

Фотографические изображения

Реагенты для количественного определения креатинкиназы (КК) в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, в вариантах исполнения

ООО «Рош Диагностика Рус»

Roche Diagnostics Rus LLC

Россия, 115114
Ул. Летниковская, дом 2, стр. 3
Бизнес-центр "Вивальди Плаза"

2, Letnikonskaya street, bld. 3
Business Center "Vivaldi Plaza"
115114, Moscow, Russia


Тел.: +7 (495) 229 6999
Факс: +7 (495) 229 6264

www.roche.ru
Тел.: +7 (495) 229 6999
Факс: +7 (495) 229 6264

www.roche.ru

Реагенты для количественного определения креатинкиназы (КК) в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, в вариант исполнения

1. Реагенты в кассете (CK/Creatine Kinase Cobas Integra/cobas c systems).

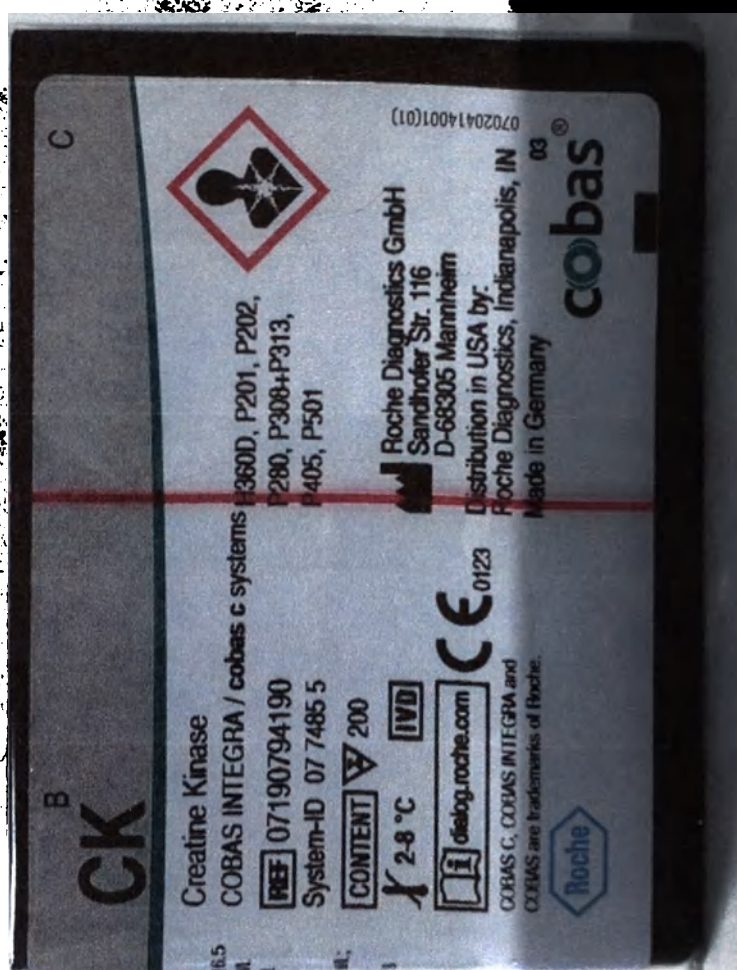

Реагенты для количественного определения креатинкиназы (КК) в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, вариант исполнения

1. Реагенты в кассете (CK/Creatine Kinase Cobas Integra/cobas c systems).



Реагенты для количественного определения креатинкиназы (КК) в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, вариант исполнения

1. Реагенты в кассете (CK/Creatine Kinase Cobas Integra/cobas c systems).



Реагенты для количественного определения креатинкиназы (КК) в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, в вариант исполнения

1. Реагенты в кассете (CK/Creatine Kinase Cobas Integra/cobas c systems).


Реагенты для количественного определения креатинкиназы (КК) в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, вариант исполнения:
1. Реагенты в кассете (CK/Creatine Kinase Cobas Integra/cobas c systems)
Регистрационное удостоверение № ГЗН 2018/7313 от _____
Срок годности см. на упаковке
Температура хранения см. на упаковке
Номер лота см. на упаковке
Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рох Дианостикус ГмбХ"),
Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия
Всё else предназначено только для диагностики in vitro
Уполномоченный представитель, производящий на территории РФ:
Общество с ограниченной ответственностью «Рох Дианостикус Рус» (ООО
«Рох Дианостикус Рус»), 107031, Москва, Трубиня площадь, д.2 Тел: +7 495
229-69-99, факс: +7 495 229-62-64, E-mail: moscow.reception.dia@roche.com
Кат. номер 07190794190

Реагенты для количественного определения креатинкиназы (КК) в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, вариант исполнения

2. Реагенты во флаконах (CK/Creatine Kinase cobas c 111),

в составе:

1. Реагент R1 во флаконе, 2 шт.
2. Реагент SR во флаконе, 2 шт.
3. Инструкция по применению.

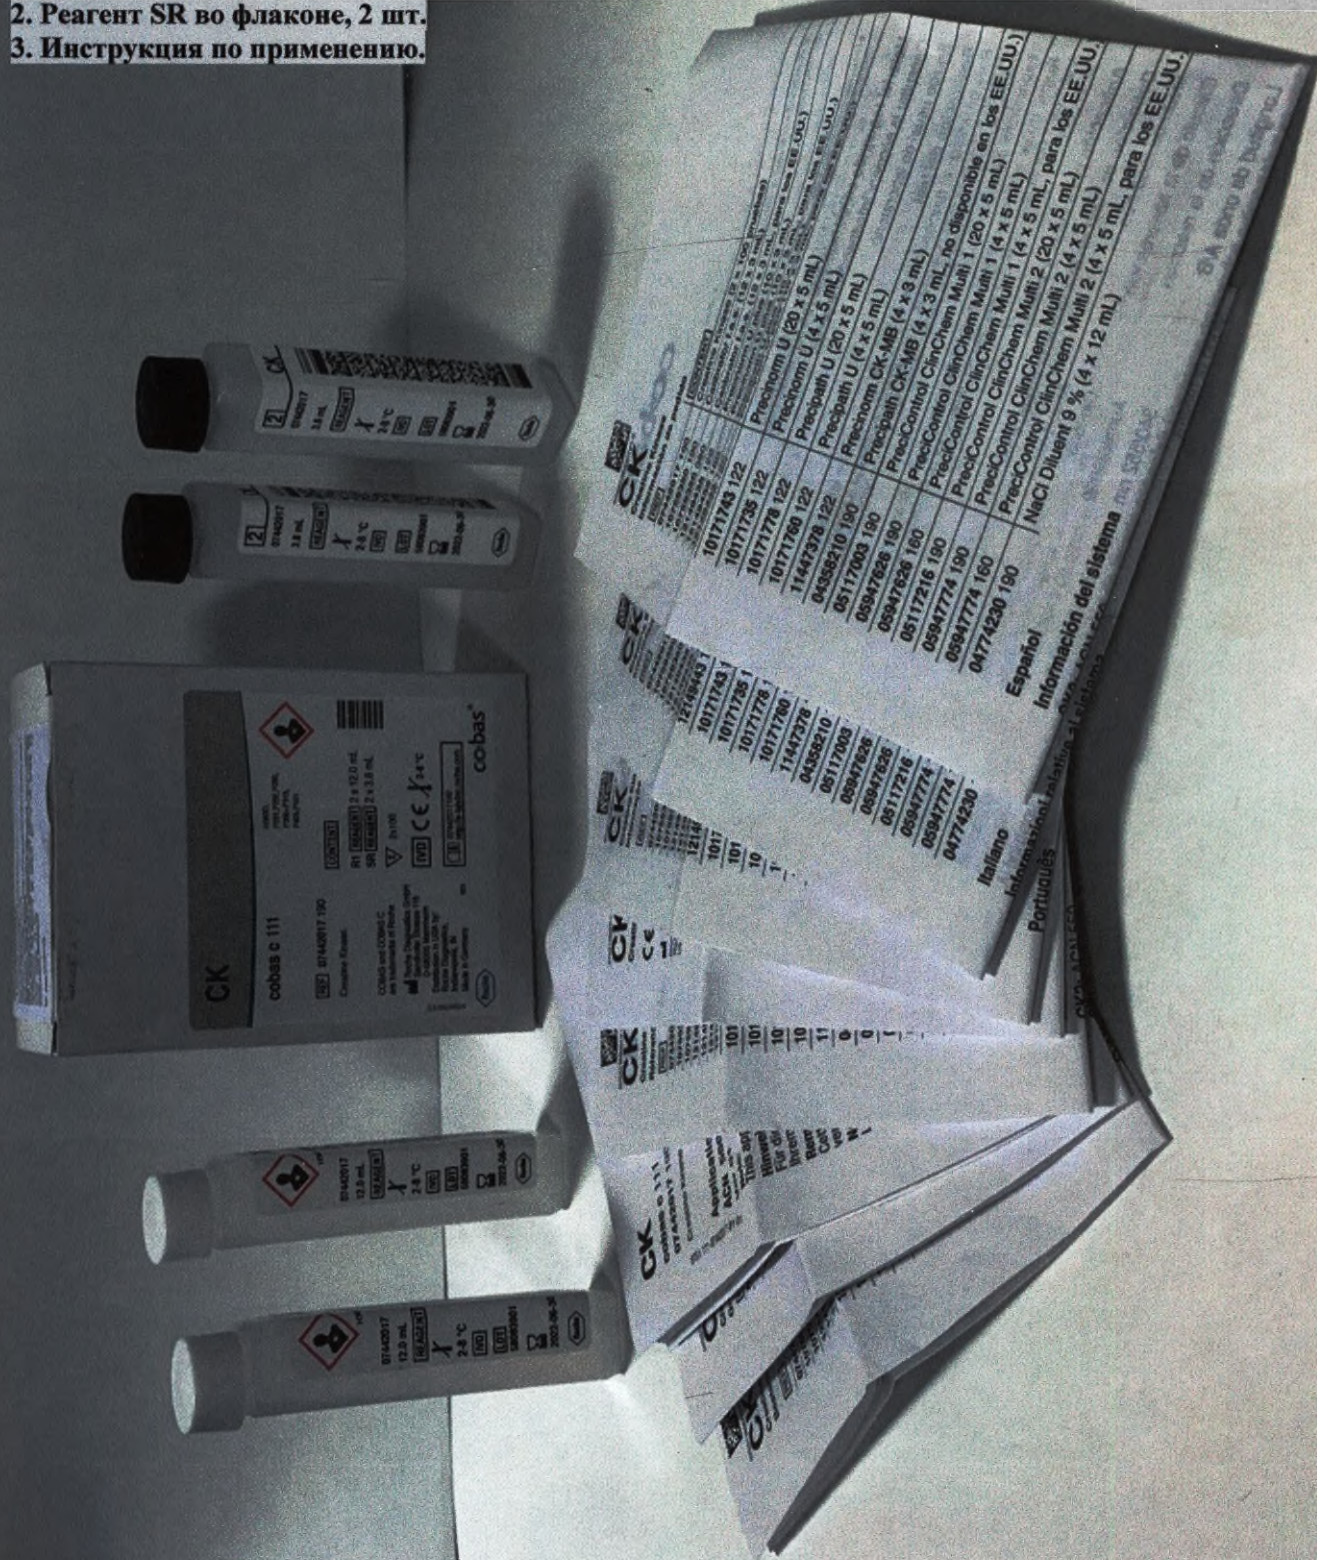


Реагенты для количественного определения креатинкиназы (КК) в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, вариант исполнения

2. Реагенты во флаконах (СК/Creatine Kinase cobas c 111),

в составе:


1. Реагент R1 во флаконе, 2 шт.
2. Реагент SR во флаконе, 2 шт.
3. Инструкция по применению.

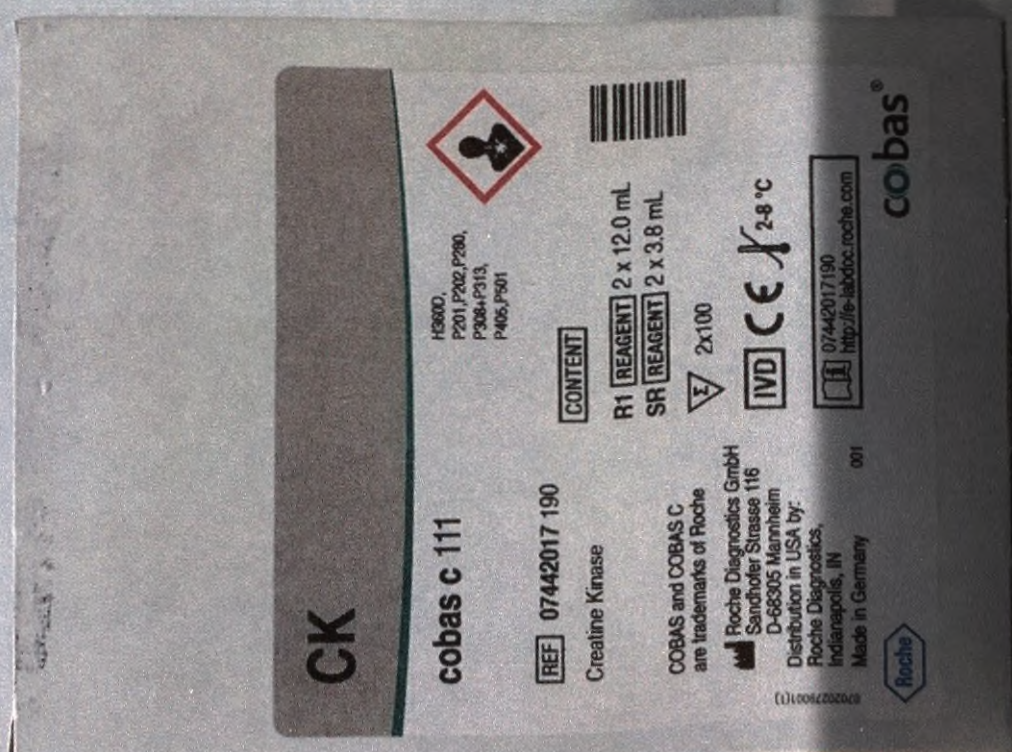

Реагенты для количественного определения креатинкиназы (КК) в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, вариант исполнения

2. Реагенты во флаконах (CK/Creatine Kinase cobas c 111),
в составе:


1. Реагент R1 во флаконе, 2 шт.
2. Реагент SR во флаконе, 2 шт.
3. Инструкция по применению.

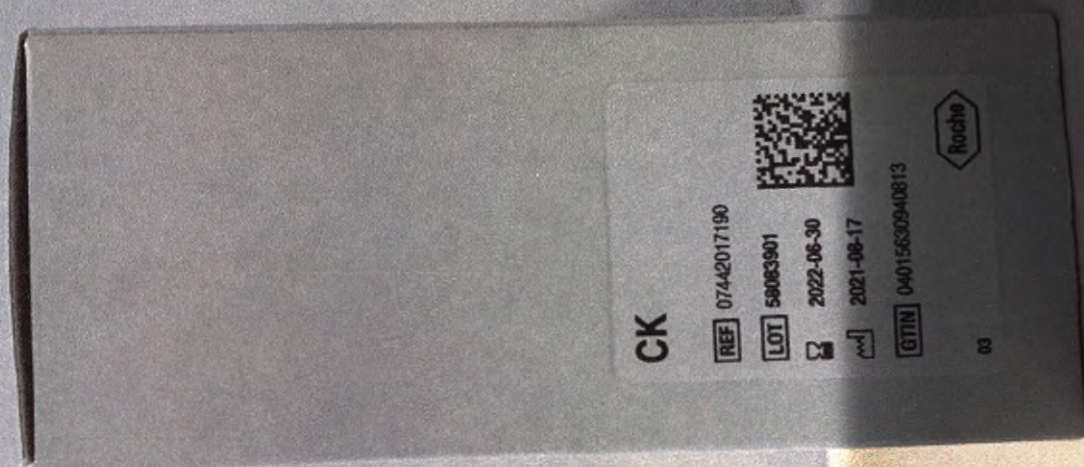

Реагенты для количественного определения креатинкиназы (КК) в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, вариант исполнения

2. Реагенты во флаконах (СК/Creatine Kinase cobas c 111),
в составе:

1. Реагент R1 во флаконе, 2 шт.
2. Реагент SR во флаконе, 2 шт.
3. Инструкция по применению.

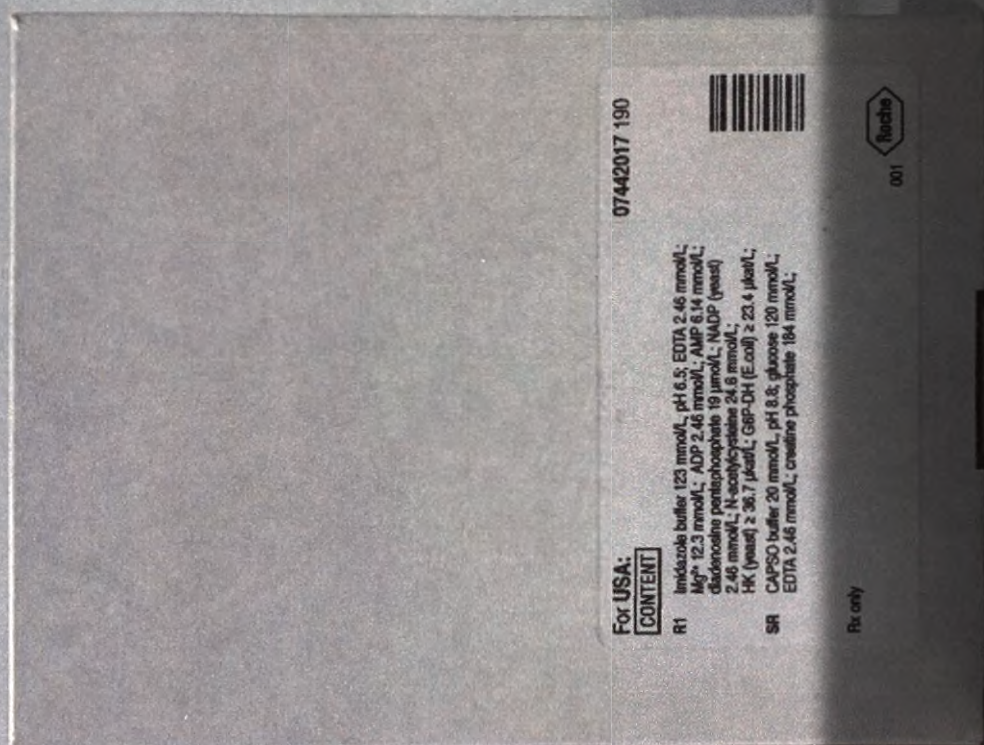

Реагенты для количественного определения креатинкиназы (КК) в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, вариант исполнения

2. Реагенты во флаконах (CK/Creatine Kinase cobas c 111),
в составе:

1. Реагент R1 во флаконе, 2 шт.
2. Реагент SR во флаконе, 2 шт.
3. Инструкция по применению.

Реагенты для количественного определения креатинкиназы (КК) в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, вариант исполнения:

2. Реагенты во флаконах (CK/Creatine Kinase cobas c 111), в составе:

1. Реагент R1 во флаконе, 2 шт.
2. Реагент SR во флаконе, 2 шт.
3. Инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2018/7313 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Roche Diagnostics GmbH"), Sandhofer Strasse 1
68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro


Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва
Трубинская площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64, E-mail: posonov.rosser@roche.com

Кат. номер 07442017190

Реагенты для количественного определения креатинкиназы (КК) в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, вариант исполнения

2. Реагенты во флаконах (СК/Creatine Kinase cobas c 111),

Реагент R1 во флаконе, 2 шт.

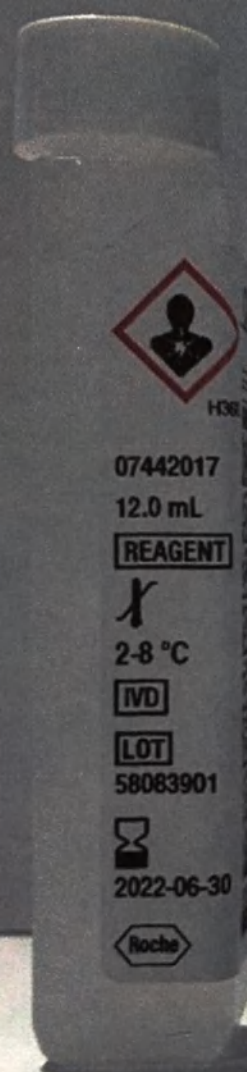

Реагенты для количественного определения креатинкиназы (КК) в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, вариант исполнения

Реагенты для количественного определения креатинкиназы (КК) в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, вариант исполнения

2. Реагенты во флаконах (СК/Creatine Kinase cobas c 111),


Реагент R1 во флаконе, 2 шт.



Реагенты для количественного определения креатинкиназы (КК) в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, вариант исполнения

2. Реагенты во флаконах (СК/Creatine Kinase cobas c 111),


Реагент SR во флаконе, 2 шт.

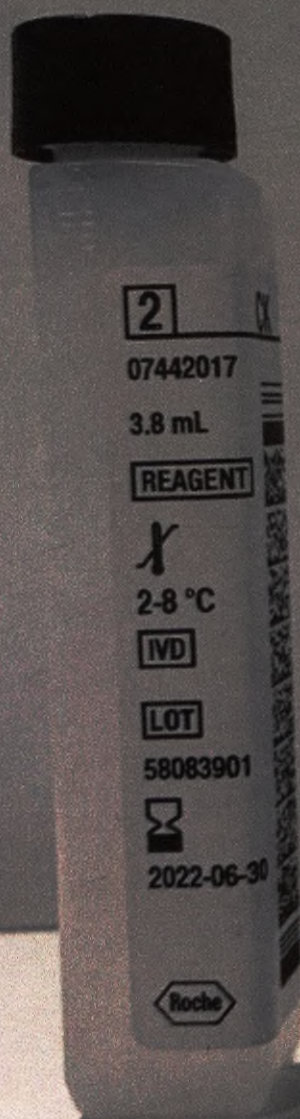

Реагенты для количественного определения креатинкиназы (КК) в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, вариант исполнения

2. Реагенты во флаконах (СК/Creatine Kinase cobas c 111),


Реагент SR во флаконе, 2 шт.

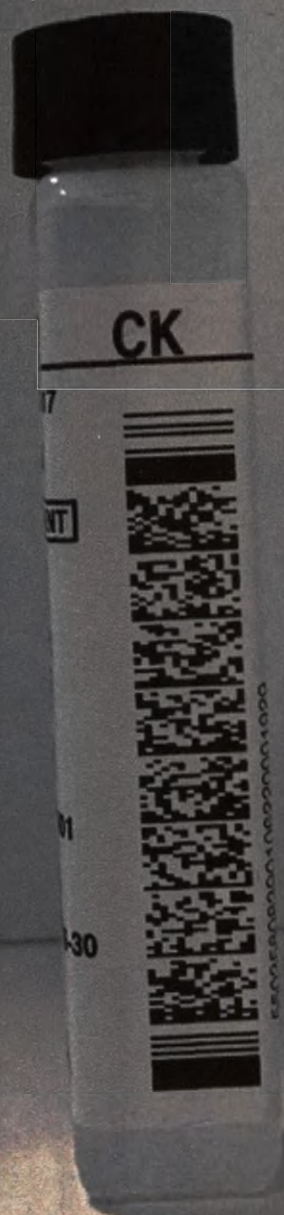

Реагенты для количественного определения креатинкиназы (КК) в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, вариант исполнения


2. Реагенты во флаконах (СК/Creatine Kinase cobas c 111),

Реагент SR во флаконе, 2 шт.

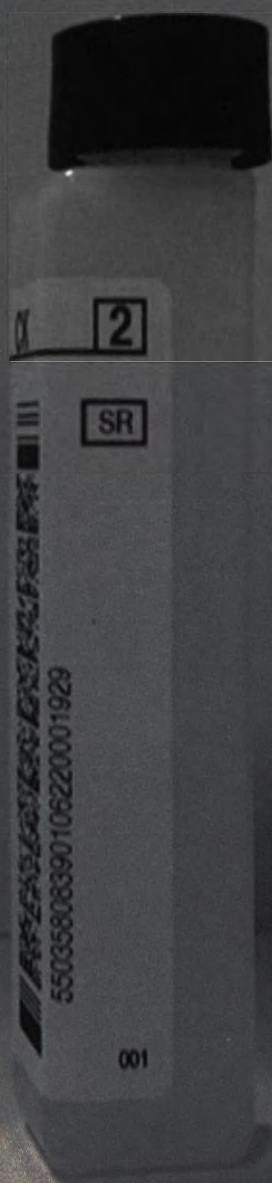


Реагенты для количественного определения креатинкиназы (КК) в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, вариант исполнения

3 Реагенты в кассете (CK/Creatine Kinase cobas c systems)

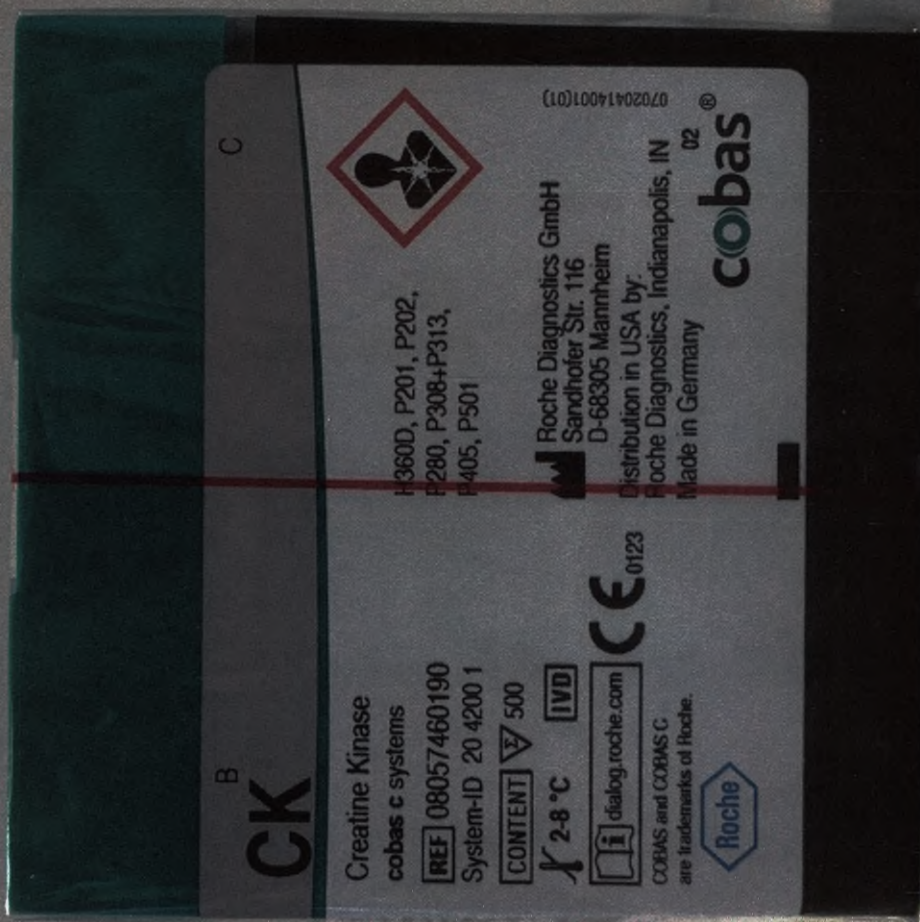

Реагенты для количественного определения креатинкиназы (КК) в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, вариант исполнения

3 Реагенты в кассете (CK/Creatine Kinase cobas c systems)

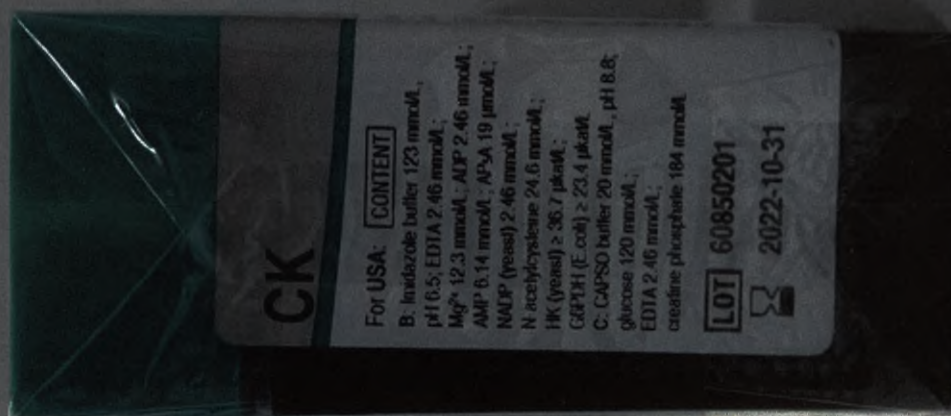

Реагенты для количественного определения креатинкиназы (КК) в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, вариант исполнения

3 Реагенты в кассете (CK/Creatine Kinase cobas c systems)



Реагенты для количественного определения креатинкиназы (КК) в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, вариант исполнения

3 Реагенты в кассете (CK/Creatine Kinase cobas c systems)

Реагенты для количественного определения креатинкиназы (КК) в сыворотке и плазме крови человека на анализаторах и модулях биохимических Cobas Integra и Roche/Hitachi cobas c, вариант исполнения:
3. Реагенты в кассете (CK/Creatine Kinase cobas c systems).

Регистрационное удостоверение № ГЭН 2018/7313 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostica GmbH» ("Roche Diagnostica GmbH"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Использование предназначено только для диагностики *in vitro*

Уполномоченный представитель: производители на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубинская площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.registration_dia@roche.com

Кат. номер 08057460190



Ходова Ю.П.

по доверенности
от 11.02.2022 г.

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
20 листа (ов)