
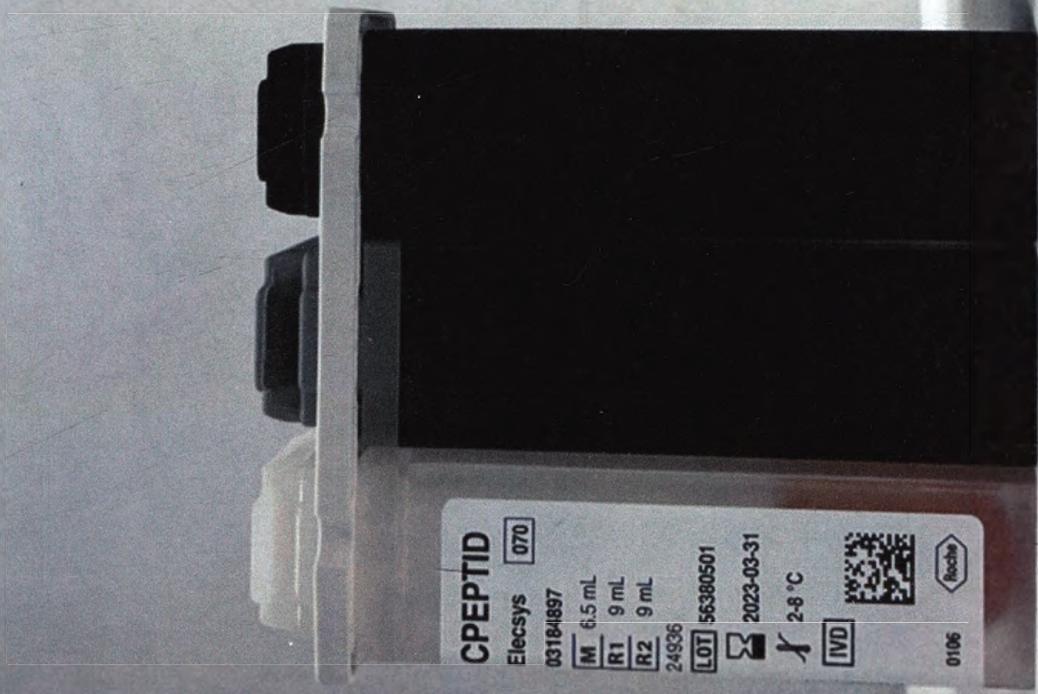



Фотографические изображения

Реагенты в кассете для количественного определения содержания С-пептида иммунохемилюминесцентным методом в моче, сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys C-Peptide), в вариантах исполнения

реагенты в кассете для количественного определения содержания С-пептида иммунохемилюминесцентным методом в моче, сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys C-Peptide Elecsys and cobas e analyzers/CPEPTID)

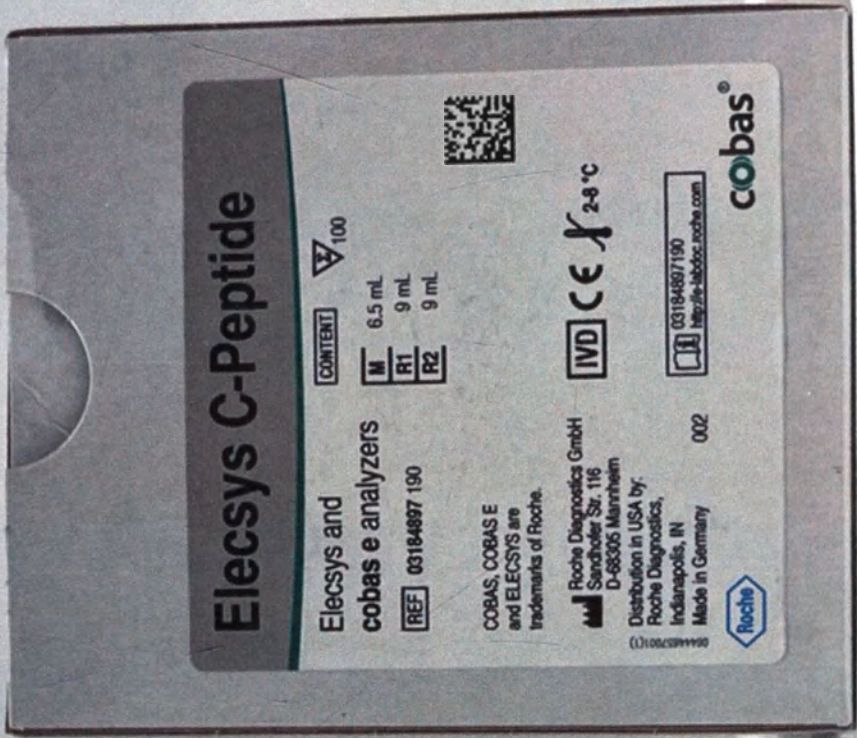

Реагенты в кассете для количественного определения содержания С-пептида иммунохемилюминесцентным методом в моче, сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys C-Peptide Elecsys and cobas e analyzers/CPEPTID)

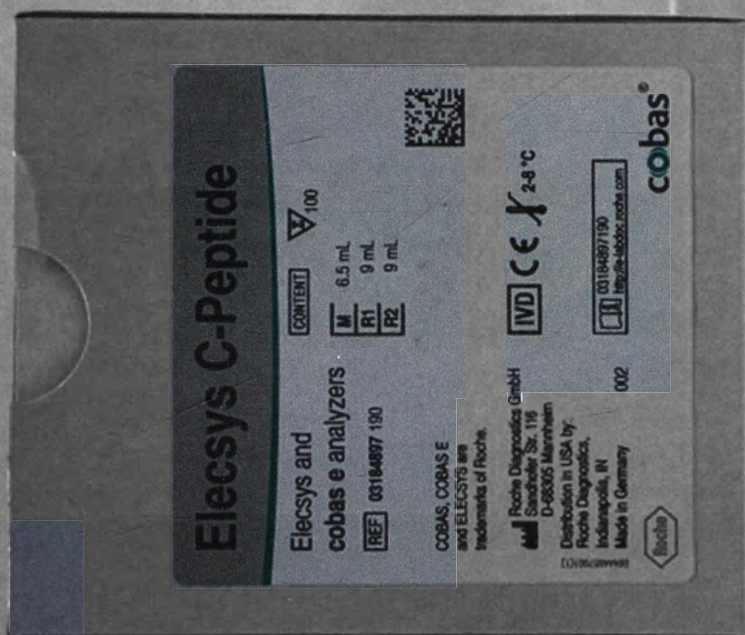

Реагенты в кассете для количественного определения содержания С-пептида иммунохемилюминесцентным методом в моче, сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys C-Peptide Elecsys and cobas e analyzers/CPEPTID)



1. Реагенты в кассете для количественного определения содержания С-пептида иммунохемилюминесцентным методом в моче, сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys C-Peptide Elecsys and cobas e analyzers/CPEPTID)

Реагенты в кассете для количественного определения содержания С-пептида иммунохемилюминесцентным методом в моче, сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys C-Peptide Elecsys and cobas e analyzers/CPEPTID)

Регистрационное удостоверение № 2020/12695 от _____

Срок годности см. на упаковке

Дату производства см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Roche Diagnostik IvoX"), Sandhofer Strasse 116, 68305

Mannheim, Germany, Германия

Исключительно только для диагностики *in vitro*

Уполномоченный представитель на территории РФ: Общество с ограниченной

ответственностью «Рос Диалогтика Рус» (ООО «Рос Диалогтика Рус»), 107031, Москва, Трубная

площадь, д.2 Тел. +7 495 229-62-64, факс: +7 495 229-62-64, E-mail: moscow.registration2_dis@roche.com


Инструкция по применению на русском языке на бумажном носителе предоставляется отдельно (для

запроса необходимо обратиться к уполномоченному представителю на территории РФ, контакты


см. выше)

Кат. номер 03184897190


1. Реагенты в кассете для количественного определения содержания С-пептида иммунохемилюминесцентным методом в моче, сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys C-Peptide Elecsys and cobas e analyzers/CPEPTID)

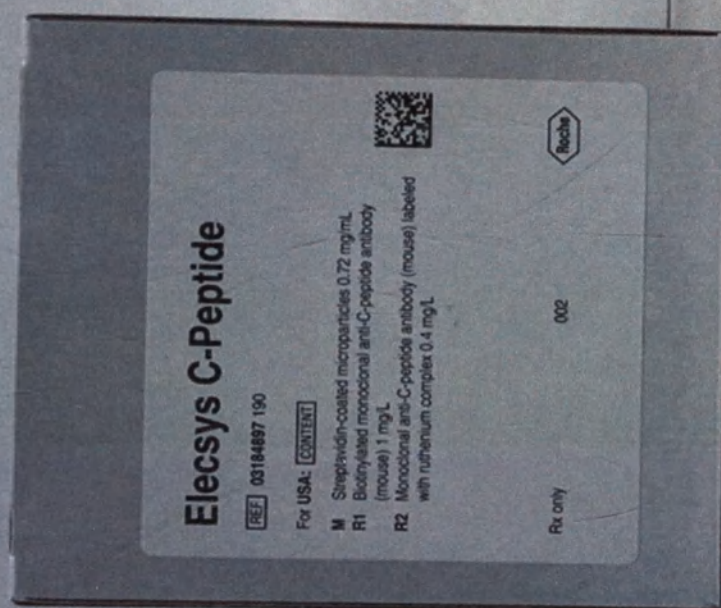

Реагенты в кассете для количественного определения содержания С-пептида иммунохемилюминесцентным методом в моче, сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys C-Peptide Elecsys and cobas e analyzers/CPEPTID)

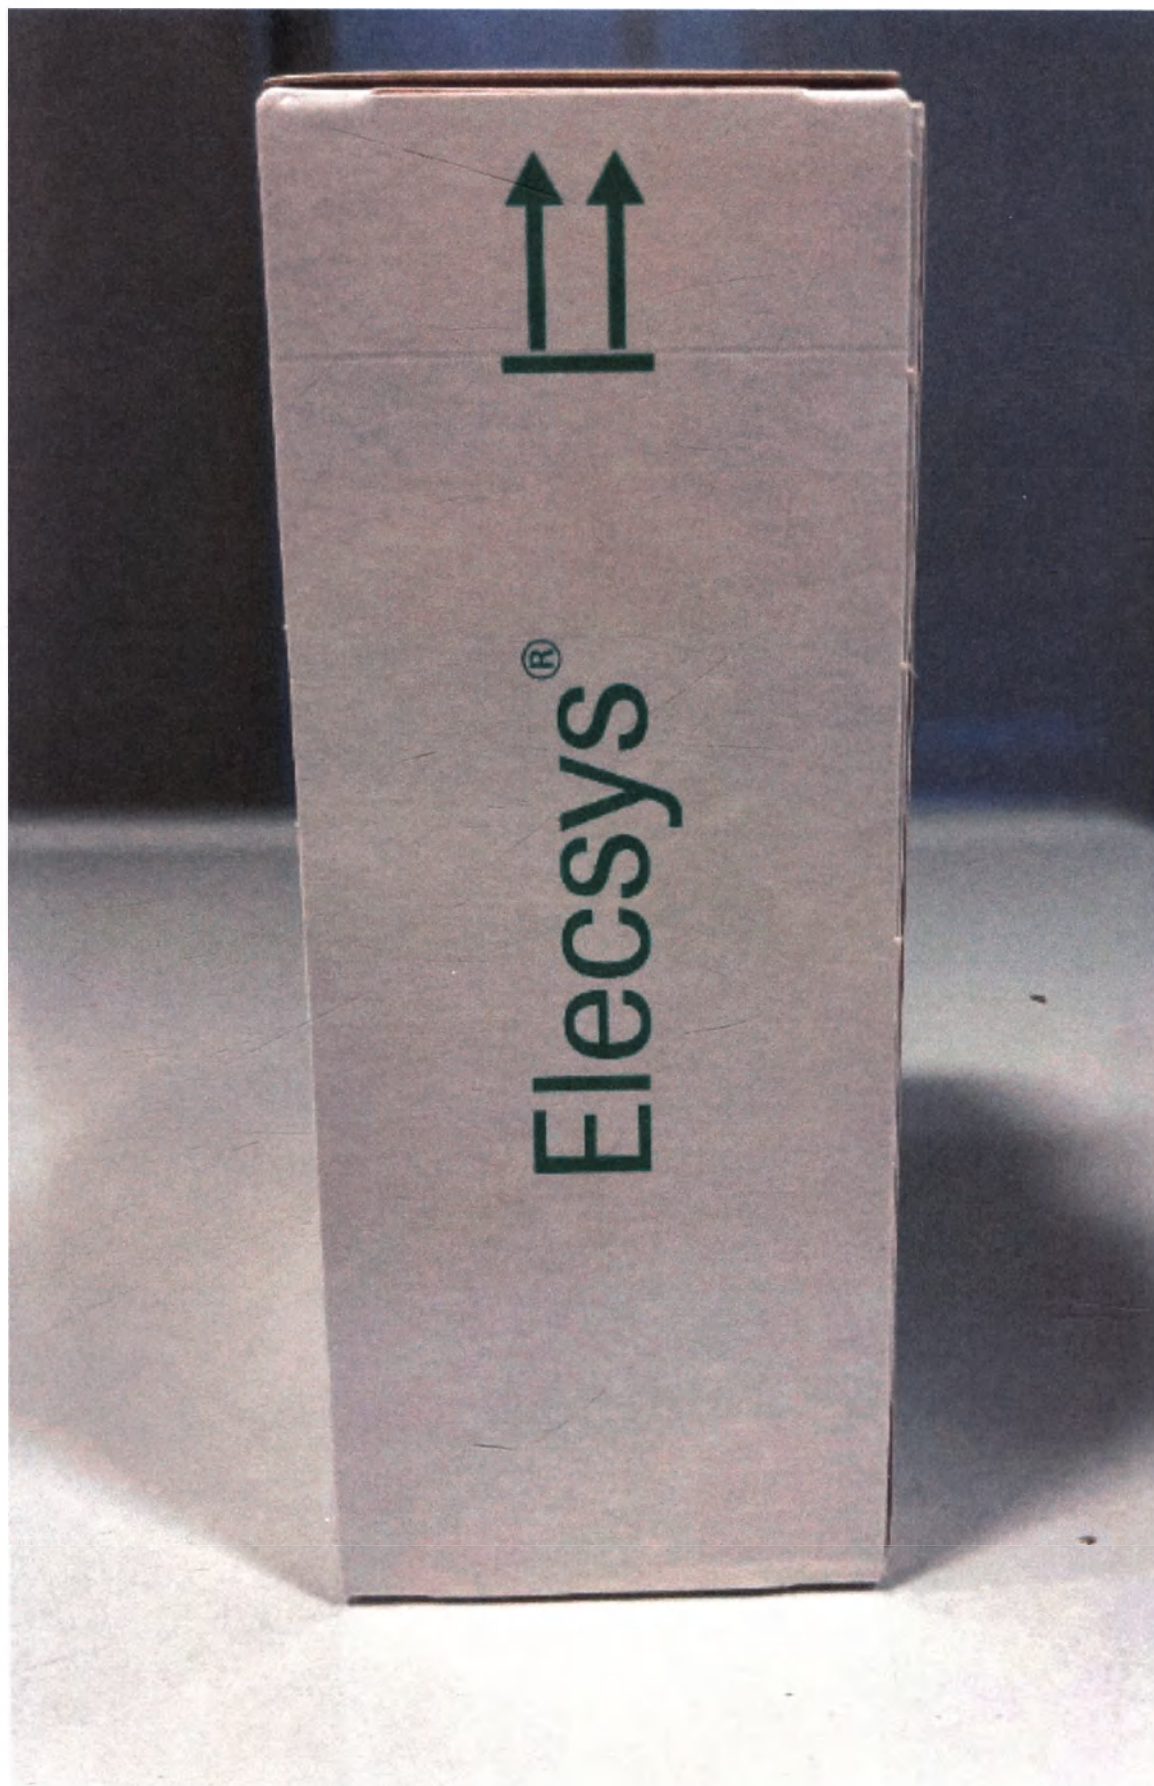

1. Реагенты в кассете для количественного определения содержания С-пептида иммунохемилюминесцентным методом в моче, сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys C-Peptide Elecsys and cobas e analyzers/CPEPTID)

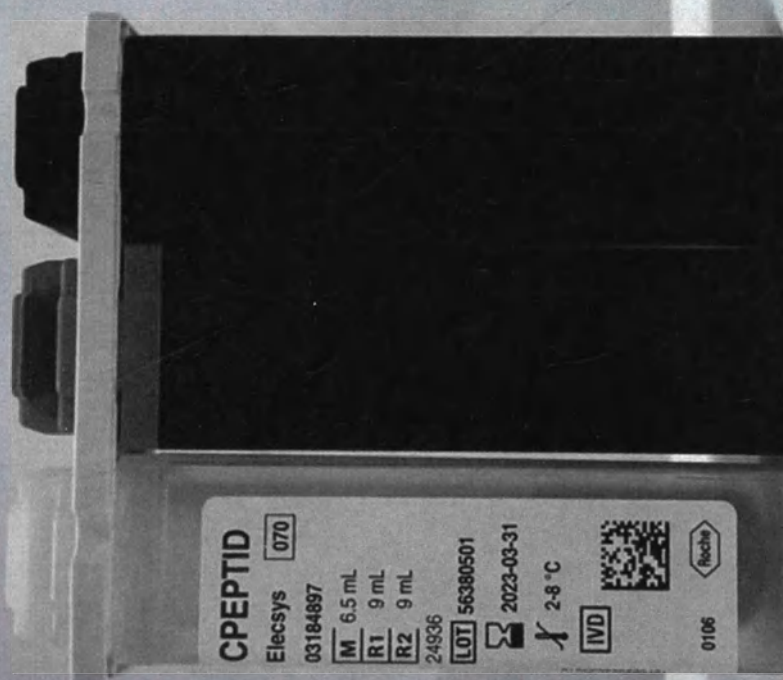


Реагенты в кассете для количественного определения содержания С-пептида иммунохемилюминесцентным методом в моче, сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys C-Peptide Elecsys and cobas e analyzers/CPEPTID)



Реагенты в кассете для количественного определения содержания С-пептида иммунохемилюминесцентным методом в моче, сыворотке и плазме крови на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys C-Peptide Elecsys and cobas e analyzers/CPEPTID)



Реагенты в кассете для количественного определения содержания С-пептида иммунохемилюминесцентным методом в моче, сыворотке и плазме крови на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys C-Peptide cobas e analyzers/CPEPTID)

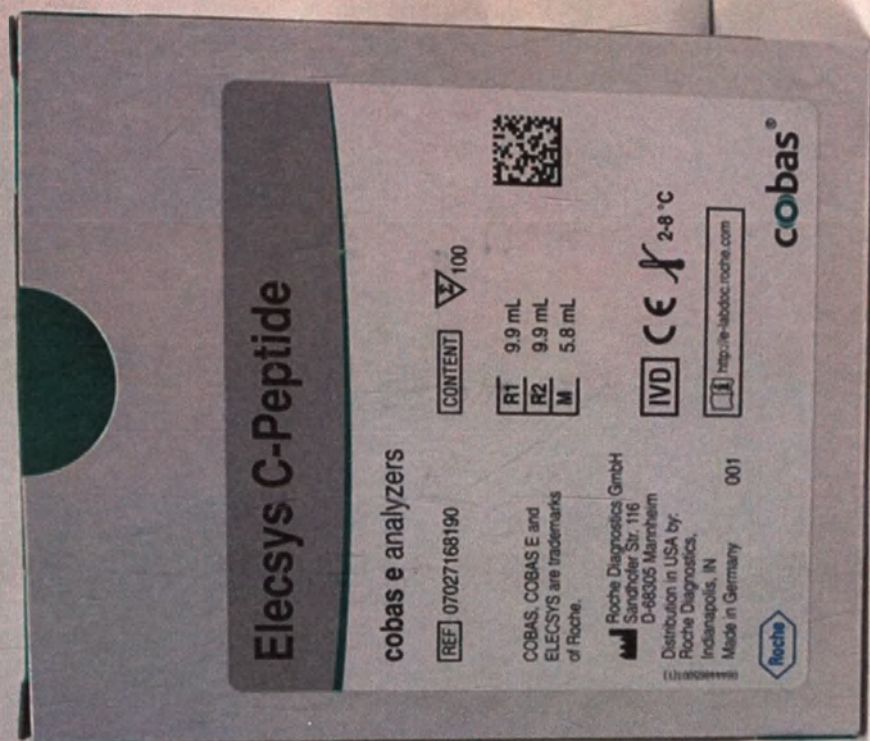


2. Реагенты в кассете для количественного определения содержания С-пептида иммунохемилюминесцентным методом в моче, сыворотке и плазме крови на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys C-Peptide cobas e analyzers/CPEPTID)




2. Реагенты в кассете для количественного определения содержания С-пептида иммунохемилюминесцентным методом в моче, сыворотке и плазме крови на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys C-Peptide cobas e analyzers/CPEPTID)



Реагенты в кассете для количественного определения содержания С-пептида иммунохемилюминесцентным методом в моче, сыворотке и плазме крови на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys C-Peptide cobas e analyzers/CPEPTID)

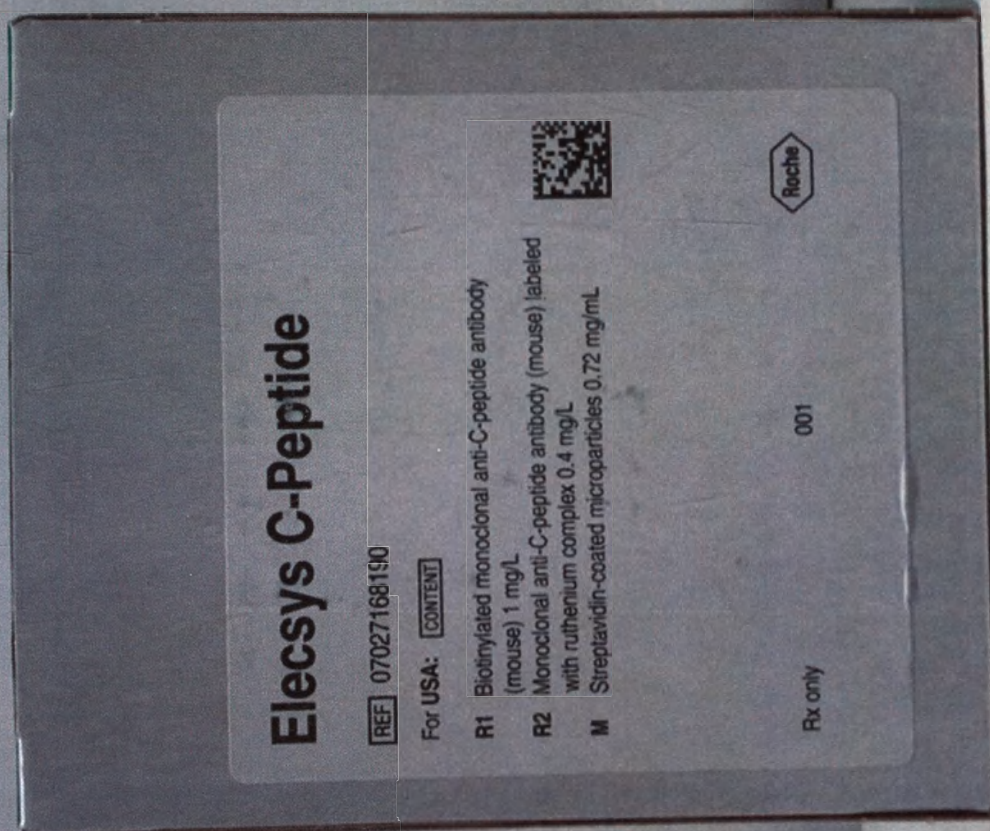

Реагенты в кассете для количественного определения содержания С-пептида иммунохемилюминесцентным методом в моче, сыворотке и плазме крови на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys C-Peptide cobas e analyzers/CPEPTID)

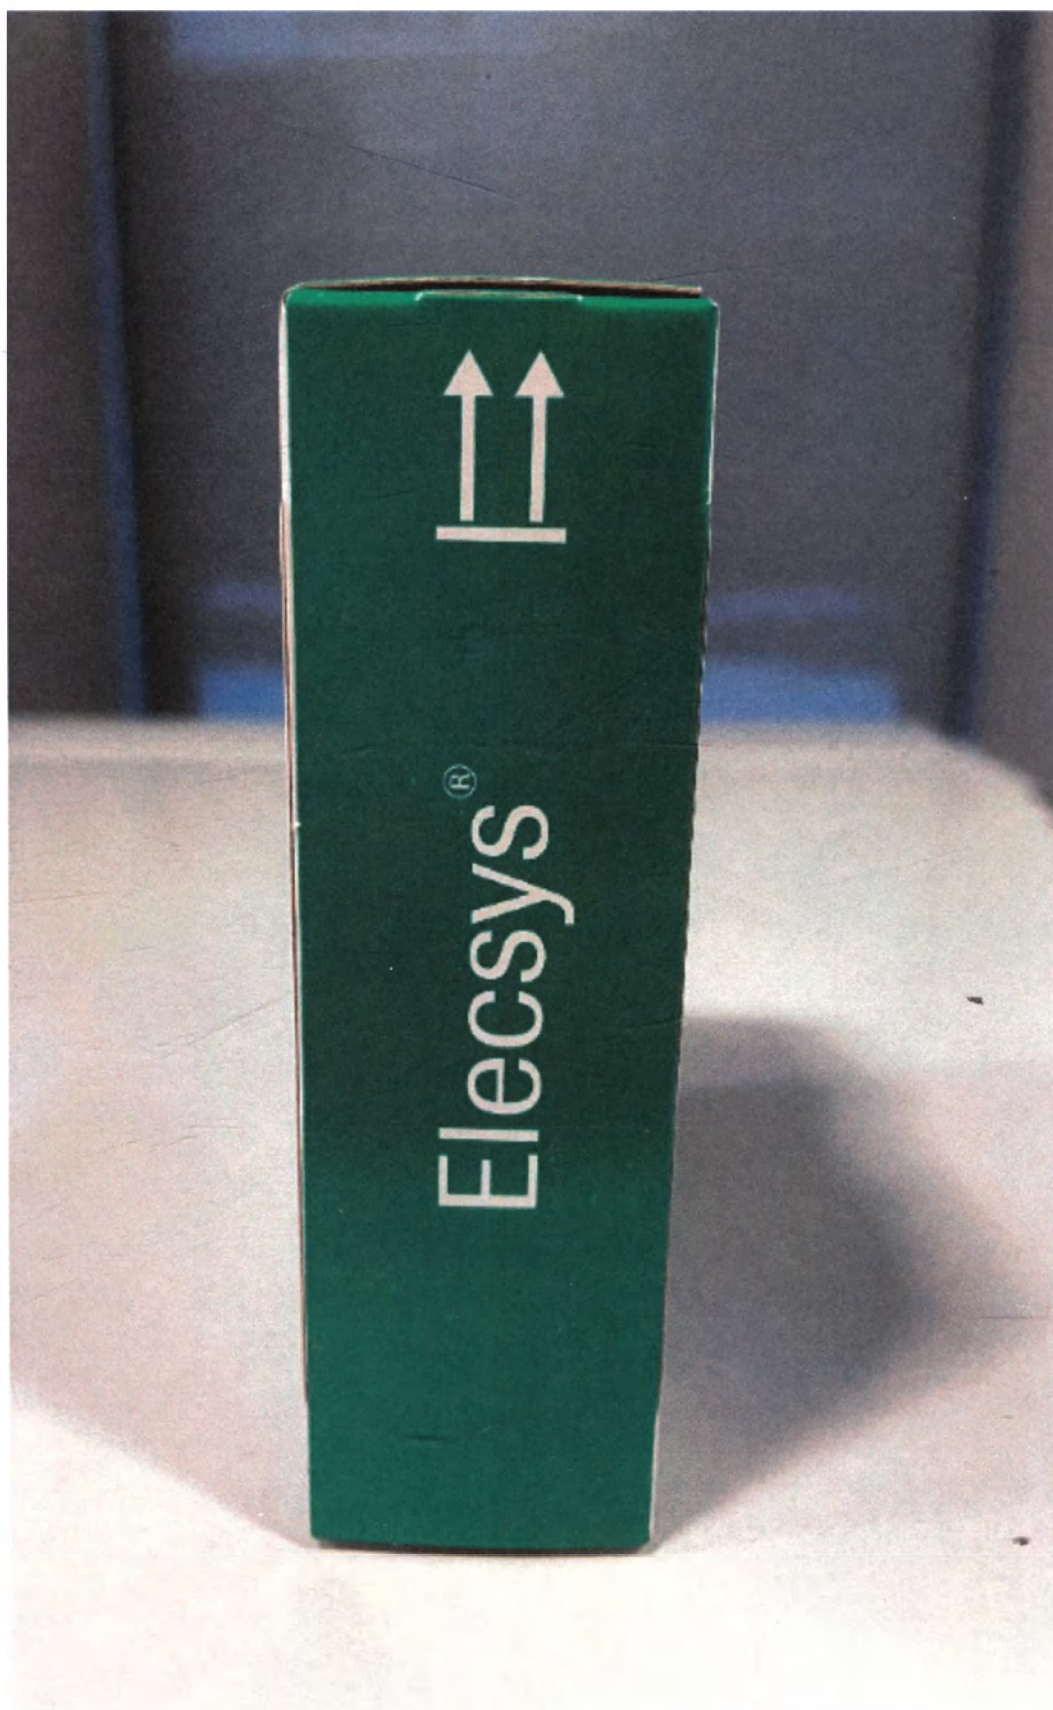

Реагенты в кассете для количественного определения содержания С-пептида иммунохемилюминесцентным методом в моче, сыворотке и плазме крови на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys C-Peptide cobas e analyzers/CPEPTID)

Реагенты в кассете для количественного определения содержания С-пептида иммунохемилюминесцентным методом в моче, сыворотке и плазме крови на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys C-Peptide cobas e analyzers/CPEPTID)

Регистрационное удостоверение № 2020/12695 от _____

Срок годности см. на упаковке

Дату производства см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Roche Diagnostika GmbH"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Использовать только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель: «РосДиagnostика Рус» (ООО «РосДиagnostика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2. Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.registration2.diag@roche.com


Инструкция по применению на русском языке на бумажном носителе предоставляется отдельно (для запроса необходимо обратиться к уполномоченному представителю на территории РФ, контакты см. выше)

Кат. номер 07027168190

2. Реагенты в кассете для количественного определения содержания С-пептида иммунохемилюминесцентным методом в моче, сыворотке и плазме крови на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys C-Peptide cobas e analyzers/CPEPTID)



Реагенты в кассете для количественного определения содержания С-пептида иммунохемилюминесцентным методом в моче, сыворотке и плазме крови на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys C-Peptide cobas e analyzers/CPEPTID)

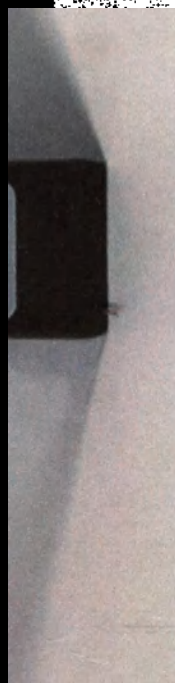

Реагенты в кассете для количественного определения содержания С-пептида иммунохемилюминесцентным методом в моче, сыворотке и плазме крови на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys C-Peptide cobas e analyzers/CPEPTID)



Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

19 листа (ов)



по доверенности
от 11.02.2022 г.