



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Лидкор»

А. И. Улыбин

«13» сентября 2022 г.

**Макеты этикеток
тары потребительской, промежуточной и транспортной
медицинского изделия**

«Система для пулирования компонентов крови»
по ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 в вариантах исполнения

«Система для пулирования компонентов крови» по ТУ 32.50.13-024-70440344-2017, вариант исполнения без фильтра «Плазмавир-1»

Этикетка тары потребительской



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

**Система для пулирования
компонентов крови**

без фильтра «Плазмавир-1»

ТУ 32.50.13-024-70440344-2017
ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.

LOT




REF



Нетоксично







Хранение





Место производства:



ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А
Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Этикетка контейнера полимерного




ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru




Контейнер для компонентов крови
ПУ №РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г. Объем: 1500 мл

ABO, Rh-фактор

Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови. Не применять при наличии признаков повреждения.



Нетоксично





-25°C
40°C
Хранение



LOT



Место производства:



ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А
Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Макет этикетки тары промежуточной



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

**Система для пулирования
компонентов крови**

без фильтра «Плазмавир-1»

ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.

LOT



#

ШТ.



Нетоксично





REF

Место производства:



ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А
Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Макет этикетки тары транспортной



LEADCORE



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

REF

**Система для пулирования компонентов крови
без фильтра «Плазмавир-1»**

ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 РУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.

LOT



шт.

Брутто:

кг

STERILE EO

Нетоксично



+5°C — +40°C
Хранение

+50°C — -50°C
Транспортировка



75 кг
max



Место производства:

ООО «Виробан»

141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А

Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

«Система для пулирования компонентов крови» по ТУ 32.50.13-024-70440344-2017, вариант исполнения без фильтра «Плазмавир-2»

Этикетка тары потребительской

 ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

Система для пулирования компонентов крови

без фильтра «Плазмавир-2»

ТУ 32.50.13-024-70440344-2017
ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.

LOT  **REF**

STERILE EO
Нетоксично

Место производства:

 ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А
Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Этикетка контейнера полимерного

 ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

Контейнер для компонентов крови
ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г. Объем: 1500 мл

ABO, Rh-фактор

Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови. Не применять при наличии признаков повреждения.

STERILE EO
Нетоксично

LOT 

Место производства:

 ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А
Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Макет этикетки тары промежуточной

 ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

Система для пулирования компонентов крови

без фильтра «Плазмавир-2»

ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.

LOT   **ШТ.**

STERILE EO
Нетоксично

REF

Место производства:

 ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А
Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru



LEADCORE



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

REF

Система для пулирования компонентов крови без фильтра «Плазмавир-2»

ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 РУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.

LOT



шт.

Брутто:

кг

STERILE EO

Нетоксично



+5°C — +40°C
Хранение

+50°C — -50°C
Транспортировка



75 кг
max



Место производства:

ООО «Виробан»

141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А

Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

«Система для пулирования компонентов крови» по ТУ 32.50.13-024-70440344-2017, вариант исполнения с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-1»

Этикетка тары потребительской



LEADCORE

ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

**Система для пулирования
компонентов крови**

**с фильтром лейкоцитарным
«Тромбосейв-1»**

ТУ 32.50.13-024-70440344-2017
ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.

LOT

⏰

REF


Нетоксично








Хранить







Место производства:



ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А
Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Этикетка контейнера полимерного



LEADCORE

ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



Контейнер для компонентов крови
ПУ №РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г. Объем: 1800 мл


	ABO, Rh-фактор
--	-----------------------


Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови. Не применять при наличии признаков повреждения.


Нетоксично








Хранить







Место производства:



ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А
Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Макет этикетки тары промежуточной



LEADCORE

ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

**Система для пулирования
компонентов крови**

с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-1»


ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.

LOT

⏰

#

шт.


Нетоксично









REF

Место производства:



ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А
Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru



LEADCORE



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

REF

**Система для пулирования компонентов крови
с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-1»**

ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 РУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.

LOT



шт.

Брутто: кг

STERILE EO

Нетоксично



+5°C — +40°C
Хранение

-50°C — +50°C
Транспортировка



Место производства:

ООО «Виробан»

141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А

Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

«Система для пулирования компонентов крови» по ТУ 32.50.13-024-70440344-2017, вариант исполнения с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-2»

Этикетка тары потребительской



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

**Система для пулирования
компонентов крови**

**с фильтром лейкоцитарным
«Тромбосейв-2»**

ТУ 32.50.13-024-70440344-2017
ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.

LOT



REF

STERILE EO
Нетоксично









Хранить
в темноте



Место производства:



ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А
Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Этикетка контейнера полимерного



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102,
Свердловская область, г. Екатеринбург
ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



Контейнер для компонентов крови
ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г. Объем: 1800 мл

	ABO, Rh-фактор
--	-----------------------

Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови. Не применять при наличии признаков повреждения.

STERILE EO
Нетоксично









Хранить
в темноте



Место производства:



ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А
Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Макет этикетки тары промежуточной



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

**Система для пулирования
компонентов крови**

с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-2»

ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.

LOT



#

ШТ.

STERILE EO
Нетоксично







REF



Место производства:



ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А
Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru



LEADCORE



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область,

г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

REF

Система для пулирования компонентов крови с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-2»

ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 РУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.

LOT



шт.

Брутто: кг

STERILE EO

Нетоксично



+5°C
+40°C
Хранение

+50°C
-50°C
Транспортировка



75 кг
max



Место производства:

ООО «Виробан»

141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А

Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

«Система для пулирования компонентов крови» по ТУ 32.50.13-024-70440344-2017, вариант исполнения с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-3»

Этикетка тары потребительской

 ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru


Система для пулирования компонентов крови

с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-3»

ТУ 32.50.13-024-70440344-2017
ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.

LOT  **REF**

STERILE EO
Нетоксично

Место производства:
 ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А
Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Этикетка контейнера полимерного

 ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

Контейнер для компонентов крови
ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г. Объем: 1800 мл

ABO, Rh-фактор

Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови. Не применять при наличии признаков повреждения.

STERILE EO
Нетоксично

LOT 

Место производства:
 ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А
Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Макет этикетки тары промежуточной

 ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

Система для пулирования компонентов крови

с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-3»

ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.

LOT   **ШТ.**

STERILE EO
Нетоксично

REF

Место производства:
 ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А
Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru



LEADCORE



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

REF

Система для пулирования компонентов крови с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-3»

ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 РУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.

LOT



ШТ.

Брутто: кг

STERILE EO

Нетоксично



+5°C
+40°C
Хранение

+50°C
-50°C
Транспортировка



**75 кг
max**



Место производства:

ООО «Виробан»

141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А

Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

«Система для пулирования компонентов крови» по ТУ 32.50.13-024-70440344-2017, вариант исполнения с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-4»

Этикетка тары потребительской

	ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru
Система для пулирования компонентов крови с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-4» ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.	
LOT STERILE EO Нетоксично    +5°C Хранение	REF  Место производства:  ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Этикетка контейнера полимерного

	ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург ул. Посадская, д. 23, офис 204 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru	
Контейнер для компонентов крови ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г. Объем: 1500 мл		
		ABO, Rh-фактор
Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови. Не применять при наличии признаков повреждения.		
STERILE EO Нетоксично    +20°C Хранение не менее 5 дней	LOT 	Место производства:  ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Макет этикетки тары промежуточной

	ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru
Система для пулирования компонентов крови с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-4» ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.	
LOT STERILE EO Нетоксично     	REF Место производства:  ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru



LEADCORE



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

REF

**Система для пулирования компонентов крови
с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-4»**

ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 РУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.

LOT



шт.

Брутто: кг

STERILE EO

Нетоксично



+5°C — +40°C
Хранение

-50°C — +50°C
Транспортировка



**75 кг
max**



Место производства:

ООО «Виробан»

141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей д. 3А

Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

«Система для пулирования компонентов крови» по ТУ 32.50.13-024-70440344-2017, вариант исполнения с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-5»

Этикетка тары потребительской



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

**Система для пулирования
компонентов крови**

**с фильтром лейкоцитарным
«Тромбосейв-5»**

ТУ 32.50.13-024-70440344-2017
ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.


LOT



REF

STERILE EO
Нетоксично









Место производства:



ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А
Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Этикетка контейнера полимерного



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102,
Свердловская область, г. Екатеринбург
ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



Контейнер для компонентов крови
ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г. Объем: 1500 мл

	ABO, Rh-фактор
--	-----------------------

Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови. Не применять при наличии признаков повреждения.

STERILE EO
Нетоксично







LOT



Место производства:



ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А
Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Макет этикетки тары промежуточной



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

**Система для пулирования
компонентов крови**

с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-5»

ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.

LOT



#

шт.

STERILE EO
Нетоксично






REF

Место производства:



ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А
Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru



LEADCORE



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область,

г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204

mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

REF

Система для пулирования компонентов крови с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-5»

ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 РУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.

LOT



шт.

Брутто:

кг

STERILE EO

Нетоксично



+40°C
+5°C
Хранение

+50°C
-50°C
Транспортировка



**75 кг
max**



Место производства:

ООО «Виробан»

141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А

Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

«Система для пулирования компонентов крови» по ТУ 32.50.13-024-70440344-2017, вариант исполнения с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-6»

Этикетка тары потребительской



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



**Система для пулирования
компонентов крови**

**с фильтром лейкоцитарным
«Тромбосейв-6»**

ТУ 32.50.13-024-70440344-2017
ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.


LOT



REF

STERILE EO
Нетоксично









Место производства:



ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А
Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Этикетка контейнера полимерного



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102,
Свердловская область, г. Екатеринбург
ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



Контейнер для компонентов крови
ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г. Объем: 1500 мл

	ABO, Rh-фактор
--	-----------------------

Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена
марка группы крови. Не применять при наличии признаков
повреждения.

STERILE EO
Нетоксично






LOT



Место производства:



ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А
Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Макет этикетки тары промежуточной



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



**Система для пулирования
компонентов крови**

с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-6»

ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.

LOT



#

ШТ.

STERILE EO
Нетоксично






REF

Место производства:



ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А
Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru



LEADCORE



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

REF

**Система для пулирования компонентов крови
с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-6»**

ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 РУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.

LOT



шт.

Брутто: кг

STERILE EO

Нетоксично



+5°C — +40°C
Хранение

+50°C — -50°C
Транспортировка



Место производства:

ООО «Виробан»

141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А .

Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

«Система для пулирования компонентов крови» по ТУ 32.50.13-024-70440344-2017, вариант исполнения с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-7»

Этикетка тары потребительской

LEADCORE ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

Система для пулирования компонентов крови
с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-7»

ТУ 32.50.13-024-70440344-2017
ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.

STERILE EO Нетоксично

LOT

PHID

Место для штрих-кода

REF

Место для штрих-кода

Место производства: ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А
Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Viroban

Этикетка контейнера полимерного

LEADCORE ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

Контейнер для компонентов крови
ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г. Объем: 1800 мл

ABO, Rh-фактор

Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови. Не применять при наличии признаков повреждения.

STERILE EO Нетоксично

LOT

PHID

Место для штрих-кода

REF

Место для штрих-кода

Место производства: ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А
Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Viroban

Макет этикетки тары промежуточной

LEADCORE ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

Система для пулирования компонентов крови
с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-7»

ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.

LOT

REF

PHID

Место производства: ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А
Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Viroban



LEADCORE



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

REF

Система для пулирования компонентов крови с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-7»

ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 РУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.

STERILE EO

Нетоксично

+5°C — +40°C
Хранение

-50°C — +50°C
Транспортировка



ШТ.

Брутто: кг

LOT



место для
штрих-кода

PHID



место для
штрих-кода



Место производства:

ООО «Виробан»

141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А

Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

«Система для пулирования компонентов крови» по ТУ 32.50.13-024-70440344-2017, вариант исполнения с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-8»

Этикетка тары потребительской



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

**Система для пулирования
компонентов крови**

**с фильтром лейкоцитарным
«Тромбосейв-8»**

ТУ 32.50.13-024-70440344-2017
ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.

STERILE EO

Нетоксично

LOT

PHID

REF




Место производства:



ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А
Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Этикетка контейнера полимерного



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru



Контейнер для компонентов крови
ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г. Объем: 1800 мл

ABO, Rh-фактор

Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови. Не применять при наличии признаков повреждения.

STERILE EO

Нетоксично

LOT

PHID

REF




Место производства:



ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А
Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Макет этикетки тары промежуточной



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

**Система для пулирования
компонентов крови**

с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-8»

ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.

LOT

ШТ.

STERILE EO

Нетоксично

REF

PHID

Место производства:



ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А
Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru



LEADCORE



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

REF

Система для пулирования компонентов крови с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-8»

ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 РУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.

STERILE EO

Нетоксично

+5°C — +40°C
Хранение

-50°C — +50°C
Транспортировка



ШТ.

Брутто: кг

LOT



место для
штрих-кода

6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 2

PHID



место для
штрих-кода

6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 2




Место производства:

ООО «Виробан»

141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А

Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 21 (двадцать один) л.
Генеральный директор
ООО «Тидкор»  А.И. Улыбин



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Лидкор»



Гохгут Е.Ю.


21» декабря 2022 г.

Фотографические изображения и макет маркировки медицинского изделия


**«Система для пулирования компонентов крови»
по ТУ 32.50.13-024-70440344-2017.**

«Система для пулирования компонентов крови» по ТУ 32.50.13-024-70440344-2017, вариант исполнения без фильтра «Плазмавир-1»

I. Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

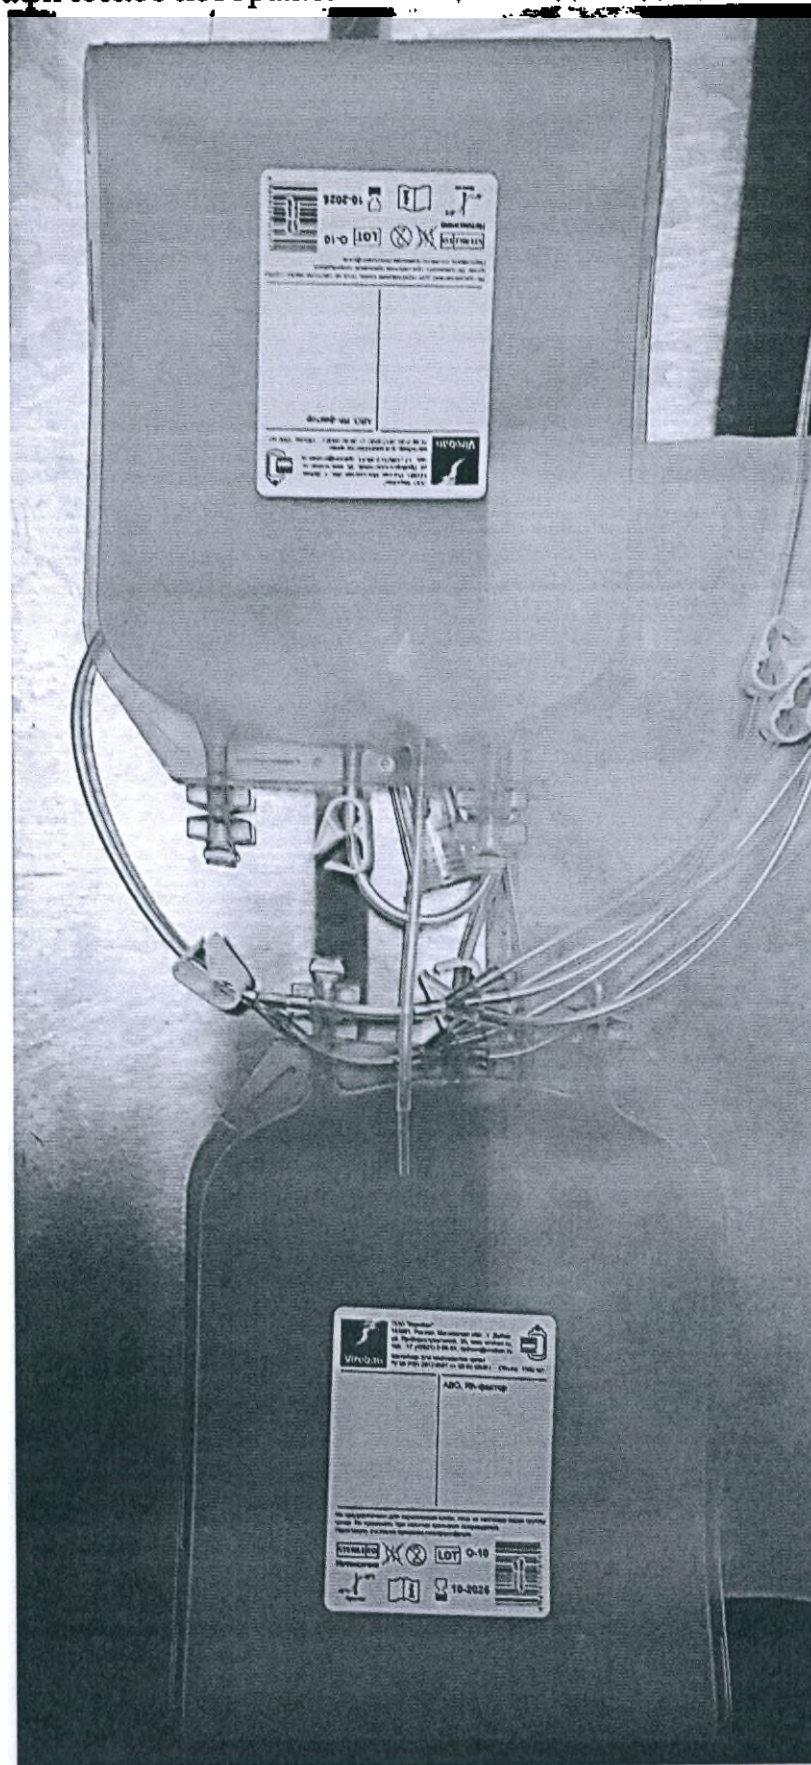

II. Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия в упаковке

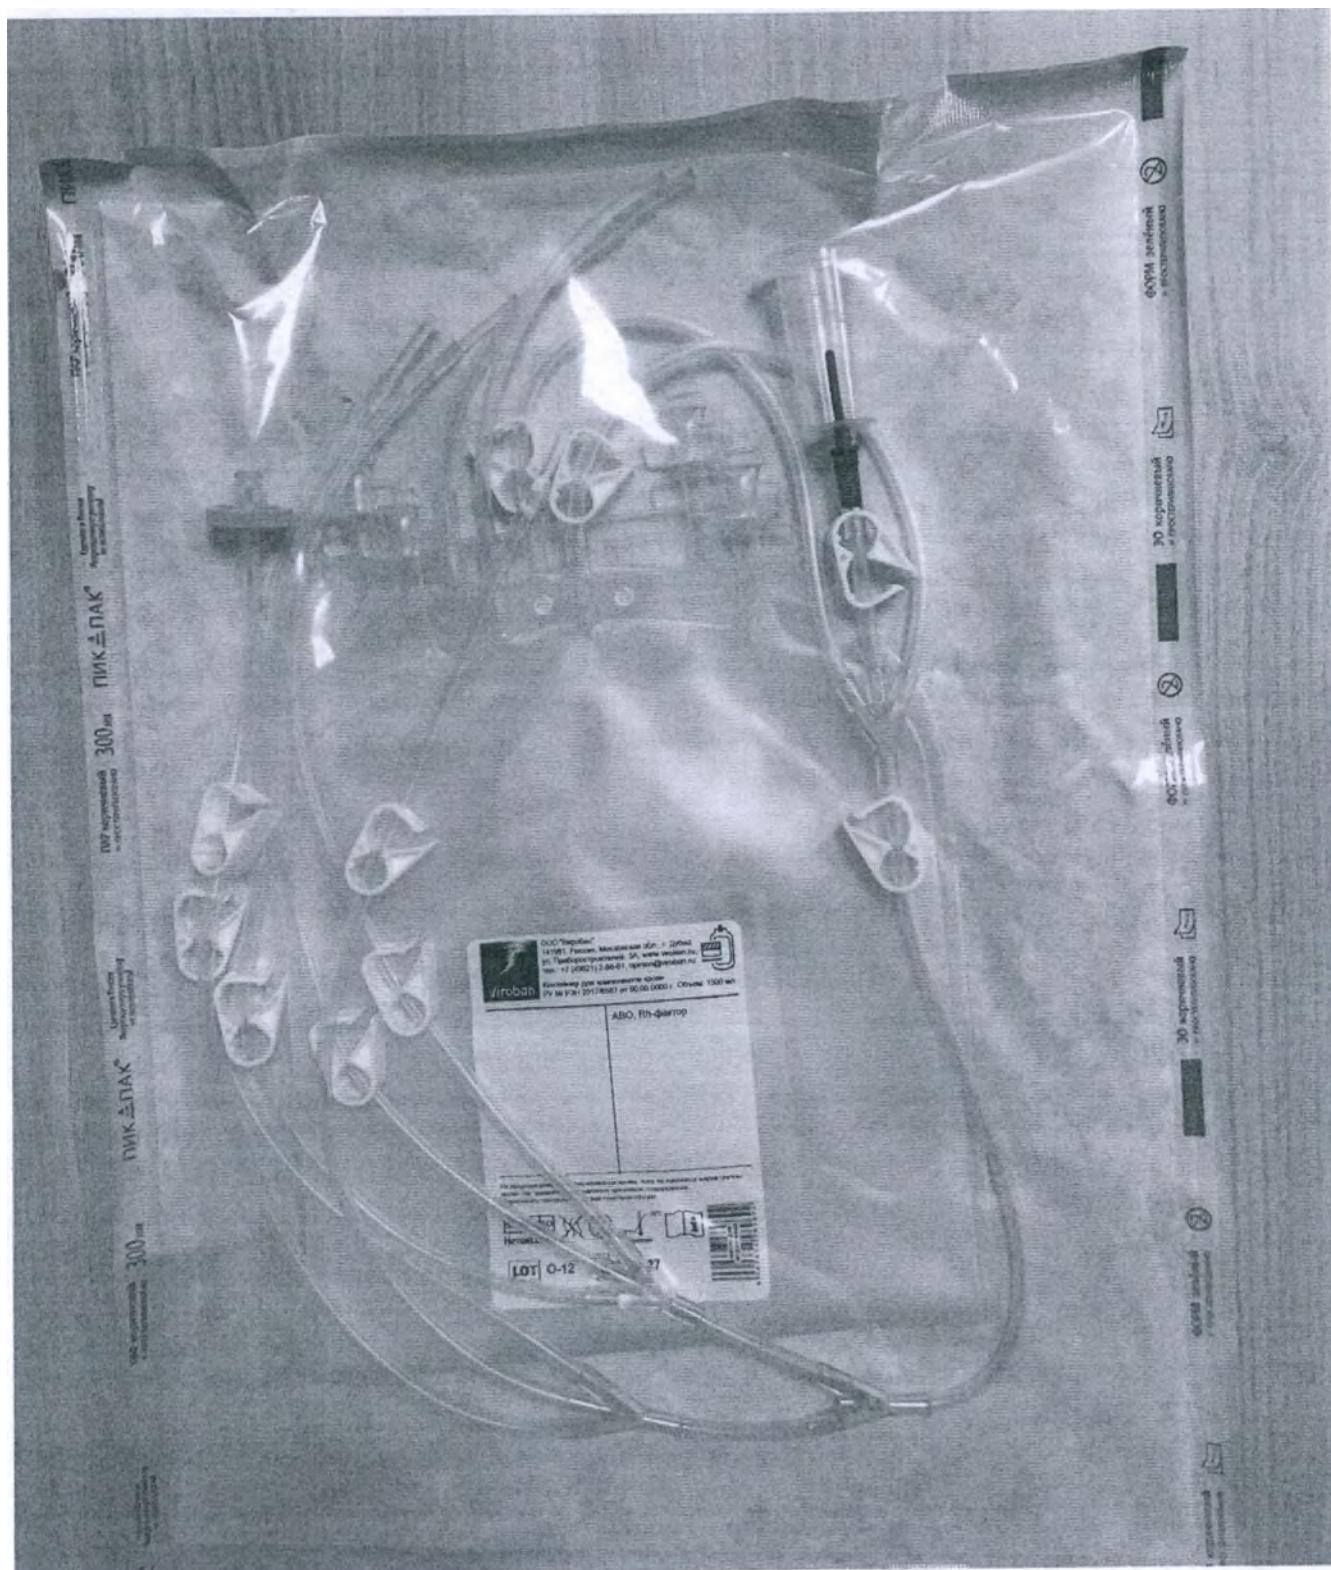

III. Макет этикеток

Этикетка тары потребительской

 ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru	
Система для пулирования компонентов крови без фильтра «Плазмавир-1» ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.	
LOT STERILE EO Нетоксично  +5°C Хранение Место производства:  ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru	REF    Место для штрих-кода

Этикетка контейнера полимерного

 ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru		
Контейнер для компонентов крови ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г. Объем: 1500 мл		
		ABO, Rh-фактор
Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови. Не применять при наличии признаков повреждения.		
STERILE EO Нетоксично  -25°C Хранение LOT Место производства:  ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru	   Место для штрих-кода	

Макет этикетки тары промежуточной

 ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru	
Система для пулирования компонентов крови без фильтра «Плазмавир-1» ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.	
LOT STERILE EO Нетоксично Место производства:  ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru	   REF  Место для штрих-кода

Макет этикетки тары транспортной



LEADCORE



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

REF

Система для пулирования компонентов крови

без фильтра «Плазмавир-1»

ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 РУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.

LOT



шт.

Брутто: кг

STERILE EO



Нетоксично



Хранение



Транспортировка




Виробан

Место производства


ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А
Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

«Система для пулирования компонентов крови» по ТУ 32.50.13-024-70440344-2017, вариант исполнения без фильтра «Плазмавир-2»

I. Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

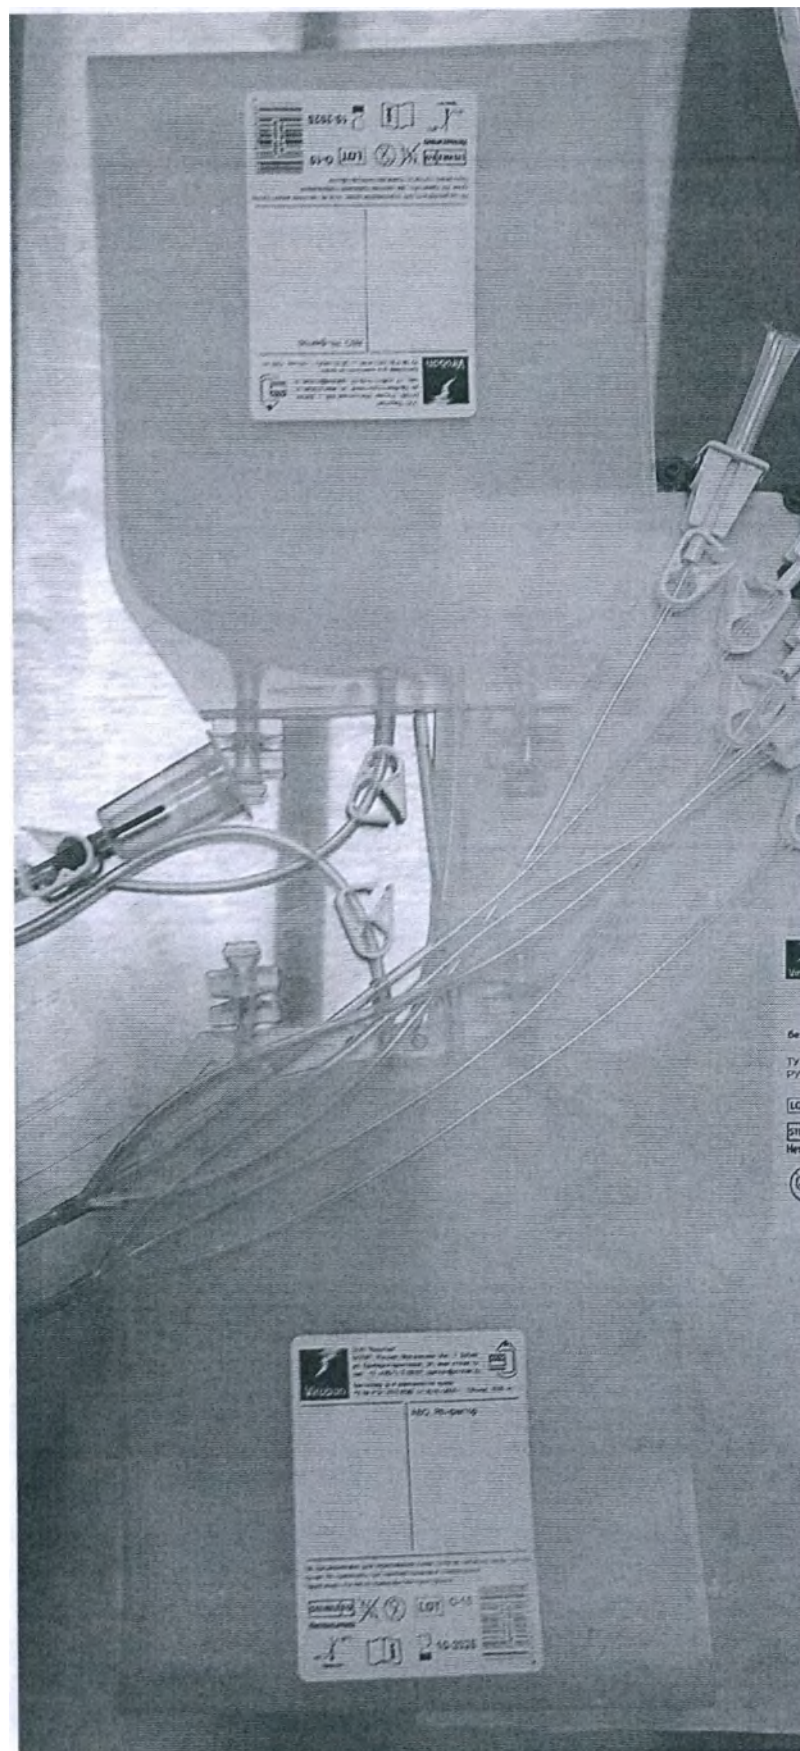

II. Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия в упаковке

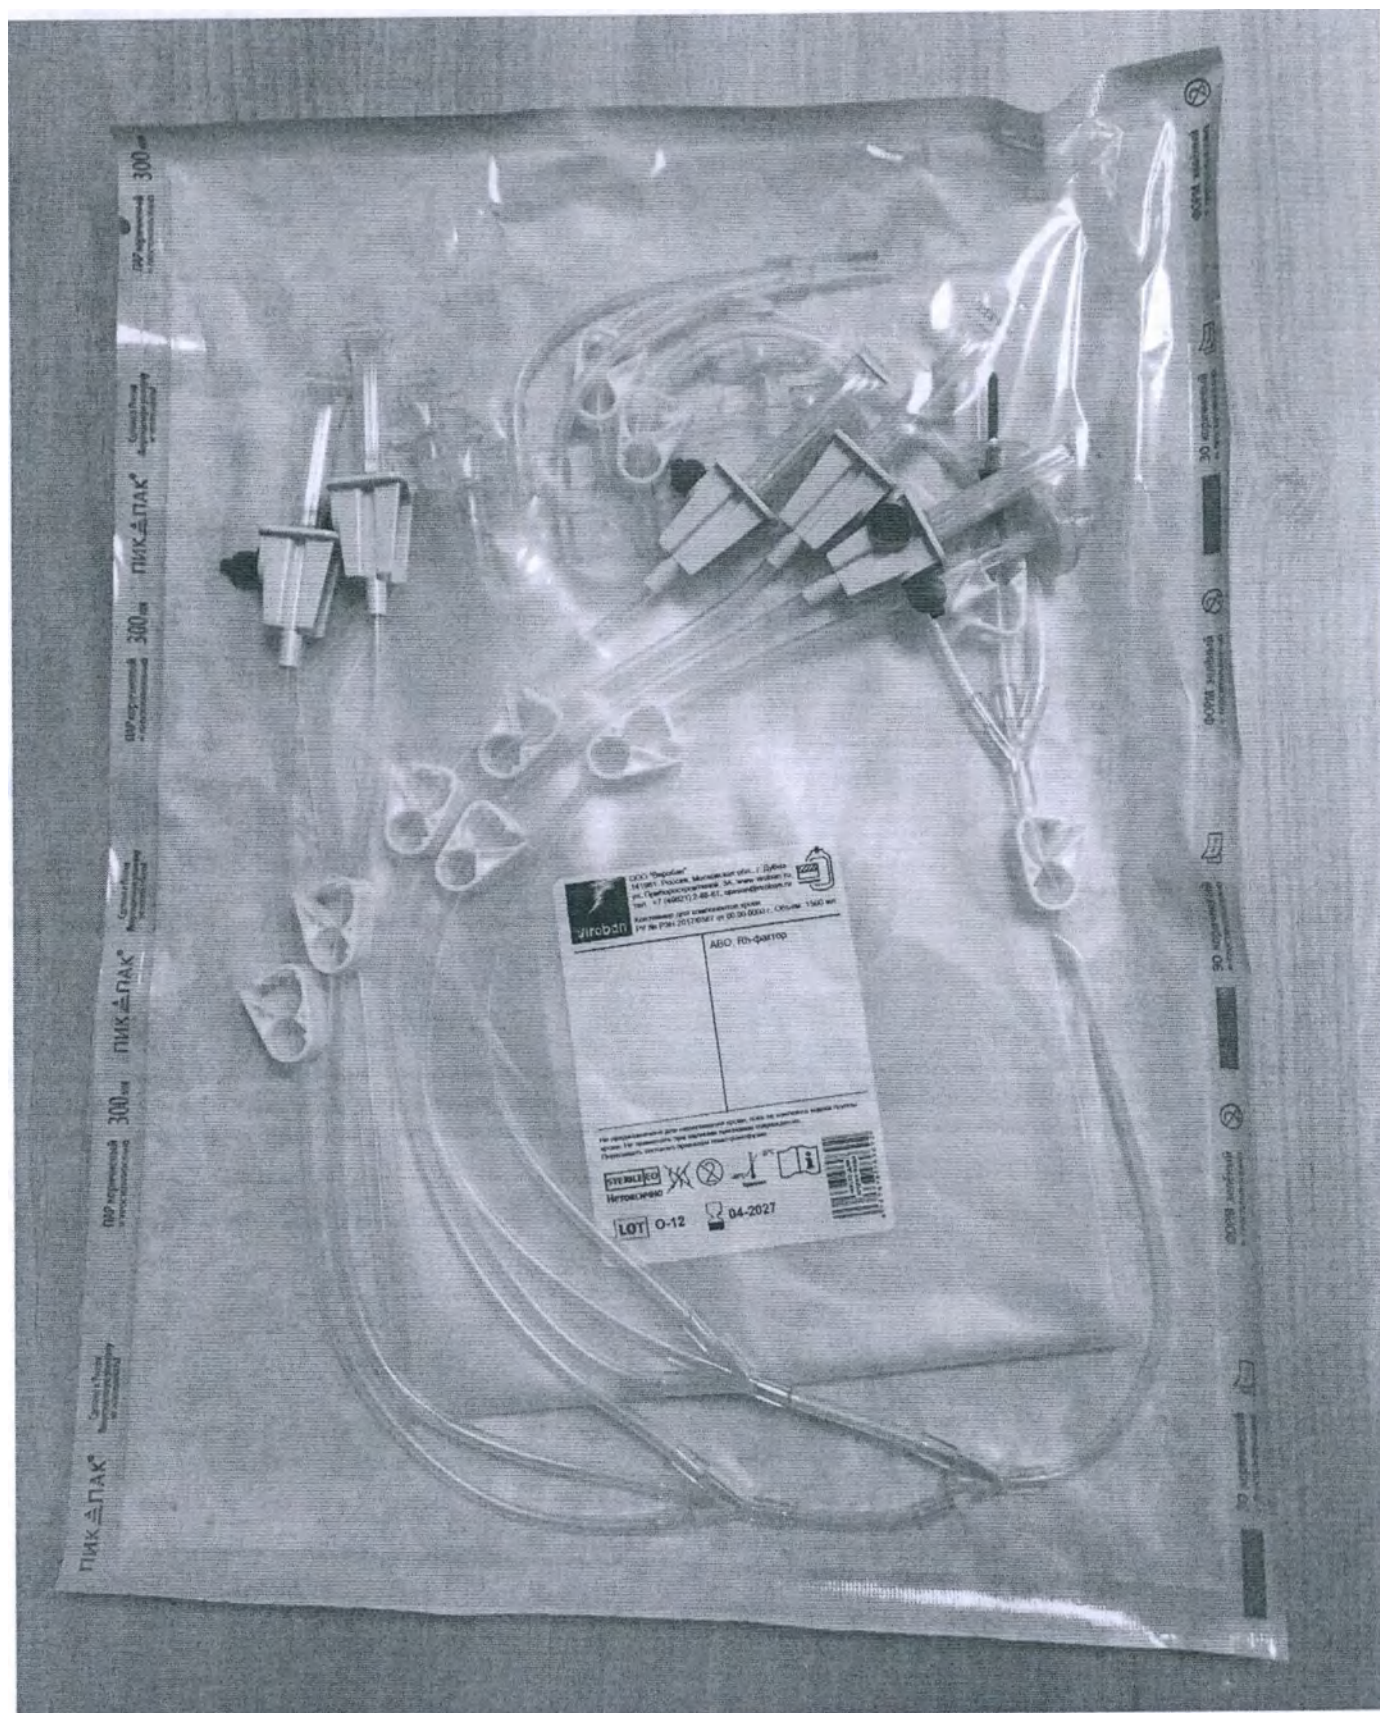

III. Макет этикеток

Этикетка тары потребительской

	ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru
Система для пулирования компонентов крови без фильтра «Плазмавир-2» ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.	
LOT STERILE EO Нетоксично  Хранение	REF  Место для штрих-кода
Место производства:  ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru	

Этикетка контейнера полимерного

	ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru	
Контейнер для компонентов крови ПУ №РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г. Объем: 1500 мл		
		ABO, Rh-фактор
Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови. Не применять при наличии признаков повреждения.		
STERILE EO Нетоксично  Хранение	 Место для штрих-кода	
LOT		
Место производства:  ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru		

Макет этикетки тары промежуточной

	ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru
Система для пулирования компонентов крови без фильтра «Плазмавир-2» ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.	
LOT STERILE EO Нетоксично  Хранение	 Место для штрих-кода
Место производства:  ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru	



LEADCORE



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

REF

**Система для пулирования компонентов крови
без фильтра «Плазмавир-2»**

ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 РУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.

LOT



шт.

Брутто:

кг

STERILE EO

Нетоксично



+5°C — +40°C
Хранение

-50°C — +50°C
Транспортировка



75 кг
max



Виробан

Место производства:


ООО «Виробан»

141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А


Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

«Система для пулирования компонентов крови» по ТУ 32.50.13-024-70440344-2017, вариант исполнения с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-1»

I. Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

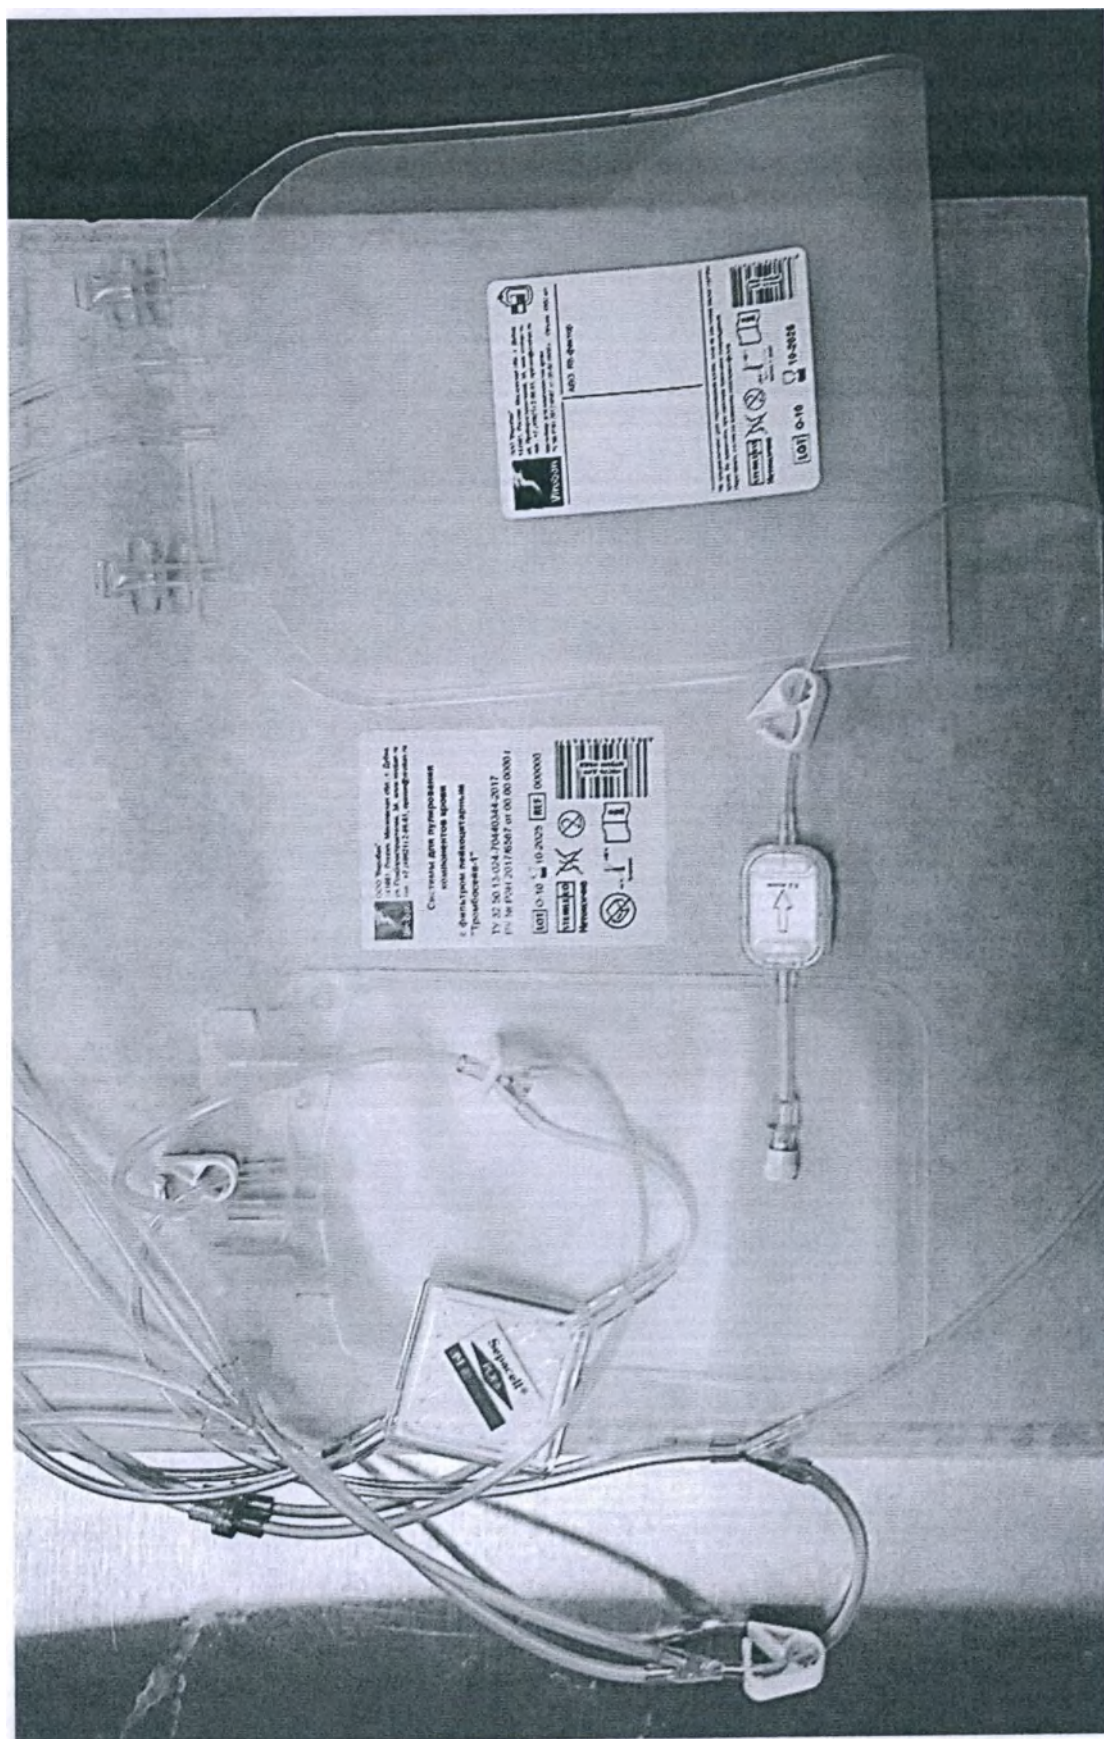

II. Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия в упаковке

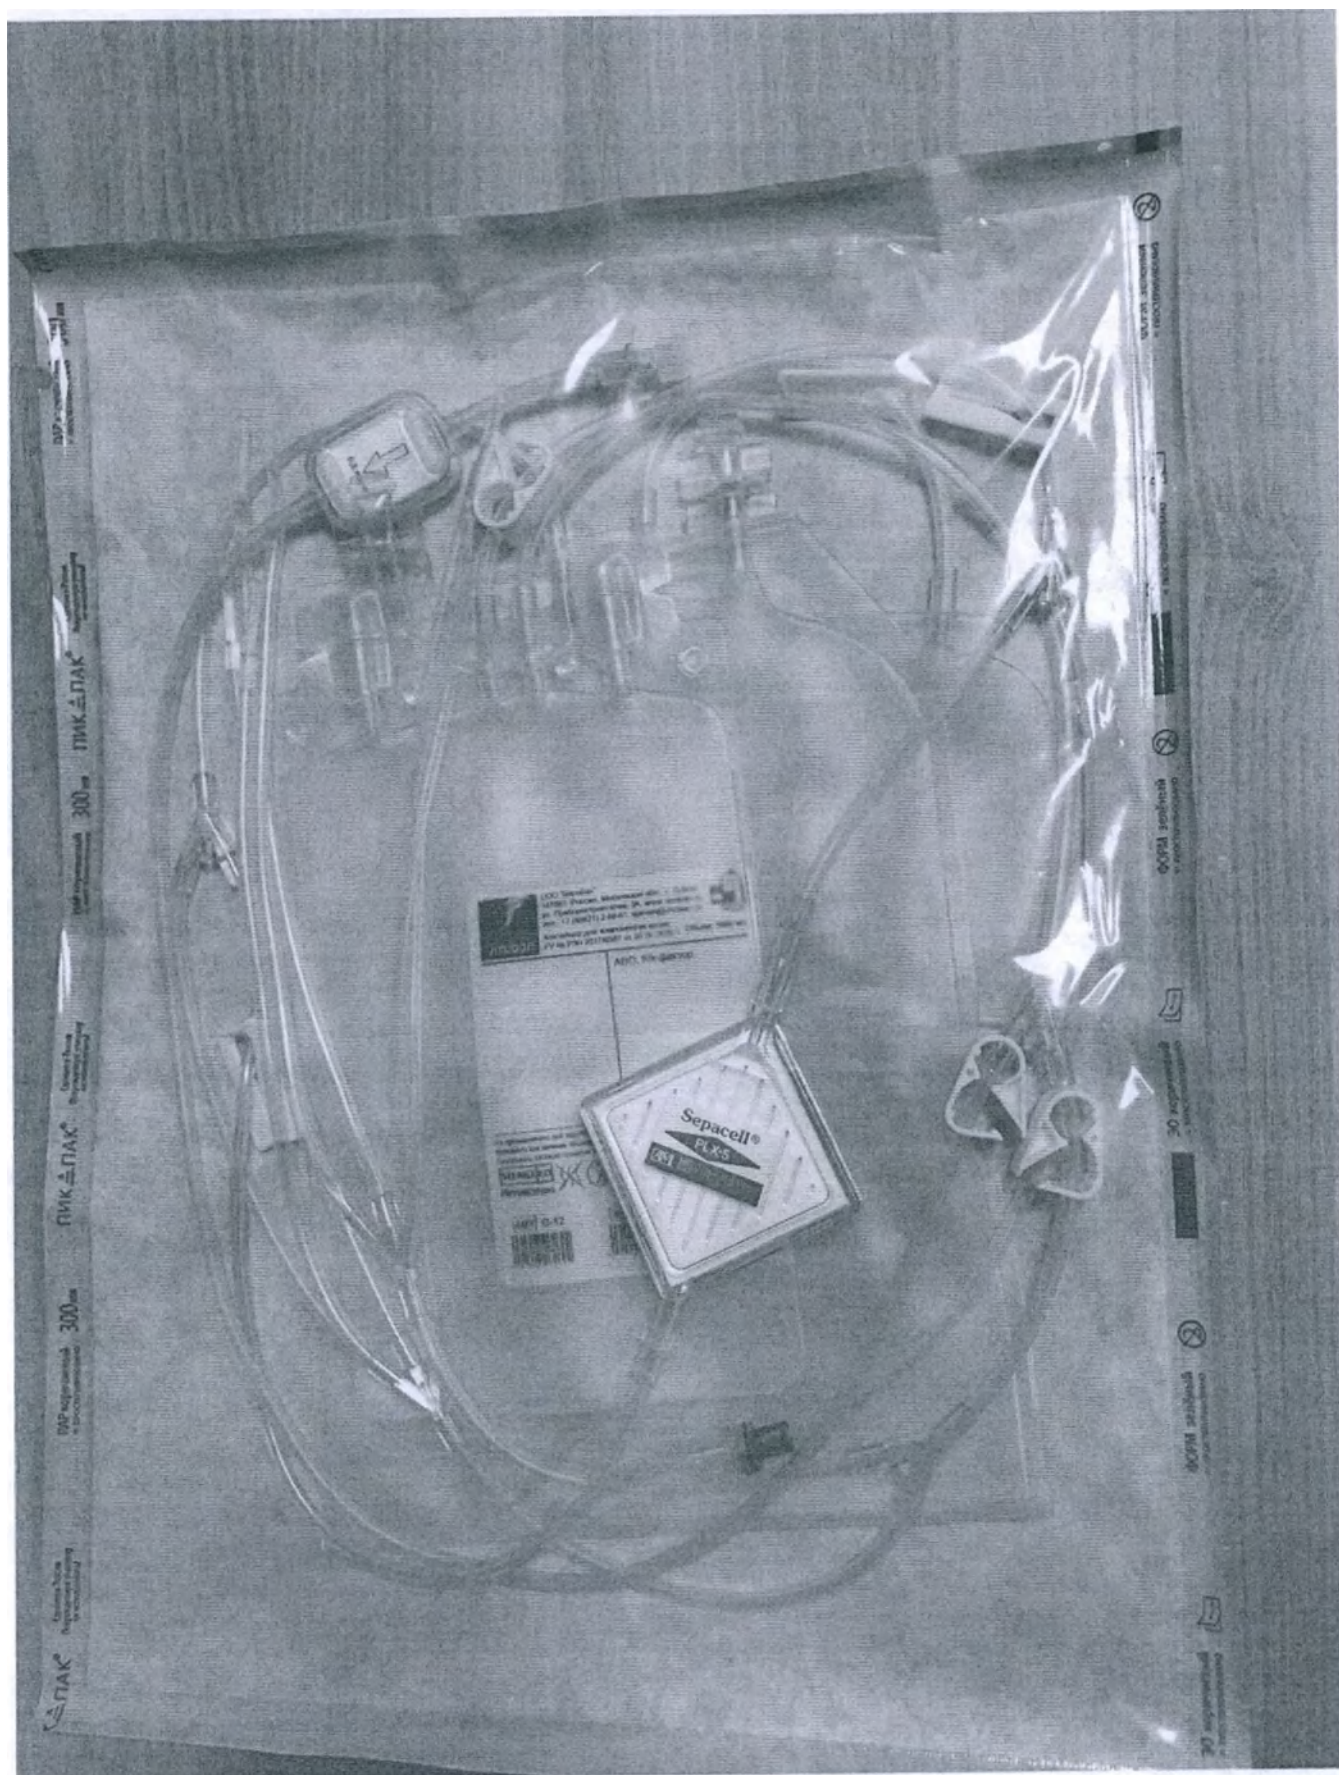


III. Макет этикеток

Этикетка тары потребительской

	ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru
Система для пулирования компонентов крови с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-1» ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.	
LOT STERILE EO Нетоксично  Хранение	REF  место для штрих-кода
Место производства:  ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru	

Этикетка контейнера полимерного

	ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru	
Контейнер для компонентов крови ПУ №РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г. Объем: 1800 мл		
		ABO, Rh-фактор
Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови. Не применять при наличии признаков повреждения.		
STERILE EO Нетоксично  Хранение не менее 5 дней	 место для штрих-кода	
LOT		
Место производства:  ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru		

Макет этикетки тары промежуточной

	ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru
Система для пулирования компонентов крови с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-1» ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.	
LOT STERILE EO Нетоксично  Хранение	  REF
Место производства:  ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru	

Макет этикетки тары транспортной



LEADCORE



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

REF

**Система для пулирования компонентов крови
с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-1»**

ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 РУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.

LOT



шт.

Брутто: кг

STERILE EO

Нетоксично



+5°C — +40°C
Хранение

-50°C — +50°C
Транспортировка



Виробан

Место производства:


ООО «Виробан»

141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А


Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

«Система для пулирования компонентов крови» по ТУ 32.50.13-024-70440344-2017, вариант исполнения с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-2»

I. Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

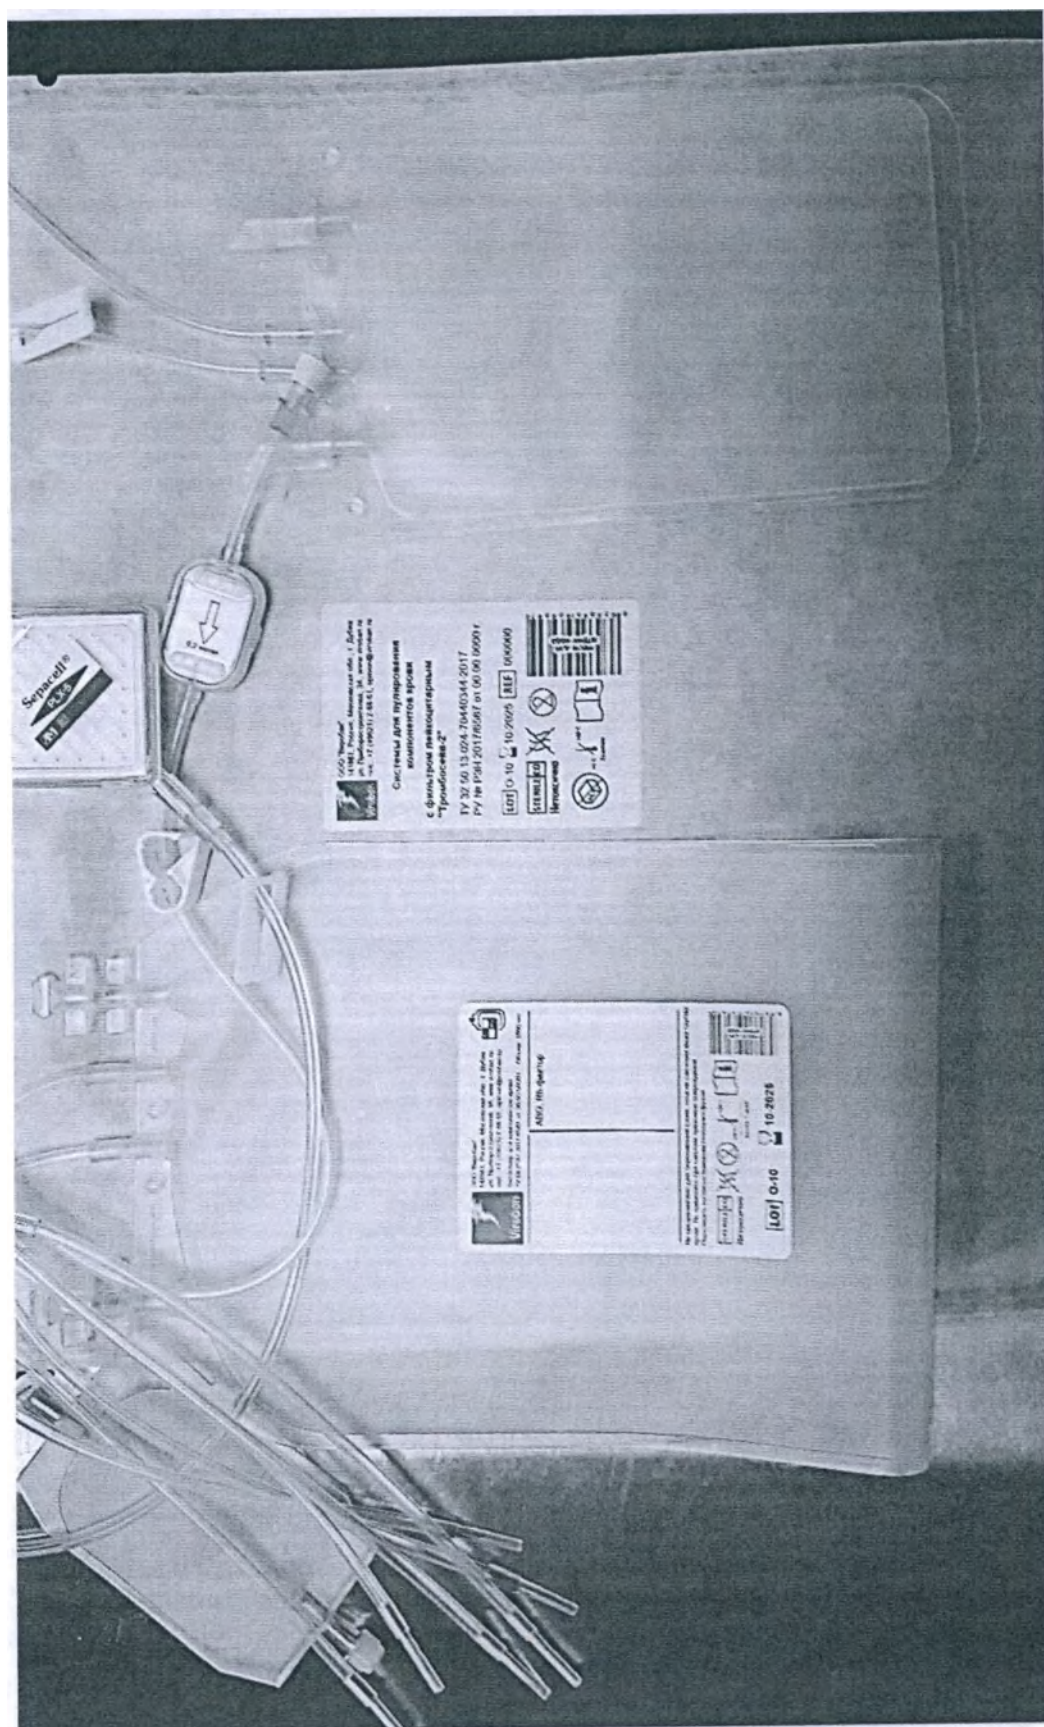

II. Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия в упаковке

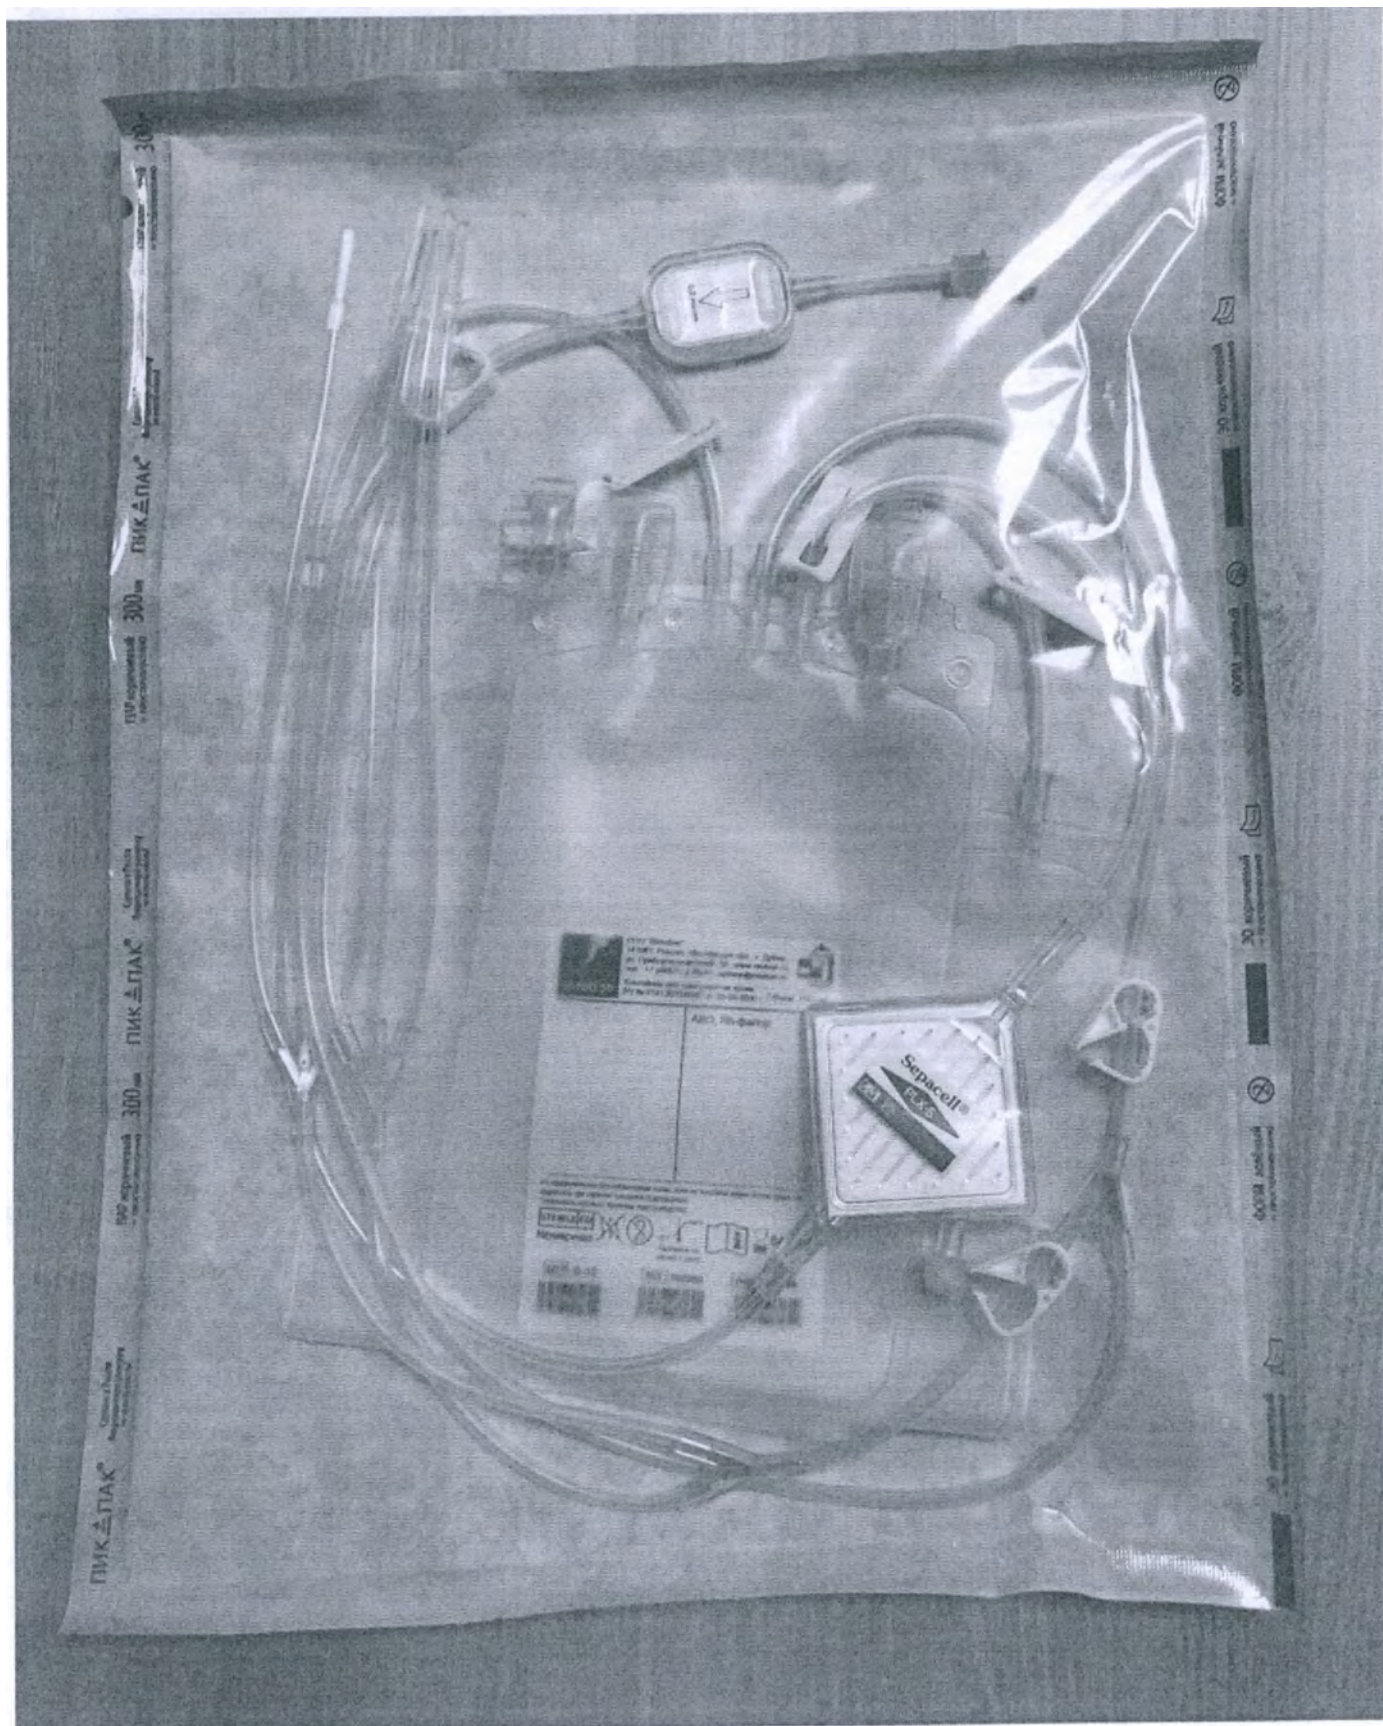


III. Макет этикеток


Этикетка тары потребительской

 ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru	
Система для пулирования компонентов крови с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-2» ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.	
LOT STERILE EO Нетоксично     +40°C Хранение	REF  Место производства:  ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru <i>Виробан</i>

Этикетка контейнера полимерного

 ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург ул. Посадская, д. 23, офис 204 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru		
Контейнер для компонентов крови ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г. Объем: 1800 мл		
		ABO, Rh-фактор
Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови. Не применять при наличии признаков повреждения.		
STERILE EO Нетоксично     +24°C Хранение не менее 5 дней	 Место производства:  ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru <i>Виробан</i>	

Макет этикетки тары промежуточной

 ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru	
Система для пулирования компонентов крови с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-2» ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.	
LOT STERILE EO Нетоксично     +40°C Хранение	REF  Место производства:  ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru <i>Виробан</i>

Макет этикетки тары транспортной



LEADCORE



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

REF

**Система для пулирования компонентов крови
с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-2»**

ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 РУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.

LOT



шт.

Брутто: кг

STERILE EO

Нетоксично



+5°C — +40°C
Хранение

-50°C — +50°C
Транспортировка



Виробан

Место производства:


ООО «Виробан»

141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А


Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

«Система для пулирования компонентов крови» по ТУ 32.50.13-024-70440344-2017, вариант исполнения с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-3»

I. Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

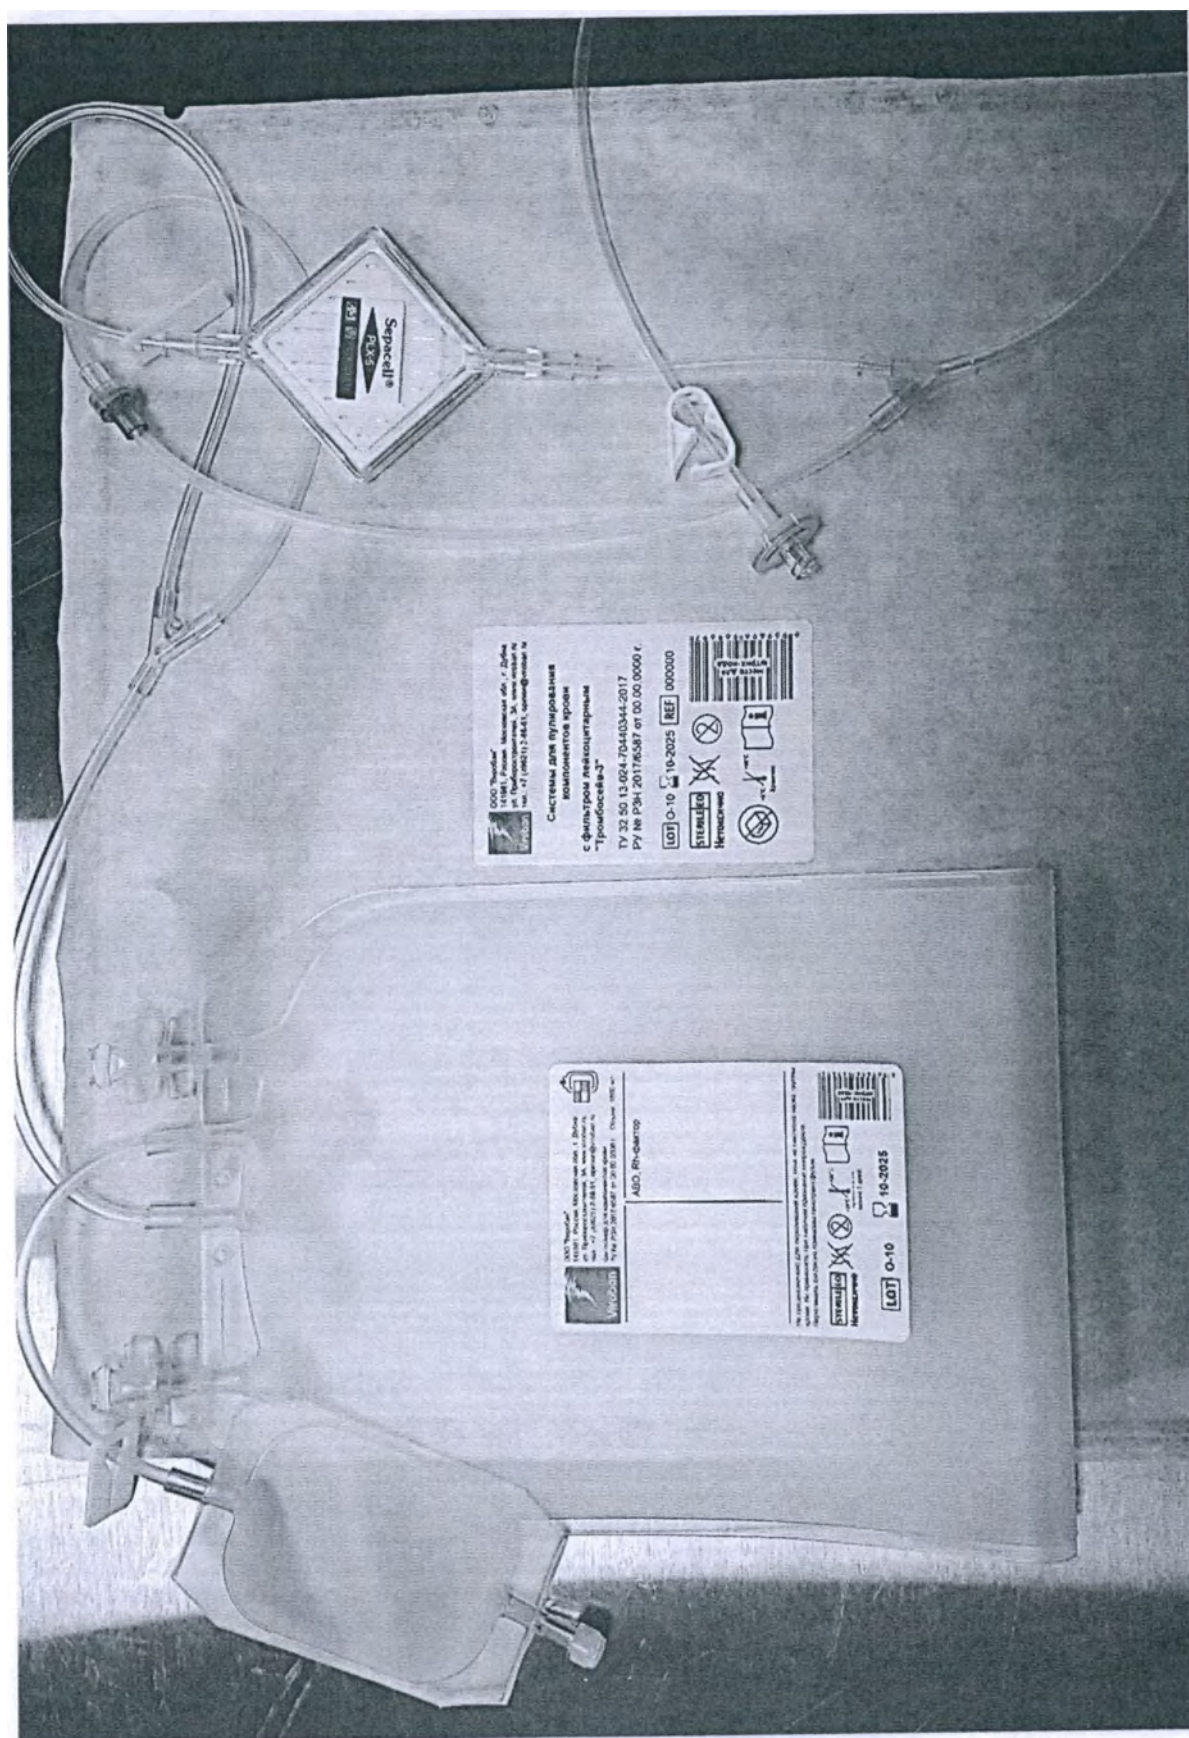

II. Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия в упаковке

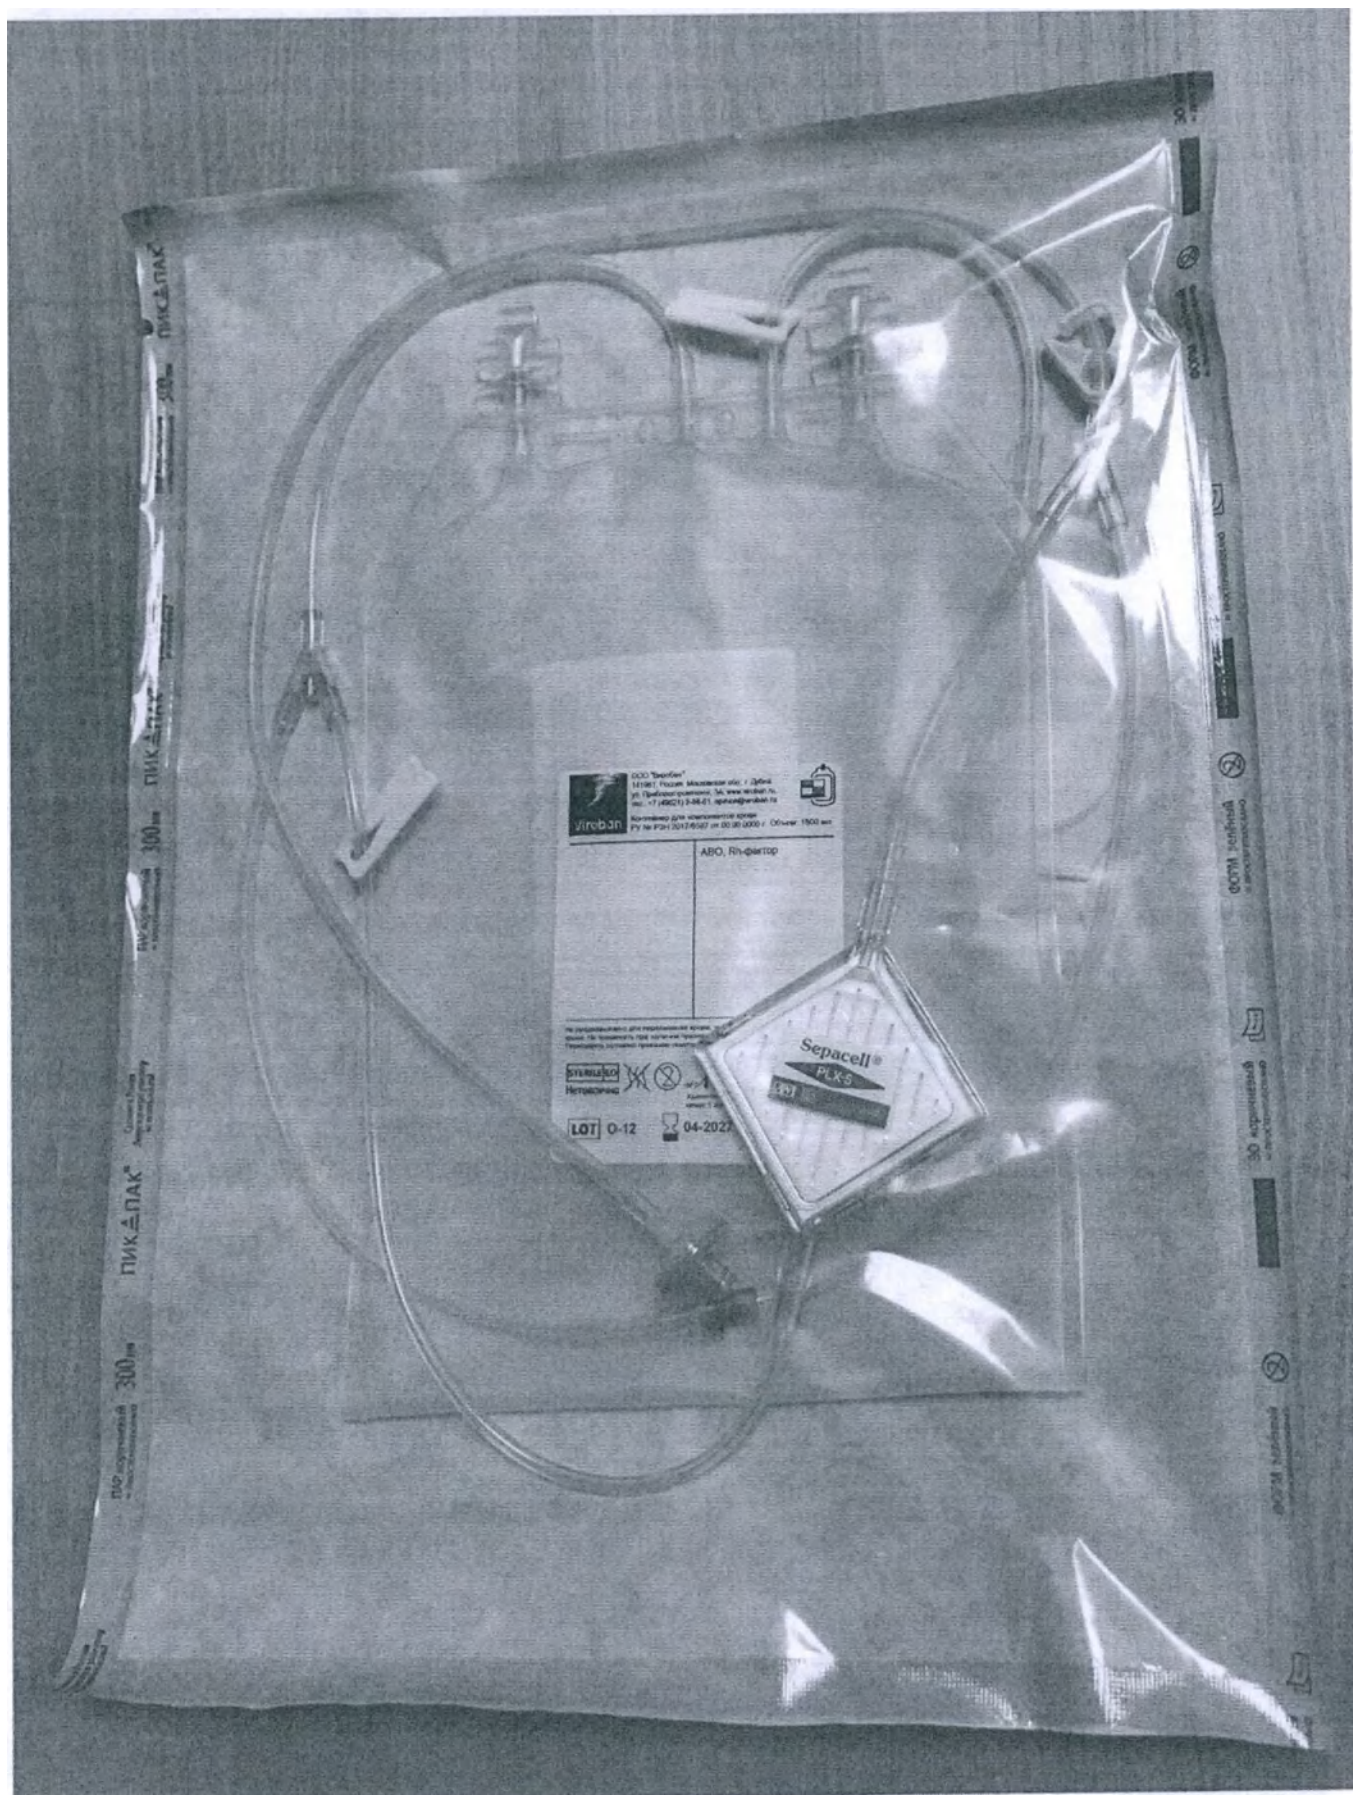

III. Макет этикеток

Этикетка тары потребительской

	ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru
Система для пулирования компонентов крови с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-3» ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.	
LOT STERILE EO Нетоксично  +5°C Хранение	   REF 
Место производства:  ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru <i>Виробан</i>	

Этикетка контейнера полимерного

	ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург ул. Посадская, д. 23, офис 204 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru	
Контейнер для компонентов крови ПУ №РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г. Объем: 1800 мл		
		ABO, Rh-фактор
Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови. Не применять при наличии признаков повреждения.		
STERILE EO Нетоксично  +20°C Хранение не более 5 дней	   LOT 	
Место производства:  ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru <i>Виробан</i>		

Макет этикетки тары промежуточной

	ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru
Система для пулирования компонентов крови с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-3» ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.	
LOT STERILE EO Нетоксично  +20°C	   REF
Место производства:  ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru <i>Виробан</i>	

Макет этикетки тары транспортной



LEADCORE



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

REF

**Система для пулирования компонентов крови
с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-3»**

ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 РУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.

LOT



шт.

Брутто: кг

STERILE EO

Нетоксично



+5°C — +40°C
Хранение

+50°C — -50°C
Транспортировка



75 кг
max



Виробан

Место производства:


ООО «Виробан»

141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А


Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

«Система для пулирования компонентов крови» по ТУ 32.50.13-024-70440344-2017, вариант исполнения с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-4»

I. Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

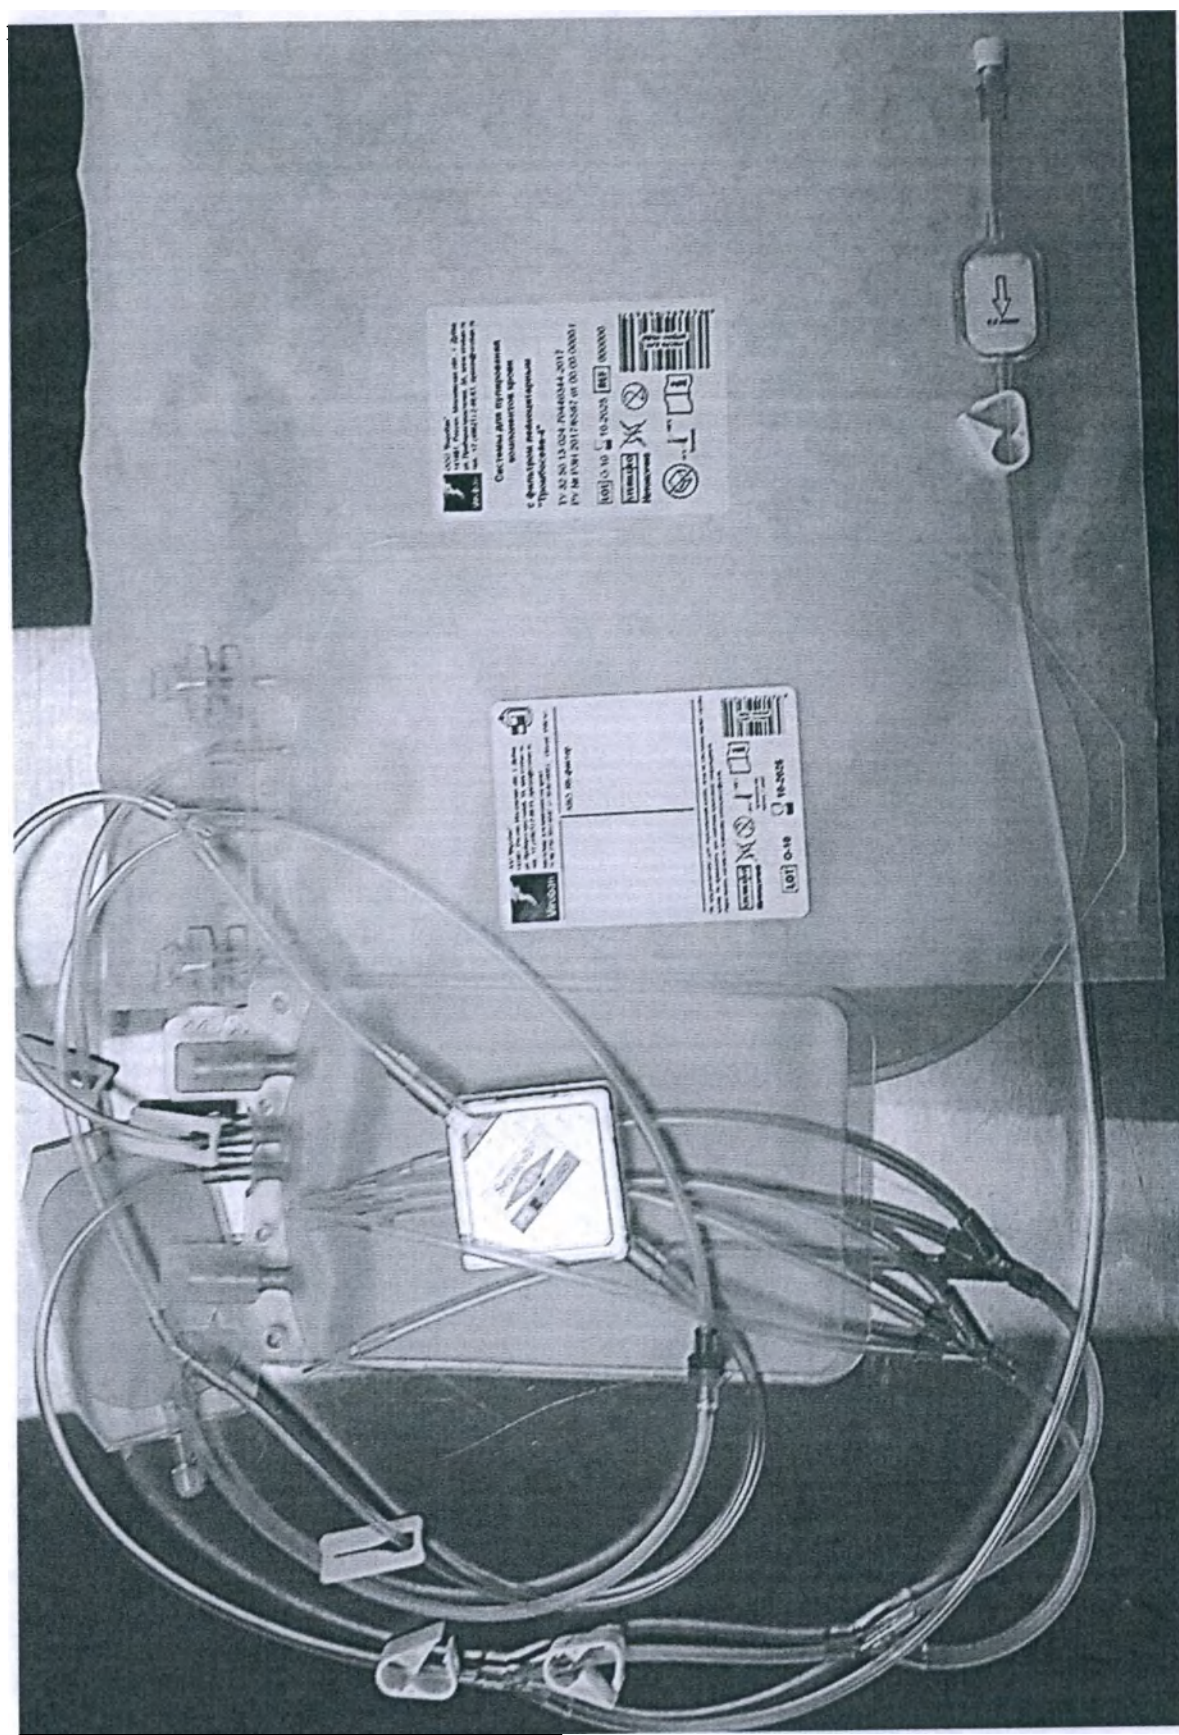

II. Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия в упаковке

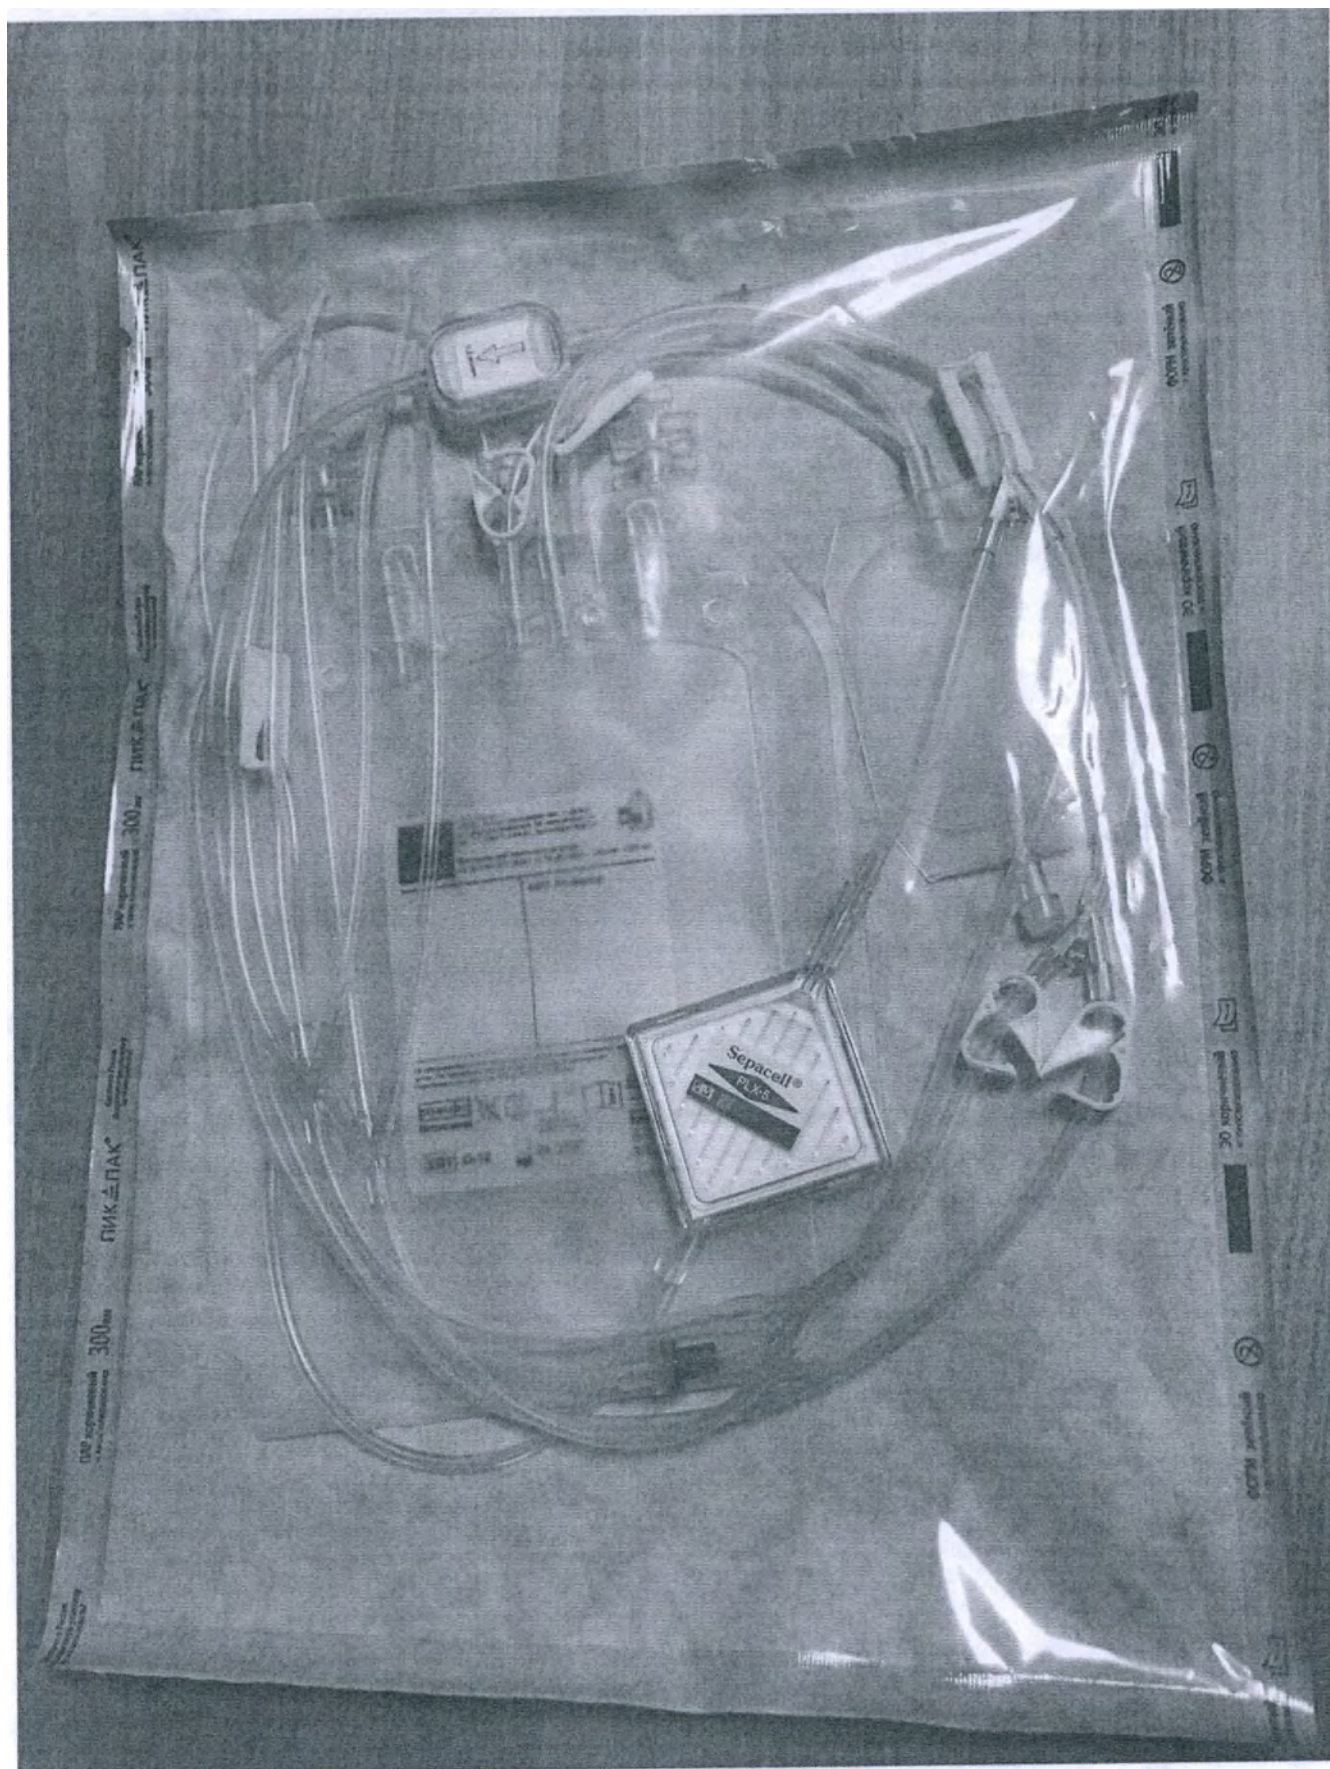

III. Макет этикеток

Этикетка тары потребительской

 ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru	
Система для пулирования компонентов крови с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-4» ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.	
LOT STERILE EO Нетоксично  Хранение	REF  Место для штрих-кода
Место производства:  ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru	

Этикетка контейнера полимерного

 ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru		
Контейнер для компонентов крови ПУ №РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г. Объем: 1500 мл		
		ABO, Rh-фактор
Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови. Не применять при наличии признаков повреждения.		
STERILE EO Нетоксично  Хранение не менее 5 дней	 Место для штрих-кода	
LOT		
Место производства:  ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru		

Макет этикетки тары промежуточной

 ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru	
Система для пулирования компонентов крови с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-4» ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.	
LOT STERILE EO Нетоксично	 REF
Место производства:  ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru	

Макет этикетки тары транспортной



LEADCORE



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

REF

**Система для пулирования компонентов крови
с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-4»**

ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 РУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.

LOT



шт.

Брутто: кг

STERILE EO

Нетоксично



+5°C — +40°C
Хранение

-50°C — +50°C
Транспортировка



75 кг
max



Виробан

Место производства:


ООО «Виробан»

141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А


Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

«Система для пулирования компонентов крови» по ТУ 32.50.13-024-70440344-2017, вариант исполнения с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-5»

I. Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

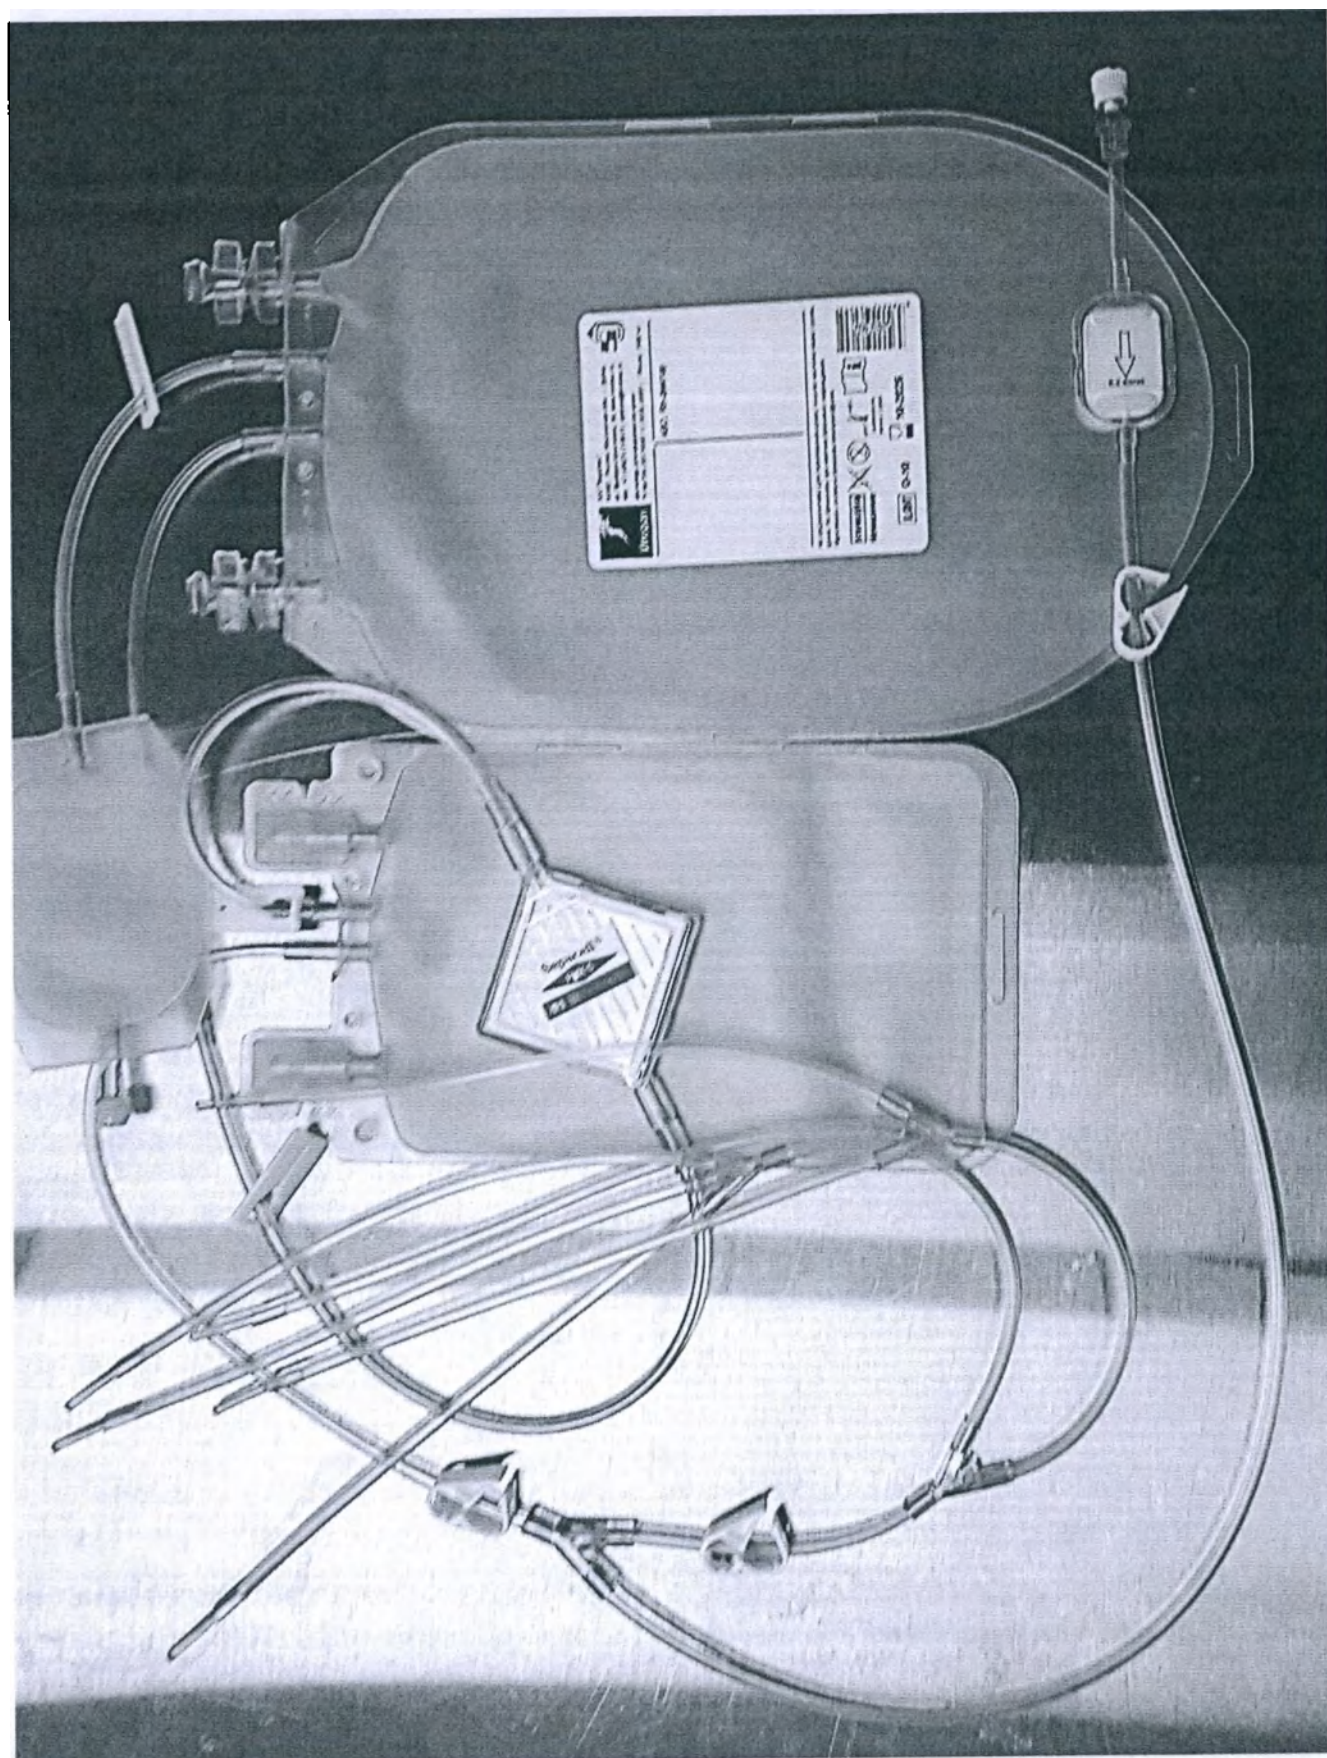

II. Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия в упаковке

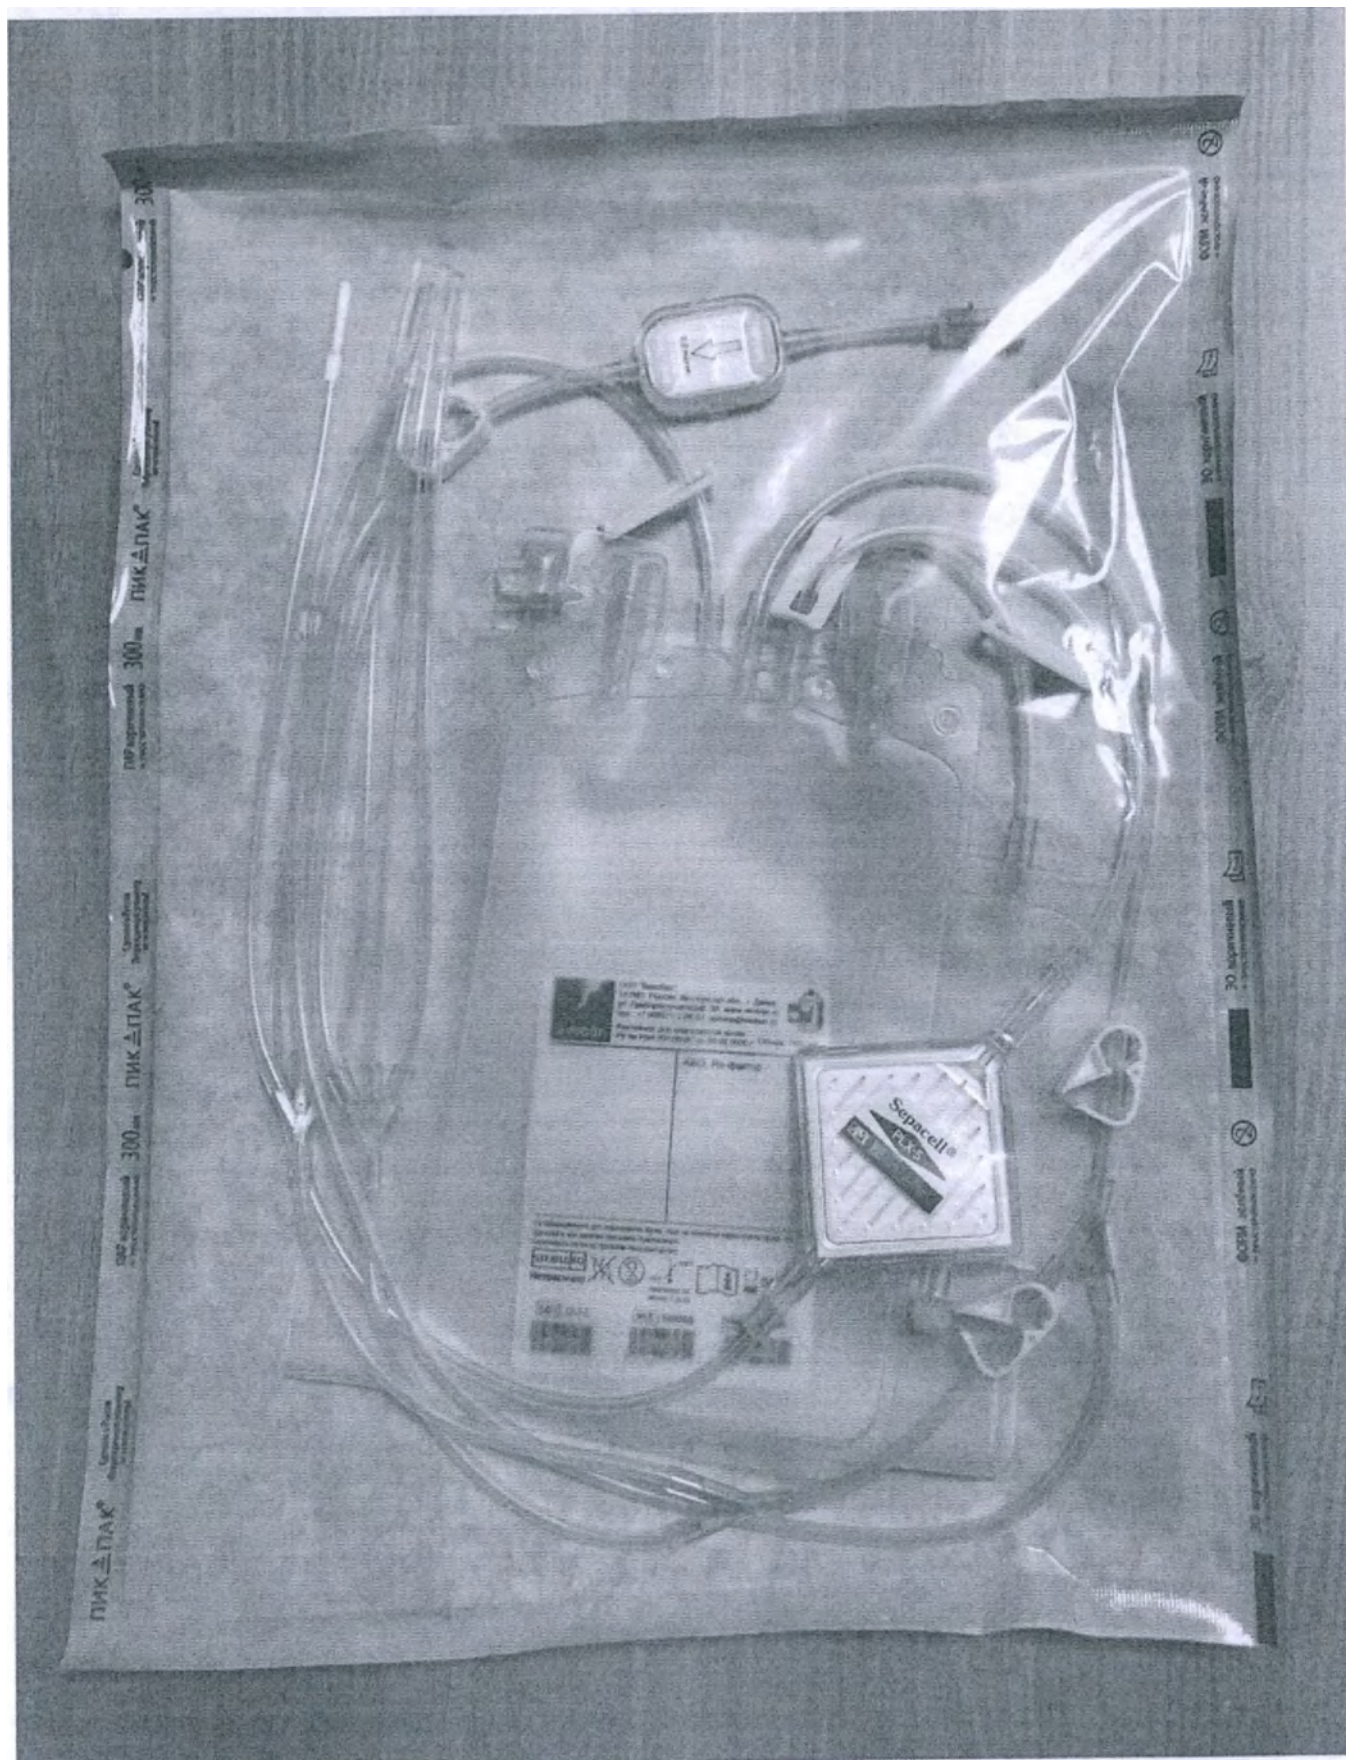


III. Макет этикеток

Этикетка тары потребительской

 ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru	
Система для пулирования компонентов крови с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-5» ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.	
LOT STERILE EO Нетоксично  +5°C Хранение Место производства:  Виробан	 REF  МЕСТО ДЛЯ ШТРИХ-КОДА 141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Этикетка контейнера полимерного

 ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург ул. Посадская, д. 23, офис 204 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru Контейнер для компонентов крови ПУ №РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г. Объем: 1500 мл		
		ABO, Rh-фактор
Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови. Не применять при наличии признаков повреждения.		
STERILE EO Нетоксично  +20°C Хранение не менее 5 дней Место производства:  Виробан	 REF  МЕСТО ДЛЯ ШТРИХ-КОДА 141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru	

Макет этикетки тары промежуточной

 ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru	
Система для пулирования компонентов крови с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-5» ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.	
LOT STERILE EO Нетоксично Место производства:  Виробан	  REF 141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Макет этикетки тары транспортной



LEADCORE



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

REF

**Система для пулирования компонентов крови
с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-5»**

ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 РУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.

LOT



шт.

Брутто: кг

STERILE EO

Нетоксично



+5°C — +40°C
Хранение

-50°C — +50°C
Транспортировка



75 кг
max



Виробан

Место производства:


ООО «Виробан»

141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А

Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

«Система для пулирования компонентов крови» по ТУ 32.50.13-024-70440344-2017, вариант исполнения с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-6»

I. Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

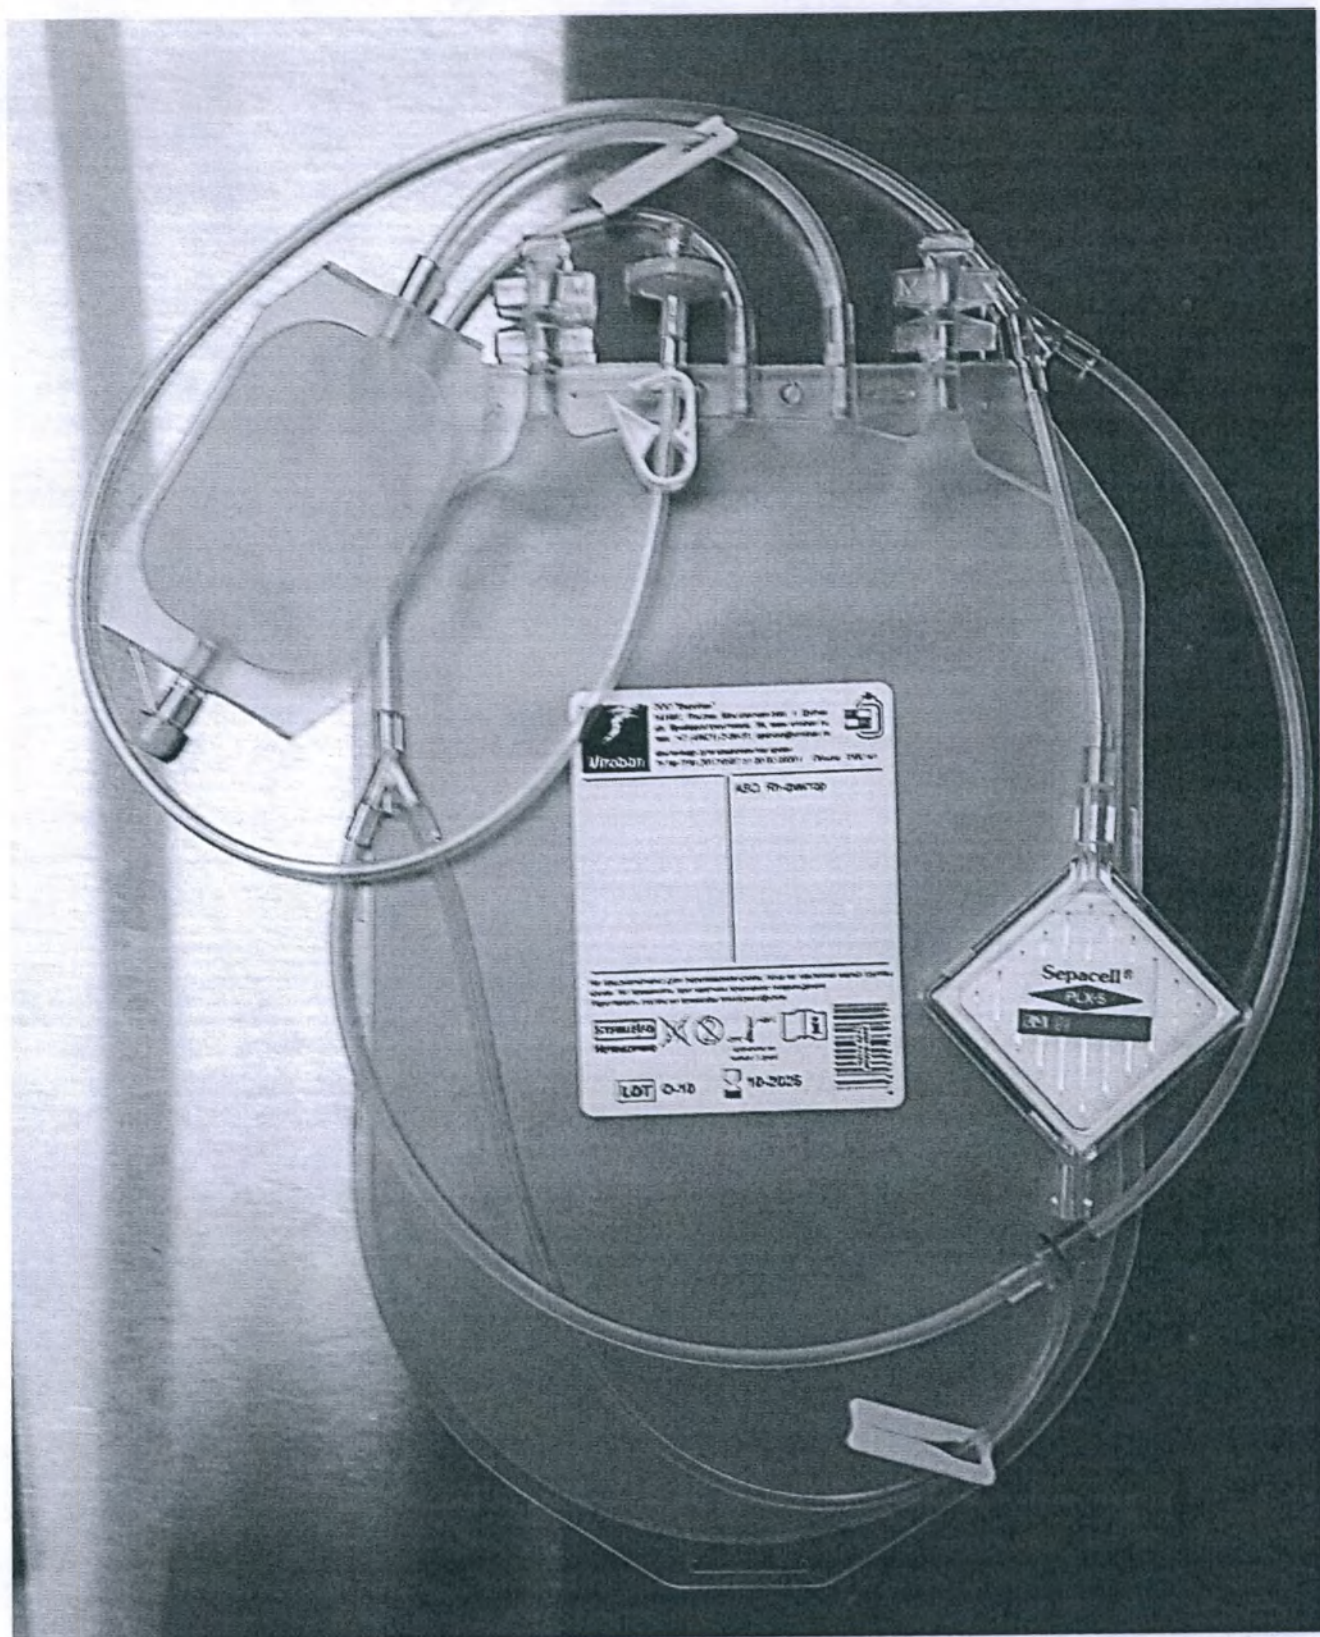

II. Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия в упаковке



III. Макет этикеток

Этикетка тары потребительской

	ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru
Система для пулирования компонентов крови с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-6» ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.	
LOT	
STERILE EO	
Нетоксично	
	
+5°C	+40°C
Хранение	
Место производства:  ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru	

Этикетка контейнера полимерного

	ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург ул. Посадская, д. 23, офис 204 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru	
Контейнер для компонентов крови ПУ №РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г. Объем: 1500 мл		
		ABO, Rh-фактор
Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови. Не применять при наличии признаков повреждения.		
STERILE EO		
Нетоксично		
		
LOT		
Место производства:  ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru		

Макет этикетки тары промежуточной

	ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru
Система для пулирования компонентов крови с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-6» ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.	
LOT	
STERILE EO	
Нетоксично	
	
	
Место производства:  ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru	



LEADCORE



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

REF

Система для пулирования компонентов крови с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-6»

ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 РУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.

LOT



шт.

Брутто: кг

STERILE EO

Нетоксично



+5°C
Хранение

+40°C
+50°C
-50°C
Транспортировка



75 кг
max



Виробан

Место производства:


ООО «Виробан»

141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А .


Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

«Система для пулирования компонентов крови» по ТУ 32.50.13-024-70440344-2017, вариант исполнения с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-7»

I. Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

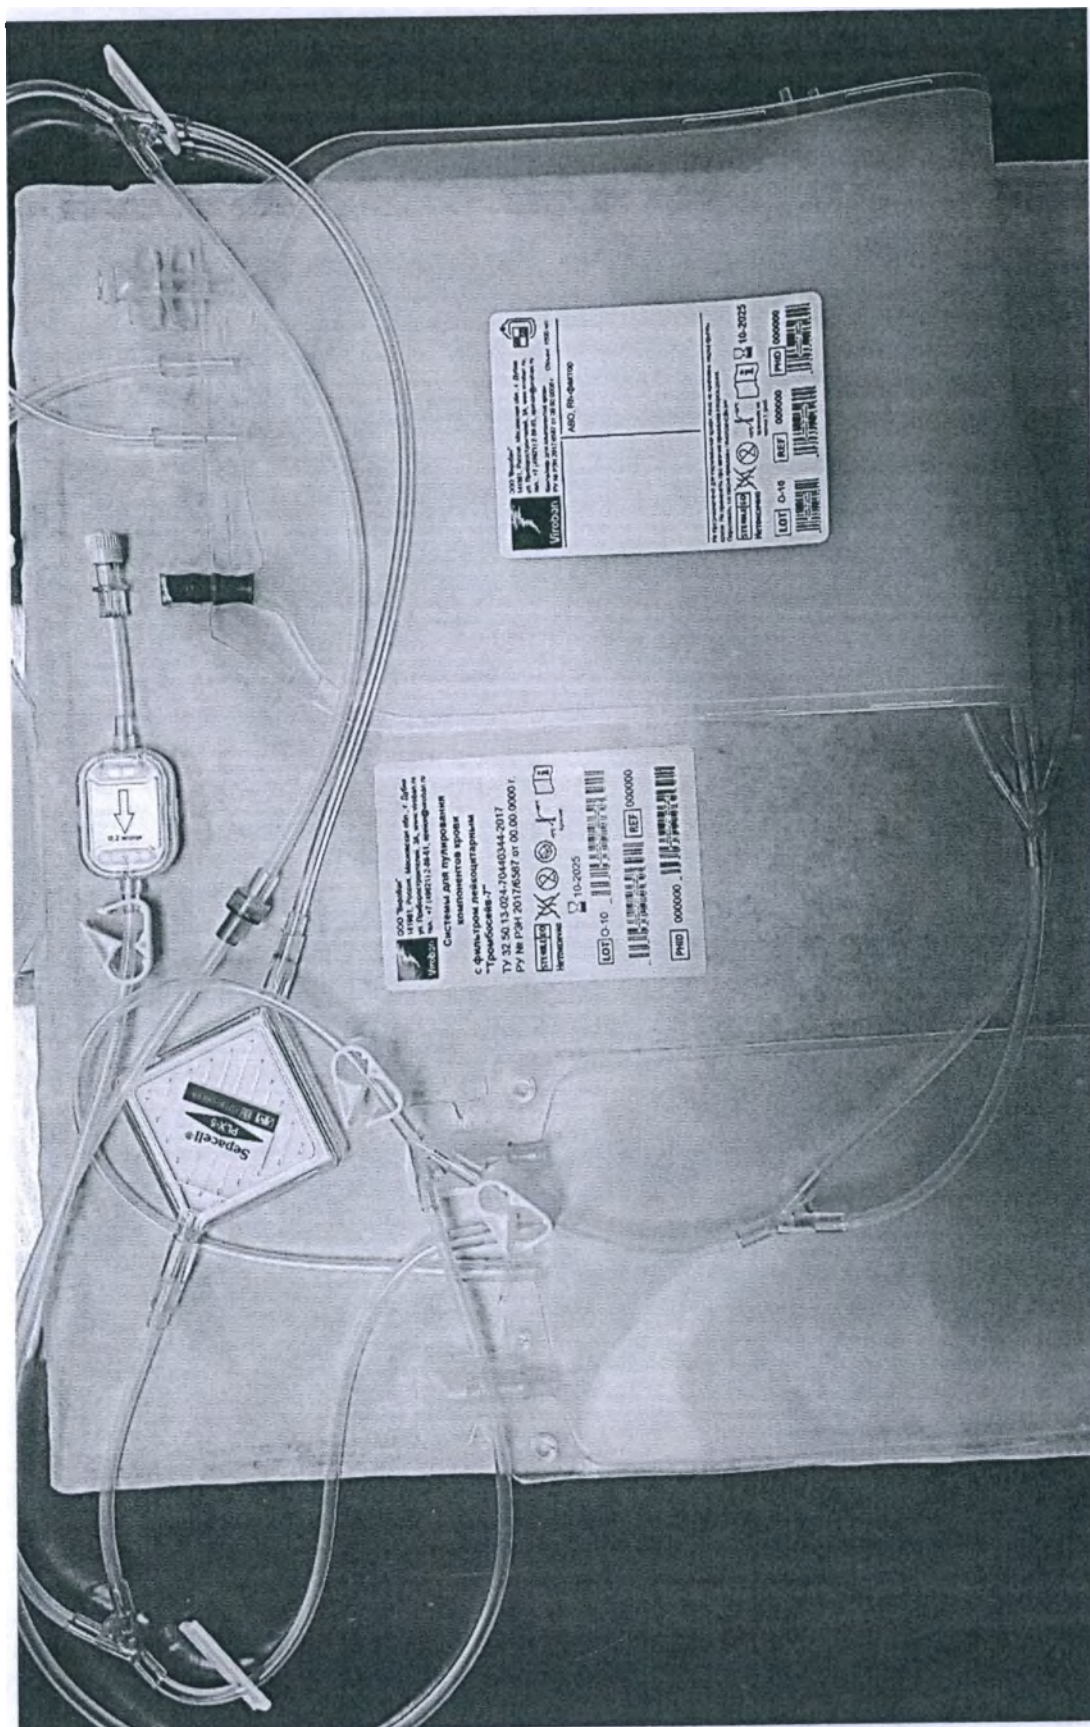

II. Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия в упаковке

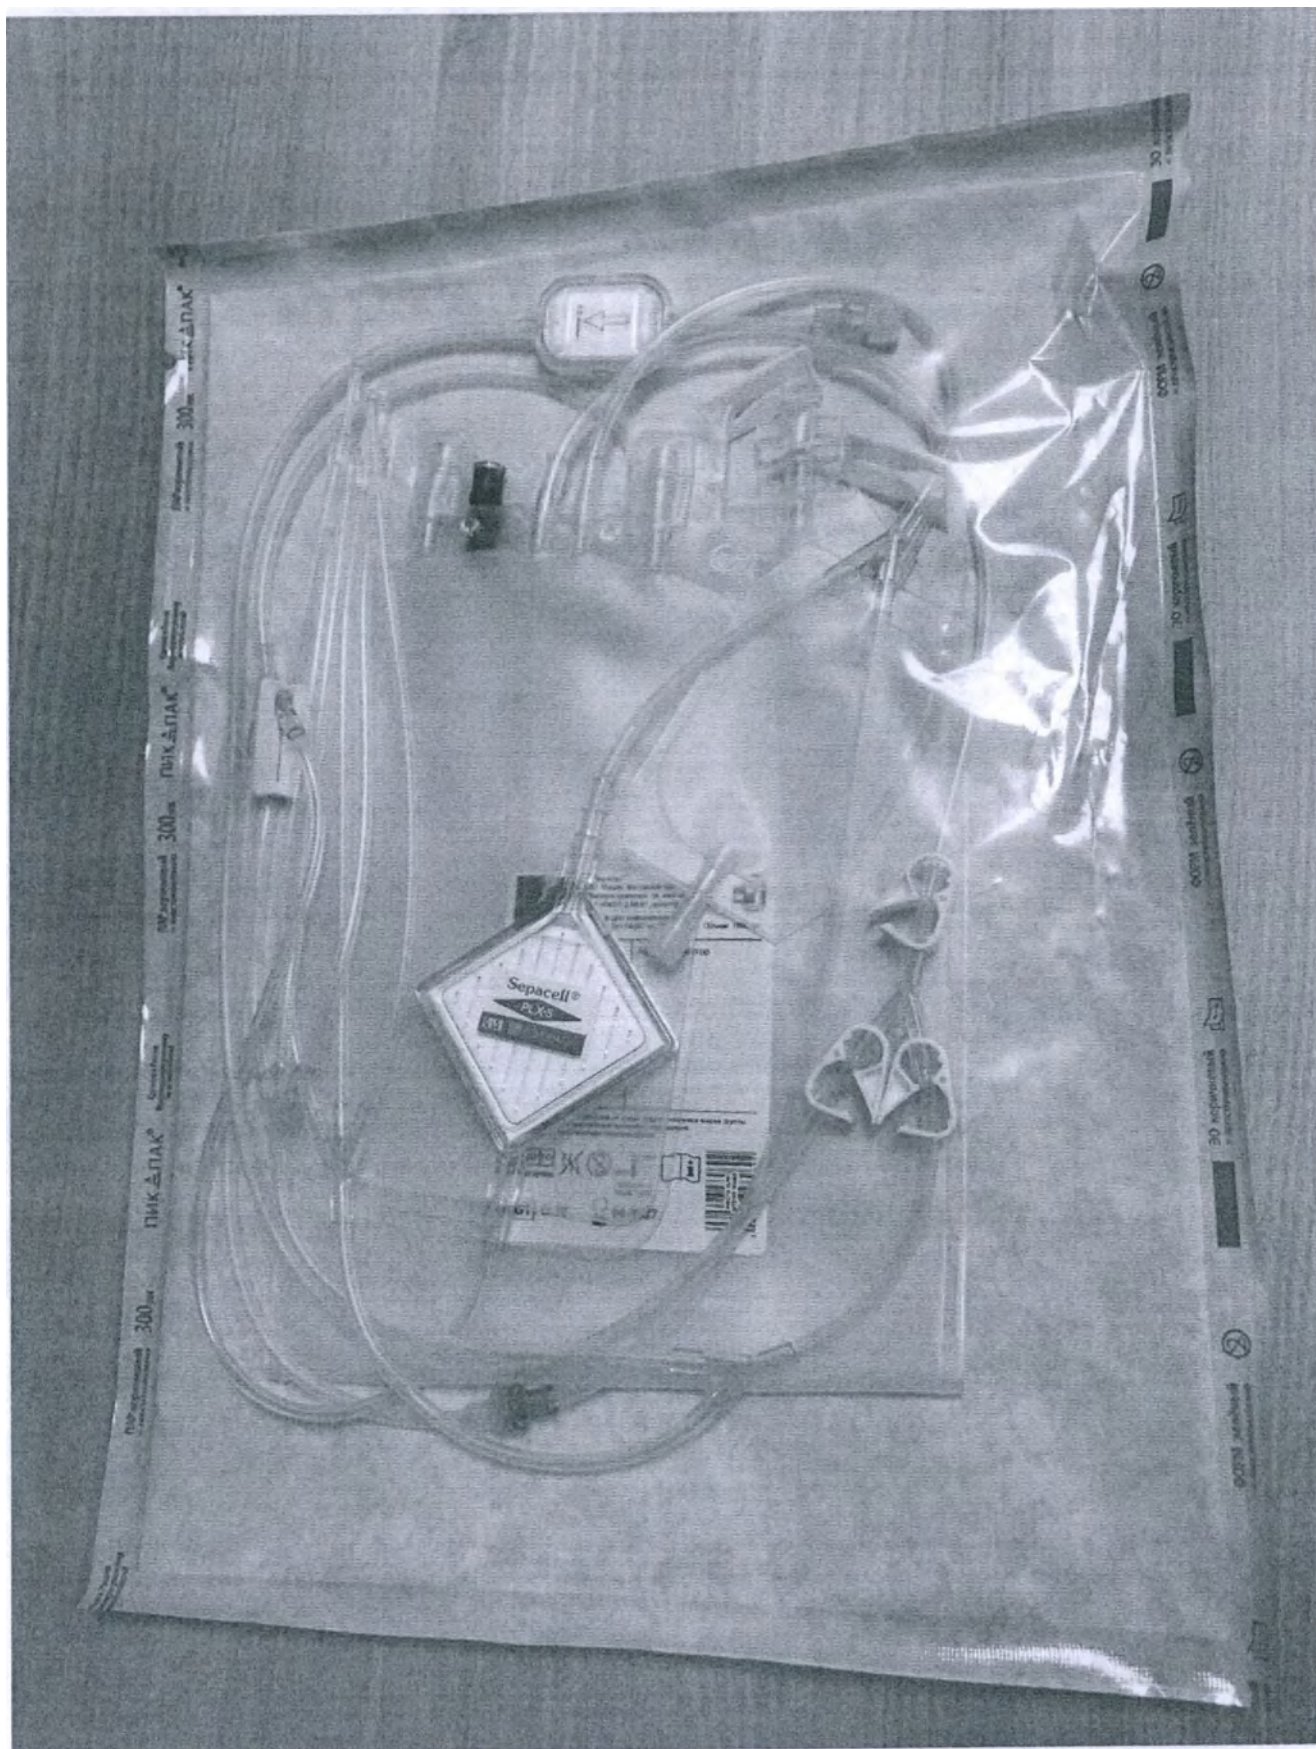


III. Макет этикеток

Этикетка тары потребительской

	ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru
Система для пулирования компонентов крови с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-7» ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.	
STERILE EO      Нетоксично Хранение	
LOT	REF
PHID	
	
Место производства:  ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru	

Этикетка контейнера полимерного

	ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург ул. Посадская, д. 23, офис 204 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru	
Контейнер для компонентов крови ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г. Объем: 1800 мл		
		ABO, Rh-фактор
Не предназначено для переливания крови, пока не наклеена марка группы крови. Не применять при наличии признаков повреждения.		
STERILE EO      REF Нетоксично Хранение не менее 5 дней		
LOT	PHID	
		
Место производства:  ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru		

Макет этикетки тары промежуточной

	ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru
Система для пулирования компонентов крови с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-7» ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.	
LOT	ШТ.
STERILE EO     Нетоксично Хранение	
REF	PHID
Место производства:  ООО «Виробан» 141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru	



LEADCORE



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

REF

Система для пулирования компонентов крови с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-7»

ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 РУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.

STERILE EO

Нетоксично

+5°C — +40°C
Хранение

LOT



-50°C — +50°C
Транспортировка



75 кг
max



PHID



ШТ.

Брутто: кг



место для
штрих-кода

6 9 6 9 6 9 6 1 9 6 9 6 9 2 1 1



место для
штрих-кода

6 9 6 9 6 9 6 1 9 6 9 6 9 2 1 1



Виробан

Место производства:


ООО «Виробан»

141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А


Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

«Система для пулирования компонентов крови» по ТУ 32.50.13-024-70440344-2017, вариант исполнения с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-8»

II. Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

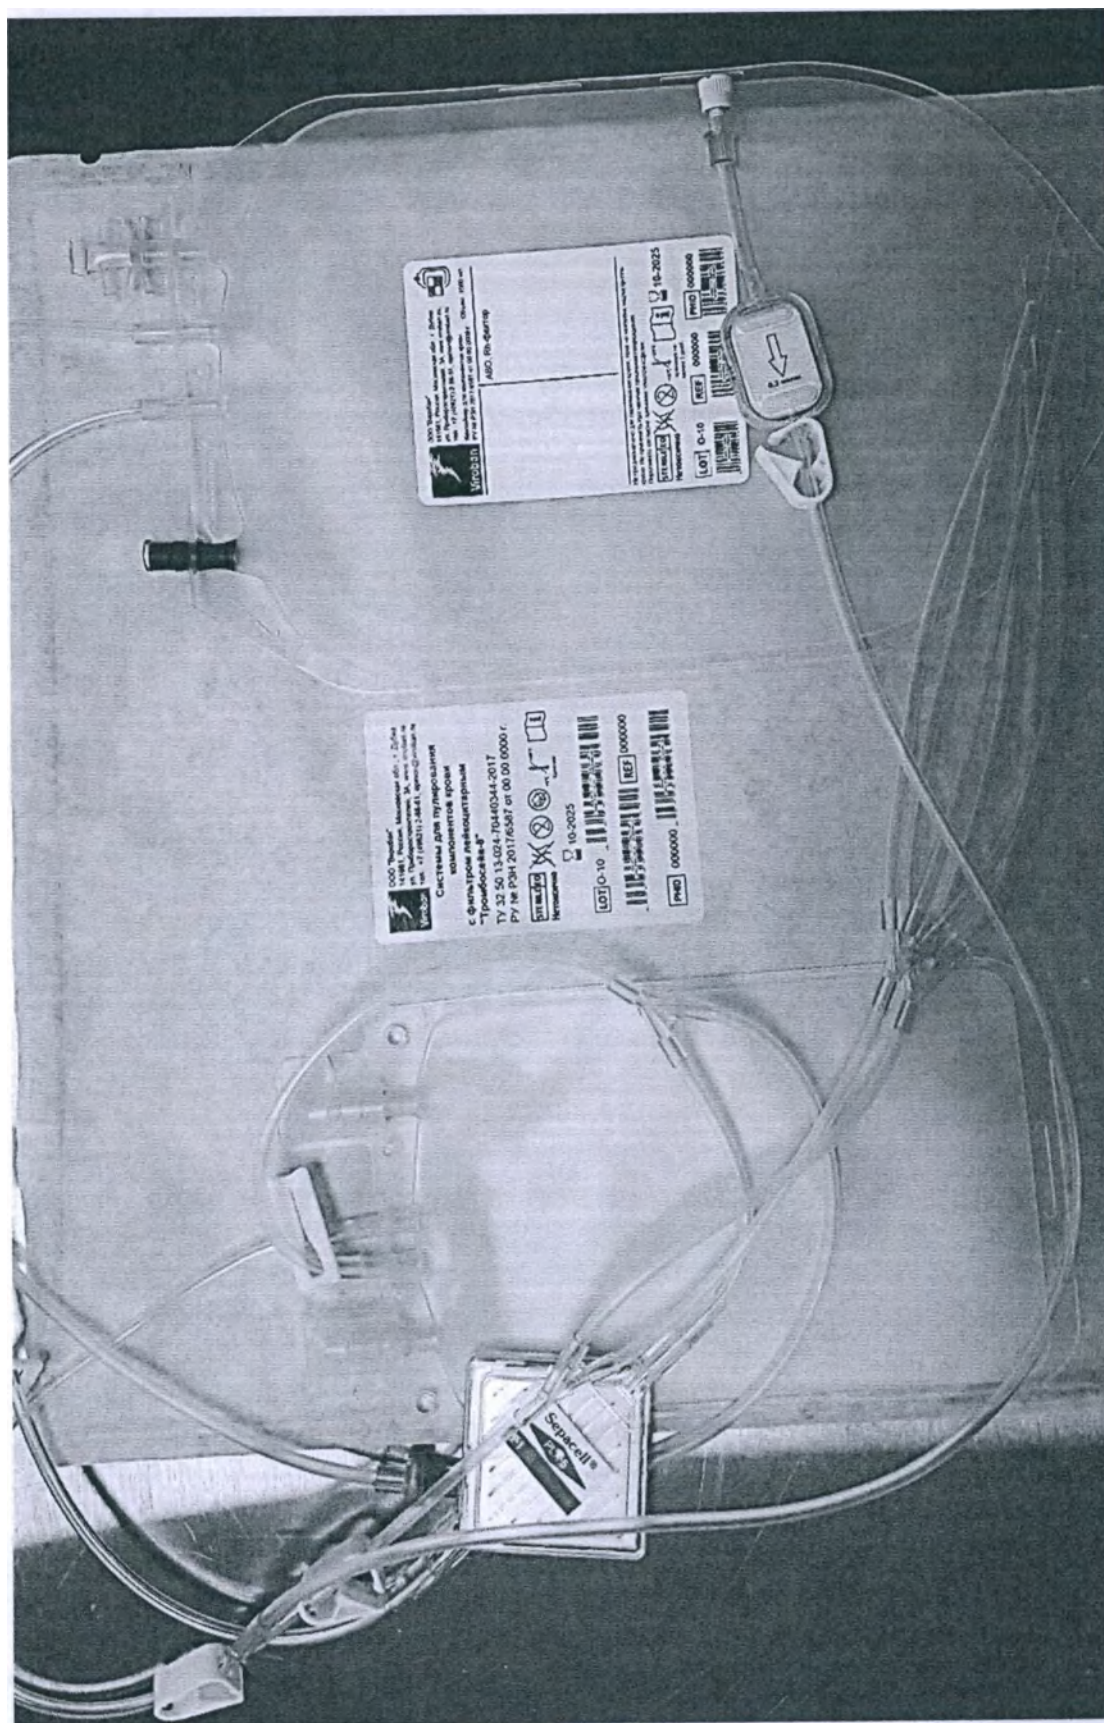

II. Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия в упаковке

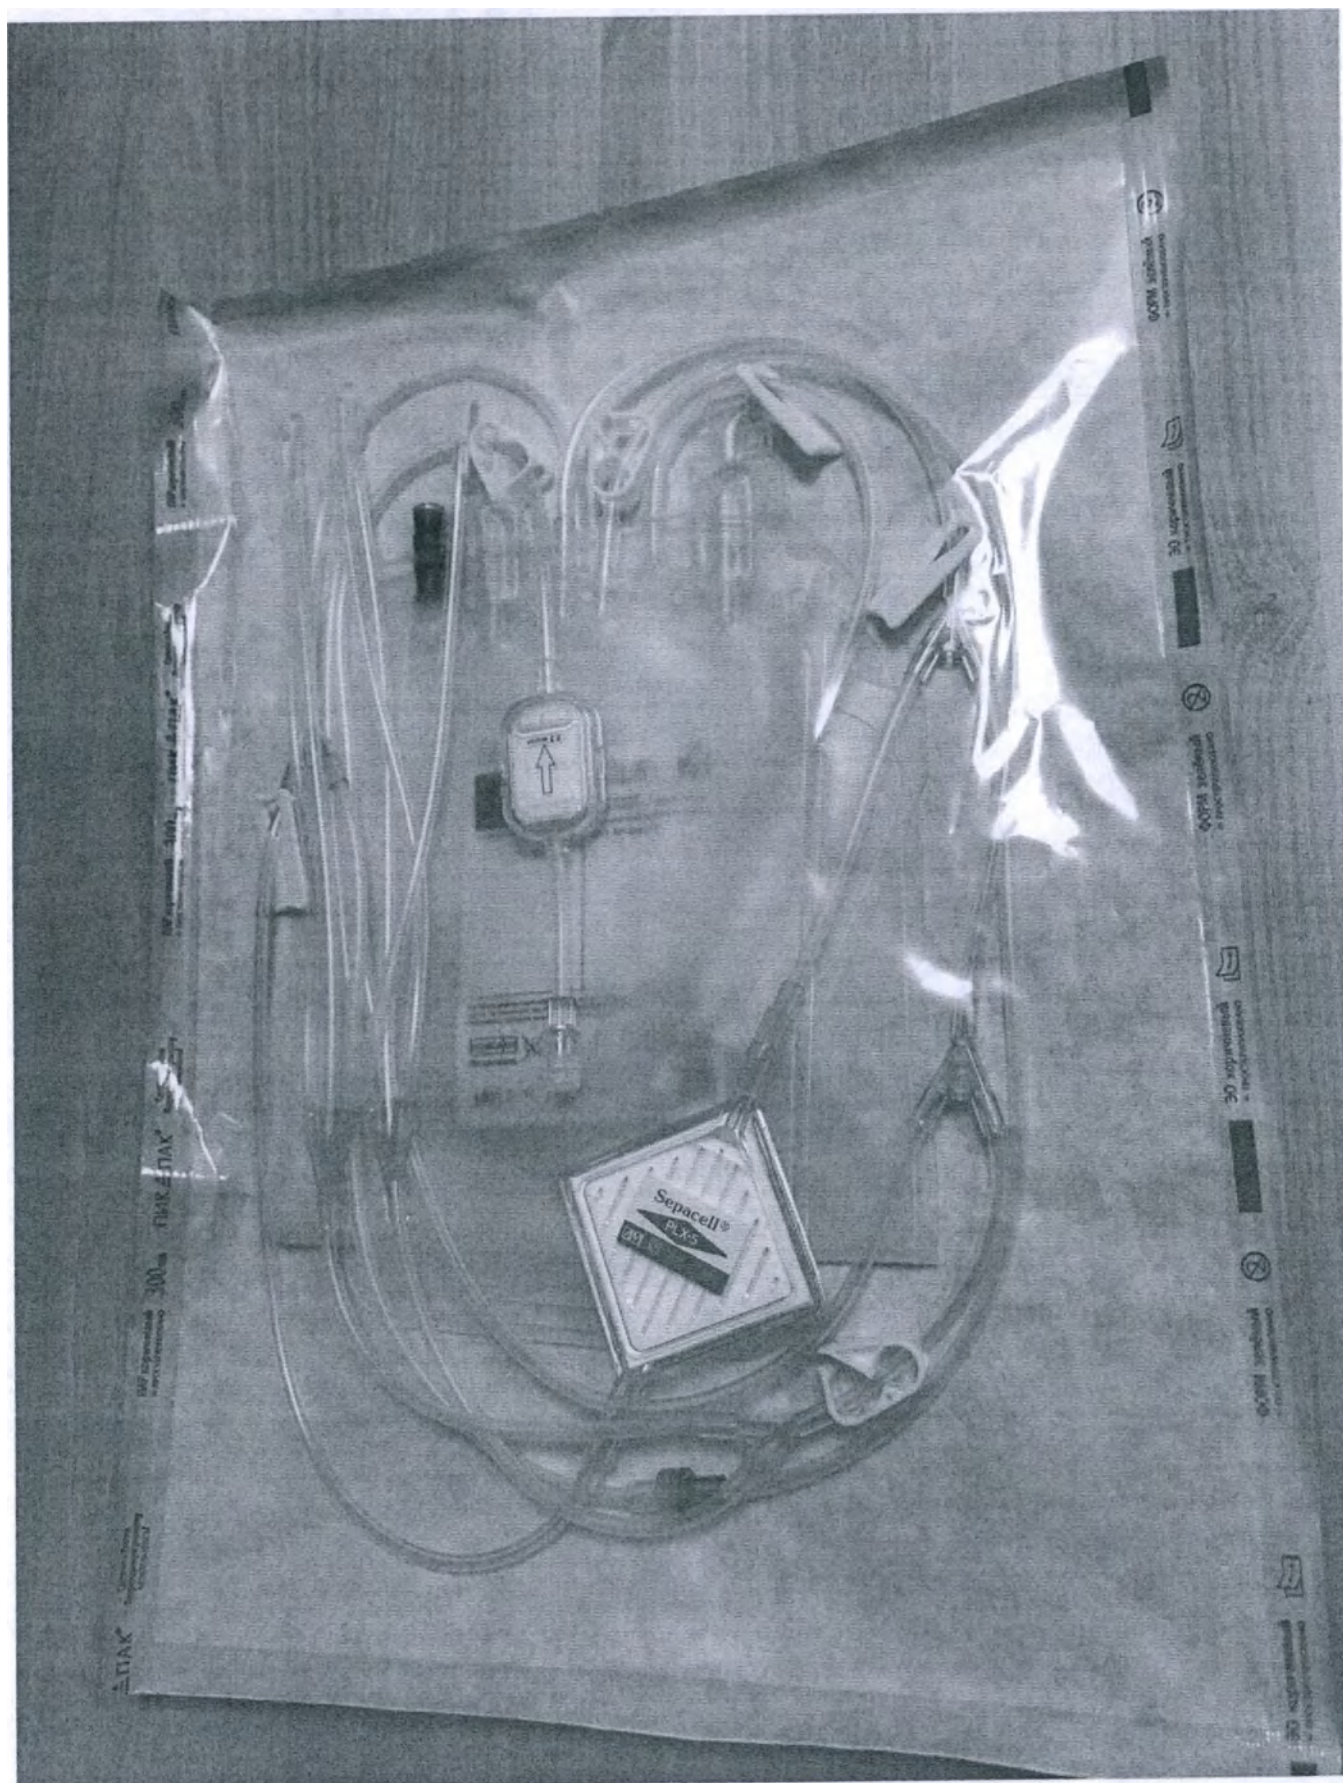

III. Макет этикеток

Этикетка тары потребительской

	ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204 mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru
Система для пулирования компонентов крови с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-8» ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 ПУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.	
STERILE EO                     	



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru

Система для пулирования компонентов крови

с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-8»

ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 РУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.

LOT



шт.

STERILE EO

Нетоксично



REF

PHID

Место производства:



Виробан

ООО «Виробан»
141981, Россия, Московская область, г. Дубна,
ул. Приборостроителей, д. 3А
Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Макет этикетки тары транспортной



LEADCORE



ООО «ЛИДКОР», Россия, 620102, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Посадская, д. 23, офис 204
mail@leadcore.ru, www.leadcore.ru


REF

Система для пулирования компонентов крови с фильтром лейкоцитарным «Тромбосейв-8»

ТУ 32.50.13-024-70440344-2017 РУ № РЗН 2017/6587 от 00.00.0000 г.

STERILE EO

Нетоксично



+5°C — +40°C
Хранение

-50°C — +50°C
Транспортировка



75 кг
max



ШТ.

Брутто: кг

LOT



место для
штрих-кода

6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 2

PHID



место для
штрих-кода

6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 2



Виробан

Место производства:

ООО «Виробан»

141981, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей, д. 3А

Тел.: +7 (49621) 2-88-61, opinion@viroban.ru

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 42 (сорок два) л.



Директор
ООО «ЛИДКОР»

02 / Е.Ю. Гохгут