

Фотографические изображения

«Реагенты в кассете для количественного определения бикарбоната (HCO_3^-) в сыворотке и плазме крови на модулях биохимических cobas c (CO2-L/ Bicarbonate Liquid cobas c systems)»

кассеты в кассете для количественного определения бикарбоната (HCO_3^-) в сыворотке и плазме крови на модулях химических cobas c (CO2-L/ Bicarbonate Liquid cobas c systems)



ты в кассете для количественного определения бикарбоната (HCO_3^-) в сыворотке и плазме крови на модулях химических cobas c (CO2-L/ Bicarbonate Liquid cobas c systems)



ы в кассете для количественного определения бикарбоната (HCO_3^-) в сыворотке и плазме крови на модулях
мических cobas c (CO2-L/ Bicarbonate Liquid cobas c systems)



в кассете для количественного определения бикарбоната (HCO_3^-) в сыворотке и плазме
биохимических cobas c ($\text{CO}_2\text{-L/ Bicarbonate Liquid cobas c systems}$)

Реагенты в кассете для количественного определения бикарбоната (HCO_3^-) в сыворотке и плазме
крови на модулях биохимических cobas c ($\text{CO}_2\text{-L/ Bicarbonate Liquid cobas c systems}$)



Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Roche Diagnostik GmbH"), Sandhofer Strasse 116, 68305
Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики *in vitro*


Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной
ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубиная
площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64.

E-mail: moscow.reception2_dia@roche.com

Инструкция по применению на русском языке на бумажном носителе предоставляется отдельно (для
запроса необходимо обратиться к уполномоченному представителю на территории РФ, контакты
см. выше)

Кат. номер 08057494190


в кассете для количественного определения бикарбоната (HCO_3^-) в сыворотке и плазме крови на модулях
анализических cobas c (CO2-L/ Bicarbonate Liquid cobas c systems)

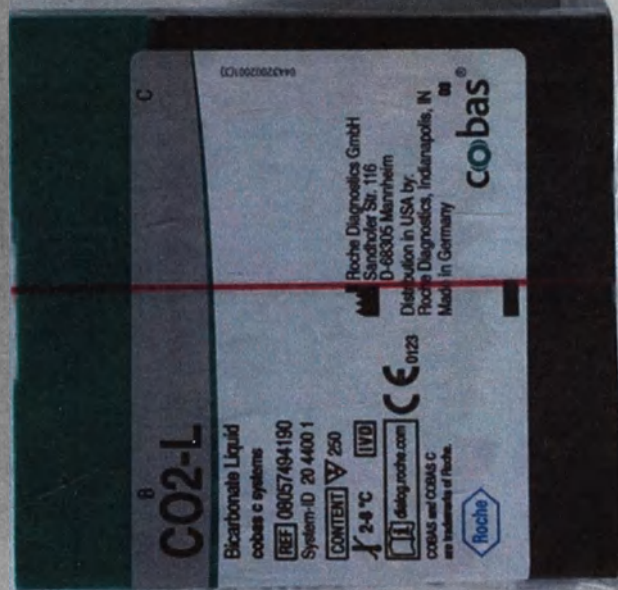

в кассете для количественного определения бикарбоната (HCO_3^-) в сыворотке и плазме крови на модулях
ических cobas c (CO2-L/ Bicarbonate Liquid cobas c systems)



ы в кассете для количественного определения бикарбоната (HCO_3^-) в сыворотке и плазме крови на модулях
мических cobas c (CO2-L/ Bicarbonate Liquid cobas c systems)

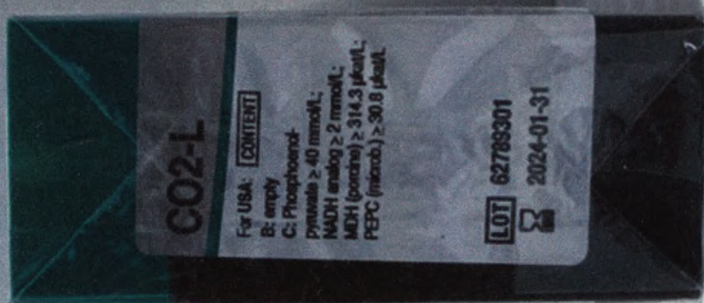

Реагенты в кассете для количественного определения бикарбоната (HCO_3^-) в сыворотке и плазме крови на модулях биохимических cobas c (CO2-L/ Bicarbonate Liquid cobas c systems)



Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Roche Diagnostik GmbH"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики *in vitro*

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трудовая площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64.

E-mail: moscow.reception2_dia@roche.com

Инструкция по применению на русском языке на бумажном носителе предоставляется отдельно (для запроса необходимо обратиться к уполномоченному представителю на территории РФ, контакты см. выше)

Кат. номер 08057494190

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

9 листа (ов)



по доверенности
от 30.01.2023 г.