

*Дополнение к Фотографическим изображениям
медицинского изделия*

**Имплантат внутридермальный биodeградируемый
на основе гиалуроната натрия Biotrisse Evo
в вариантах исполнения
Biotrisse Evo Soft 20,
Biotrisse Evo Medium 25,
Biotrisse Evo Deep 30.**

Производства

ООО «И.Р.А. Институт прикладных исследований»

(I.R.A. Istituto Ricerche Applicate S.R.L.)

Via del Lavoro, 4a/6 20865 Usmate Velate (MB) ITALY (Италия)

Biotrisse
Evo
Soft 20

Cross-linked
Hyaluronic Acid



Biotrisse AG
Gewerbestrasse 5
CH-6330, Cham
Switzerland

Rev. 02 / 2016-10-24

Имплантат внутридермальный биодеградируемый на основе
гиалуроната натрия Biotrisse Evo Soft 20

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Шприц стерильный имплантатом, объём 1 мл - 2 шт.
2. Игла стерильная одноразовая размером 30G x 1/2" (0,30 x 12 мм) с колпачком - 4 шт.
3. Опора для шприца - 2 шт.
4. Этикетки самоклеющиеся - 6 шт.
5. Инструкция по применению - 1 шт.

НЕТОКСИЧНО

LOT

См. на упаковке

REF

См. на упаковке



См. на упаковке



См. на упаковке



Патентование символов см. в инструкции

Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:
ООО «Бютирис Рус»
Российская Федерация, 127015, г. Москва,
ул. Новодмитровская Б, д.36, строение 3,
этаж 2, пом. 1, ком. 1-3.
Телефон +79035445199 / +79652091772
info@biotrisse.com


ООО «И.Р.А. Институт прикладных исследований»
(I.R.A. Istituto Ricerche Applicate S.R.L.)
Via del Lavoro, 44/9
20065 Umate Velate (MI) ITALY (Италия)
Телефон: +39 039 631741 / +39 039 6755409
medic@irab.it

Регистрационное удостоверение № *** от ***

Гель на основе перекрестно связанной гиалуроновой кислоты для интрадермального введения. Содержит: два одноразовых стерильных шприца, содержащих каждый по 1 мл перекрестно связанной гиалуроновой кислоты (20 мг/мл), 4 стерильные одноразовые иглы 30G 1/2" (CE 0476). **ВНИМАНИЕ:** данный продукт может быть использован исключительно врачом посредством внутрикожной инъекции.

Имплантат внутридермальный биодеградируемый на основе гиалуроната натрия Biotrisse Evo Soft 20. Состав индивидуальной упаковки (вне упаковки).


Шприц стерильный
наполненный
имплантатом,
объем 1 мл - 1 шт.;

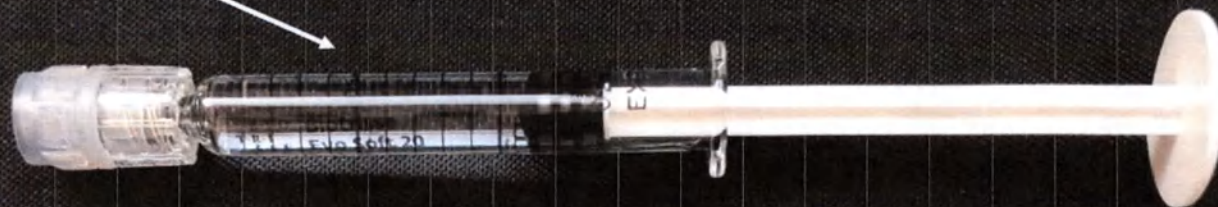



Игла стерильная
одноразовая размером
30G x 1/2" (0,30 x 12 мм)
с колпачком - 2 шт.;




Опора для
шприца - 1 шт.;

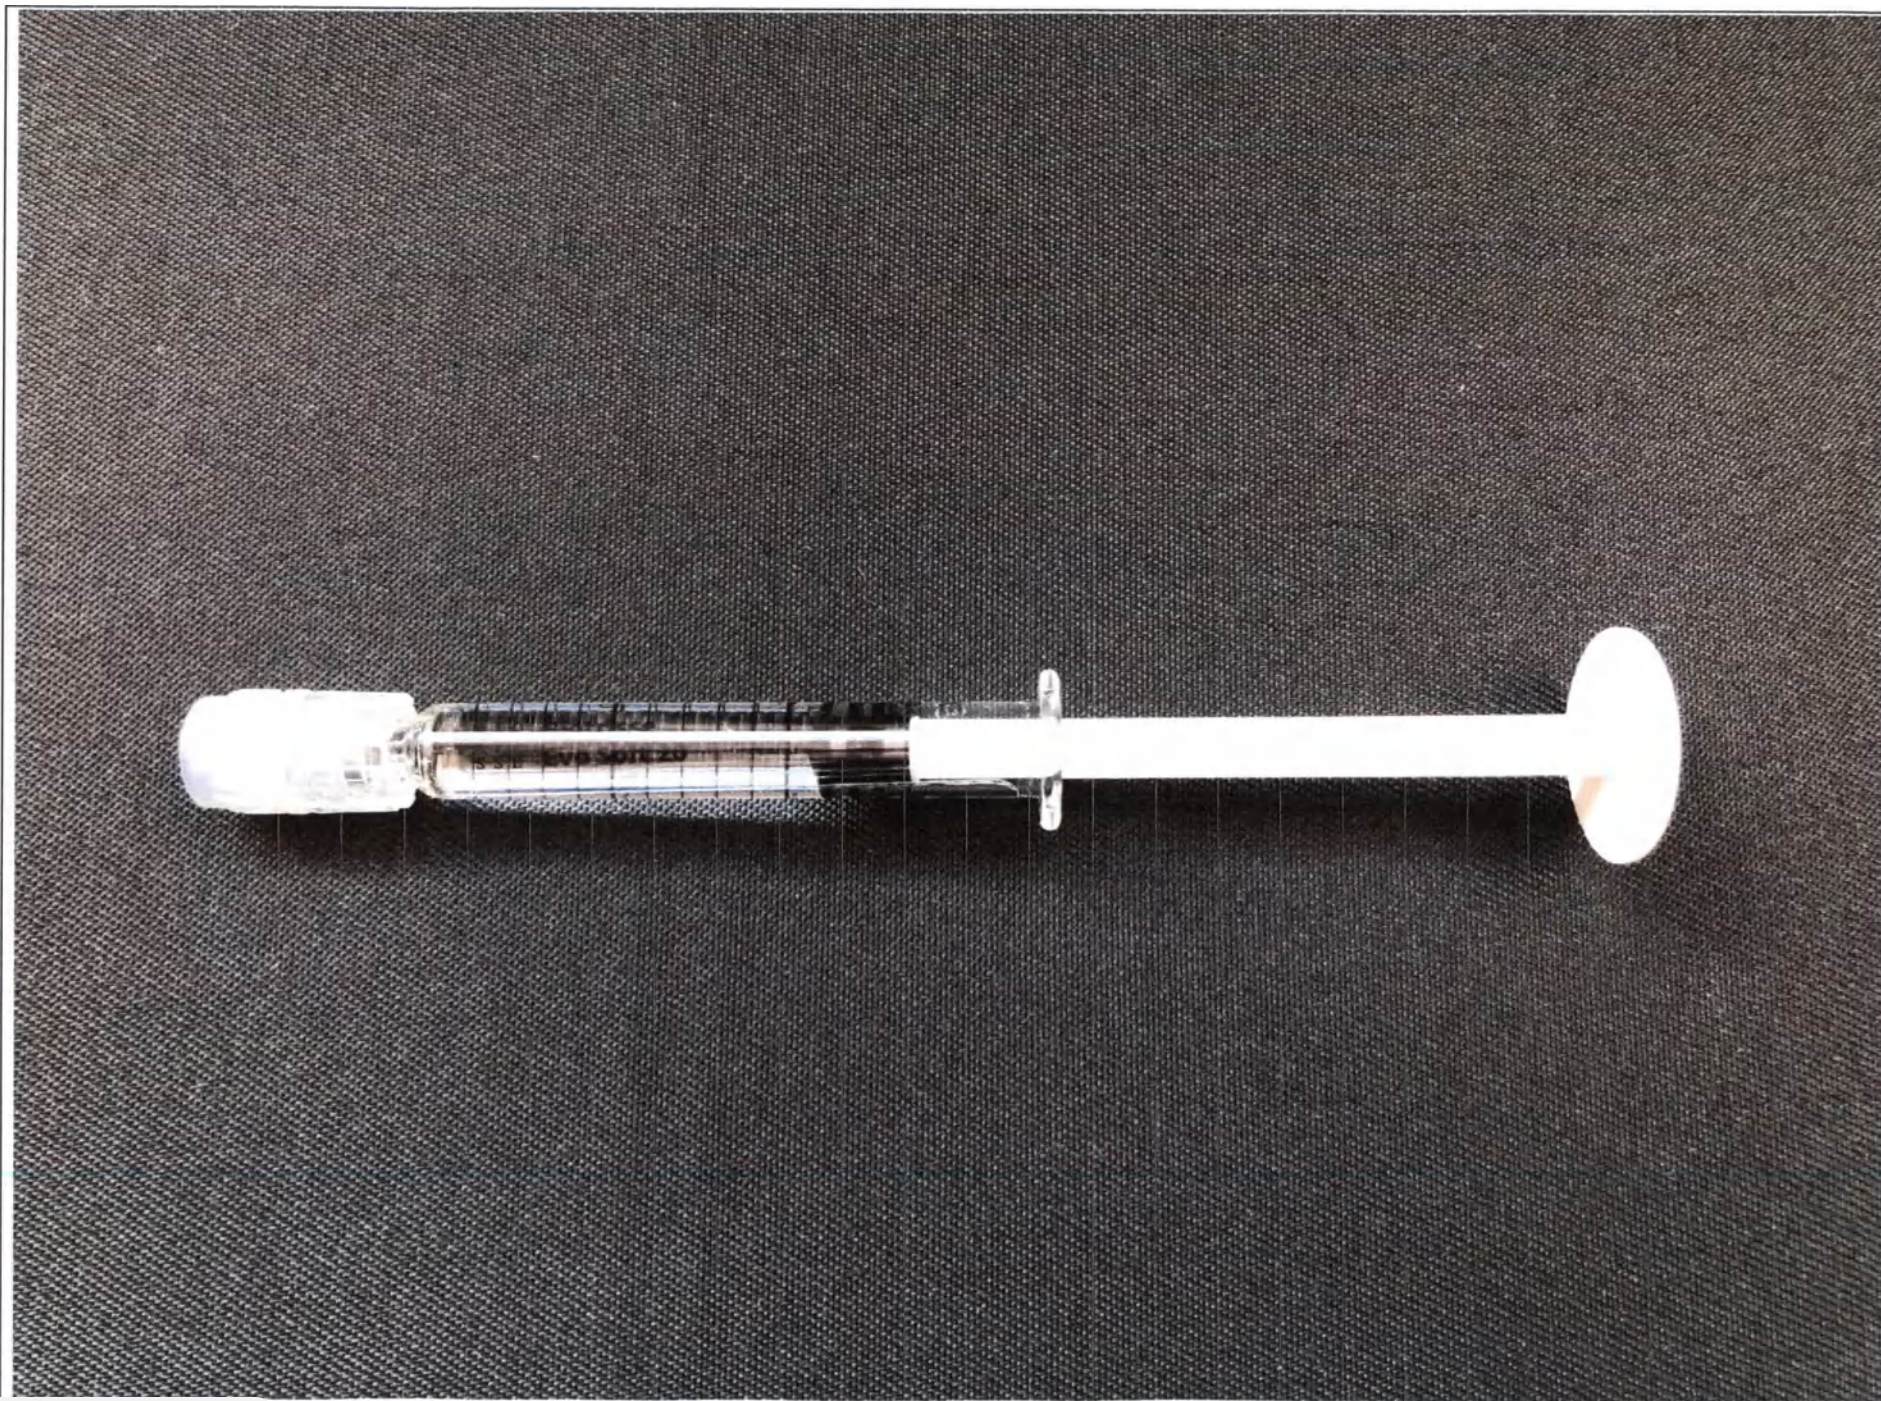

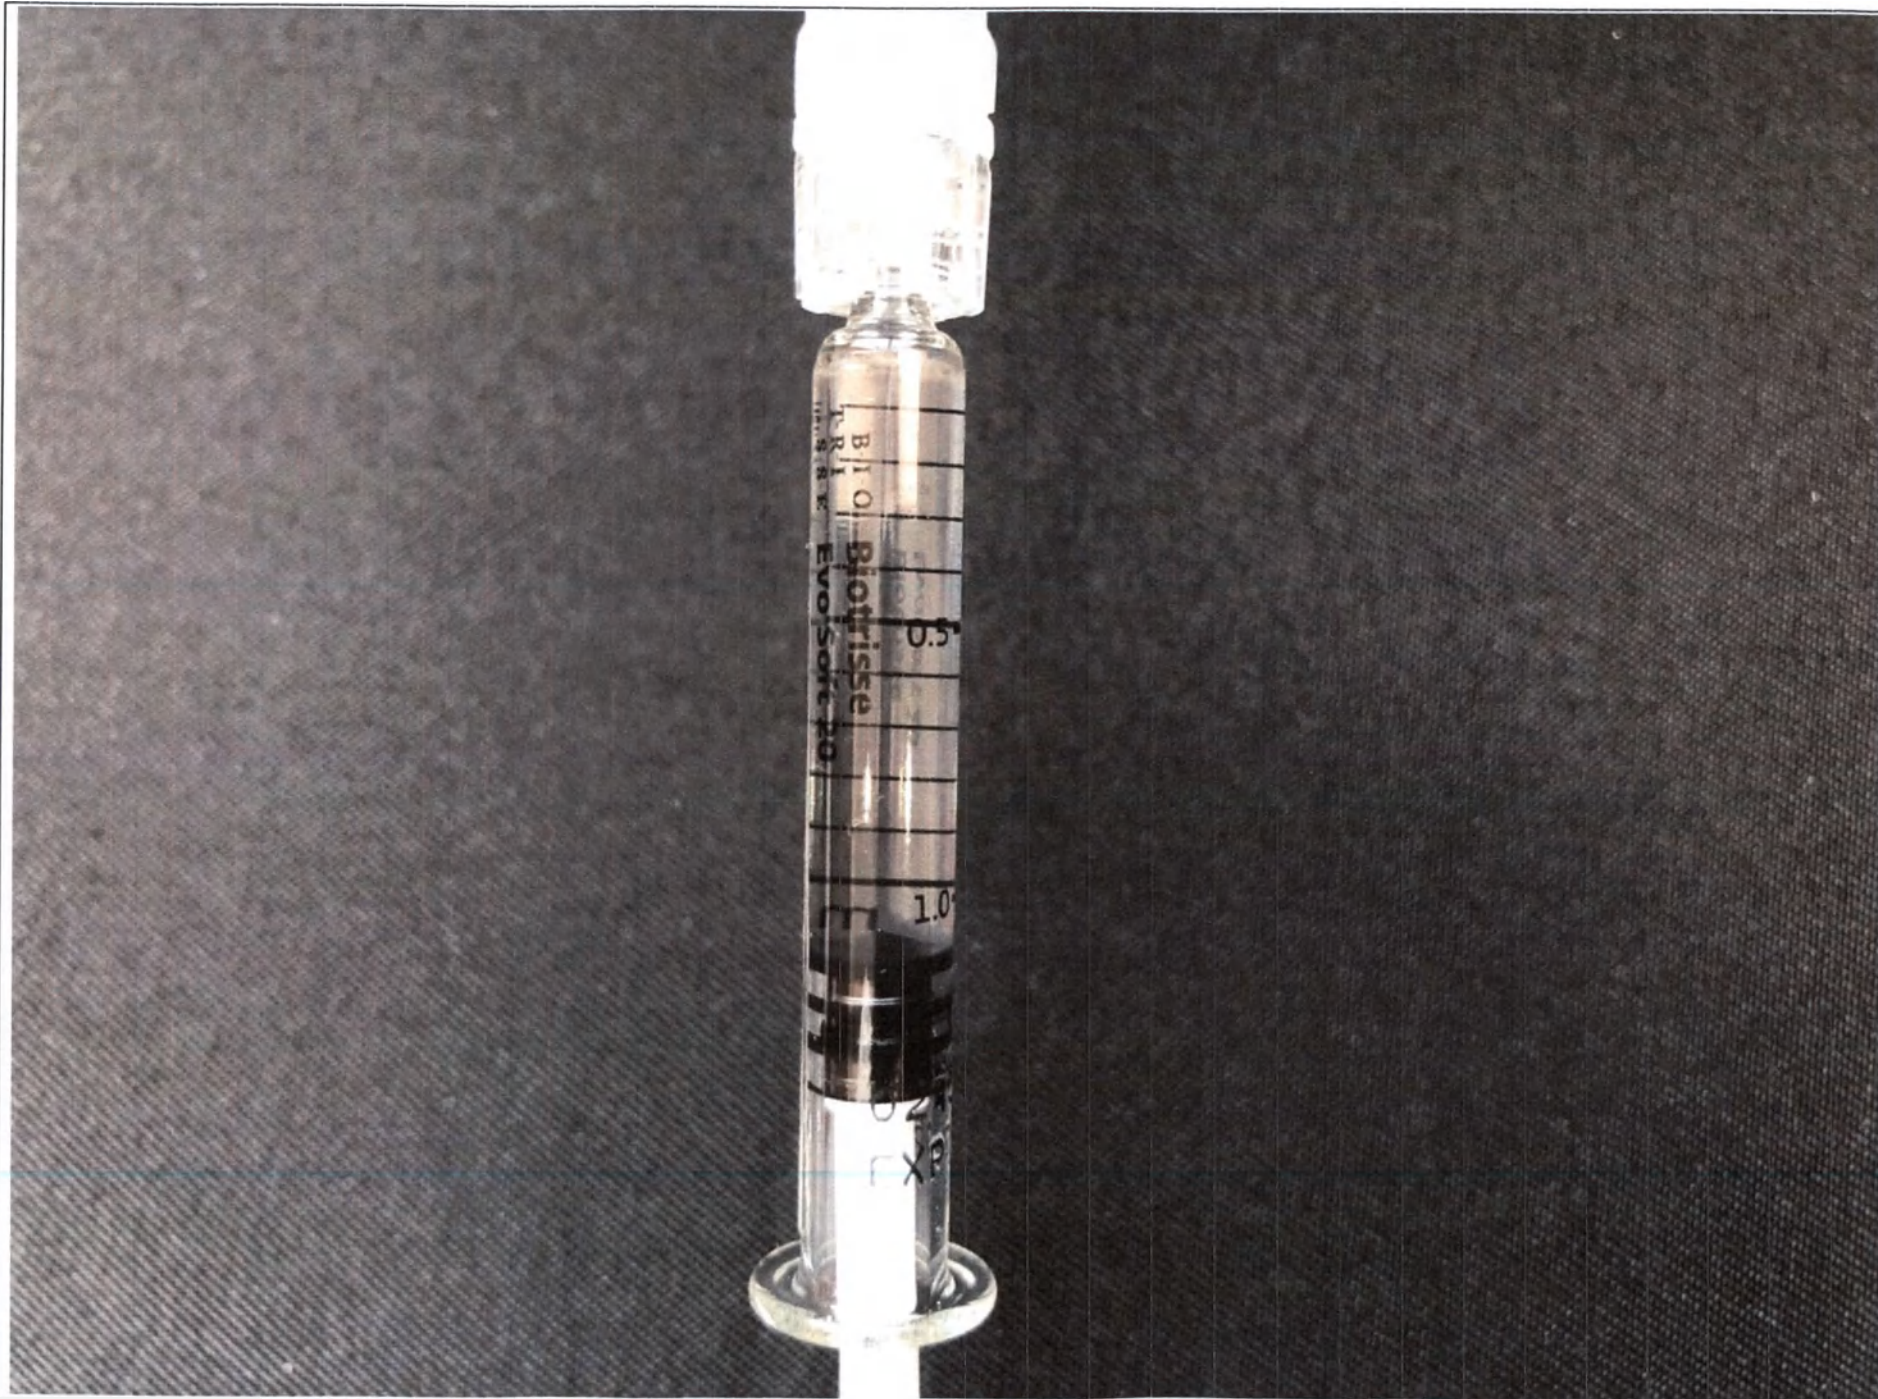

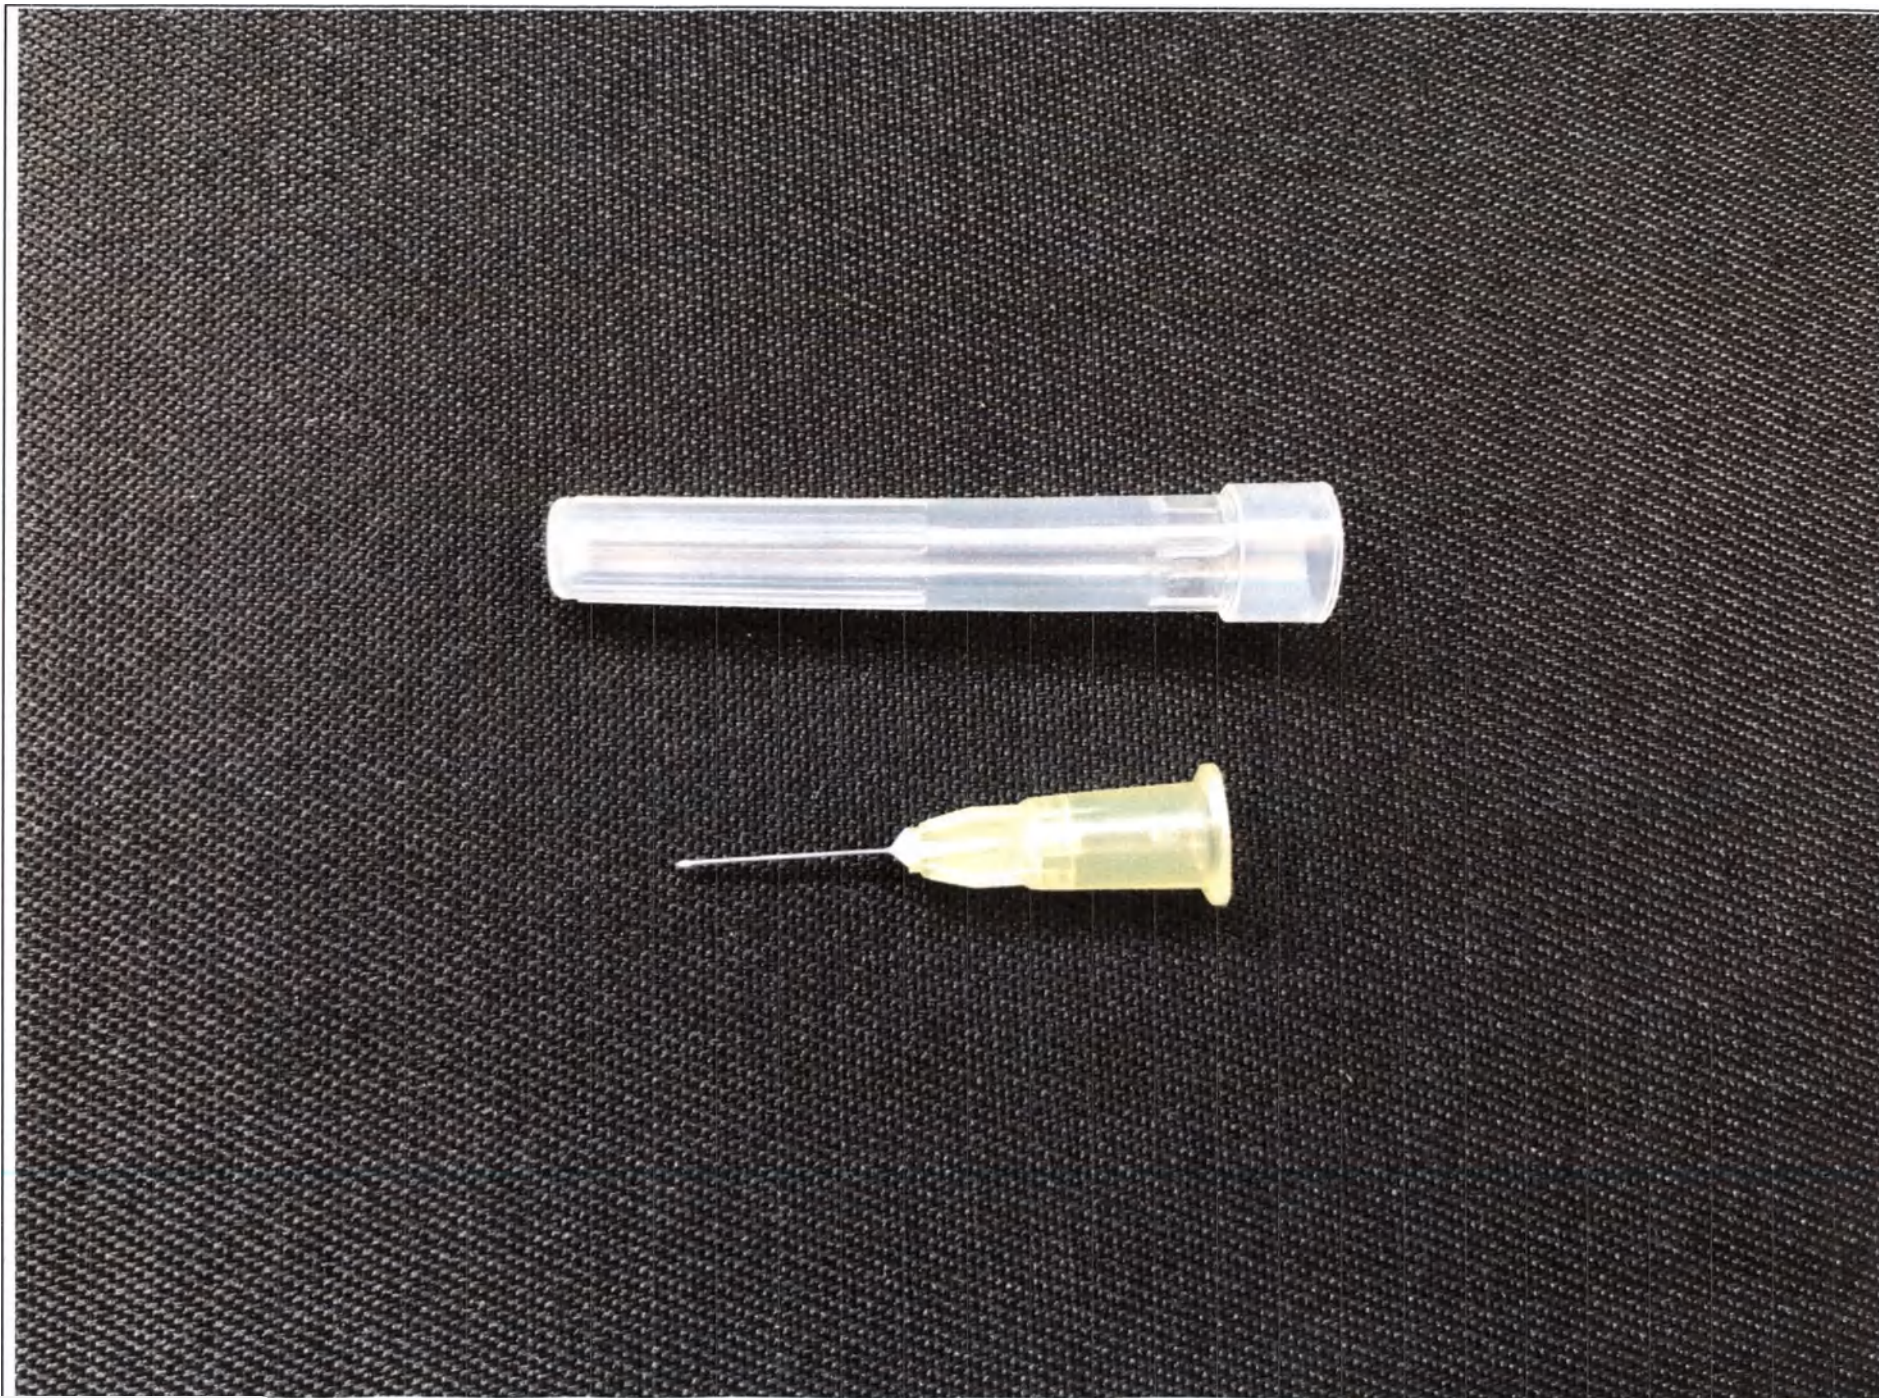

Имплантат внутридермальный биодеградируемый на основе гиалуроната натрия Biotrisse Evo Soft 20. Опора для шприца.

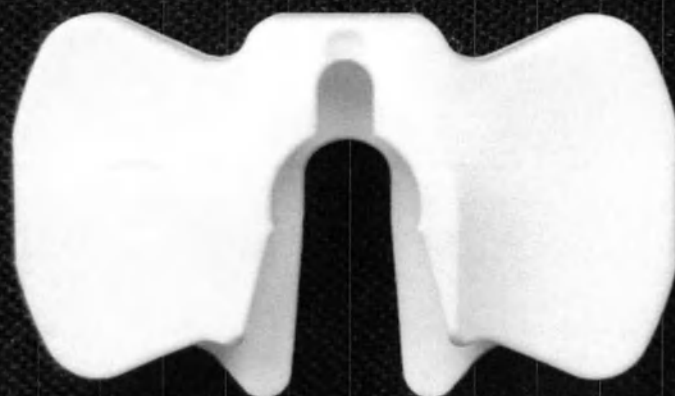

**Biotrisse
Evo
Medium 25**
Cross-linked
Hyaluronic Acid



Biotrisse AG
Gewerbstrasse 5
CH-6330, Cham
Switzerland

Rev 02/2015-10-24

Имплантат внутривидермальный биодеградируемый на основе
гиалуроната натрия Biotrisse Evo Medium 25

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Шприц стерильный одноразовый имплантатом, объем 1 мл - 2 шт.
2. Пила стерильная одноразовая размером 170 x 15 x (0.40 x 12 мм) x
количество - 4 шт.
3. Оперя для шприца - 2 шт.
4. Этикетка биодеградируемая - 4 шт.
5. Инструкция по применению - 1 шт.

НЕТОКСИЧНО

LOT

См. на упаковке

REF

См. на упаковке

См. на упаковке

См. на упаковке

2

STERILE A

STERILE B

0.25°C

1

1

1

1

1

Интерпретацию символов см. в инструкции


Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:
ООО «Бютирисс Рус»
Российская Федерация, 127015, г. Москва,
ул. Новодмитровская д. 36, строение 3,
этаж 2, пом. 1, комн. 1.3.
Телефон +7 (903) 5445199 / +7 (965) 091772
info@biotrisse.com

ООО «ИРПА. Институт прикладных исследований»
(I.R.A. Istituto Ricerche Applicate S.R.L.)
Via del Lavoro, 44/6
20865 Umate Valtale (MB) ITALY (Италия)
Телефон +39 039 631741 / +39 039 6755409
medical@icras.it

Регистрационное удостоверение № *** 01 ***


Тель на основе перекрестно связанной гиалуроновой кислоты для интрадермального введения. Содержит: два одно-
разовых стерильных шприца, содержащих каждый по 1 мл перекрестно связанной гиалуроновой кислоты
(25 мг/мл), 4 стерильные одноразовые пилы 170 x 15 x (0.40 x 12 мм) (CE 0476). **Внимание:** данный продукт может быть использован
исключительно врачом посредством внутривидермальной инъекции.

Имплантат внутридермальный биодеградируемый на основе гиалуроната натрия Biotrisse Evo Medium 25. Состав индивидуальной упаковки (вне упаковки).

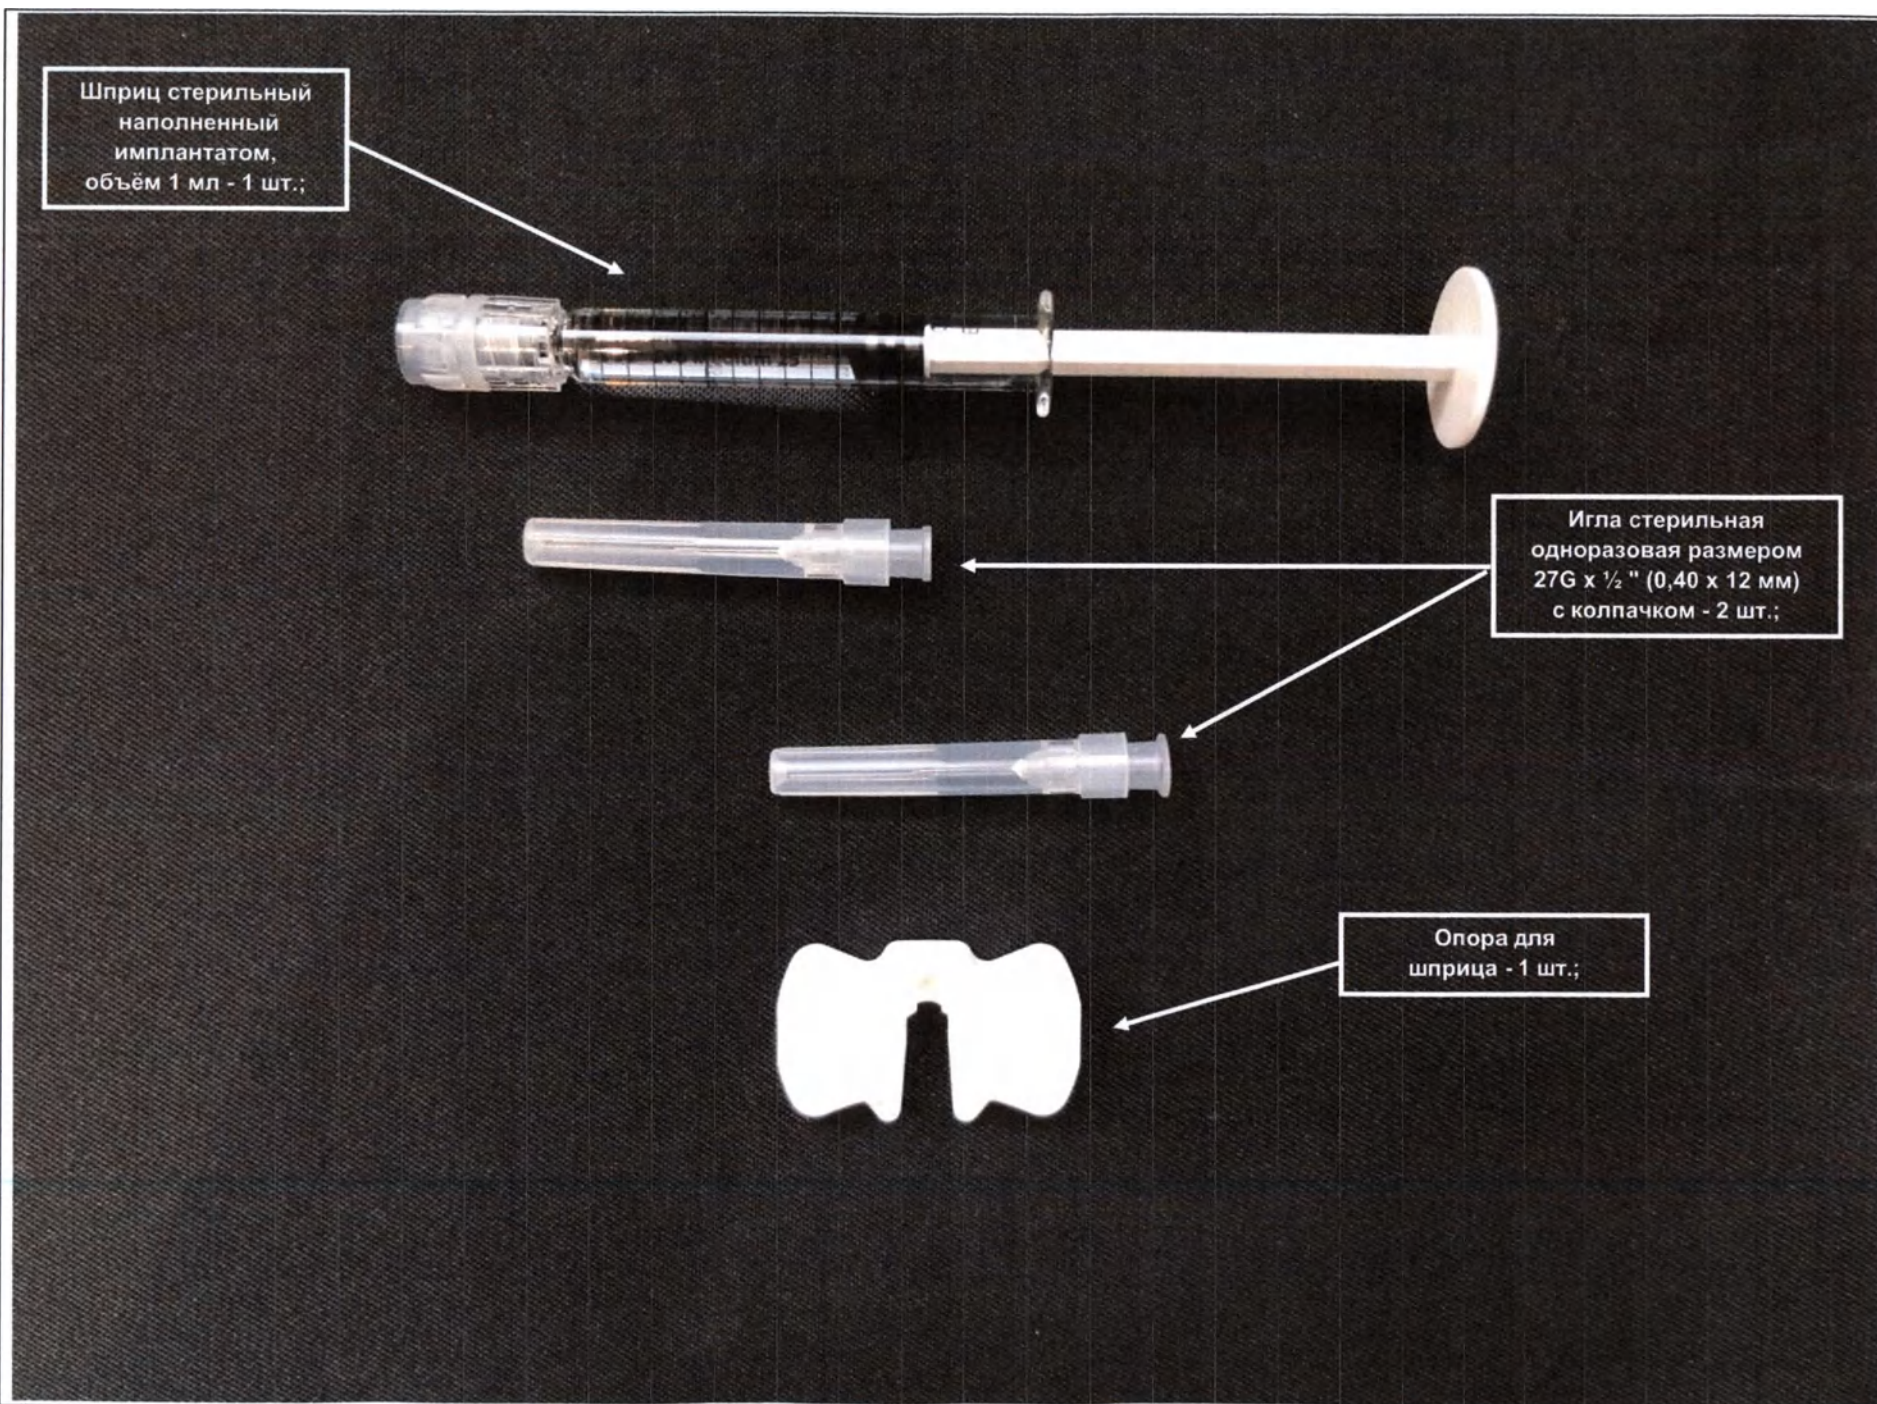





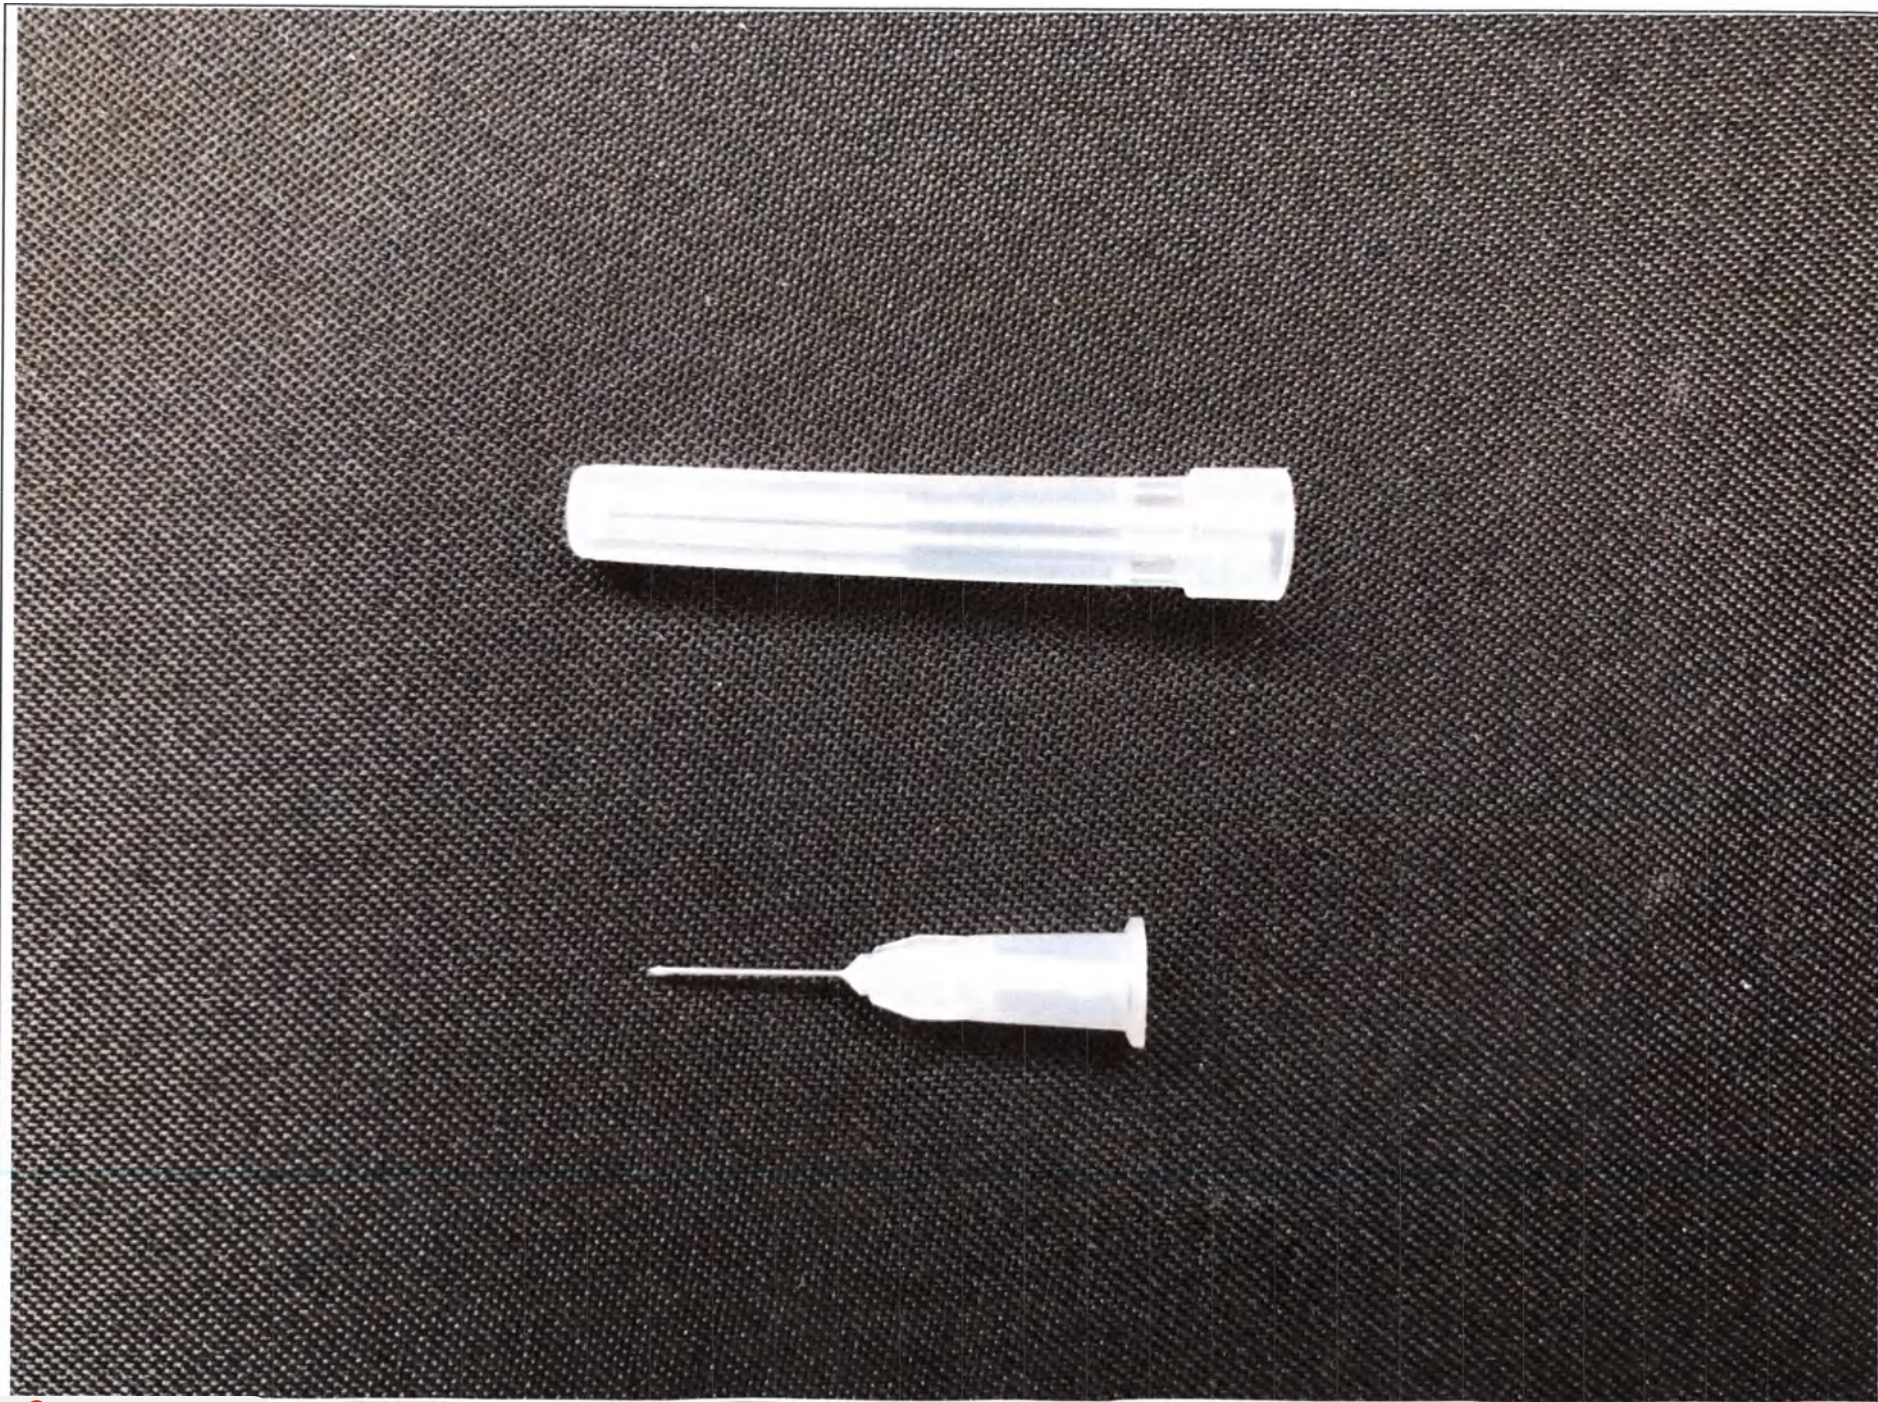

Имплантат внутридермальный биodeградируемый на основе гиалуроната натрия Biotrisse Evo Medium 25. Опора для шприца.



Biotrisse Evo Deep 30

Cross-linked
Hyaluronic Acid



Biotrisse AG
Chemiedistrikt
CH-8330, Cham
Switzerland

Rev 02 / 2016-10-24

Имплантат внутридермальный биодеградируемый на основе гиалуроната натрия Biotrisse Evo Deep 30

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Шарик стерильный имплантируемый, объем 1 мл - 2 шт.
2. Игла стерильная одноразовая (размер 26G x 1/2" (0,45 x 13 мм)) - 4 шт.
3. Шприц для инъекции - 2 шт.
4. Упаковка стерилизационная - 6 шт.
5. Инструкция по применению - 1 шт.

LOT	См. на упаковке	REF	См. на упаковке
	См. на упаковке		См. на упаковке

STERILE A

STERILE B

25°C

Интерпретацию символов см. в инструкции


Уполномоченный представитель
производителя на территории РФ:
ООО «Бютирисс Рус»
Российская Федерация, 127015, г. Москва,
ул. Новодмитровская д. 36, строение 3,
этаж 2, пом. 1, ком. 1-3.
Телефон +7 903 544 5199 / +7 965 209 1772
info@biotrisse.com


ООО «И.Р.А. Институт прикладных исследований»
(I.R.A. Istituto Ricerche Applicato S.R.L.)
Via del Lavoro, 4a/6
20865 Usmate Velate (MB) ITALY (Herculov)
Телефон +39 039 631741 / +39 039 6755409
medical@icra.it


Регистрационное удостоверение № *** 01 ***


Гель на основе перекрестно связанной гиалуроновой кислоты для интрадермального введения. Содержит два одноразовых стерильных шприца, содержащих каждый по 1 мл перекрестно связанной гиалуроновой кислоты (30 мг/мл), 4 стерильные одноразовые иглы 26G 1/2" (CE 0050). **Внимание:** данный продукт может быть использован исключительно врачом посредством внутрикожной инъекции.

Имплантат внутридермальный биодеградируемый на основе гиалуроната натрия Biotrisse Evo Deep 30. Состав индивидуальной упаковки (вне упаковки).

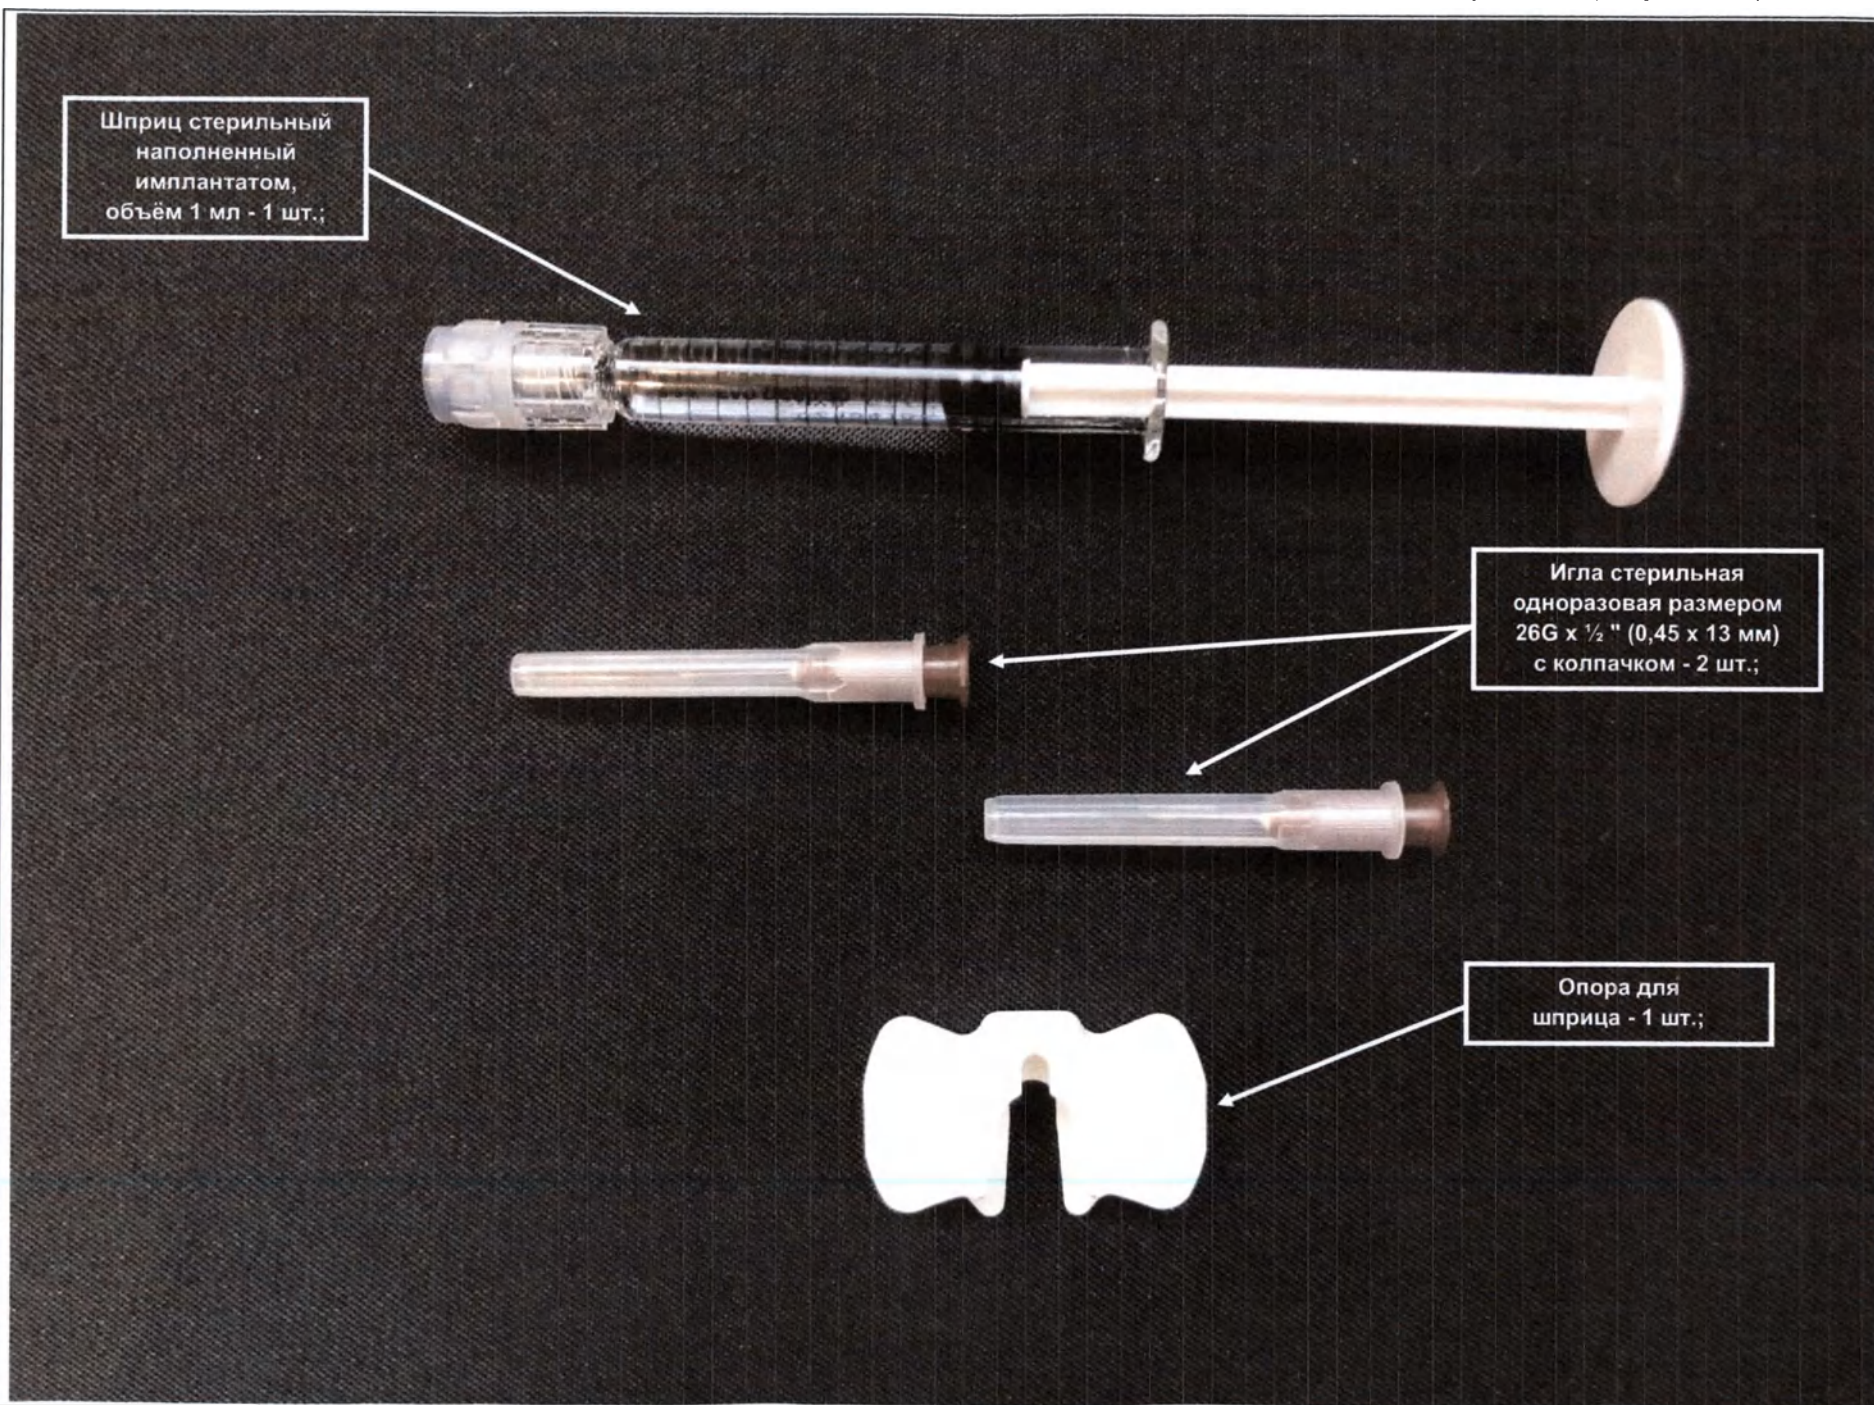


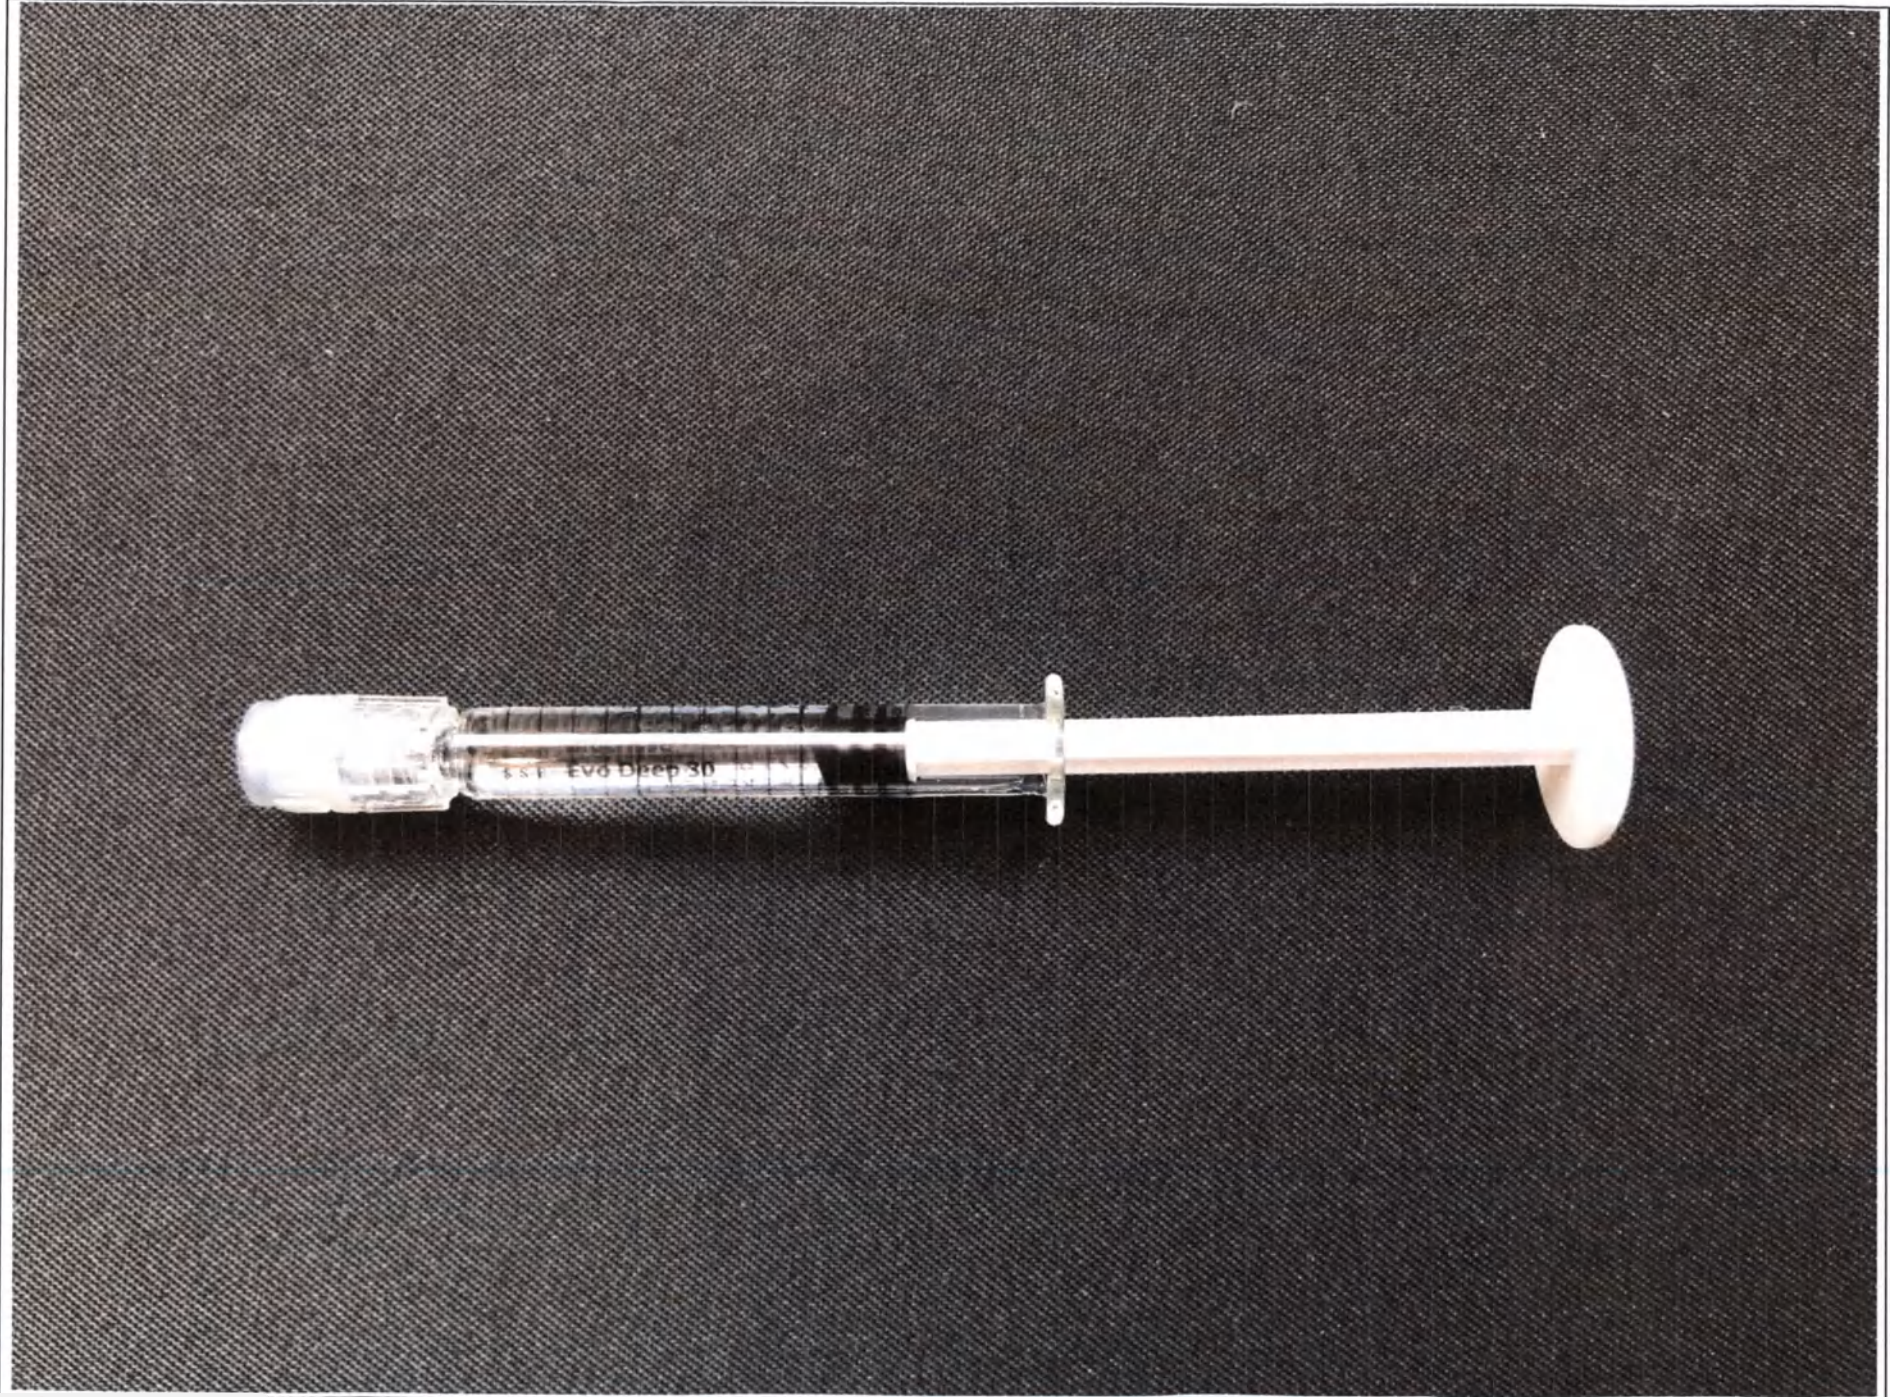

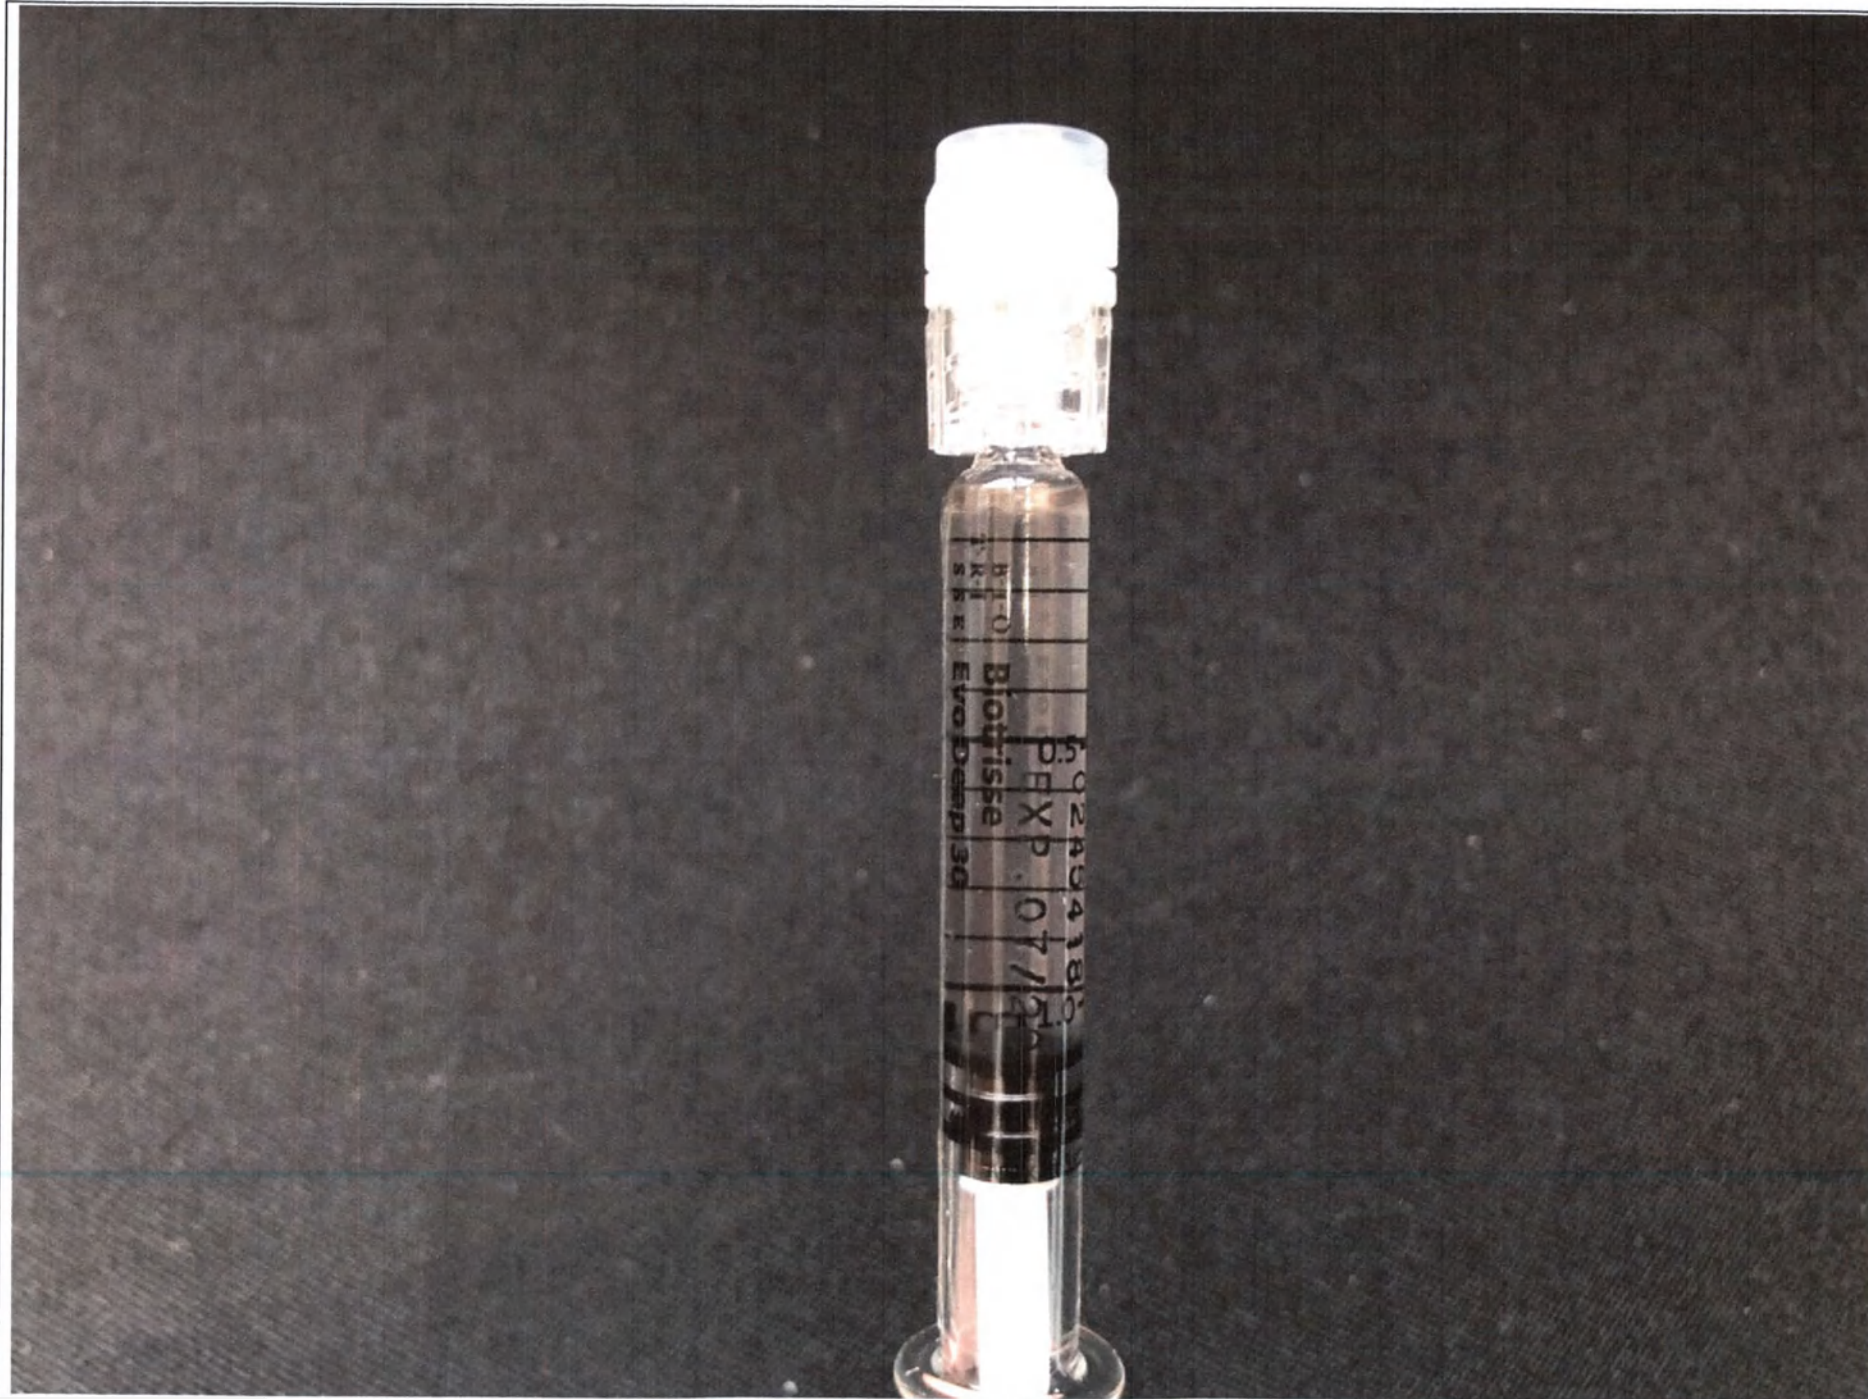

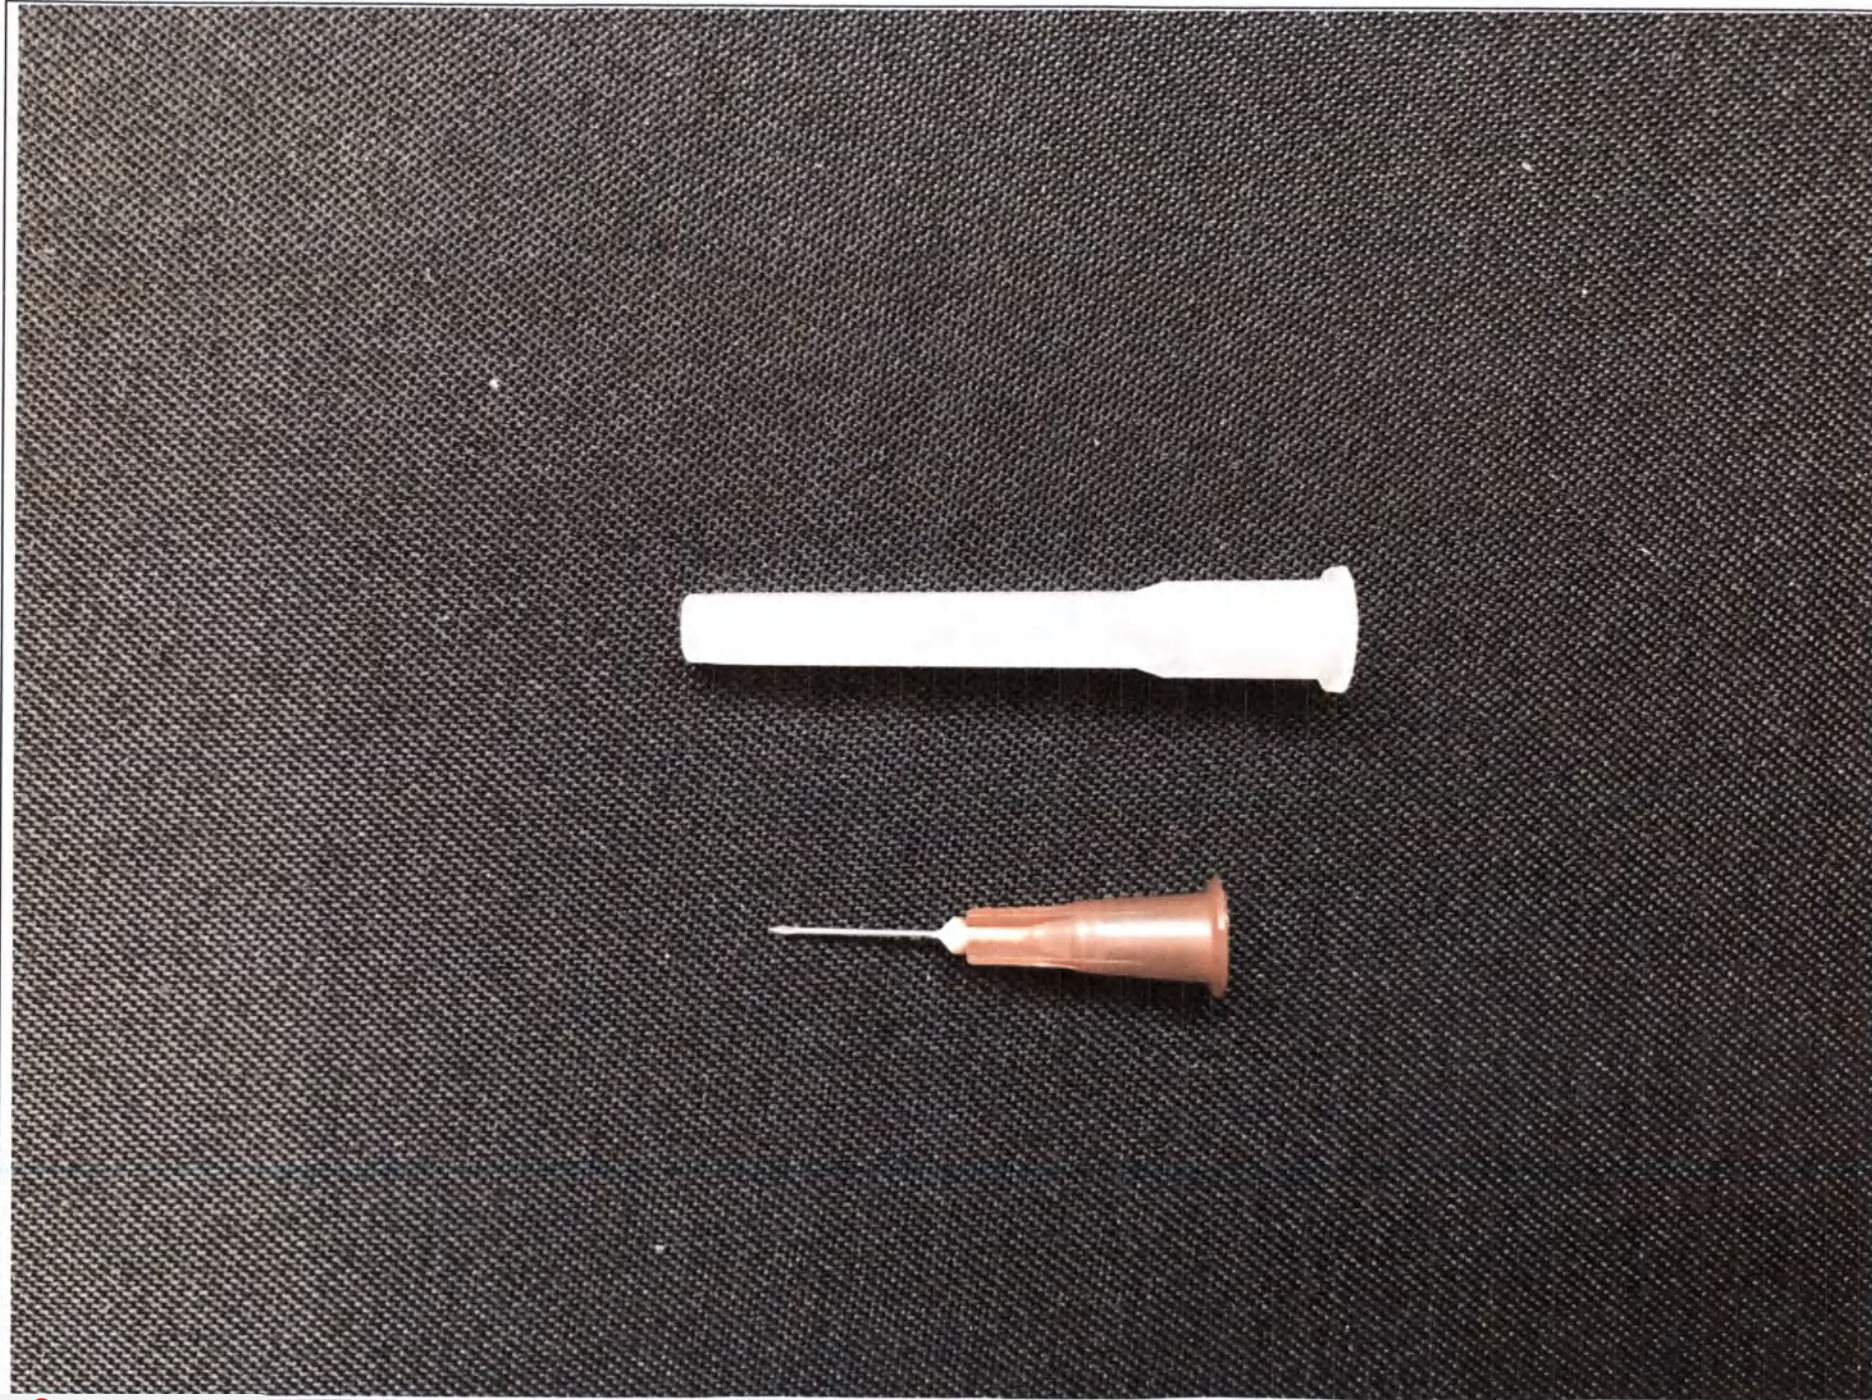

Имплантат внутридермальный биodeградируемый на основе гиалуроната натрия Biotrisse Evo Deep 30. Опора для шприца.

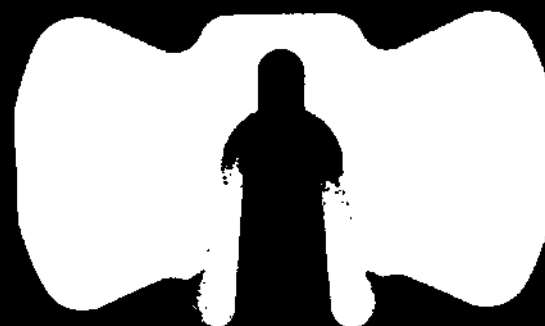

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
19 (двадцать девять) листов
Подпись

