

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Лидер»

Юминов М.А.



2022

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Облучатель-рециркулятор медицинский ультрафиолетовый бактерицидный «МЕДЭЙР» в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-001-39370457-2021

I. Фотографические изображения общего вида.

1. Модель: «МЕДЭЙР 15-1»
2. Модель: «МЕДЭЙР 15-2»
3. Модель: «МЕДЭЙР 15-3»
4. Модель: «МЕДЭЙР 15-1 ЛЮКС»
5. Модель: «МЕДЭЙР 15-2 ЛЮКС»
6. Модель: «МЕДЭЙР 15-3 ЛЮКС»
7. Модель: «МЕДЭЙР 30-1 ЛЮКС»
8. Модель: «МЕДЭЙР 30-2 ЛЮКС»
9. Модель: «МЕДЭЙР 30-3 ЛЮКС»
10. Модель: «МЕДЭЙР 30-4 ЛЮКС»
11. Модель: «МЕДЭЙР 30-6 ЛЮКС»
12. Модель: «МЕДЭЙР 30-8 ЛЮКС»
13. Модель: «МЕДЭЙР 30-1»
14. Модель: «МЕДЭЙР 30-2»
15. Модель: «МЕДЭЙР 30-3»
16. Модель: «МЕДЭЙР 30-4»
17. Модель: «МЕДЭЙР 30-6»
18. Модель: «МЕДЭЙР 30-8»


1. Ультрафиолетовая лампа 15 Вт, модель: UVC 15W G13
2. Ультрафиолетовая лампа 30 Вт, модель: UVC 30W G1
3. Фильтр
4. Шнур питания
5. Блок управления МЕДЭЙР-1
6. Вставка плавкая(предохранитель)
7. Фильтр
8. Крепежные элементы
9. Подставка передвижная для облучателя- рециркулятора МЕДЭЙР

II. Транспортная упаковка


III. Потребительская упаковка

IV. Маркировка.


Модель: «МЕДЭЙР 15-2»

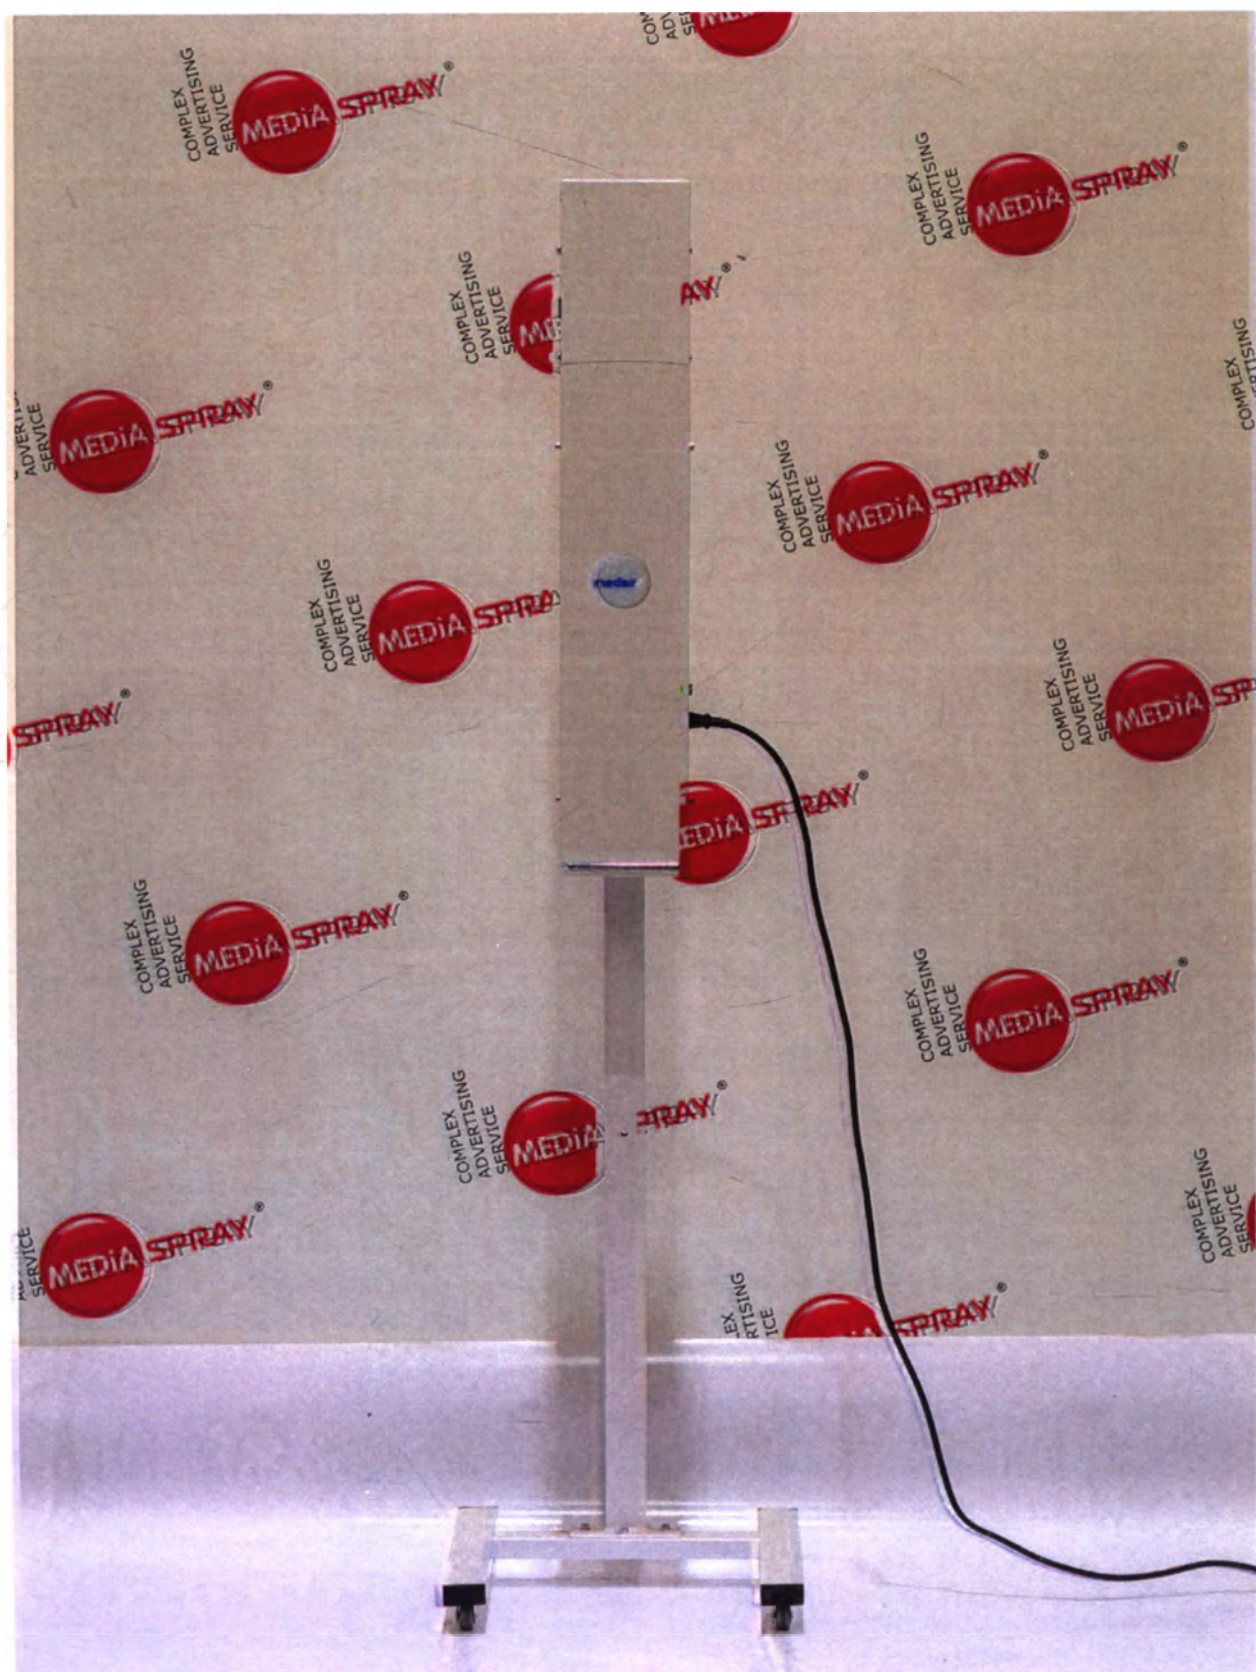


Модель: «МЕДЭЙР 15-3»

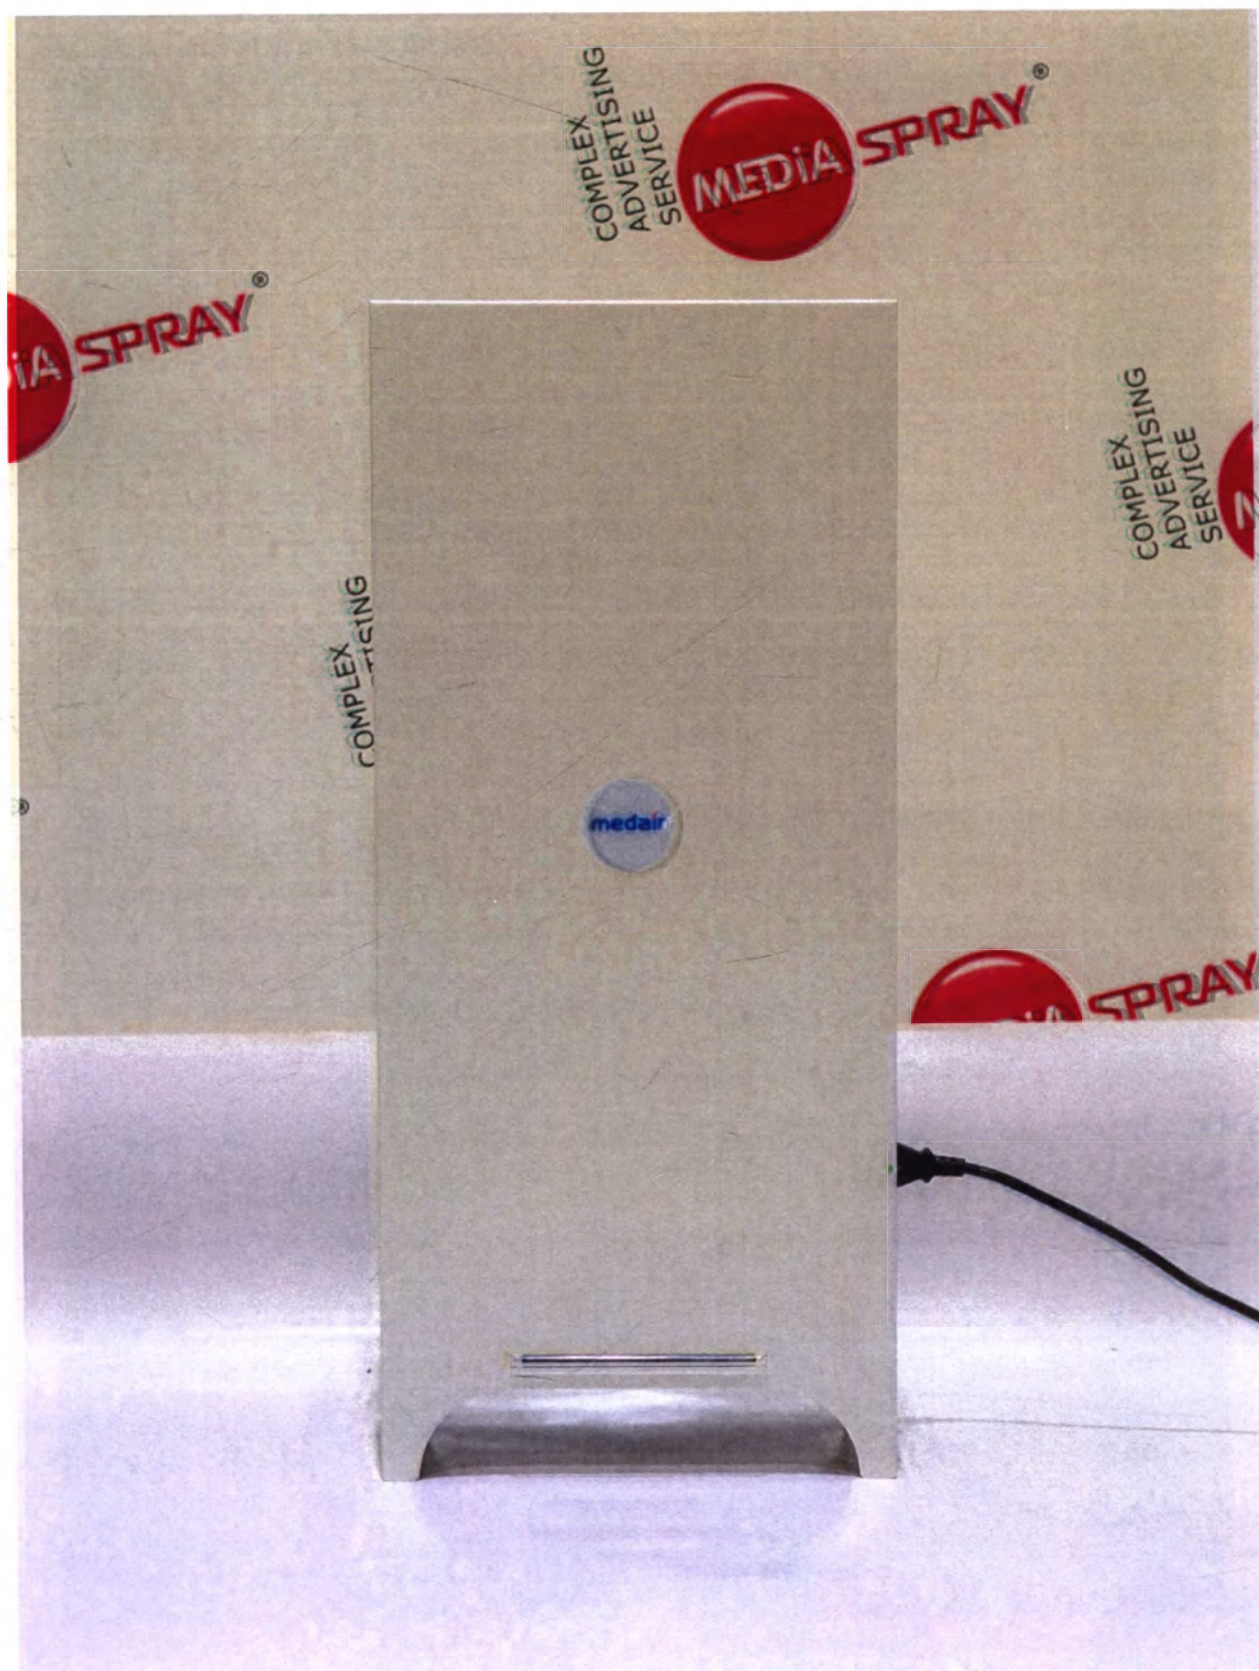


Модель: «МЕДЭЙР 15-1 ЛЮКС»

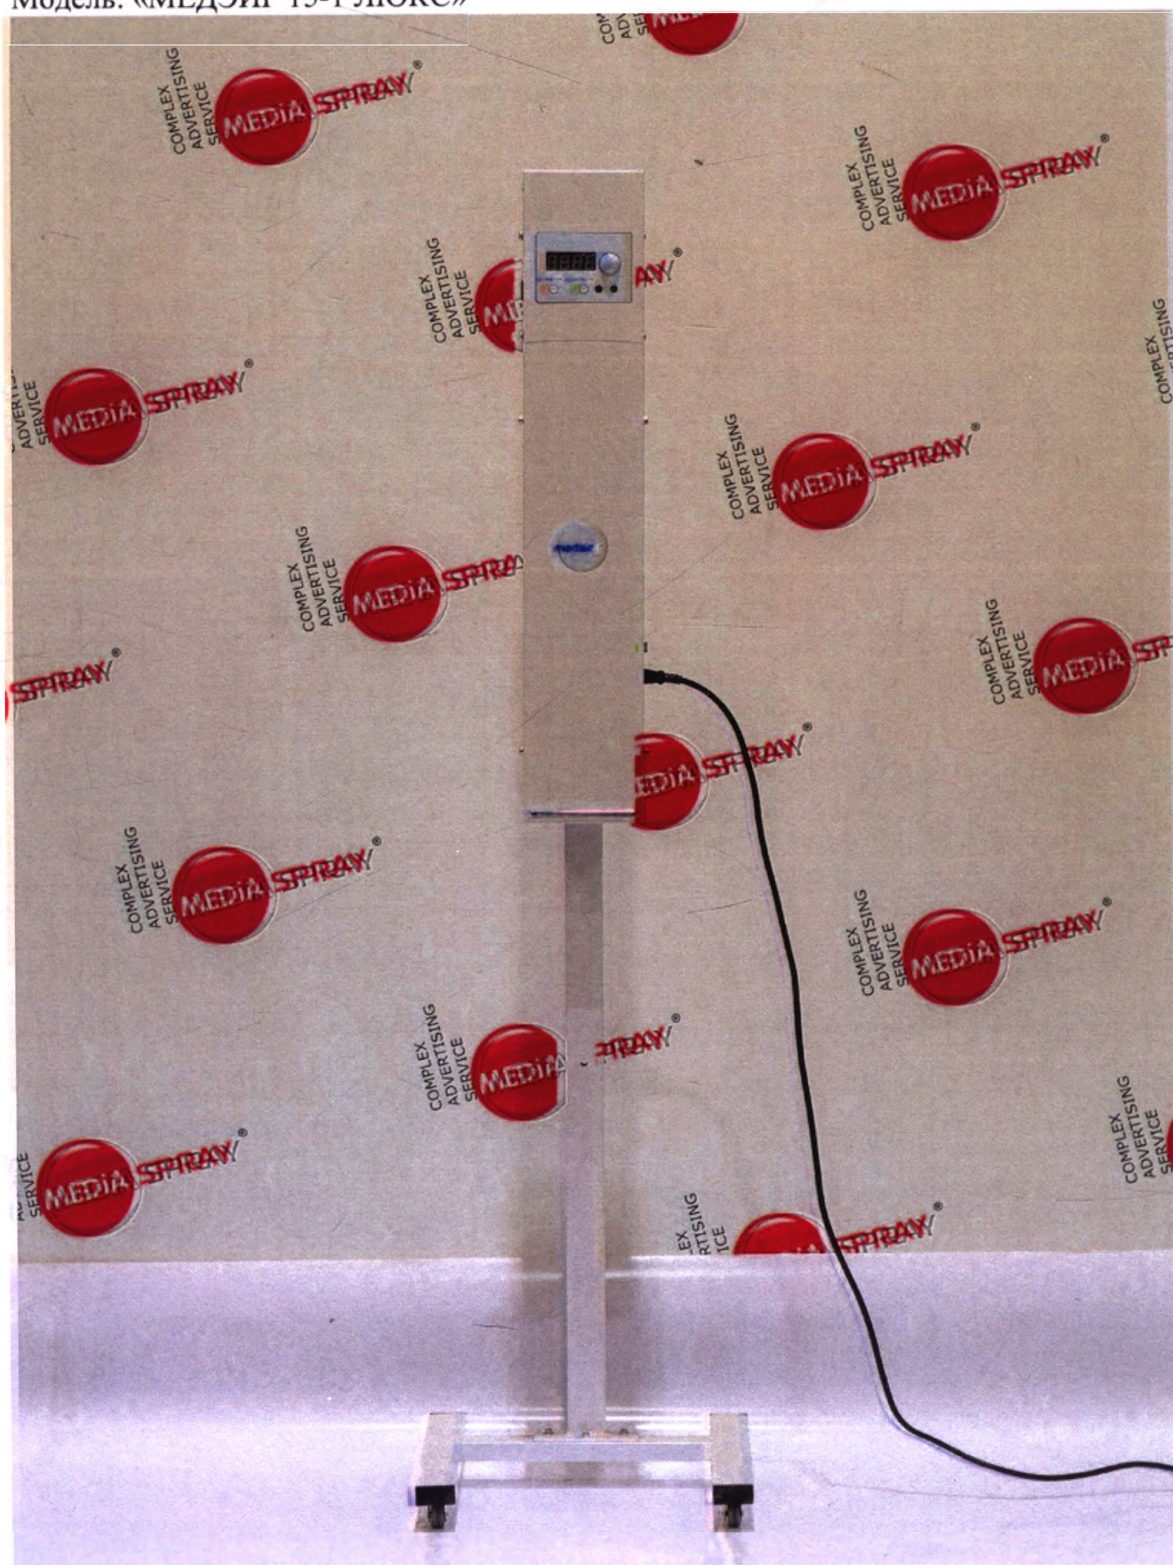


Модель: «МЕДЭЙР 15-2 ЛЮКС»

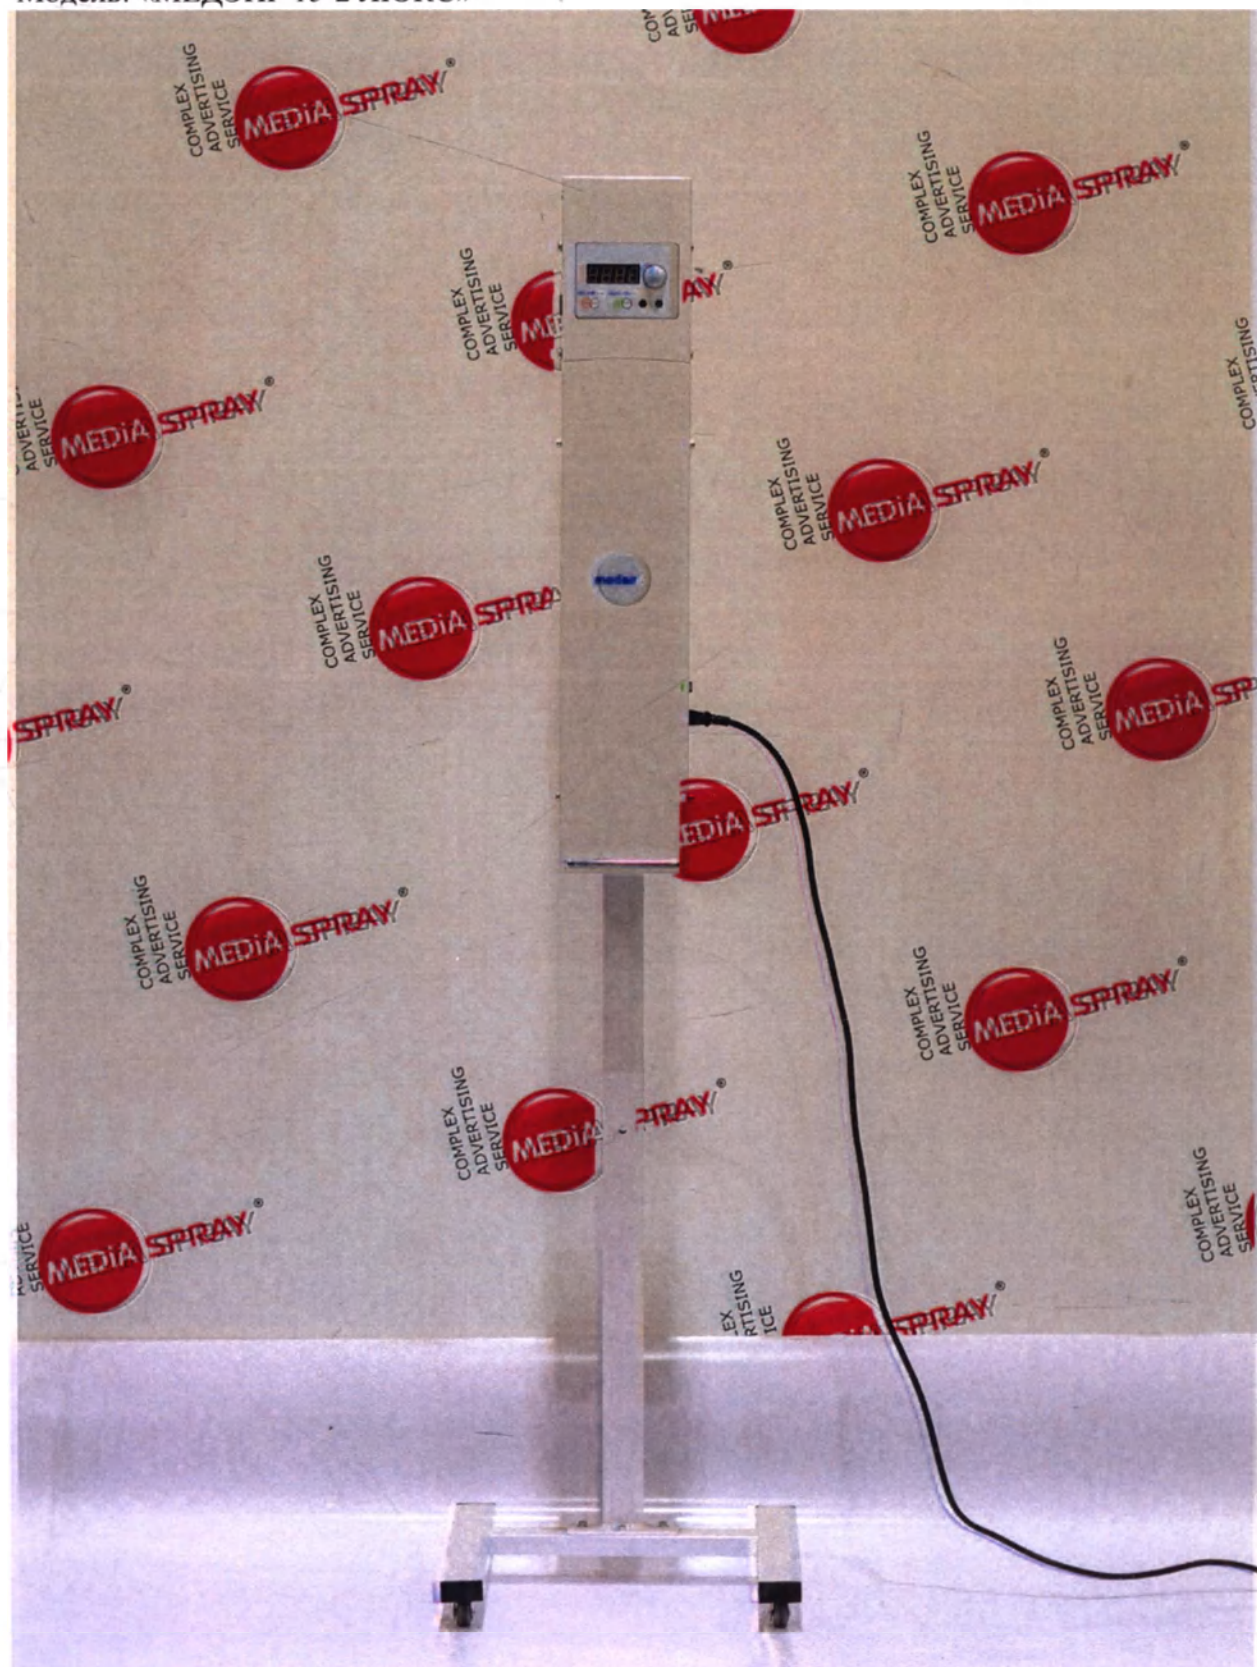


Модель: «МЕДЭЙР 15-3 ЛЮКС»

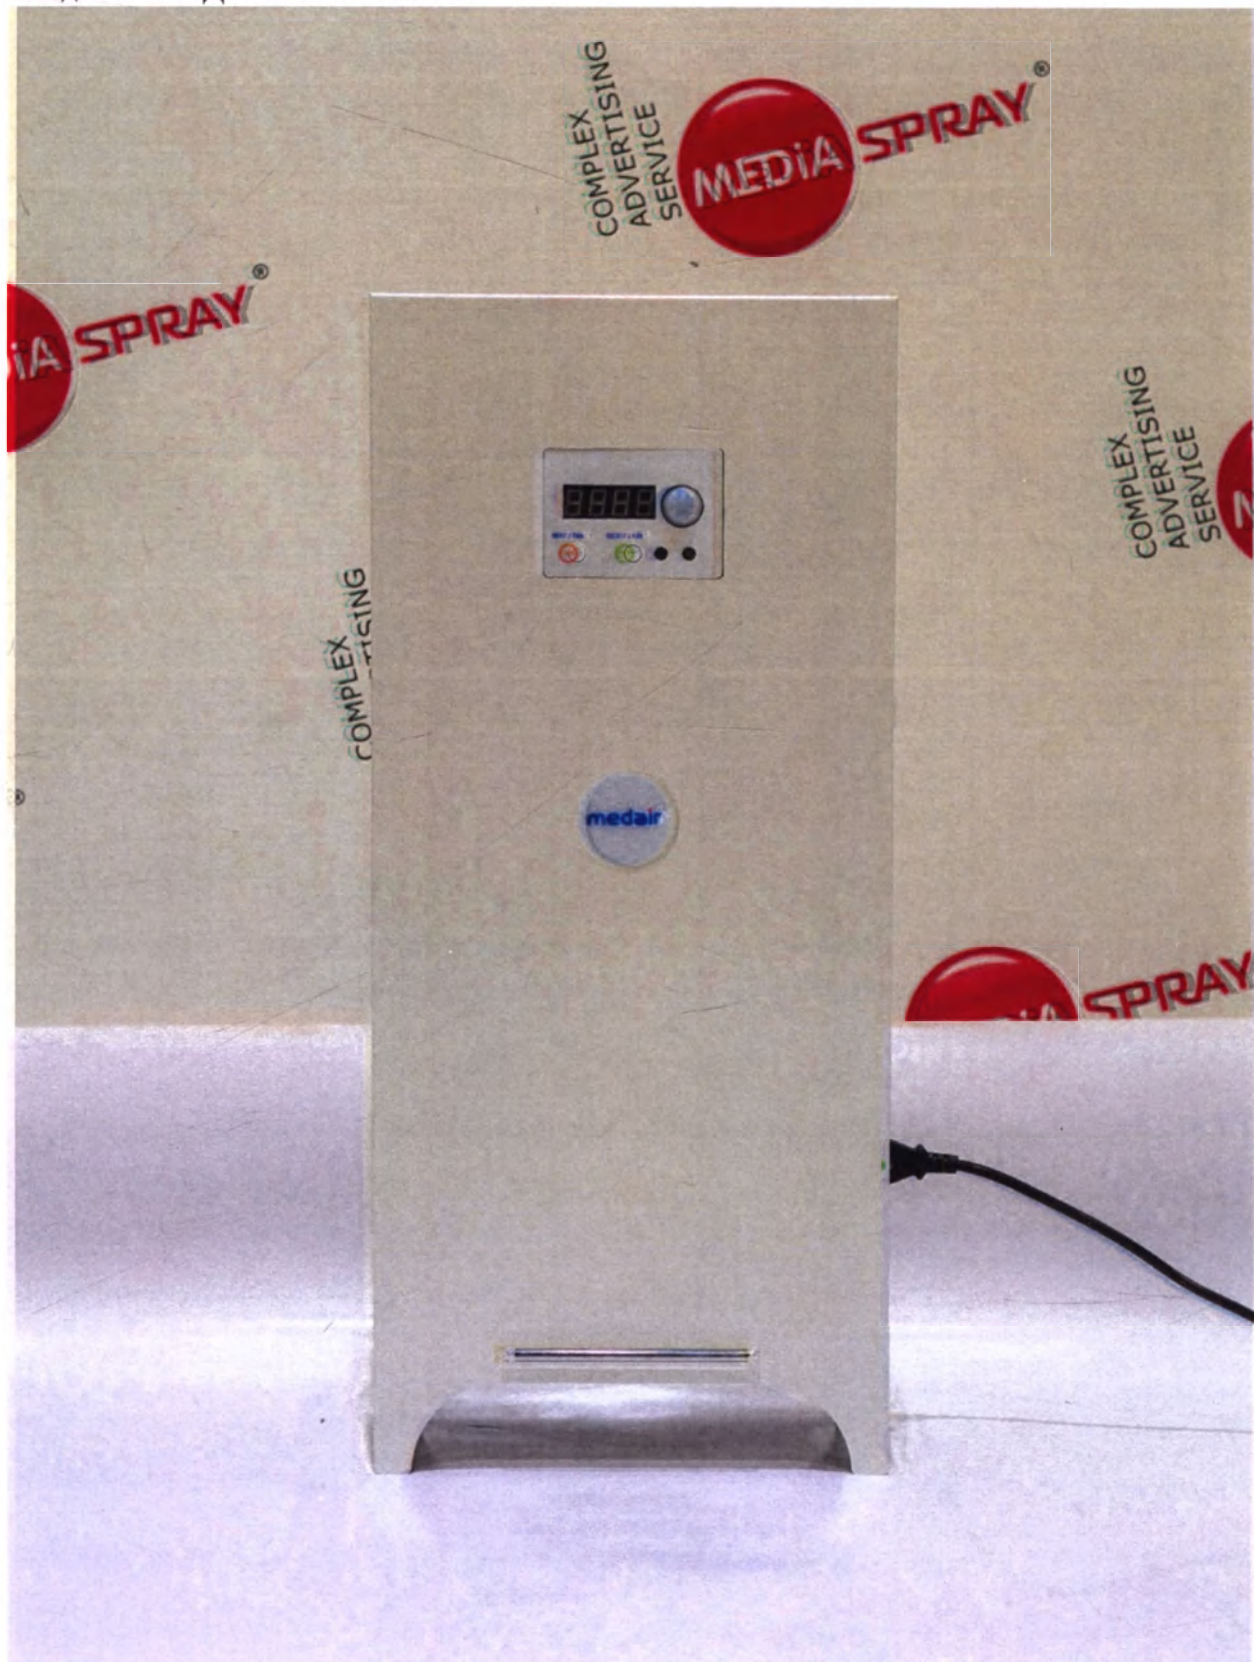


Модель: «МЕДЭЙР 30-1 ЛЮКС»

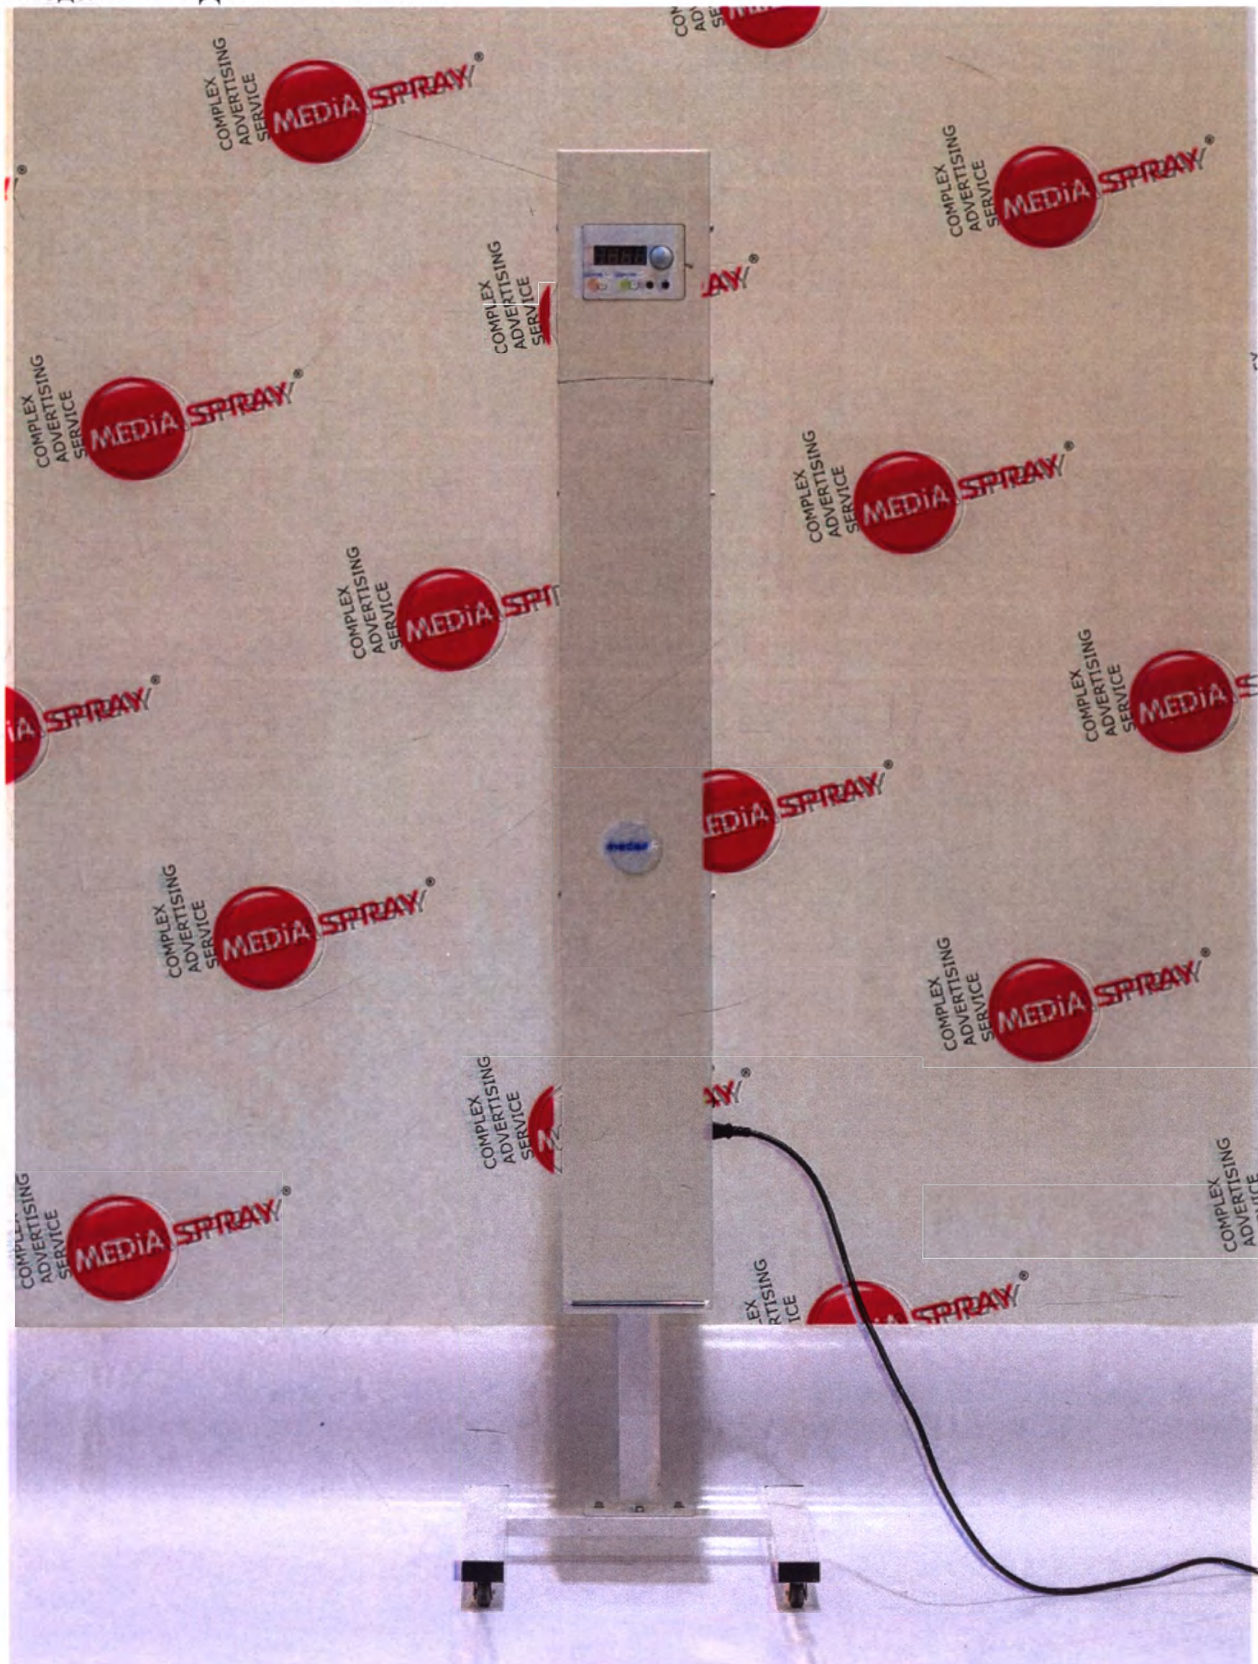


Модель: «МЕДЭЙР 30-2 ЛЮКС»

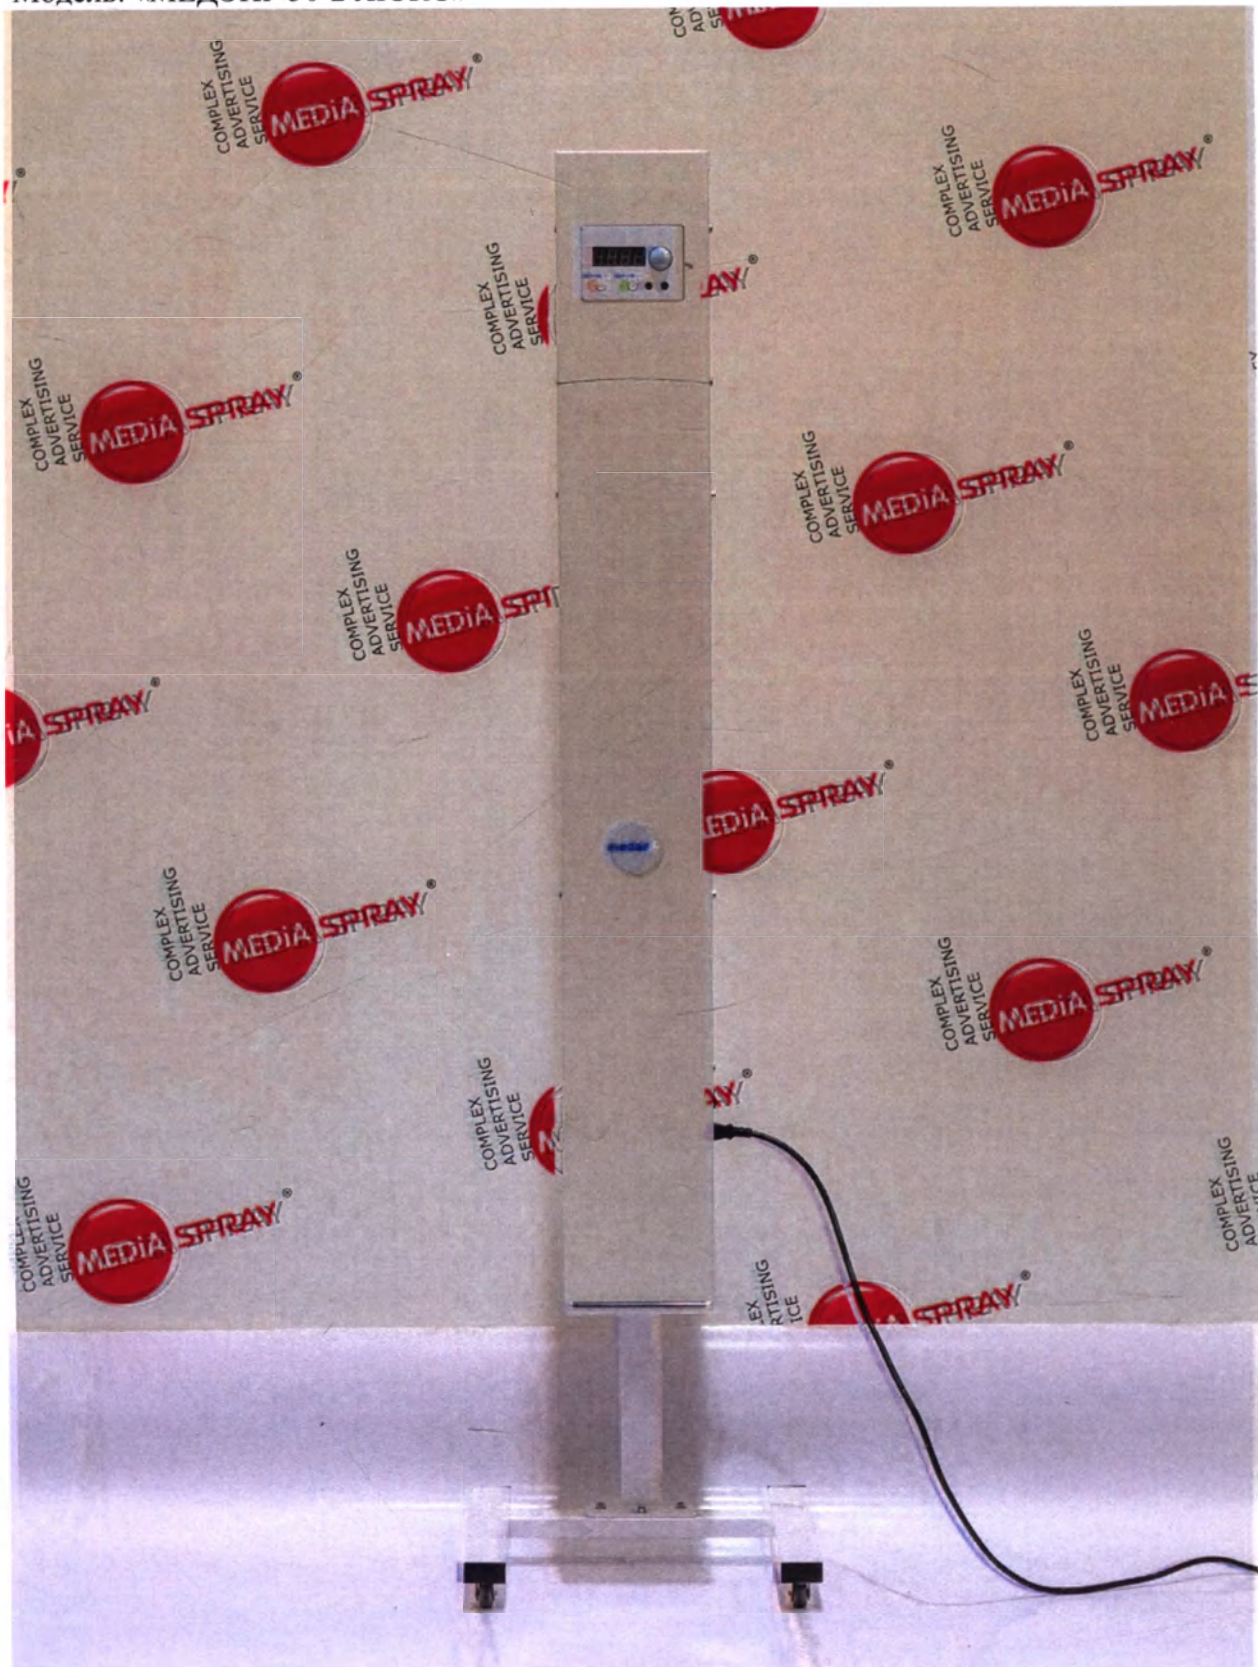


Модель: «МЕДЭЙР 30-3 ЛЮКС»

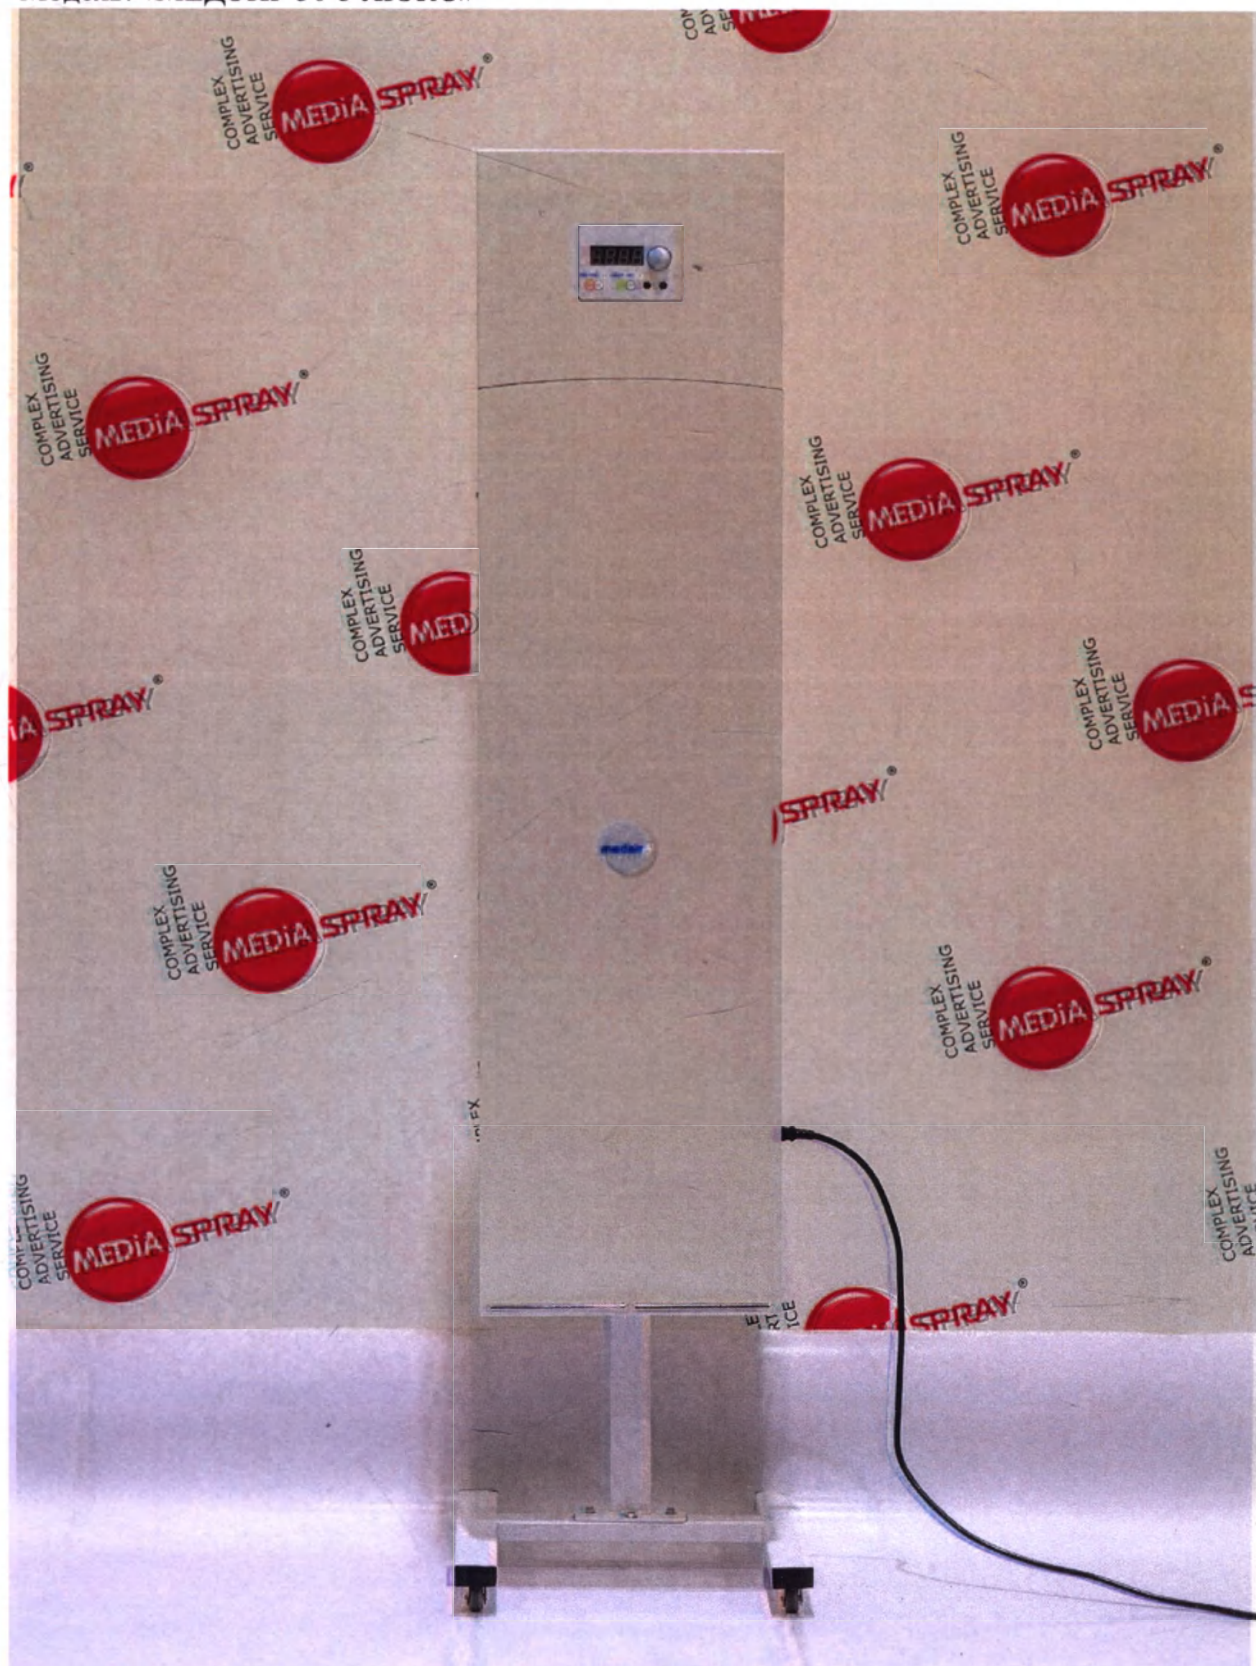


Модель: «МЕДЭЙР 30-4 ЛЮКС»

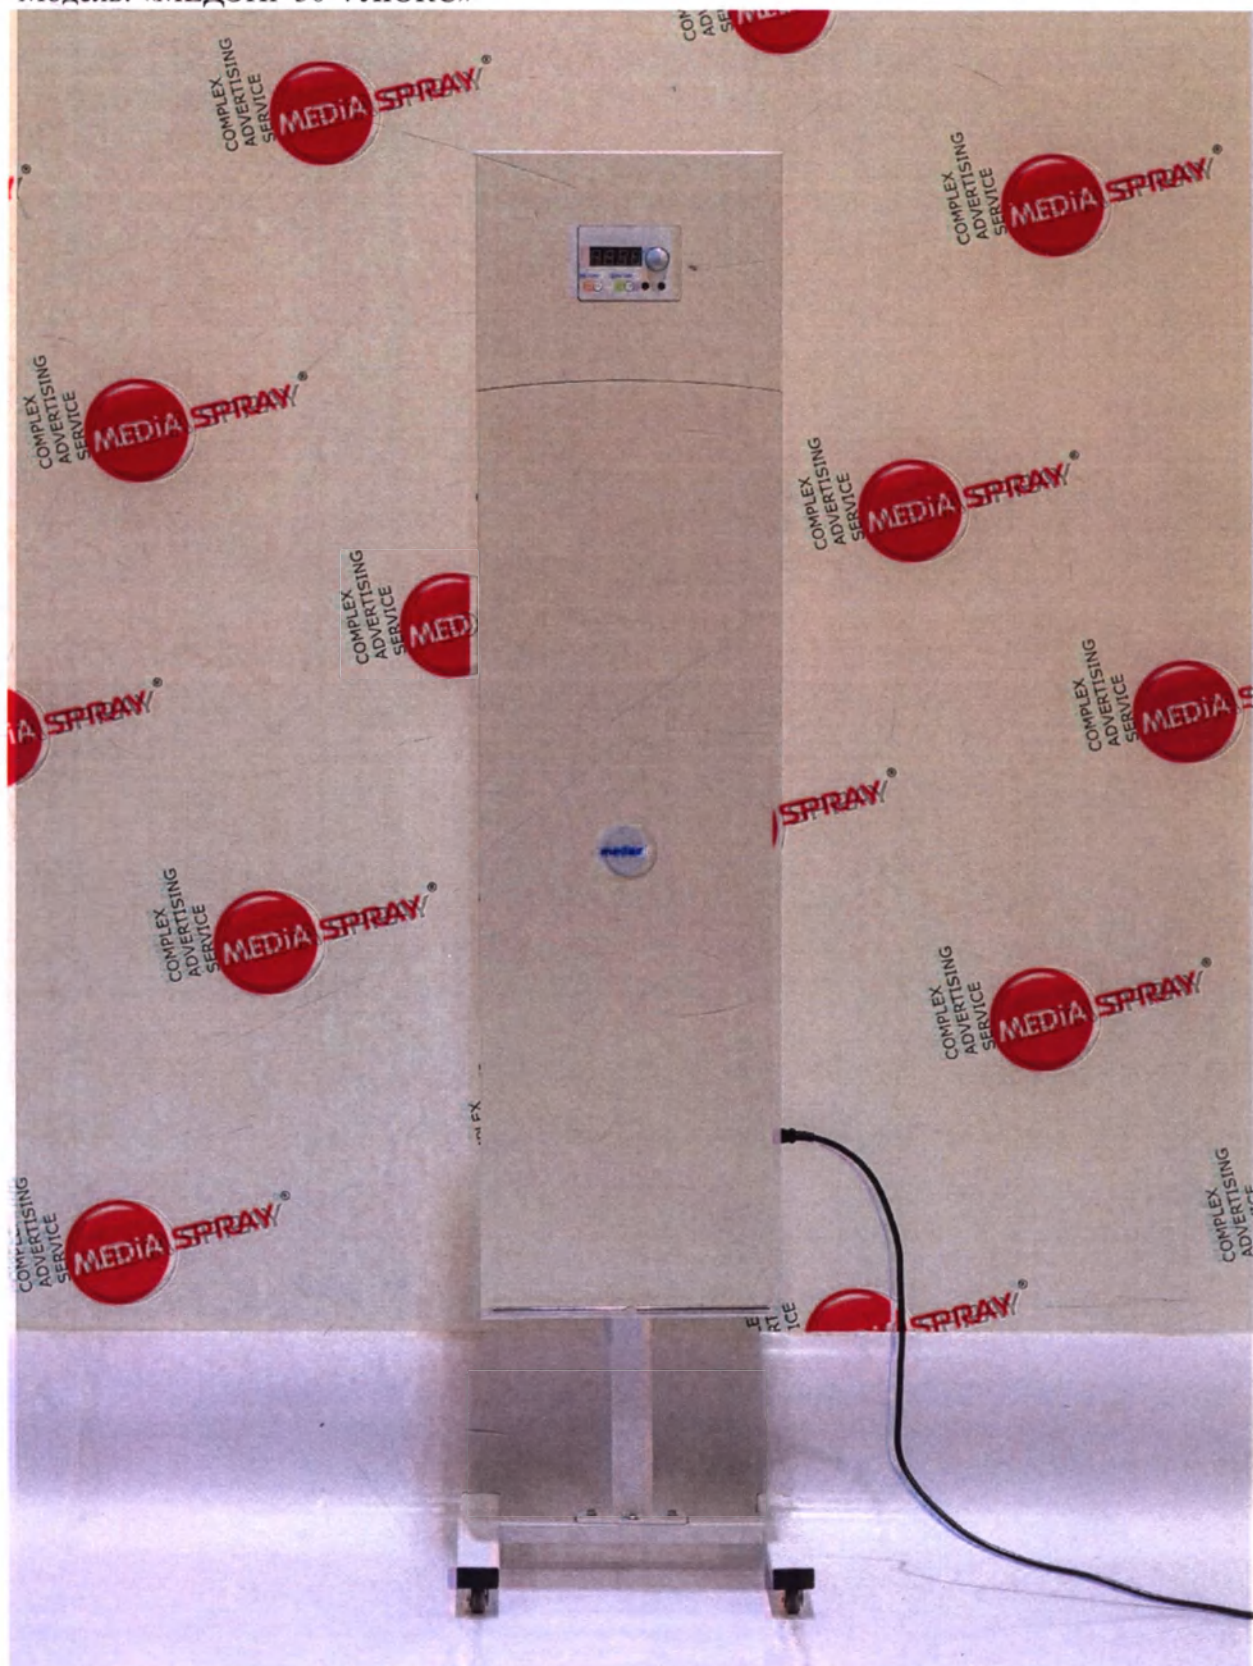

Модель: «МЕДЭЙР 30-6 ЛЮКС»

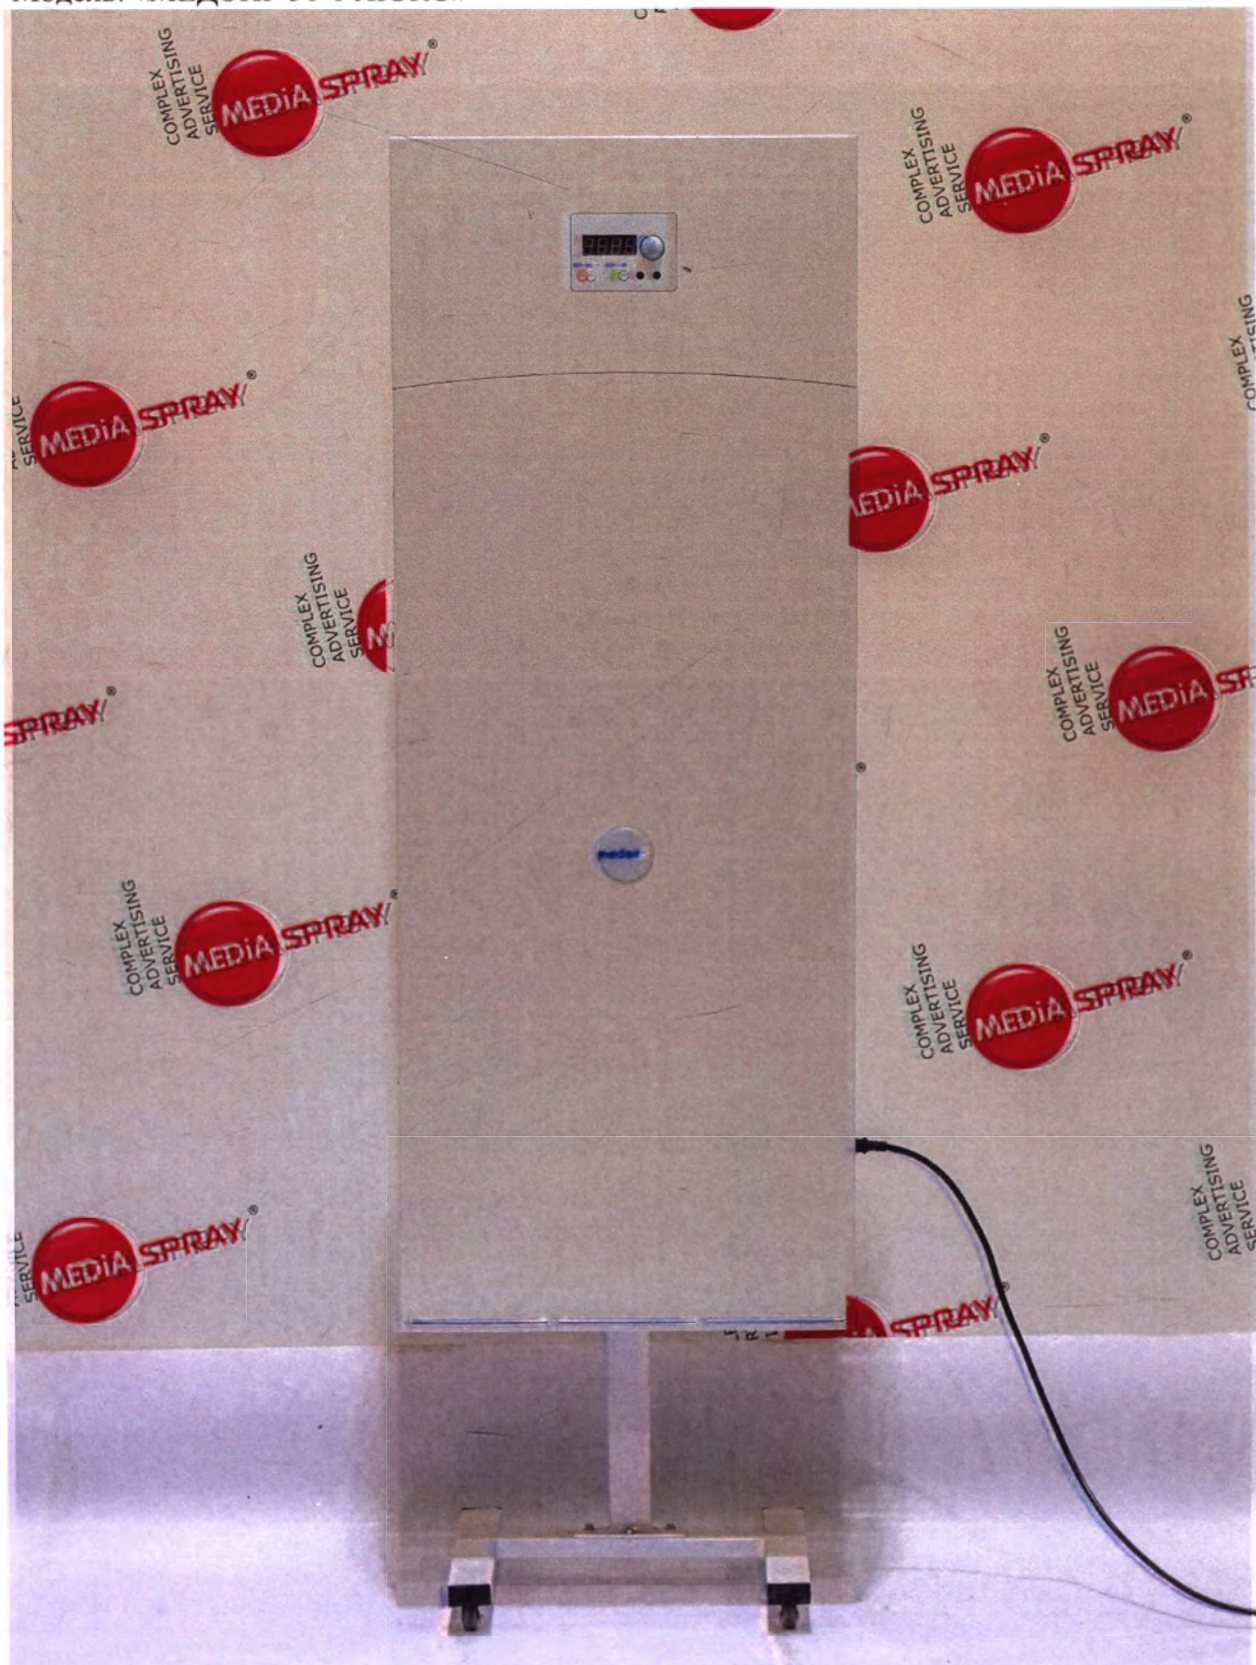

Модель: «МЕДЭЙР 30-8 ЛЮКС»

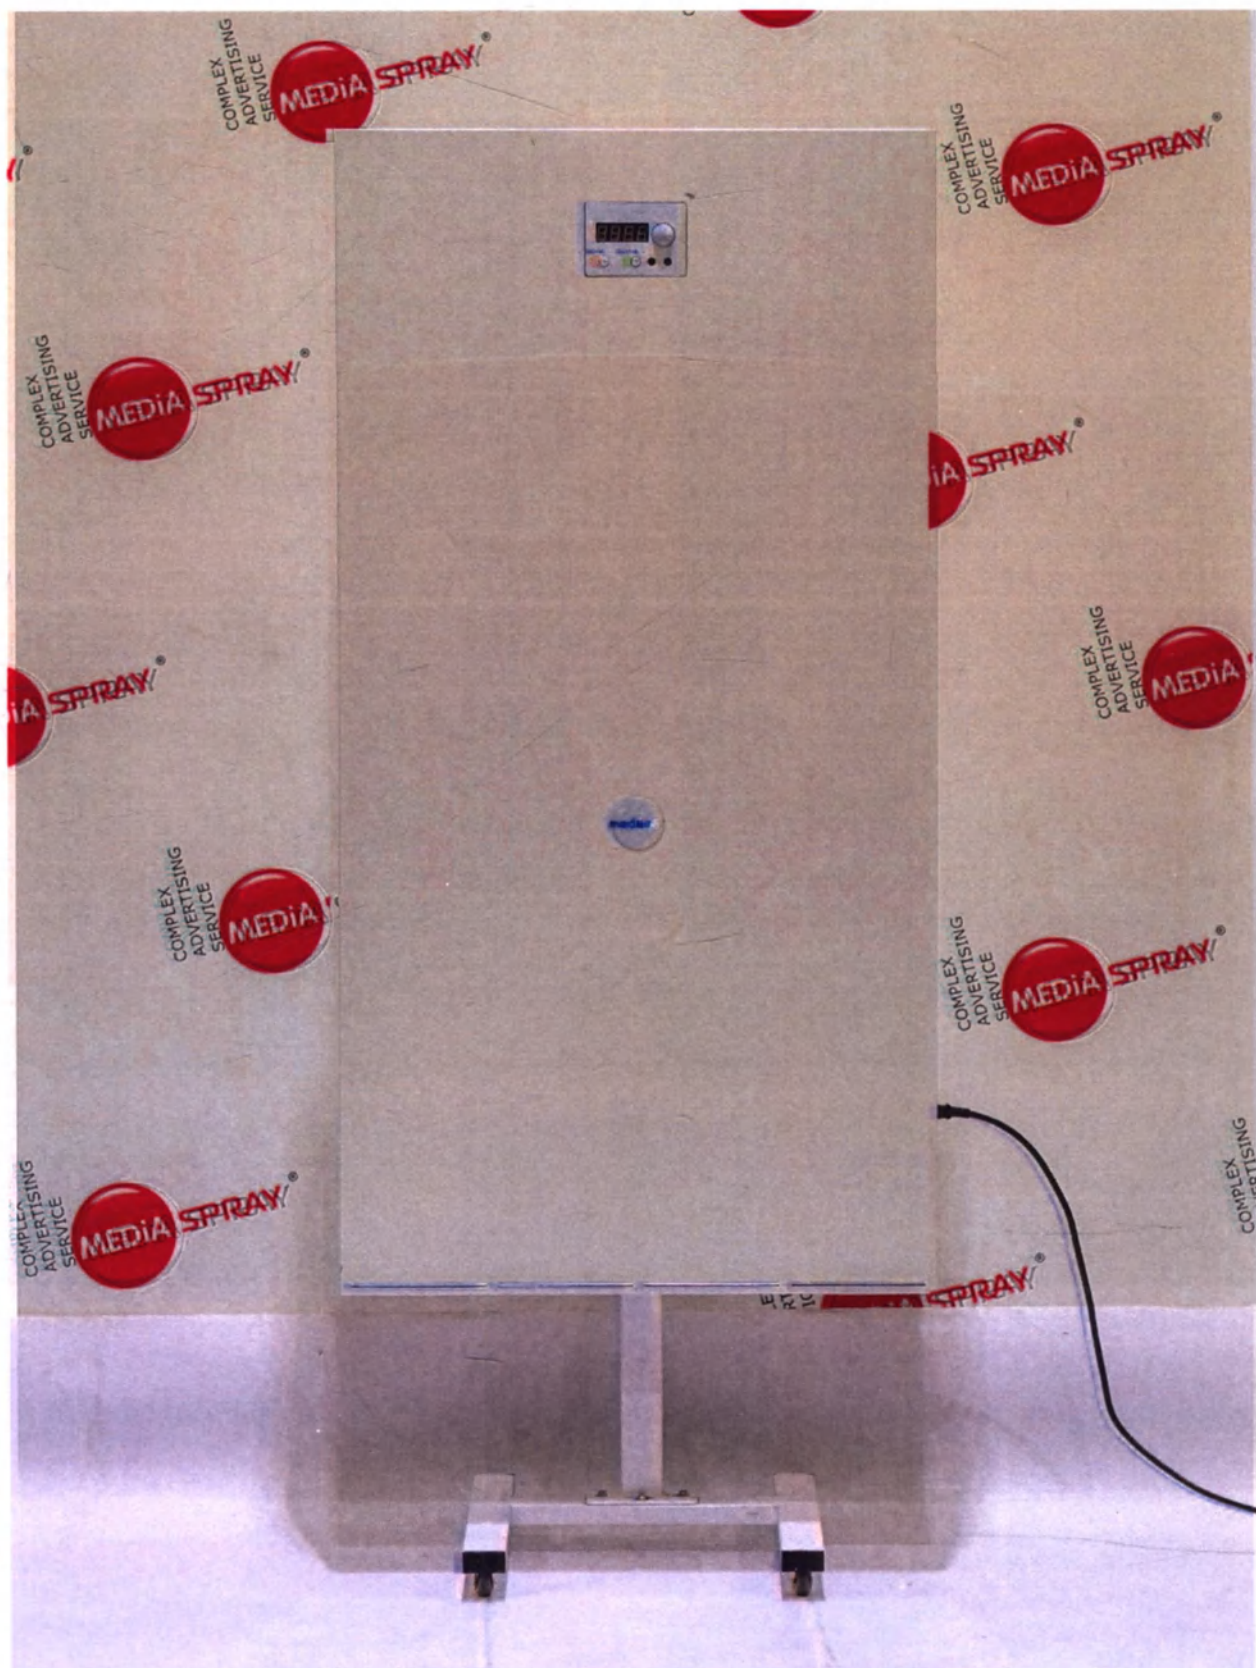

Модель: «МЕДЭЙР 30-1»



Модель: «МЕДЭЙР 30-2»



Модель: «МЕДЭЙР 30-3»



Модель: «МЕДЭЙР 30-4»



Модель: «МЕДЭЙР 30-6»



Модель: «МЕДЭЙР 30-8»




II.

Ультрафиолетовая лампа 15 Вт, модель: UVC 15W G13



Ультрафиолетовая лампа 30 Вт, модель: UVC 30W G1

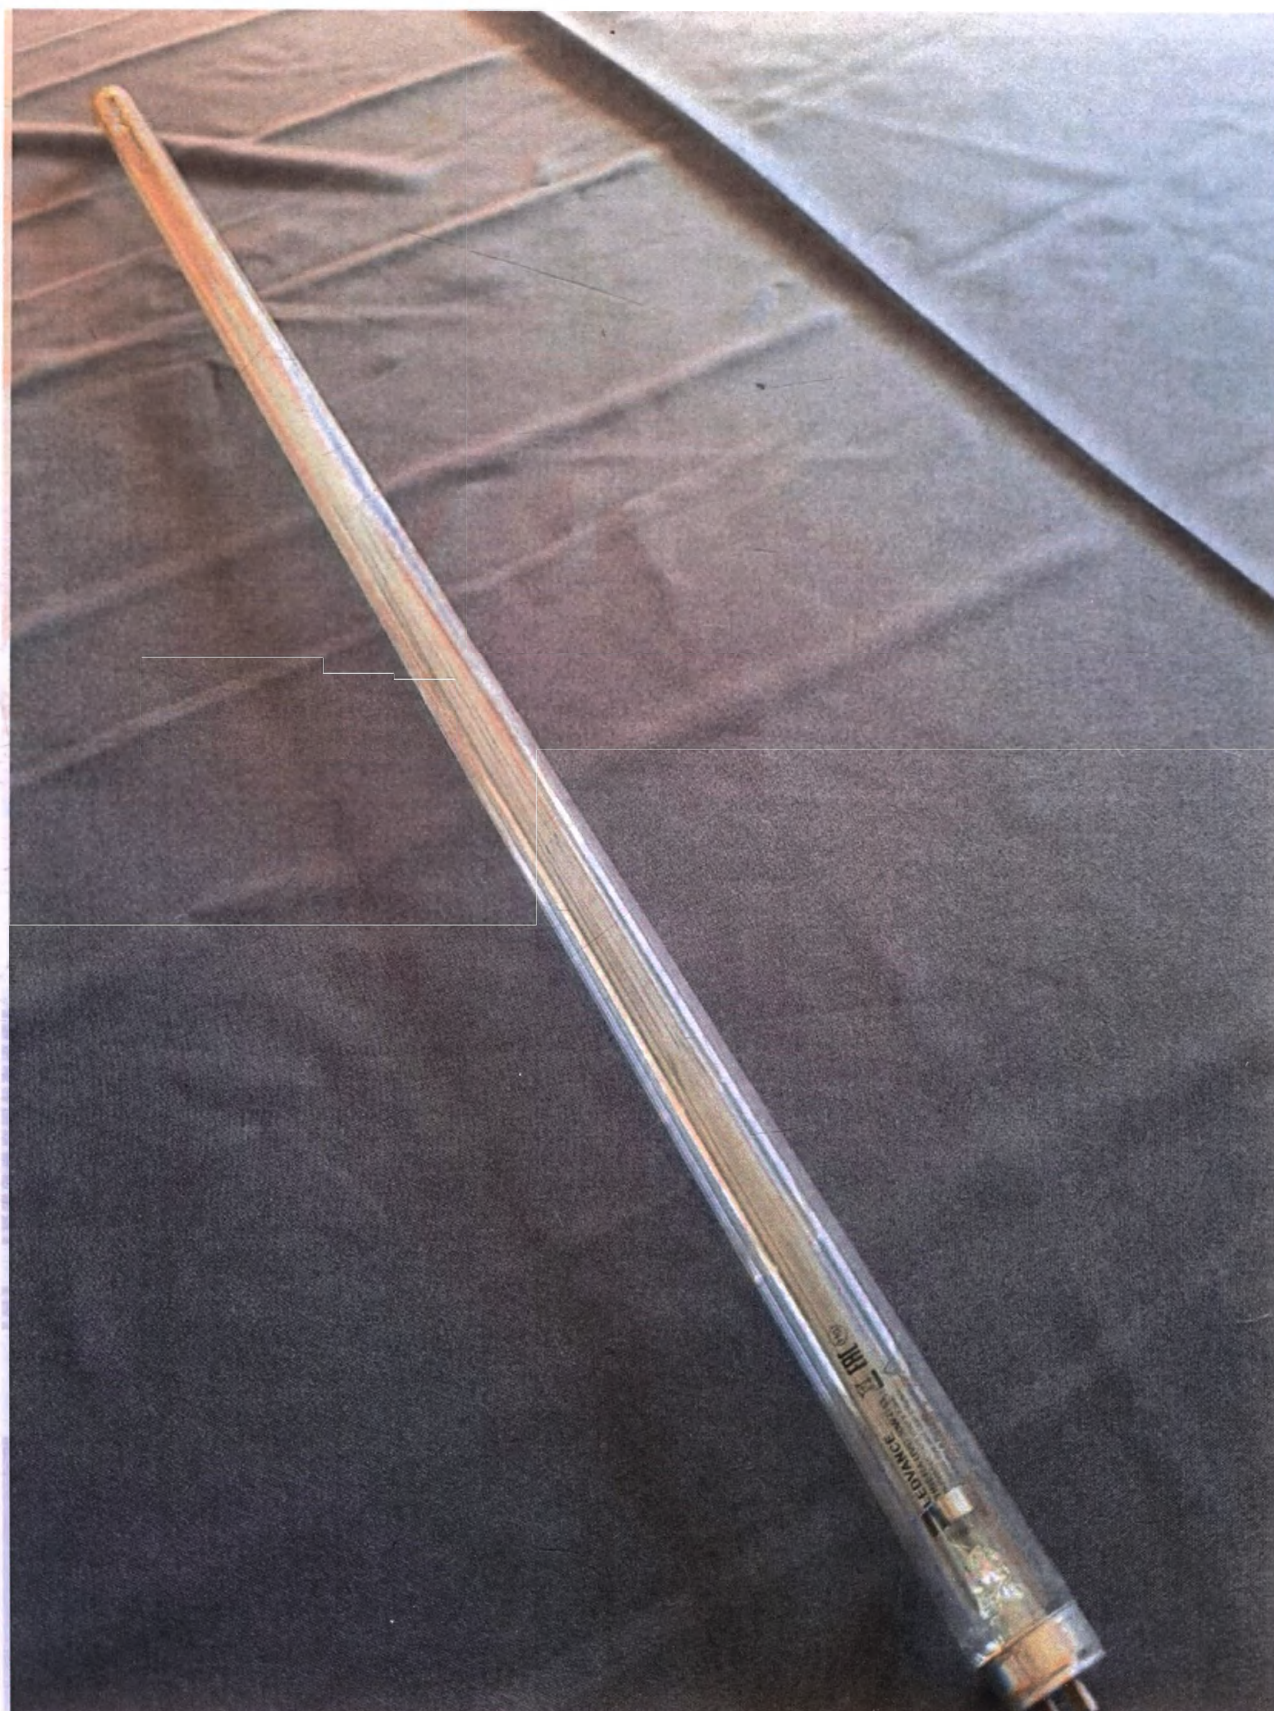

Фильтр



Шнур питания



Блок управления МЕДЭЙР-1



Маркировка Блока управления МЕДЭЙР-1

Блок управления МЕДЭЙР-1



ООО «Лидер»
Удмуртская республика,
г. Ижевск, пер. Инвентарный,
д. 141, офис 4

SN



COMPLEX
ADVERTISING
SERVICE




EAC



РУ: От:
Масса: 150 г.
Срок службы: не менее 5 лет

Вставка плавкая(предохранитель)



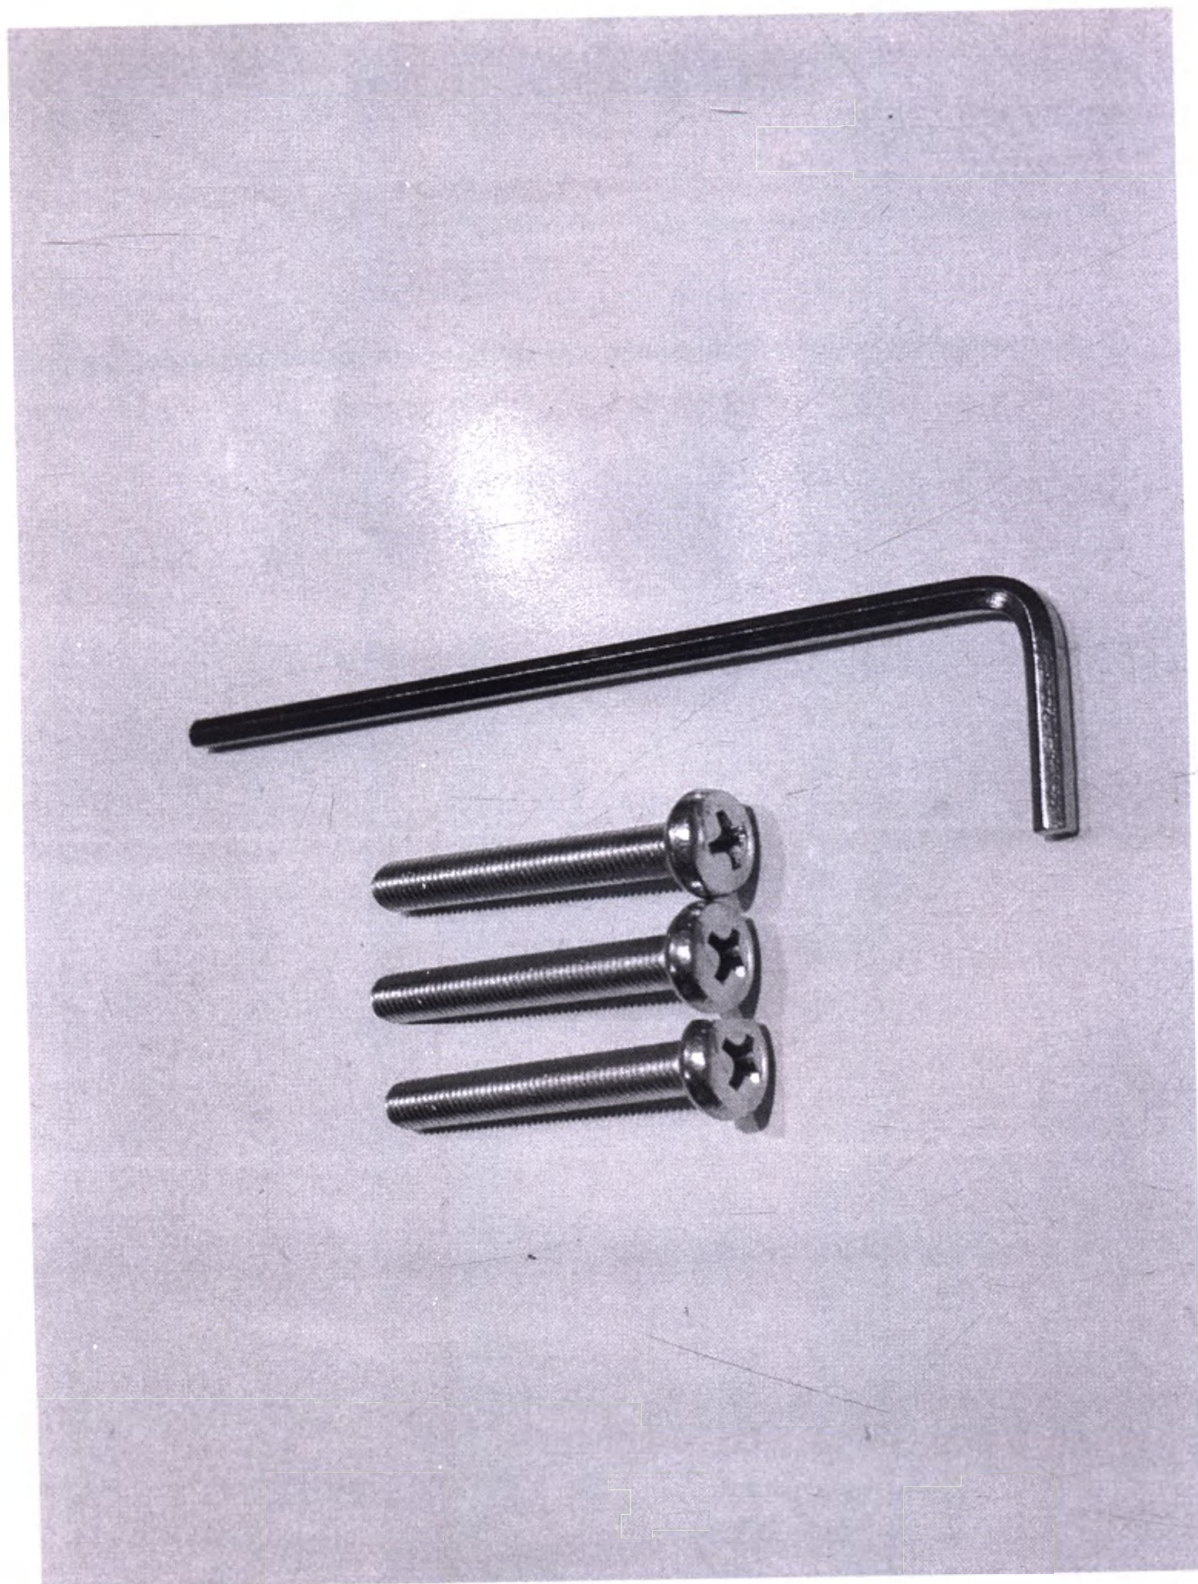

Крепежные элементы

Подставка передвижная для облучателя- рециркулятора МЕДЭЙР



Маркировка подставки передвижной для облучателя- рециркулятора МЕДЭЙР

Подставка передвижная для облучателя- рециркулятора МЕДЭЙР


 ООО «Лидер»
 Удмуртская республика,
 г. Ижевск, пер. Инвентарный,
 д. 141, офис 4



SN _____

COMPLEX
 ADVERTISING
 SERVICE




РУ: _____ От: _____
 Масса: 2,5 кг
 Срок службы: не менее 5 лет

II. Транспортная упаковка



III.

Потребительская упаковка



II. Маркировка

Маркировка Облучателя-рециркулятора медицинский ультрафиолетовый бактерицидный «МЕДЭЙР» в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-001-39370457-2021

1. Модель: «МЕДЭЙР 15-1»

Облучатель-рециркулятор медицинский ультрафиолетовый, бактерицидный
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-001-39370457-2021

ООО «Лидер»
Удмуртская республика,
г. Ижевск, пер. Инвентарный,
д. 141, офис 4




COMPLEX
ADVERTISING
SERVICE



Модель: МЕДЭЙР 15-1

SN



Источник питания: 220 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность: не более 20 Вт
РУ: От:
Масса: 2,2 кг
Срок службы: не менее 5 лет

Класс защиты: IP20

2. Модель: «МЕДЭЙР 15-2»

Облучатель-рециркулятор медицинский ультрафиолетовый, бактерицидный
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-001-39370457-2021

ООО «Лидер»
Удмуртская республика,
г. Ижевск, пер. Инвентарный,
д. 141, офис 4




COMPLEX
ADVERTISING
SERVICE



Модель: МЕДЭЙР 15-2

SN



Источник питания: 220 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность: не более 40 Вт
РУ: От:
Масса: 2,5 кг
Срок службы: не менее 5 лет

Класс защиты: IP20

3. Модель: «МЕДЭЙР 15-3»

Облучатель-рециркулятор медицинский ультрафиолетовый, бактерицидный
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-001-39370457-2021

ООО «Лидер»
Удмуртская республика,
г. Ижевск, пер. Инвентарный,
д. 141, офис 4




COMPLEX
ADVERTISING
SERVICE



Модель: МЕДЭЙР 15-3

SN



Источник питания: 220 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность: не более 60 Вт
РУ: От:
Масса: 4 кг
Срок службы: не менее 5 лет

Класс защиты: IP20

4. Модель: «МЕДЭЙР 15-1 ЛЮКС»


Облучатель-рециркулятор медицинский ультрафиолетовый, бактерицидный
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-001-39370457-2021



ООО «Лидер»
Удмуртская республика,
г. Ижевск, пер. Инвентарный,
д. 141, офис 4

Модель: МЕДЭЙР 15-1 ЛЮКС

SN



COMPLEX
ADVERTISING
SERVICE



Источник питания: 220 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность: не более 20 Вт
РУ: От:
Масса: 2,2 кг
Срок службы: не менее 5 лет

Класс защиты: IP20

5. Модель: «МЕДЭЙР 15-2 ЛЮКС»

Облучатель-рециркулятор медицинский ультрафиолетовый, бактерицидный
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-001-39370457-2021



ООО «Лидер»
Удмуртская республика,
г. Ижевск, пер. Инвентарный,
д. 141, офис 4

Модель: МЕДЭЙР 15-2 ЛЮКС

SN



COMPLEX
ADVERTISING
SERVICE



Источник питания: 220 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность: не более 40 Вт
РУ: От:
Масса: 2,5 кг
Срок службы: не менее 5 лет

Класс защиты: IP20

6. Модель: «МЕДЭЙР 15-3 ЛЮКС»


Облучатель-рециркулятор медицинский ультрафиолетовый, бактерицидный
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-001-39370457-2021



ООО «Лидер»
Удмуртская республика,
г. Ижевск, пер. Инвентарный,
д. 141, офис 4

Модель: МЕДЭЙР 15-3 ЛЮКС

SN



COMPLEX
ADVERTISING
SERVICE



Источник питания: 220 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность: не более 60 Вт
РУ: От:
Масса: 4 кг
Срок службы: не менее 5 лет

Класс защиты: IP20

7. Модель: «МЕДЭЙР 30-1 ЛЮКС»

Облучатель-рециркулятор медицинский ультрафиолетовый, бактерицидный
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-001-39370457-2021



ООО «Лидер»
Удмуртская республика,
г. Ижевск, пер. Инвентарный,
д. 141, офис 4



COMPLEX
ADVERTISING
SERVICE



Модель: МЕДЭЙР 30-1 ЛЮКС



Источник питания: 220 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность: не более 50 Вт
РУ: От:
Масса: 4 кг
Срок службы: не менее 5 лет

Класс защиты: IP20

8. Модель: «МЕДЭЙР 30-2 ЛЮКС»

Облучатель-рециркулятор медицинский ультрафиолетовый, бактерицидный
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-001-39370457-2021




ООО «Лидер»
Удмуртская республика,
г. Ижевск, пер. Инвентарный,
д. 141, офис 4



COMPLEX
ADVERTISING
SERVICE



Модель: МЕДЭЙР 30-2 ЛЮКС



Источник питания: 220 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность: не более 70 Вт
РУ: От:
Масса: 4,2 кг
Срок службы: не менее 5 лет

Класс защиты: IP20

9. Модель: «МЕДЭЙР 30-3 ЛЮКС»

Облучатель-рециркулятор медицинский ультрафиолетовый, бактерицидный
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-001-39370457-2021



ООО «Лидер»
Удмуртская республика,
г. Ижевск, пер. Инвентарный,
д. 141, офис 4



COMPLEX
ADVERTISING
SERVICE



Модель: МЕДЭЙР 30-3 ЛЮКС



Источник питания: 220 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность: не более 130 Вт
РУ: От:
Масса: 6,6 кг
Срок службы: не менее 5 лет

Класс защиты: IP20

10. Модель: «МЕДЭЙР 30-4 ЛЮКС»

Облучатель-рециркулятор медицинский ультрафиолетовый, бактерицидный
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-001-39370457-2021

 ООО «Лидер»
Удмуртская республика,
г. Ижевск, пер. Инвентарный,
д. 141, офис 4

Модель: МЕДЭЙР 30-4 ЛЮКС

SN



COMPLEX
ADVERTISING
SERVICE



Источник питания: 220 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность: не более 160 Вт
РУ: От:
Масса: 6,9 кг
Срок службы: не менее 5 лет

Класс защиты: IP20

11. Модель: «МЕДЭЙР 30-6 ЛЮКС»

Облучатель-рециркулятор медицинский ультрафиолетовый, бактерицидный
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-001-39370457-2021

 ООО «Лидер»
Удмуртская республика,
г. Ижевск, пер. Инвентарный,
д. 141, офис 4

Модель: МЕДЭЙР 30-6 ЛЮКС

SN



COMPLEX
ADVERTISING
SERVICE



Источник питания: 220 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность: не более 240 Вт
РУ: От:
Масса: 10,3 кг
Срок службы: не менее 5 лет

Класс защиты: IP20


12. Модель: «МЕДЭЙР 30-8 ЛЮКС»

Облучатель-рециркулятор медицинский ультрафиолетовый, бактерицидный
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-001-39370457-2021

 ООО «Лидер»
Удмуртская республика,
г. Ижевск, пер. Инвентарный,
д. 141, офис 4

Модель: МЕДЭЙР 30-8 ЛЮКС

SN



COMPLEX
ADVERTISING
SERVICE



Источник питания: 220 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность: не более 320 Вт
РУ: От:
Масса: 13 кг
Срок службы: не менее 5 лет

Класс защиты: IP20

13. Модель: «МЕДЭЙР 30-1»

Облучатель-рециркулятор медицинский ультрафиолетовый, бактерицидный
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-001-39370457-2021



ООО «Лидер»
Удмуртская республика,
г. Ижевск, пер. Инвентарный,
д. 141, офис 4




COMPLEX
ADVERTISING
SERVICE



Модель: МЕДЭЙР 30-1

SN



Источник питания: 220 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность: не более 50 Вт
РУ: От:
Масса: 4 кг
Срок службы: не менее 5 лет
Класс защиты: IP20

14. Модель: «МЕДЭЙР 30-2»

Облучатель-рециркулятор медицинский ультрафиолетовый, бактерицидный
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-001-39370457-2021



ООО «Лидер»
Удмуртская республика,
г. Ижевск, пер. Инвентарный,
д. 141, офис 4




COMPLEX
ADVERTISING
SERVICE



Модель: МЕДЭЙР 30-2

SN



Источник питания: 220 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность: не более 70 Вт
РУ: От:
Масса: 4.2 кг
Срок службы: не менее 5 лет
Класс защиты: IP20

15. Модель: «МЕДЭЙР 30-3»

Облучатель-рециркулятор медицинский ультрафиолетовый, бактерицидный
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-001-39370457-2021



ООО «Лидер»
Удмуртская республика,
г. Ижевск, пер. Инвентарный,
д. 141, офис 4



COMPLEX
ADVERTISING
SERVICE



Модель: МЕДЭЙР 30-3

SN



Источник питания: 220 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность: не более 130 Вт
РУ: От:
Масса: 6.6 кг
Срок службы: не менее 5 лет
Класс защиты: IP20

16. Модель: «МЕДЭЙР 30-4»

Облучатель-рециркулятор медицинский ультрафиолетовый, бактерицидный
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-001-39370457-2021

ООО «Лидер»
Удмуртская республика,
г. Ижевск, пер. Инвентарный,
д. 141, офис 4

Модель: МЕДЭЙР 30-4

SN



Источник питания: 220 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность: не более 160 Вт
РУ: От:
Масса: 6,9 кг
Срок службы: не менее 5 лет
Класс защиты: IP20



17. Модель: «МЕДЭЙР 30-6»

Облучатель-рециркулятор медицинский ультрафиолетовый, бактерицидный
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-001-39370457-2021

ООО «Лидер»
Удмуртская республика,
г. Ижевск, пер. Инвентарный,
д. 141, офис 4

Модель: МЕДЭЙР 30-6

SN



Источник питания: 220 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность: не более 240 Вт
РУ: От:
Масса: 10,3 кг
Срок службы: не менее 5 лет
Класс защиты: IP20



18. Модель: «МЕДЭЙР 30-8»

Облучатель-рециркулятор медицинский ультрафиолетовый, бактерицидный
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.50-001-39370457-2021

ООО «Лидер»
Удмуртская республика,
г. Ижевск, пер. Инвентарный,
д. 141, офис 4

Модель: МЕДЭЙР 30-8

SN



Источник питания: 220 В ~ 50 Гц
Потребляемая мощность: не более 320 Вт
РУ: От:
Масса: 13 кг
Срок службы: не менее 5 лет
Класс защиты: IP20



