



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Катетер для васкулярной визуализации OptiCross в индивидуальной упаковке, варианты
исполнения**


Катетер для васкулярной визуализации OptiCross 18 30 МГц в индивидуальной упаковке, в составе

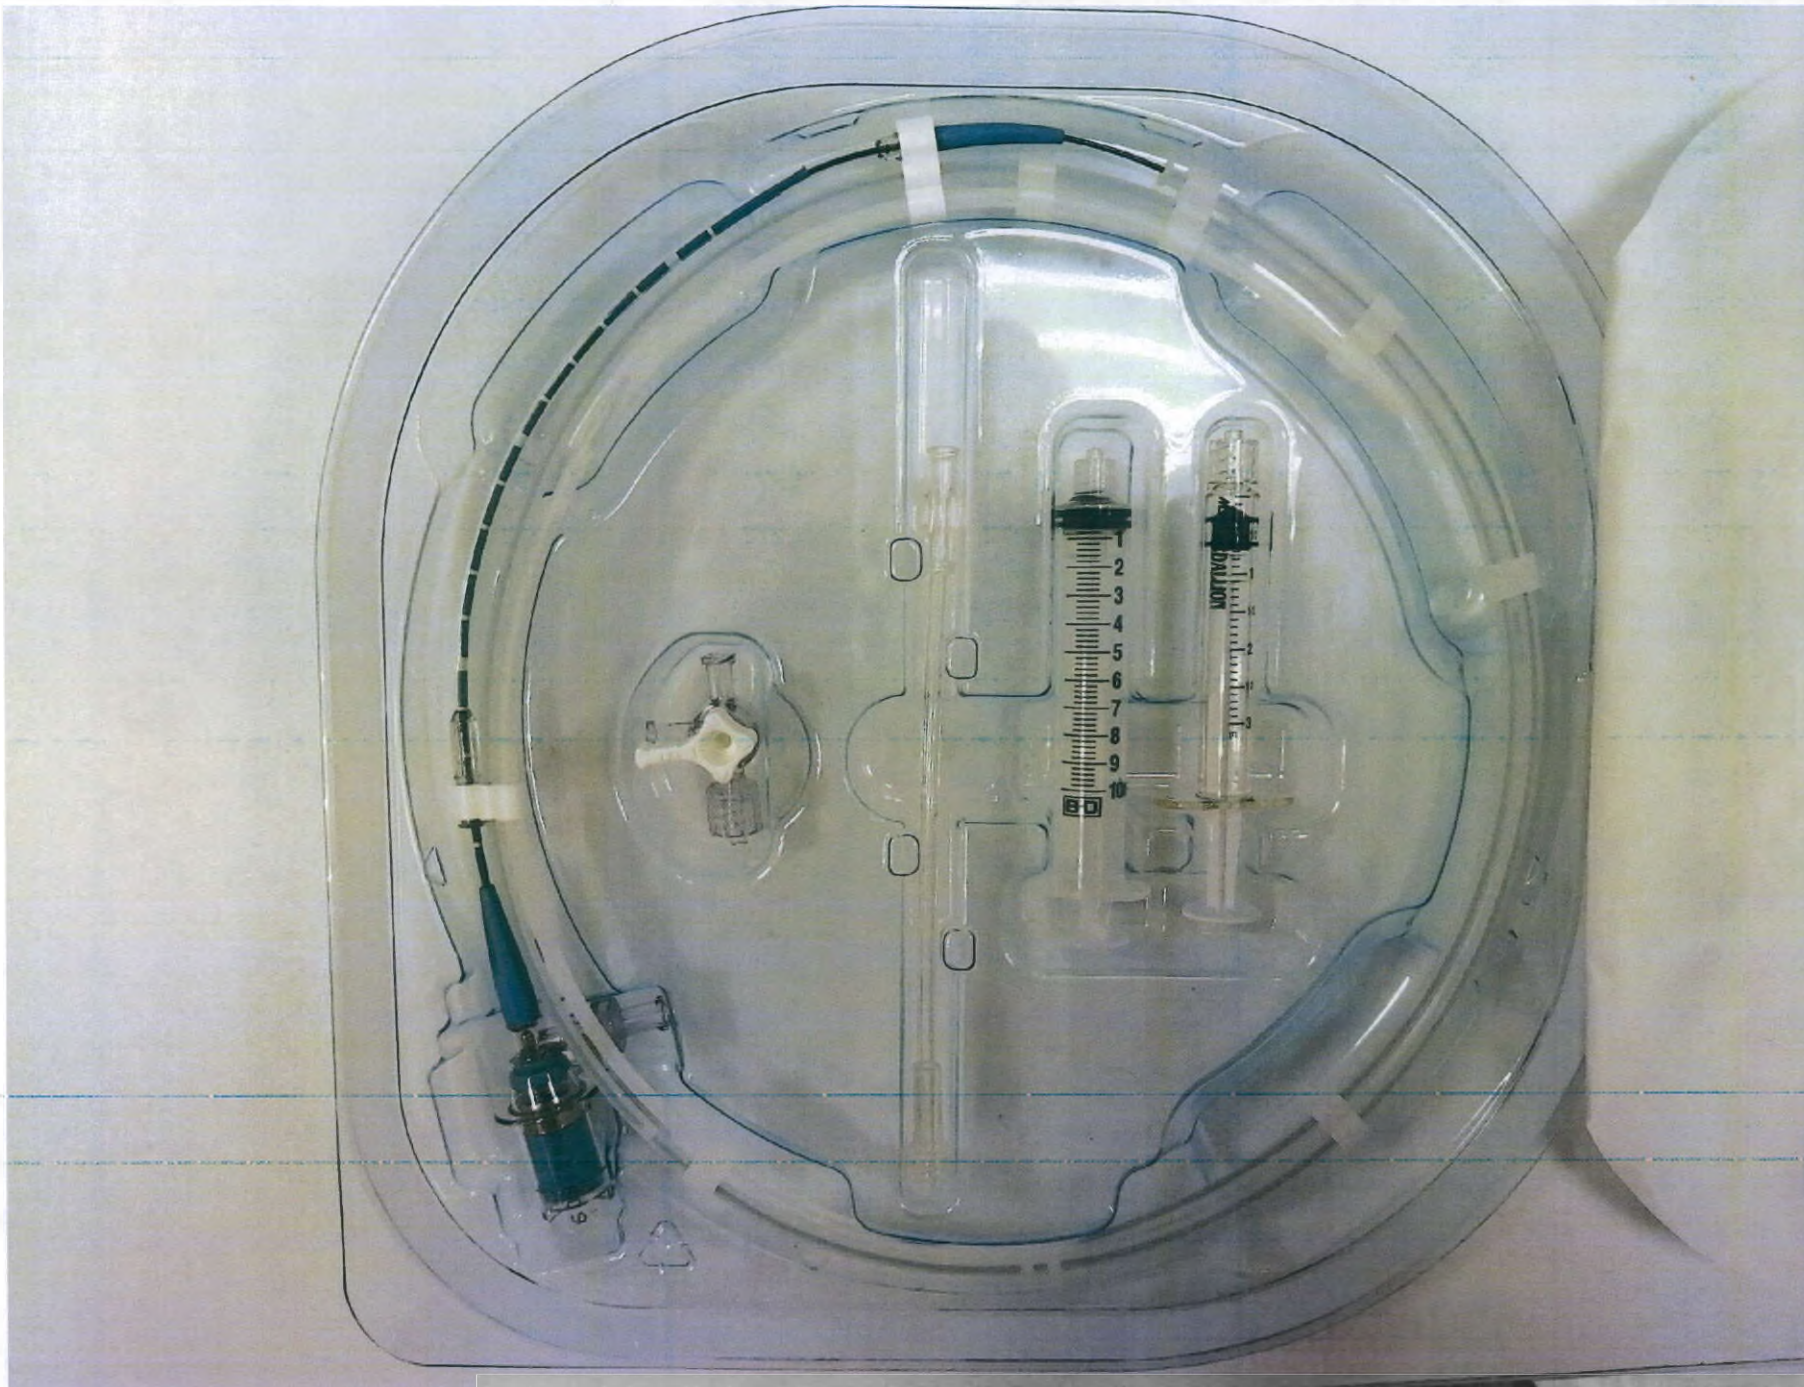


Общий вид катетера для васкулярной визуализации OptiCross 18 30 МГц в составе в индивидуальной упаковке (лотке)

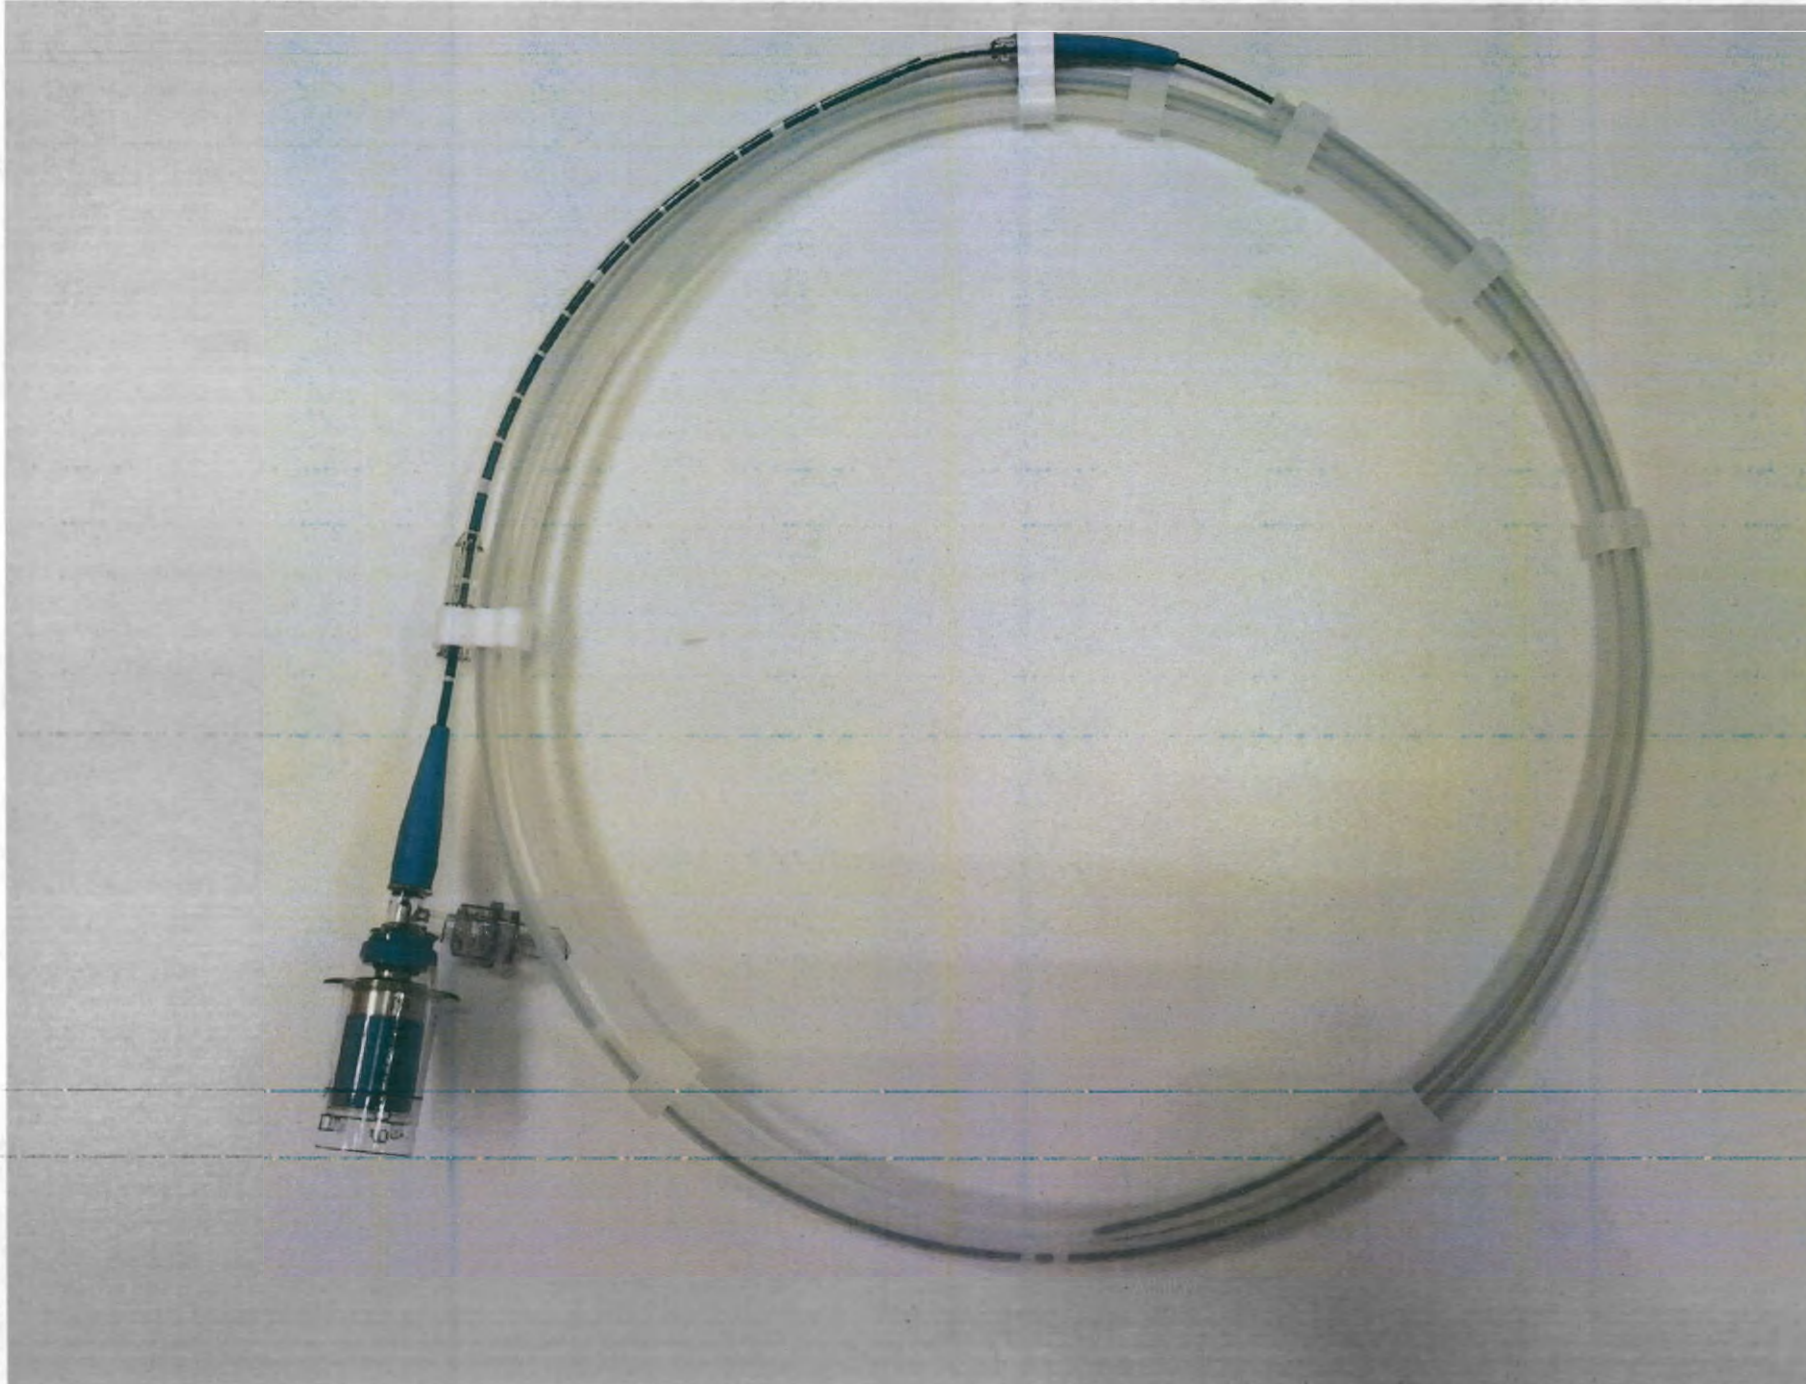


Общий вид катетера для васкулярной визуализации OptiCross 18 30 МГц в защитной трубке с зажимами

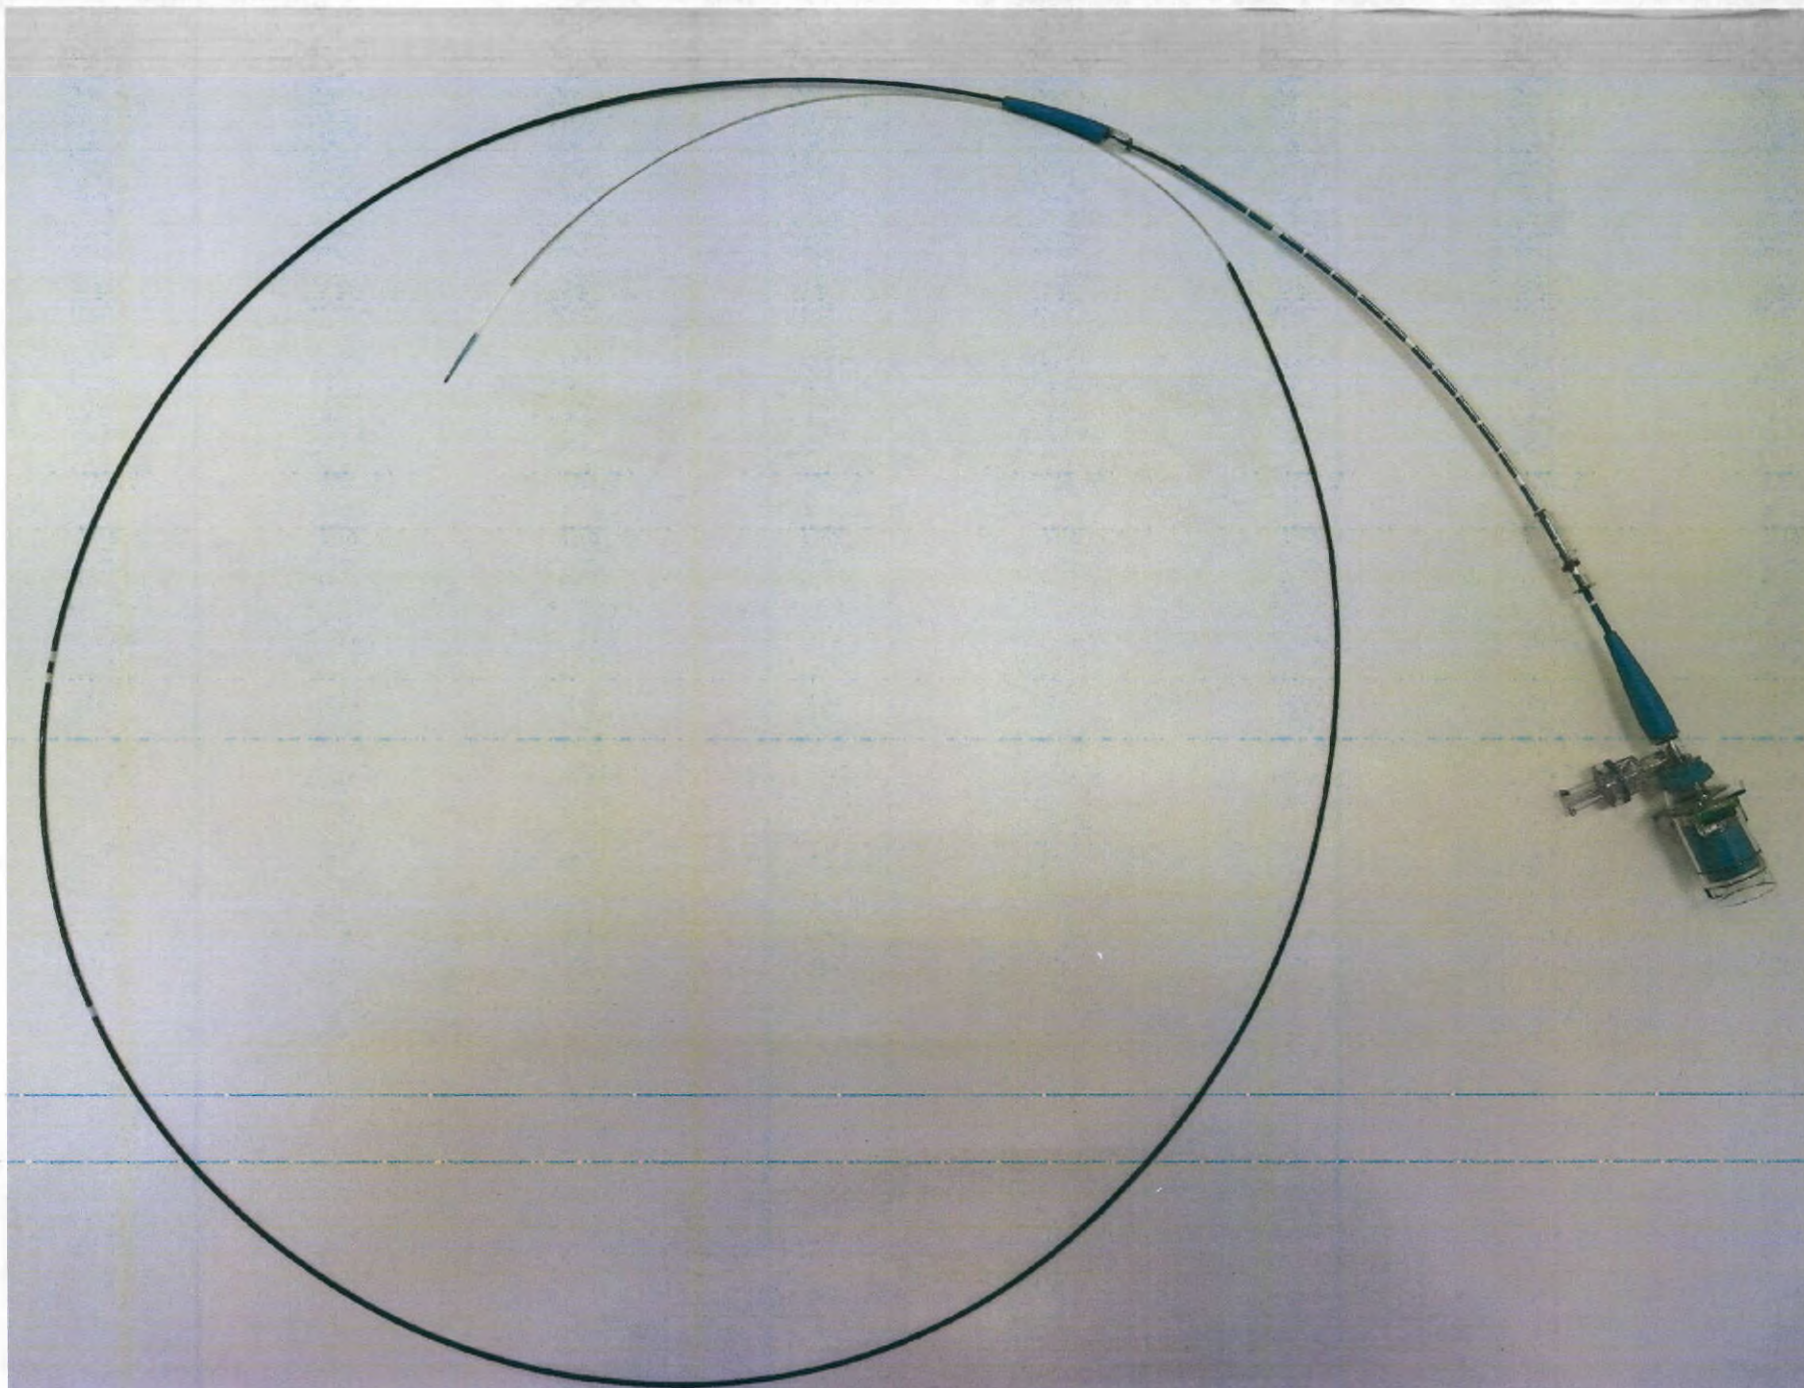


Катетер для васкулярной визуализации OptiCross 18 30 МГц

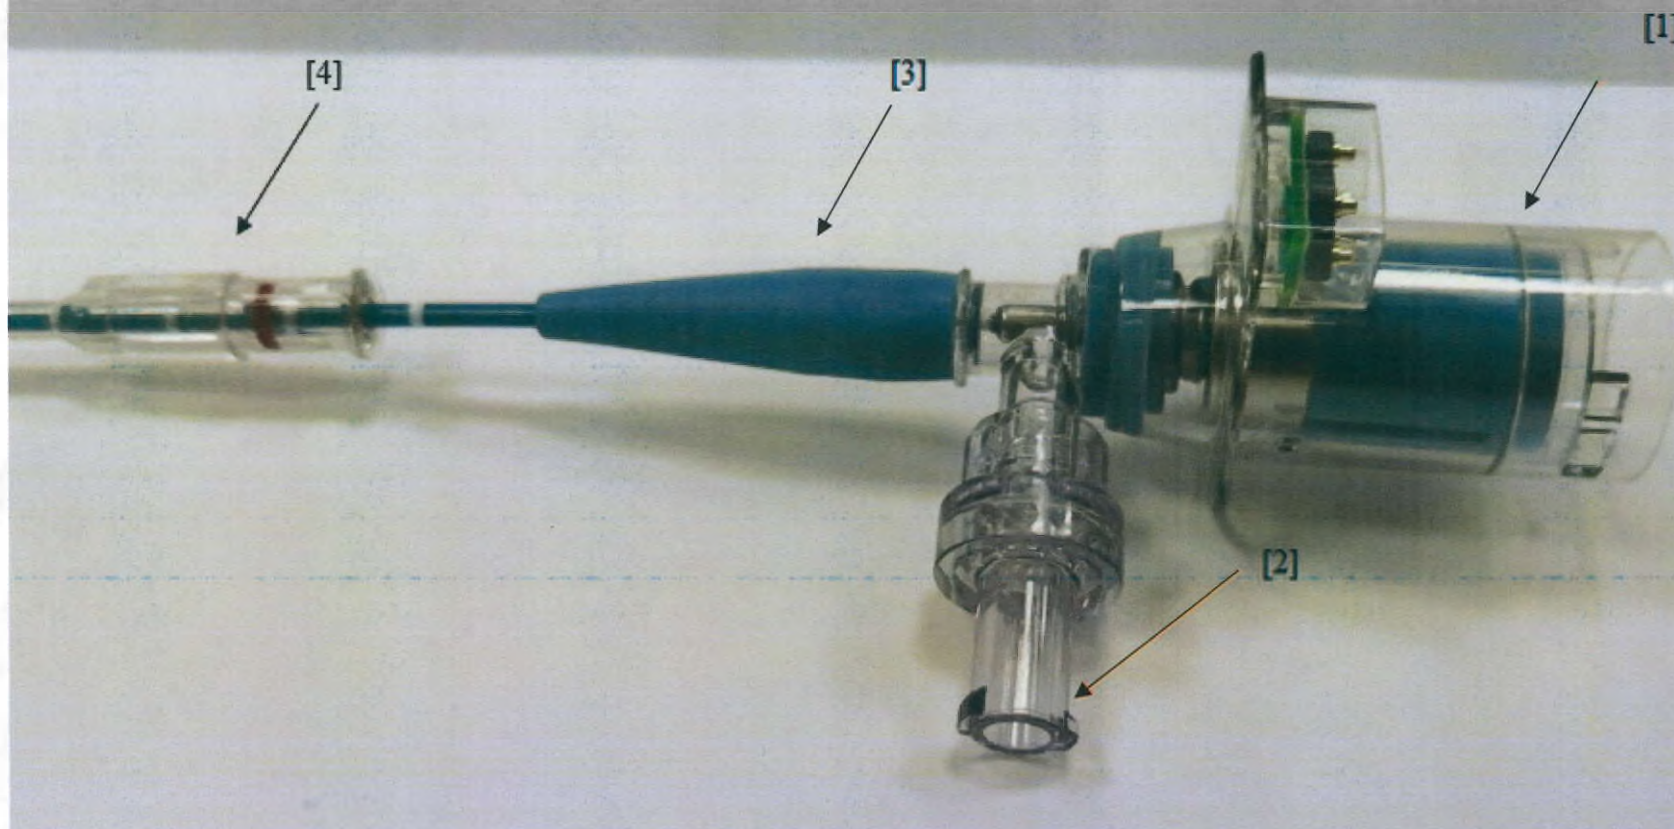


Хаб [1], возвратный клапан [2], проксимальная разгрузочная муфта [3], корпус анкерный [4]

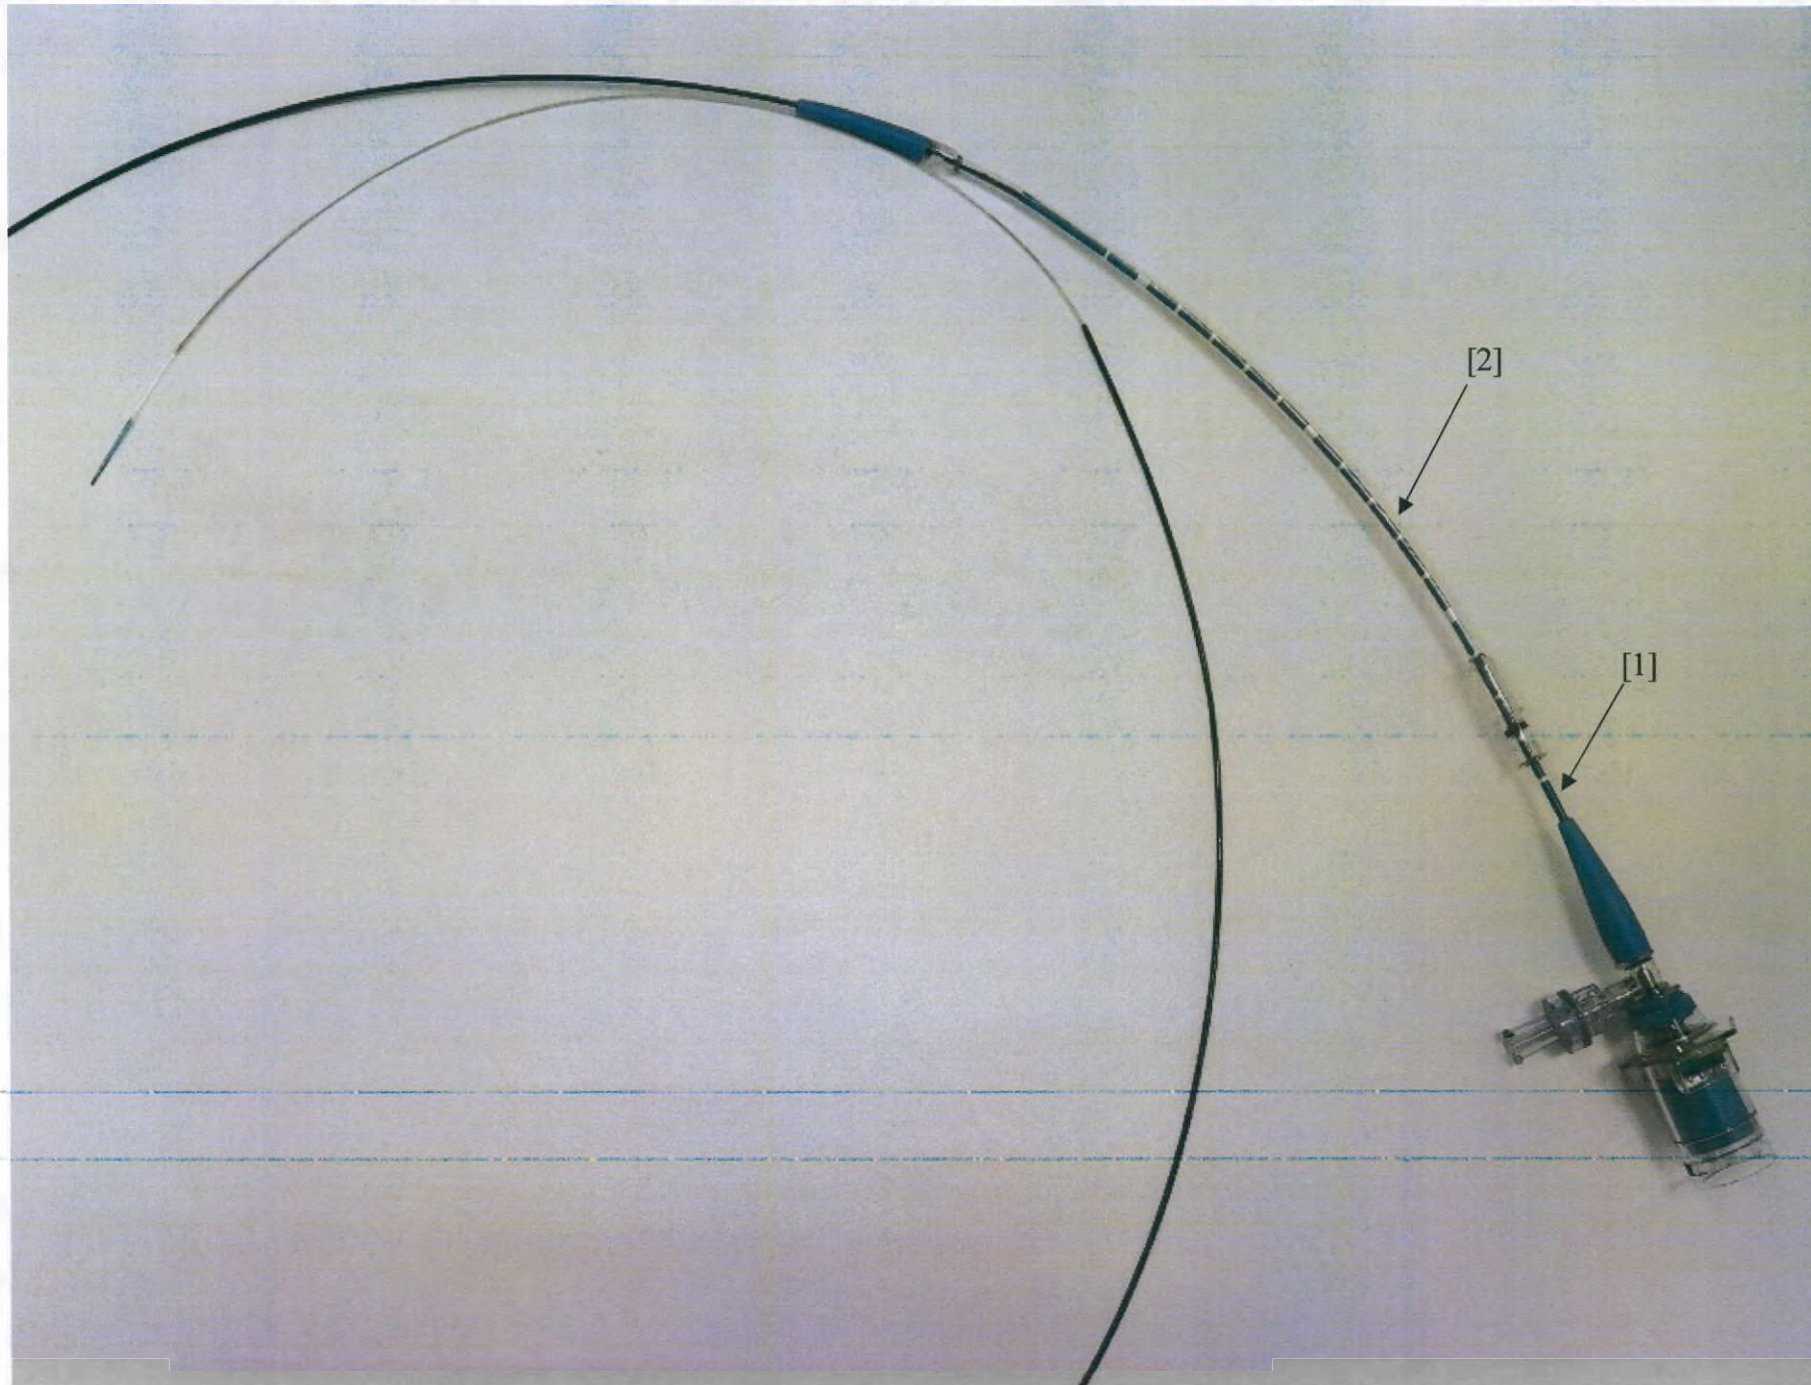


Внутренняя телескопическая трубка [1], наружная телескопическая трубка [2]

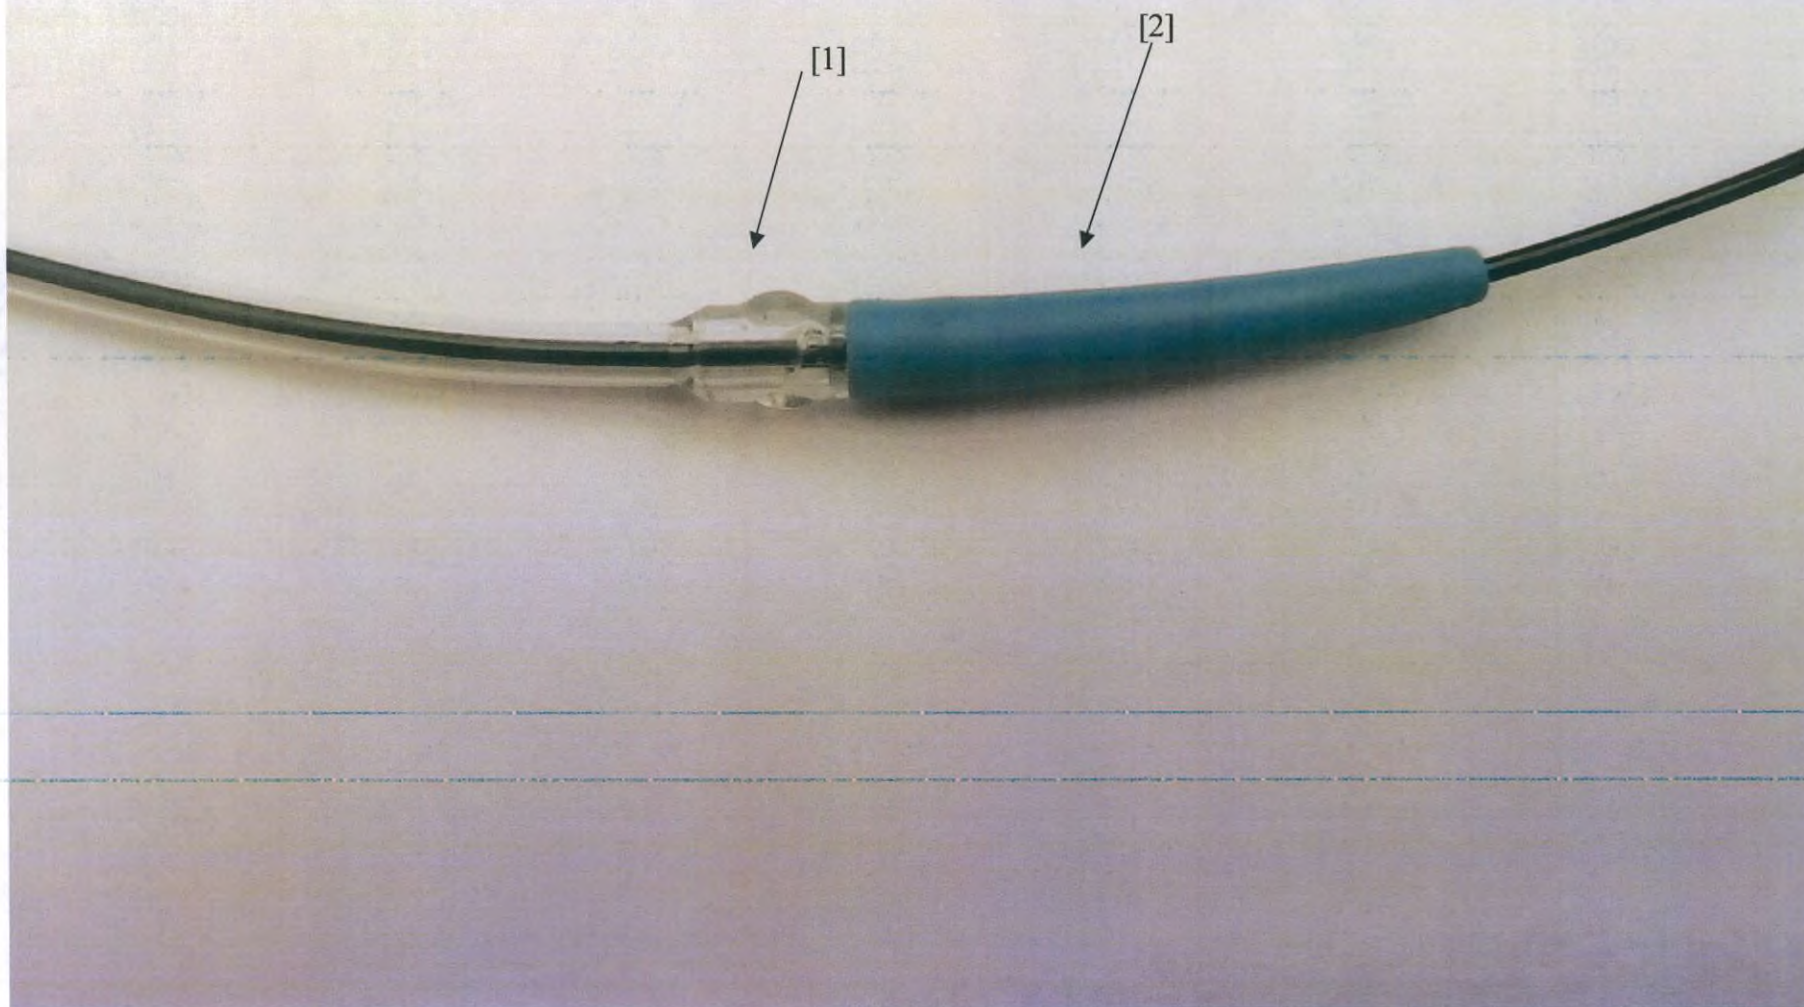


Держатель разгрузочной муфты [1], дистальная разгрузочная муфта [2]

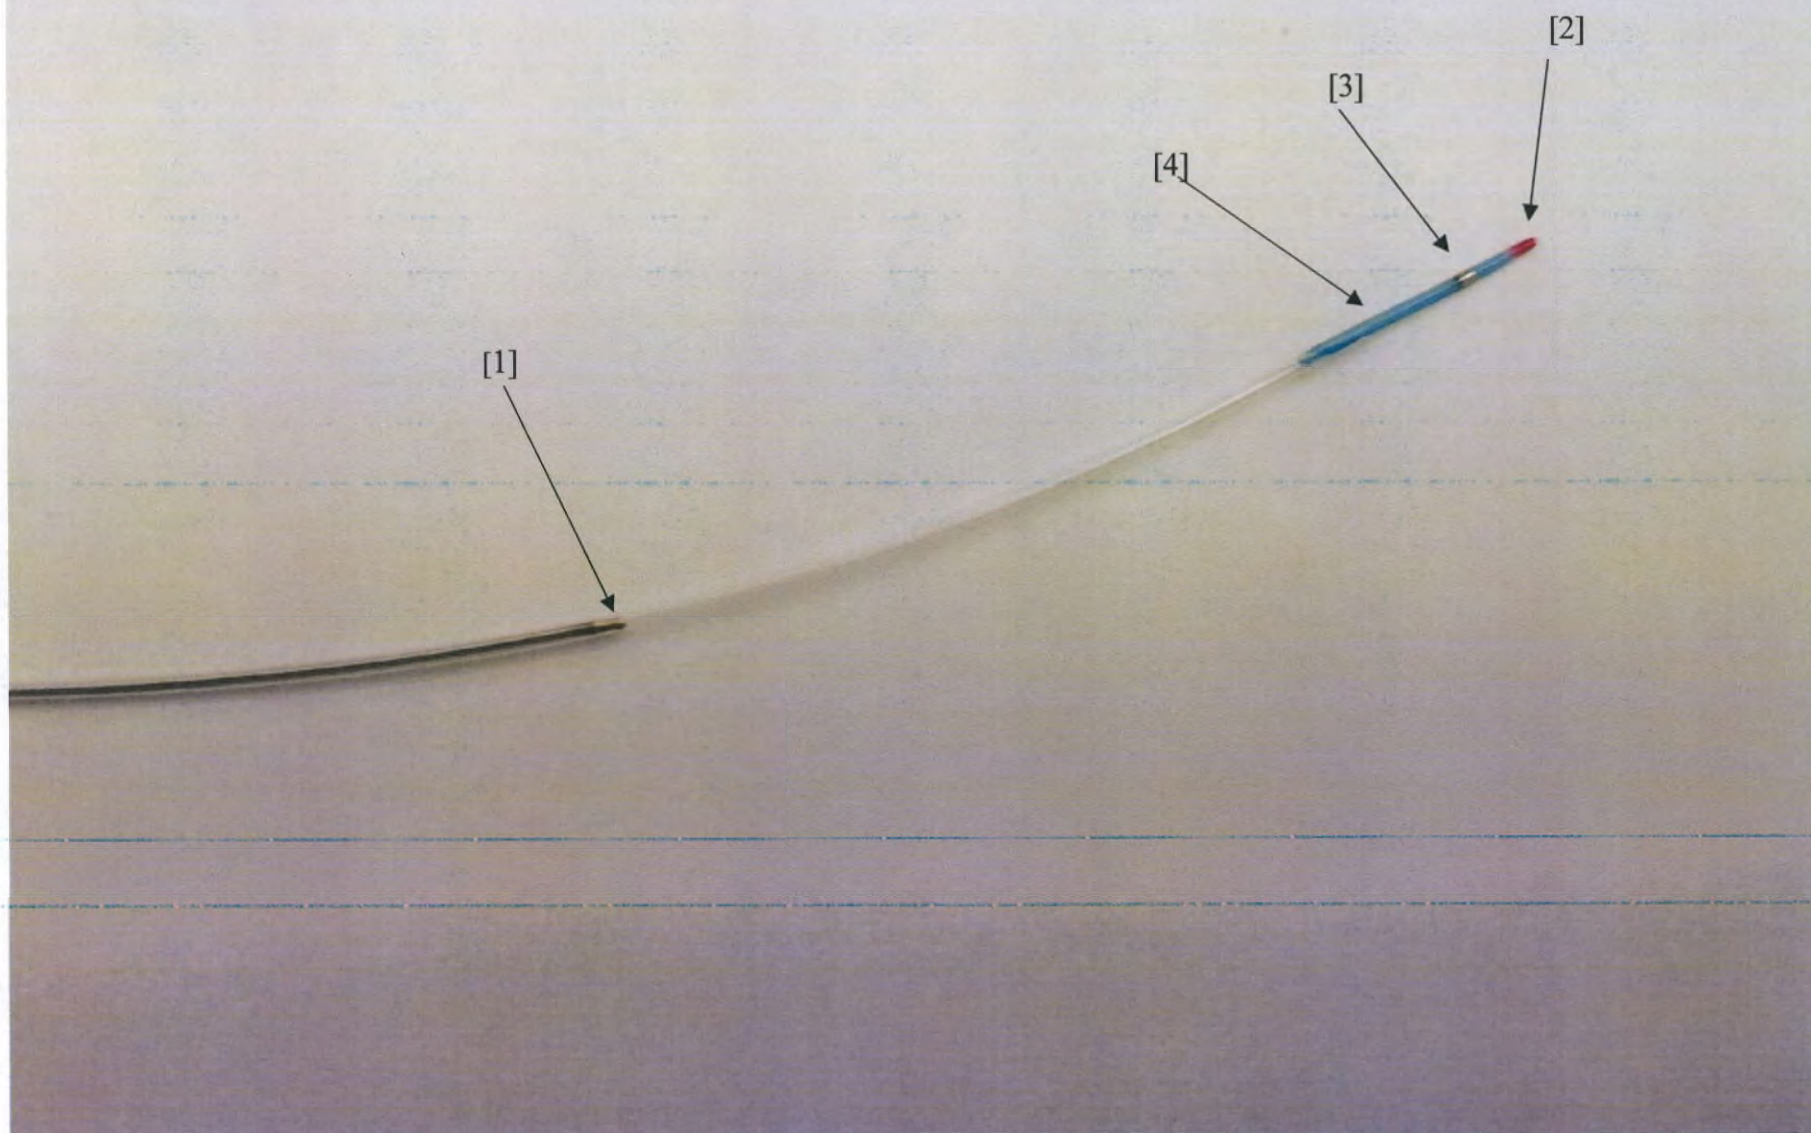


Пьезоэлектрический датчик [1], дистальный кончик [2], рентгеноконтрастная метка [3] и трубка с просветом для проводника [4]

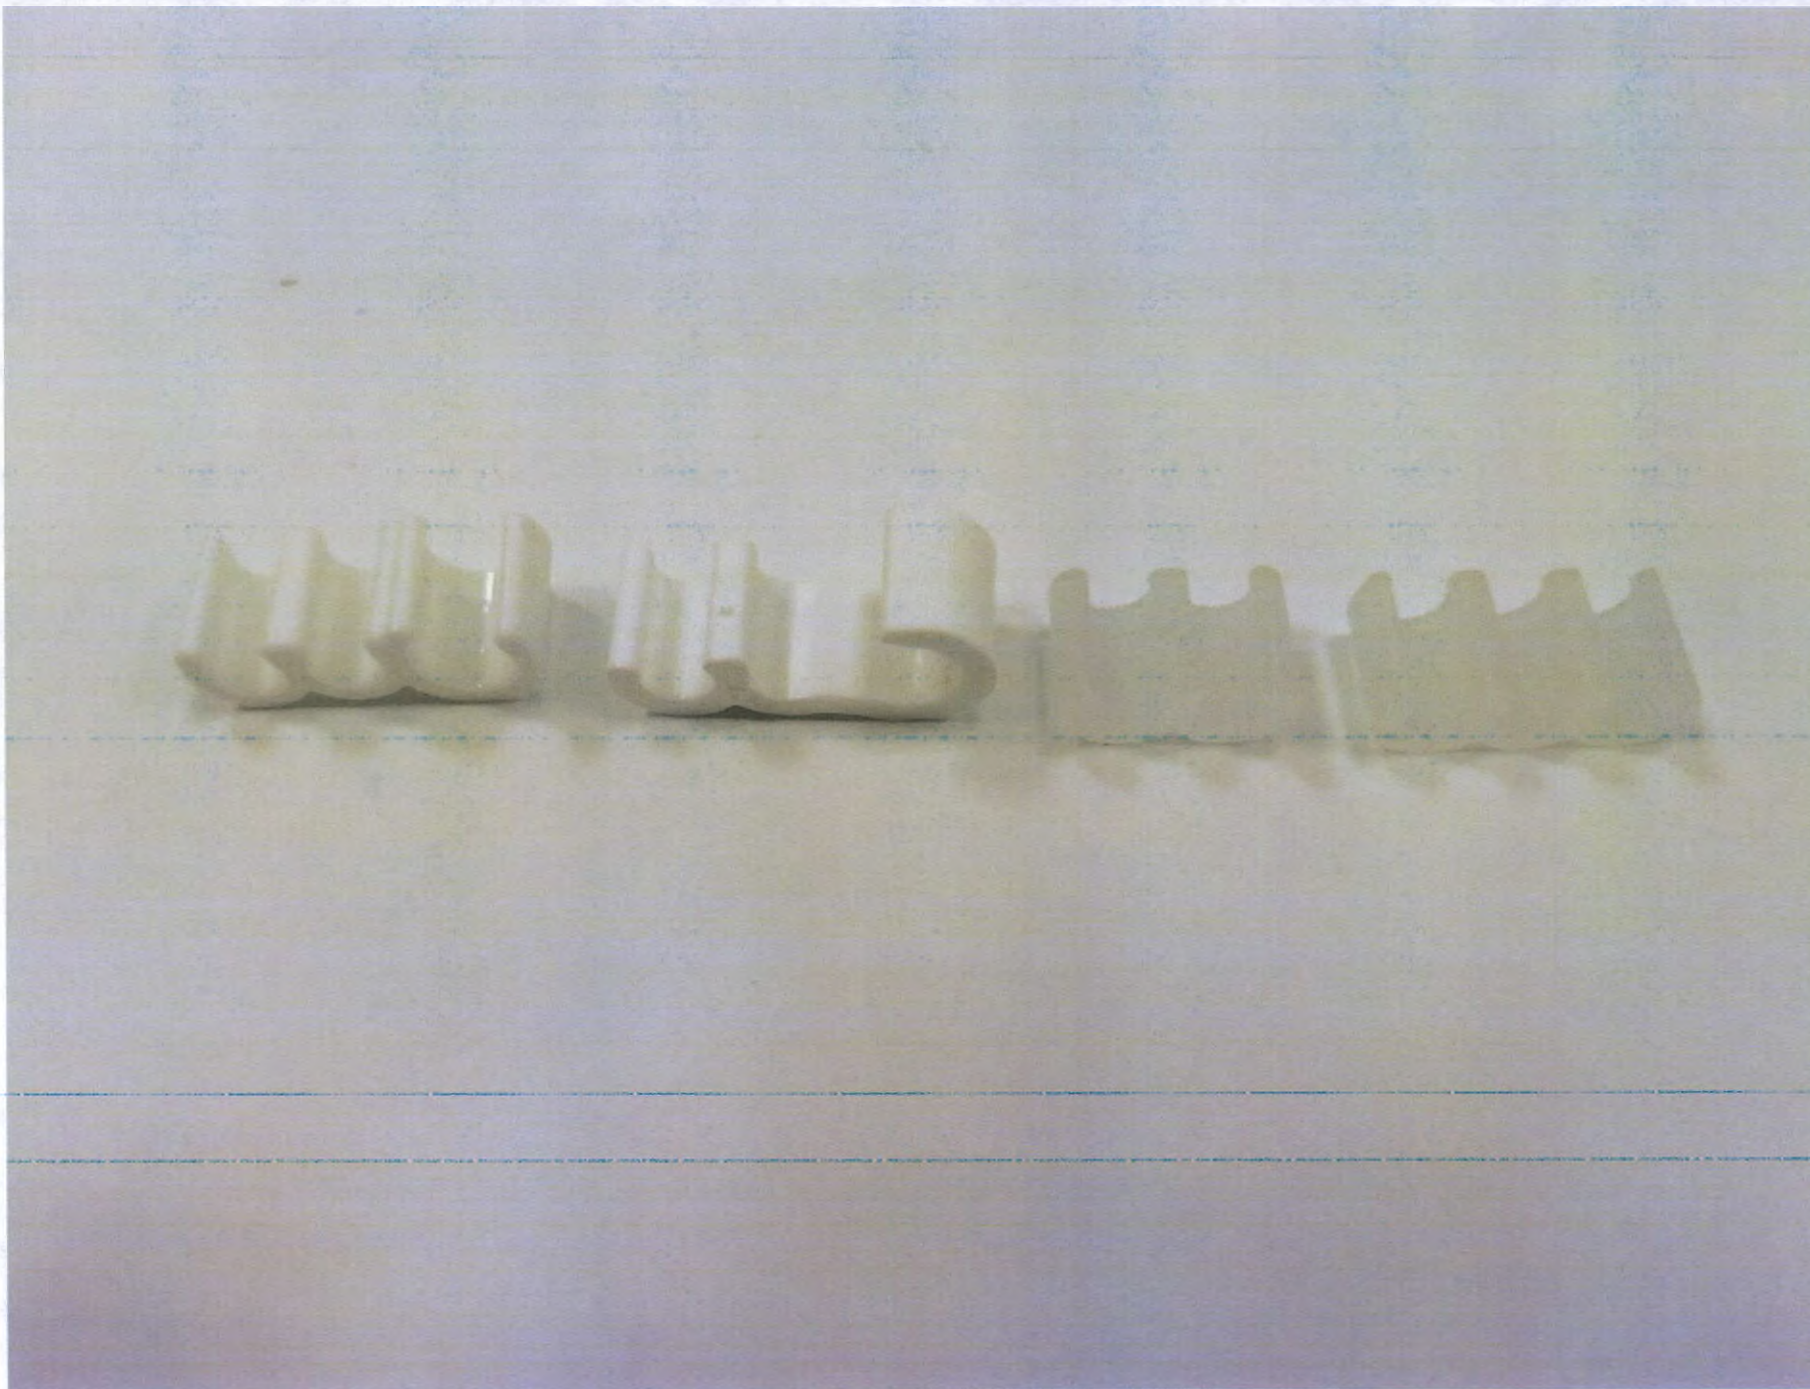

Зажимы для крепления защитной трубки

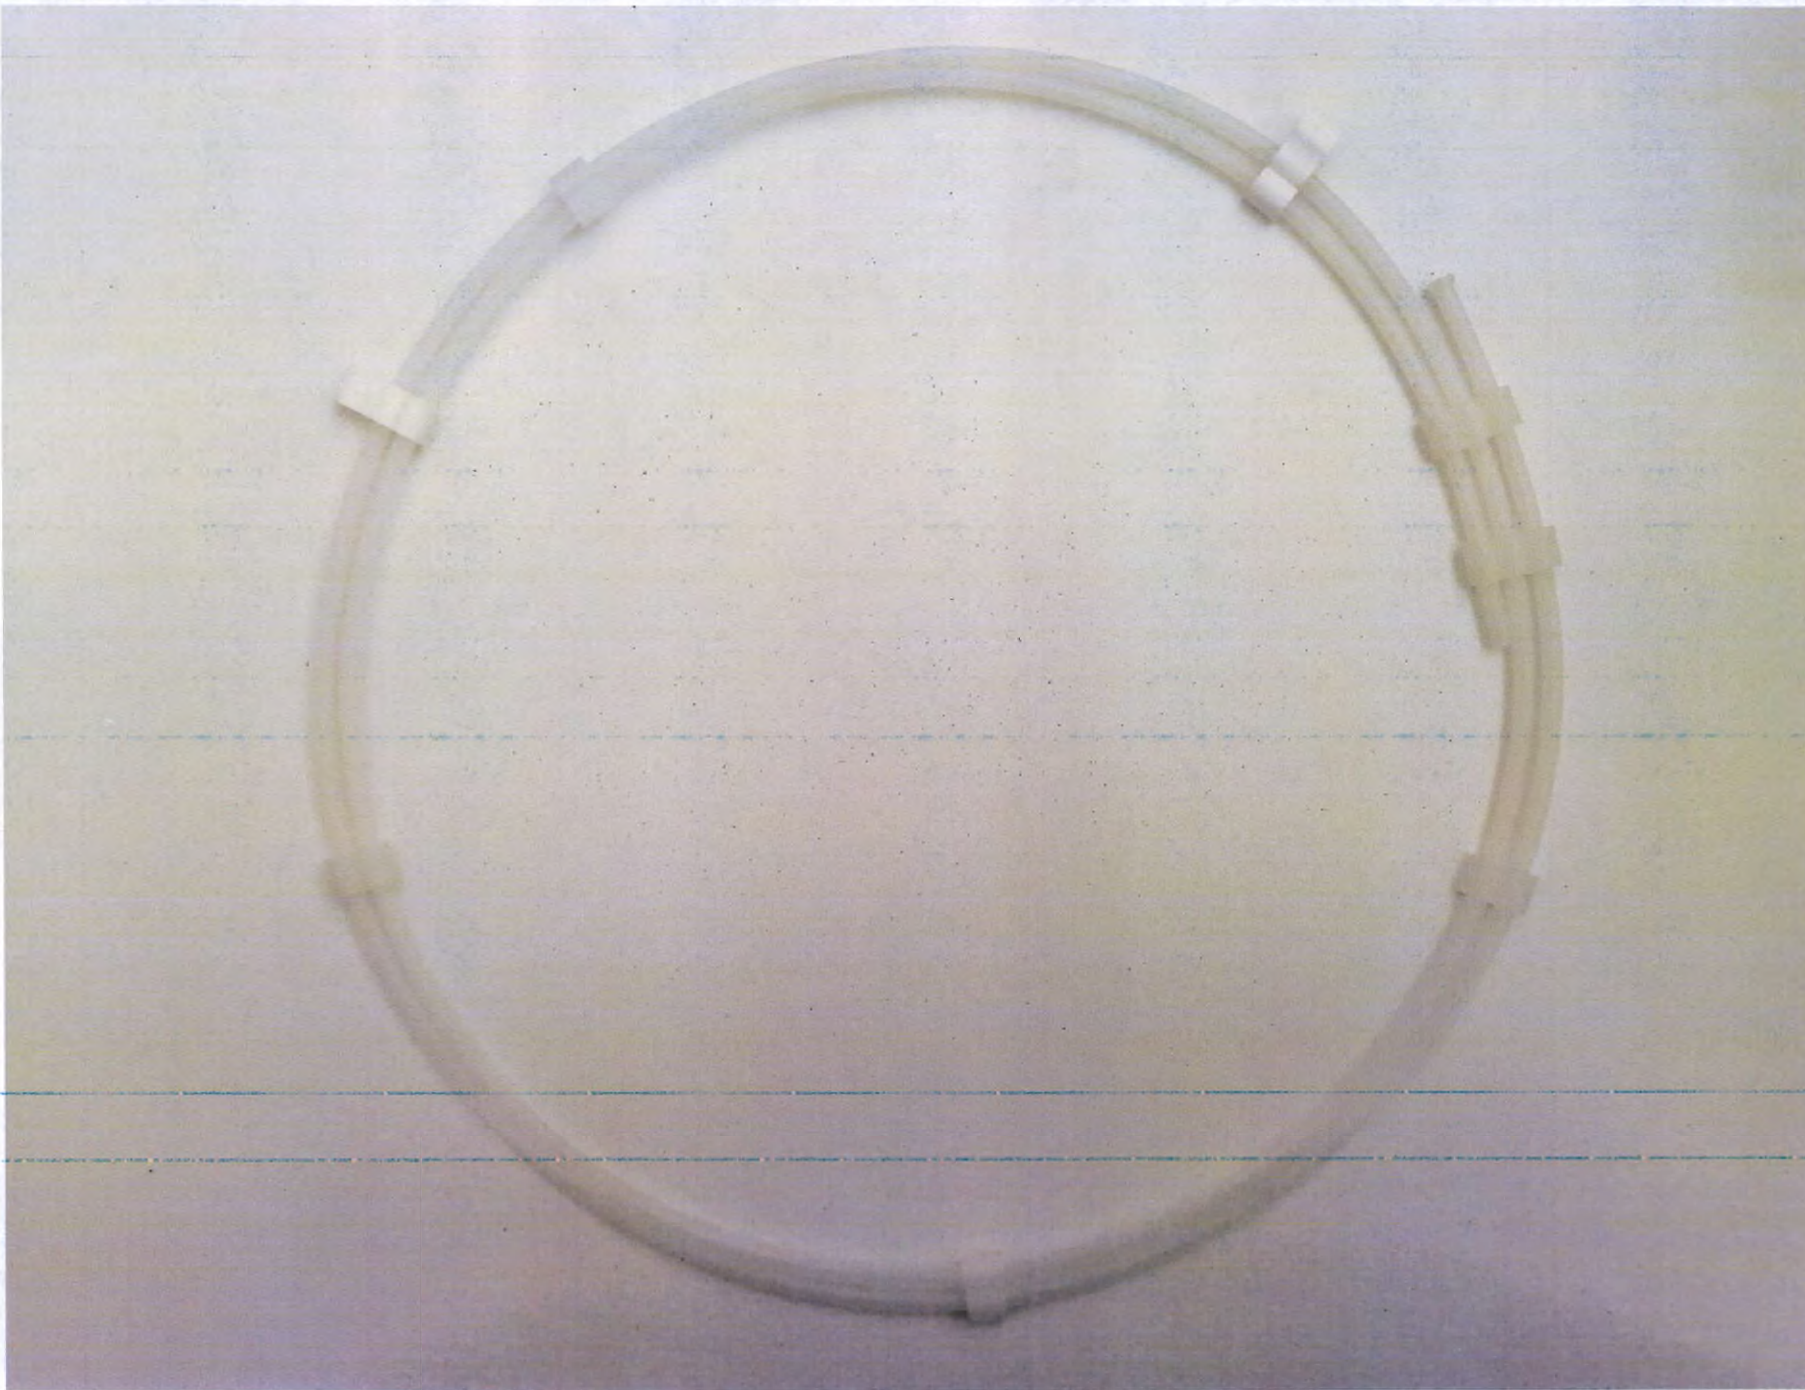

Защитная трубка с зажимами

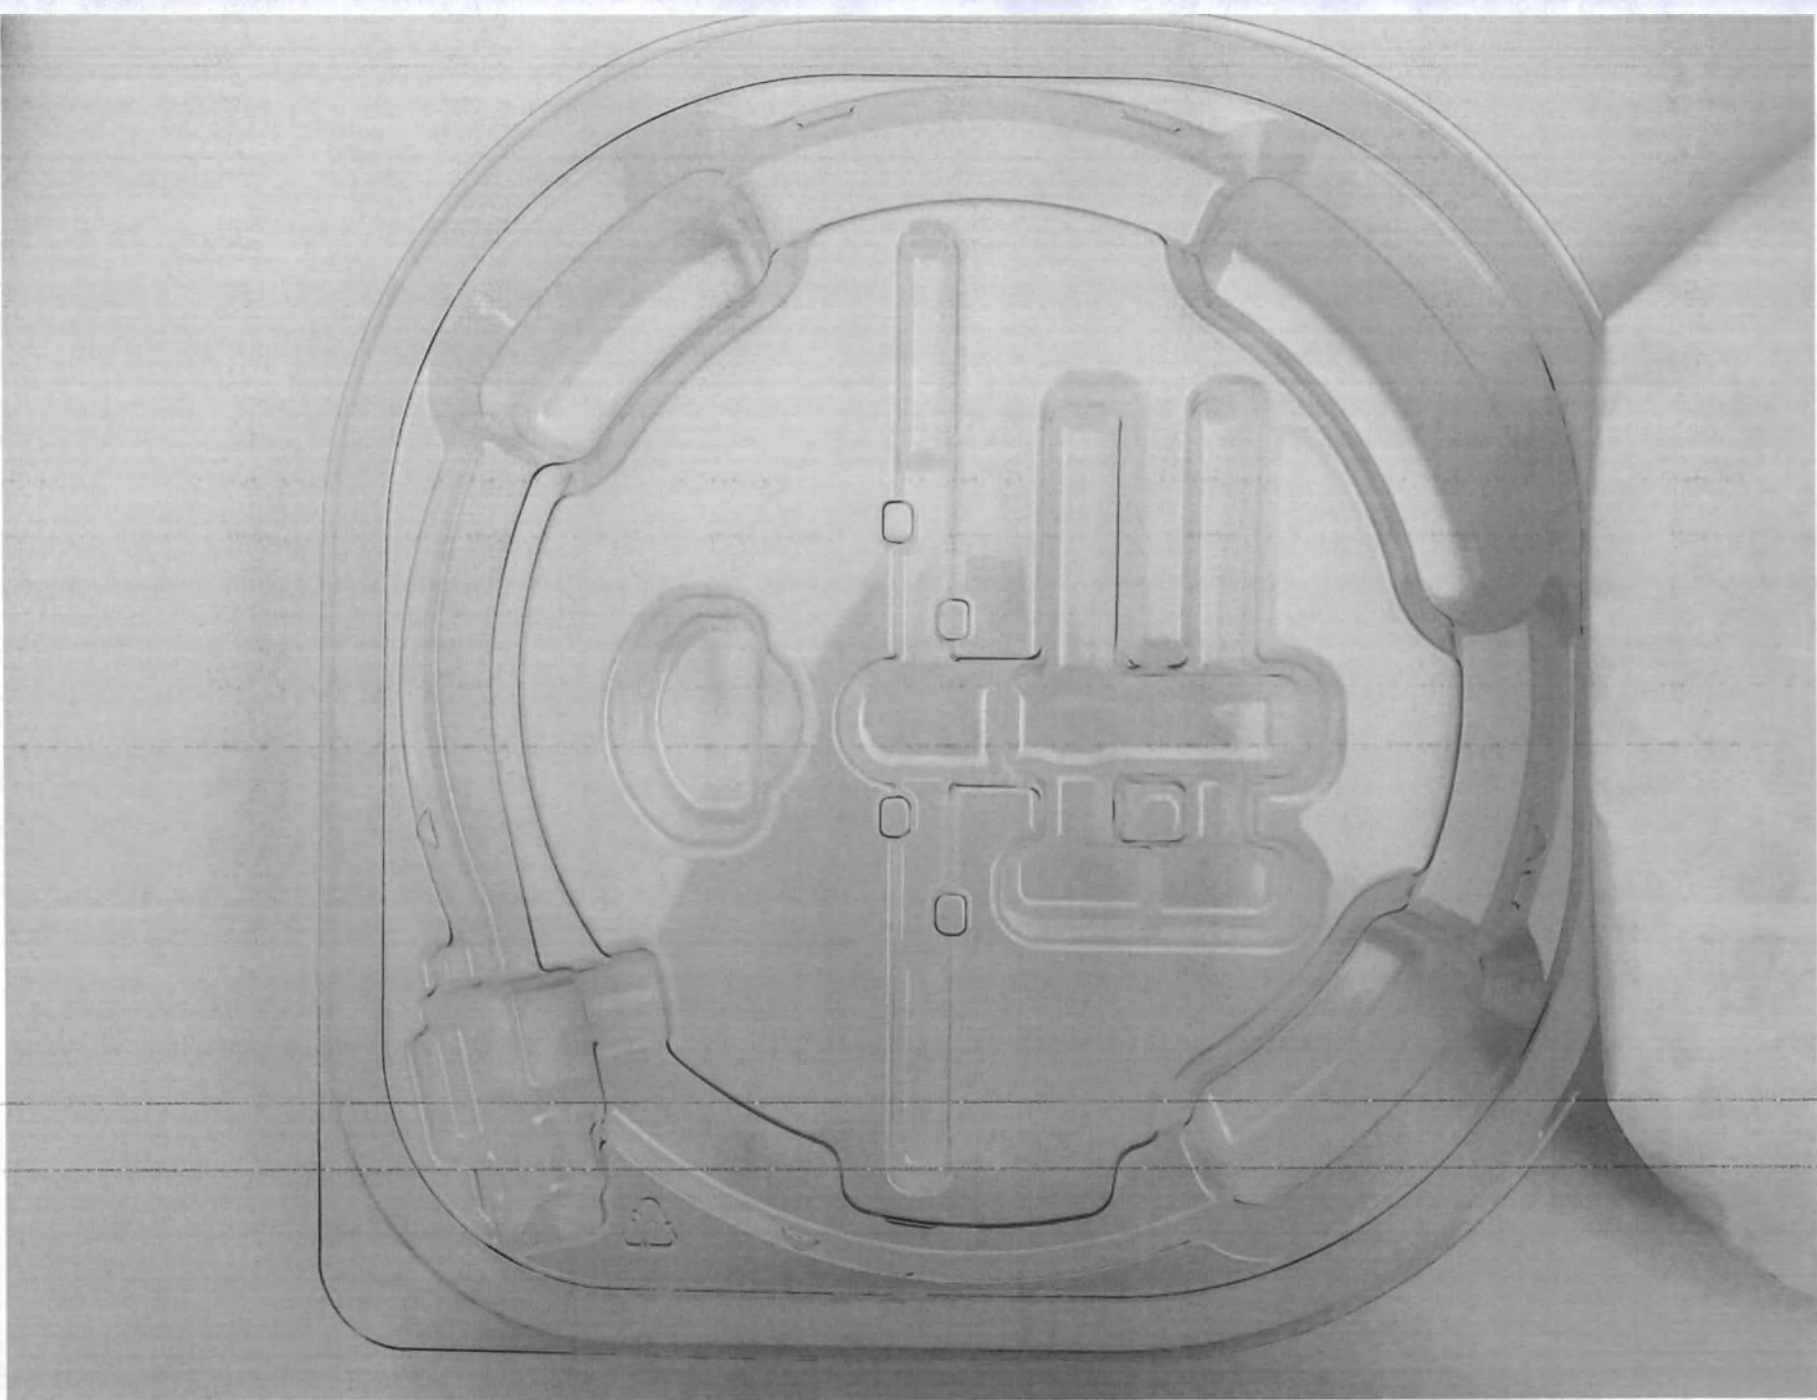

Лоток

Boston Scientific



EC REP EU Authorized Representative

Boston Scientific Limited
Ballybrink Business Park
Galway
IRELAND

Legal Manufacturer

Boston Scientific Corporation
200 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752
USA
USA Customer Service 800-272-1801

Rx ONLY

Consult instructions for use.

Do not use if package is damaged.

For single use only. Do not reuse.

Do Not Restерilize

Boston Scientific

OptiCross™ 18

30MHz

Peripheral Imaging Catheter

Cateter ecográfico periférico, Cathéter d'imagerie périphérique, Peripherer Bildgebungskatheter, Cateters per imaging periferico, Perifere imagingkatheter, 末梢用イメージング・カテーテル, Kateter til perifer billedannelse, Koßerþpaç omeuðwaðç neþieþþikoð omeuðwaðç, Cateter Ecográfico Periférico, Perifer bildkatheter, Perifériás képekotó katéter, Katéter pro periferní snímkování, Cewnik do diagnostyki obrazowej naczyń obwodowych, Periferit ultralydkatheter, Periferai Görüntölés Kateteri, Perifereinén kuvantamiskatetri, Cateter de imagistică periferică, Катетер для периферической эсорографии, Katéter na periférne zobrazovanie



- (2) Includes Springs
- (1) Includes Extension Tubing
- (1) Includes Stopcock

GTIN 08714729904748 **LOT** 28832609

REF Catalog No. H7493932700180 **Use By** 2024-02-08

STERILE R Sterilized using irradiation.



91102812-01A

CE 0344

Made in COSTA RICA
2545 First Street
Properk
El Coyol, Alajuela
COSTA RICA

This product may be protected by one or more patents
Patent information can be obtained at
<http://www.bostonscientific.com/patents>

Boston Scientific
OptiCross™ 18
3.6F (1.18mm) x 135cm
GTIN 08714729904748
REF H7493932700180
LOT 28832609

Boston Scientific
OptiCross™ 18
3.6F (1.18mm) x 135cm


Boston Scientific
OptiCross™ 18
3.6F (1.18mm) x 135cm
GTIN 08714729904748
REF H7493932700180
LOT 28832609

Boston Scientific
OptiCross™ 18
3.6F (1.18mm) x 135cm
GTIN 08714729904748
REF H7493932700180
LOT 28832609




101108714729904748 171240208 10128832609 GS1

Крышка лотка

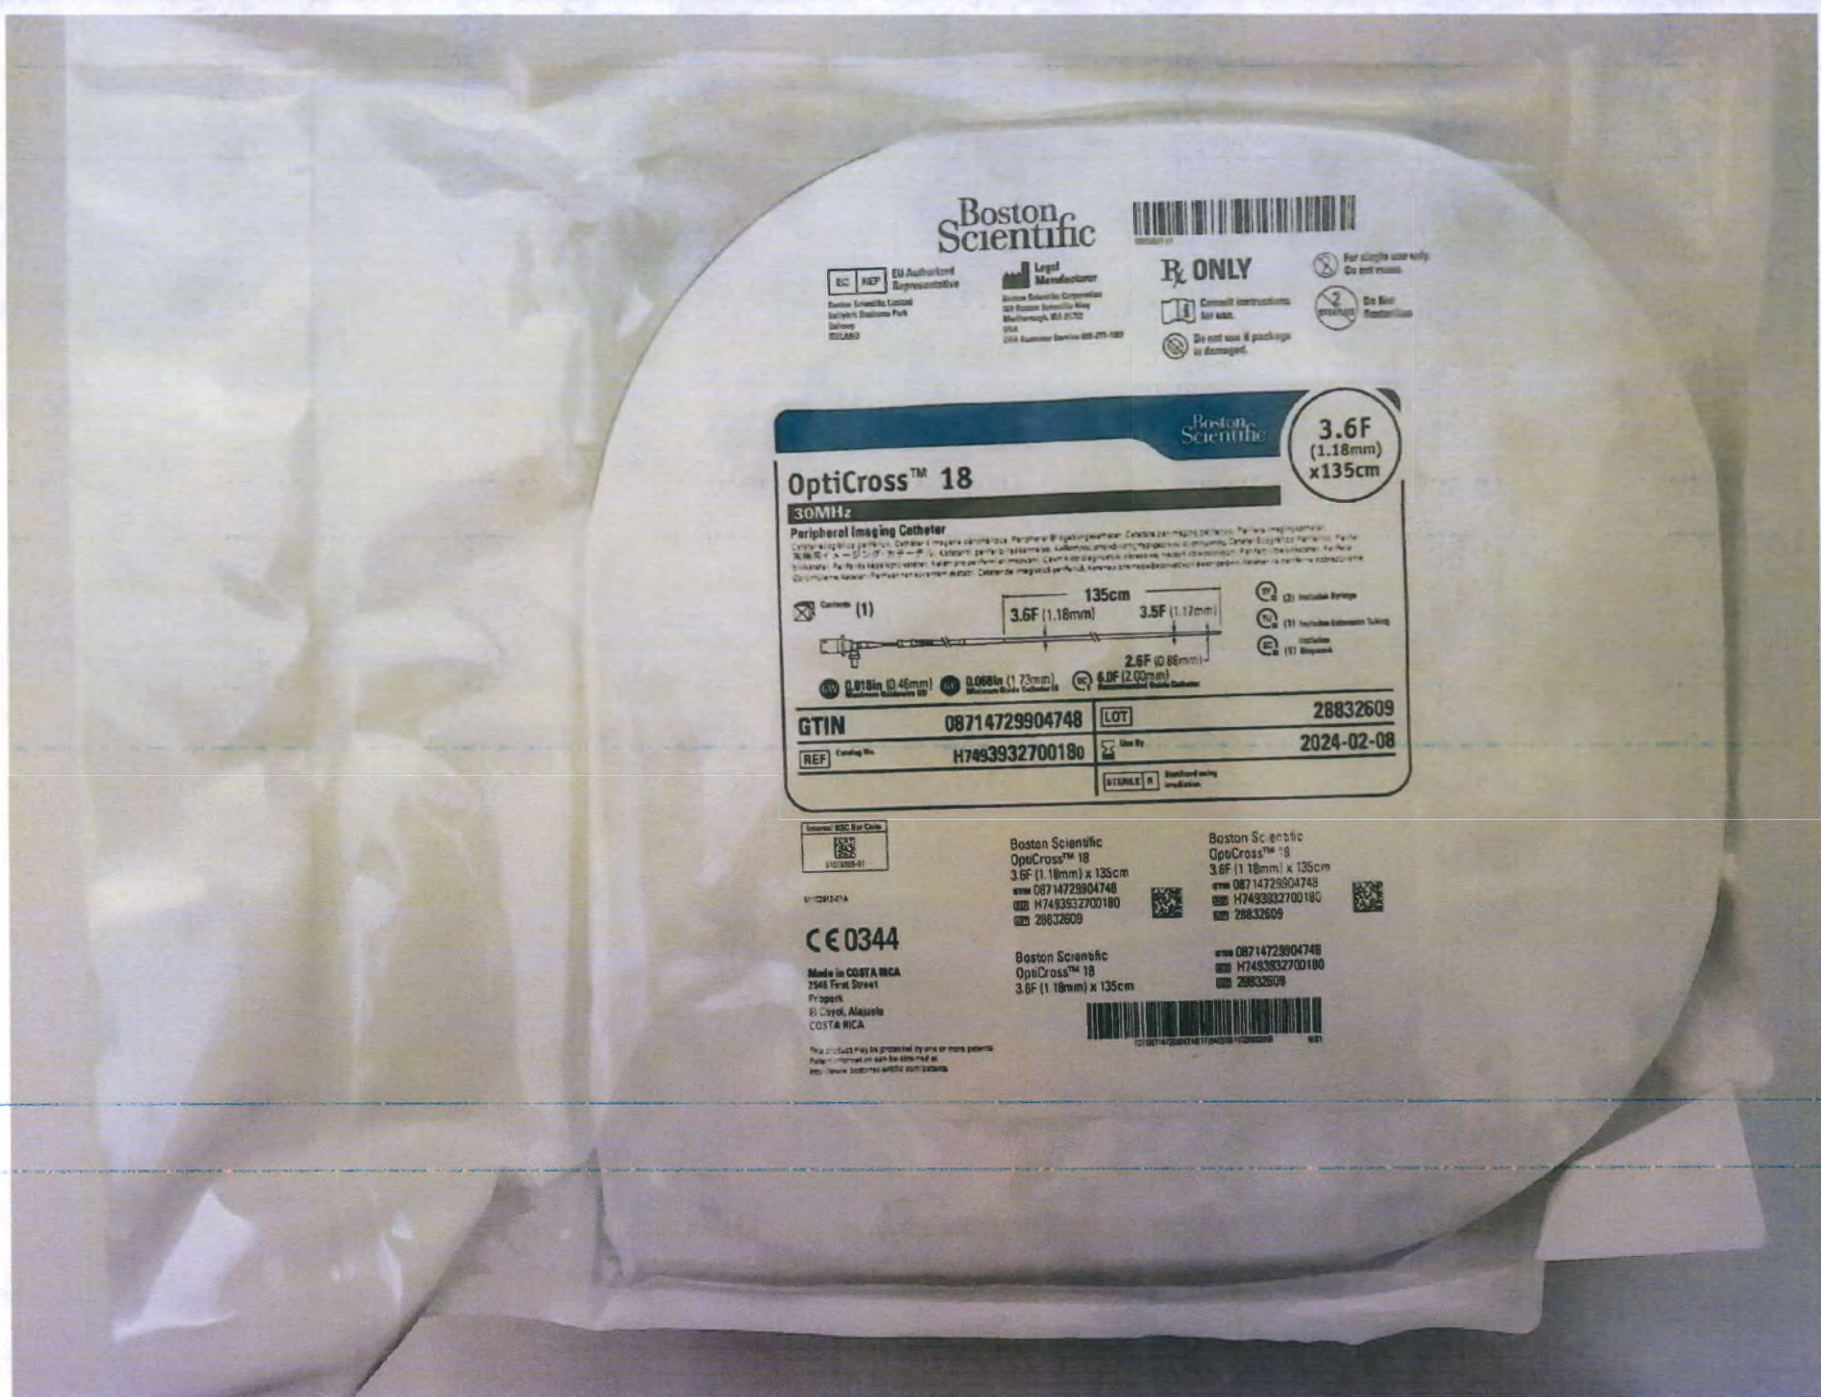

Запечатываемый пакет для лотка (вид спереди)

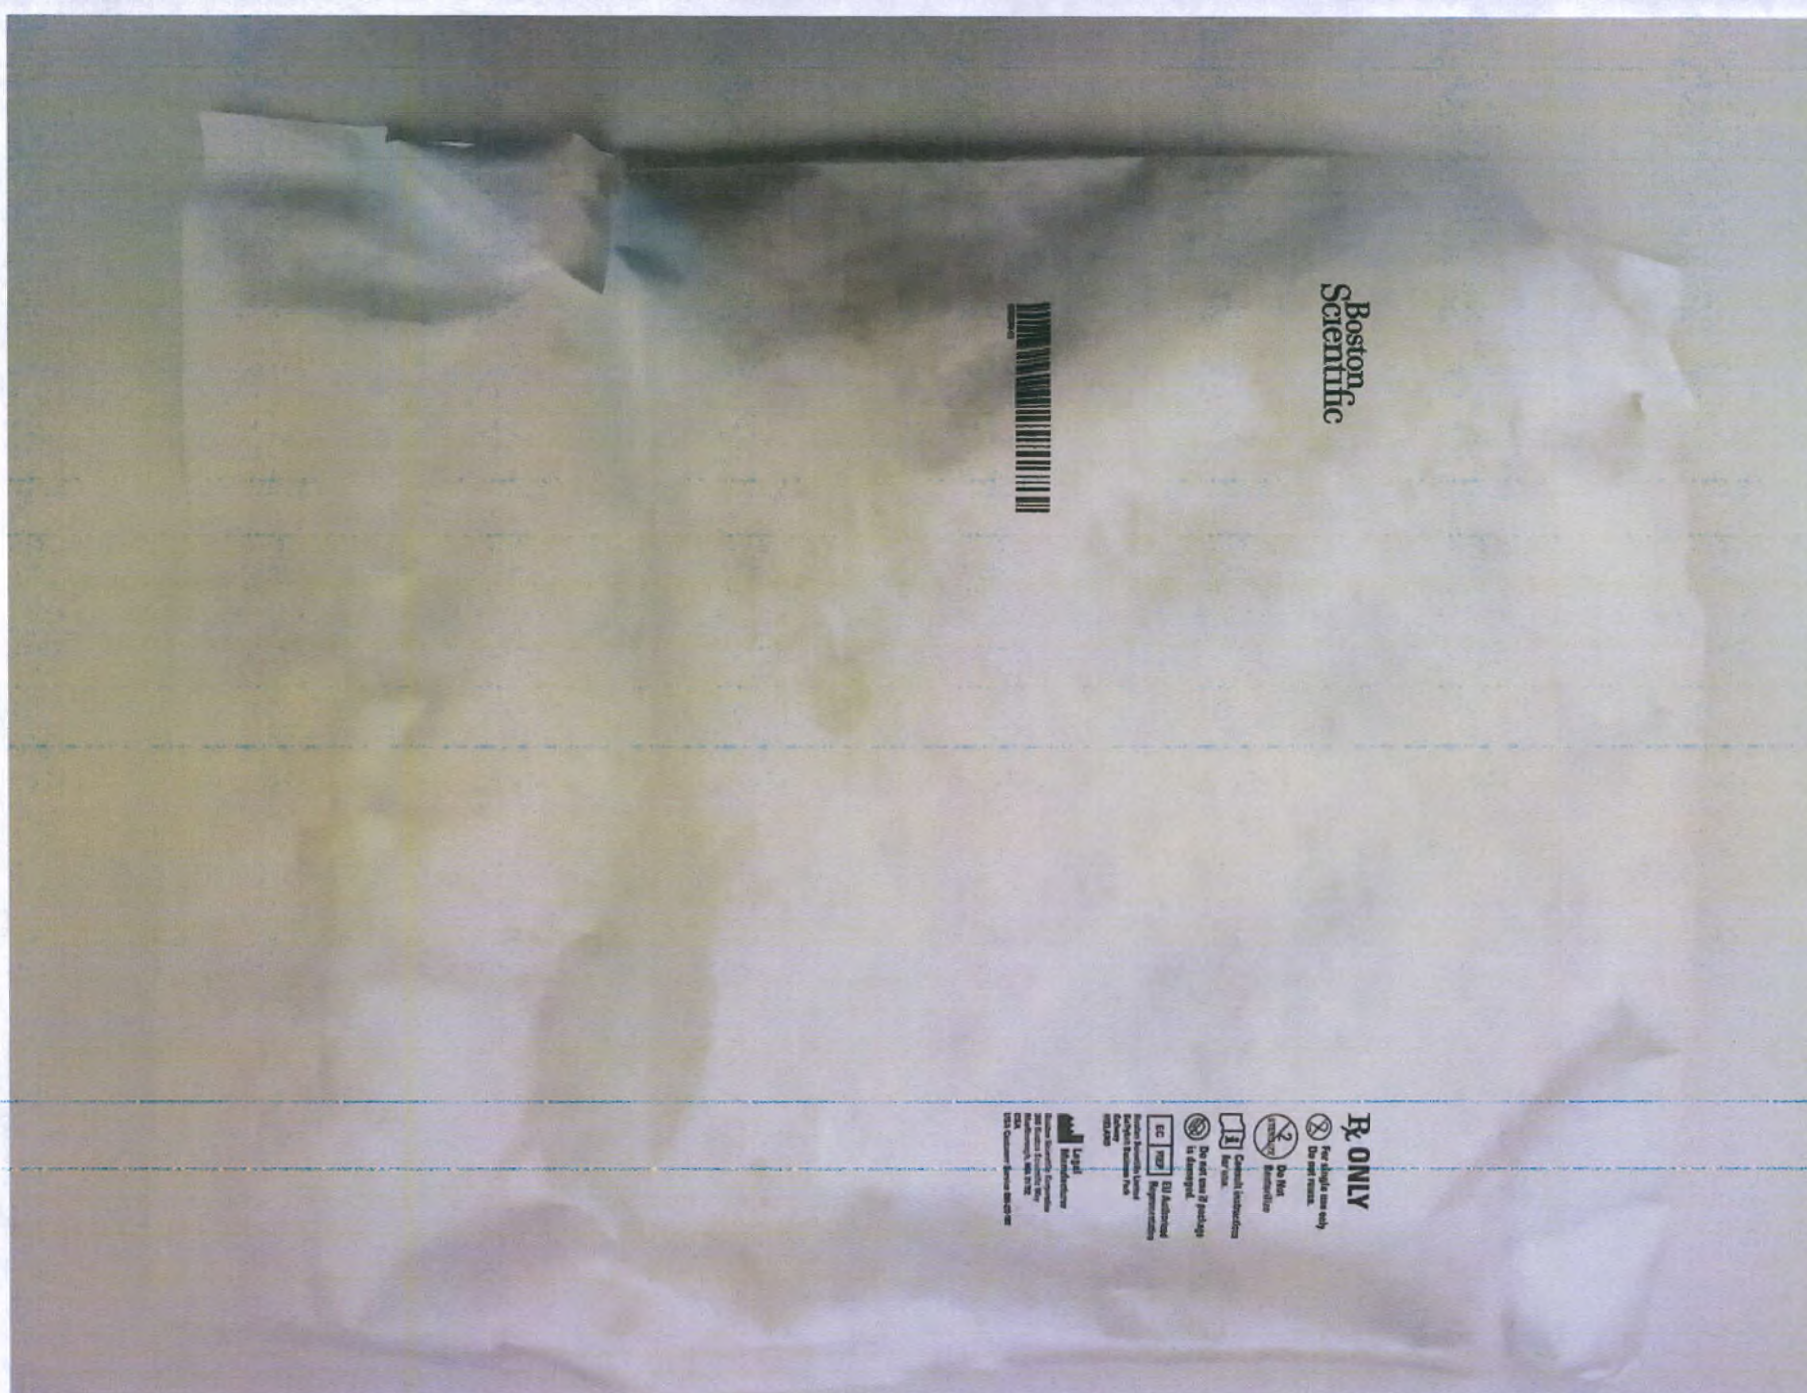

Запечатываемый пакет для лотка (вид сзади)

OptiCross™ 18

30 MHz Peripheral Imaging Catheter


MDU5 PLUS™ Sterile Bag

Sterile Bag for MDU5 PLUS Motordrive Unit


Directions for Use	2
Instrucciones de uso	8
Mode d'emploi	14
Gebrauchsanweisung	20
Istruzioni per l'uso	26
Gebruiksaanwijzing	32
Instruções de Utilização	38



Картонная коробка (вид сзади)

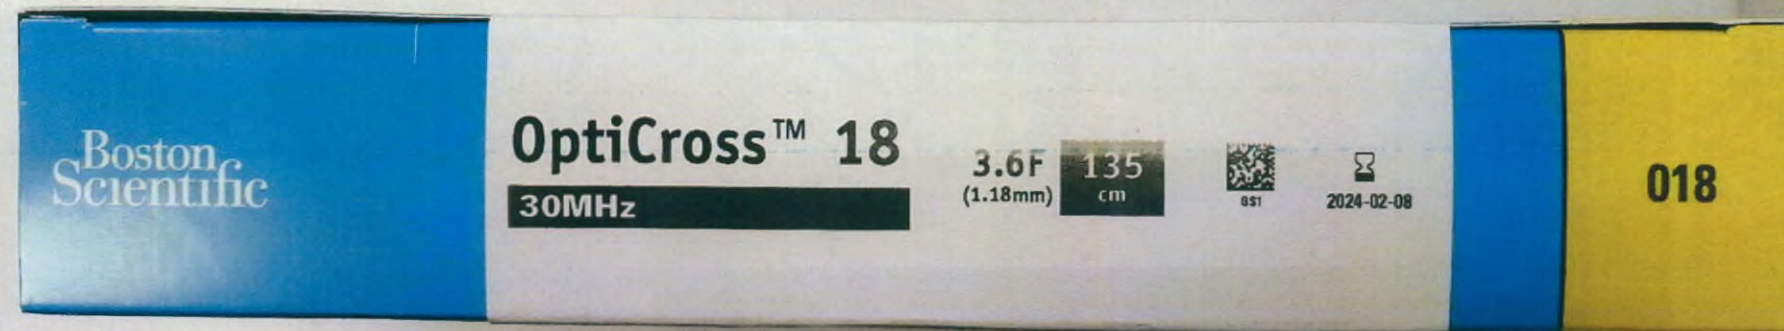



Картонная коробка (вид снизу)

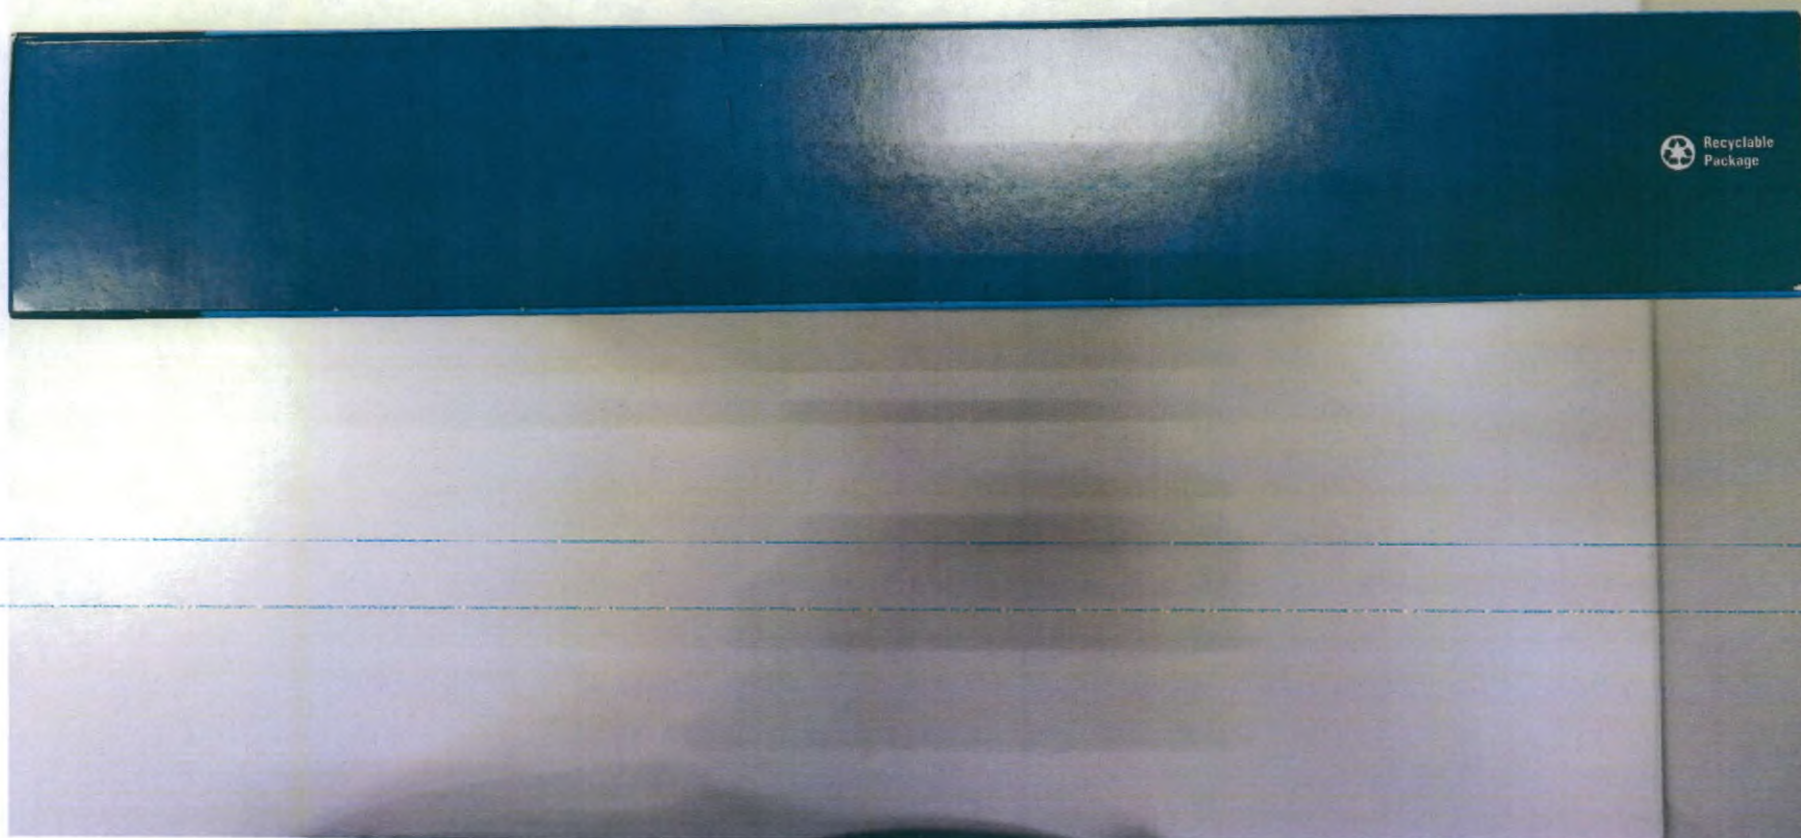


Картонная коробка (вид слева)

Шприц 3 мл

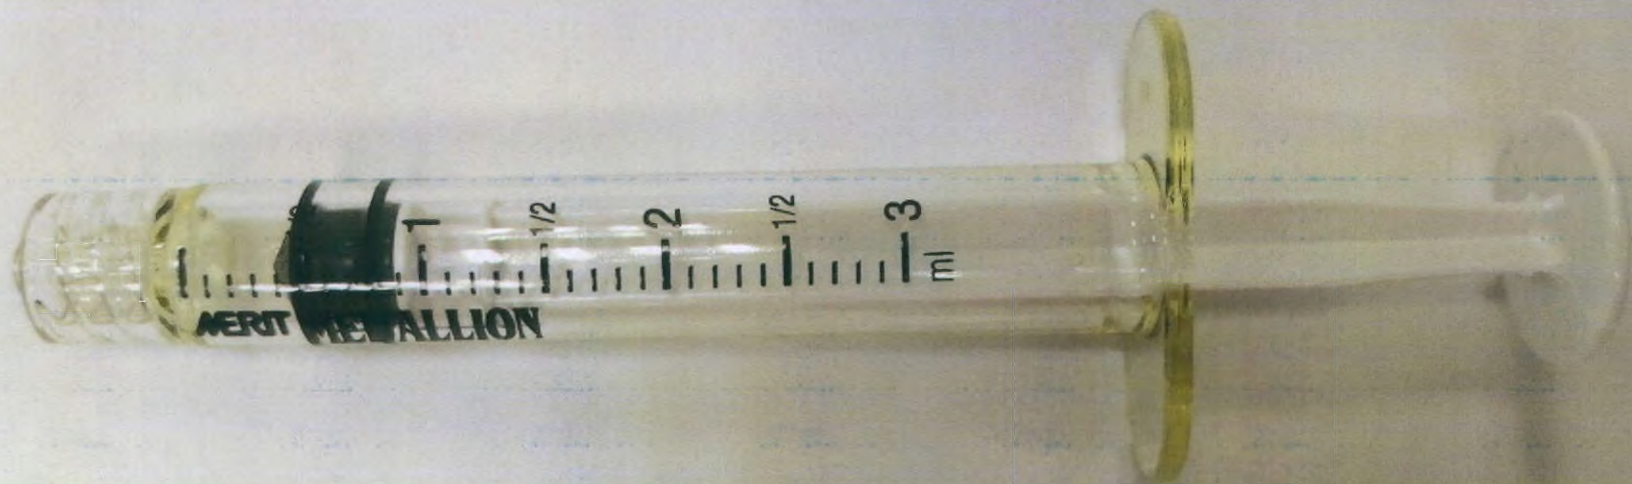


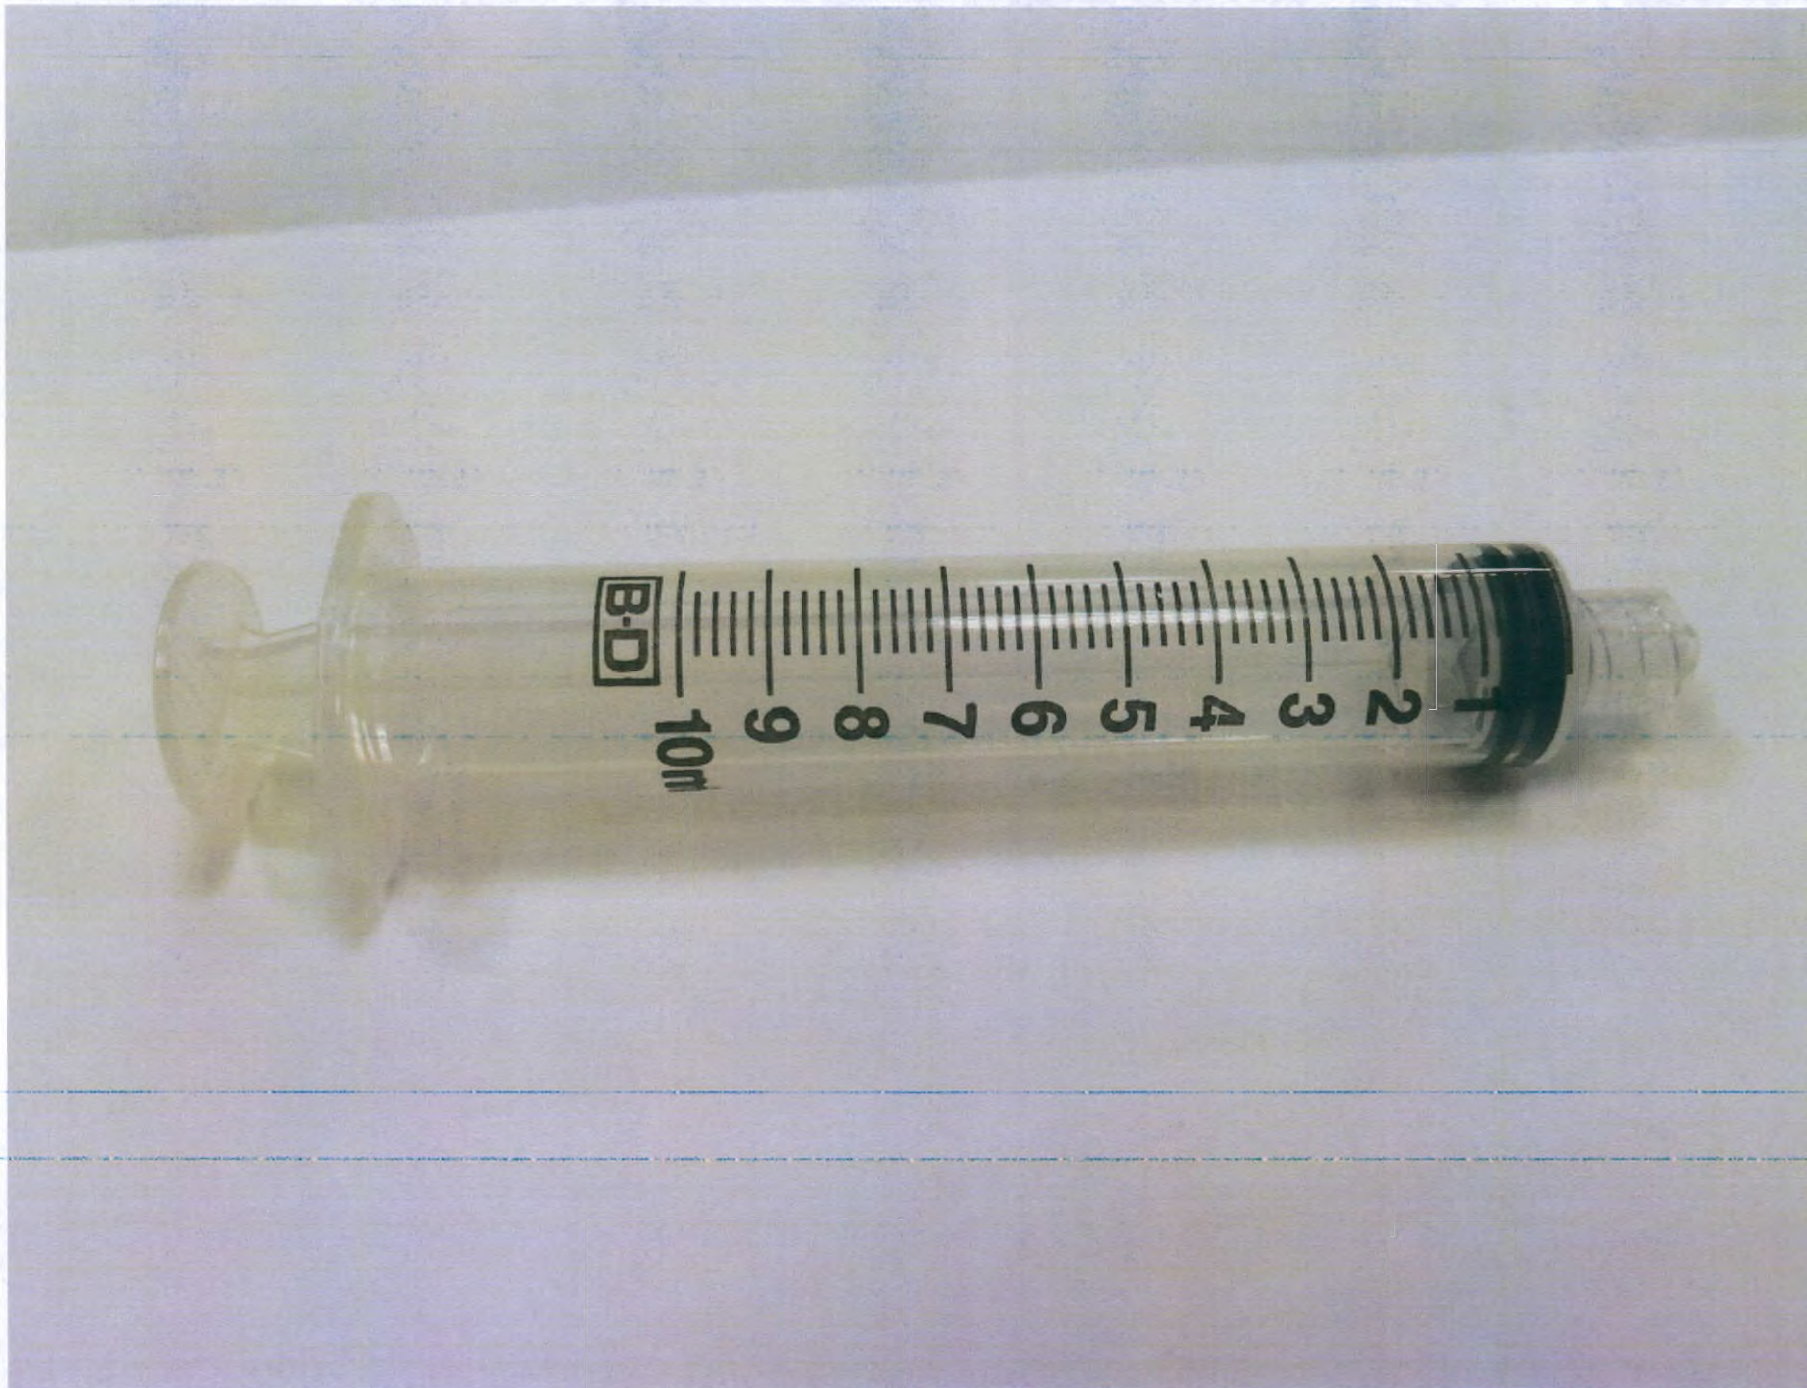


Шприц 10 мл

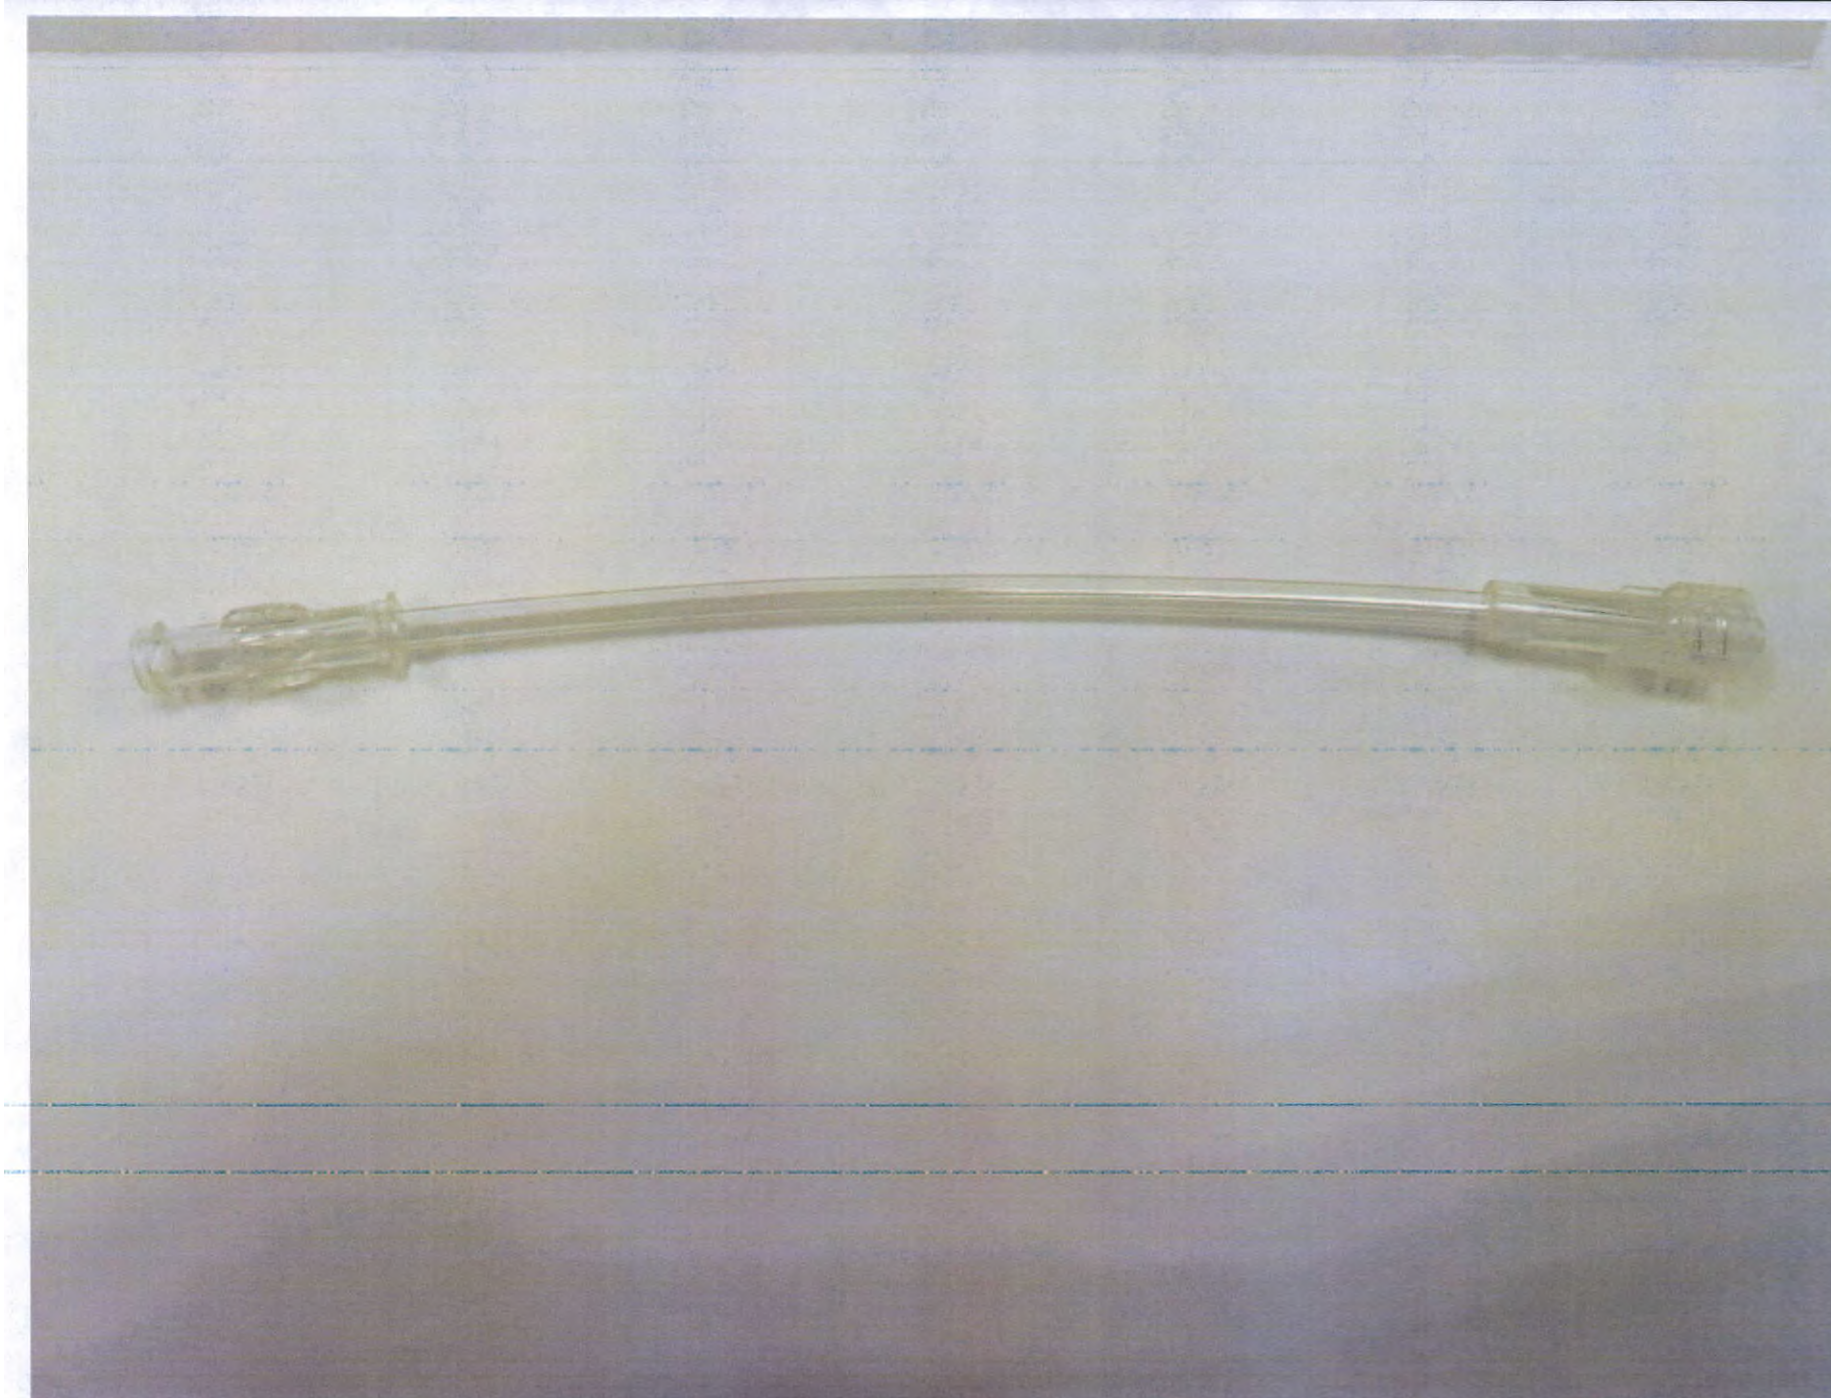


Трубка удлинительная

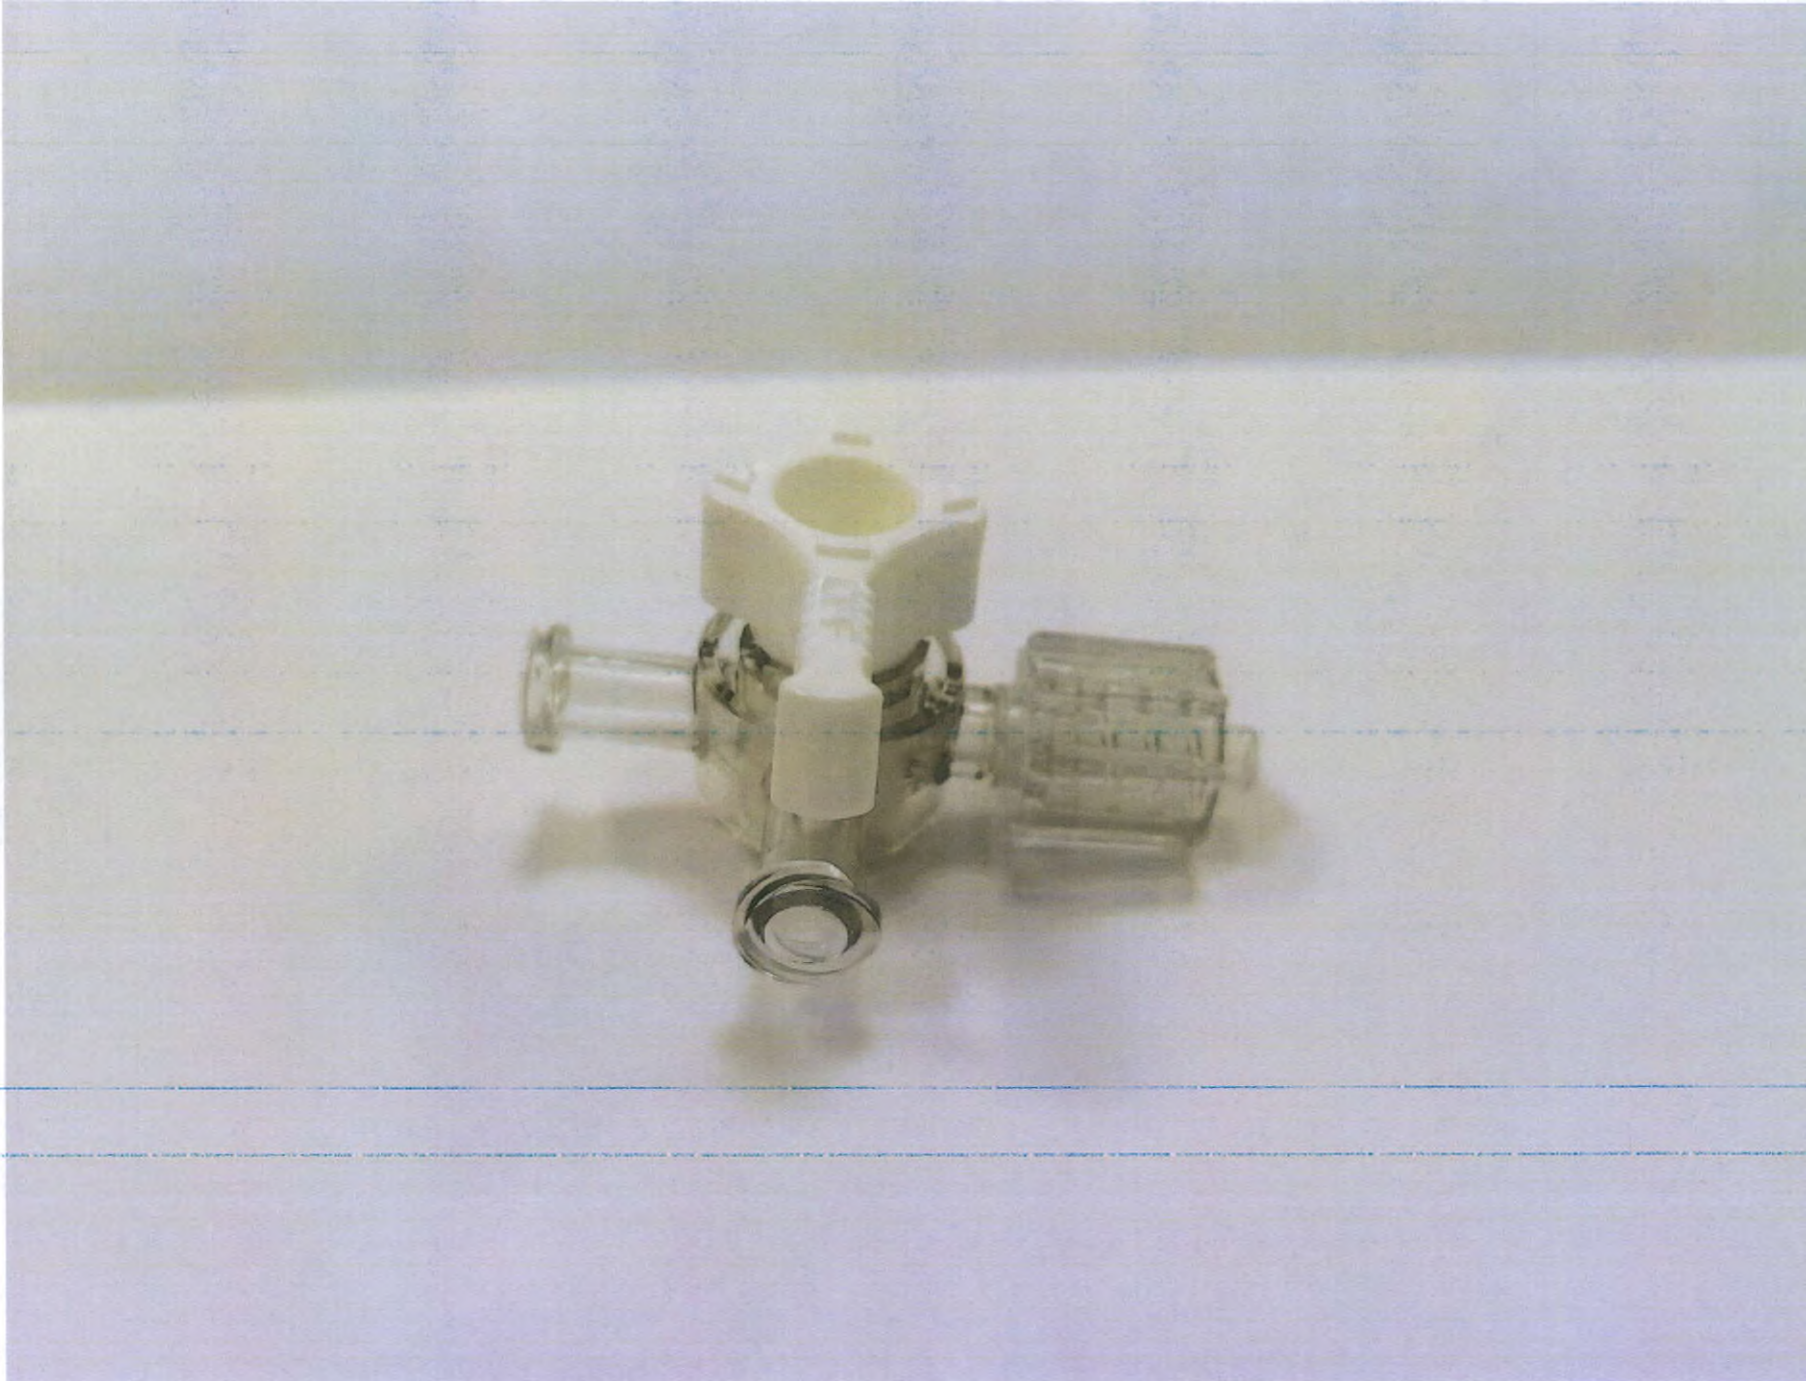

Кран 4-х ходовой

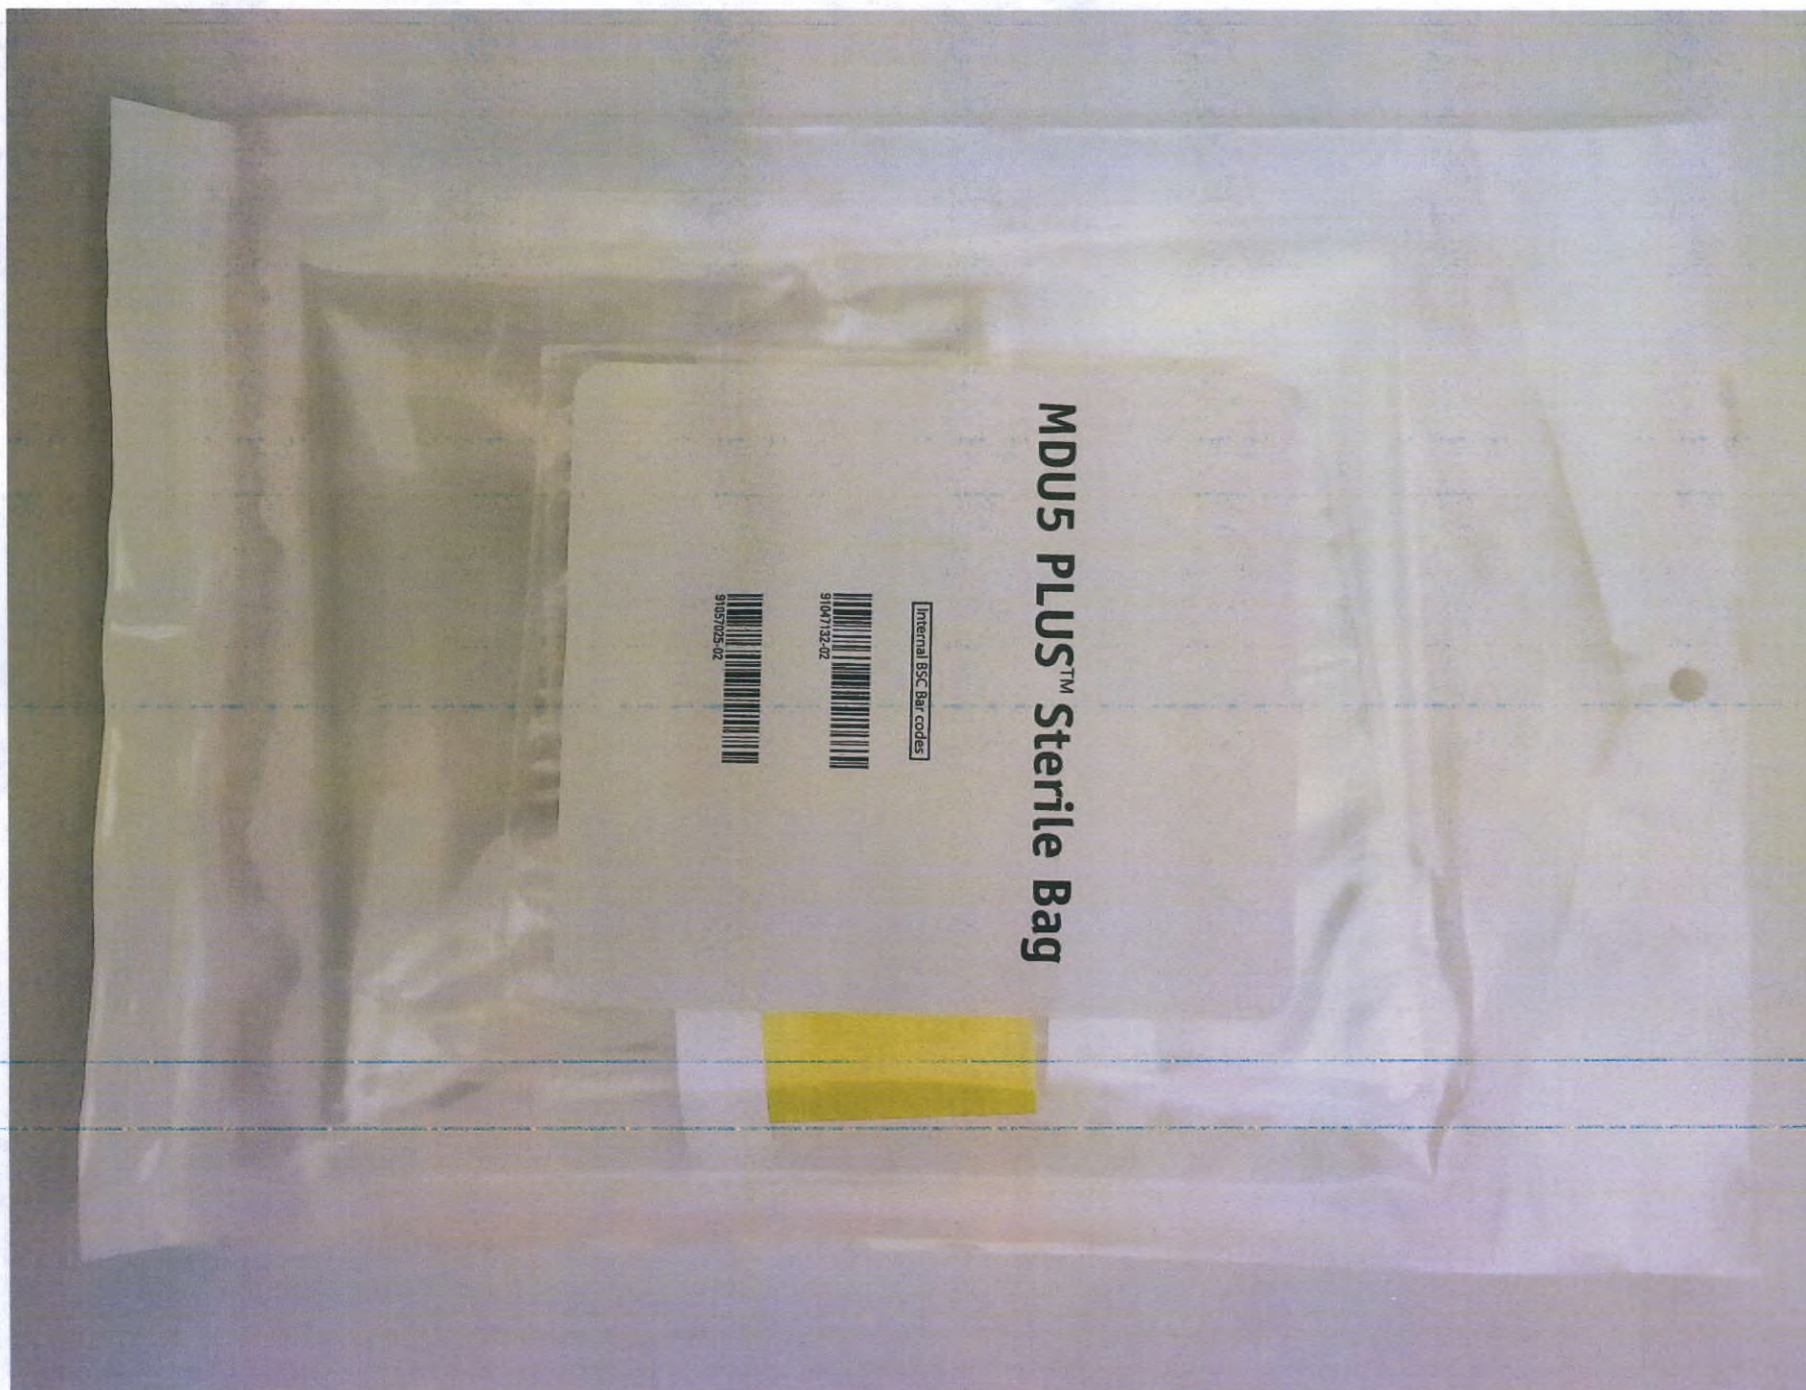


Запечатываемый пакет для пакета стерильного для блока электропривода MDU5 PLUS

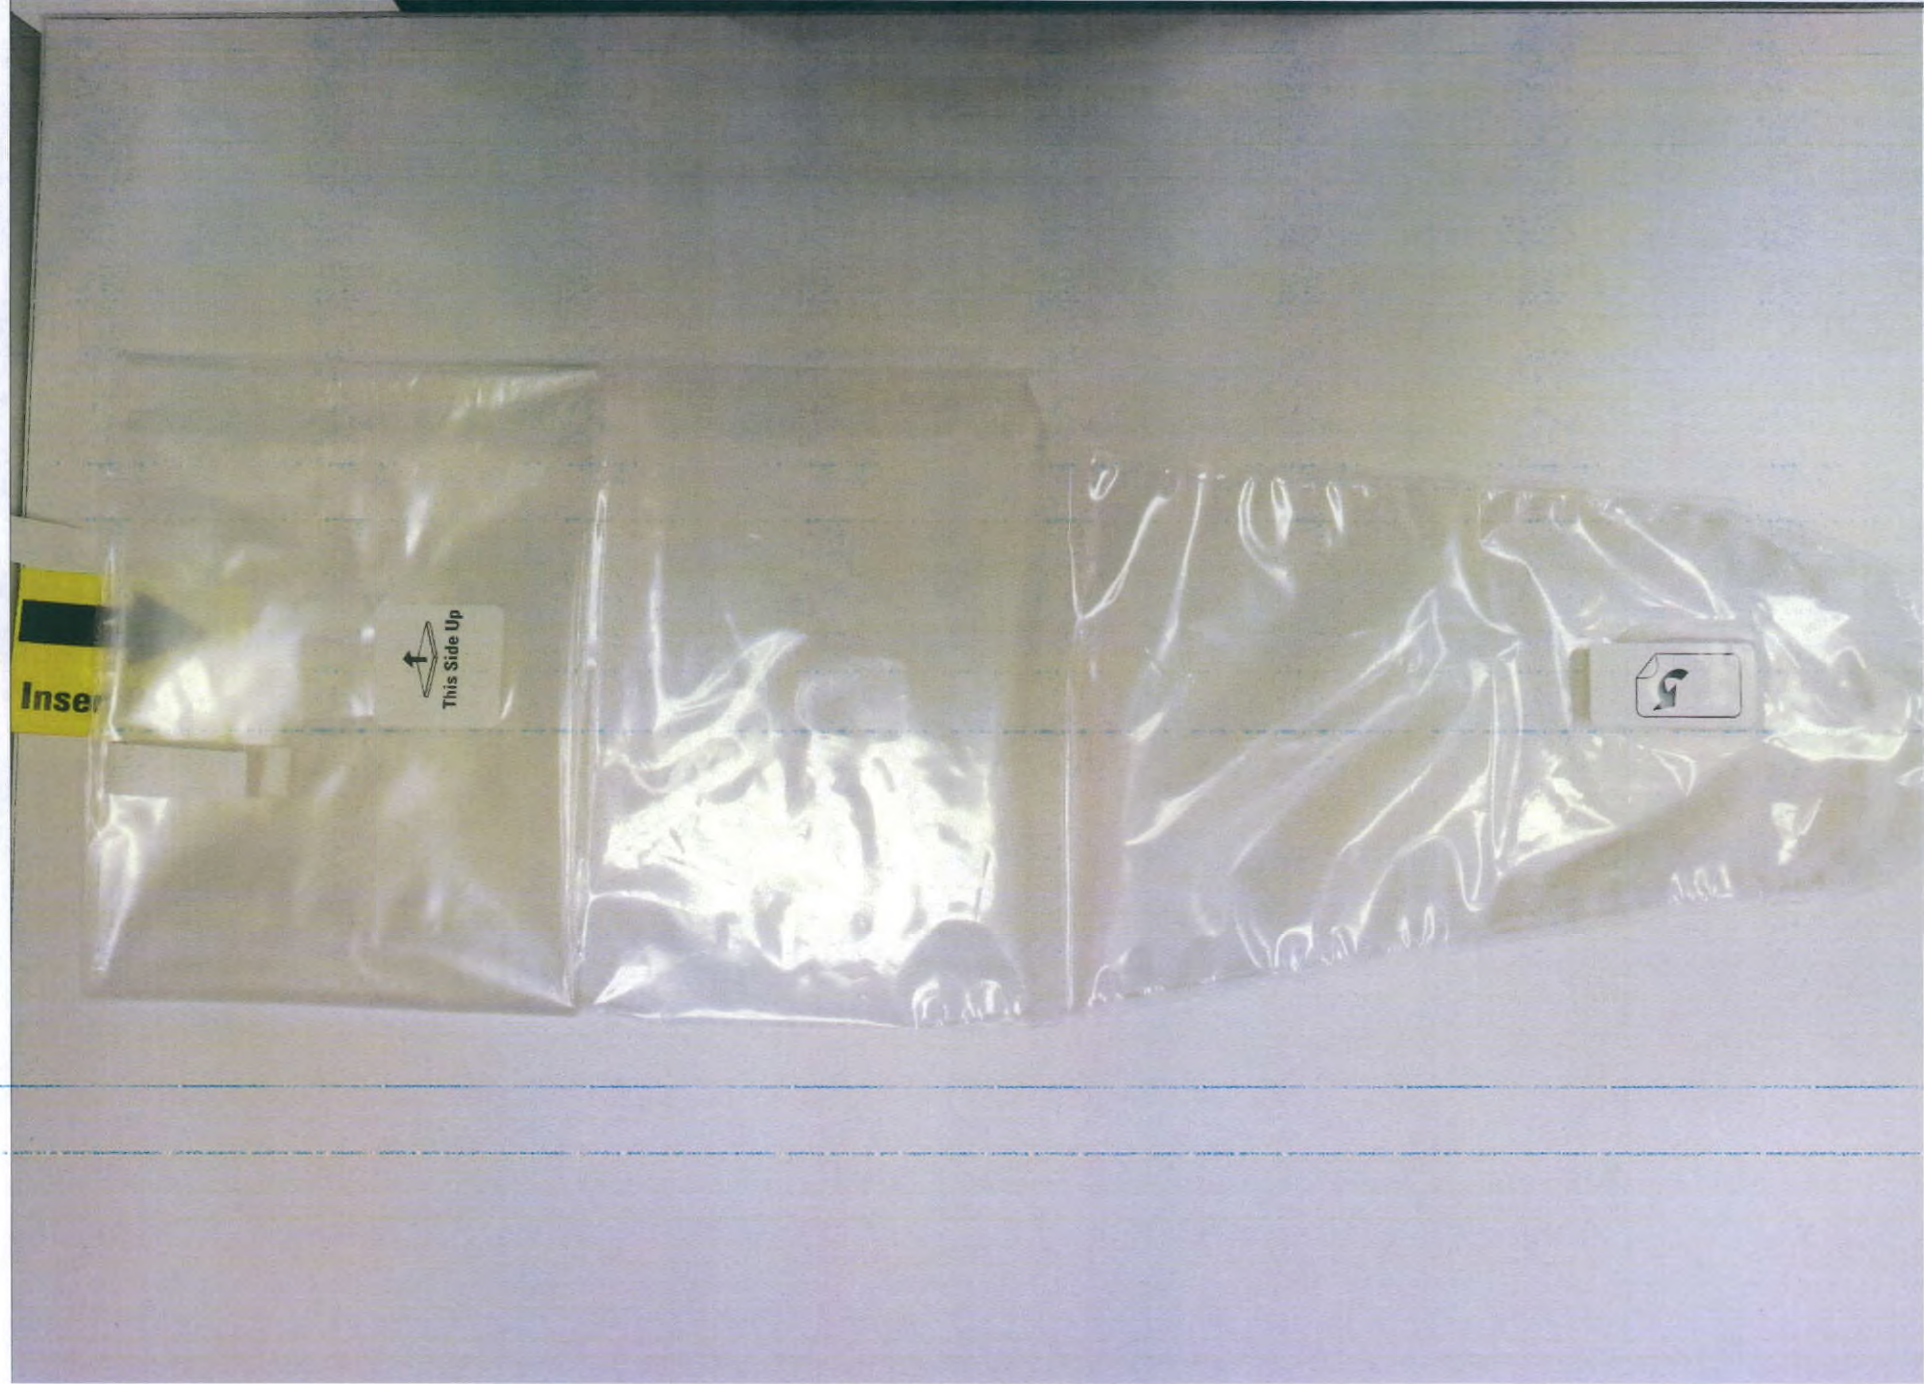


Пакет стерильный для блока электропривода MDU5 PLUS


Катетер для васкулярной визуализации OptiCross 35 15 МГц в индивидуальной упаковке, в составе

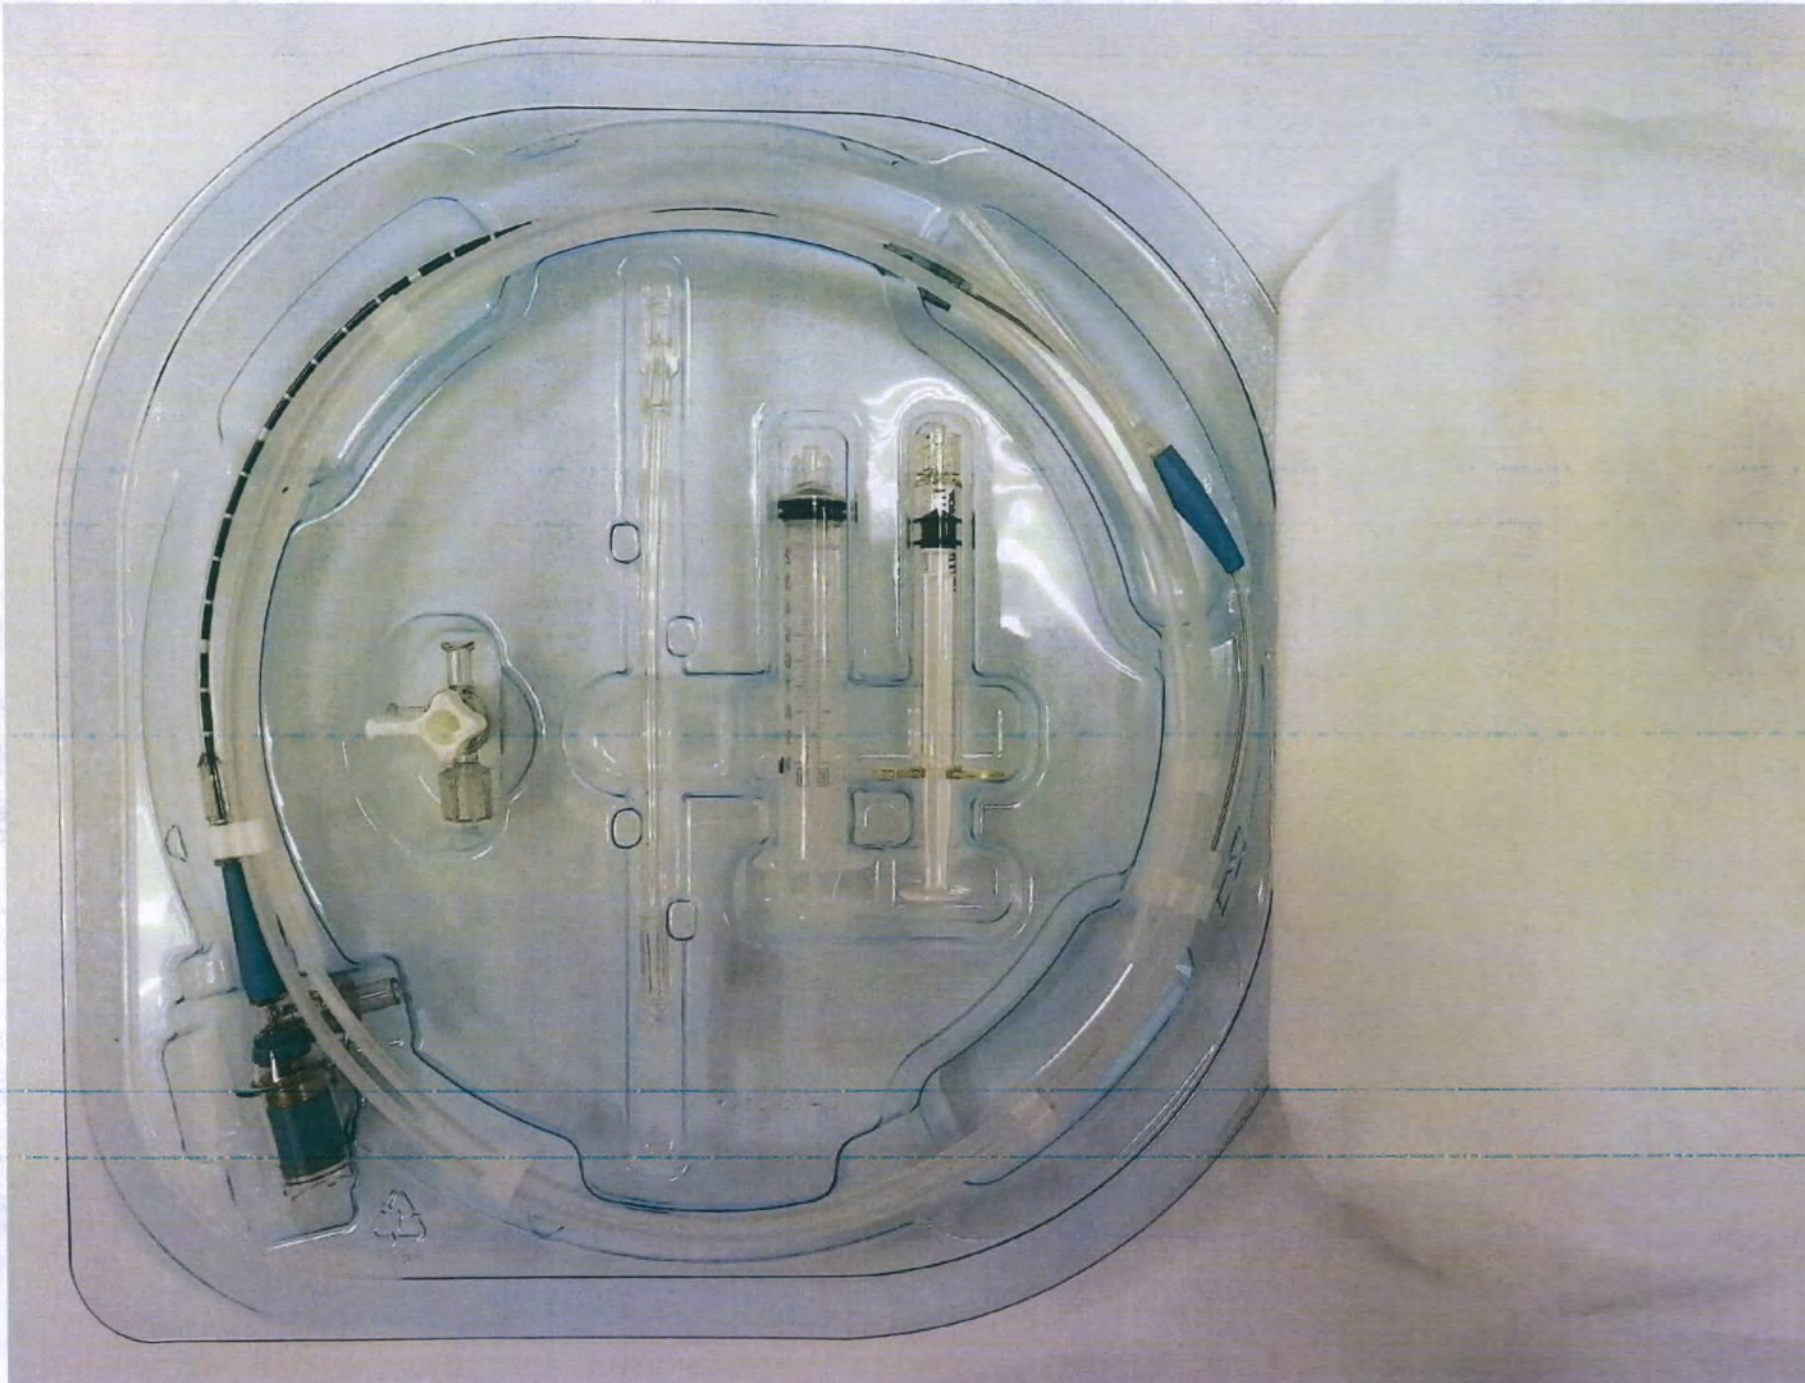


Общий вид катетера для васкулярной визуализации OptiCross 35 15 МГц в составе в индивидуальной упаковке (лотке)

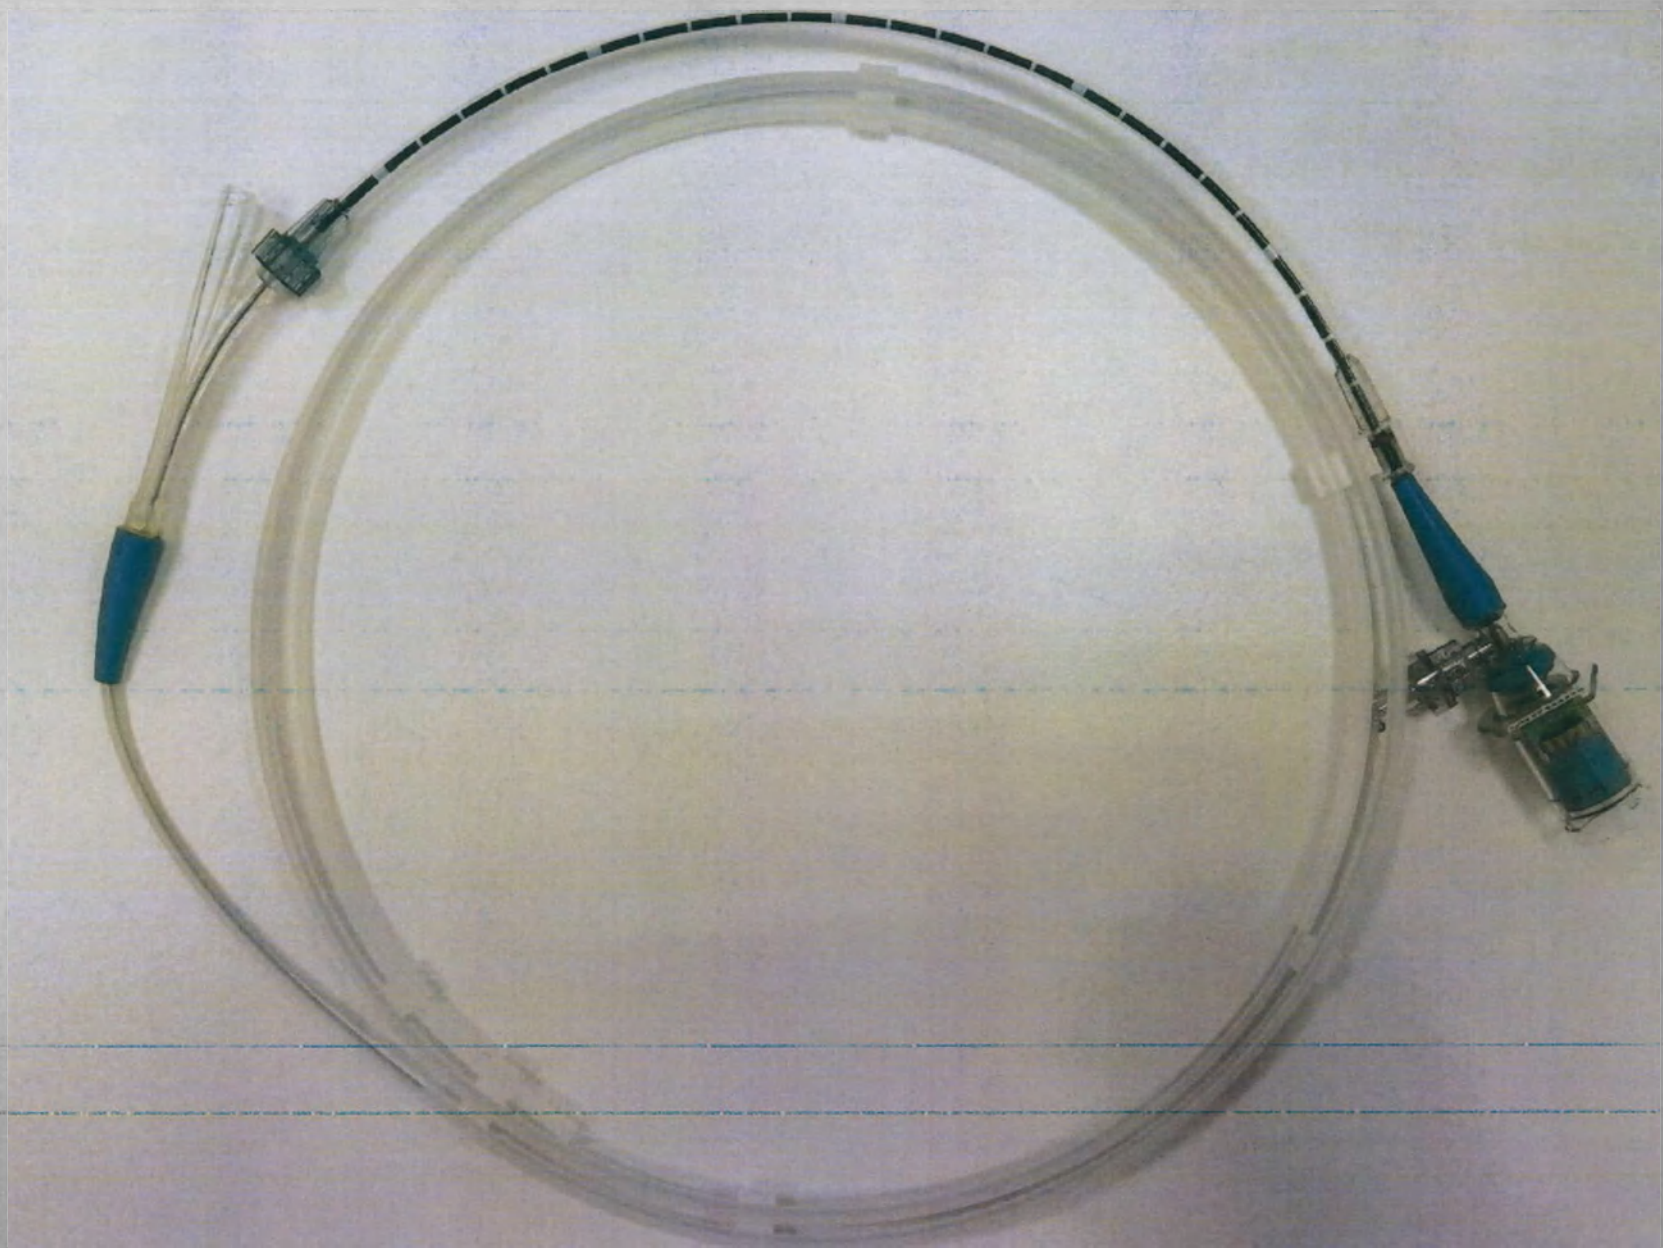


Общий вид катетера для васкулярной визуализации OptiCross 35 15 МГц в защитной трубке с зажимами

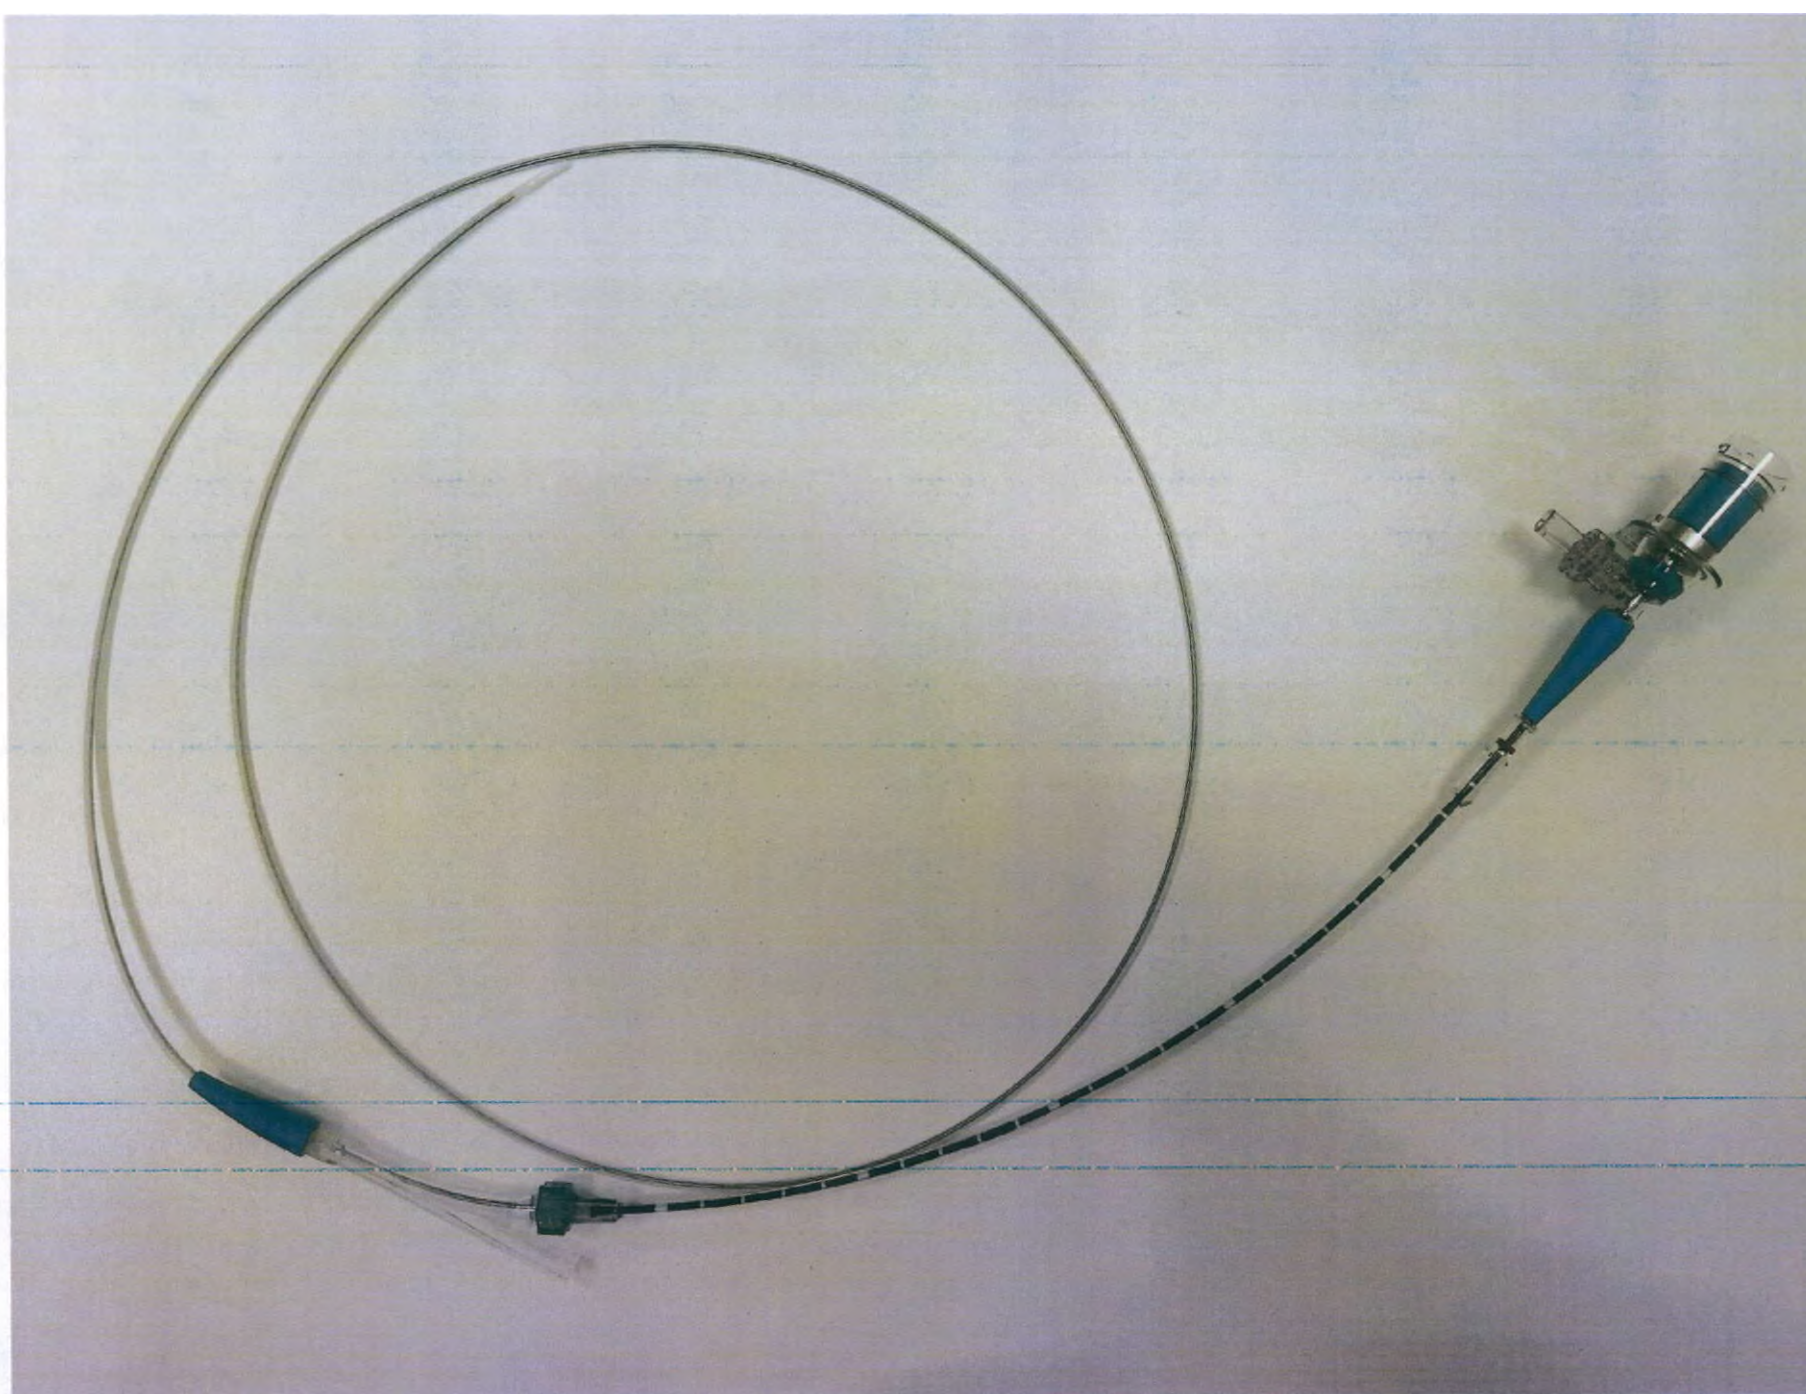


Катетер для васкулярной визуализации OptiCross 35 15 МГц

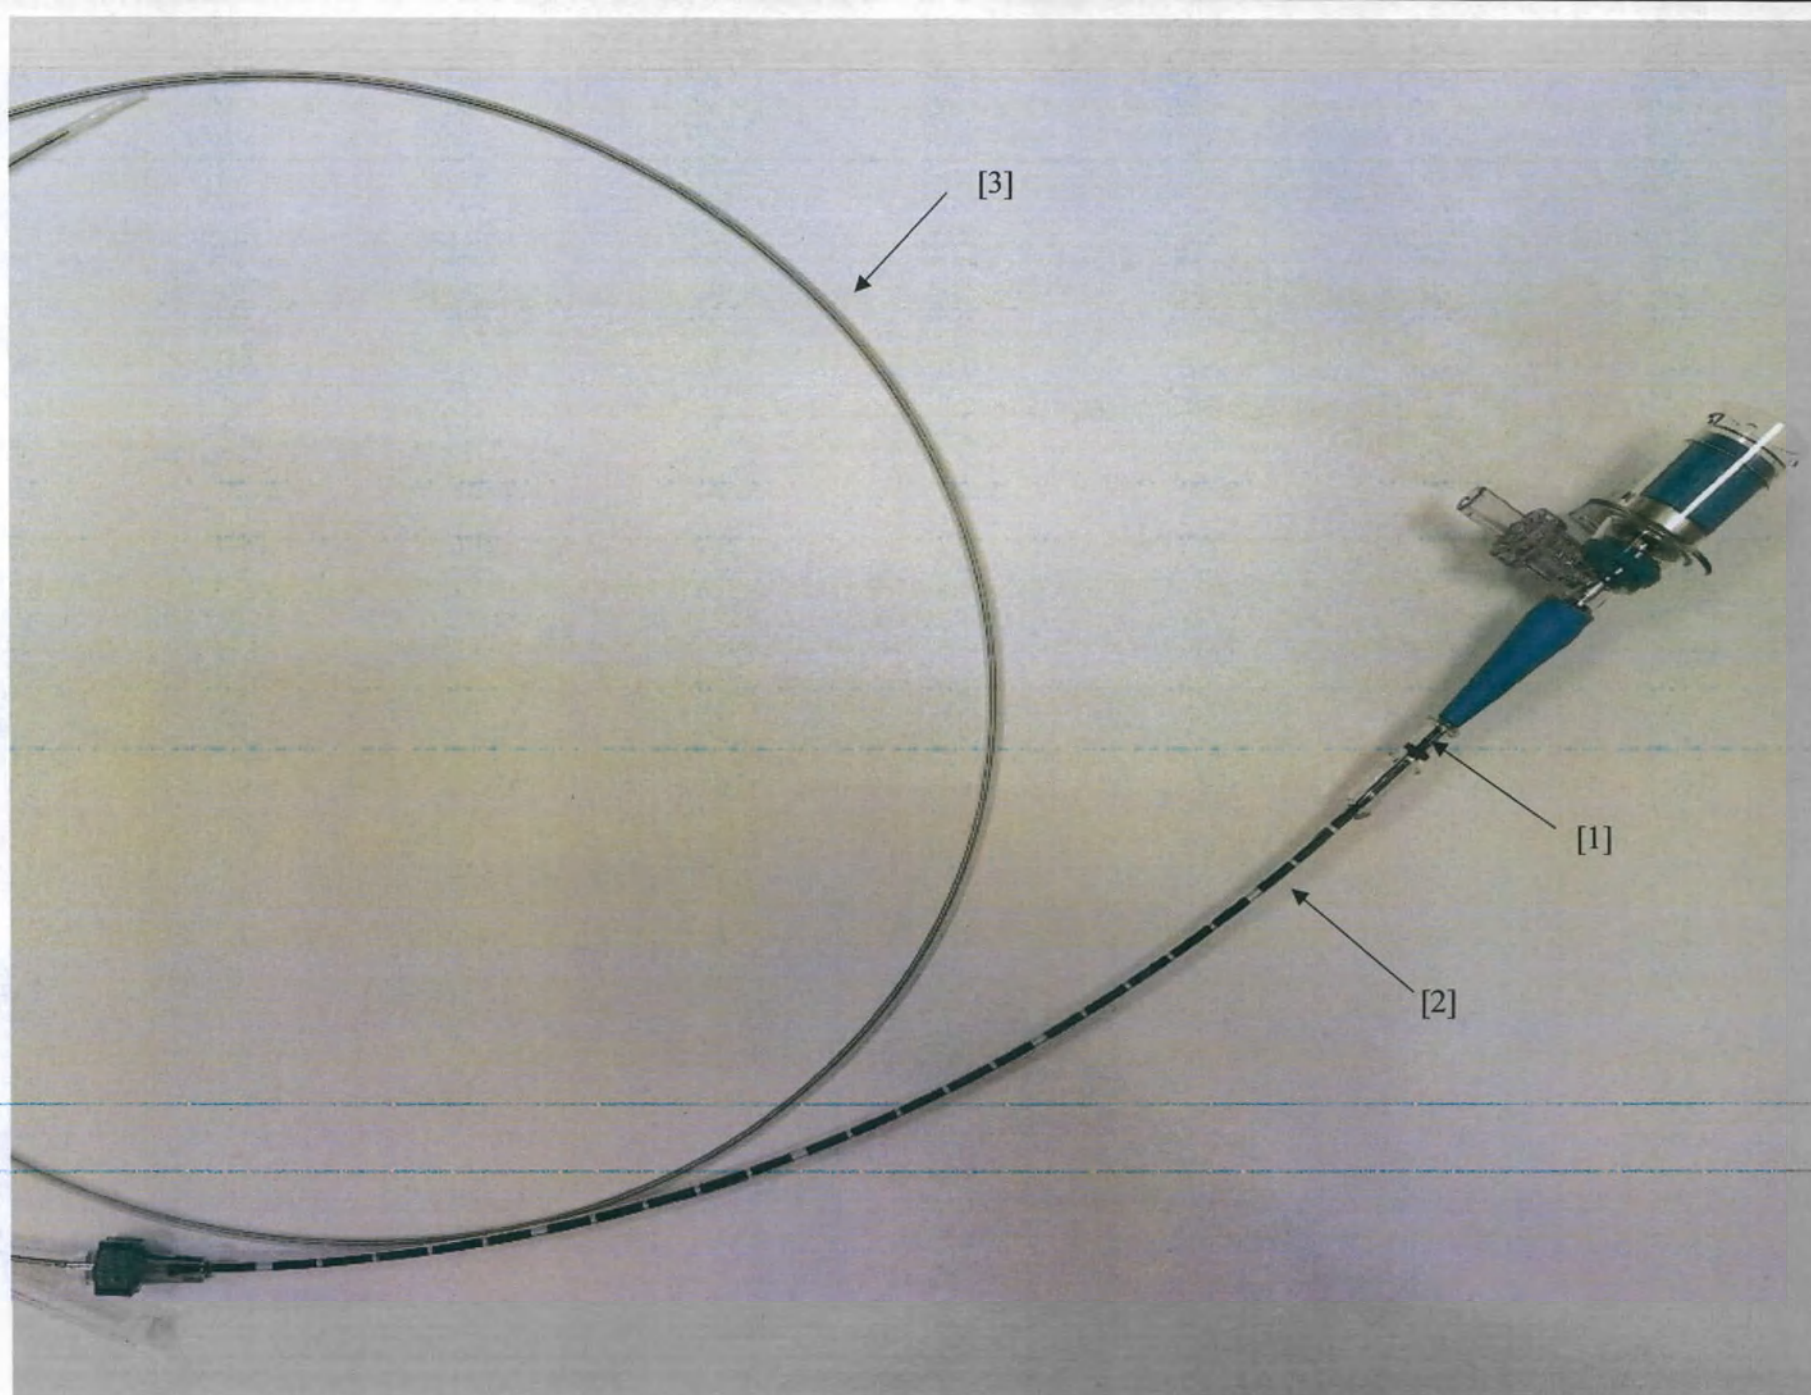


Внутренняя телескопическая трубка [1], наружная телескопическая трубка [2], трубка с просветом для проводника [3]

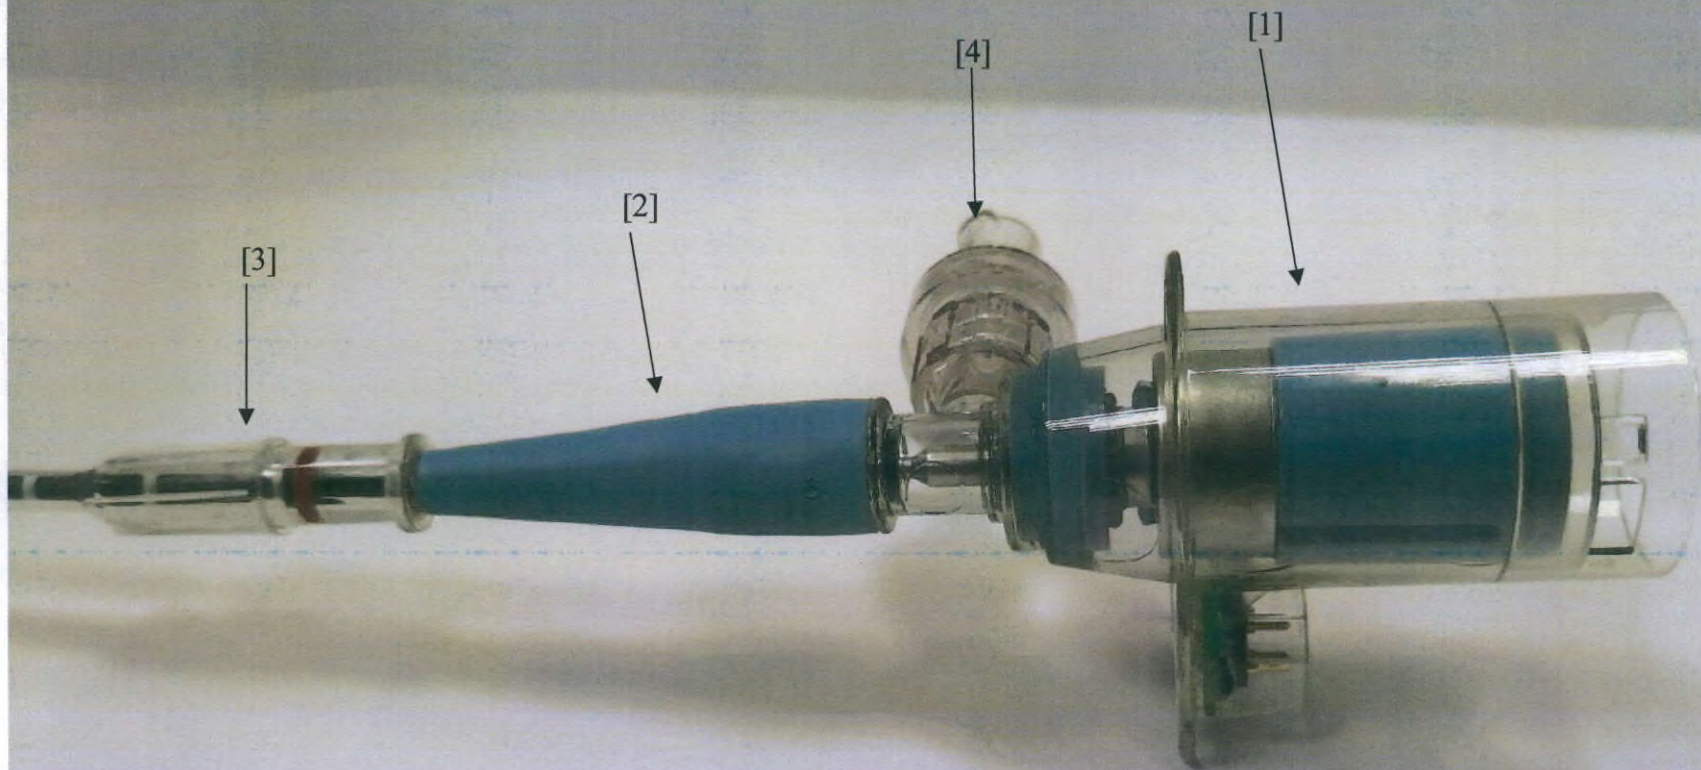


Хаб [1], проксимальная разгрузочная муфта [2], корпус анкерный [3], возвратный клапан [4]

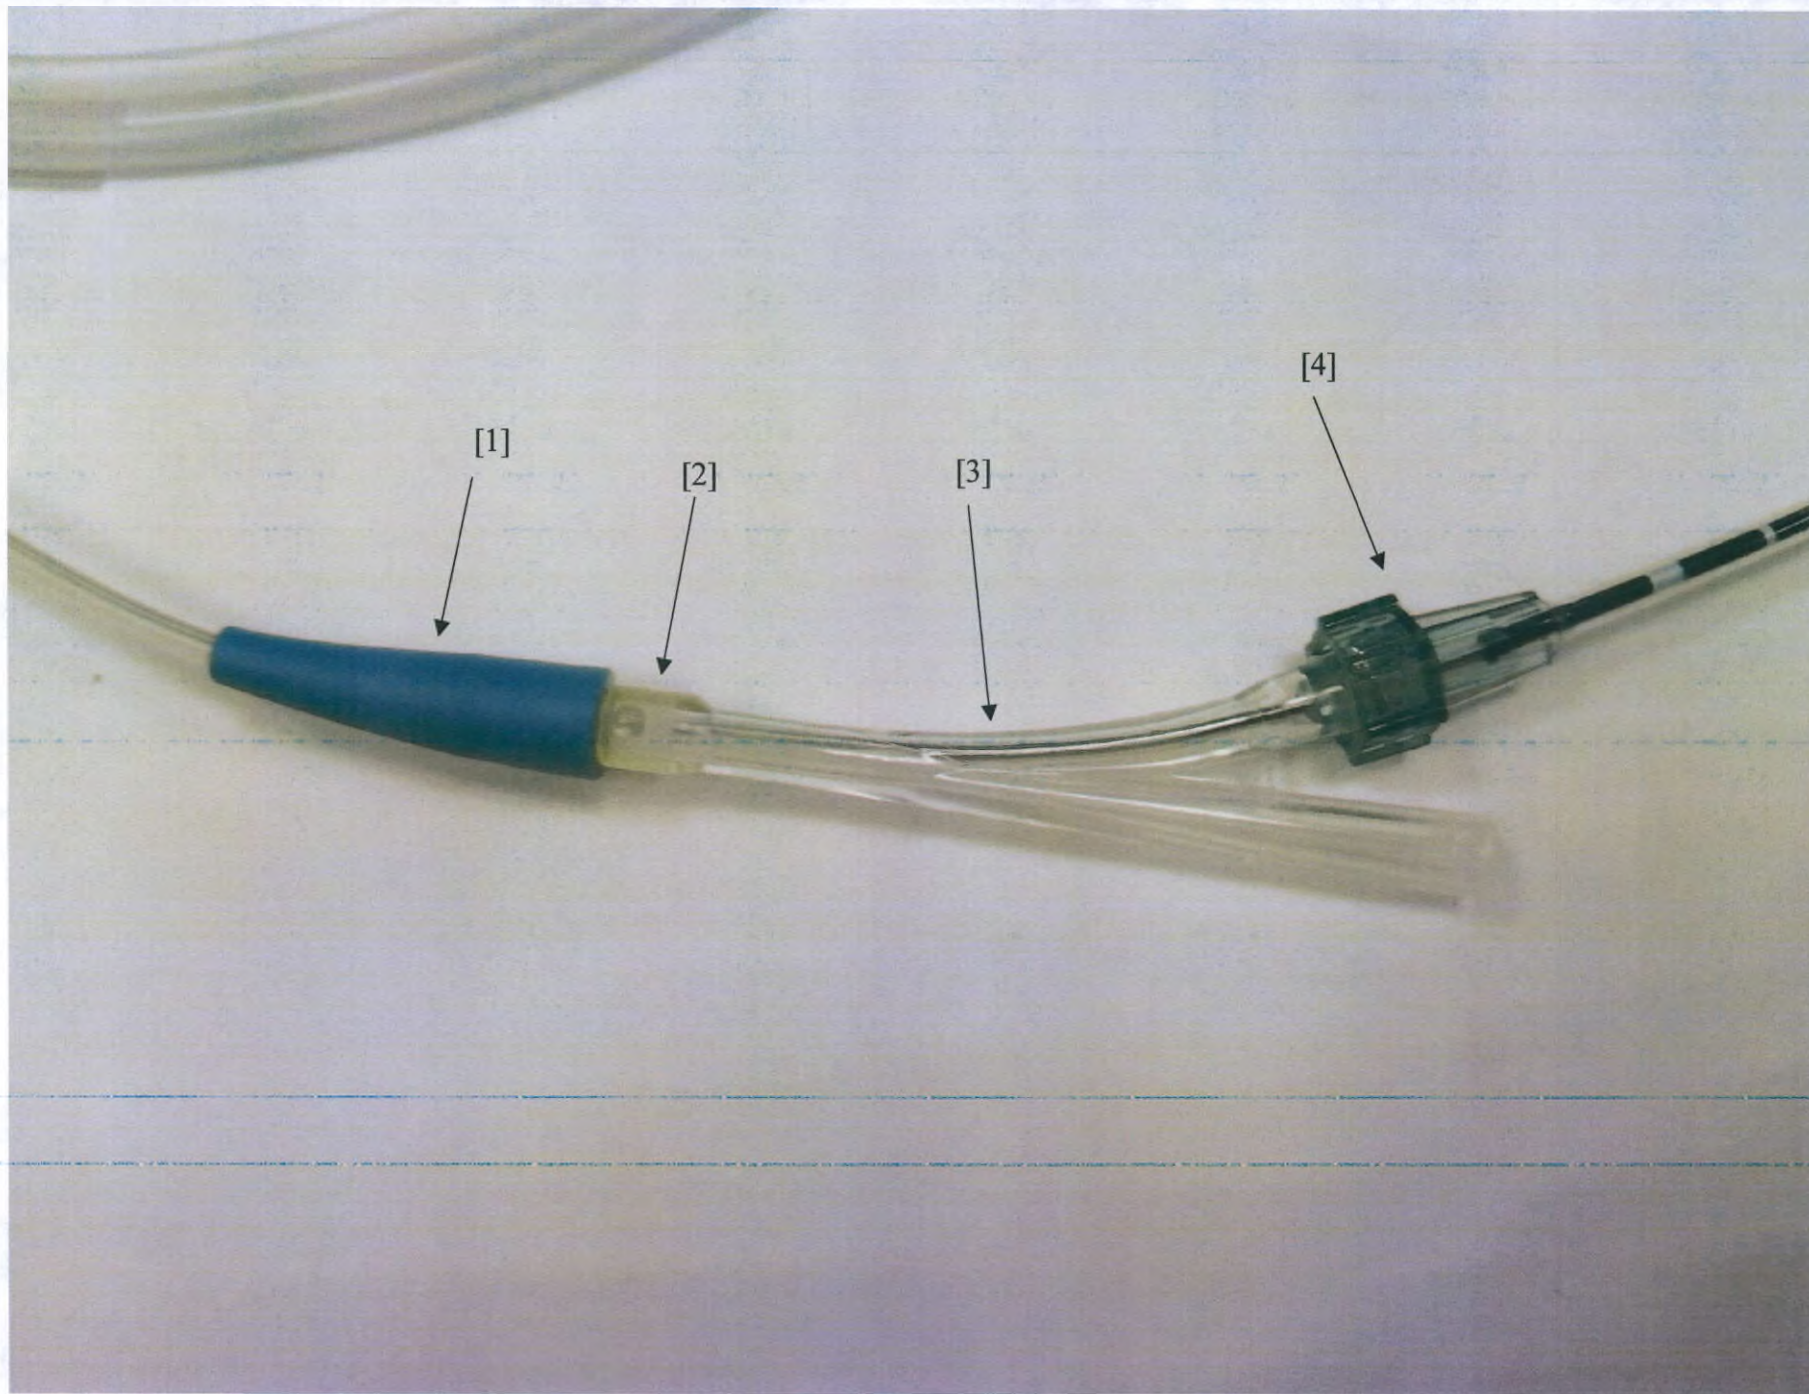


Дистальная разгрузочная муфта [1], держатель разгрузочной муфты [2], Y-образный коннектор [3] и разъем Люэра [4]

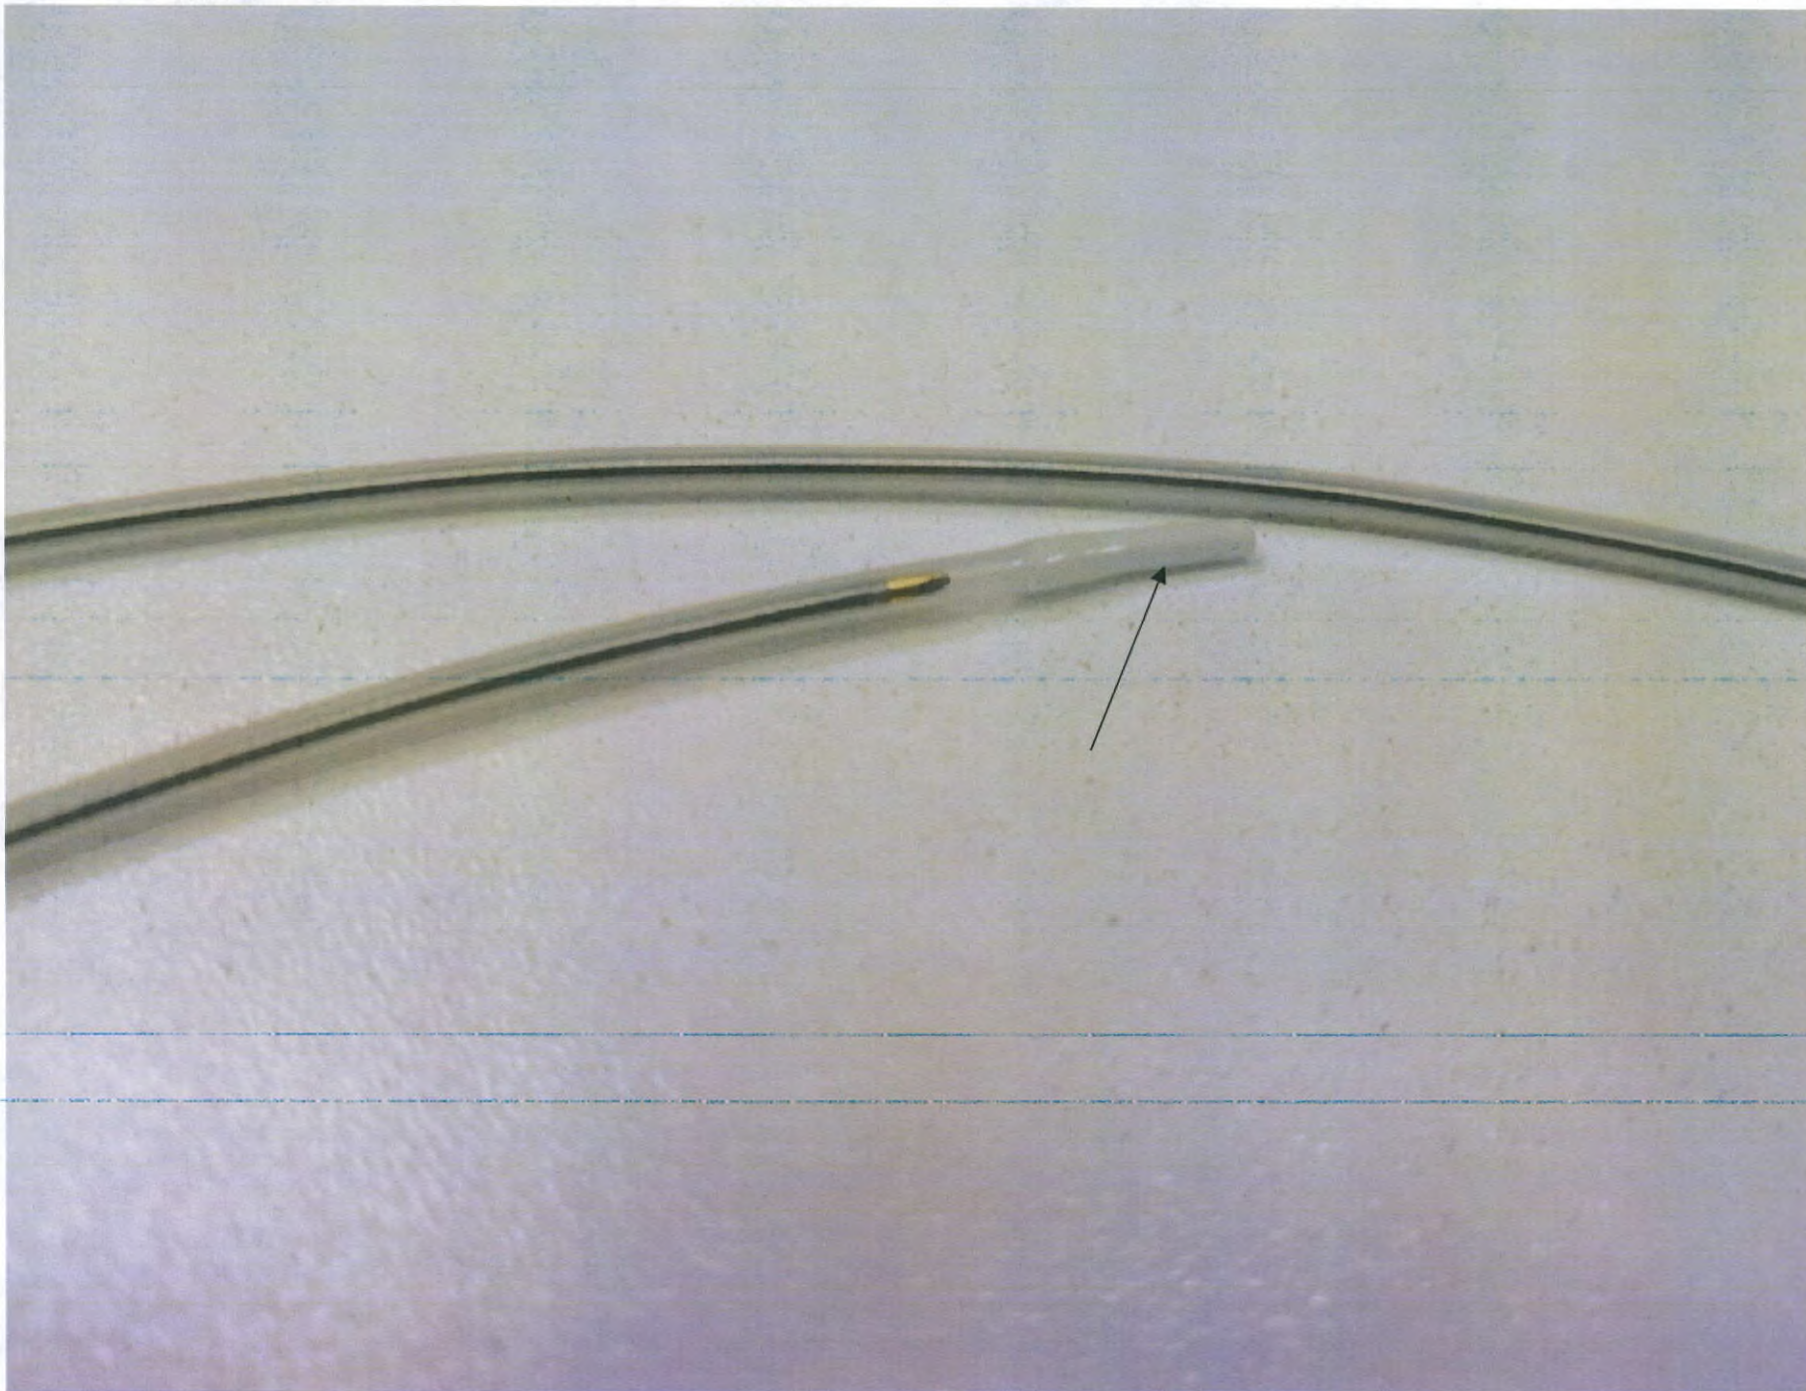

Дистальный кончик

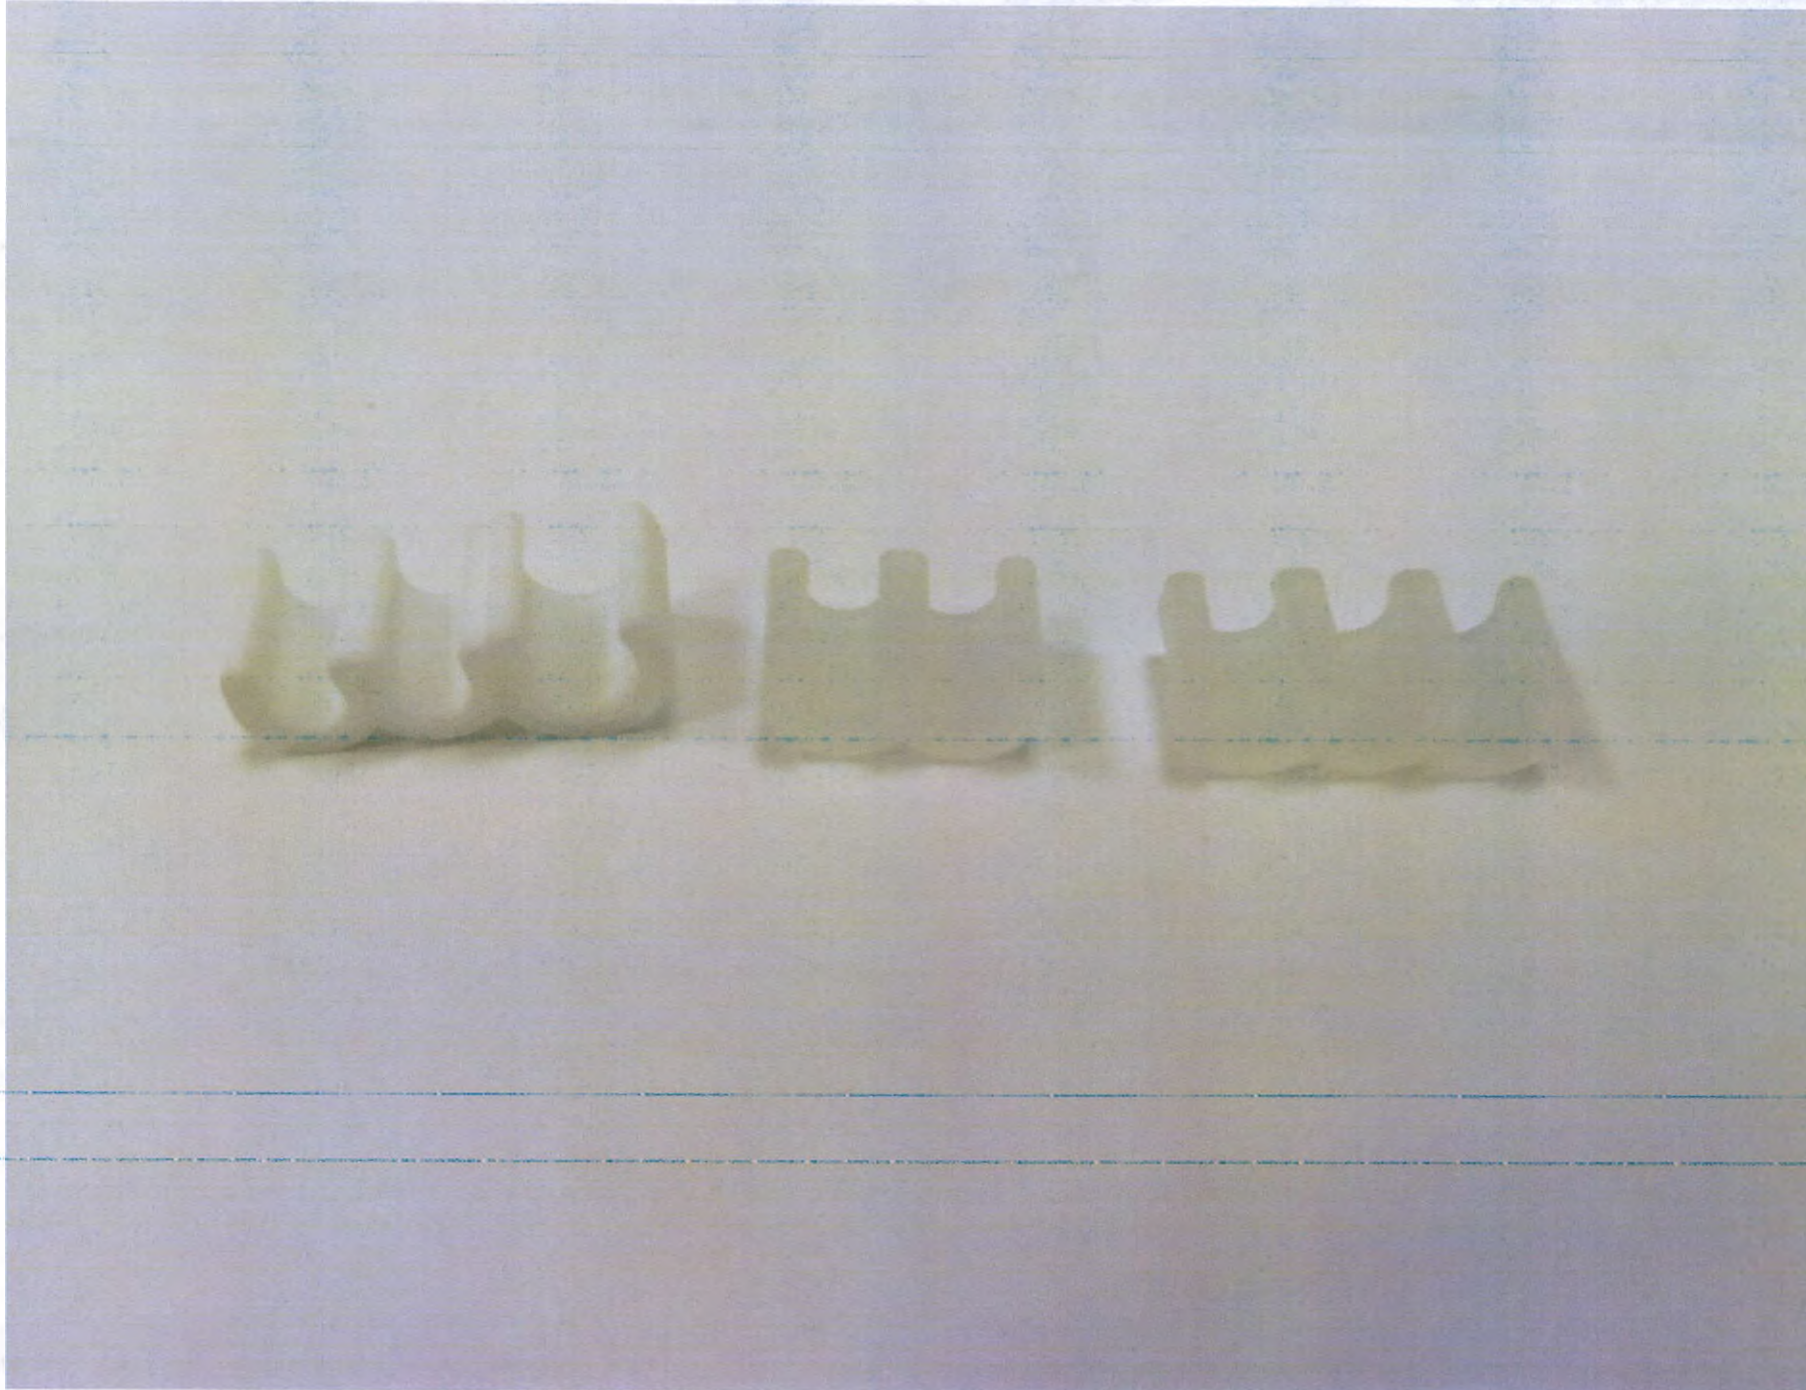

Зажимы для крепления защитной трубки

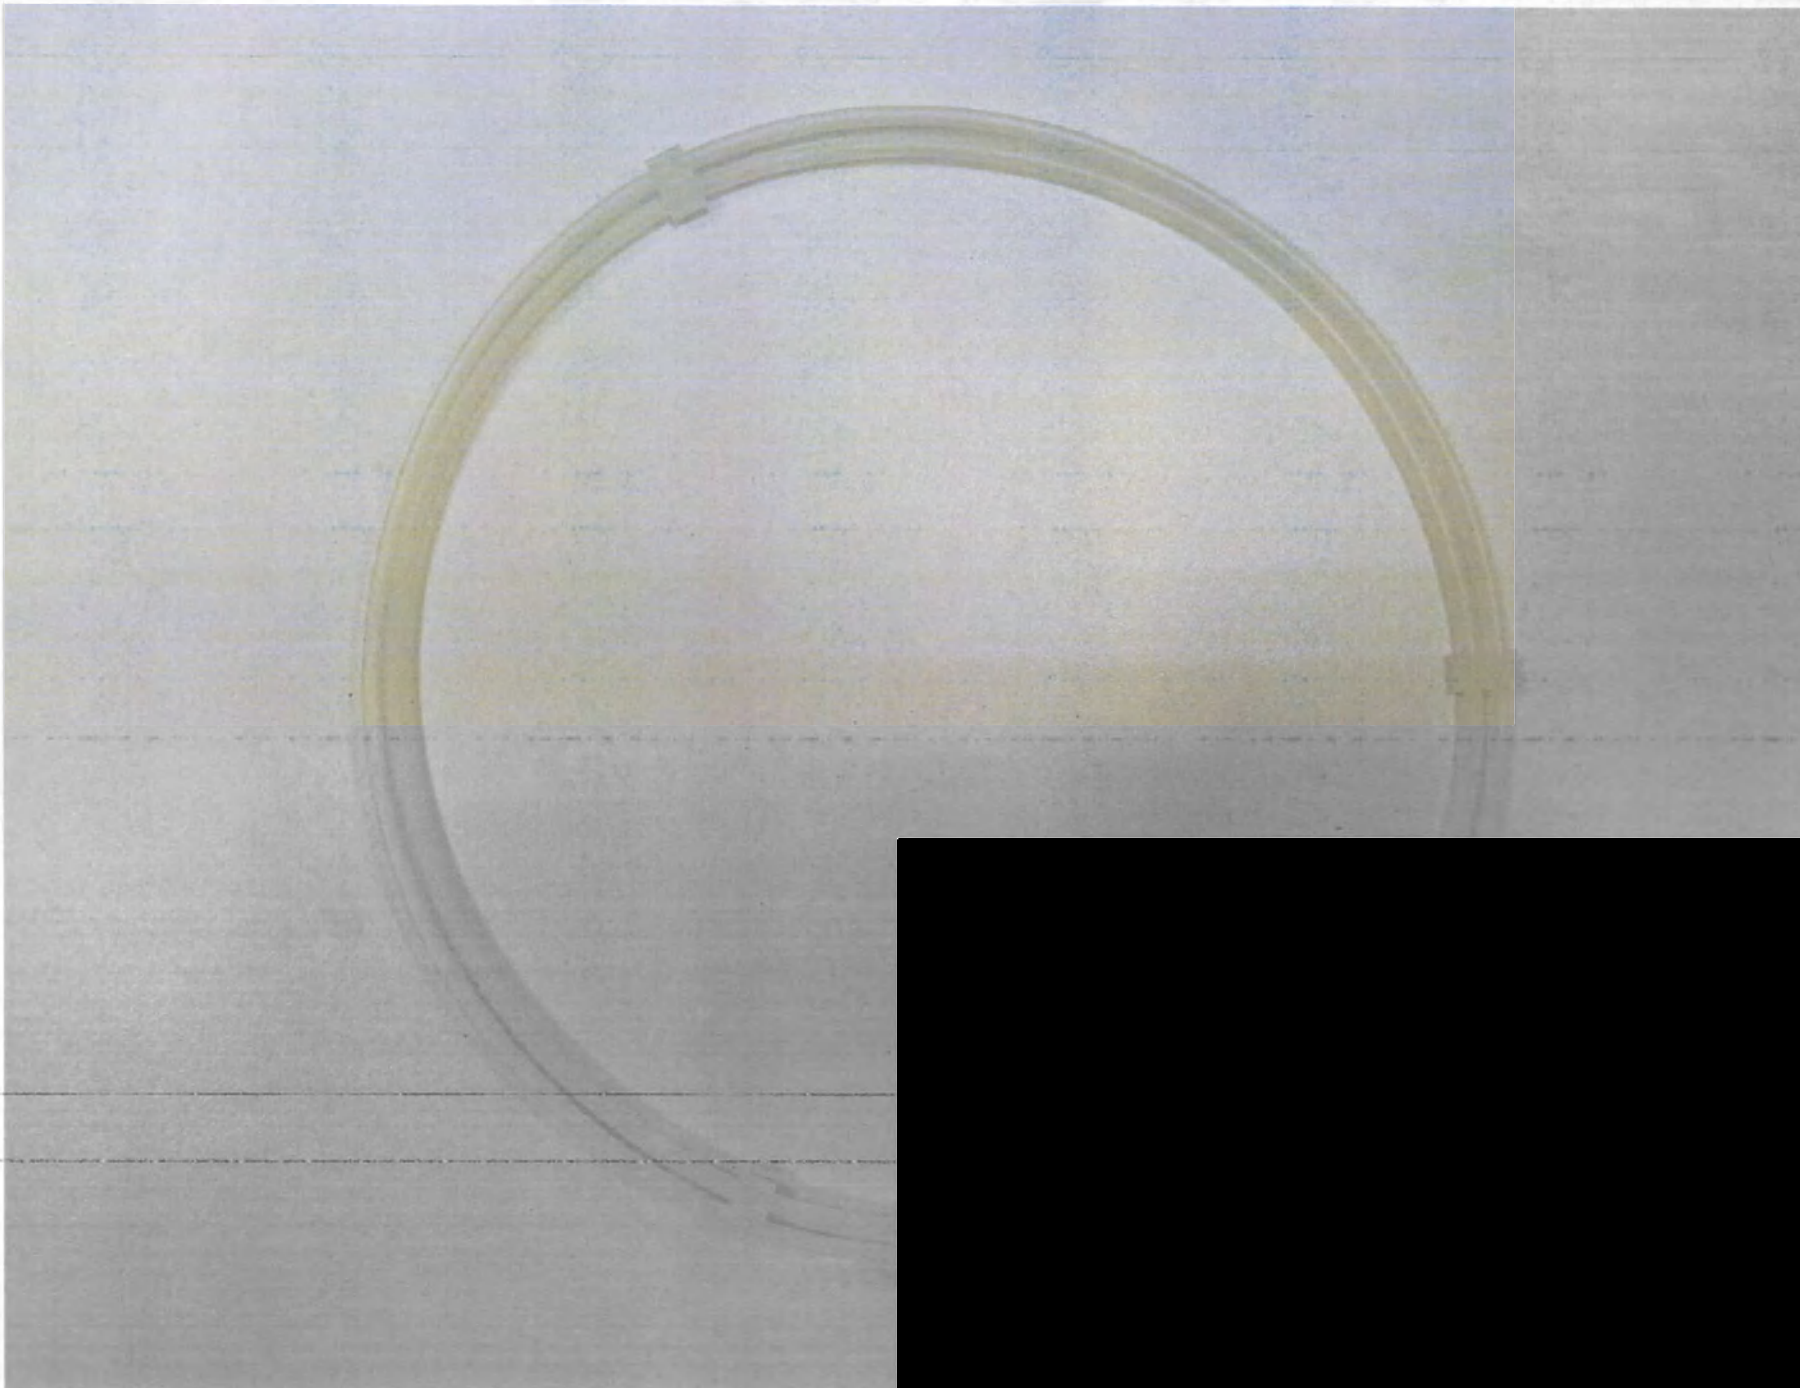

Защитная трубка с зажимами

Boston
Scientific


OptiCross™ 35

15 MHz

Peripheral Imaging Catheter

Directions for Use	2
Instrucciones de uso	9
Mode d'emploi	17
Gebrauchsanweisung	25
Istruzioni per l'uso	33
Gebruiksaanwijzing	41
Instruções de Utilização	49

Инструкция по применению

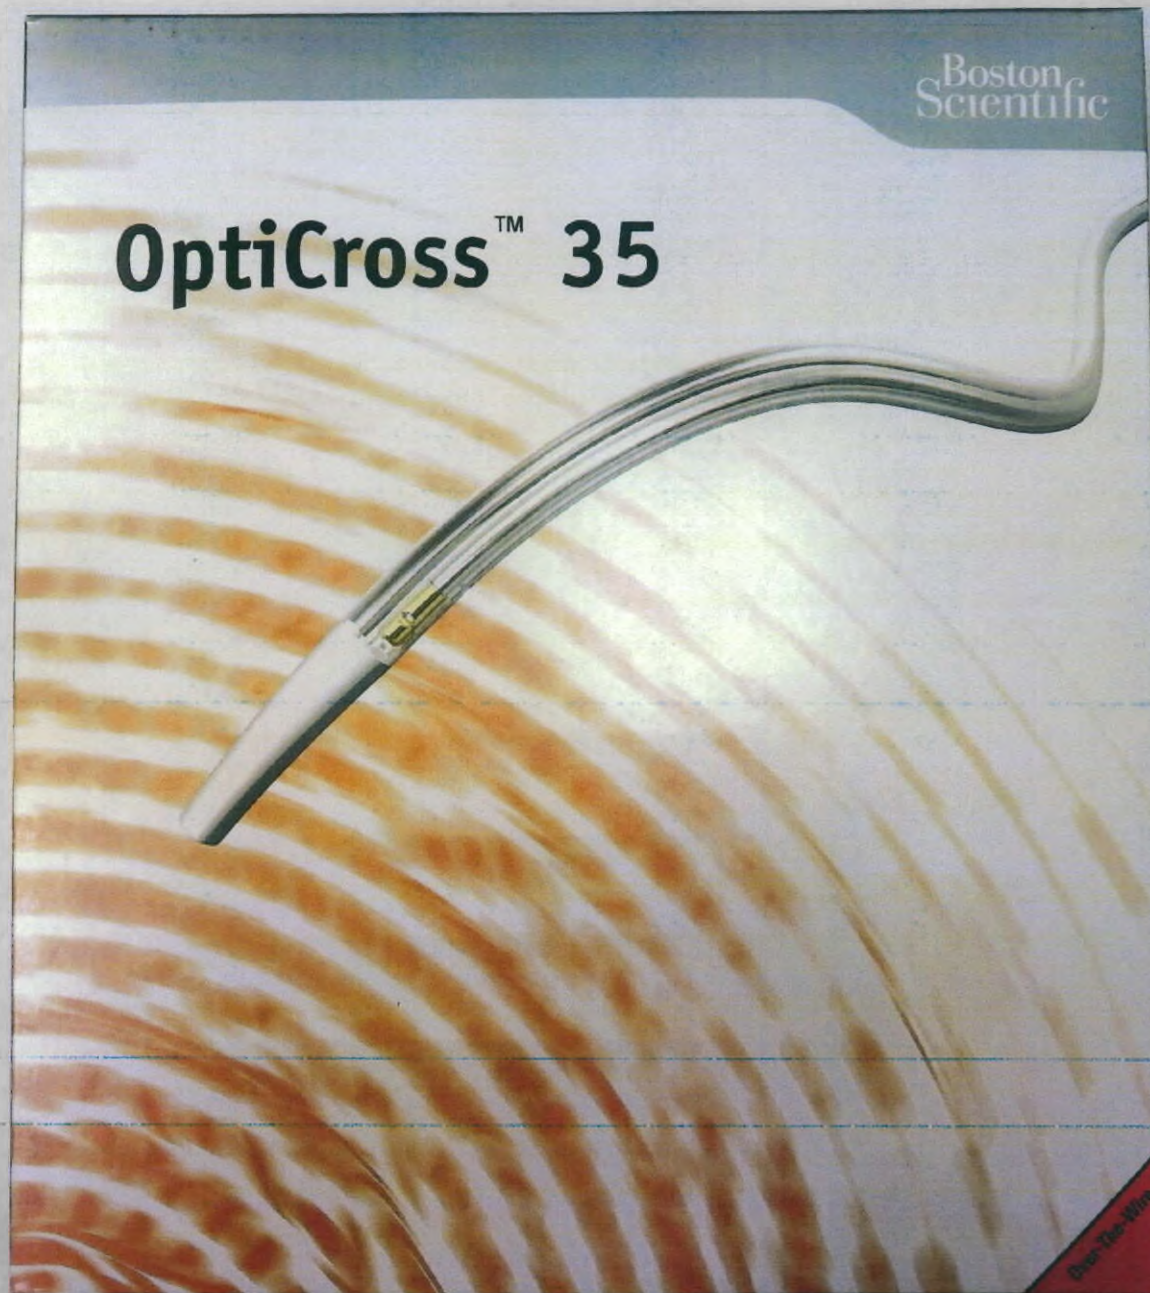

Картонная коробка (вид спереди)



② For single use only.
Do not reuse.

 Do Not Sterilize

 Consult instructions for use.

 Do not use if package is damaged.

CC	REP	EU Authorized Representative
----	-----	------------------------------

Boston Scientific Limited
Ballynaburn Park
Galway
IRELAND

 Legal Manufacturer

Boston Scientific Corporation
200 Boston Scientific Place
Boston, MA 02116

USA
USA Customer Service 800-377

8r
(2.74 mm)
x105

OptiCross™ 35

15 MHz

Peripheral Imaging Catheter

Citléri vyznával pohanstvo. Citléri domagali práva na vlastnú katedru, ktorá by bola "všetkým národov".
 Pohanstvo vyznávali citléri. Citléri vyznávali pohanstvo. Citléri vyznávali pohanstvo. Citléri vyznávali pohanstvo.
 Pohanstvo vyznávali citléri. Pohanstvo vyznávali citléri. Pohanstvo vyznávali citléri. Pohanstvo vyznávali citléri.
 Citléri vyznávali pohanstvo. Citléri vyznávali pohanstvo. Citléri vyznávali pohanstvo. Citléri vyznávali pohanstvo.

☒ Comments (1)



0.035in (0.89mm)
Minimum Fillet Radius R2

8F (2.67mm)

© (2) Infotrac Services

© (1) Identification System: *Not applicable*

Includes
Spanish

Section 101
(1) Driving School

GTIN 08714729997153

LOT 29320764

REF Catalog No. H7493932801350

Use By 2023-05-19



1-800-441-5444
 1-800-441-5444
 1-800-441-5444



800-368-2267
 1-800-368-2267
 1-800-368-2267
 1-800-368-2267

Internal SEC Reg. Letter
09-06-08 A.D.

Boomer 5000000
5000000
5000000

[illegible]

CE 0344

Made in COSTA RICA

2548 First Street

Property

El Ceyol, Nájuala COSTA RICA

Syringes, Extension Tubing and Stopcocks
Manufactured in USA


MDIS PLUS™ Sterile Bag
Manufactured in Connelton, South Dakota

This product may be protected by one or more patents. Patient information can be obtained at <http://www.bayerusa.com/inf/inf00000001.htm>

STEP 4	8	Standard error loadings
--------	---	----------------------------

Over-The-Wire

 ООО ЦИПМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

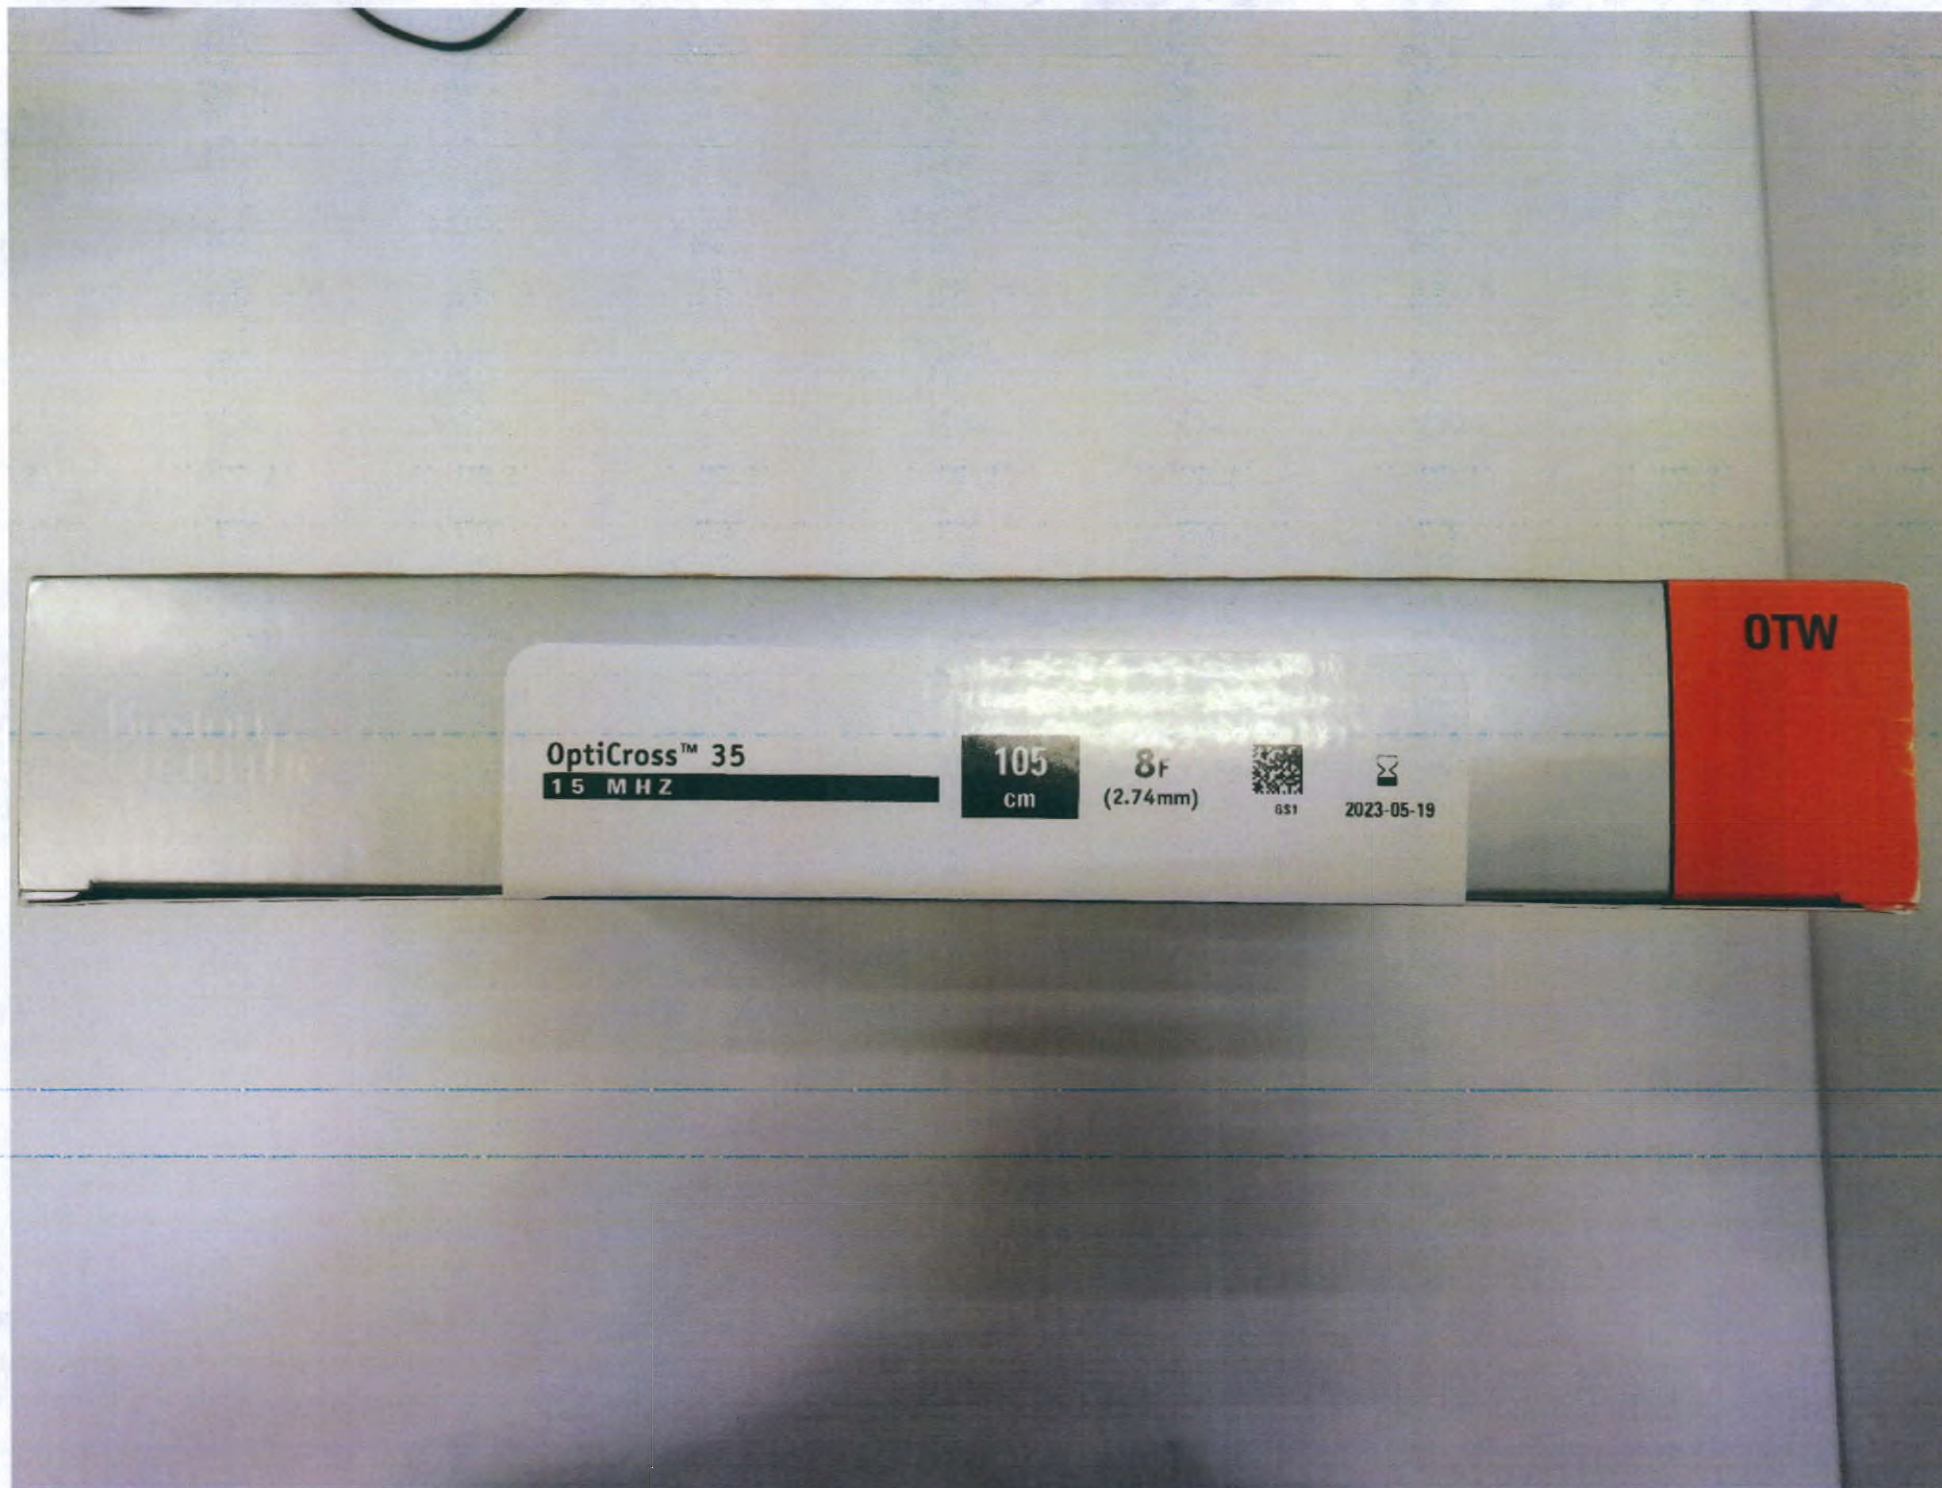

OptiCross™ 35
15 MHz


105
cm

8F
(2.74mm)




2023-05-19

OTW

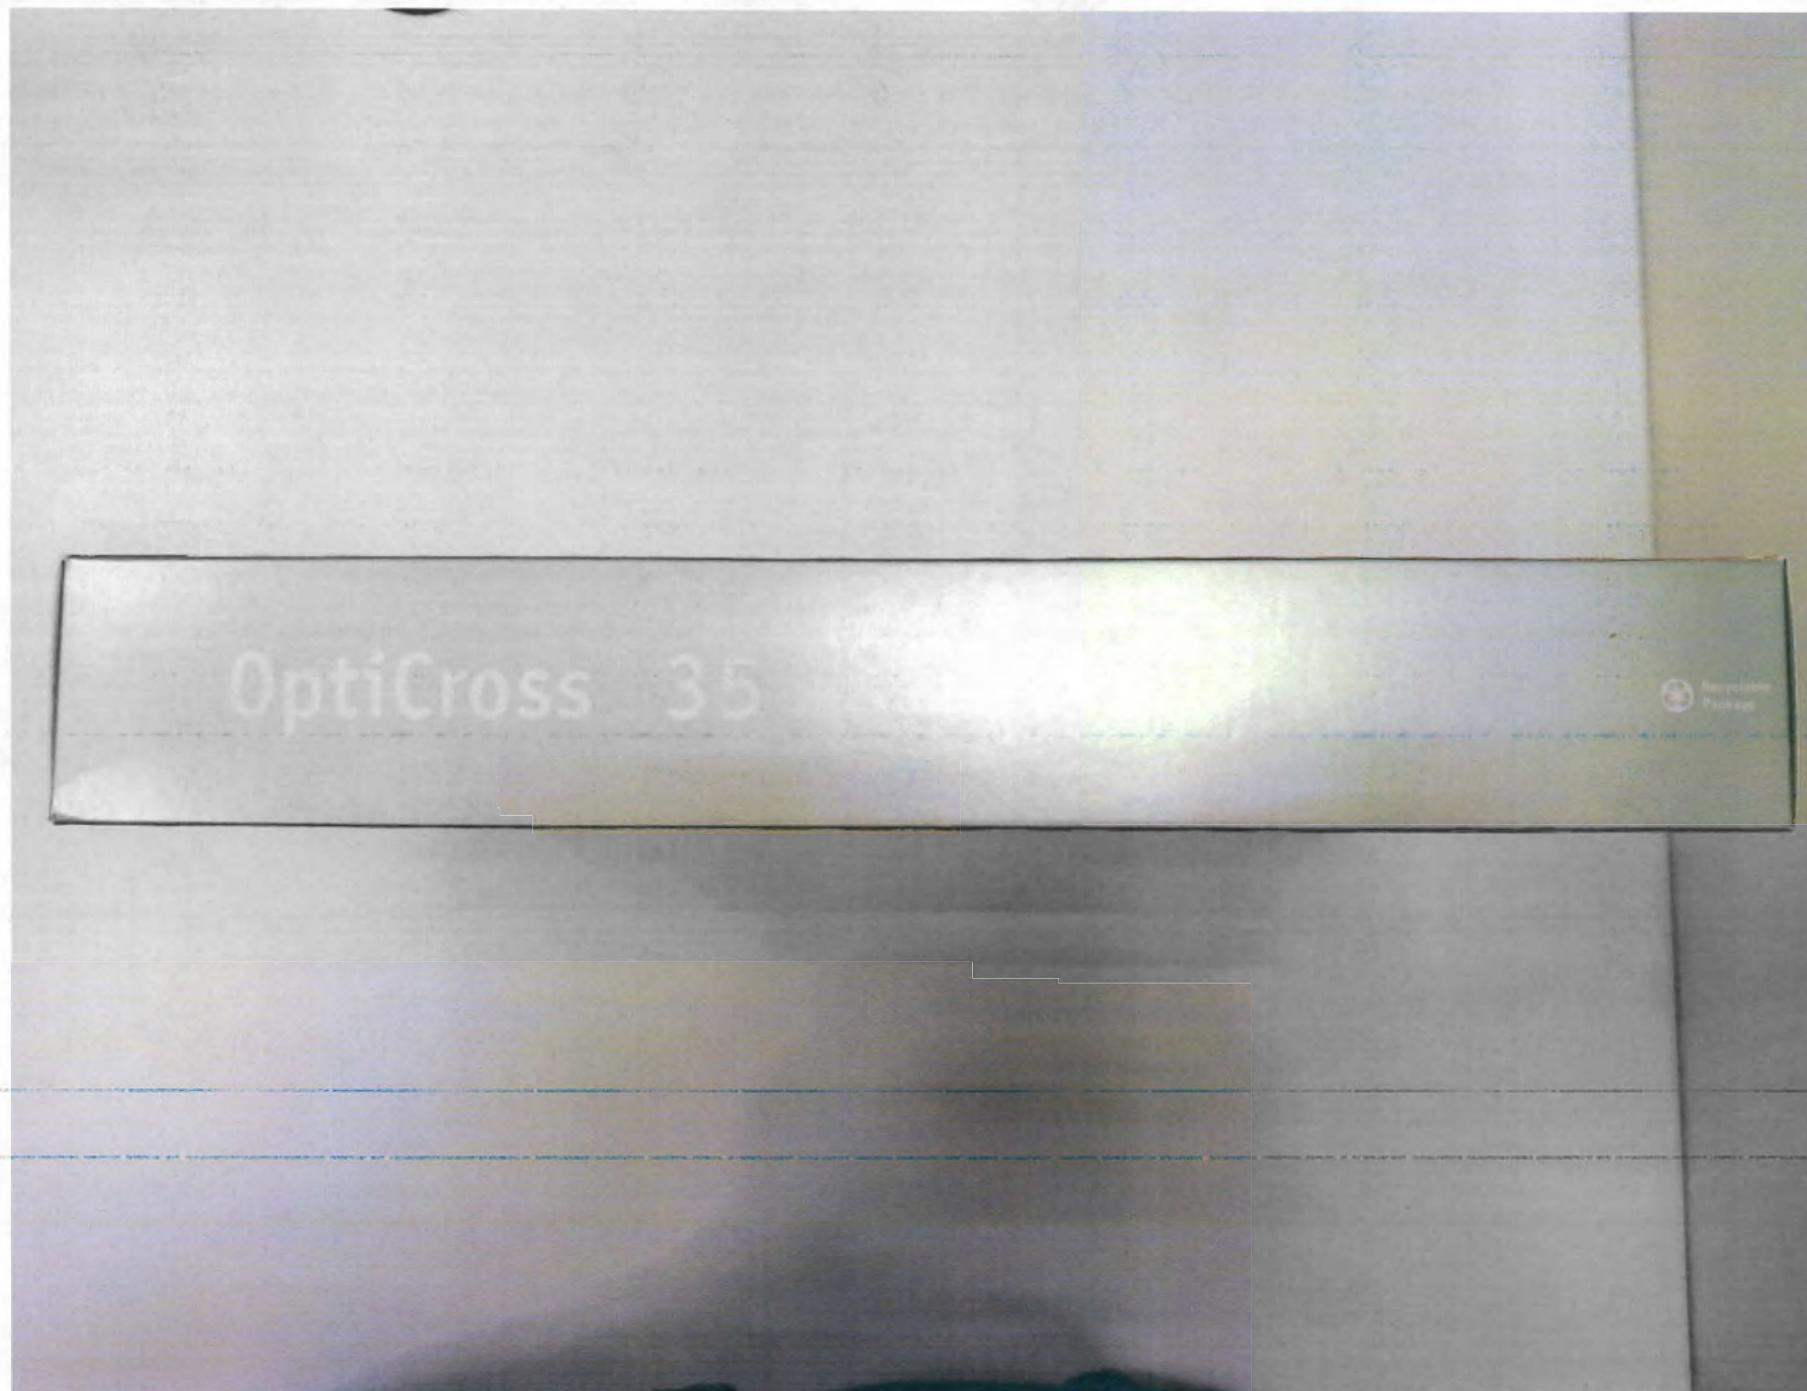



Картонная коробка (вид слева)

Шприц 3 мл

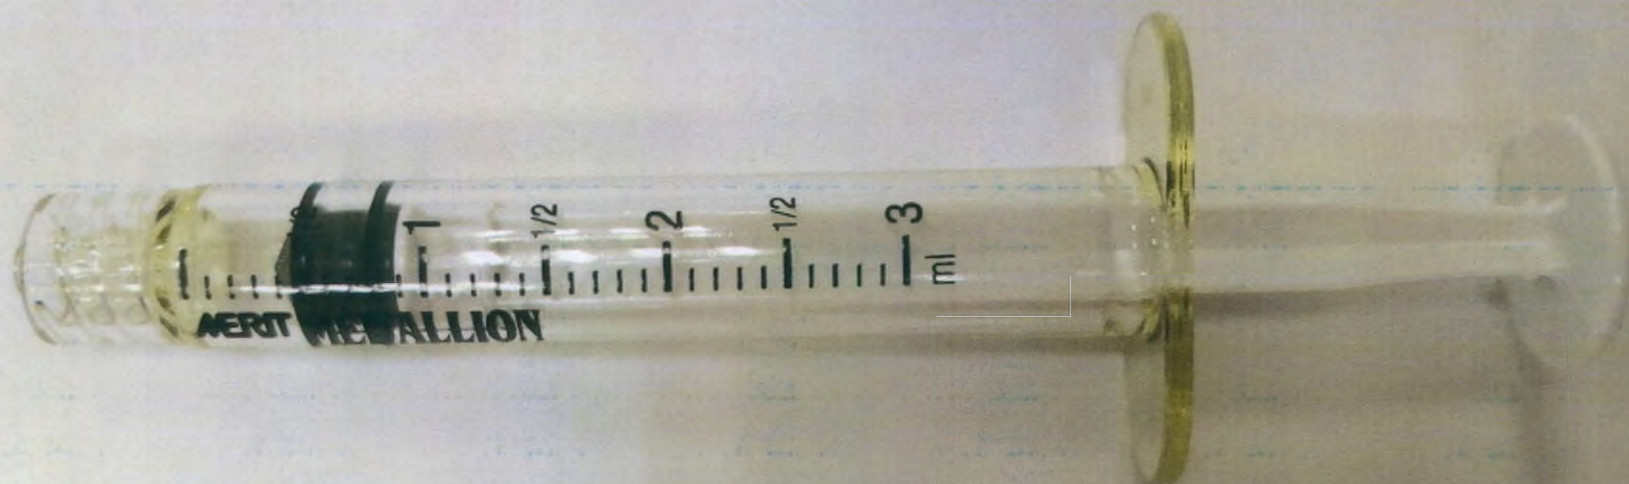


Шприц 10 мл

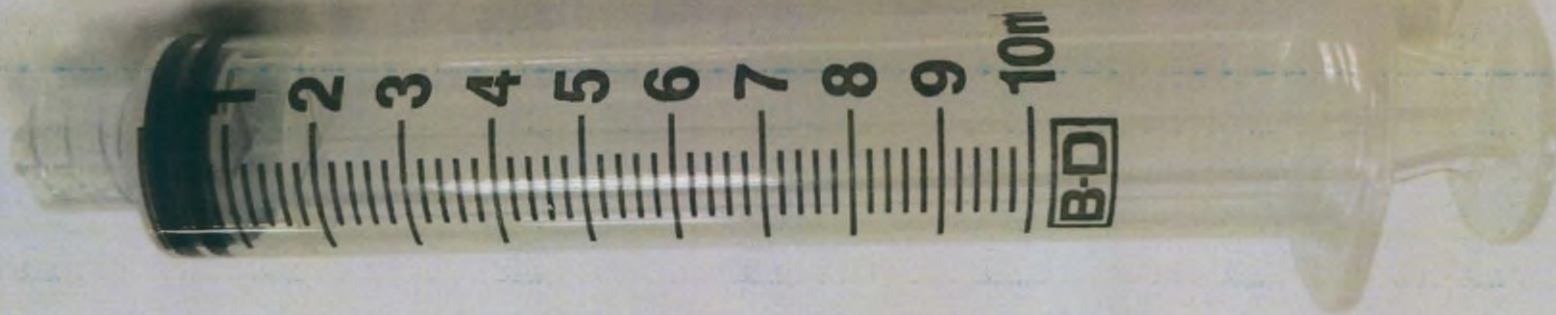


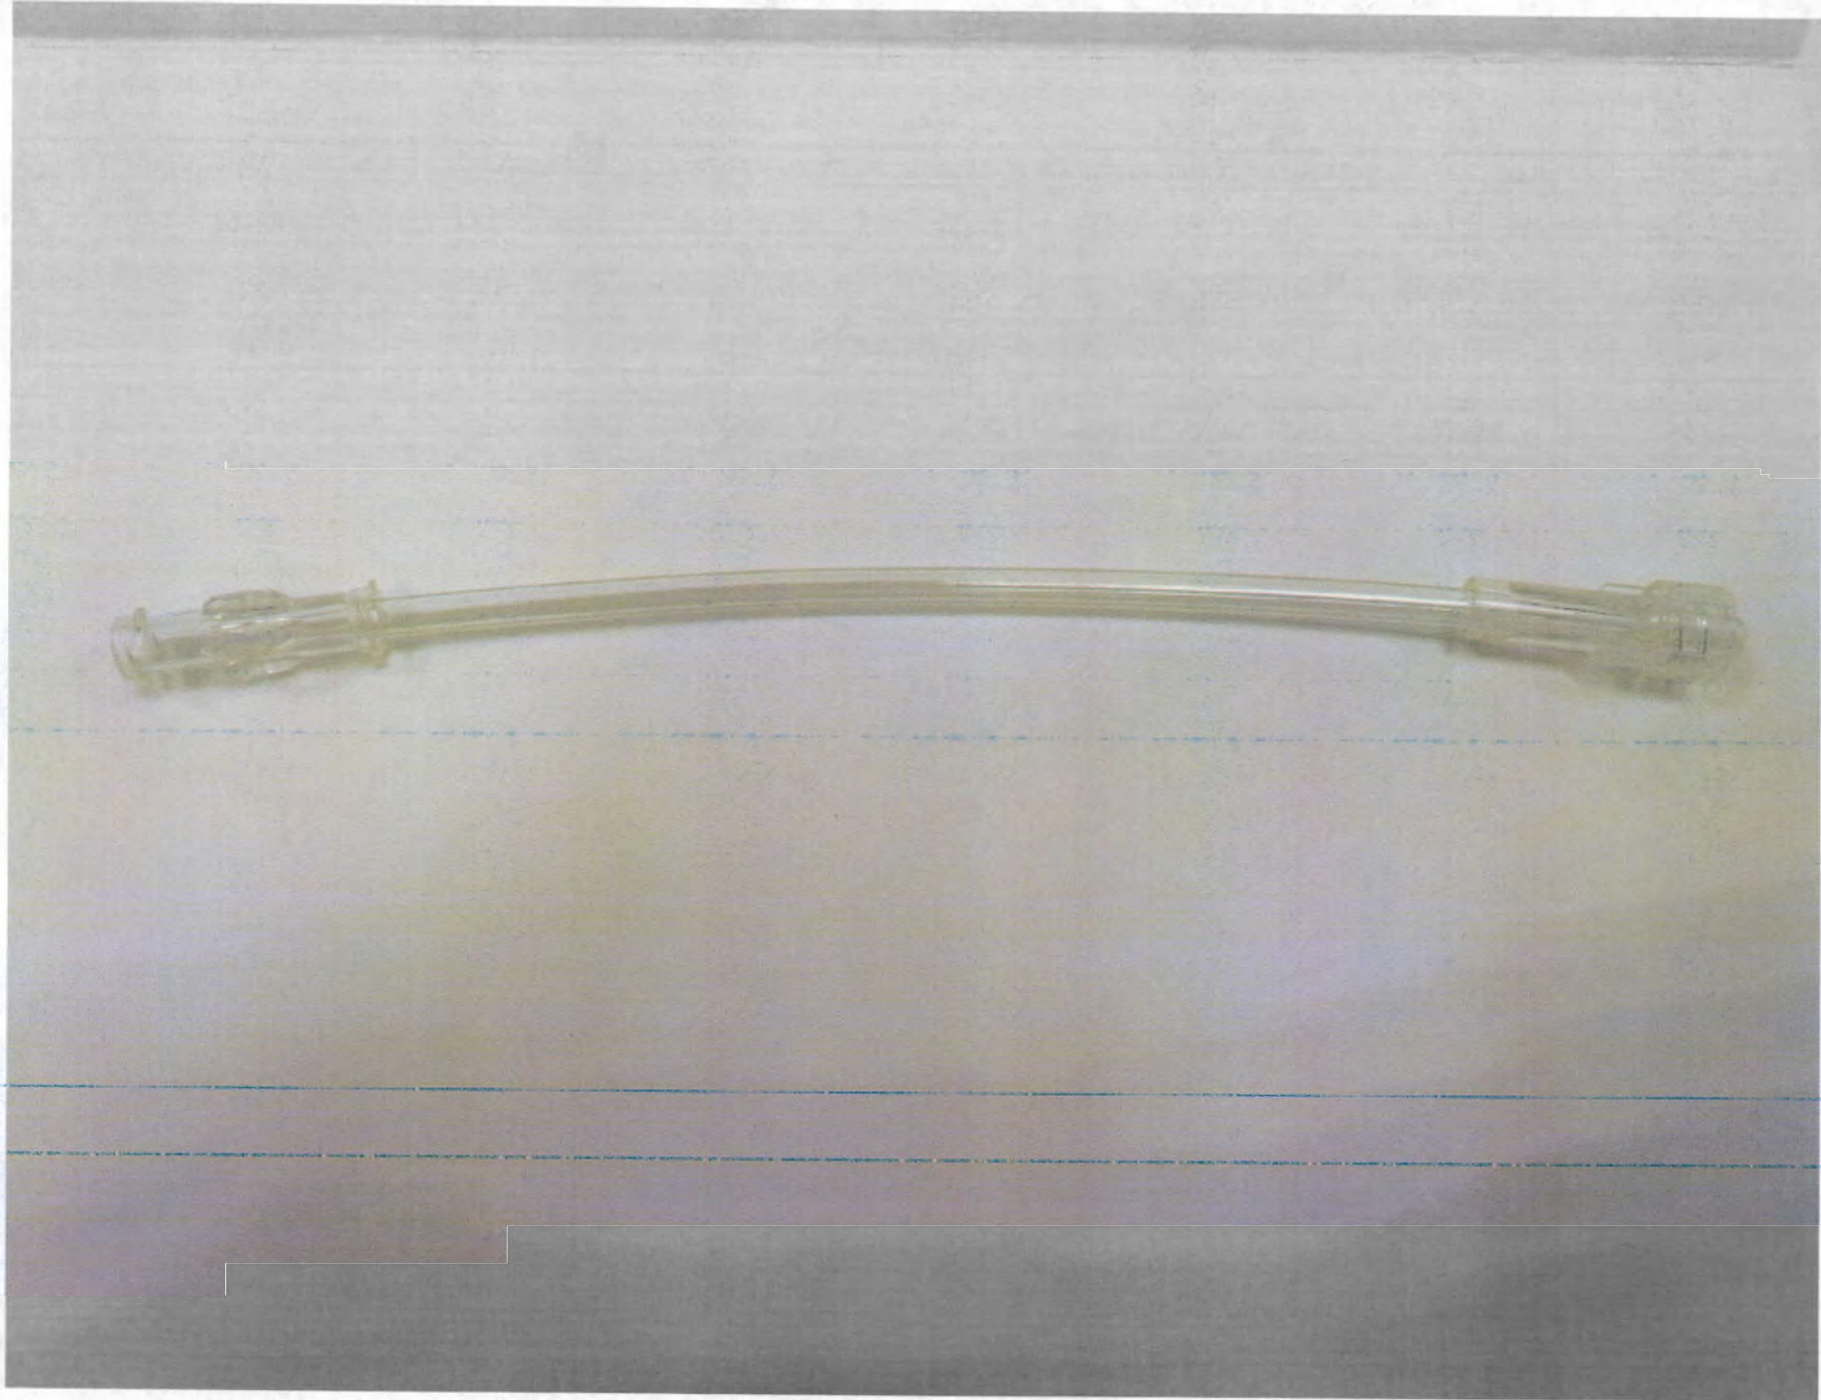


Трубка удлинительная

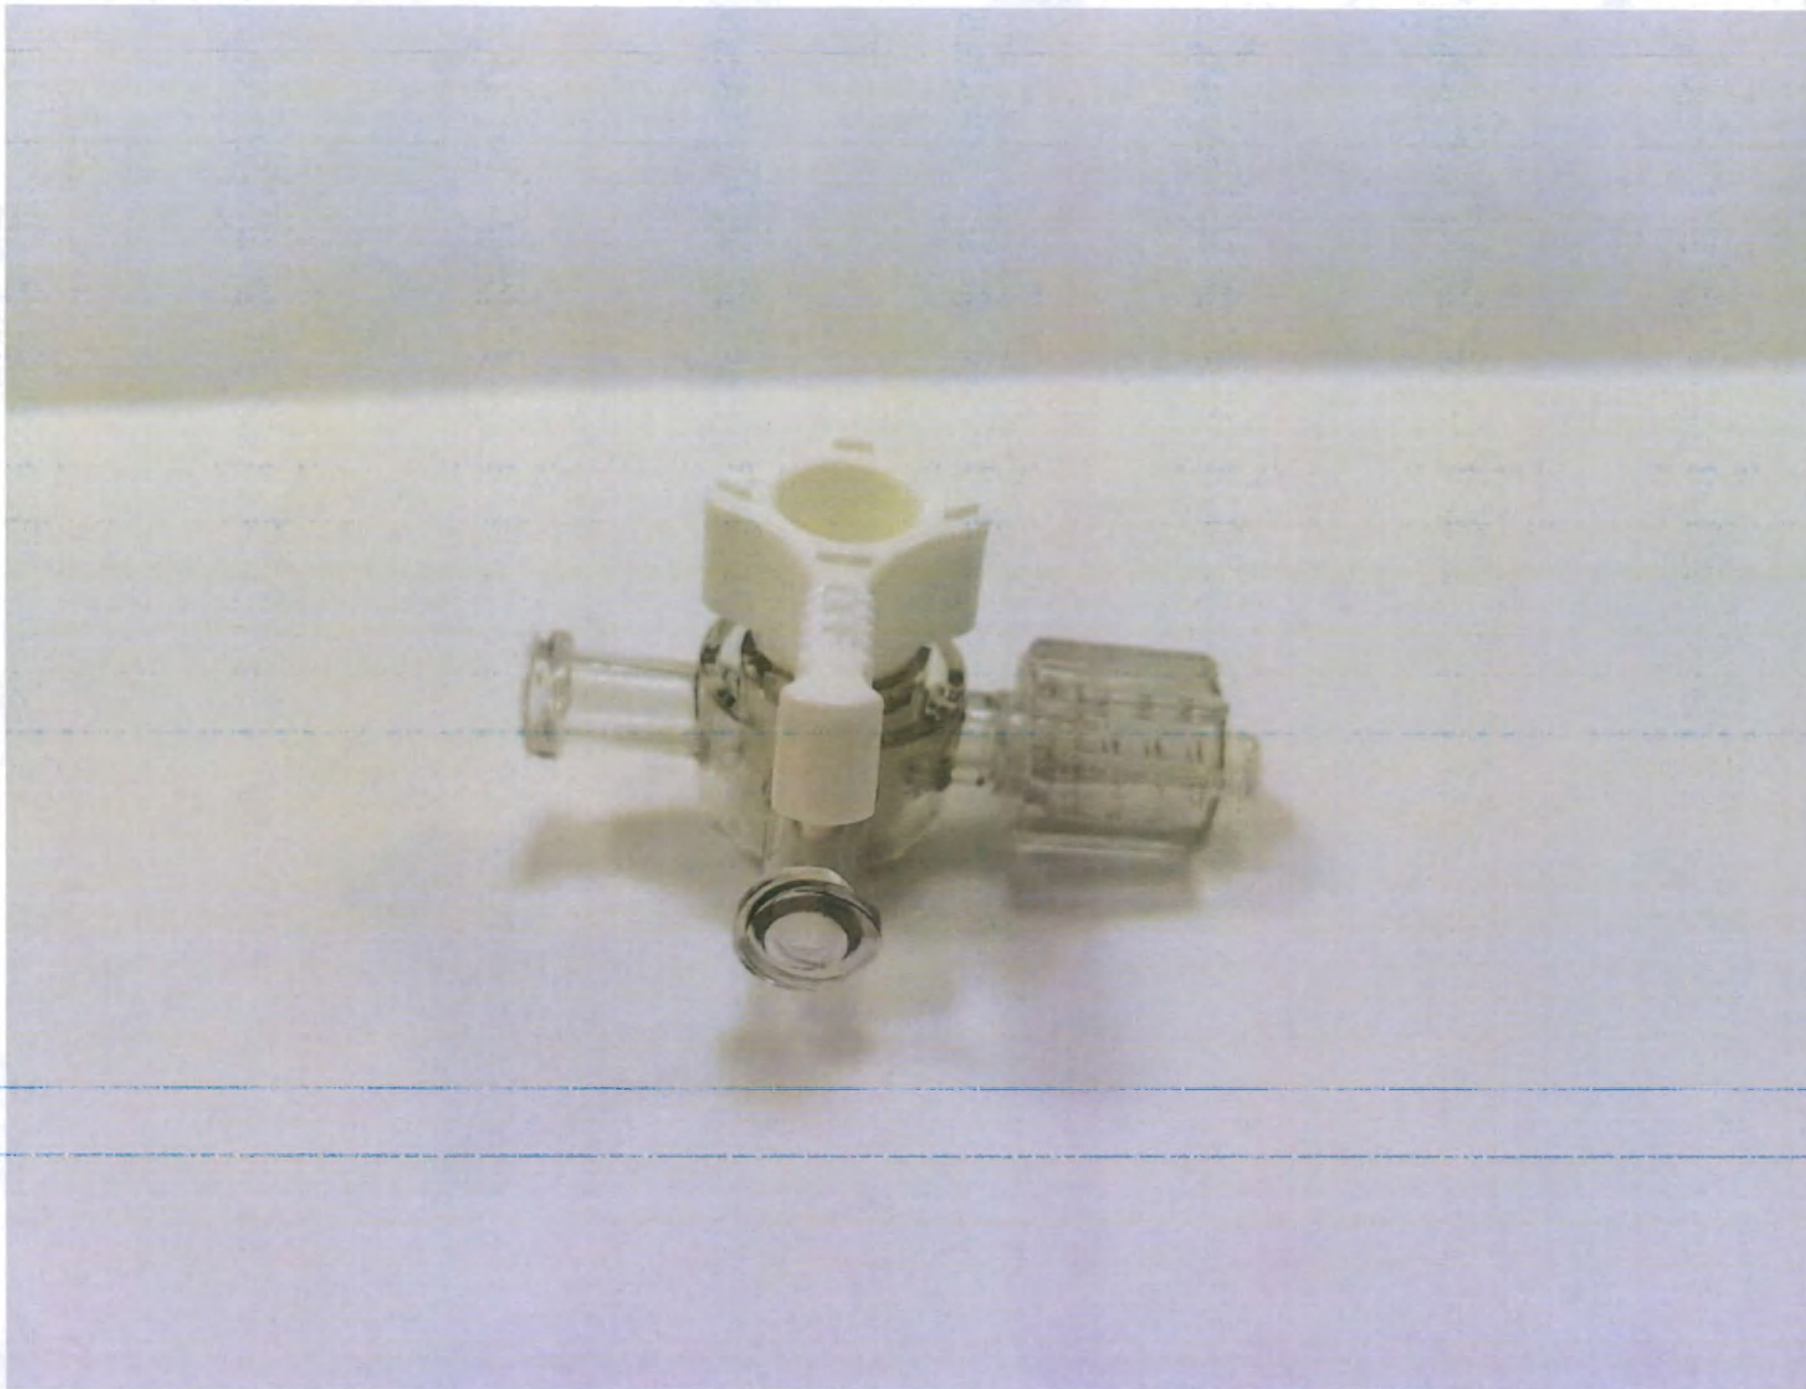


Кран 4-х ходовой

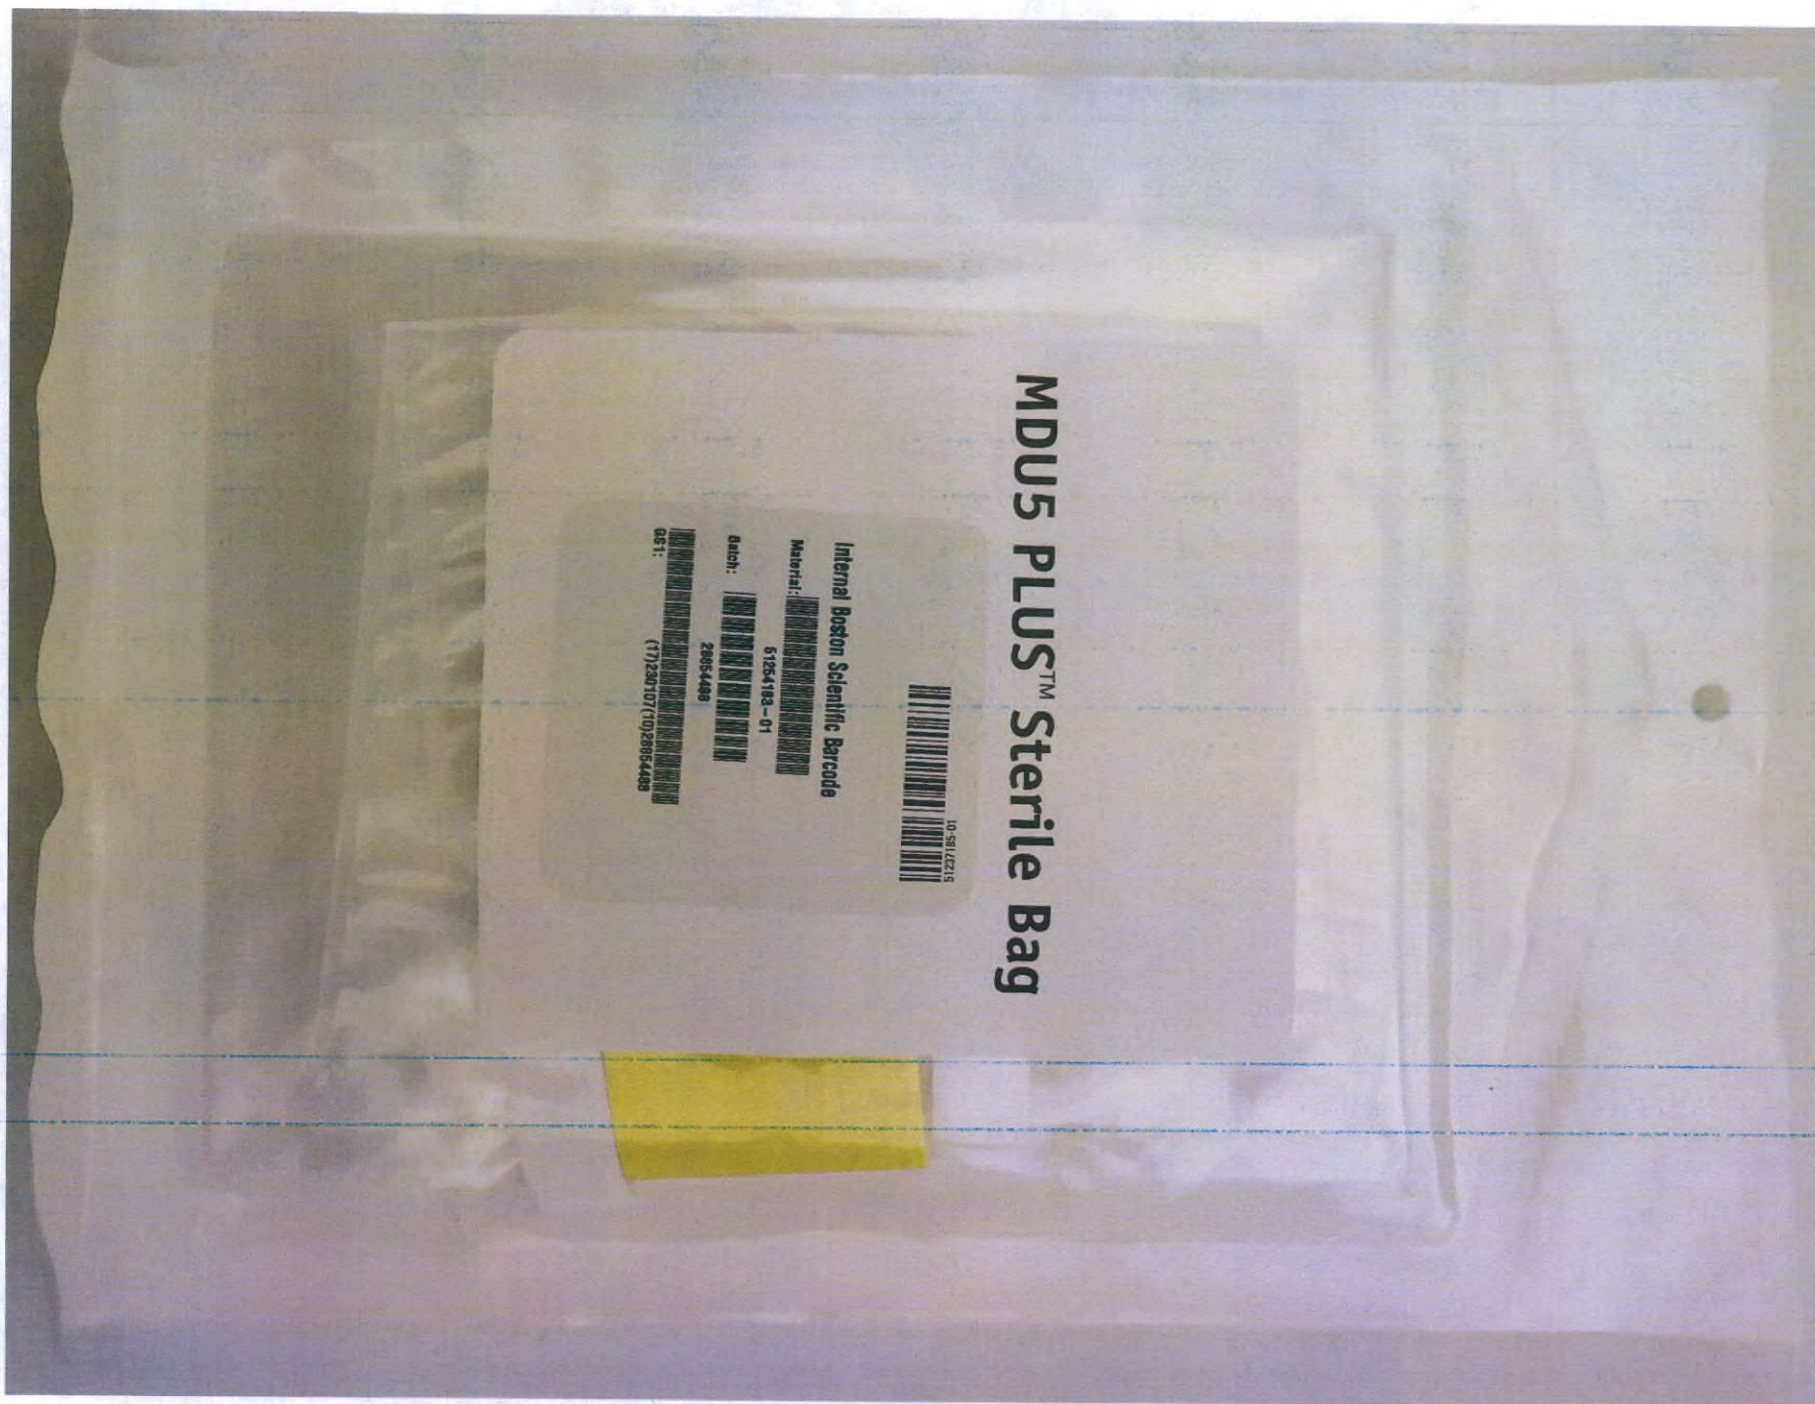

Запечатываемый пакет для пакета стерильного для блока электропривода MDU5 PLUS

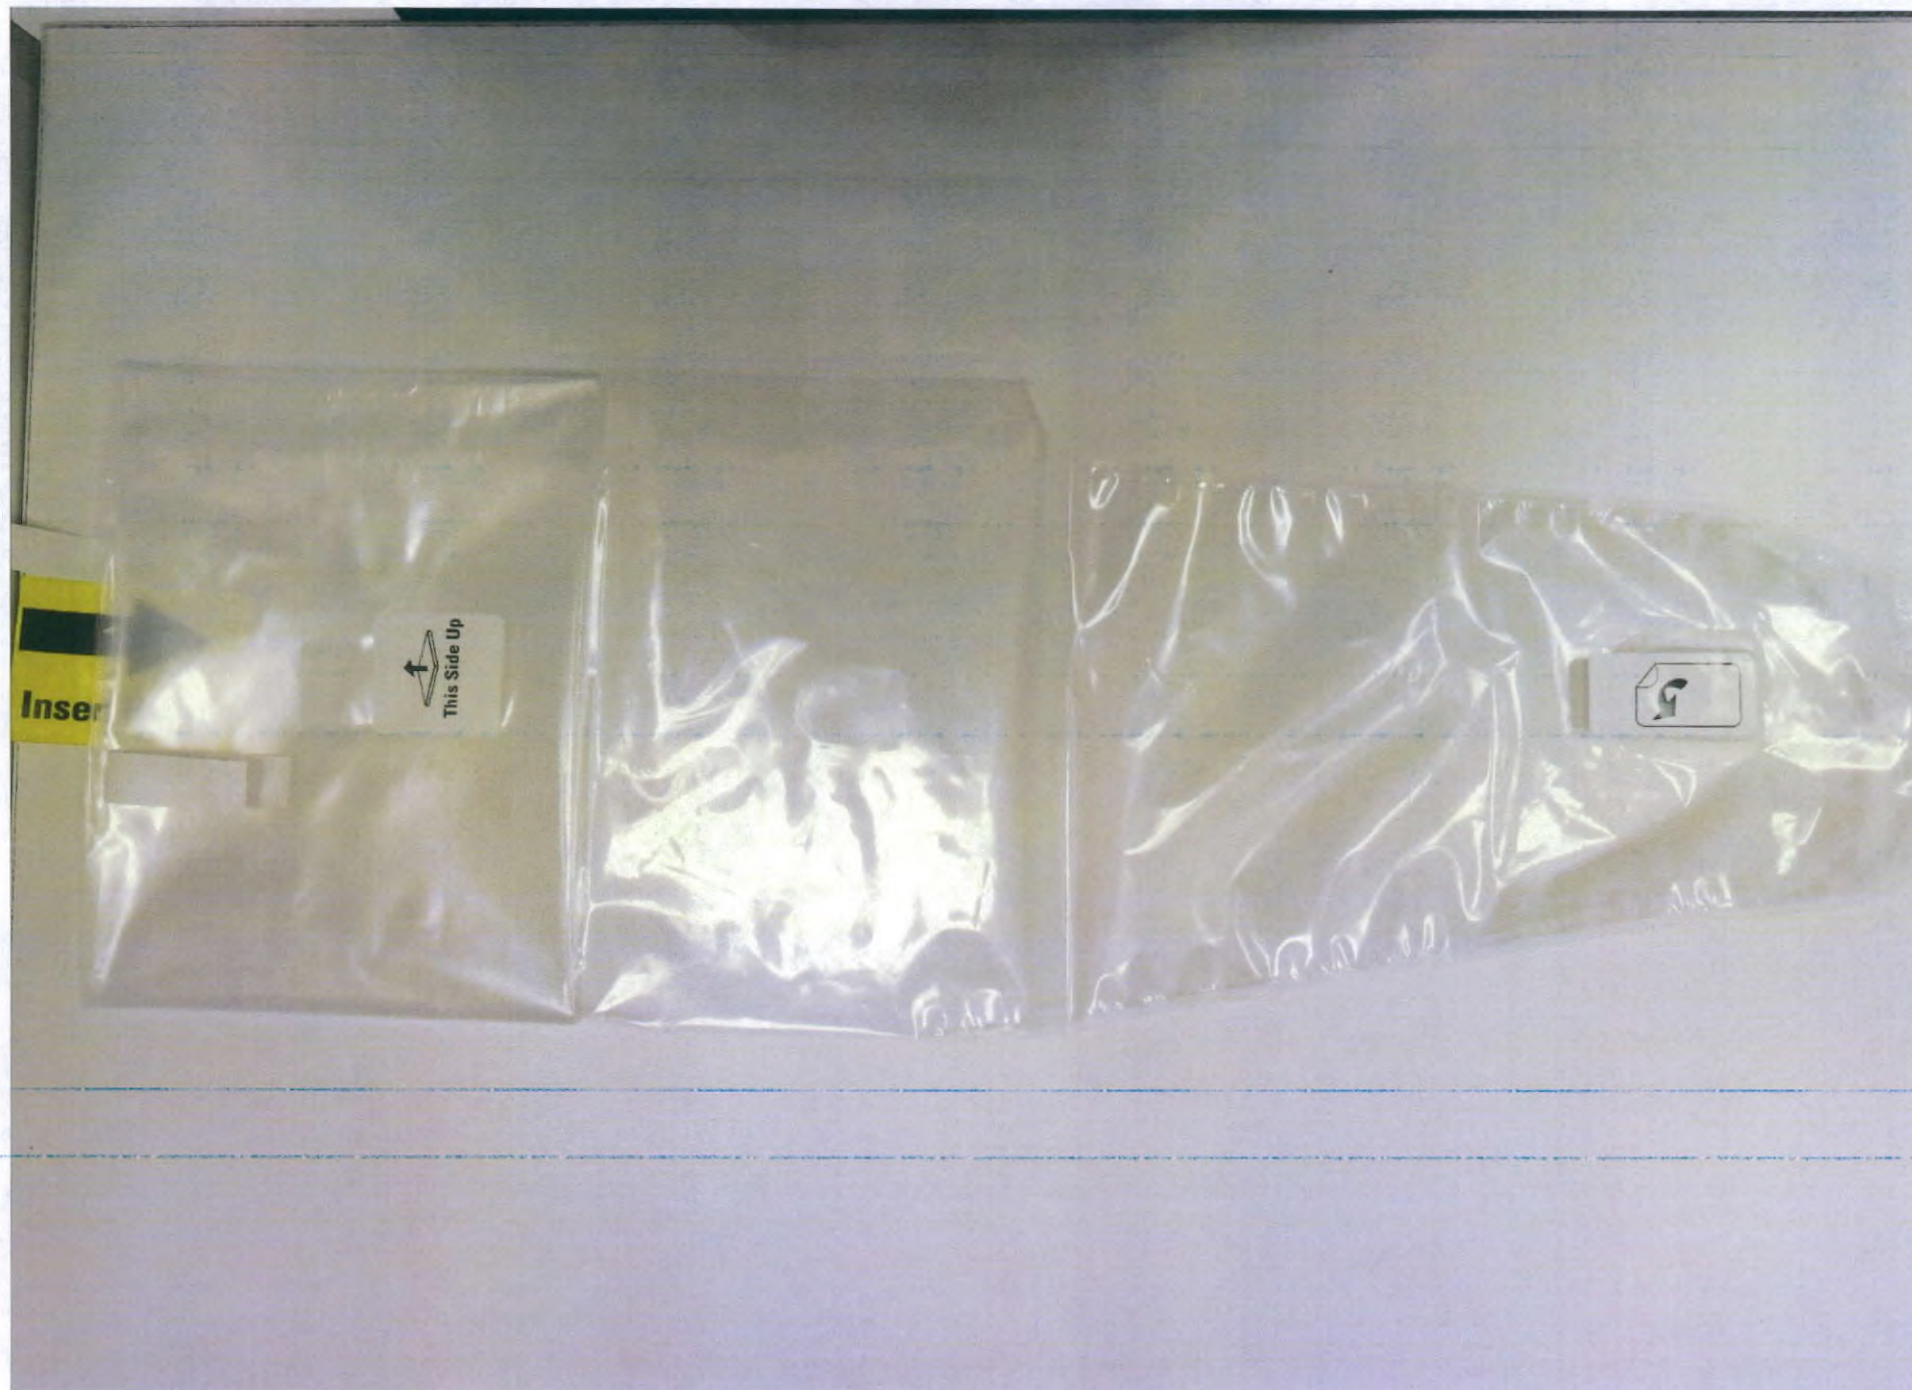

Пакет стерильный для блока электропривода MDU5 PLUS

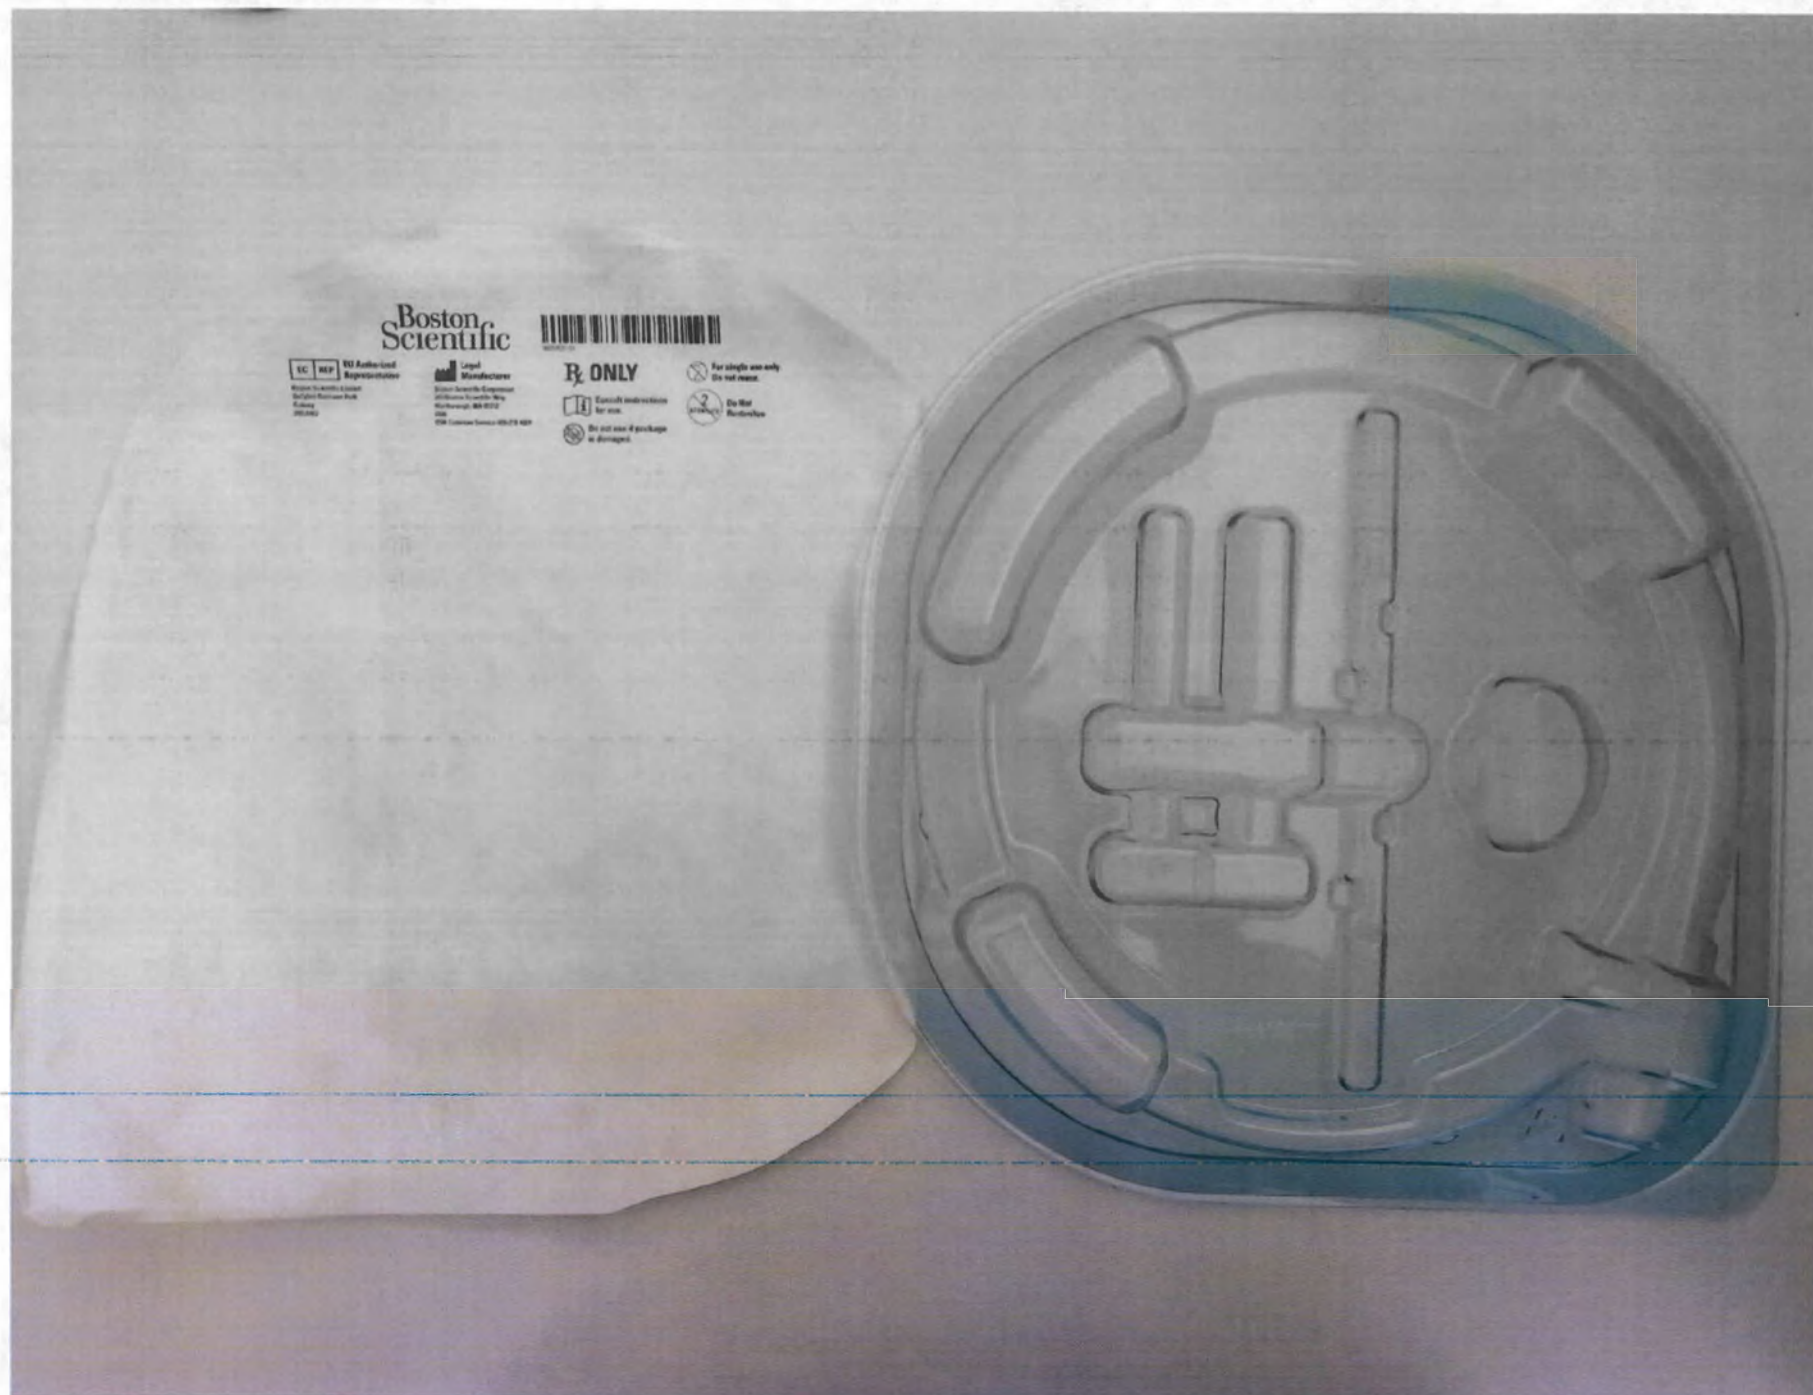

Лоток

Генеральный директор
Шевчук Е.В.

ПРОШТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
50 ЛИСТОВ



МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАРИАНТА ИСПОЛНЕНИЯ

Катетер для васкулярной визуализации OptiCross 18 30 МГц в индивидуальной упаковке в составе:

1. Катетер для васкулярной визуализации OptiCross 18 30 МГц в индивидуальной упаковке в составе: - 1 шт.;

1.1. Катетер для васкулярной визуализации OptiCross 18 30 МГц, внешний диаметр (3,6 F) 1,18 мм, рабочая длина 135 см – 1 шт.;

1.2. Шприц 3 мл -1 шт.;

1.3. Шприц 10 мл -1 шт.;

1.4. Трубка удлинительная -1 шт.;

1.5. Кран 4-х ходовой -1 шт.;

2. Пакет стерильный для блока электропривода MDU5 PLUS – 1 шт.;

3. Инструкция по применению- 1 шт.

Регистрационное удостоверение:

От:

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Катетер для васкулярной визуализации OptiCross 35 15 МГц в индивидуальной упаковке в составе:

1. Катетер для васкулярной визуализации OptiCross 35 15 МГц в индивидуальной упаковке в составе: - 1 шт.;
- 1.1. Катетер для васкулярной визуализации OptiCross 35 15 МГц, внешний диаметр (8 F) 2,74 мм, рабочая длина 105 см - 1 шт.;
- 1.2 Шприц 3 мл-1 шт.;
- 1.3 Шприц 10 мл -1 шт.;
- 1.4 Трубка удлинительная -1 шт.;
- 1.5 Кран 4-х ходовой -1 шт.;
2. Пакет стерильный для блока электропривода MDU5 PLUS – 1 шт.;
3. Инструкция по применению- 1 шт.

Регистрационное удостоверение:

От:

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкции по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Генеральный директор
Шевчук Е.В.

