



Фотографические изображения

«Реагенты в кассете для количественного определения аммиака ферментативным методом в плазме крови человека на анализаторах и модулях биохимических Roche/Hitachi cobas с (NH3L2/Ammonia II cobas с systems), в вариантах исполнения»


реагенты в кассете для количественного определения аммиака ферментативным методом в плазме крови человека на анализаторах и модулях биохимических Roche/Hitachi cobas c (NH3L2/ Ammonia II cobas c systems), 150 тестов

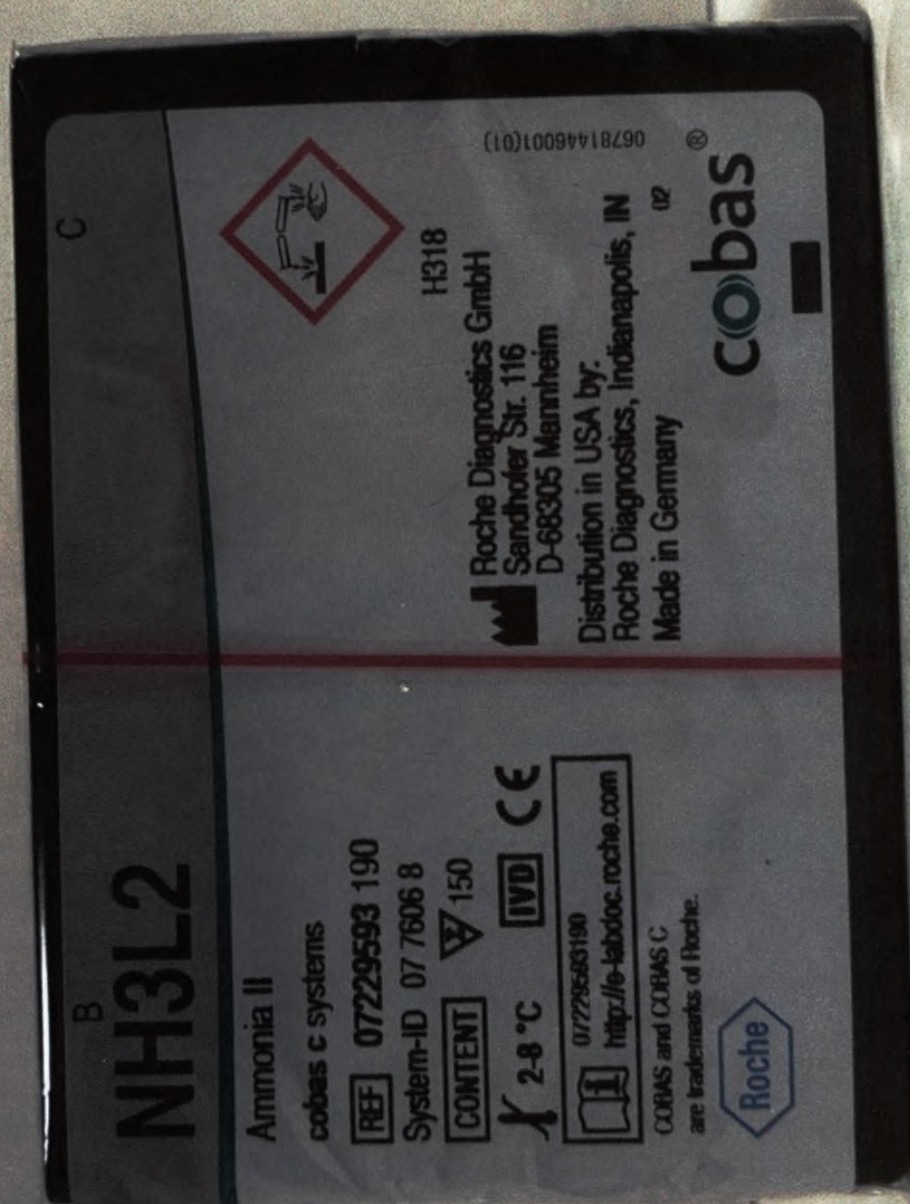


реагенты в кассете для количественного определения аммиака ферментативным методом в плазме крови человека на анализаторах и модулях биохимических Roche/Hitachi cobas c (NH3L2/ Ammonia II cobas c systems), 150 тестов

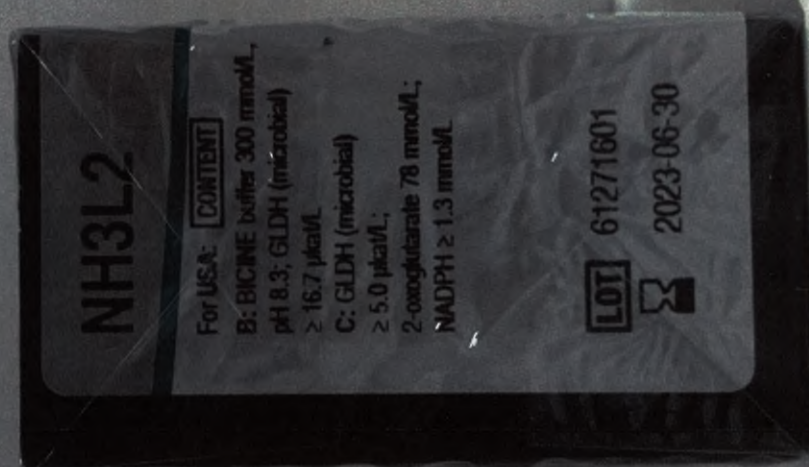

реагенты в кассете для количественного определения аммиака ферментативным методом в плазме крови человека на анализаторах и модулях биохимических Roche/Hitachi cobas с (NH3L2/ Ammonia II cobas с systems), 150 тестов

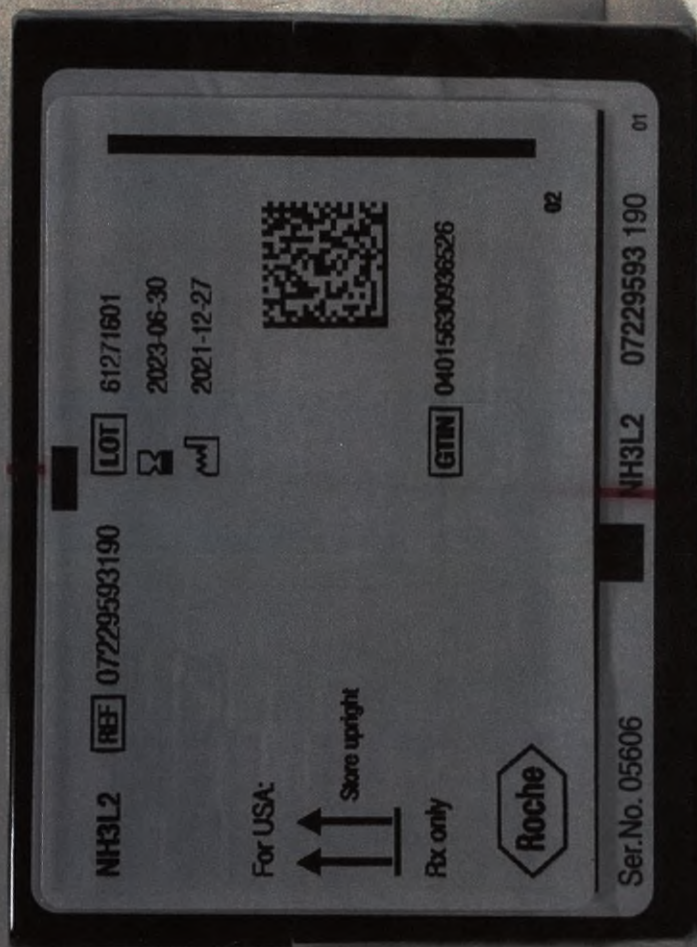

агенты в кассете для количественного определения аммиака ферментативным методом в плазме крови человека на анализаторах и модулях биохимических Roche/Hitachi cobas c (NH3L2/ Ammonia II cobas c systems), 150 тестов

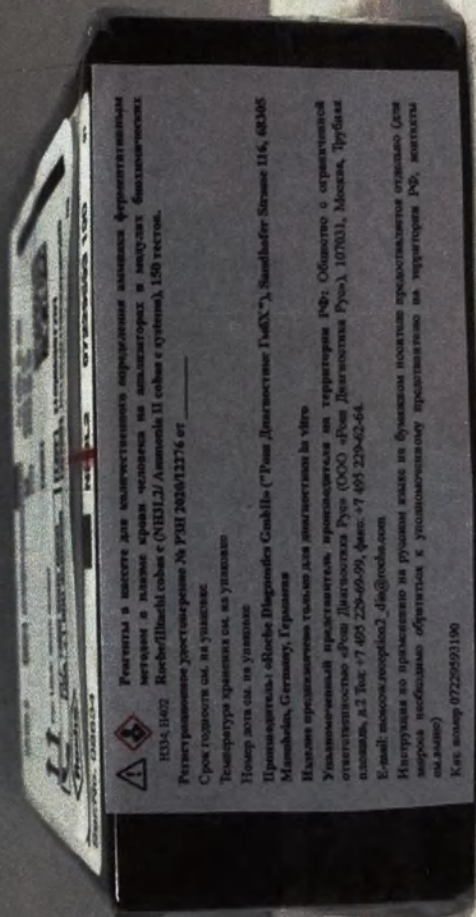

Регистры в кассете для количественного определения аммиака ферментативным методом в плазме крови человека на анализаторах и модулях биохимических Roche/Hitachi cobas c (NH3L2/ Ammonia II cobas c systems), 150 тестов.

Регистрационное удостоверение № РУД 2020/13276 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер даты см. на упаковке

Примечания: Roche Diagnostics GmbH ("Рохе Диангностикс ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Название производителя только для информации и не

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рохе Диангностикс Рус» (ООО «Рохе Диангностикс Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.1. Тел: +7 495 229-60-99, факс: +7 495 229-62-64.

E-mail: moscow@roche.ru, di@roche.com

Инструкция по применению на русском языке и буклетом носителя предоставлены отдельно (для заказа необходимо обратиться к уполномоченному представителю на территории РФ, контакты см. выше)

Кат. номер 0722593190

агенты в кассете для количественного определения аммиака ферментативным методом в плазме крови человека на модулях биохимических Roche/Hitachi cobas c (NH3L2/ Ammonia II cobas c systems), 200 тестов

B
NH3L2

Ammonia II

cobas c systems

REF 07236450190

System-ID 03 7606 8

CONTENT  200

 2-8 °C

IVD

 dialog.roche.com

COBAS and COBAS C
are trademarks of Roche.



CE 0123

P318, P280, P305+
P351+P338+P310



 Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim

Distribution in USA by:


Roche Diagnostics, Indianapolis, IN

Made in Germany

cobas

06781446001(01)

реагенты в кассете для количественного определения аммиака ферментативным методом в плазме крови человека на модулях биохимических Roche/Hitachi cobas c (NH3L2/ Ammonia II cobas c systems), 200 тестов

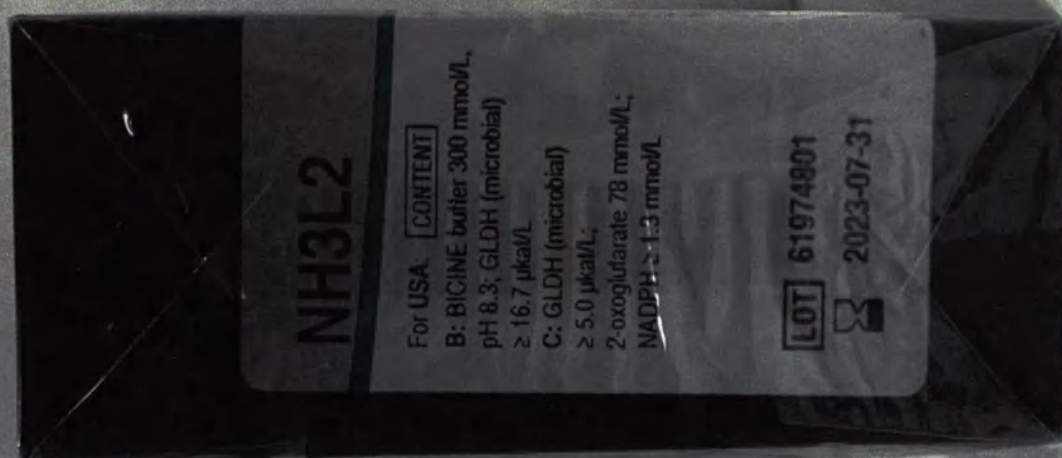

реагенты в кассете для количественного определения аммиака ферментативным методом в плазме крови человека на модулях биохимических Roche/Hitachi cobas c (NH3L2/ Ammonia II cobas c systems), 200 тестов



Ректенты в кассете для количественного определения аммиака ферментативным методом в плазме крови человека на модулях биохимических Roche/Hitachi cobas c (NH3L2/ Ammonia II cobas c systems), 200 тестов

 Ректенты в кассете для количественного определения аммиака ферментативным методом в плазме крови человека на модулях биохимических Roche/Hitachi cobas c (NH3L2/ Ammonia II cobas c systems), 200 тестов.

НЗ34, Н402
Регистрационное удостоверение № РЗН 2020/12276 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostika GmbH» ("Roche Diagnostika GmbH", Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия)

Их использование только для диагностики in vitro


Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64.

E-mail: помощь.сервис@roche2_dia@roche.com


Инструкция по применению на русском языке на бумажном носителе предоставляется отдельно (для запроса необходимо обратиться к уполномоченному представителю на территории РФ, контакты см. выше)

Кат. номер 07236450190

тенты в кассете для количественного определения аммиака ферментативным методом в плазме крови человека на
для биохимических Roche/Hitachi cobas c (NH3L2/ Ammonia II cobas c systems), 300 тестов

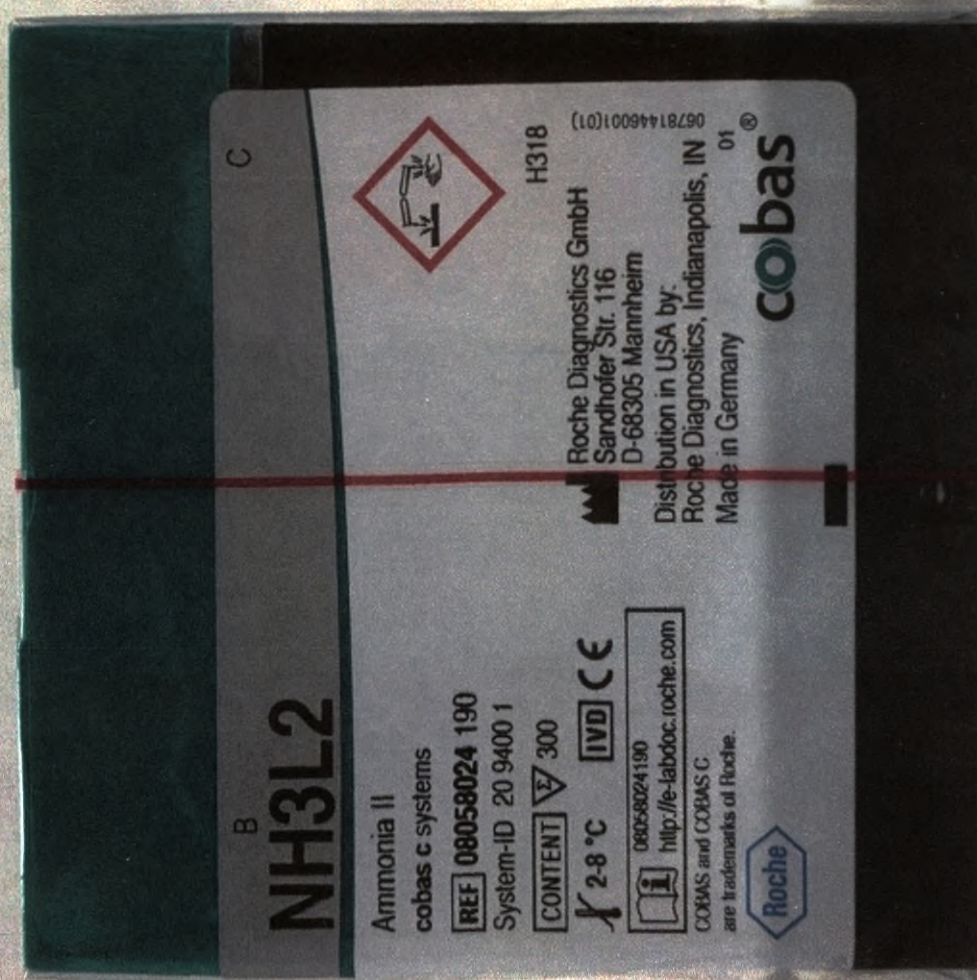

реагенты в кассете для количественного определения аммиака ферментативным методом в плазме крови человека на модулях биохимических Roche/Hitachi cobas c (NH3L2/ Ammonia II cobas c systems), 300 тестов

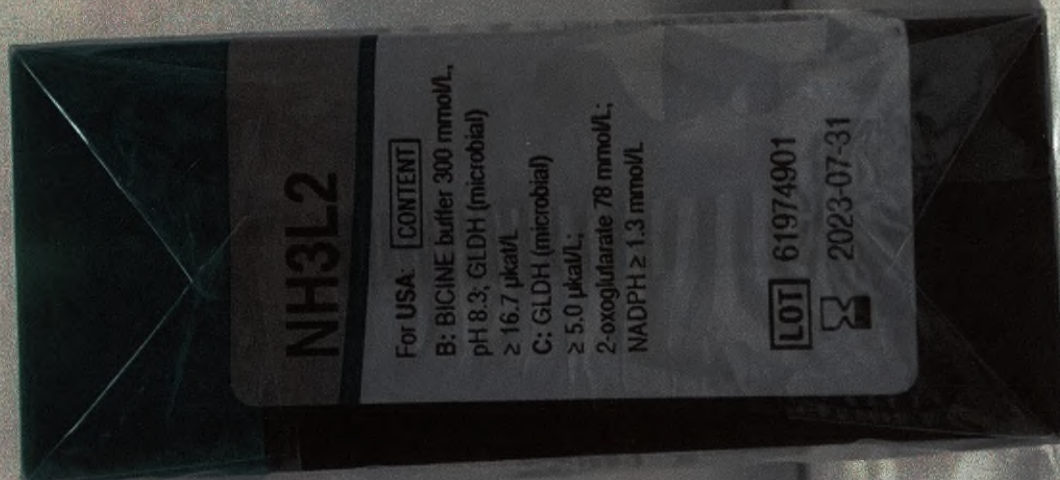

тенты в кассете для количественного определения аммиака ферментативным методом в плазме крови человека на
для биохимических Roche/Hitachi cobas c (NH3L2/ Ammonia II cobas c systems), 300 тестов



реактивы в кассете для количественного определения аммиака ферментативным методом в плазме крови человека на модулях биохимических Roche/Hitachi cobas c (NH3L2/ Ammonia II cobas c systems), 300 тестов

Реактивы в кассете для количественного определения аммиака ферментативным методом в плазме крови человека на модулях биохимических Roche/Hitachi cobas c (NH3L2/ Ammonia II cobas c systems), 300 тестов

Регистрационное удостоверение № РЗН 2826/12176 от _____

ИЗДА 11/02

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: **Roche Diagnostics GmbH** ("Рох Диангностикс ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Germany

Полное наименование товара для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель, представляющий на территории РФ Общество с ограниченной ответственностью «Рох Диангностикс Рус» (ООО «Рох Диангностикс Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 729-69-99, факс: +7 495 229-62-64.

E-mail: moscow.support@roche.com

Инструкция по применению на русском языке на бумажном носителе предоставляется отдельно (для запроса необходимо обратиться к уполномоченному представителю на территории РФ, контакты см. выше)

Кат. номер 08058024190

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью



по доверенности
от 11.02.2022 г.