

Общество с ограниченной ответственностью
«Современные лабораторные технологии»

Адрес производства:
630559, Россия,
Новосибирская обл.,
р.п. Кольцово,
ул. Технопарковая, 1;
+7 (383) 309-2000;
8 (800) 100-5-777
info@3092000.ru
www.QUBIOlab.ru



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «СЛТ»

Е.В. Печковский

«08» июля 2022 г.

Фотографический отчет

медицинского изделия для диагностики *in vitro*

Набор реагентов для выявления ДНК

***Mycoplasma hominis*, *Ureaplasma parvum* и *Ureaplasma urealyticum* (T 960)**

в клиническом материале методом ПЦР в режиме реального времени

SLT-RT-ИППП-2

по ТУ 21.20.23-010-75841125-2021


ООО «СЛТ»	Фотографический отчет медицинского изделия для диагностики <i>in vitro</i>	SLT-RT-ИППП-2	Стр. 2 из 13
-----------	--	---------------	--------------

№ п/п	Компоненты
1.	Вариант 1

1.1. Фотографическое изображение маркировки на фольгированном пакете (вид спереди):



1.2. Фотографическое изображение маркировки на фольгированном пакете (вид сзади):

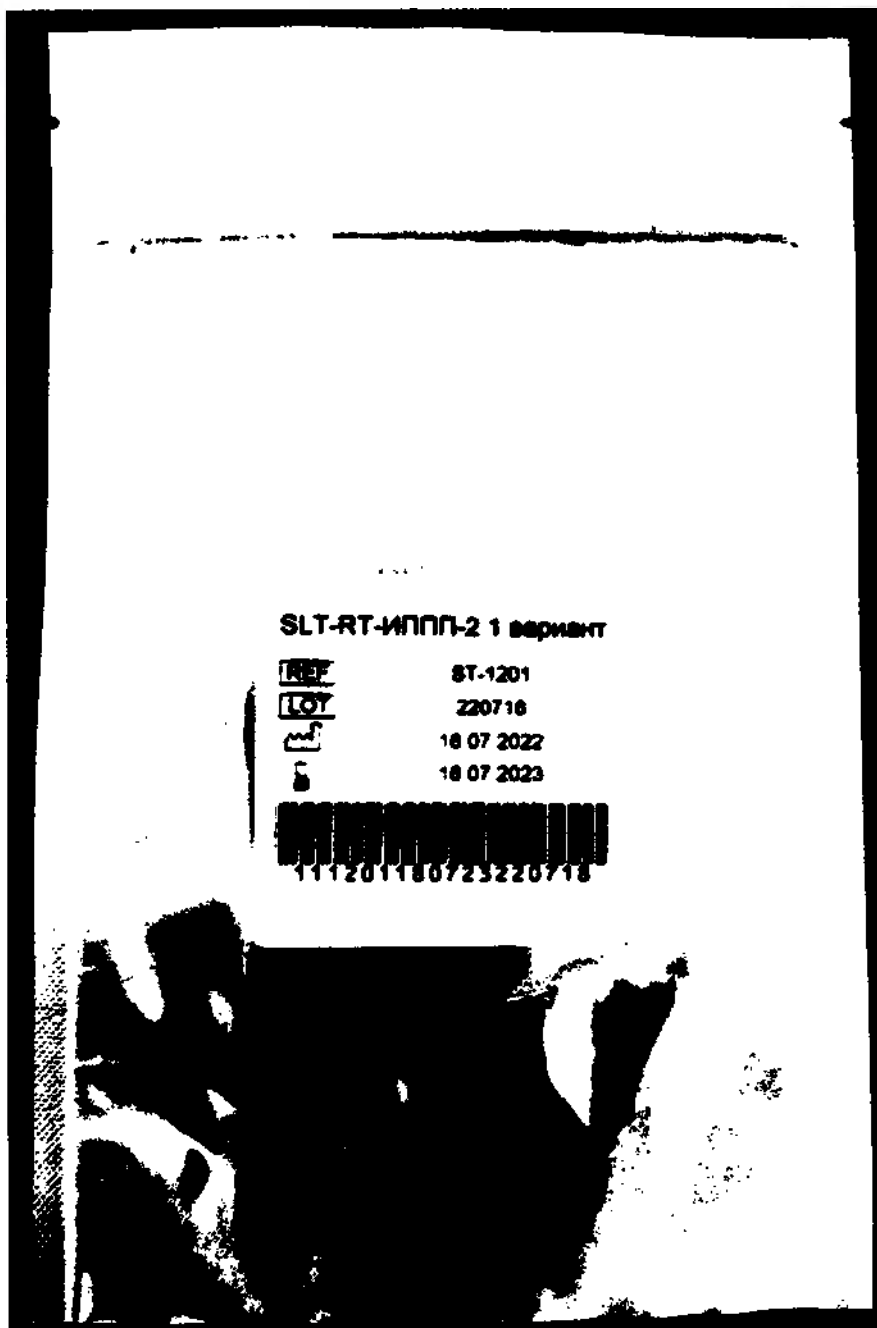

1.3. Фотографическое изображение компонента
 РС - реакционная смесь в пробирке объемом 2,0 мл:



1.4. Фотографическое изображение компонента
 СПЗ - смесь праймеров и зондов в пробирке объемом 2,0 мл:



1.5. Фотографическое изображение компонента
ПКО - положительный контрольный образец в пробирке объемом 0,5 мл:



1.6. Фотографическое изображение компонента
ОКО - отрицательный контрольный образец в пробирке объемом 0,5 мл:




1.7. Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия:



ООО «СЛТ»	Фотографический отчет медицинского изделия для диагностики <i>in vitro</i>	SLT-RT-ИППП-2	Стр. 8 из 13
-----------	--	---------------	--------------

2.2. Фотографическое изображение маркировки на фольгированном пакете (вид сзади):

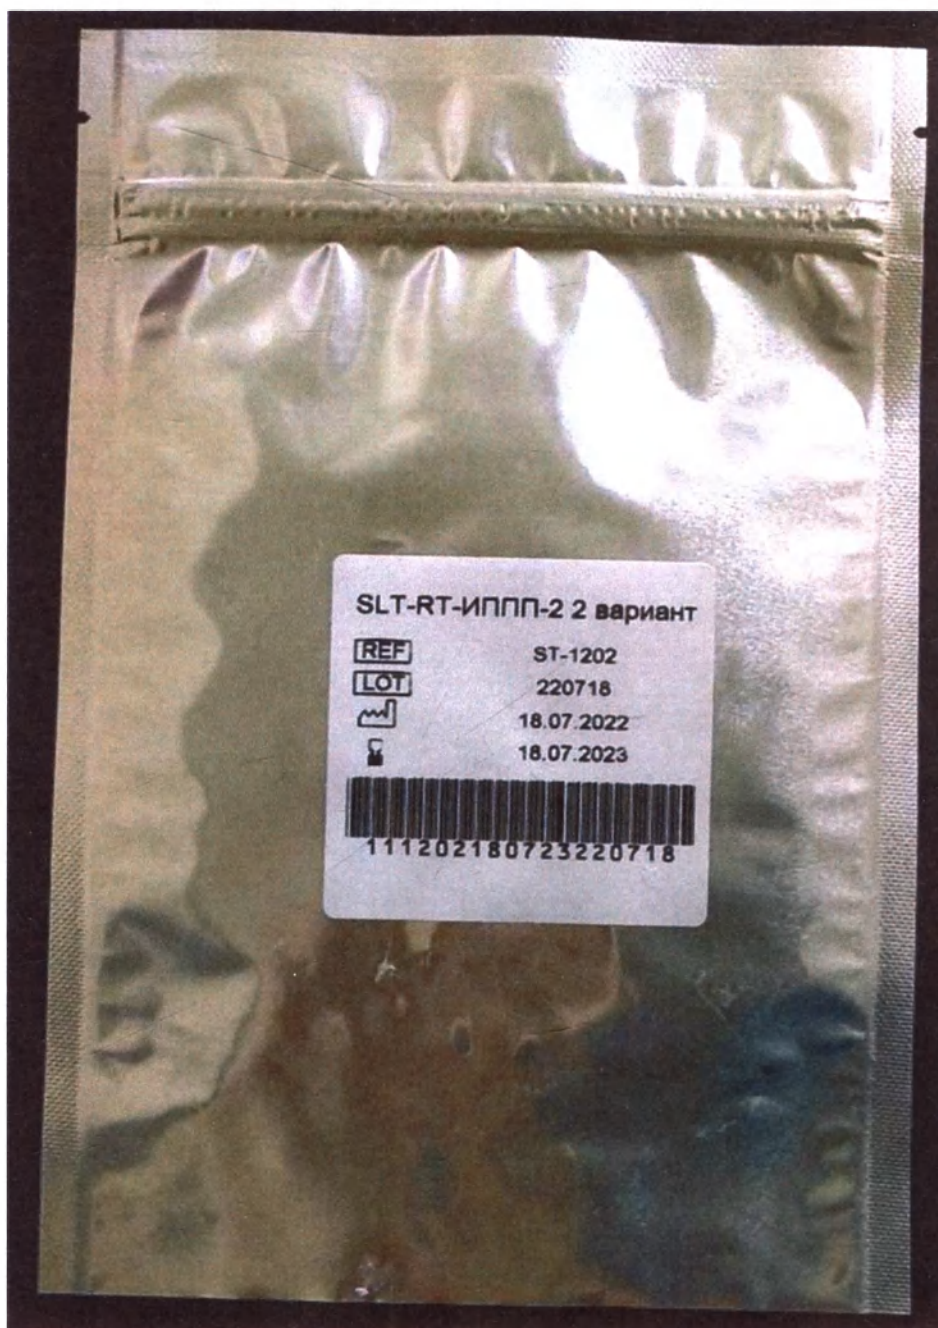

ООО «СЛТ»	Фотографический отчет медицинского изделия для диагностики <i>in vitro</i>	SLT-RT-ИППП-2	Стр. 9 из 13
-----------	--	---------------	--------------

2.3. Фотографическое изображение компонента
ГРС - готовая реакционная смесь в 96 пробирках по 20 мкл:



ООО «СЛТ»	Фотографический отчет медицинского изделия для диагностики <i>in vitro</i>	SLT-RT-ИППП-2	Стр. 10 из 13
-----------	--	---------------	---------------

2.4. Фотографическое изображение компонента
ПКО - положительный контрольный образец в пробирке объемом 0,5 мл:



2.5. Фотографическое изображение компонента
ОКО - отрицательный контрольный образец в пробирке объемом 0,5 мл:



2.6. Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия:



ООО «СЛТ»	Фотографический отчет медицинского изделия для диагностики <i>in vitro</i>	SLT-RT-ИППП-2	Стр. 12 из 13
-----------	--	---------------	---------------

2.7. Фотографическое изображение маркировки групповой упаковки для варианта 1:



ООО «СЛТ»	Фотографический отчет медицинского изделия для диагностики <i>in vitro</i>	SLT-RT-ИППП-2	Стр. 13 из 13
-----------	--	---------------	---------------

2.8. Фотографическое изображение маркировки групповой упаковки для варианта 2:



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 13 листов (листа)
Должность: Директор ООО «СЛТ»
Фамилия И.О.: Печковский Е.В.
Подпись _____
« 23 » 01 20 23 г.



Общество с ограниченной ответственностью
«Современные лабораторные технологии»

Адрес производства:
630559, Россия,
Новосибирская обл.,
р.п. Кольцово,
ул. Технопарковая, 1;
+7 (383) 309-2000;
8 (800) 100-5-777
info@3092000.ru
www.QUBIOlab.ru



УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «СЛТ»

Е.В. Печковский

«18» января 2022 г.



Макеты этикеток

медицинского изделия для диагностики *in vitro*

Набор реагентов для выявления ДНК

Mycoplasma hominis, *Ureaplasma parvum* и *Ureaplasma urealyticum* (T 960)

в клиническом материале методом ПЦР в режиме реального времени

SLT-RT-ИППП-2


по ТУ 21.20.23-010-75841125-2021

ООО «СЛТ»	Макеты этикеток медицинского изделия для диагностики <i>in vitro</i>	SLT-RT-ИППП-2	Стр. 2 из 6
-----------	---	---------------	-------------


Этикетки на пробирки для 1 варианта исполнения:

На каждую пробирку объемом 2,0 и 0,5 мл наклеена этикетка размером 20мм×40мм:


1. РС – реакционная смесь




2. СПЗ – смесь праймеров и зондов



3. ПКО – положительный контрольный образец



4. ОКО – отрицательный контрольный образец



5. На каждый фольгированный пакет наклеена этикетка размером 60мм×60мм:



Набор реагентов для выявления ДНК
Mycoplasma hominis, Ureaplasma parvum и Ureaplasma T-960
 в клиническом материале методом ПЦР в режиме реального времени

SLT-RT-ИППП-2
 по ТУ 21.20.23-010-75841125-2021

Вариант 1

REF	1201	LOT	YYMMDD
-----	------	-----	--------

 DD.MM.YYYY Масса нетто наборов _____ кг
 DD.MM.YYYY Масса брутто наборов _____ кг

Число единиц потребительской упаковки _____

Этикетки для 2 варианта исполнения:

На каждый на полиэтиленовый прозрачный пакет с замком zip-lock для отдельных пробирок объемом 0,2 мл с жидким компонентом ГРС наклеена этикетка размером 35мм×70мм с указанием:

1. ГРС – готовая реакционная смесь

1. ГРС

SLT-RT-ИППП-2
 в 96 пробирках по 20 мкл

REF	ST-1202
LOT	YYMMDD

 DD.MM.YYYY -15°C
 DD.MM.YYYY -25°C

На каждую пробирку объемом 0,5 мл наклеена этикетка размером 20мм×40мм:

2. ПКО – положительный контрольный образец

2. ПКО

SLT-RT-ИППП-2
 60 мкл

REF	ST-1202
LOT	YYMMDD

 DD.MM.YYYY -15°C
 DD.MM.YYYY -25°C

3. ОКО – отрицательный контрольный образец

3. ОКО

SLT-RT-ИППП-2
 60 мкл

REF	ST-1202
LOT	YYMMDD

 DD.MM.YYYY -15°C
 DD.MM.YYYY -25°C

ООО «СЛТ»	Макеты этикеток медицинского изделия для диагностики <i>in vitro</i>	SLT-RT-ИППП-2	Стр. 5 из 6
-----------	---	---------------	-------------

4. На каждый фольгированный пакет наклеена этикетка размером 60мм×60мм:



5. На каждый фольгированный пакет наклеена этикетка размером 120мм×90мм:



ООО «СЛТ»	Макеты этикеток медицинского изделия для диагностики <i>in vitro</i>	SLT-RT-ИППП-2	Стр. 6 из 6
-----------	---	---------------	-------------

6. На каждую групповую упаковку для каждого варианта наклеены 2 этикетки размером 100мм×70мм:

ООО «Современные лабораторные технологии»

Россия, 630559; Новосибирская обл.,
рп Кольцово, ул. Технопарковая, 1
тел: +7 (383)-309-2000;
8 (800)-100-5-777
e-mail: info@3092000.ru

Набор реагентов для выявления ДНК
Mycoplasma hominis, Ureaplasma parvum и Ureaplasma T-960
в клиническом материале методом ПЦР в режиме реального времени

SLT-RT-ИППП-2
по ТУ 21.20.23-010-75841125-2021
Вариант 2

REF 1202 LOT YYMMDD

 DD.MM.YYYY Масса нетто наборов _____ кг

 DD.MM.YYYY Масса брутто наборов _____ кг

Число единиц потребительской упаковки _____

Прошито, пронумеровано и скреплено

печатью 6 листов (листа)

Должность: Директор ООО «СЛТ»

Фамилия И.О.: Печковский Е.В.

Подпись

«23» 01 2023 г.

