


МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Стандартные эритроциты ABO A2 «ID-DiaCell ABO A2» для определения группы крови перекрестной реакцией для иммуногематологических исследований в in vitro диагностике, 1 × 10 мл, производства DiaMed GmbH / «ДиаМед ГмбХ»

BIO-RAD**Список символов**

Следующие символы содержатся на маркировке.

Расшифровка символов на упаковке:

Символ	Значение
	Логотип производителя Био-Рад
	Изготовитель
	Код партии
	Использовать до
	Предел температуры (от 2°C до 8°C)
Id-n°	Идентификационный номер медицинского изделия
	Медицинское изделие для диагностики <i>in vitro</i>
	Маркировка соответствия требованиям СЕ (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Номер по каталогу
	Обратитесь к инструкции по применению
	Осторожно!
	Упаковка пригодна для вторичной переработки
	Серийный номер

Макет маркировки первичной упаковки

Макет маркировки

BIO-RAD**BIO-RAD****ID-DiaCell ABO A₂
ccdde**

human, suspension 0.8% ± 0.1

E003616 10.19

Id-n°:
06022**IVD**


2 °C

DiaMed GmbH
Pra Rond 23
1785 Cressier FR
Switzerland**CE**
0123

Примечание. Код партии, срок годности, штрих-код, серийный номер и двумерный матричный штрих-код наносятся в процессе наполнения флаконов.

Маркировка первичной упаковки содержит следующую информацию:

- наименование, адрес и логотип производителя;
- наименование медицинского изделия;
- объем флакона;
- фенотип эритроцитов по системе Резус;
- информация о содержании материалов человеческого происхождения;
- идентификационный номер медицинского изделия;
- символ «Медицинское изделие для диагностики in vitro»;
- символ «Предел температуры»;
- символ соответствия требованиям CE;
- штрих-код;
- код партии;
- символ «Использовать до»;
- двумерный матричный штрих-код;
- серийный номер.

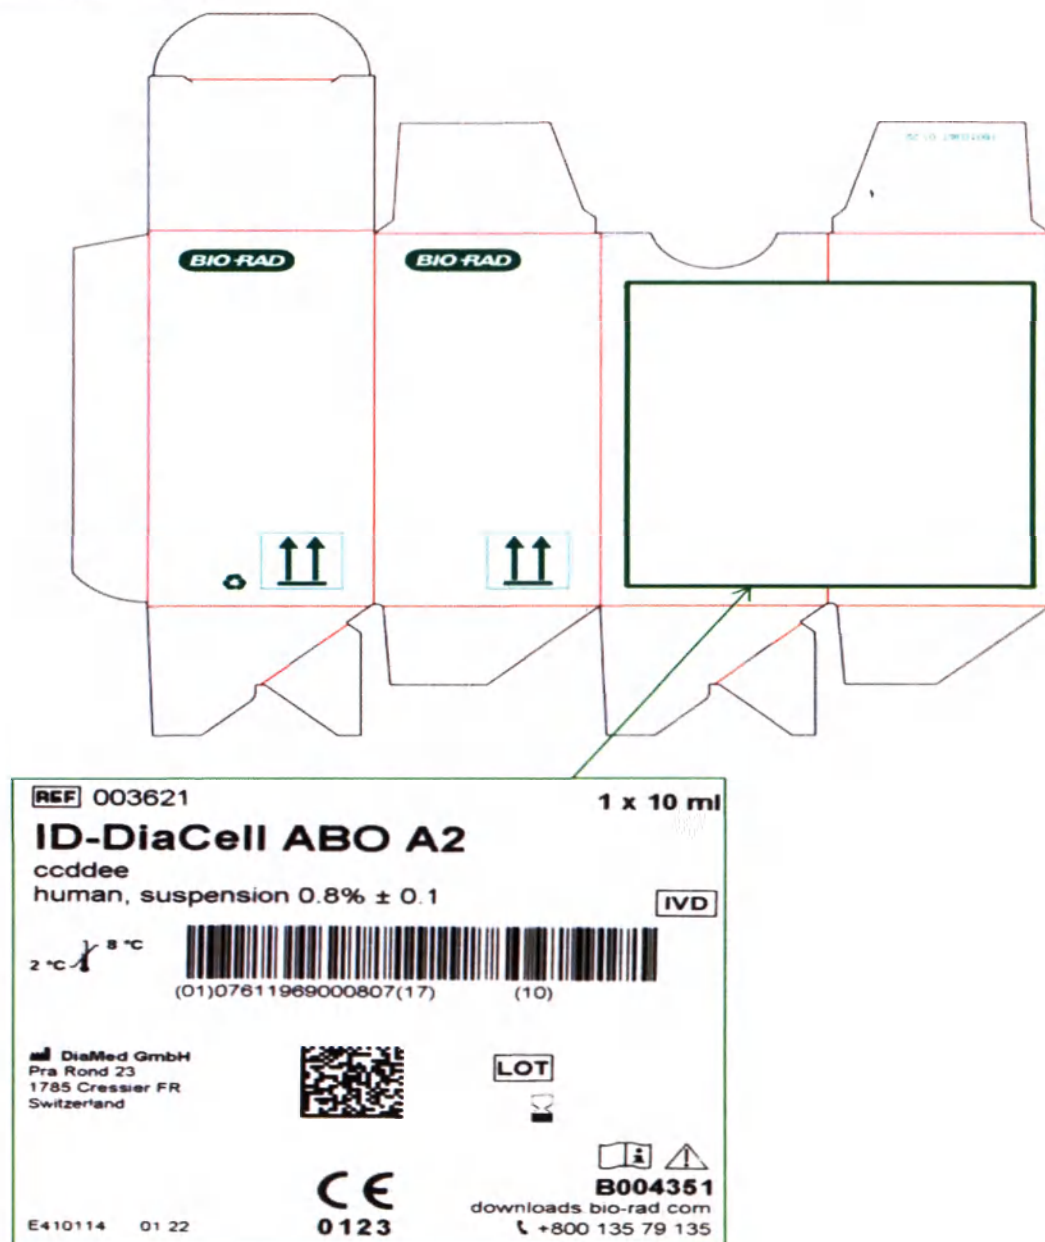Макет маркировки картонной коробки (вторичная упаковка)Макет маркировки

Примечание: Цвет нанесения текста маркировки и его расположение на первичной и вторичной упаковках может отличаться от партии к партии при неизменности самого текста. Данные отличия не влияют на качество, безопасность и эффективность медицинского изделия.

Маркировка каждой коробки содержит следующую информацию:

- наименование, адрес и логотип производителя;
- наименование медицинского изделия;
- фенотип эритроцитов по системе Резус;
- информация о содержании материалов человеческого происхождения;
- номер по каталогу;
- объем и количество флаконов в упаковке;

BIO-RAD

- символ «Медицинское изделие для диагностики in vitro»;
- символ «Обратитесь к инструкции по применению»;
- символ «Осторожно!»;
- символ «Предел температуры»;
- символ соответствия требованиям СЕ;
- код партии;
- штрих-код;
- двумерный матричный штрих-код;
- символ «Использовать до»;
- символ «Упаковка пригодна для вторичной переработки»;
- сайт для скачивания инструкции по применению;
- версия инструкции по применению;
- контактный телефон.

BIO-RAD

Макет маркировки на русском языке для обращения на территории Российской Федерации

REF 003621

IVD

Стандартные эритроциты ABO A2 «ID-DiaCell ABO A2» для определения группы крови перекрестной реакцией для иммуногематологических исследований в *in vitro* диагностике, 1 × 10 мл.

Только для диагностики *in vitro*

Для профессионального применения

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Серийный номер, номер по каталогу, срок годности, условия хранения и графические символы указаны на оригинальной упаковке



Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Производитель: DiaMed GmbH, Pra Rond 23, 1785 Cressier (FR), Switzerland (Швейцария)

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Био-Рад Лаборатории»

Адрес: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 5А

Телефон: (495) 721 14 04

e-mail: ra_russia.cis@bio-rad.com

www.bio-rad.com

Место производства: Швейцария

Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью 6 листа (ов).




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Стандартные эритроциты ABO A2 «ID-DiaCell ABO A2» для определения группы
крови перекрестной реакцией для иммуногематологических исследований в in vitro
диагностике, 1 × 10 мл**


производства

DiaMed GmbH / «ДиаМед ГмбХ», Швейцария


2022

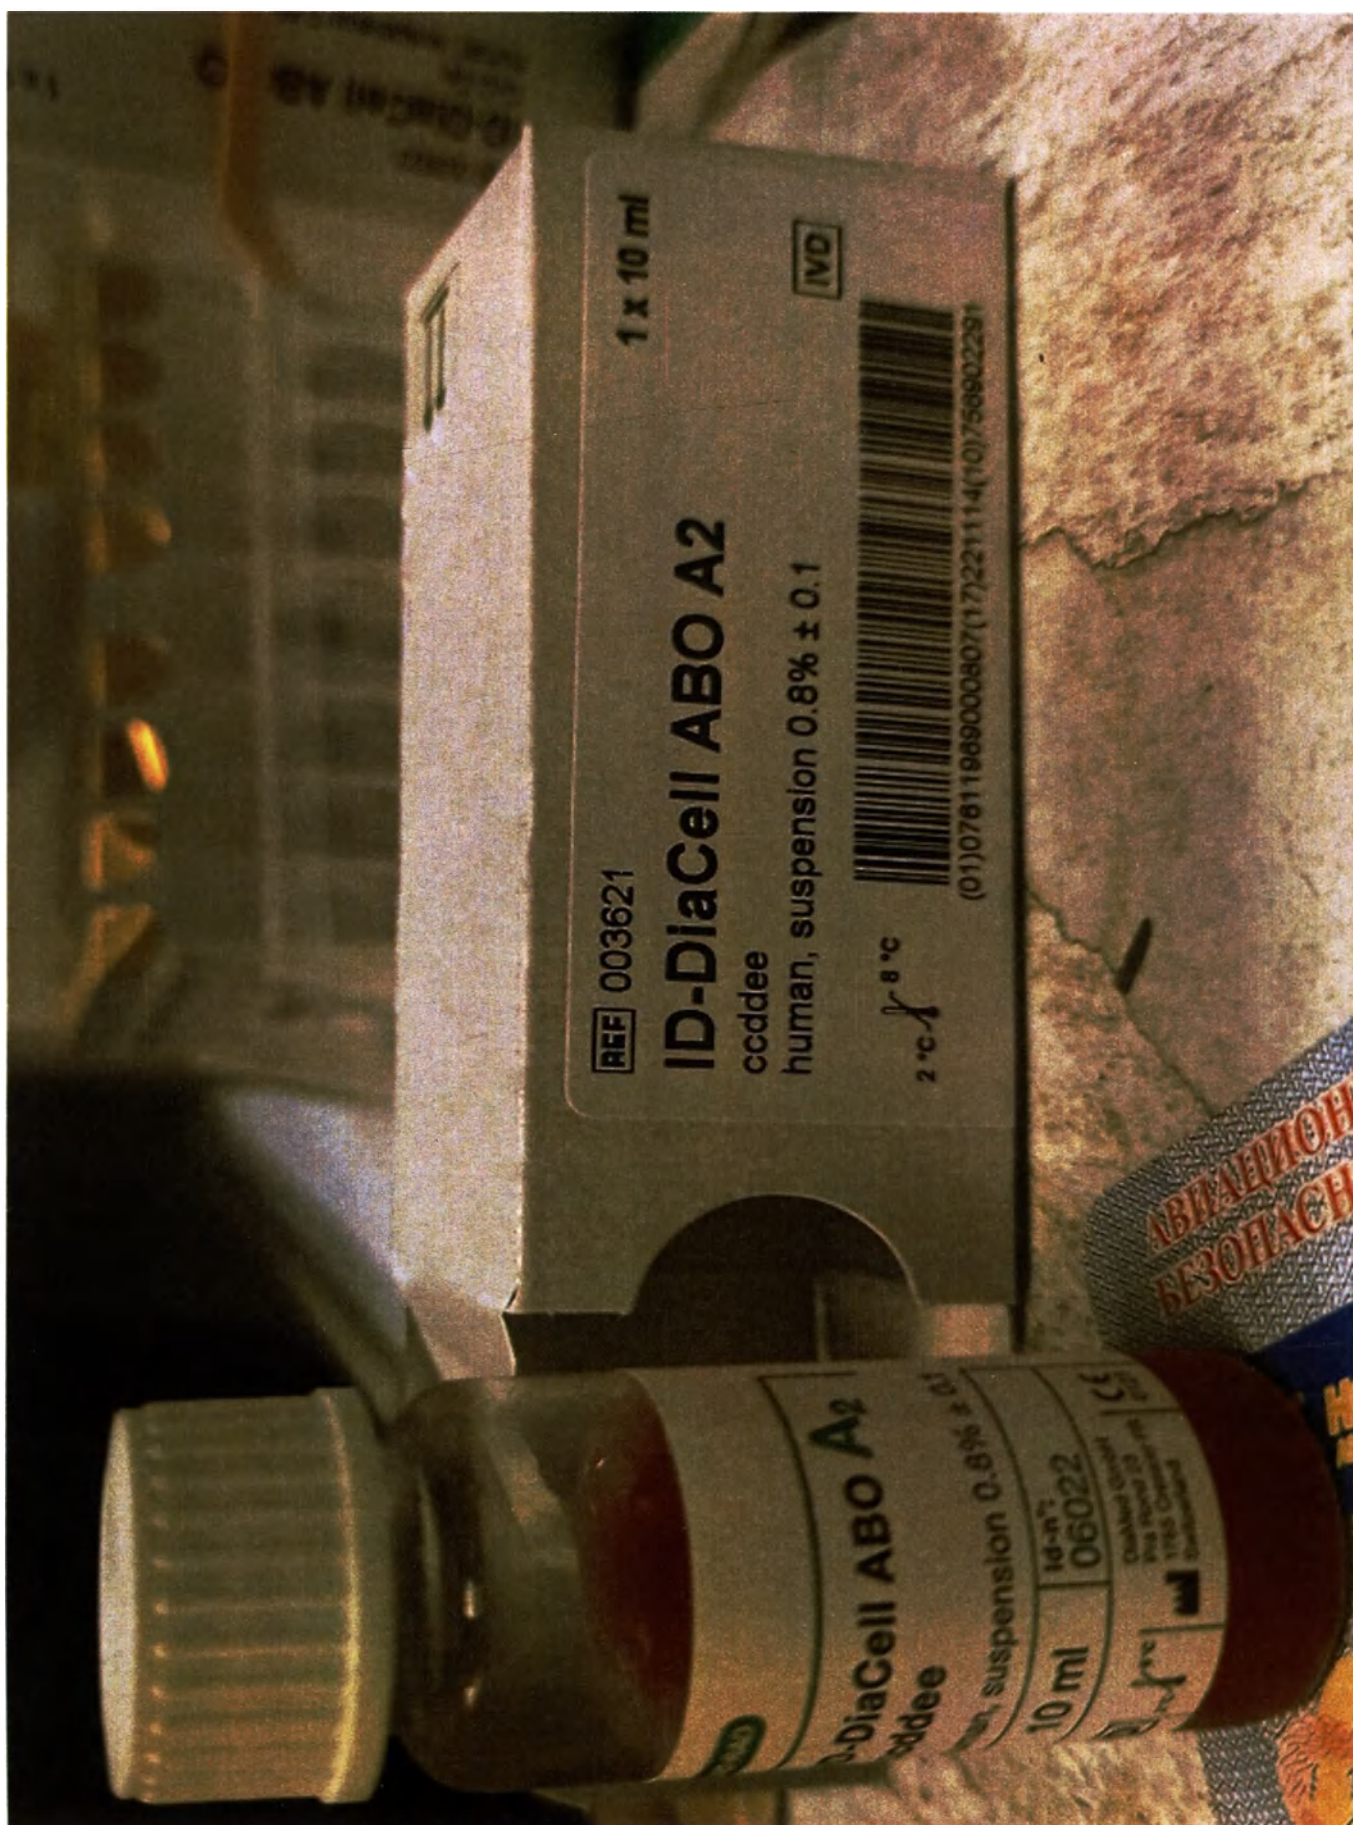

Общий вид на фоне коробки

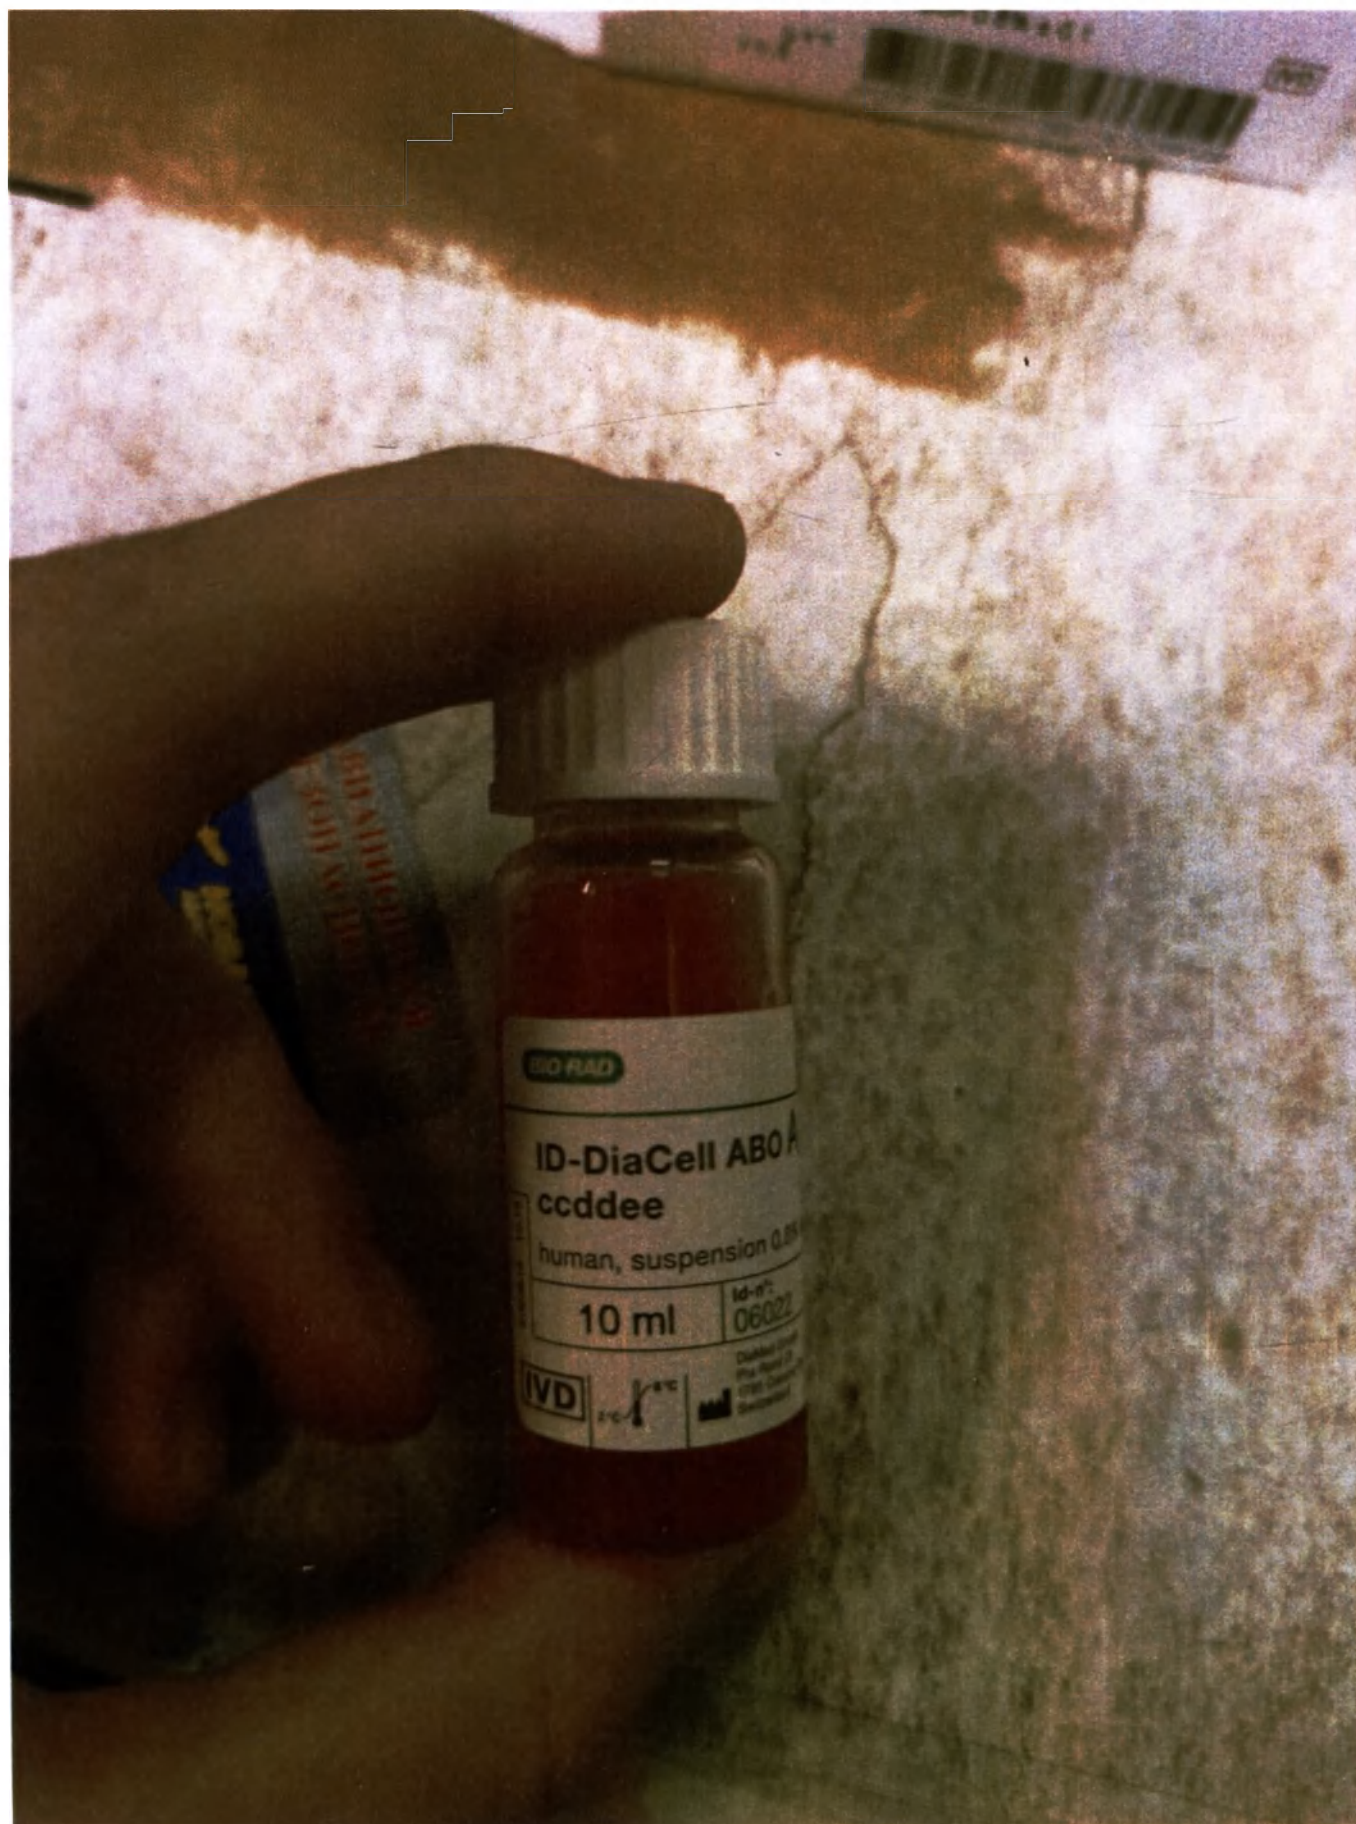

Общий вид флакона со всех сторон

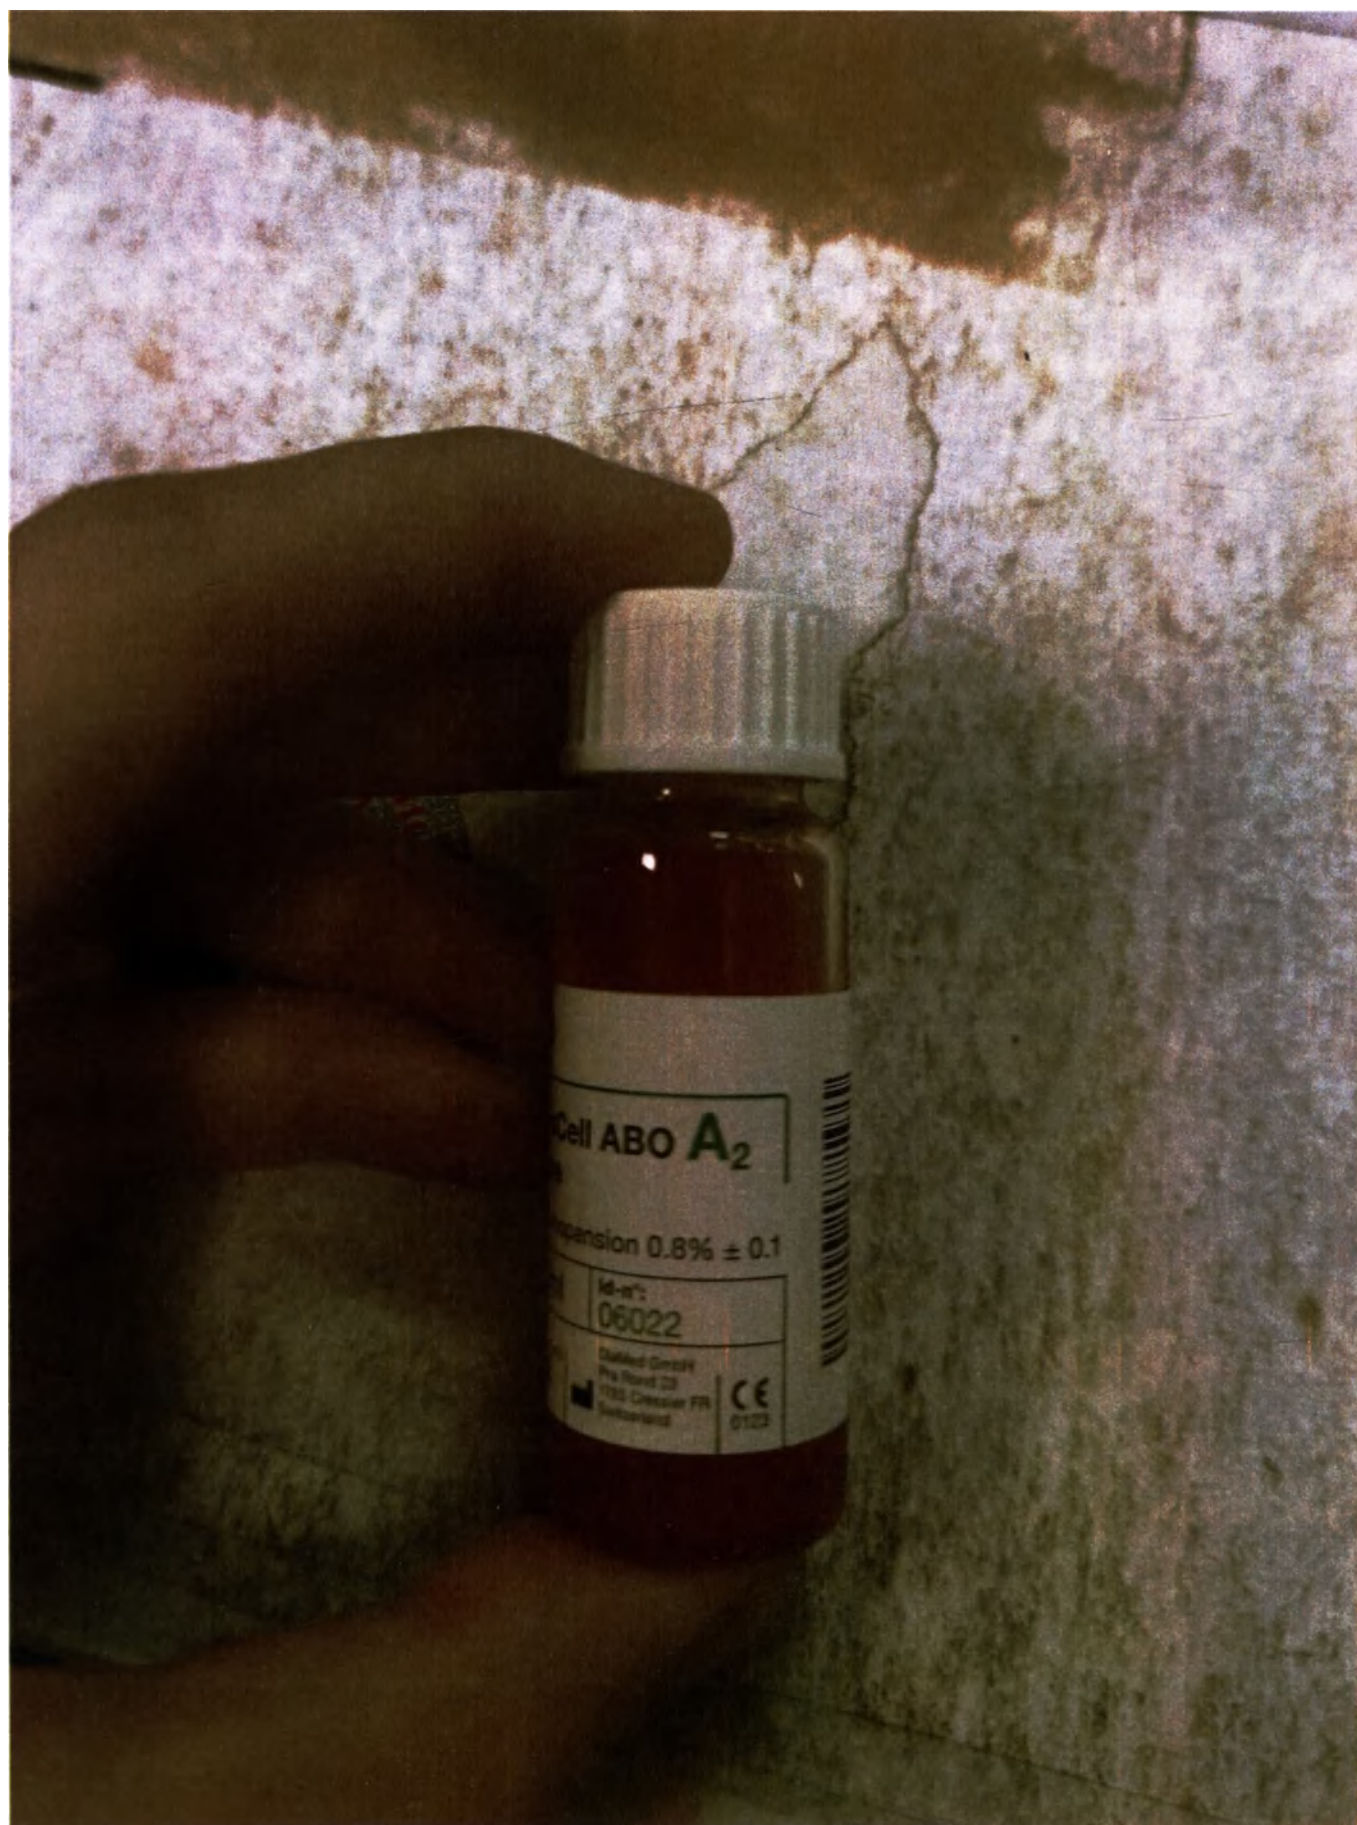


Общий вид флакона со всех сторон



Общий вид флакона со всех сторон

Общий вид коробки со всех сторон, сторона 1

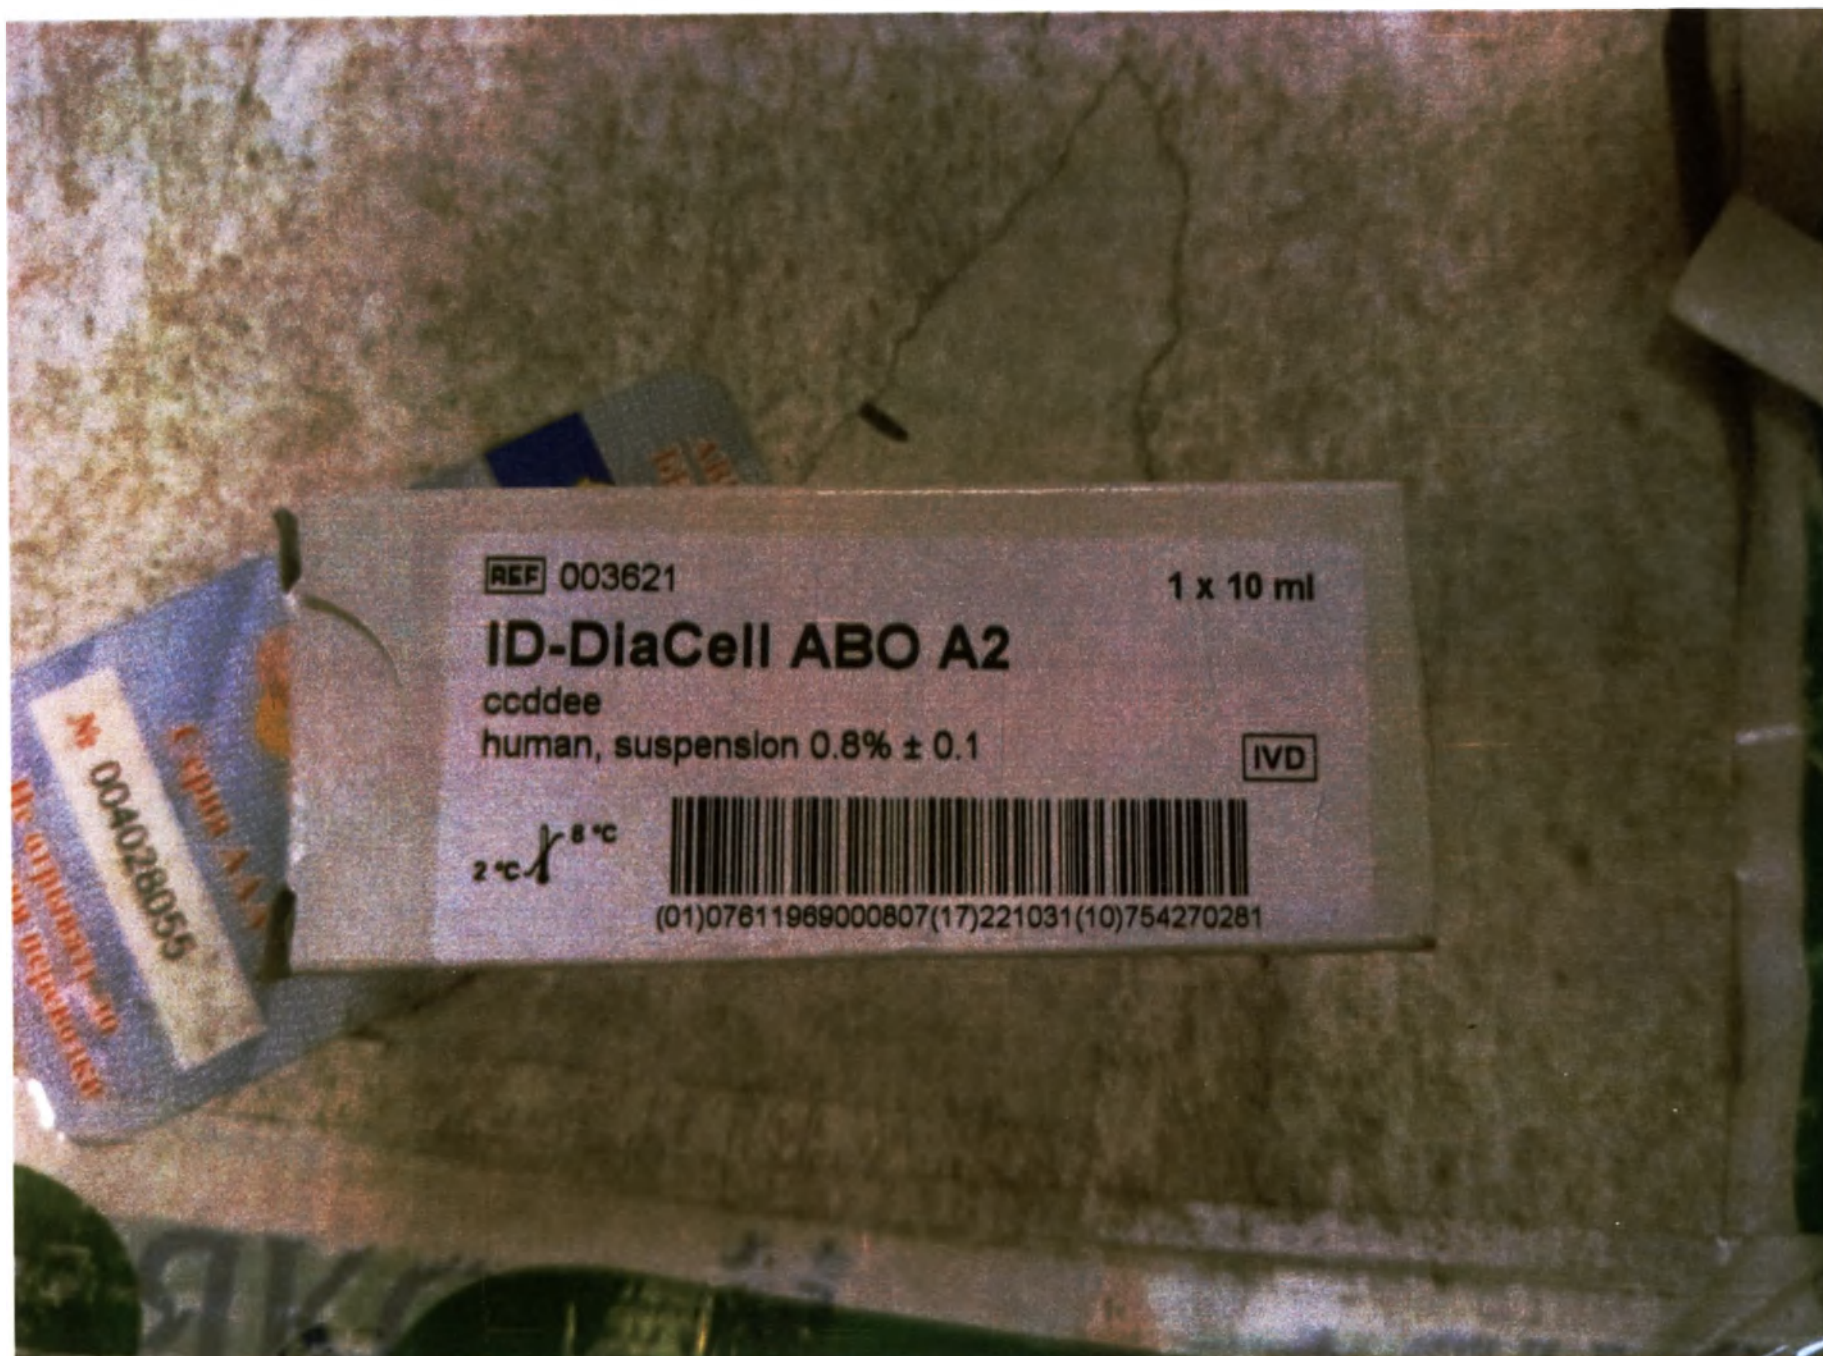



Общий вид коробки со всех сторон, сторона 2



Общий вид коробки со всех сторон, сторона 3



Общий вид коробки со всех сторон, сторона 4

ВАНЕ И СКРЕПЛЕНО

9 листа (ов)

БИО-РАД
LABORATORII
БИО-РАД
LABORATORII
МОСКВА