

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ПРОФИТ ФАРМ»
А.Ю. Осипцев





Фотографические изображения общего вида, фотографические изображения упаковки и макета маркировки медицинского изделия

Соединитель для стерильного соединения пластиковых магистралей


по ТУ 32.50.13-006-18833344-2021

2021 г.

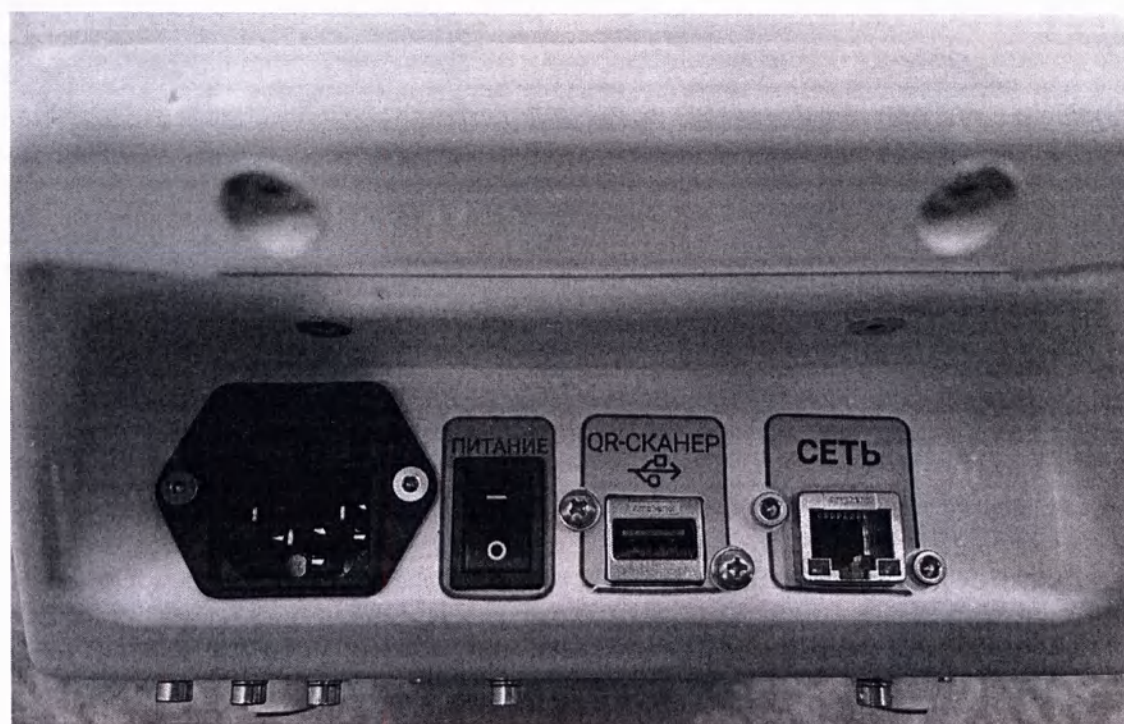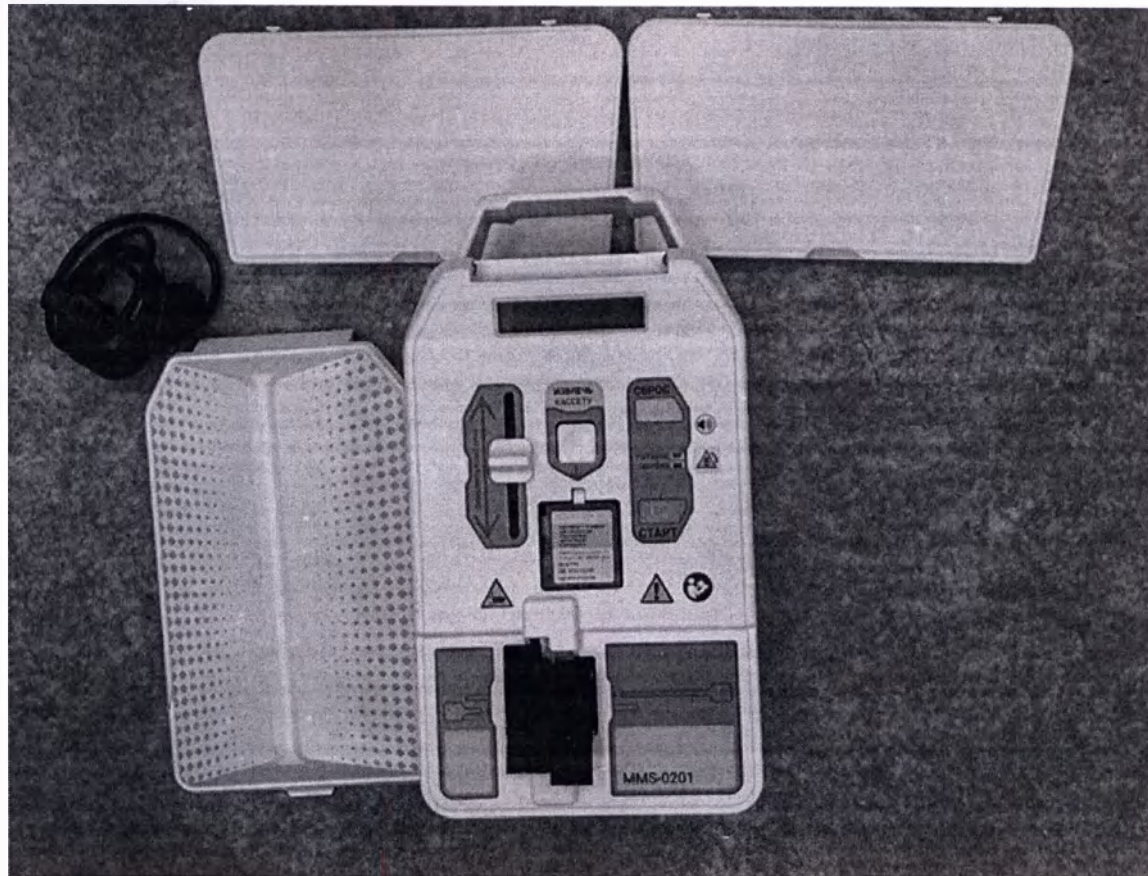



Пласскогупцы

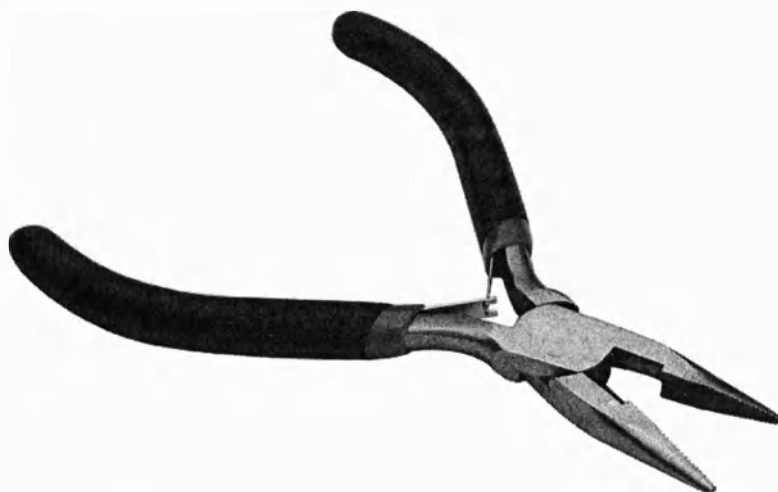

Отвертка



наименование изделия	Соединитель для стерильного соединения пластиковых магистралей стерильный по ТУ 32.50.13-006-18833344-2021, в составе: Соединитель для стерильного соединения пластиковых магистралей – 1 шт.; Сетевой шнур питания – 1 шт.; Сканер штрих-кодов – 1 шт.; Отвертка шлицевая – 1 шт.; Плоскогубцы – 1 шт.; Руководство по эксплуатации – 1 шт. Паспорт – 1 шт.		
код партии (серии)			
наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак	ООО «ПРОФИТ ФАРМ», 123154, г. Москва, бул. Генерала Карбышева, д. 8, стр. 4		
Месяц и год упаковывания	...-....		
Условия хранения и транспортирования	Условия транспортирования изделий должны соответствовать: температура – от минус 5°С до плюс 35°С; относительная влажность – от 80% при температуре 25 °С; атмосферное давление – от 70 кПа до 106 кПа. Хранение АППАРАТА у изготовителя и потребителя должно осуществляться в оригинальной упаковке производителя в соответствии с условиями хранения: температура – от минус 5°С до плюс 35°С; относительная влажность – от 80% при температуре 25 °С; атмосферное давление – от 70 кПа до 106 кПа.		
Масса брутто, кг			
Масса нетто, кг			
			

