

Фотографические изображения

Материал контрольный «Интеликью Контроль Специальный Иммунохимический» (InteliQ Specialty Immunoassay Control) для диагностики *in vitro* для внутрилабораторного контроля качества процедур лабораторных анализов, в вариантах исполнения, производства «Bio-Rad Laboratories, Inc.» («Био-Рад Лабораториз, Инк»), США

Материал контрольный «Интеликью Контроль Специальный Иммунохимический» (InteliQ Specialty Immunoassay Control) для диагностики in vitro для внутрилабораторного контроля качества процедур лабораторных анализов, вариант исполнения
Материал контрольный Уровень LTA, пробирка, объем 4 мл – 6 шт. (общий вид)




Материал контрольный «Интеликью Контроль Специальный Иммунохимический» (InteliQ Specialty Immunoassay Control) для диагностики in vitro для внутрилабораторного контроля качества процедур лабораторных анализов, вариант исполнения
Материал контрольный Уровень LTA, пробирка, объем 4 мл – 6 шт. (пробирки)



Специальный «Интеликью Контроль Специальный Иммунохимический» (InteliQ Specialty Control) для диагностики in vitro для внутрилабораторного контроля качества процедур анализов, вариант исполнения


Материал: контрольный Уровень 1, пробирка, объем 4 мл – 6 шт. (общий вид)

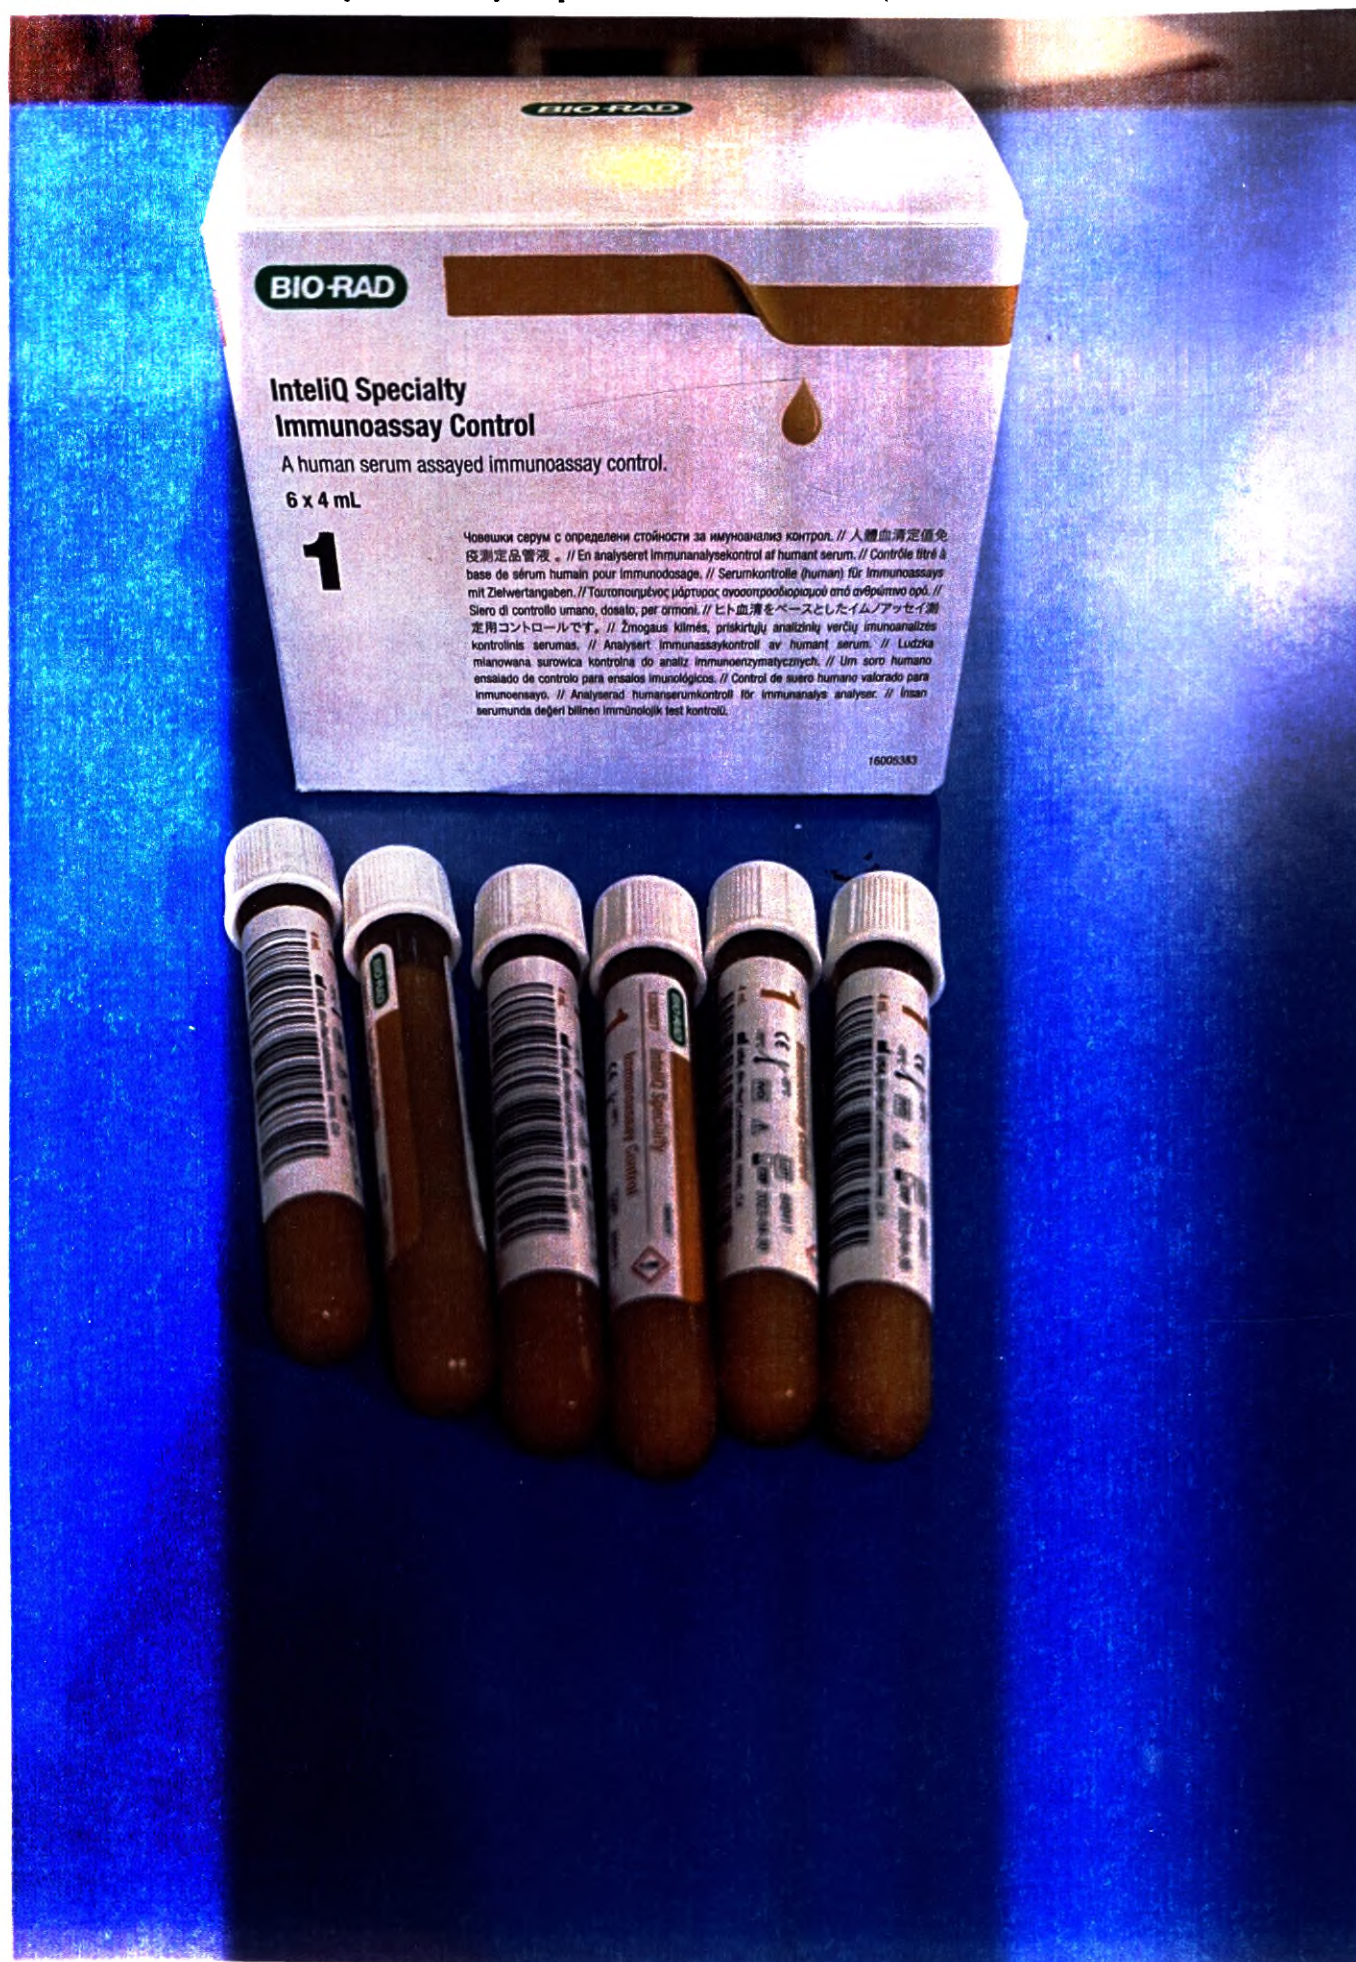

Материал контрольный «Интеликью Контроль Специальный Иммунохимический» (Specialty Immunoassay Control) для диагностики in vitro для внутрилабораторного использования процедур лабораторных анализов, вариант исполнения
Материал контрольный Уровень 1, пробирка, объем 4 мл – 6 шт. (пробирки)




Иммуноанализаторный «Интеликью Контроль Специальный Иммунохимический» (InteliQ Specialty Immunoassay Control) для диагностики in vitro для внутрилабораторного контроля качества процедур лабораторных анализов, вариант исполнения
Иммуноанализаторный Уровень 2, пробирка, объем 4 мл – 6 шт. (общий вид)

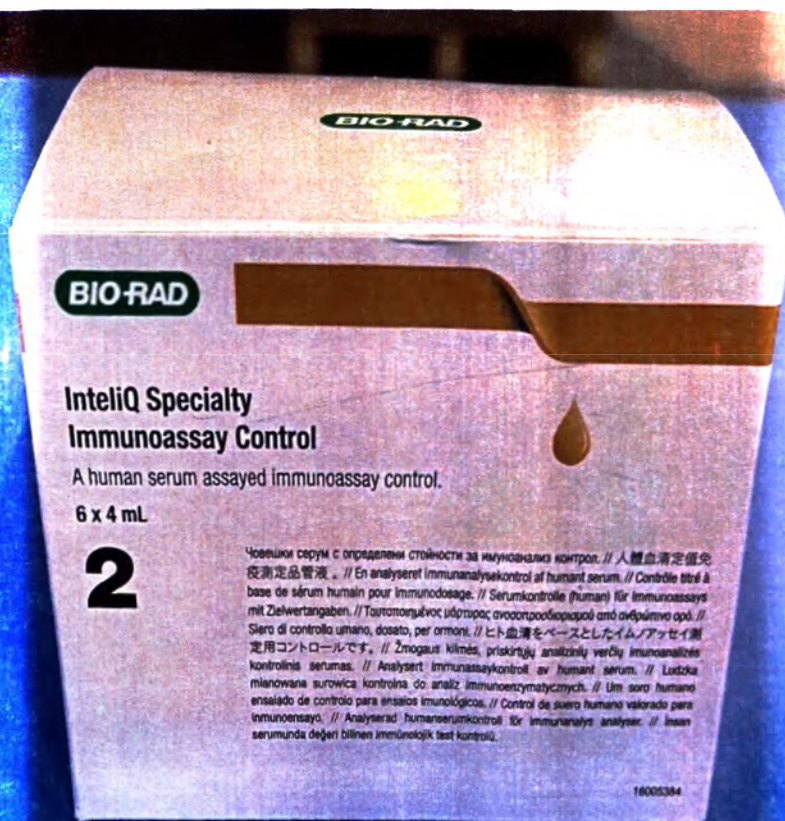

Материал контрольный - Интеллектуальный Контроль Специальный Иммунохимический (Specialty Immunoassay Control) для диагностики in vitro для внутрилабораторного использования, в качестве процедур лабораторных анализов, вариант исполнения
Материал контрольный Уровень 2, пробирка, объем 4 мл - 6 шт. (пробирки)



Материал контрольный «Интеликью Контроль Специальный Иммунохимический» (InteliQ Specialty Immunoassay Control) для диагностики in vitro для внутрилабораторного контроля качества процедур лабораторных анализов, вариант исполнения
Материал контрольный Уровень 3, пробирка, объем 4 мл – 6 шт. (пробирки)

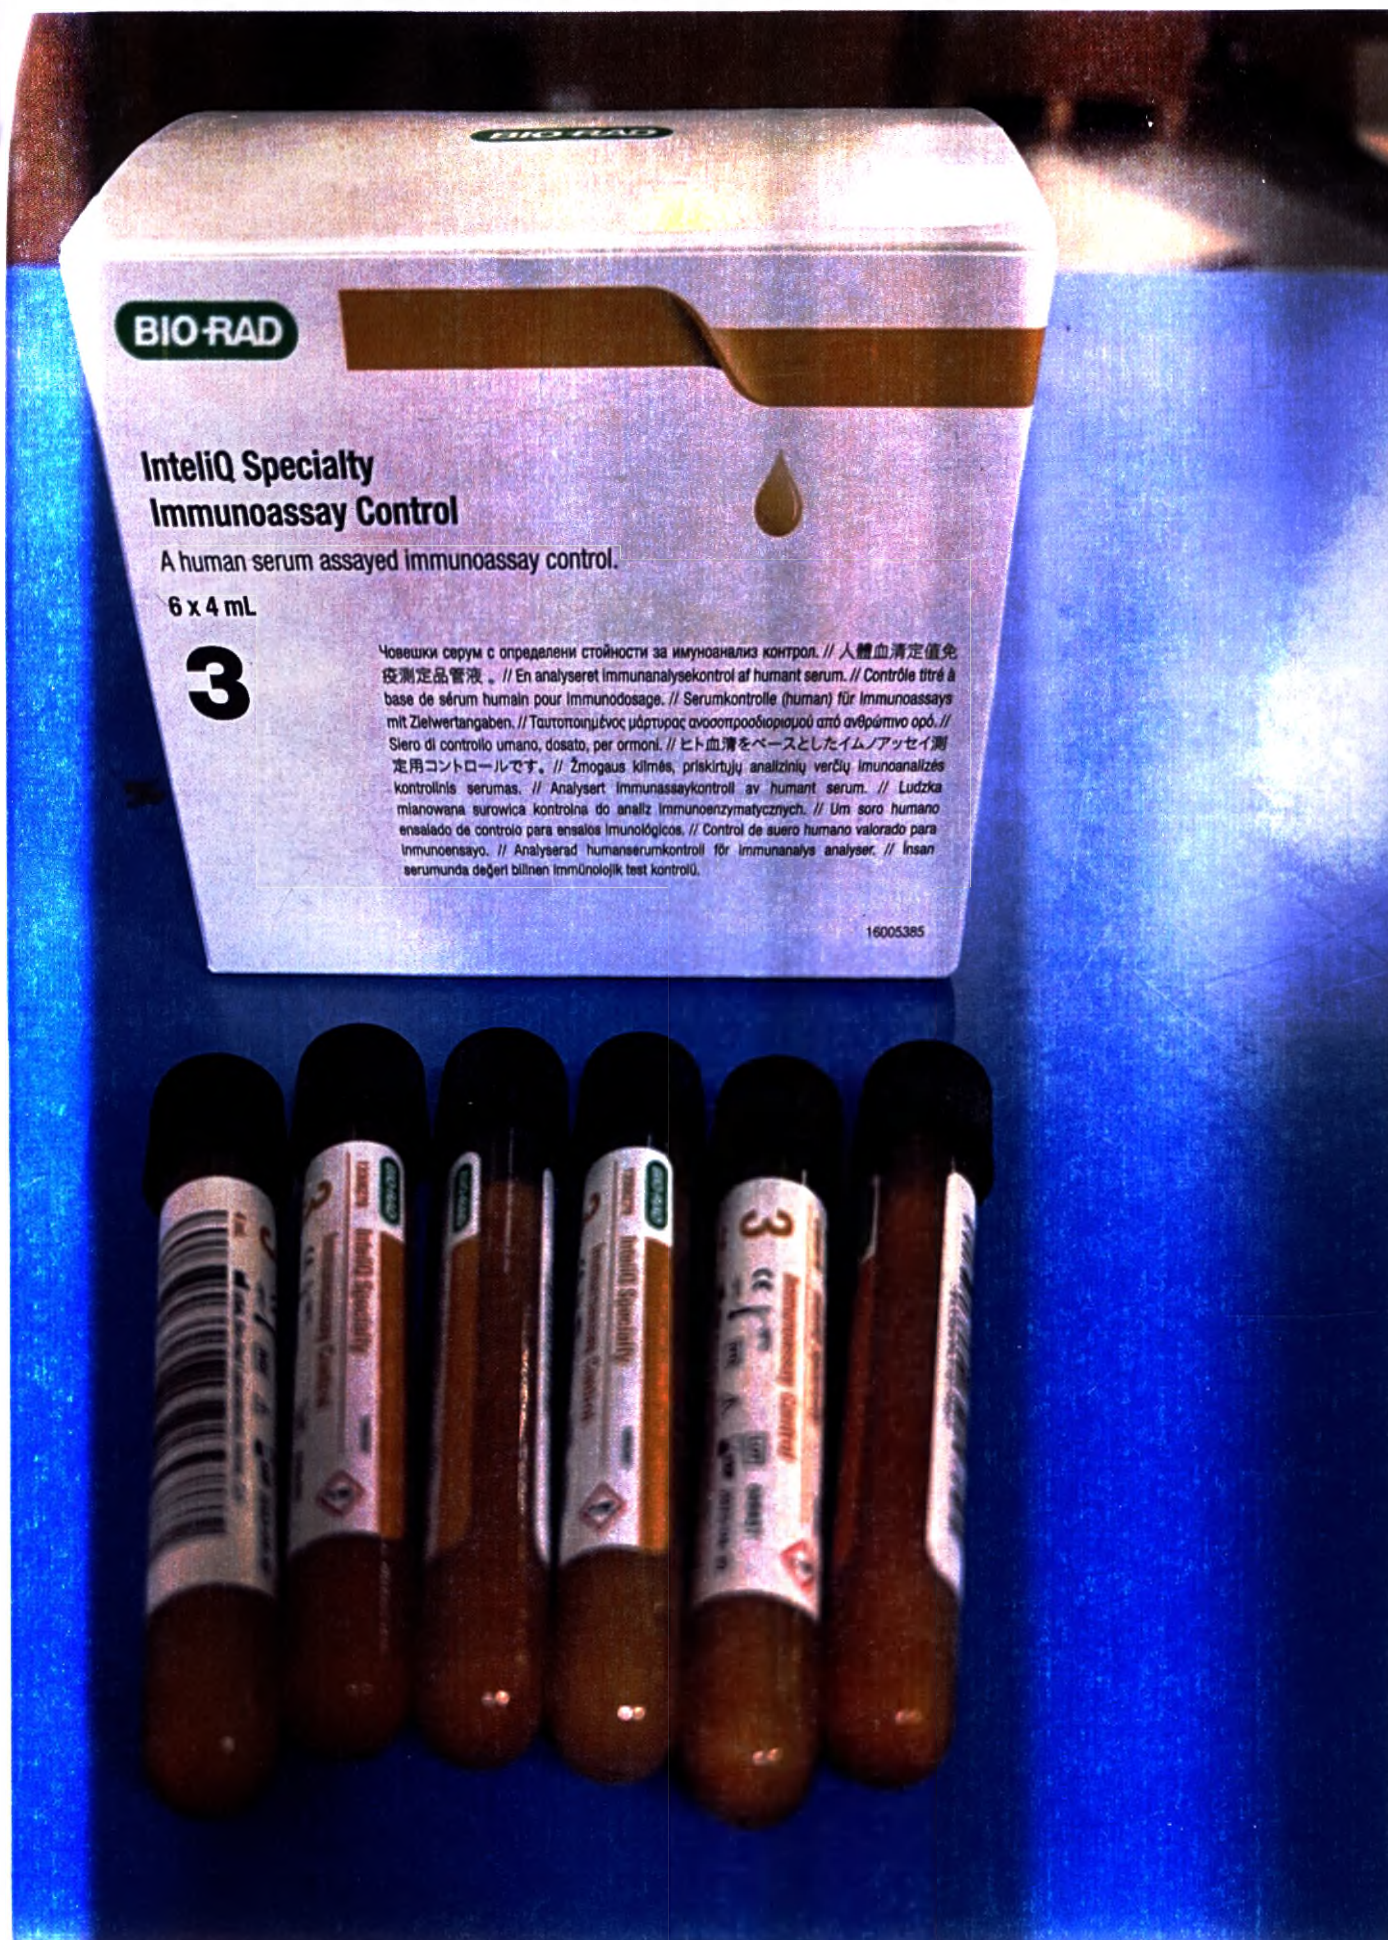

реактив «Интеллекью Контроль Специальный Иммунохимический» (InteliQ
Specialty Immunoassay Control) для диагностики in vitro для внутрилабораторного контроля
анализов, вариант исполнения
Температура хранения: +2-8 °C, пробирка, объем 4 мл – 6 шт. (пробирки)



Всего пронумеровано,
прошито и скреплено
печатью 9 листа «об»

(Генкин Д. В.)

По доверенности № 43/2021
от 03.12.2021

