

«СОГЛАСОВАНО»

Генеральный директор

ООО «ПРИМУС»

А.Г. Яковлев

«01» декабря 2024 г.



М.П.

ШАБЛОНЫ МАРКИРОВКИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки

Производитель: Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd

2024

Маркировка продукции при поставке в РФ, должна быть дополнена стикером, содержащим:

- Наименование изделия,
- Надпись: «ИЗДЕЛИЕ СТЕРИЛЬНО, НЕТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО»,
- Сведения о регистрационном удостоверении: «РУ № ____ от ЧЧ.ММ.ГГ. Срок действия: Бессрочно»
- Дата производства ()
- Надпись * Номер партии (LOT), номер по каталогу (REF), срок годности, сведения о производителе и графические символы указаны на оригинальной упаковке
- Стикер для маркировки продукции при поставке в РФ
- Данные по Уполномоченному лицу на территории Российской Федерации

Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки

ИЗДЕЛИЕ СТЕРИЛЬНО, НЕТОКСИЧНО, АПИРОГЕННО

РУ № ____ от ЧЧ.ММ.ГГ. Срок действия: Бессрочно.



XX.XX.XXXX

* Номер партии (LOT), номер по каталогу (REF), срок годности, сведения о производителе и графические символы указаны на оригинальной упаковке

Уполномоченный представитель производителя в России ООО «Примус» 192012, г. Санкт-Петербург, вн. Тер. Г. Муниципальный округ Обуховский, ул. Ново-Александровская, д. 14 литера А, помещение 45Н, офис 2, рабочее место 2, +7 902 330 94 primusooo@mail.ru

Размеры: 148 мм X 118 мм
R: 2 мм

Материал: матовая клейкая бумага (бумага с двойным дном, рулон, высота вала 148 мм)

Примечание: красный цвет - для обозначения, которое не печатается. Красные тексты должны быть напечатаны в соответствии с актуальной информацией о продукте.

■ C:70 M:5 Y:10 K:0
■ C:0 M:0 Y:0 K:15
■ C:0 M:0 Y:0 K:40
■ C:0 M:0 Y:0 K:100

148 mm
R: 2mm




GuReater®
CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System



2292

SIZE 3.0mm×36mm

RX

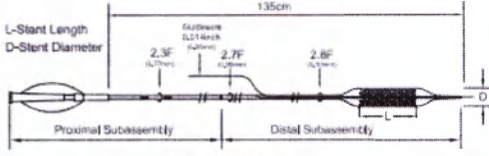

Compliance chart

Stent diameter (mm)	Pressure (mmHg)																					
	2	4	6	7	8	10	12	14	16	18	20	2	4	6	7	8	10	12	14	16	18	20
2.25	2.08	2.14	2.18	2.22	2.26	2.31	2.35	2.43	2.48	2.54	2.60	2.25	2.31	2.35	2.39	2.43	2.48	2.54	2.60	2.66	2.72	2.78
2.5	2.25	2.31	2.35	2.39	2.43	2.48	2.54	2.60	2.66	2.72	2.78	2.5	2.56	2.58	2.60	2.62	2.64	2.66	2.68	2.70	2.72	2.74
2.75	2.40	2.46	2.50	2.54	2.58	2.62	2.66	2.72	2.78	2.84	2.90	2.75	2.76	2.78	2.80	2.82	2.84	2.86	2.88	2.90	2.92	2.94
3.0	2.54	2.59	2.63	2.67	2.71	2.75	2.79	2.84	2.90	2.96	3.02	3.0	3.01	3.02	3.04	3.06	3.08	3.10	3.12	3.14	3.16	3.18
3.5	3.17	3.22	3.26	3.30	3.34	3.38	3.42	3.47	3.53	3.59	3.65	3.5	3.51	3.52	3.54	3.56	3.58	3.60	3.62	3.64	3.66	3.68
4.0	3.80	3.85	3.89	3.93	3.97	4.01	4.05	4.10	4.16	4.22	4.28	4.0	4.01	4.02	4.04	4.06	4.08	4.10	4.12	4.14	4.16	4.18
4.5	4.38	4.43	4.47	4.51	4.55	4.59	4.63	4.68	4.74	4.80	4.86	4.5	4.51	4.52	4.54	4.56	4.58	4.60	4.62	4.64	4.66	4.68

NP: Nominal Pressure
RBP: Rated Burst Pressure

Warning

- Rated Burst Pressure DO NOT EXCEED.

Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.
No. 27 Chaoyuan Road, Changping District, Beijing 102200, P.R. China
Tel: +86-10-80120666
Fax: +86-10-80120600
Website: en.lepumedical.com

Lepu Medical (Europe) Co., Ltd.
Ade Lestra Boulevard 36, 8448 JB, Heerlen, The Netherlands
Tel: +31-515-573399
Fax: +31-515-760200

CE-001-LA-0002.1 Rev.03

Minimum Guiding Catheter Inside Diameter: 5F/1.67mm
Maximum Guidewire Diameter: 0.014inch/0.36mm
Nominal drug amount: 1.6µg/mm²


2023-08-30

REF LPRPC3036

LOT 210851

SN 3UTFD42DG

STERILE



GuReater® CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System

(01)06936733715680

REF LPRPC3036

LOT 210851

SN 3UTFD42DG

2023-08-30

GuReater® CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System

(01)06936733715680

REF LPRPC3036

LOT 210851

SN 3UTFD42DG

2023-08-30



Клейкая этикетка учета для прикрепления к истории болезни пациента, получающего имплантат. Стикеры являются частью этикеток

Макет маркировки на внешней упаковке и пакете из алюминиевой фольги
размеры: 226.5mm X 196.5mm R:4mm

Материал: матовая клейкая бумага (бумага с двойным дном, рулон, высота вала 196,5 мм).

Примечание. Серый цвет обозначает серебро, а красный - обозначение, которое не подлежит печати. Красные тексты должны быть напечатаны в соответствии с актуальной информацией о продукте

Макет маркировки на внутренней упаковке

180mm

R:4mm


GuReater®  2292
CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System

RX

3.0mm×36mm REF **LPRPC3036** LOT **210851**
2023-08-30 SN **3UTFD42DG**

GuReater®
CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System


Minimum Guiding Catheter Inside Diameter: 5F/1.67mm
Maximum Guidewire Diameter: 0.014inch/0.36mm
Nominal drug amount: 1.6µg/mm²

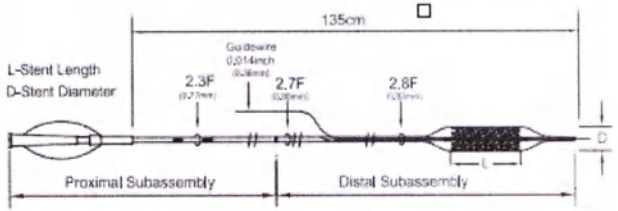

Compliance chart

Stent diameter (mm)	Pressure (mmHg)															
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
2.35	2.08	2.24	2.38	2.52	2.65	2.78	2.91	3.04	3.17	3.30	3.43	3.56	3.69	3.82	3.95	4.08
2.5	2.25	2.40	2.55	2.70	2.85	2.98	3.12	3.25	3.38	3.51	3.64	3.77	3.90	4.03	4.16	4.29
2.75	2.40	2.55	2.70	2.85	2.98	3.12	3.25	3.38	3.51	3.64	3.77	3.90	4.03	4.16	4.29	4.42
3.0	2.64	2.79	2.94	3.09	3.22	3.35	3.48	3.61	3.74	3.87	4.00	4.13	4.26	4.39	4.52	4.65
3.25	2.87	3.02	3.17	3.32	3.45	3.58	3.71	3.84	3.97	4.10	4.23	4.36	4.49	4.62	4.75	4.88
3.5	3.10	3.25	3.40	3.55	3.68	3.81	3.94	4.07	4.20	4.33	4.46	4.59	4.72	4.85	4.98	5.11
3.75	3.33	3.48	3.63	3.78	3.91	4.04	4.17	4.30	4.43	4.56	4.69	4.82	4.95	5.08	5.21	5.34
4.0	3.56	3.71	3.86	4.01	4.14	4.27	4.40	4.53	4.66	4.79	4.92	5.05	5.18	5.31	5.44	5.57
4.25	3.79	3.94	4.09	4.24	4.37	4.50	4.63	4.76	4.89	5.02	5.15	5.28	5.41	5.54	5.67	5.80
4.5	4.02	4.17	4.32	4.47	4.60	4.73	4.86	4.99	5.12	5.25	5.38	5.51	5.64	5.77	5.90	6.03

NP: Nominal Pressure RBP: Rated Burst Pressure

STERILE  **Warning** • Rated Burst Pressure DO NOT EXCEED.

Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd.
No. 37 Chaoqian Road, Changping District, Beijing 102200, P.R. China
Tel: +86-10-80120606
Fax: +86-10-80120600
Website: en.lepu-medical.com

EC REP **Lepu Medical (Europe) Cooperative U.A.**
Abe Lenstra Boulevard 36, 8440 JB, Heerlen, The Netherlands
Tel: +31-515-573399
Fax: +31-515-750020

CE-OR-La-0001.1 Rev.03

GuReater®
CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System
REF **LPRPC3036**
LOT **210851**
SN **3UTFD42DG**
2023-08-30

GuReater®
CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System
REF **LPRPC3036**
LOT **210851**
SN **3UTFD42DG**
2023-08-30

GuReater®
CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System
REF **LPRPC3036**
LOT **210851**
SN **3UTFD42DG**
2023-08-30

90mm

30mm

Макет маркировки на внешней упаковке и пакете из алюминиевой фольги

Размеры: 226.5mm X 196.5mm R:4mm

Материал: матовая клейкая бумага (бумага с двойным дном, рулон, высота вала 196,5 мм).

Примечание. Серый цвет обозначает серебро, а красный - обозначение, которое не подлежит печати. Красные тексты должны быть напечатаны в соответствии с актуальной информацией о продукте

Описание символов, нанесенных на маркировку медицинского изделия

СИМВОЛ	ОПИСАНИЕ
	НОМЕР ПО КАТАЛОГУ
	КОД ПАРТИИ
	СРОК ГОДНОСТИ
	СТЕРИЛИЗАЦИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОКСИДА ЭТИЛЕНА
	НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОВТОРНО
	НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ УПАКОВКИ
	ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА
	ВНИМАНИЕ
	СМ. ИНСТРУКЦИЮ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
	АВТОРИЗОВАННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ЕВРОПЕЙСКОМ СООБЩЕСТВЕ
	НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ
	РАСЧЕТНОЕ ДАВЛЕНИЕ РАЗРЫВА
	КАТЕТЕР БЫСТРОЙ ЗАМЕНЫ
	ФРАНЦУЗСКАЯ ШКАЛА ДИАМЕТРА КАТЕТЕРОВ
	НЕ СТЕРИЛИЗОВАТЬ ПОВТОРНО
	УСЛОВНО-БЕЗОПАСНЫЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МРТ
	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР
	ДАТА ПРОИЗВОДСТВА
	ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ
	ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ СЕ И ИД. НОМЕР УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА
	БЕРЕЧЬ ОТ СОЛНЕЧНОГО СВЕТА
	аспиринно



Генеральный директор

А.Г. Яковлев

«01» декабря 2024 г.

М.П.



Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System)

на системе доставки

Производитель: Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd

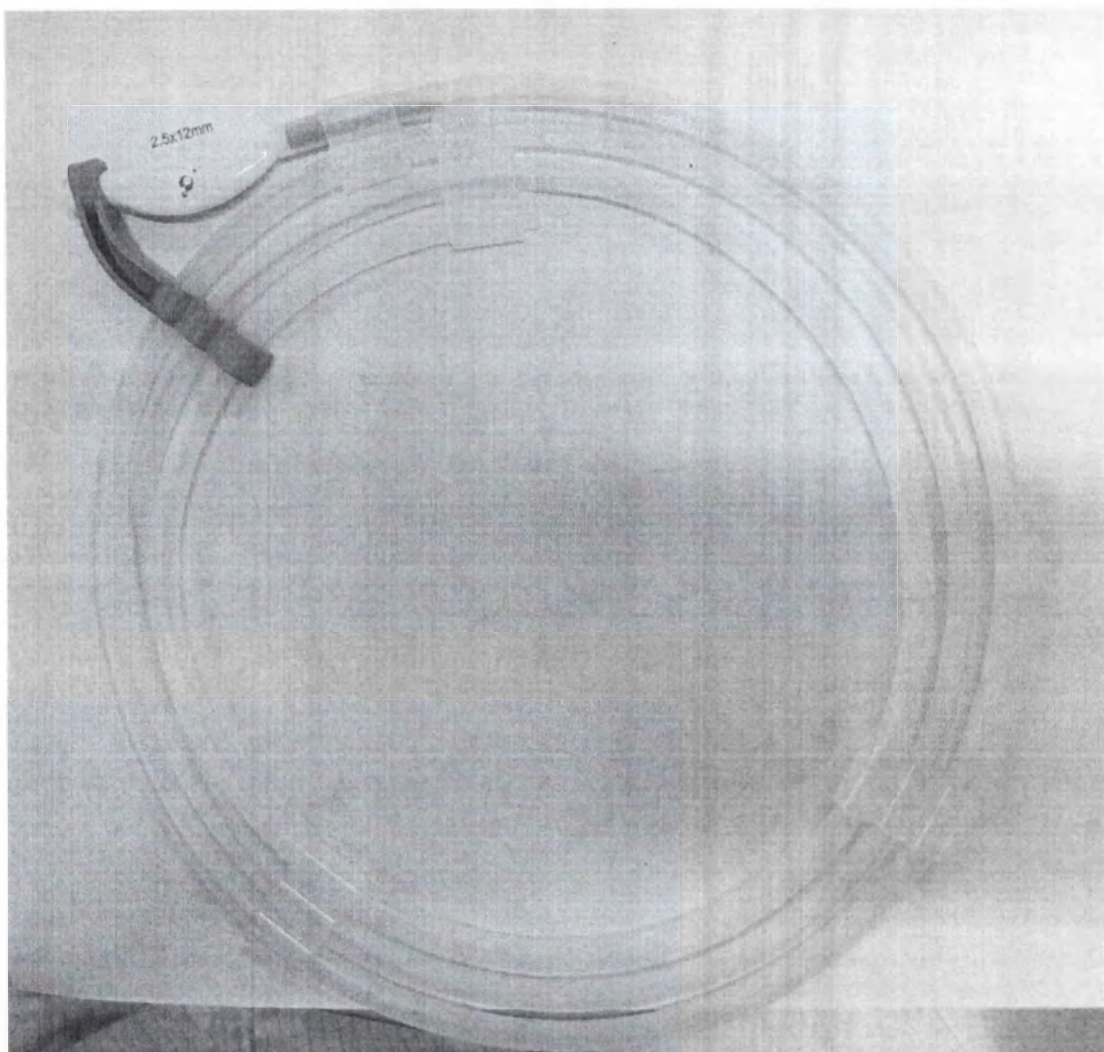


Фото 1. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC2512 длина 12 мм, диаметр 2,5 мм)

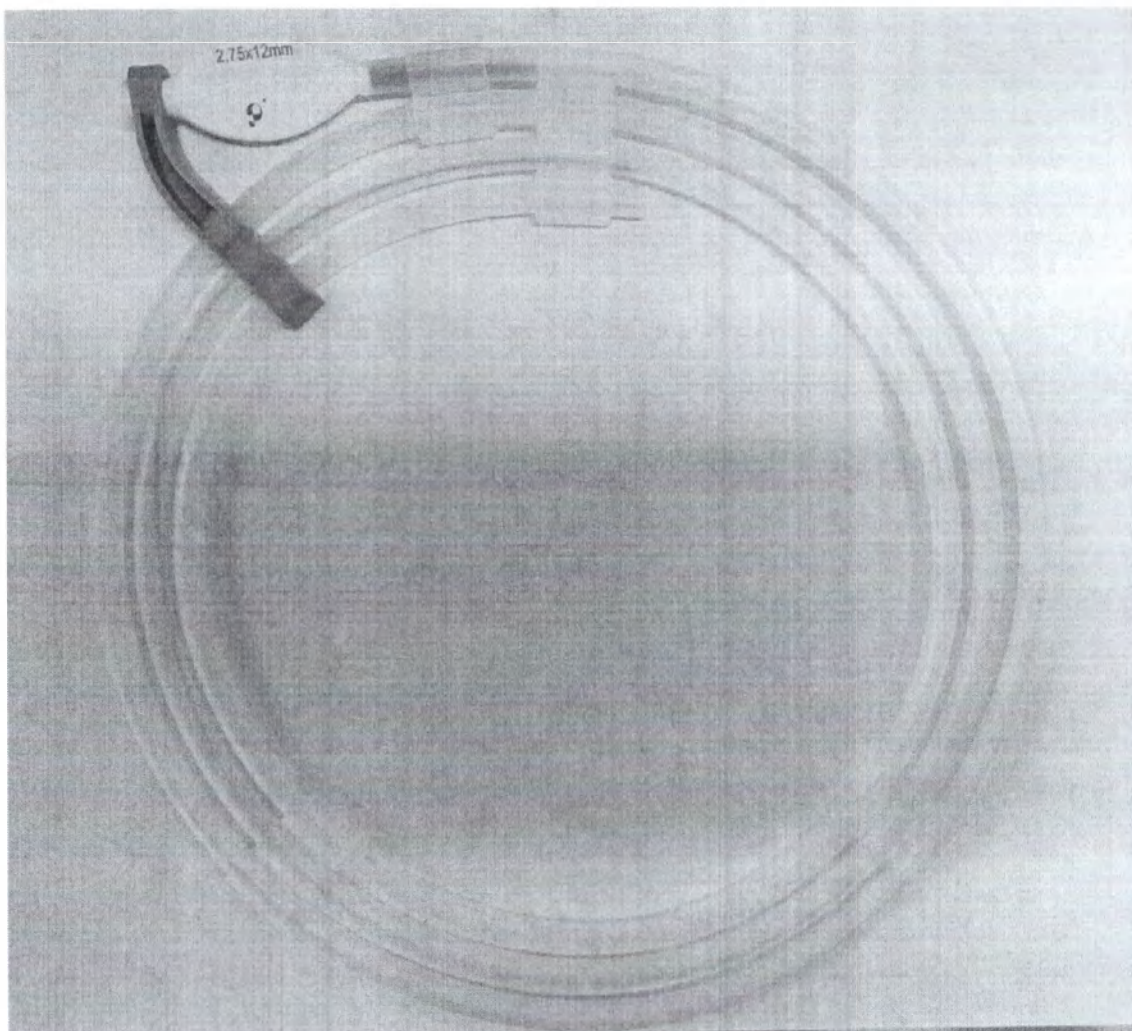


Фото 2. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC2712 длина 12 мм, диаметр 2,75 мм)

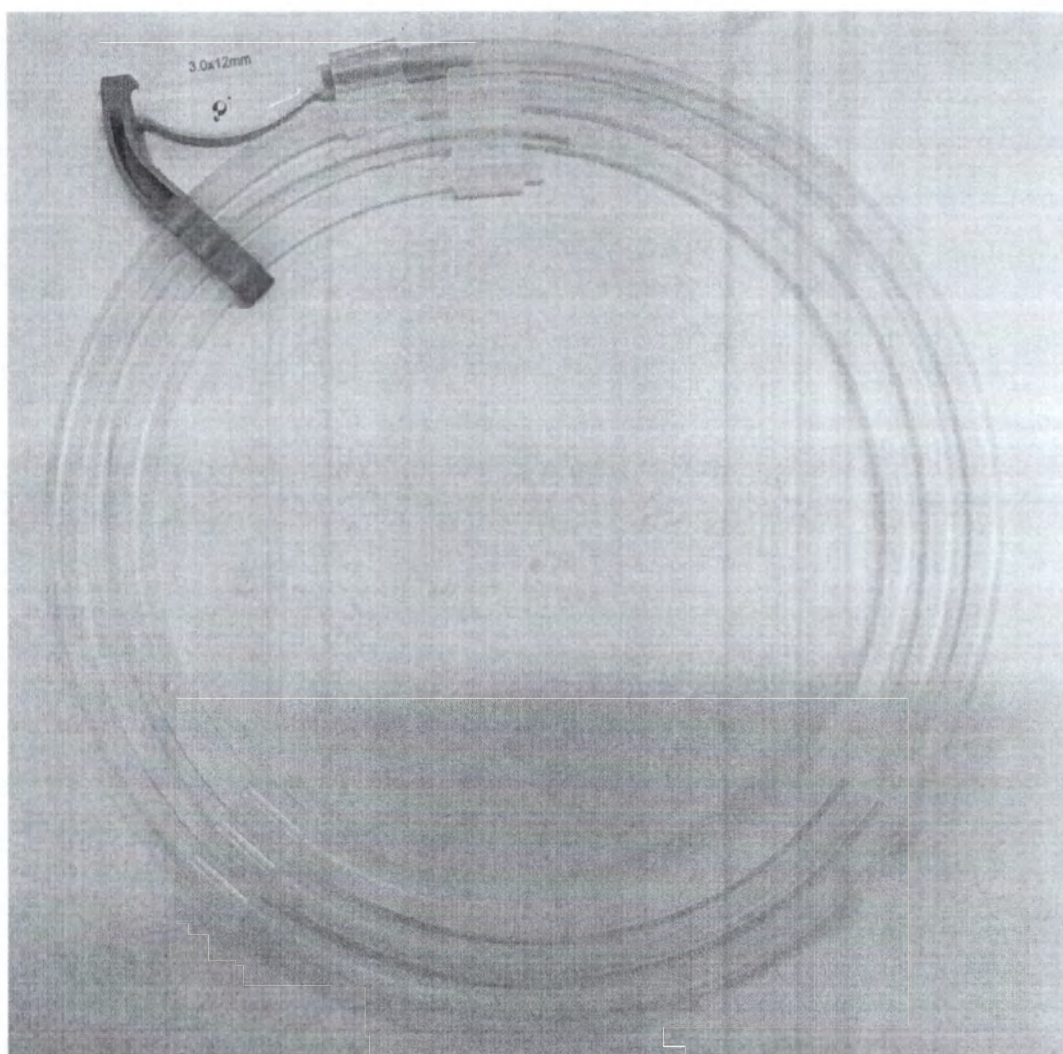


Фото 3. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC3012 длина 12 мм, диаметр 3 мм)

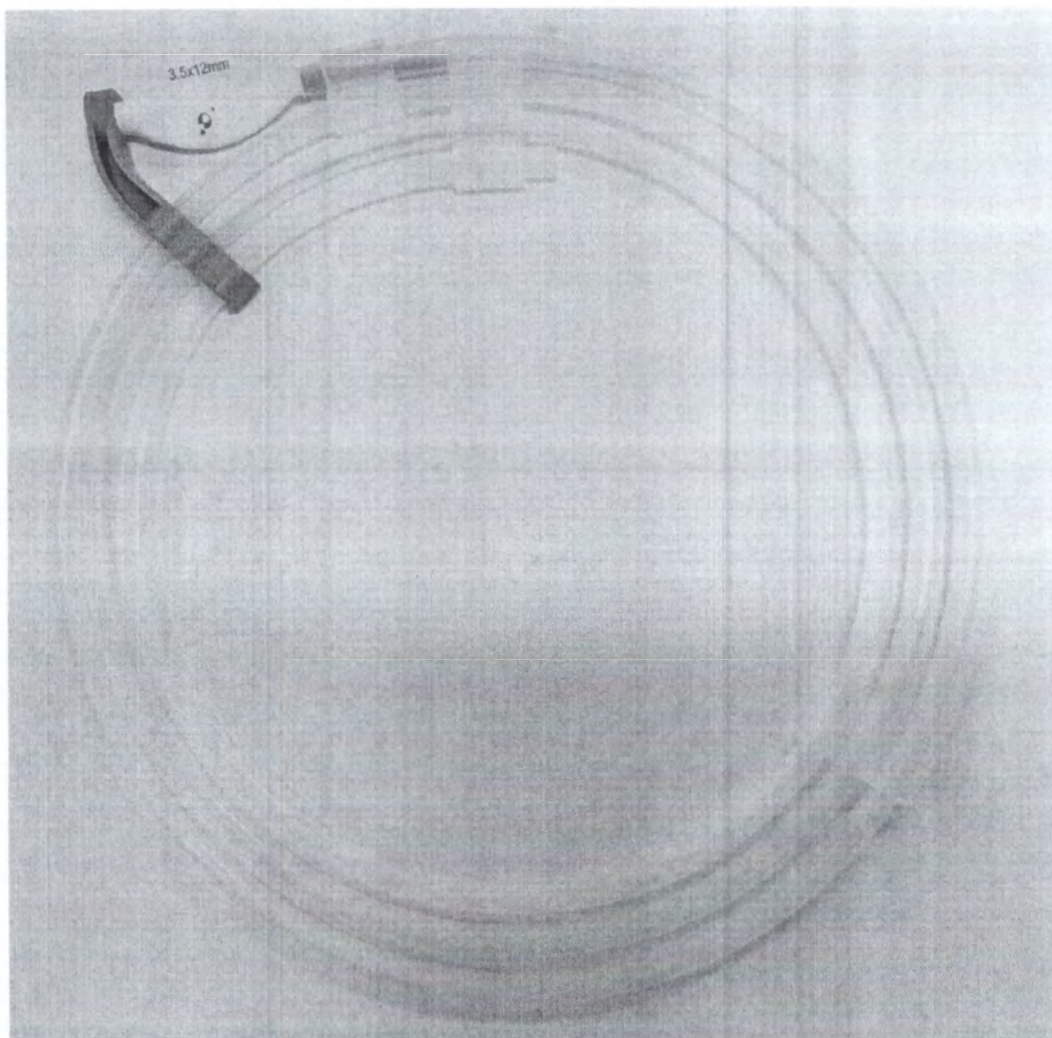


Фото 4. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC3512 длина 12 мм, диаметр 3,5 мм)

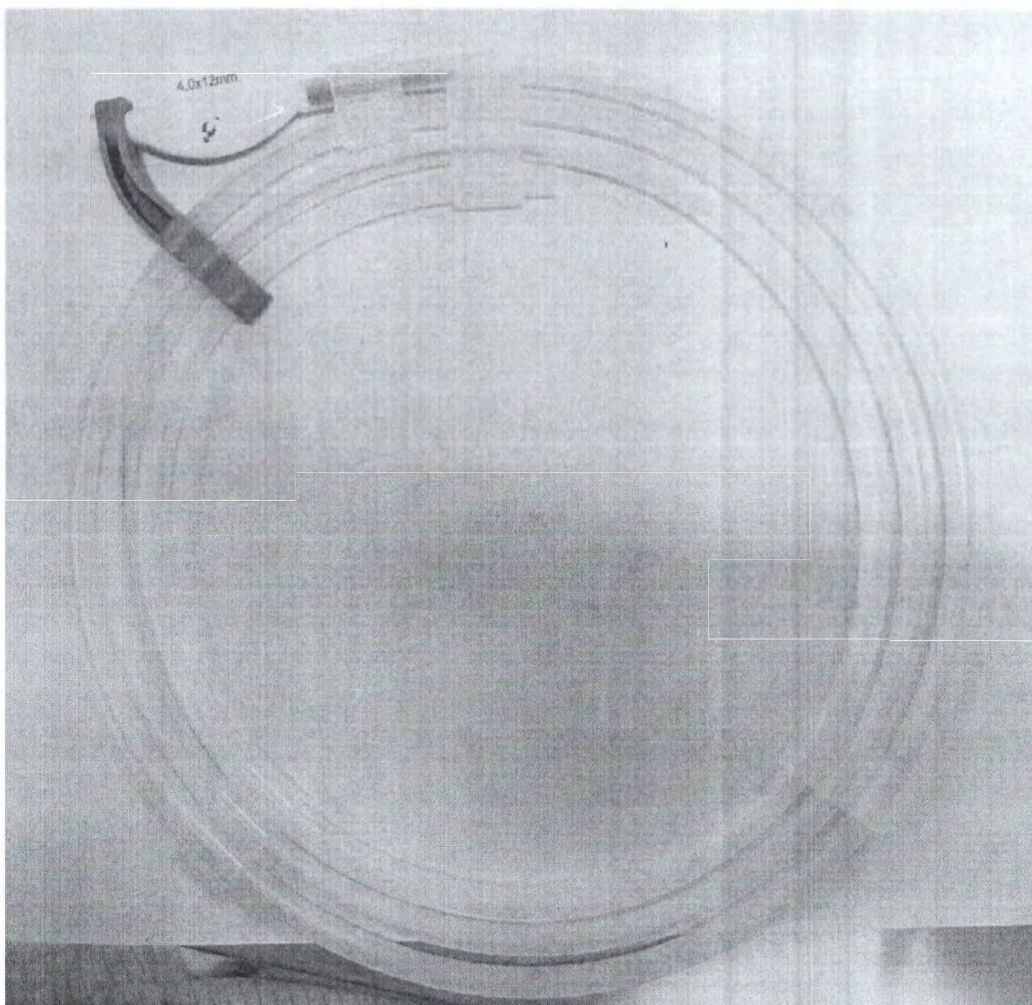


Фото 5. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC4012 длина 12 мм, диаметр 4 мм)

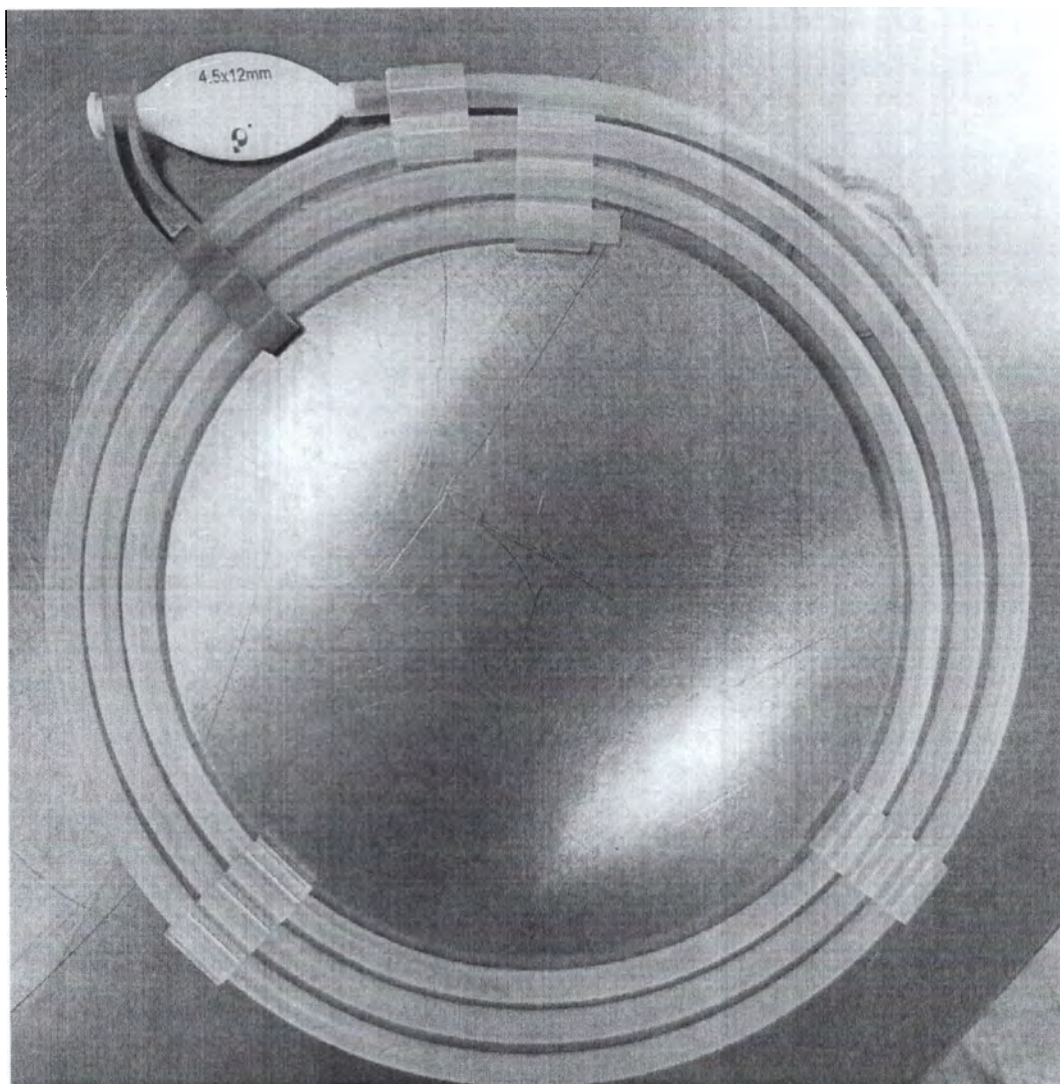


Фото 6. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC4512 длина 12 мм, диаметр 4,5 мм)

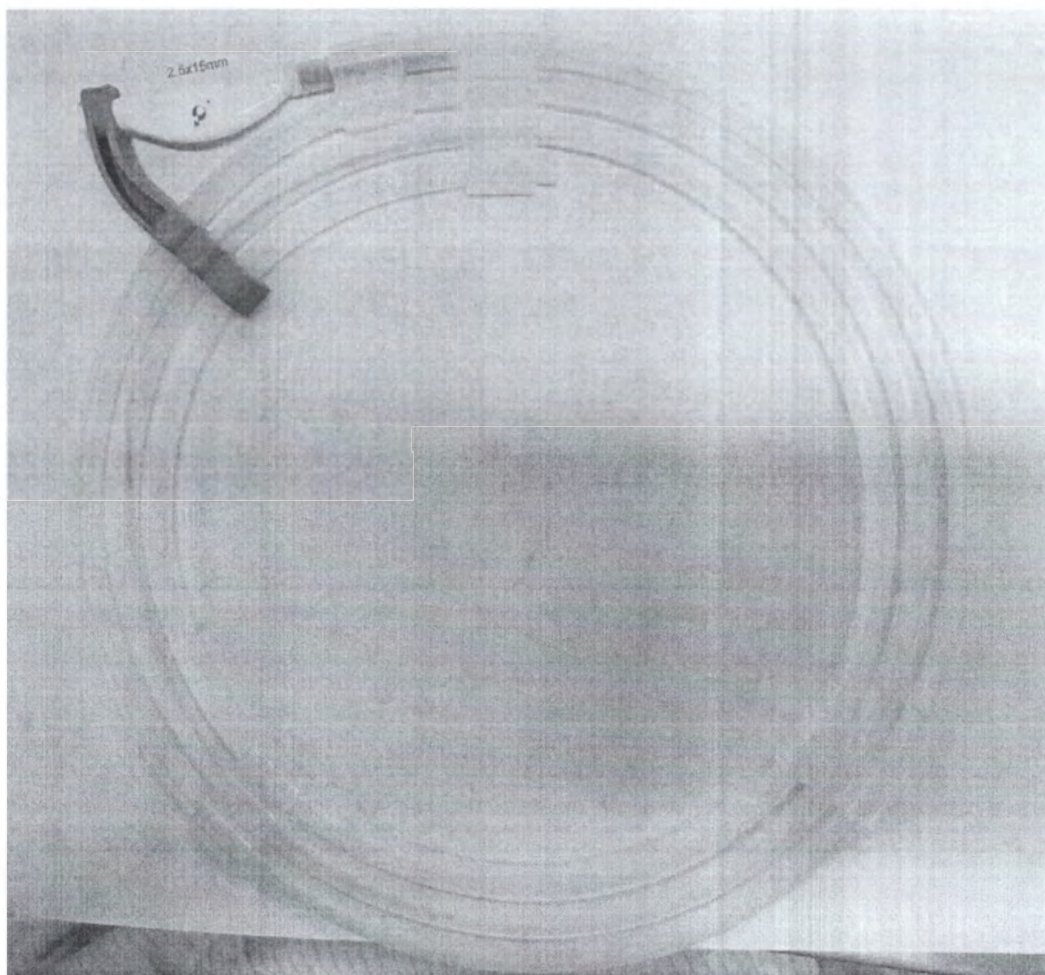


Фото 7. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC2515 длина 15 мм, диаметр 2,5 мм)

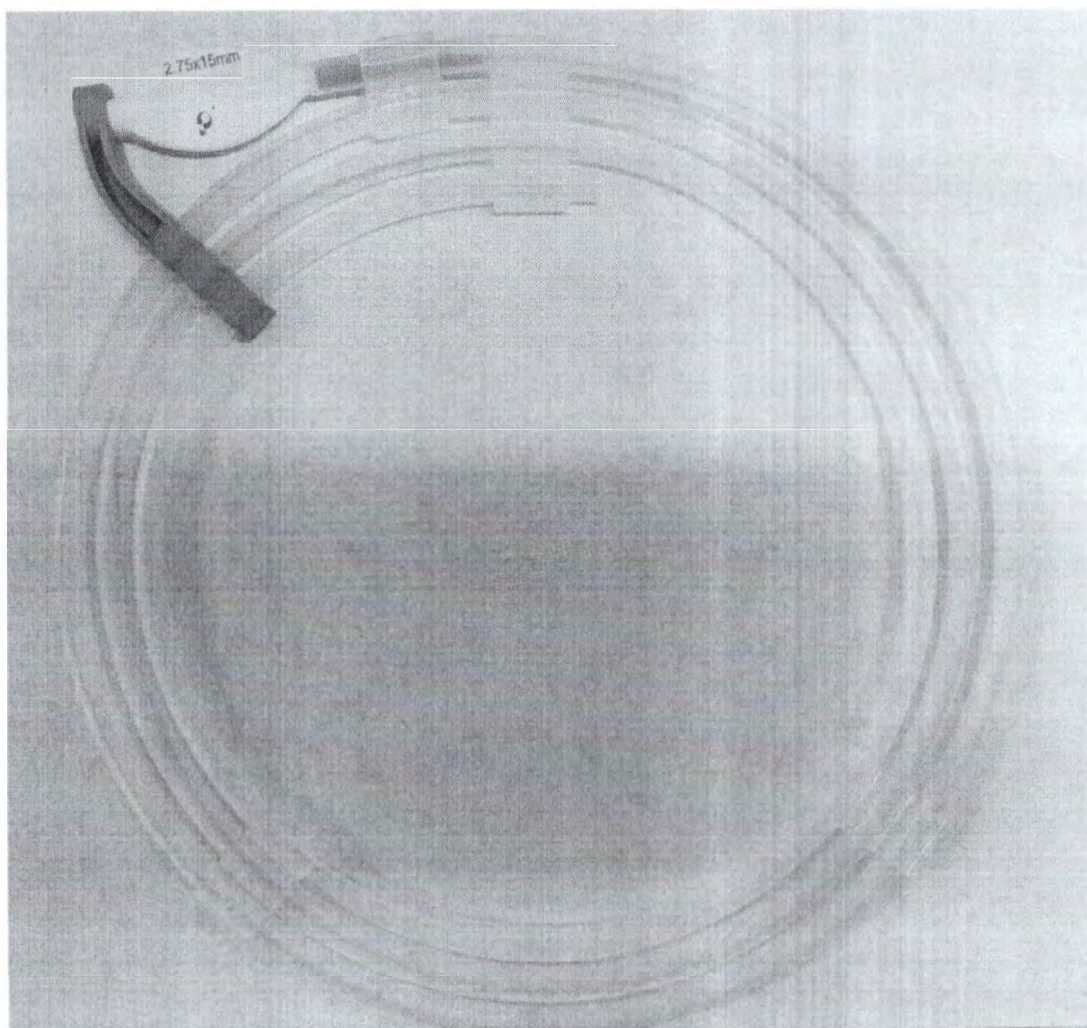


Фото 8. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC2715 длина 15 мм, диаметр 2,75 мм)

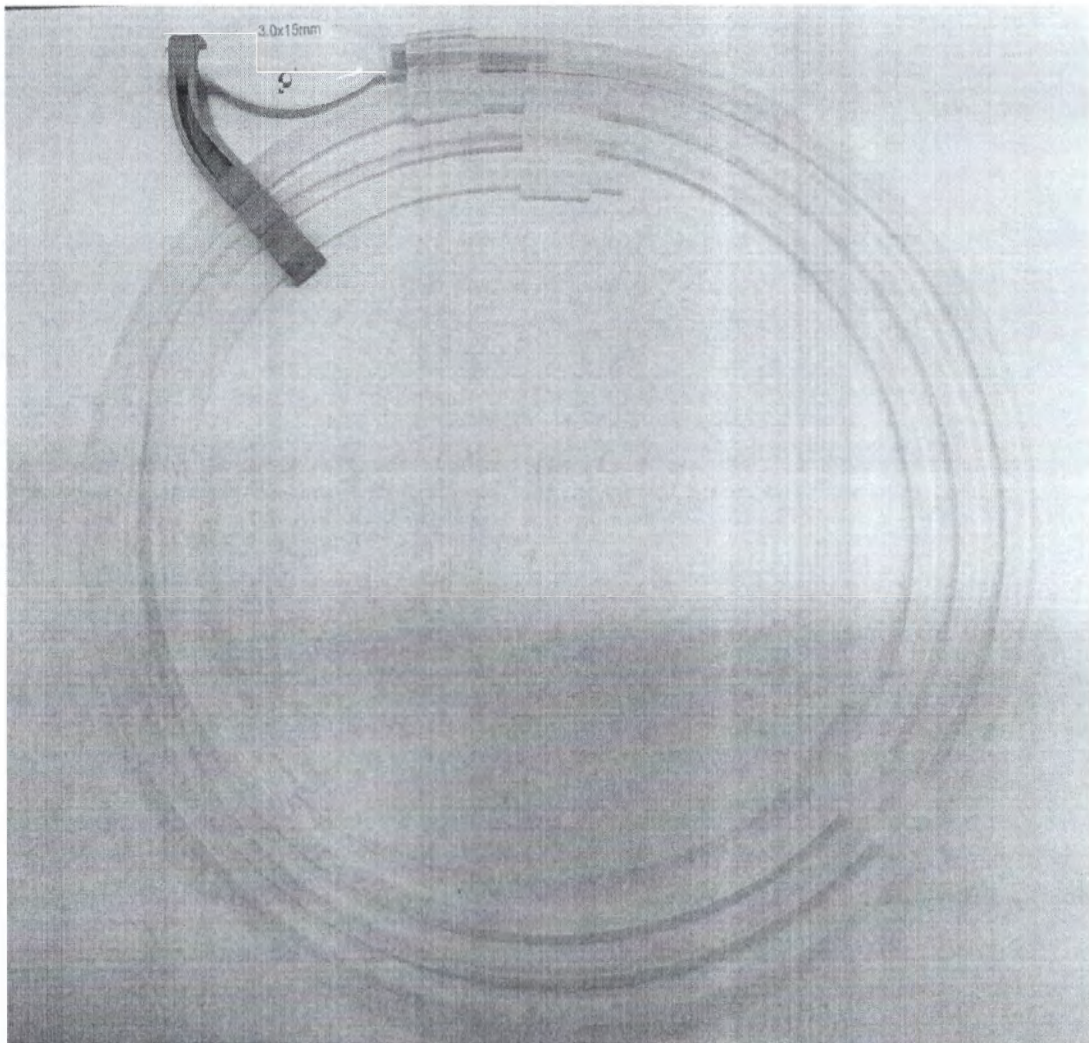


Фото 9. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC3015 длина 15 мм, диаметр 3 мм)

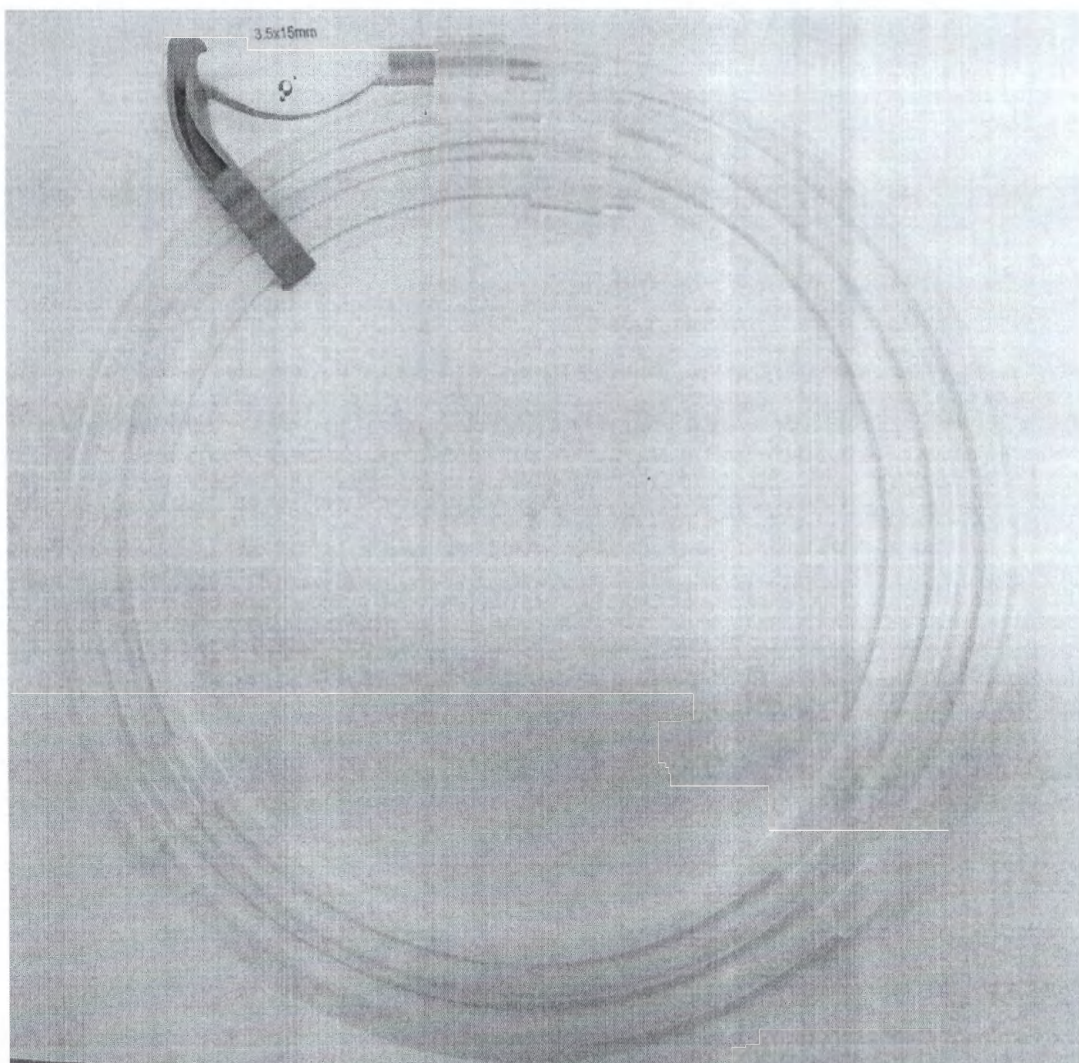


Фото 10. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC3515 длина 15 мм, диаметр 3,5 мм)

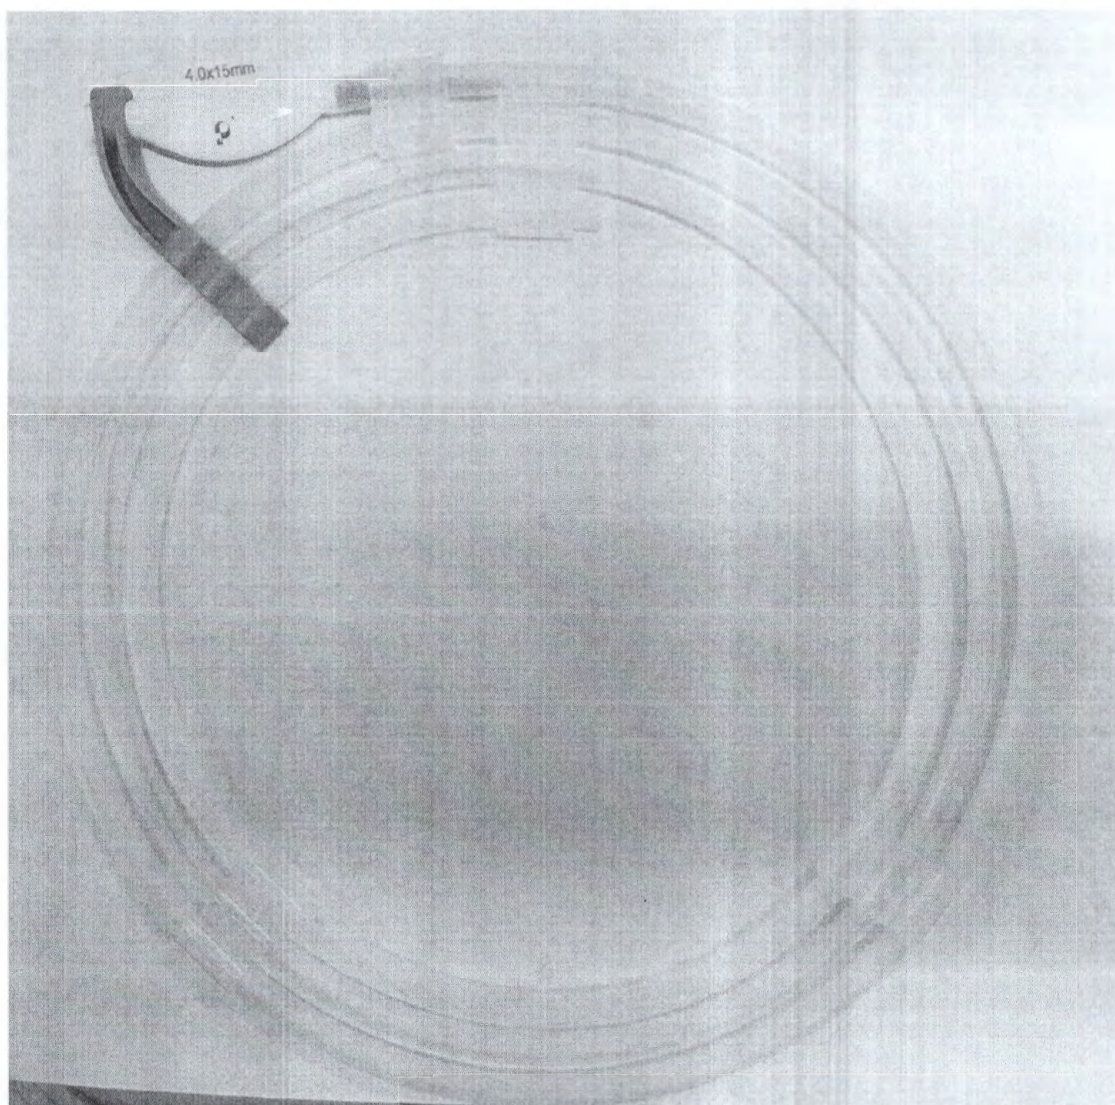


Фото 11. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC4015 длина 15 мм, диаметр 4 мм)

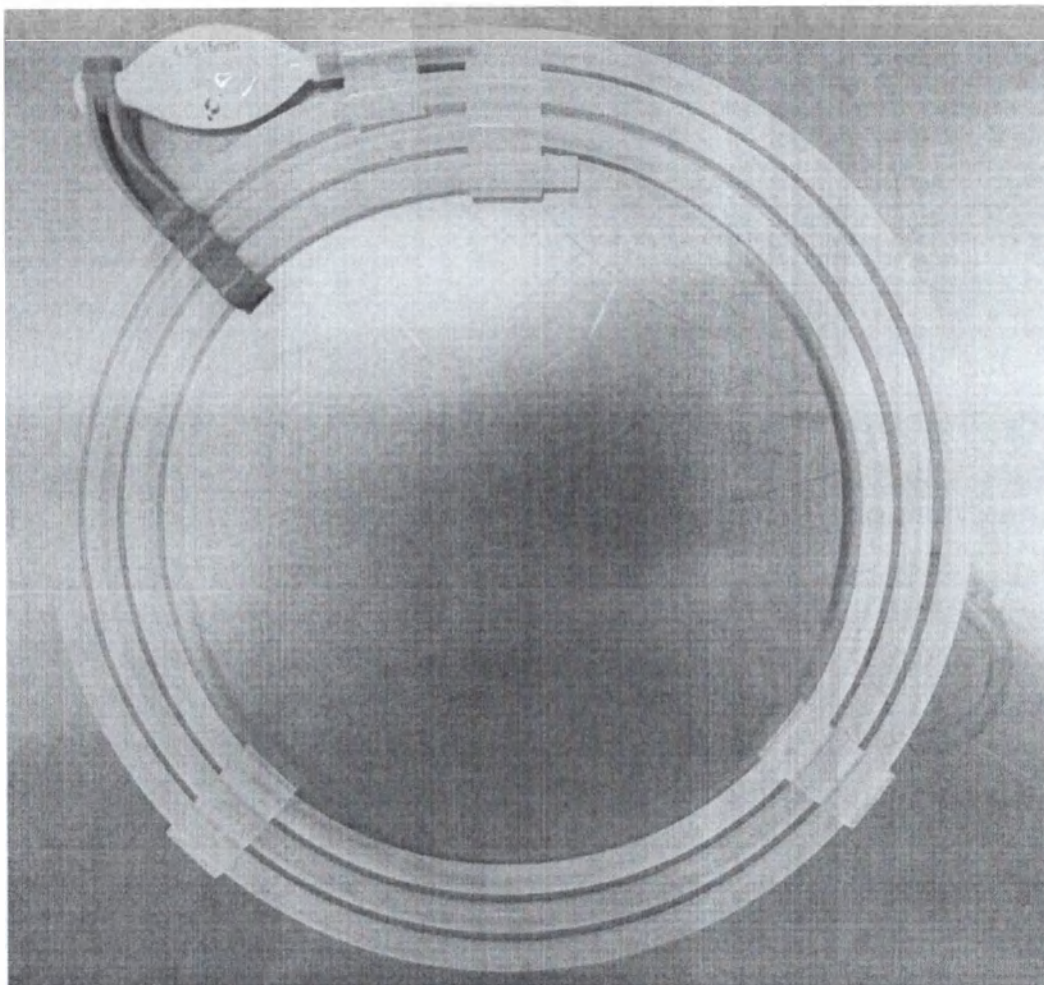


Фото 12. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC4515 длина 15 мм, диаметр 4,5 мм)

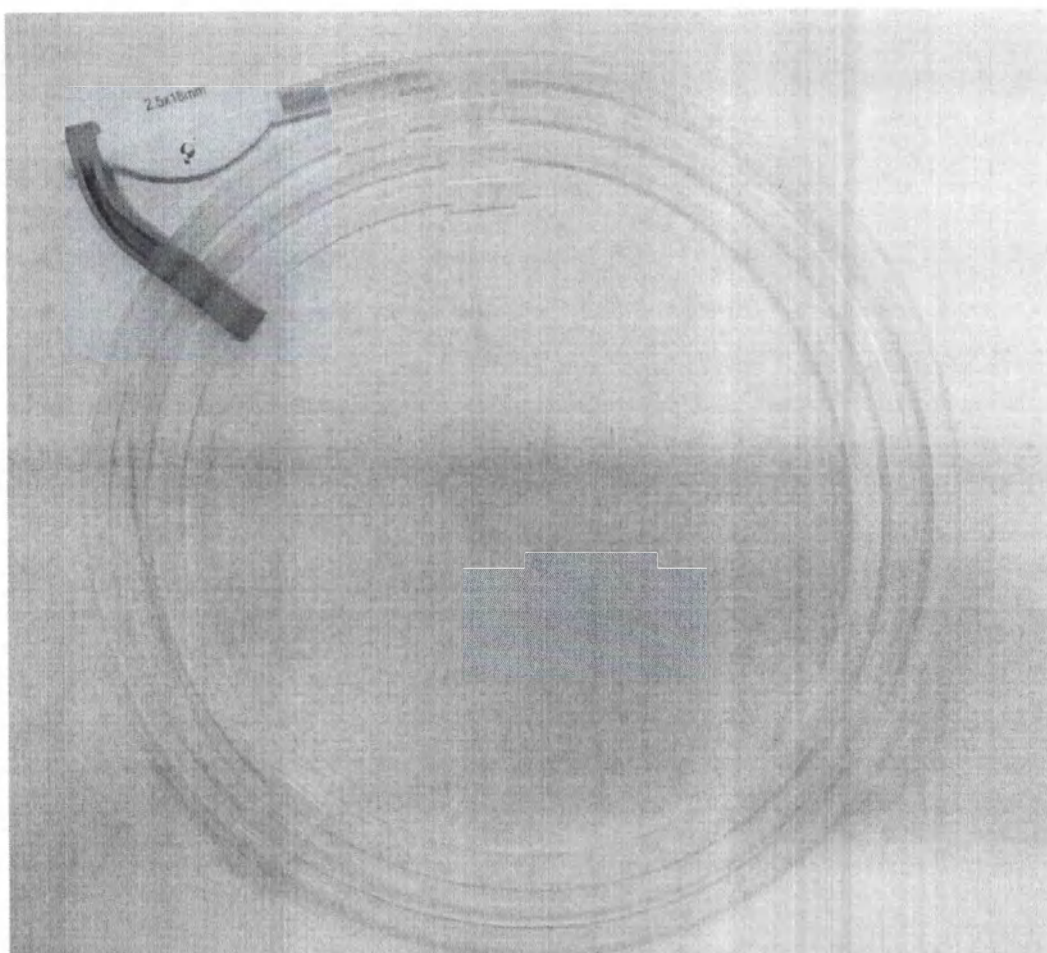


Фото 13. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC2518 длина 18 мм, диаметр 2,5 мм)

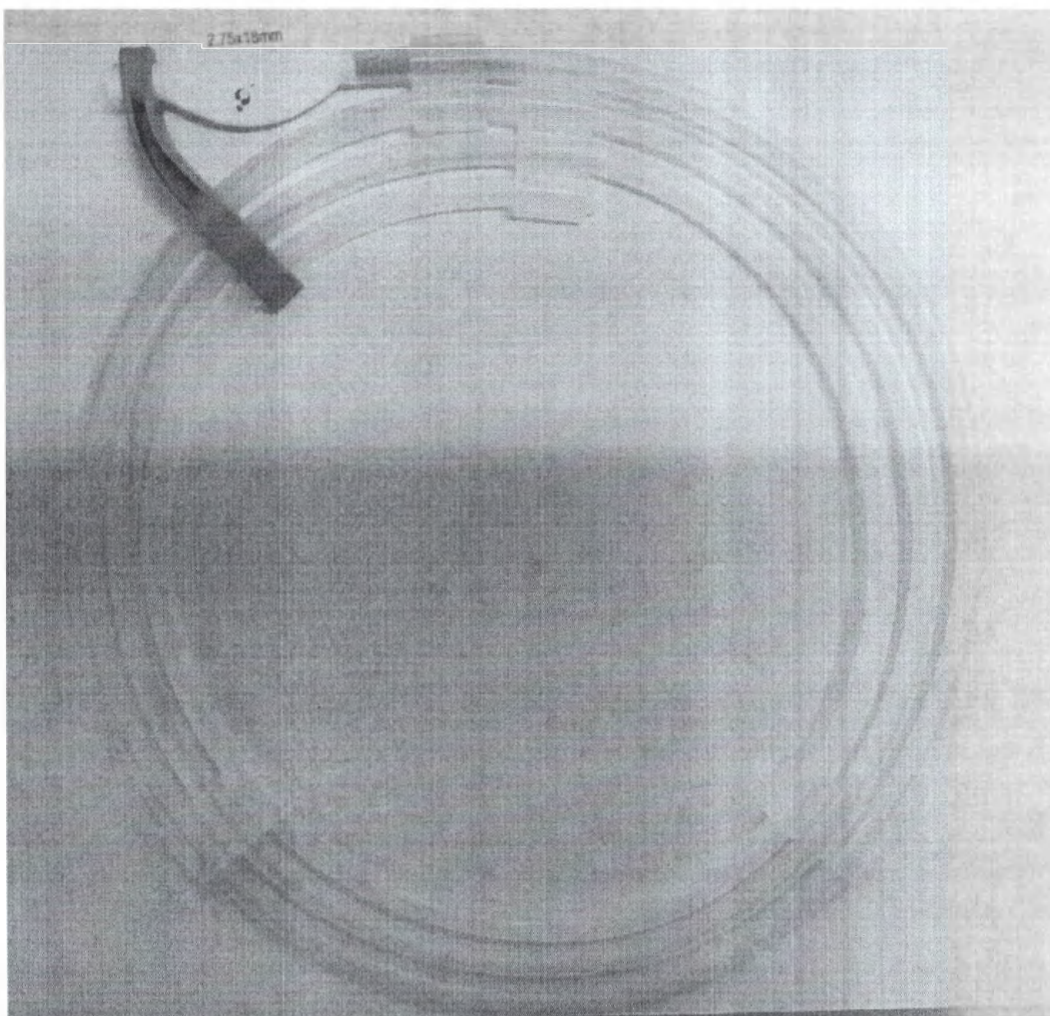


Фото 14. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC2718 длина 18 мм, диаметр 2,75 мм)

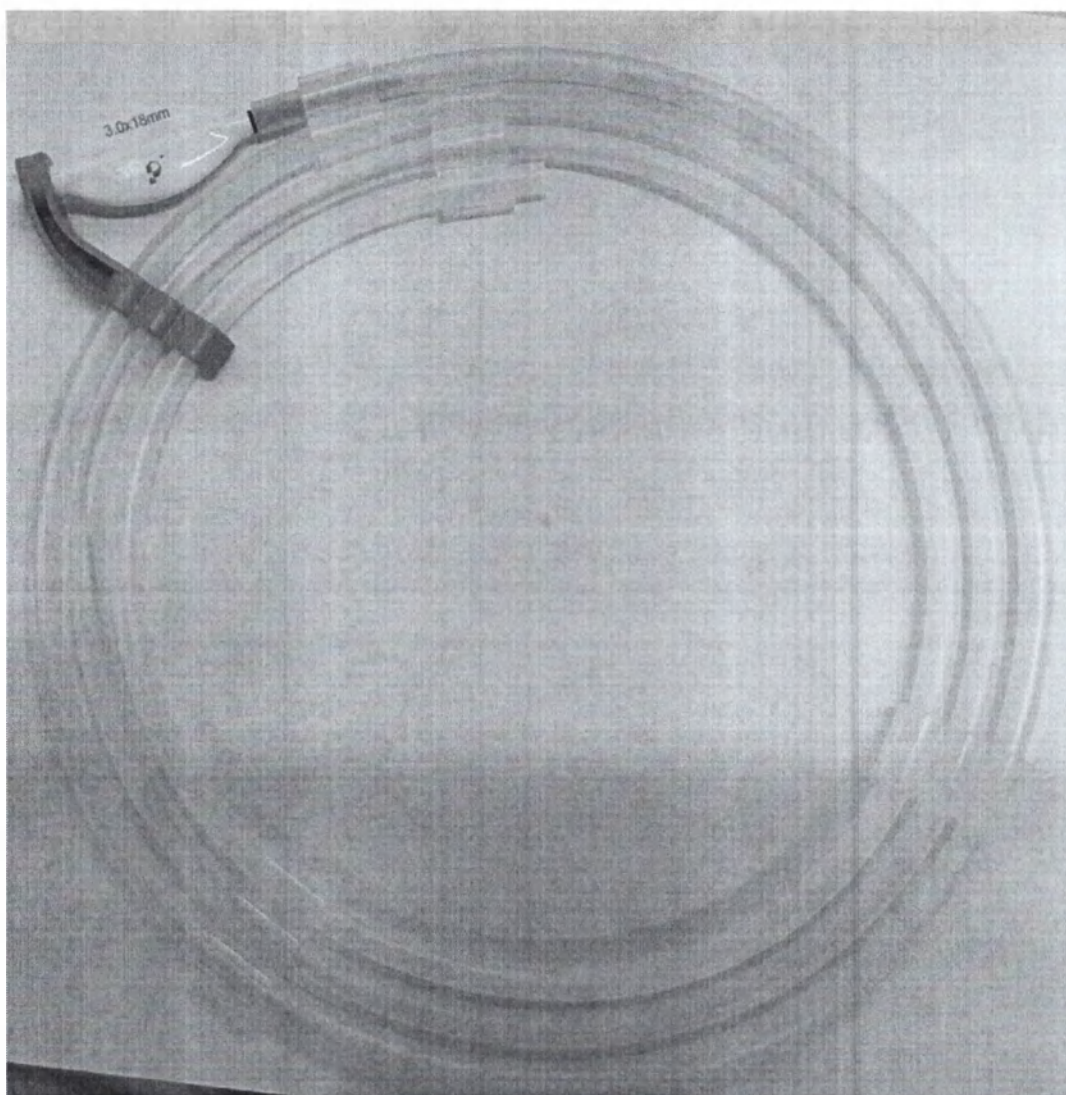


Фото 15. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC3018 длина 18 мм, диаметр 3 мм)

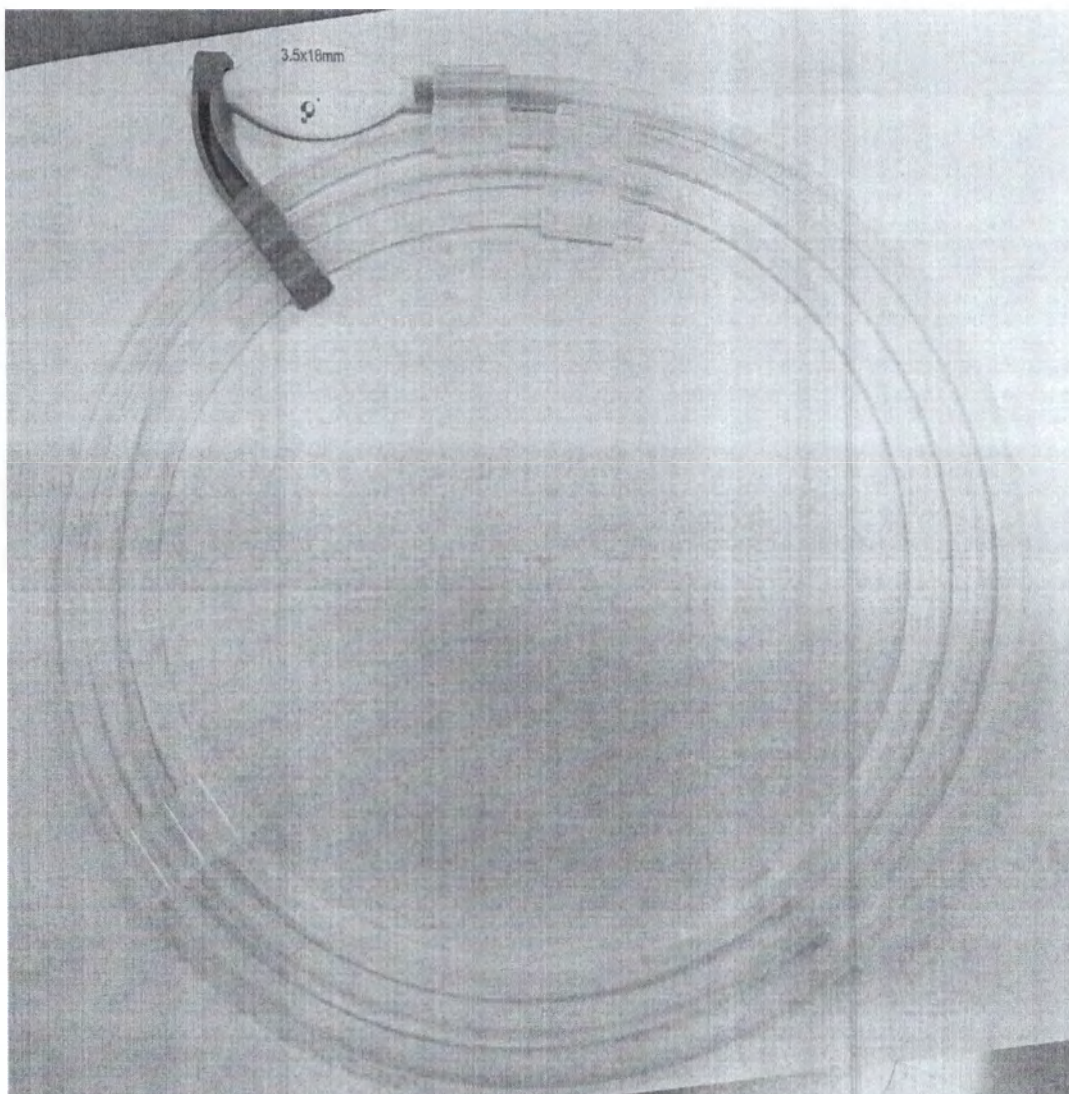


Фото 16. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC3518 длина 18 мм, диаметр 3,5 мм)

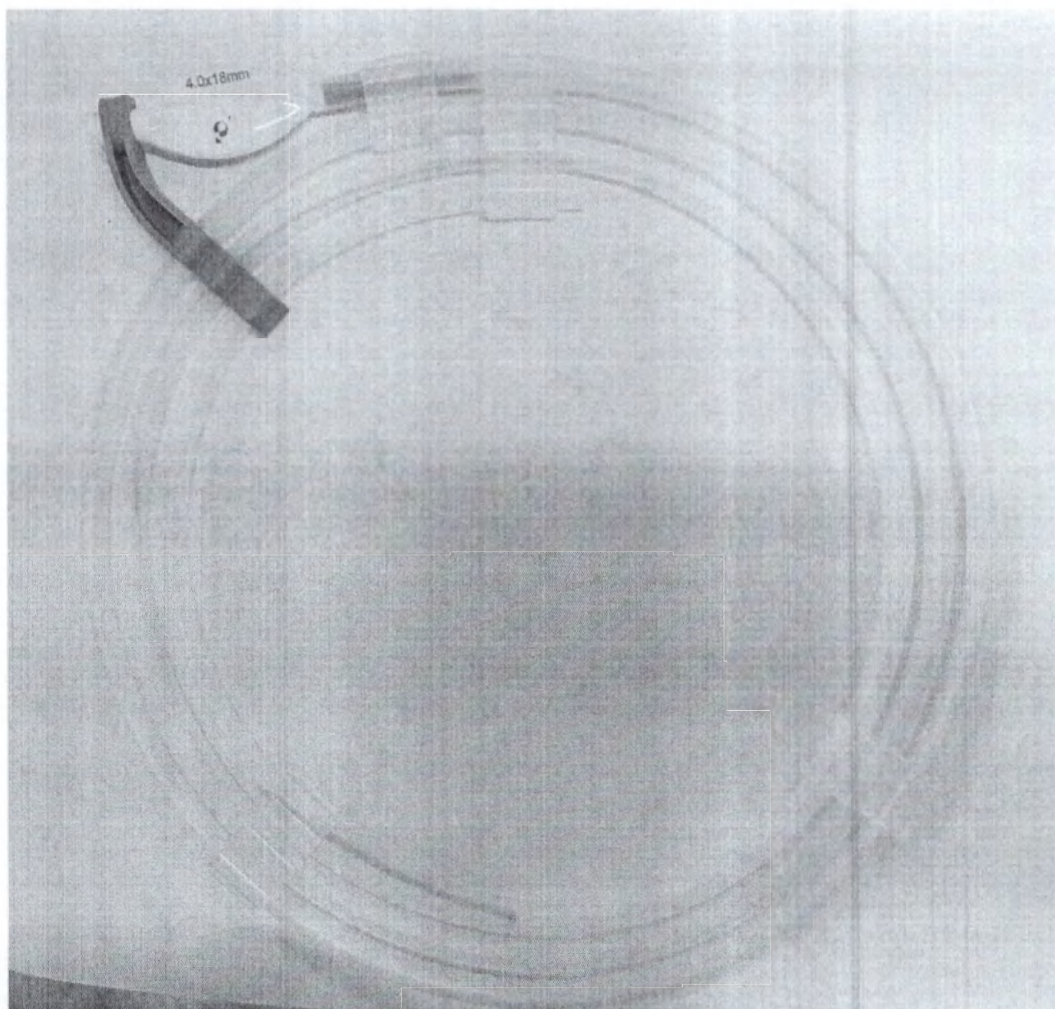


Фото 17. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC4018 длина 18 мм, диаметр 4 мм)

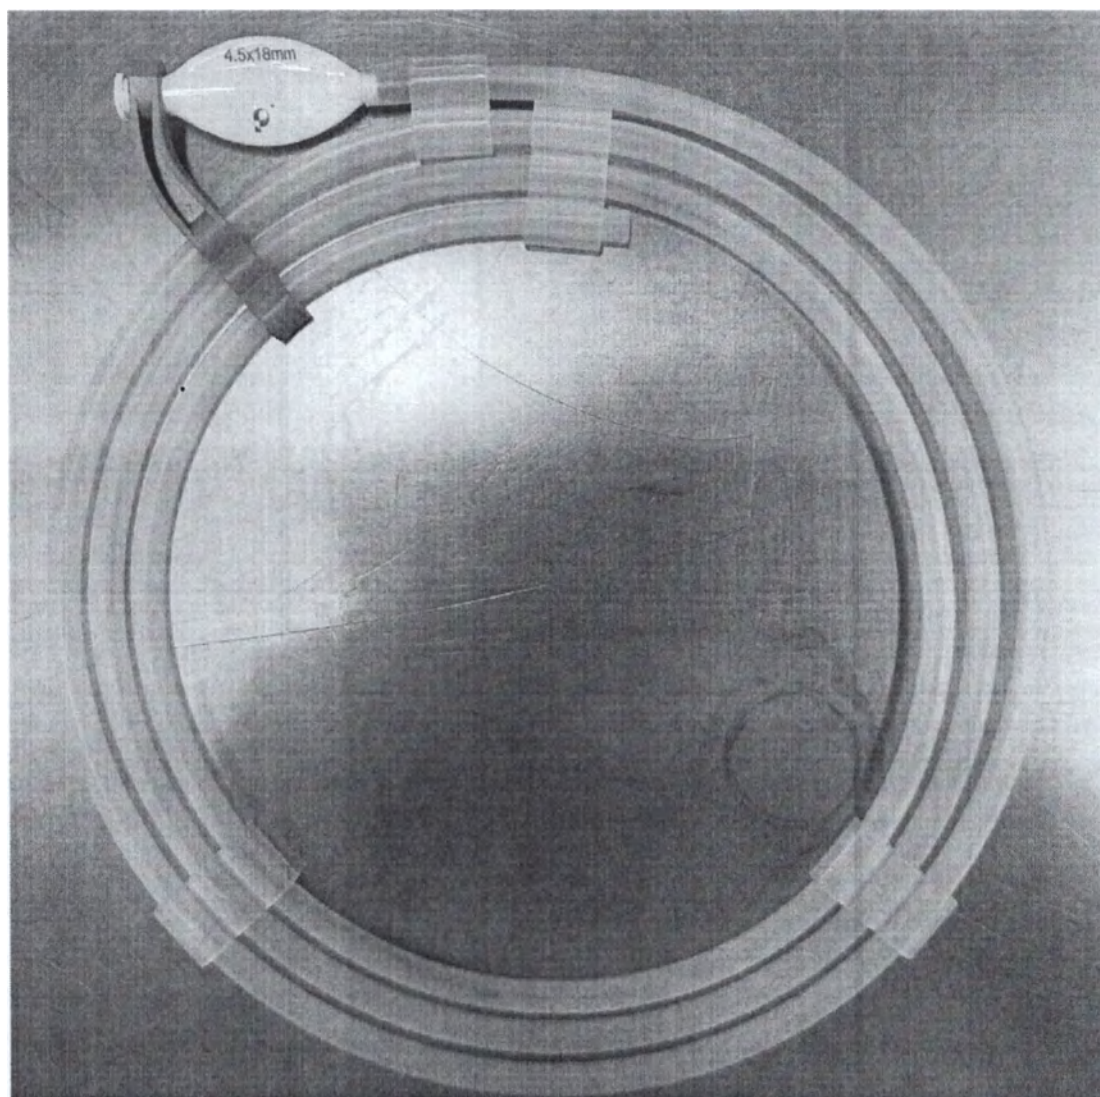


Фото 18. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC4518 длина 18 мм, диаметр 4,5 мм)

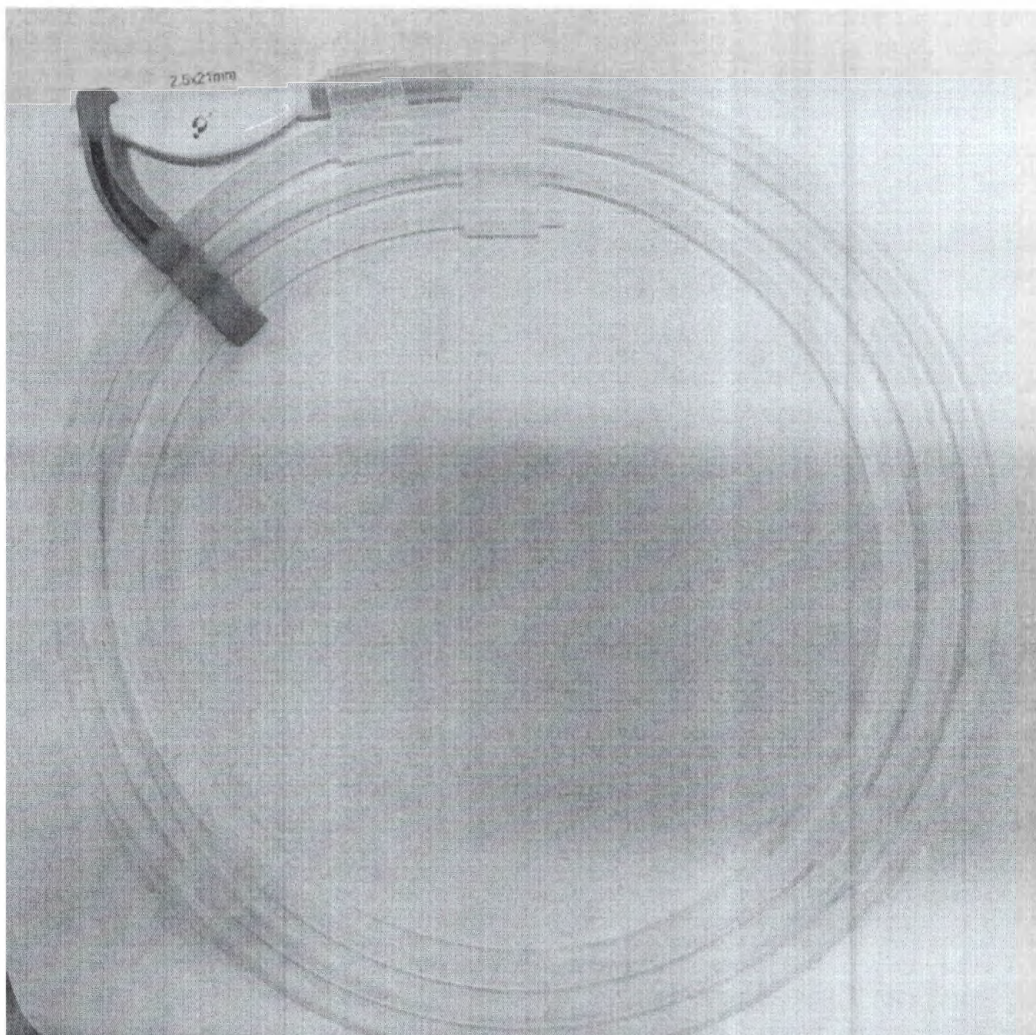


Фото 19. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC2521 длина 21 мм, диаметр 2,5 мм)

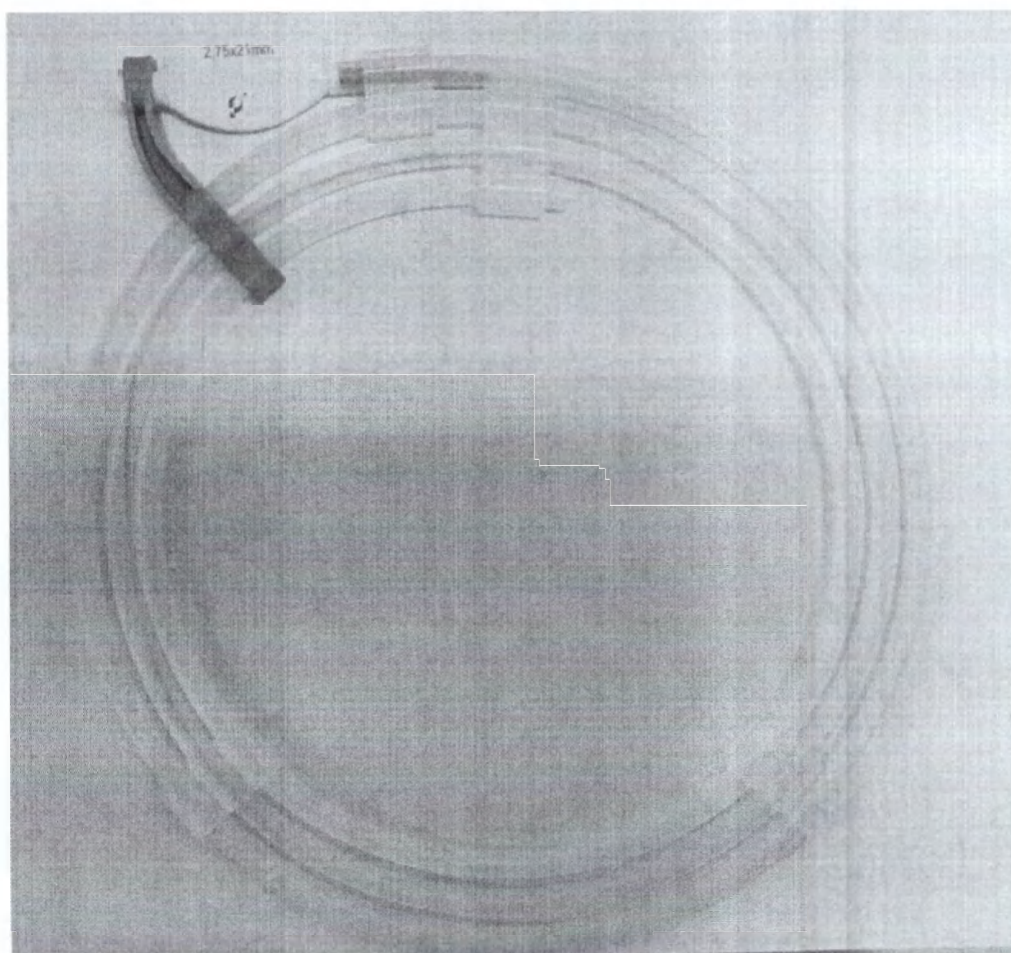


Фото 20. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC2721 длина 21 мм, диаметр 2,75 мм)

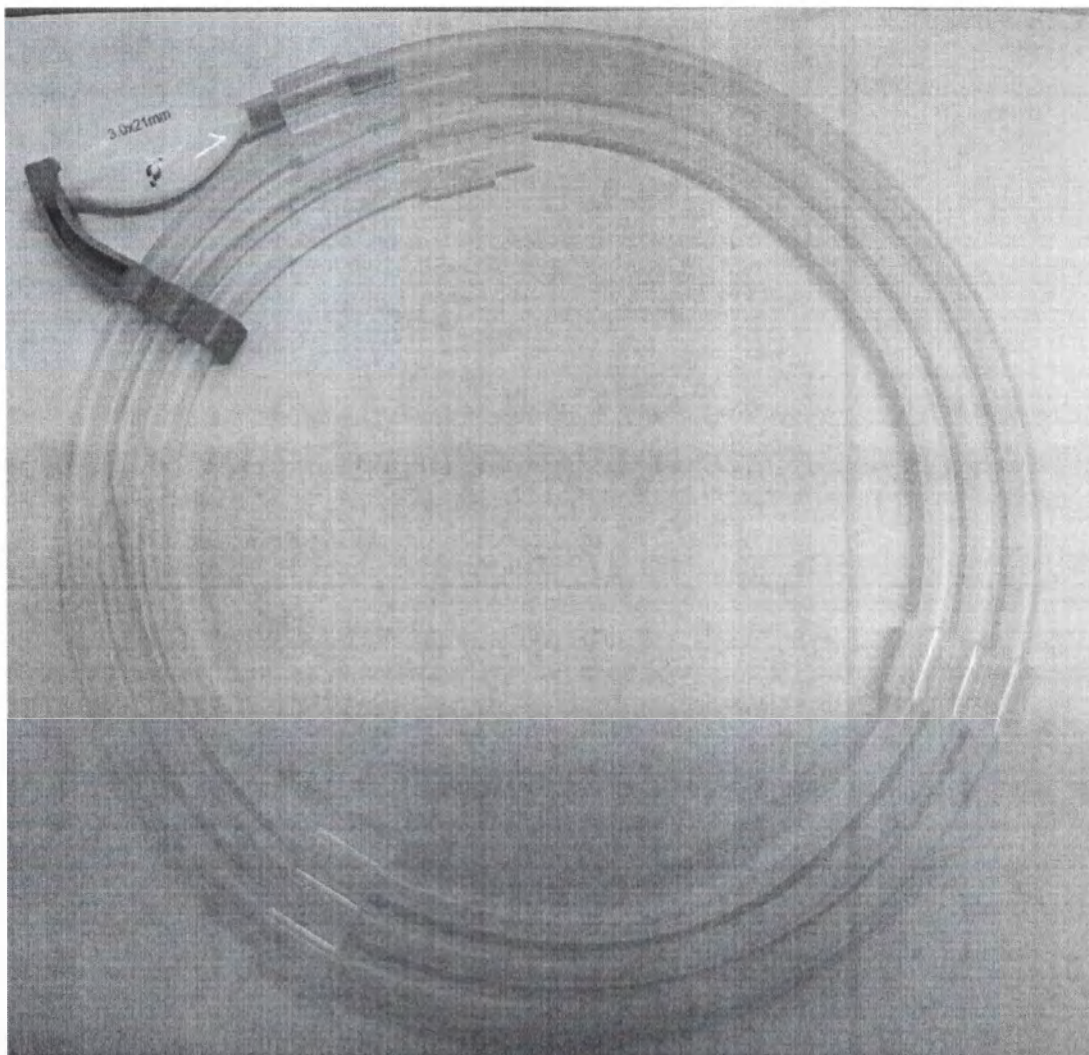


Фото 21. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC3021 длина 21 мм, диаметр 3 мм)

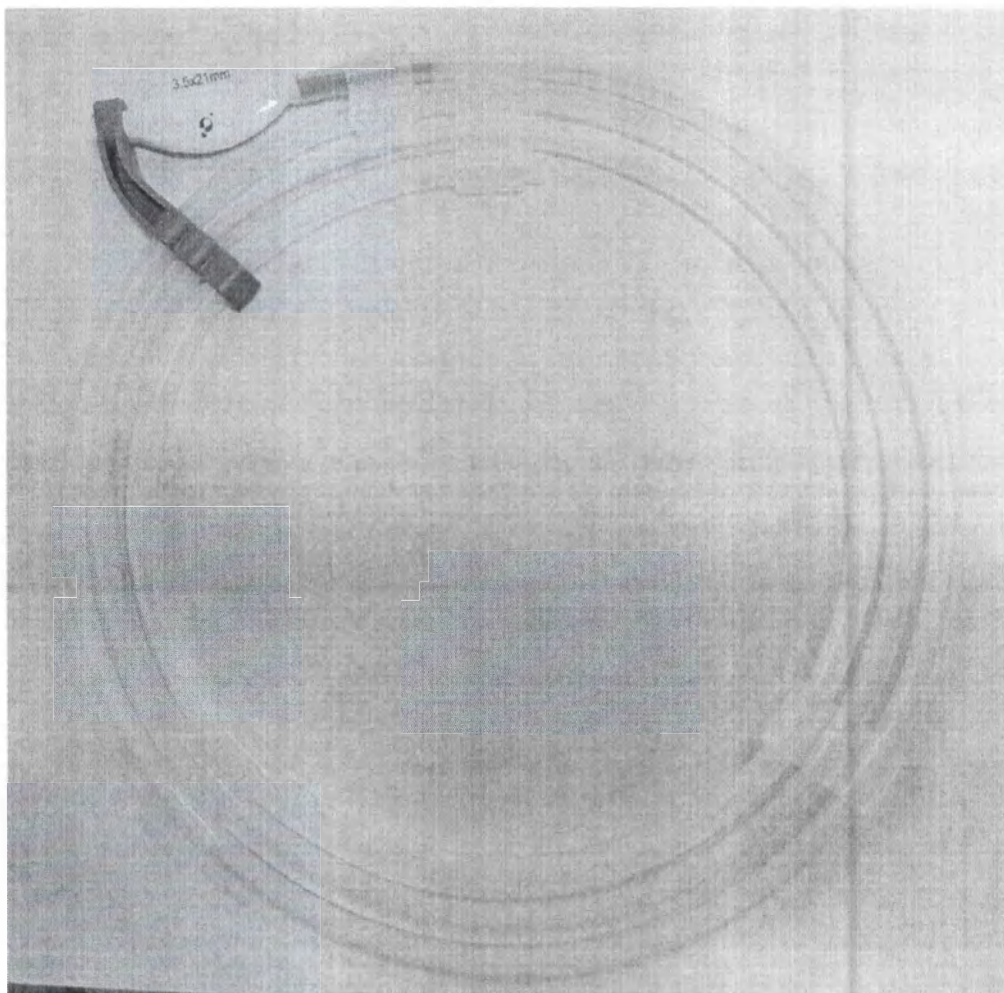


Фото 22. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC3521 длина 21 мм, диаметр 3,5 мм)

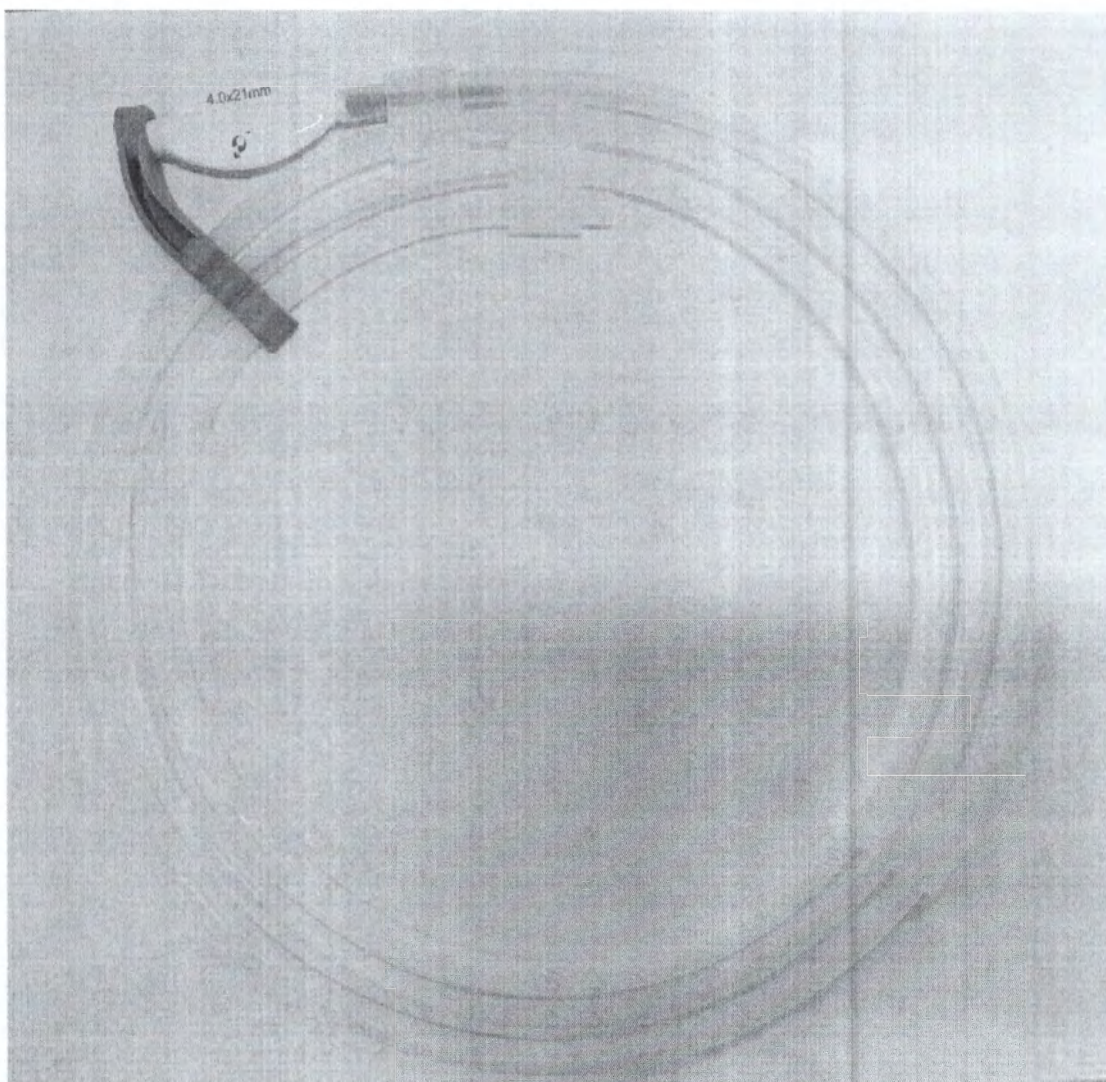


Фото 23. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC4021 длина 21 мм, диаметр 4 мм)

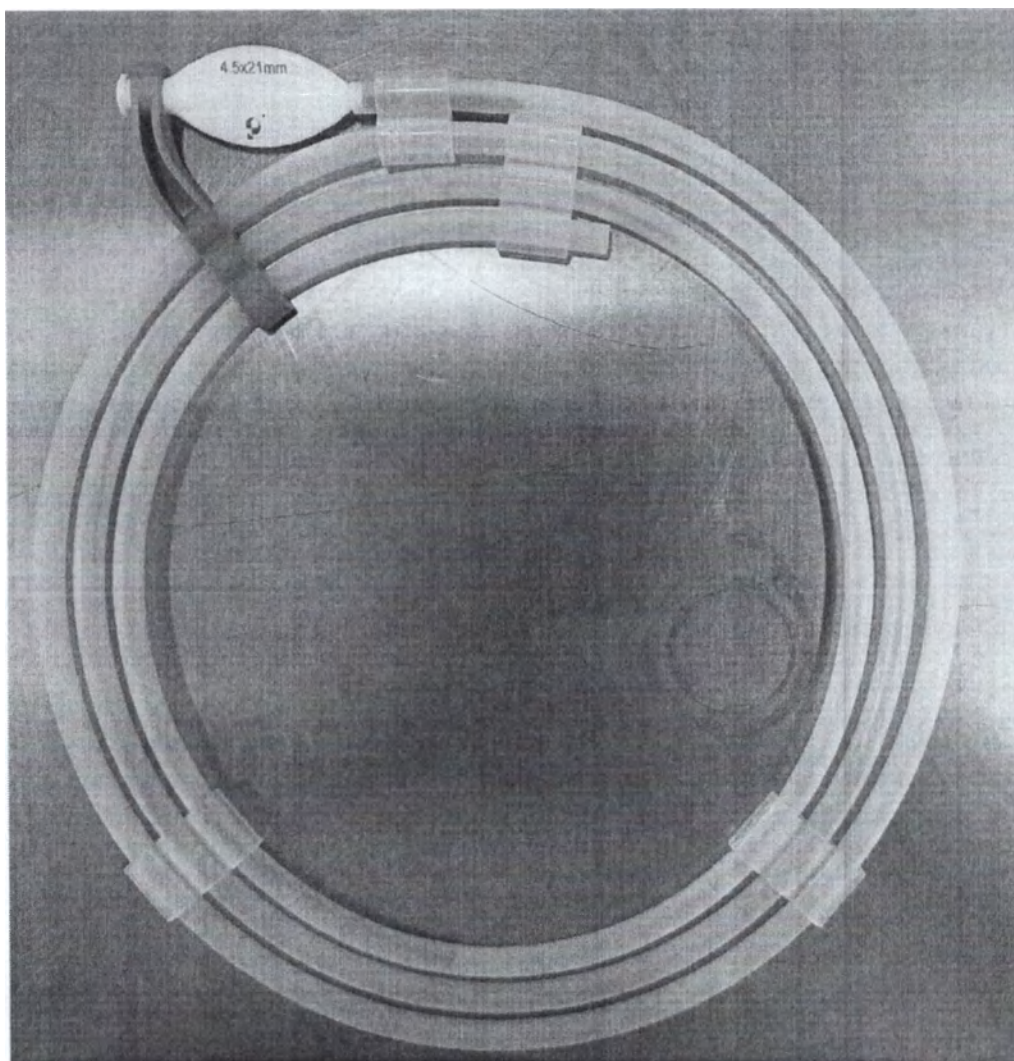


Фото 24. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC4521 длина 21 мм, диаметр 4,5 мм)

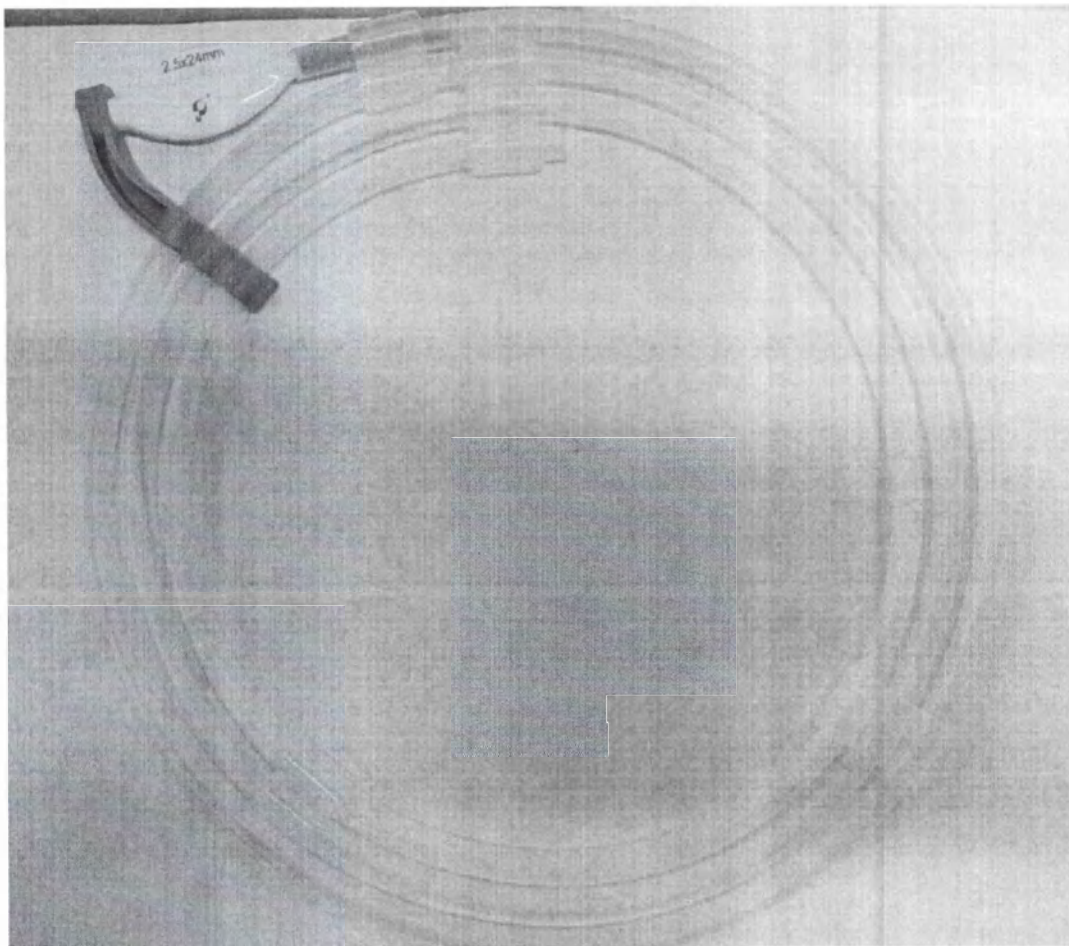


Фото 25. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC2524 длина 24 мм, диаметр 2,5 мм)

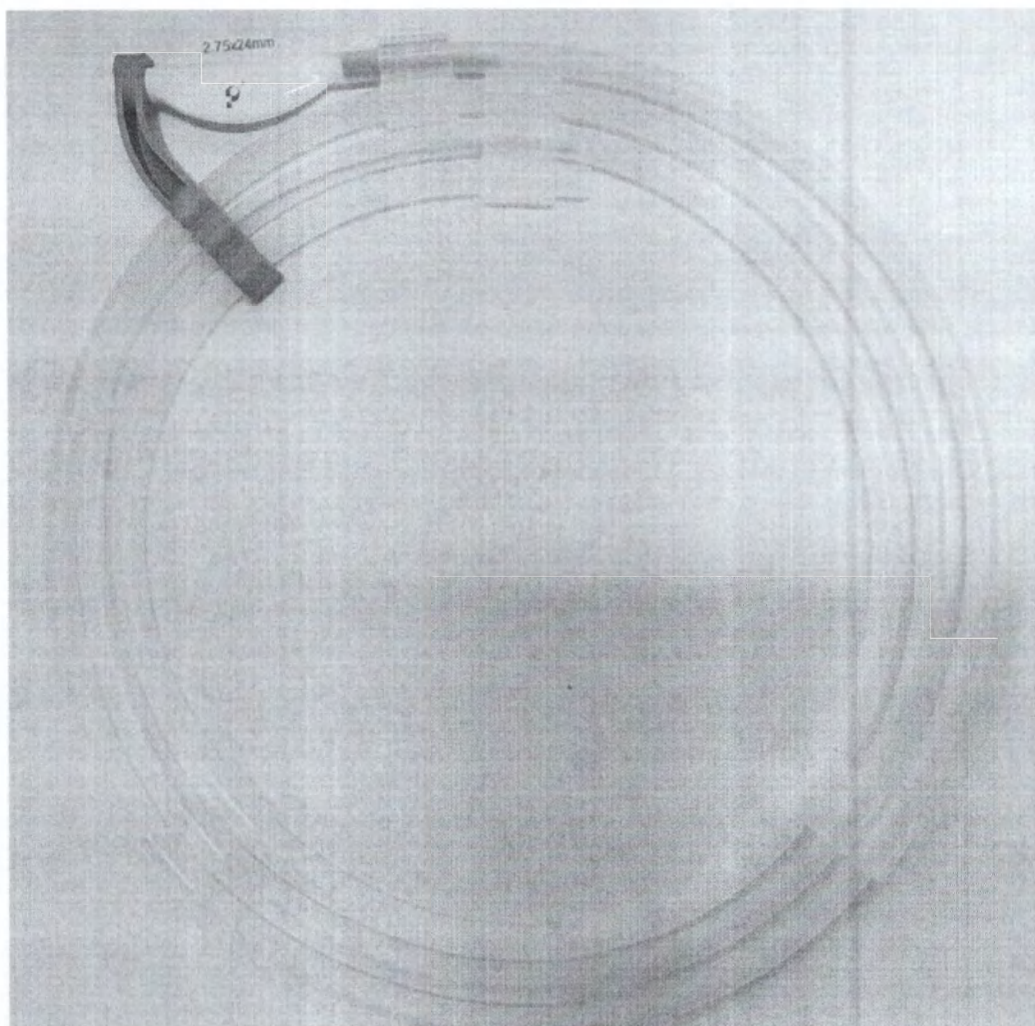


Фото 26. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC2724 длина 24 мм, диаметр 2,75 мм)

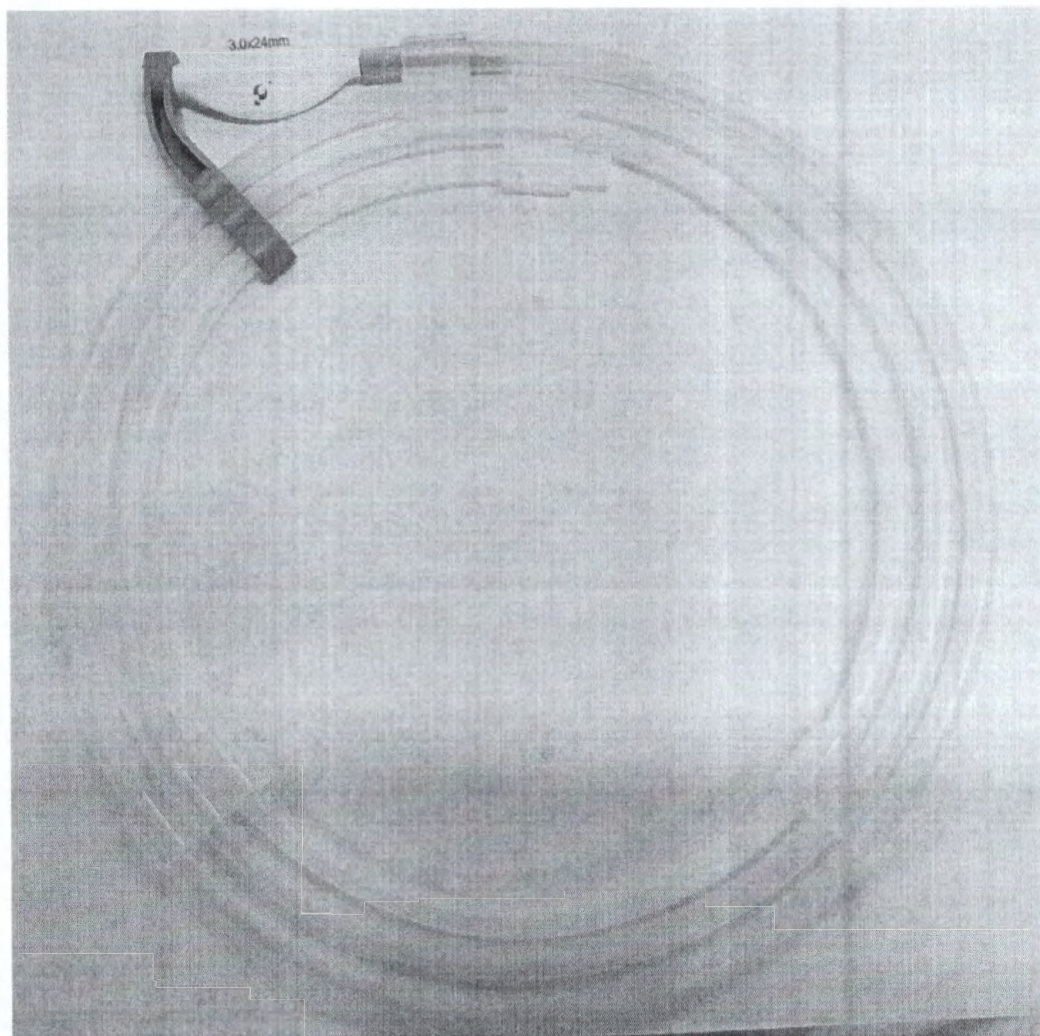


Фото 27. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC3024 длина 24 мм, диаметр 3 мм)

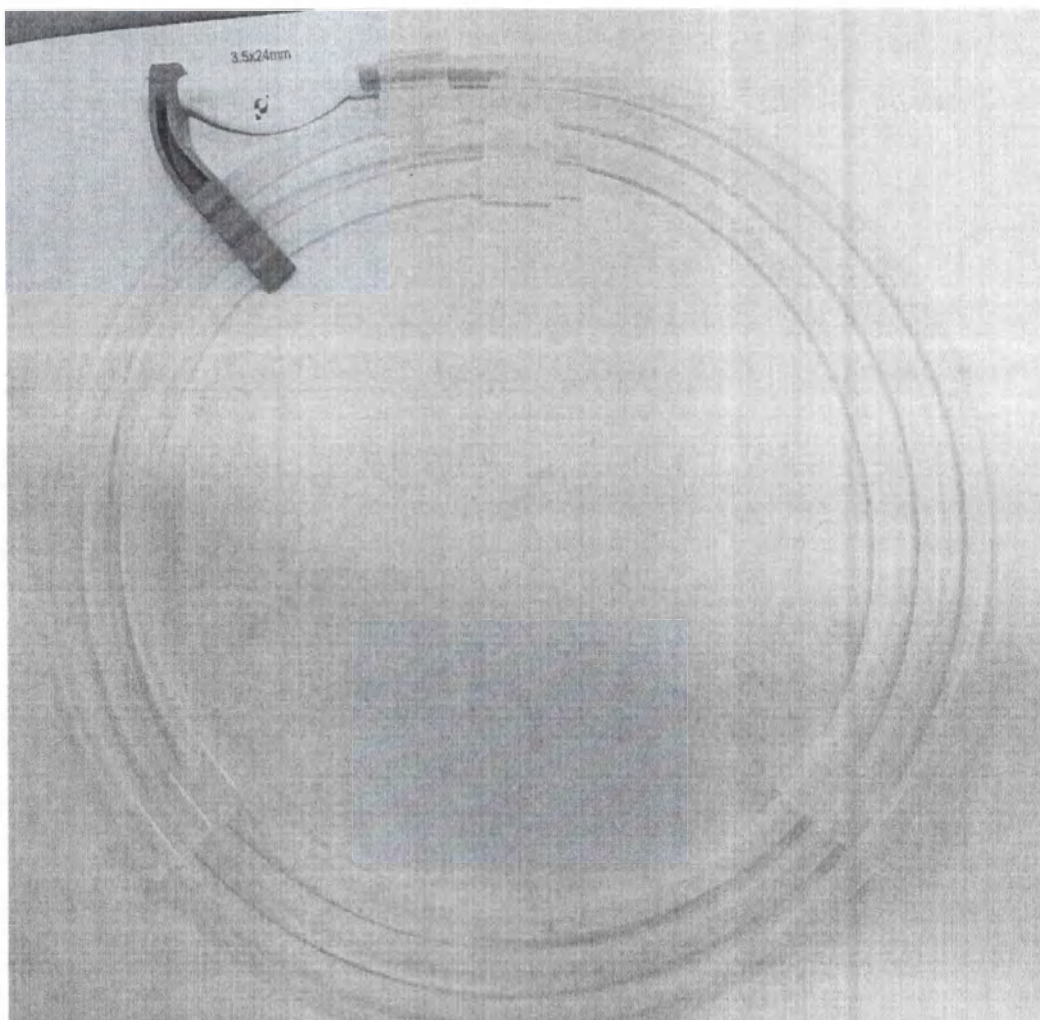


Фото 28. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC3524 длина 24 мм, диаметр 3,5 мм)

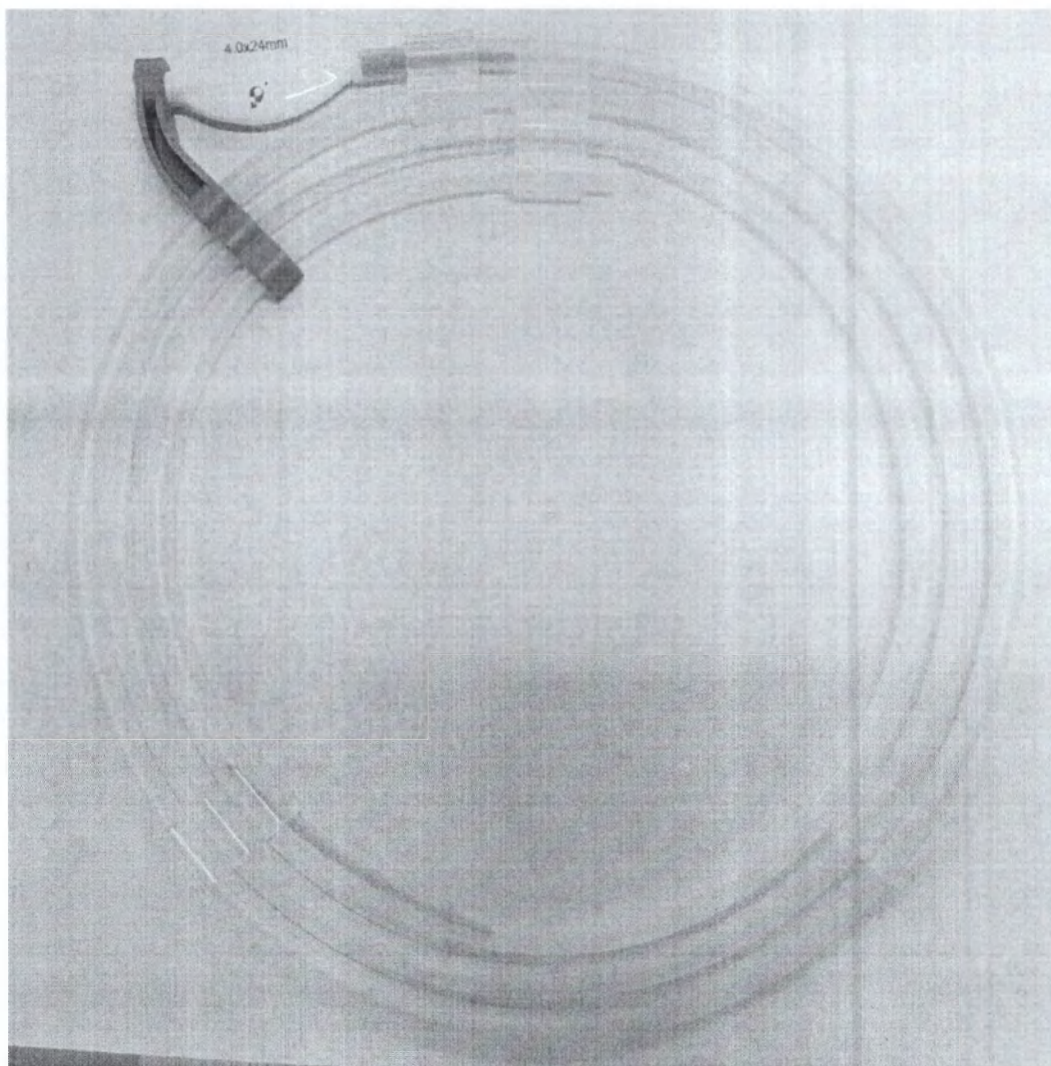


Фото 29. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC4024 длина 24 мм, диаметр 4 мм)

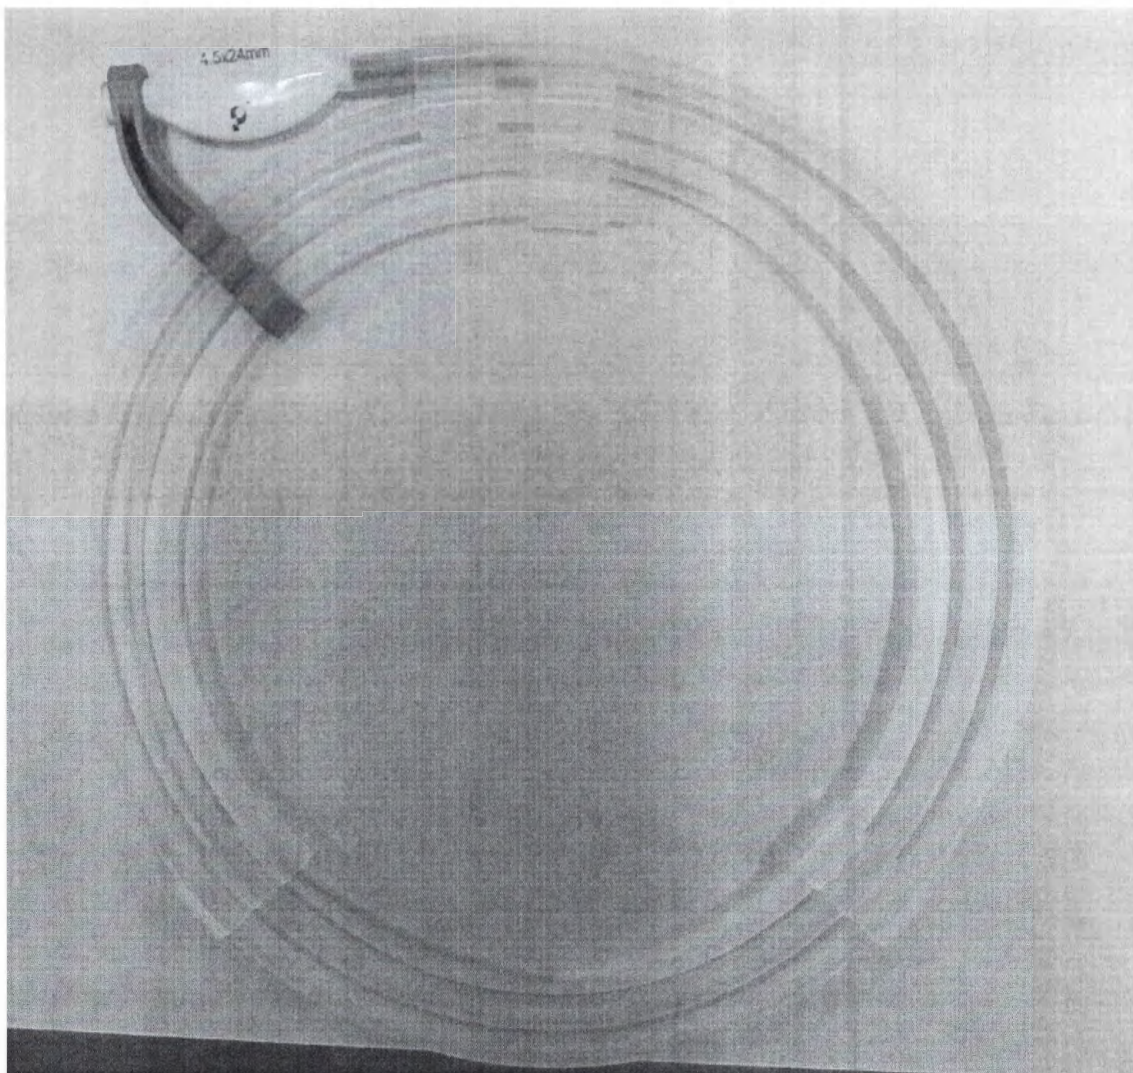


Фото 30. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC4524 длина 24 мм, диаметр 4,5 мм)

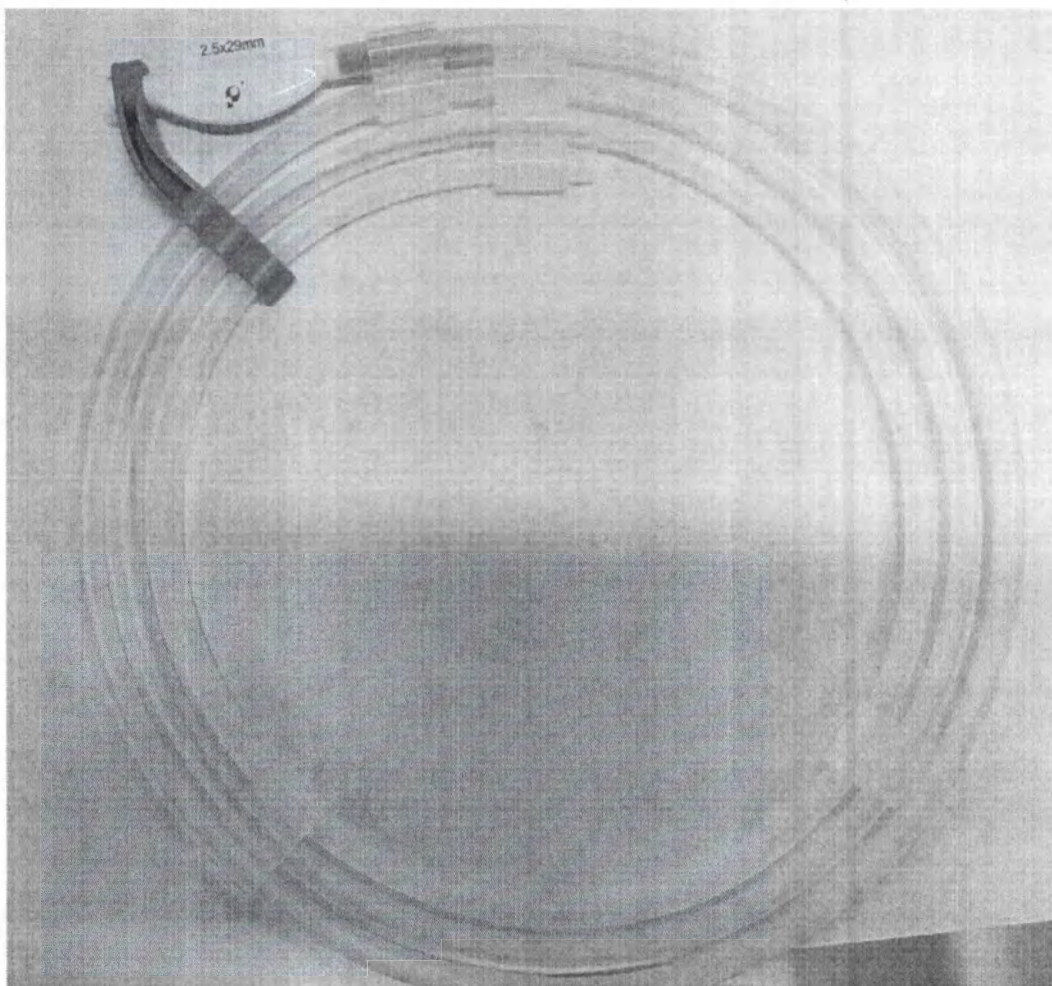


Фото 31. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC2529 длина 29 мм, диаметр 2,5 мм)

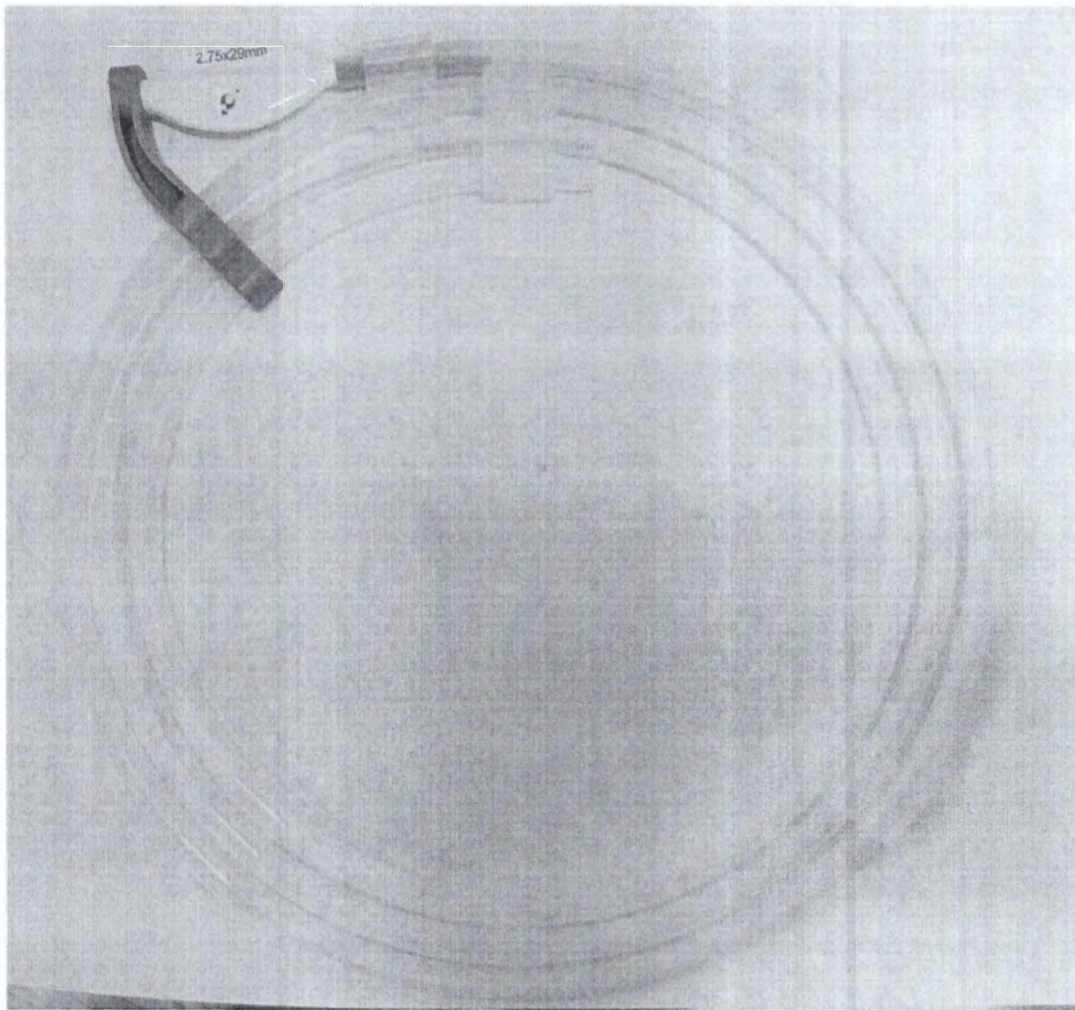


Фото 32. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC2729 длина 29 мм, диаметр 2,75 мм)

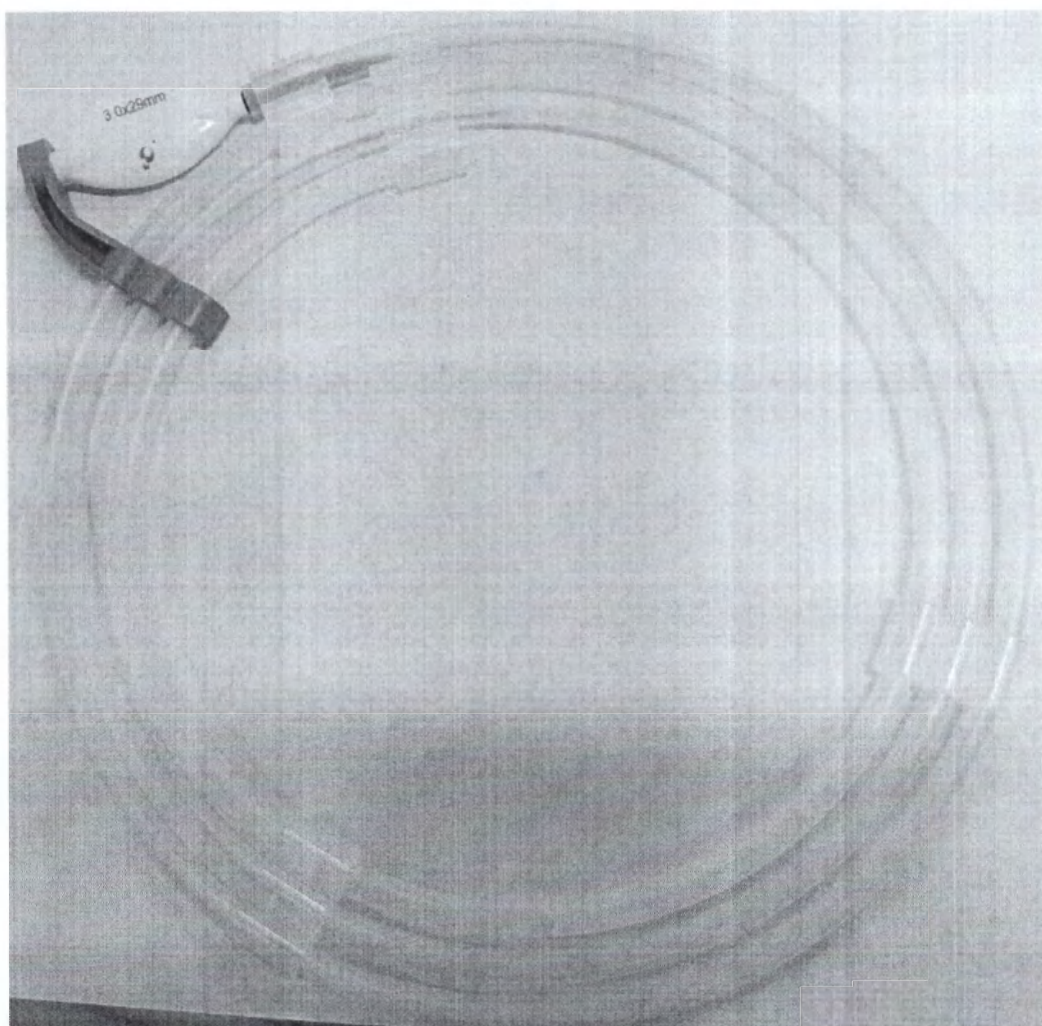


Фото 33. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC3029 длина 29 мм, диаметр 3 мм)

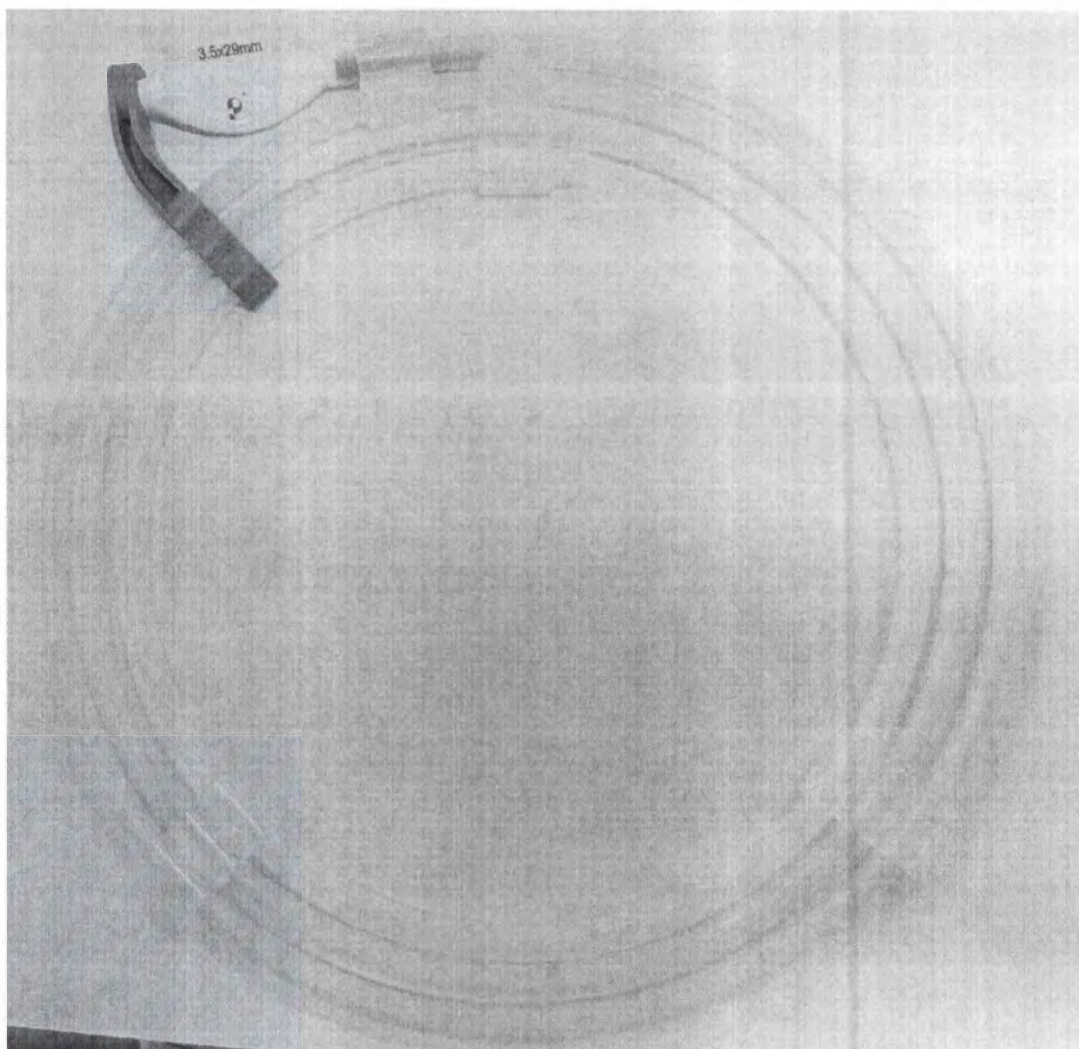


Фото 34. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC3529 длина 29 мм, диаметр 3,5 мм)

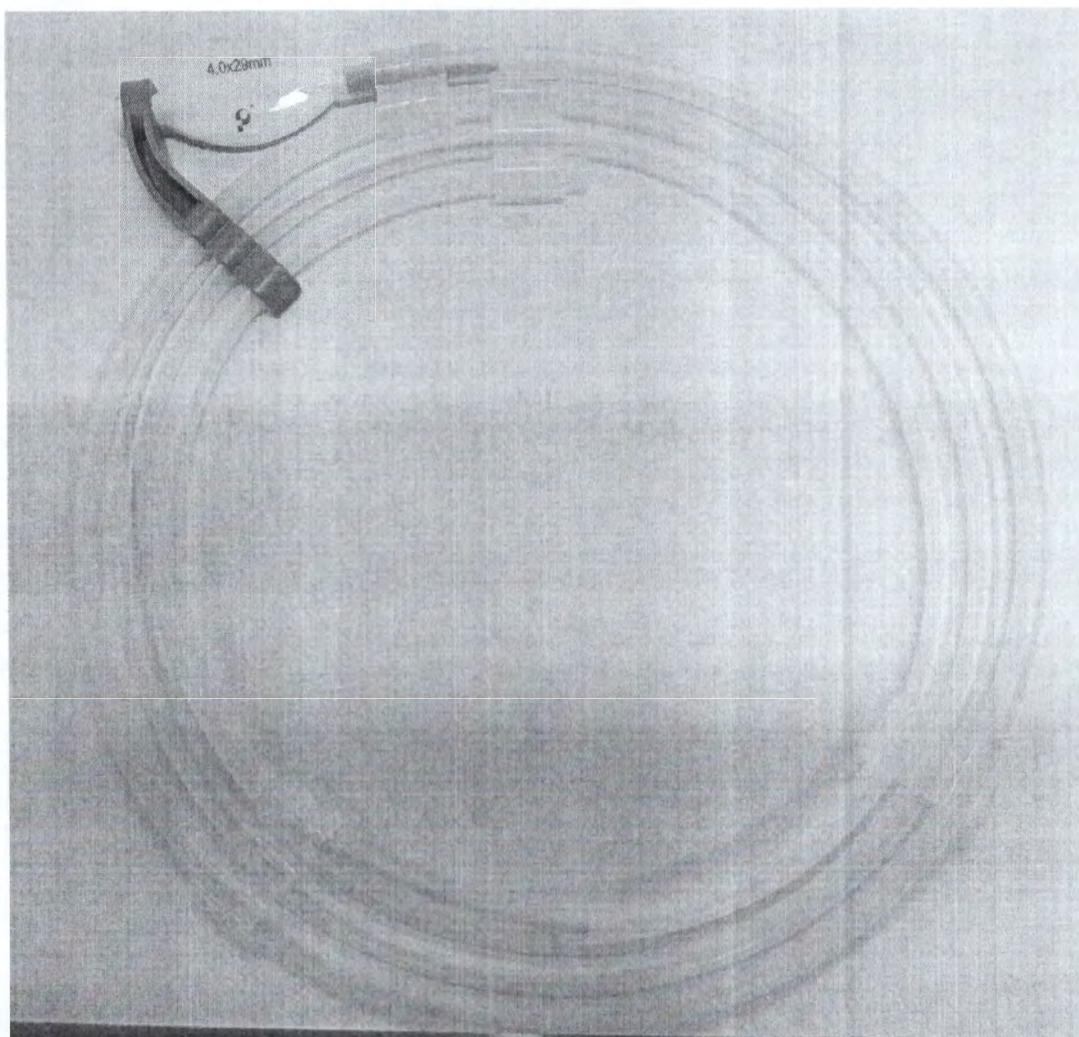


Фото 35. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC4029 длина 29 мм, диаметр 4 мм)

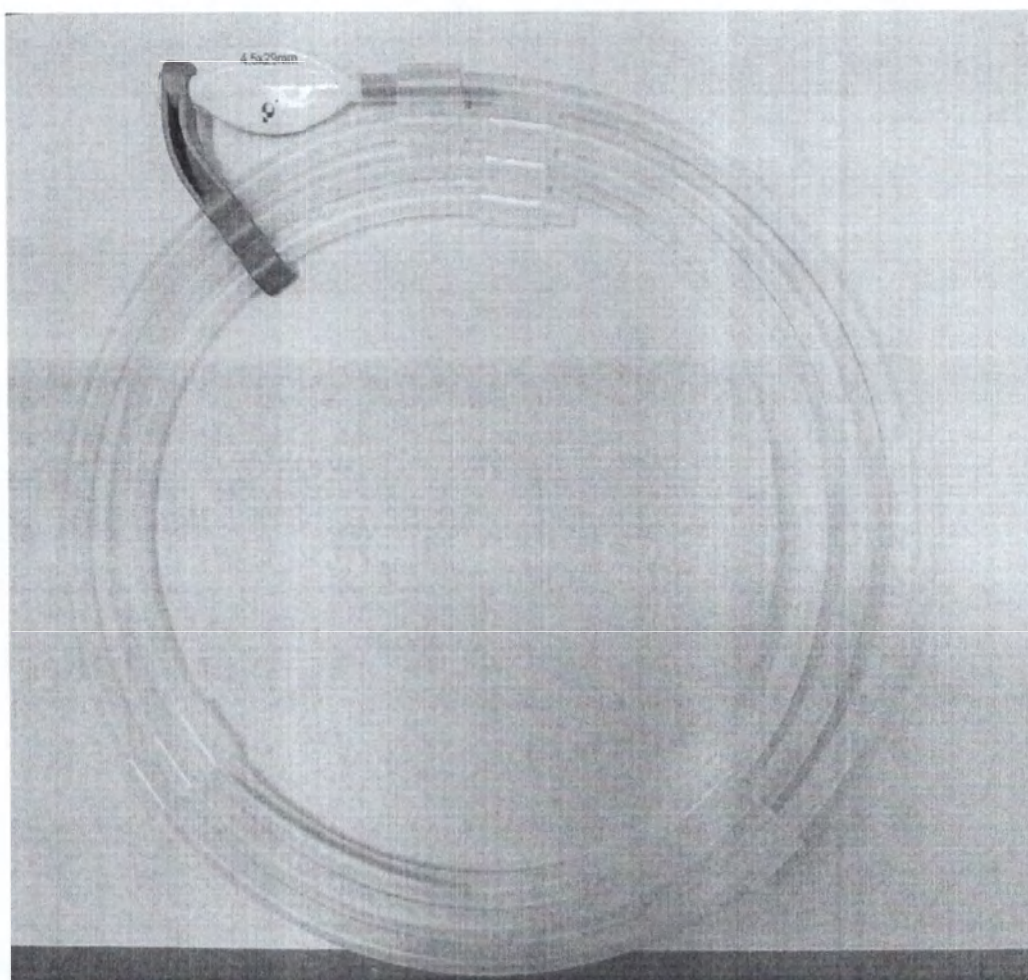


Фото 36. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC4529 длина 29 мм, диаметр 4,5 мм)

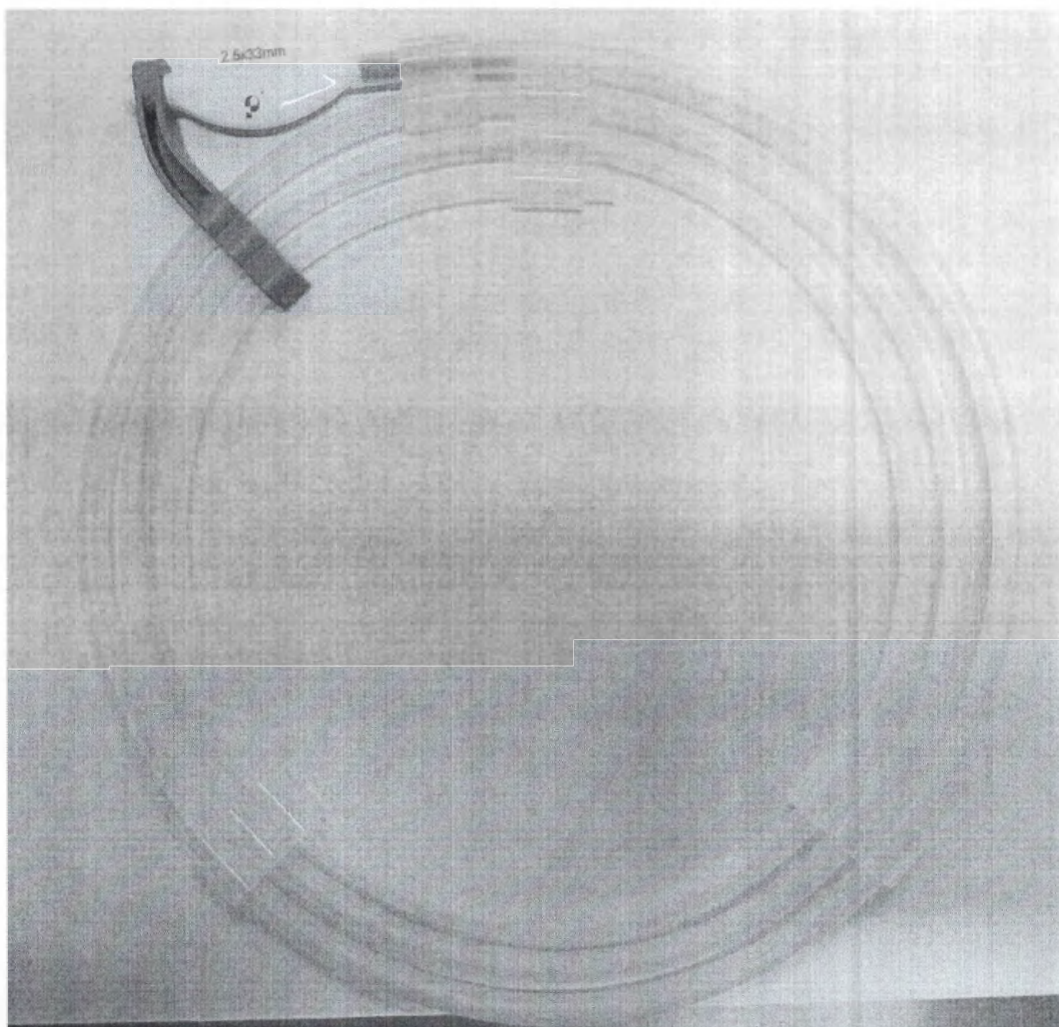


Фото 37. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC2533 длина 33 мм, диаметр 2,5 мм)

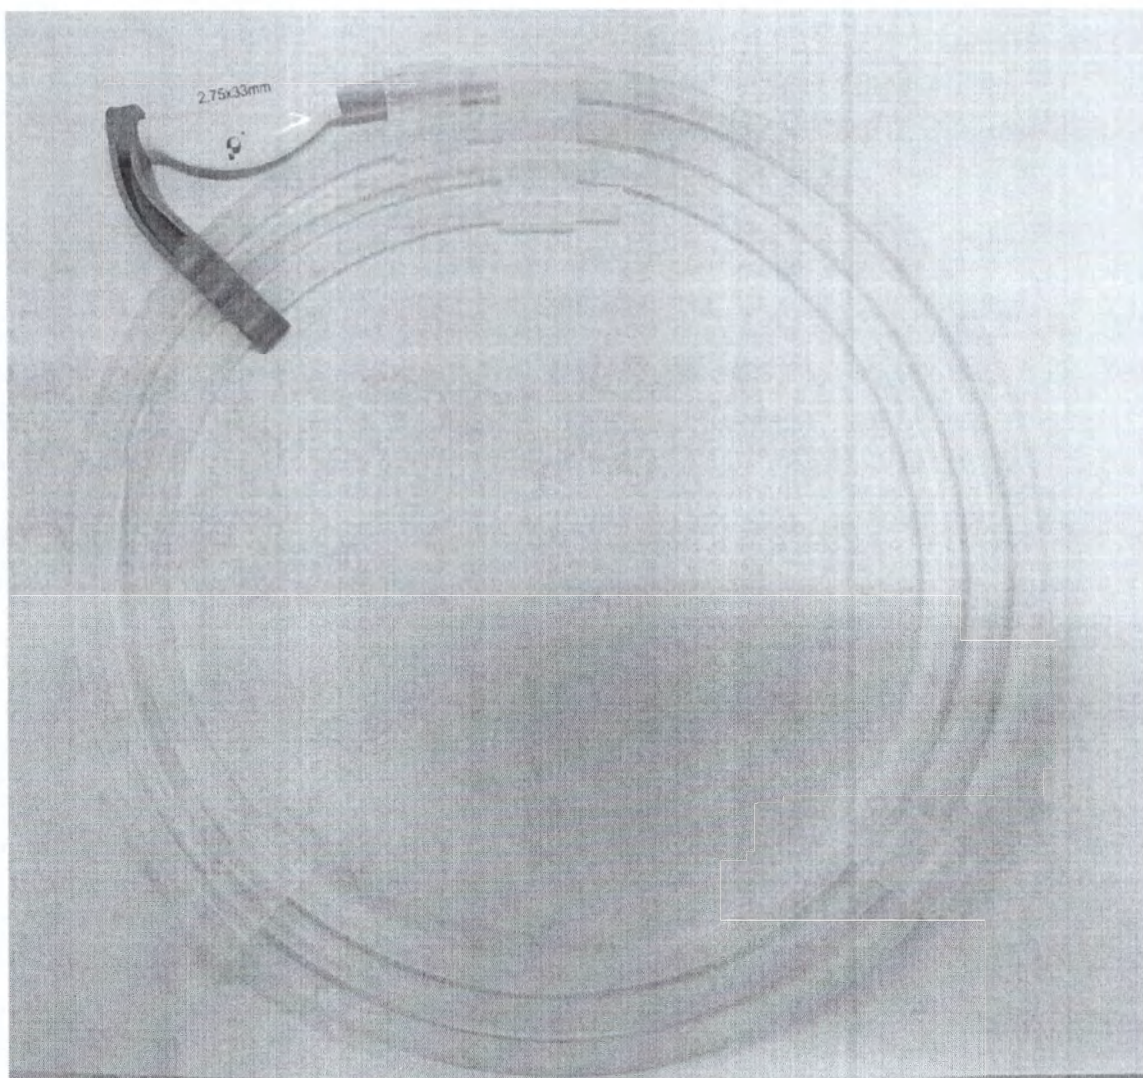


Фото 38. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC2733 длина 33 мм, диаметр 2,75 мм)

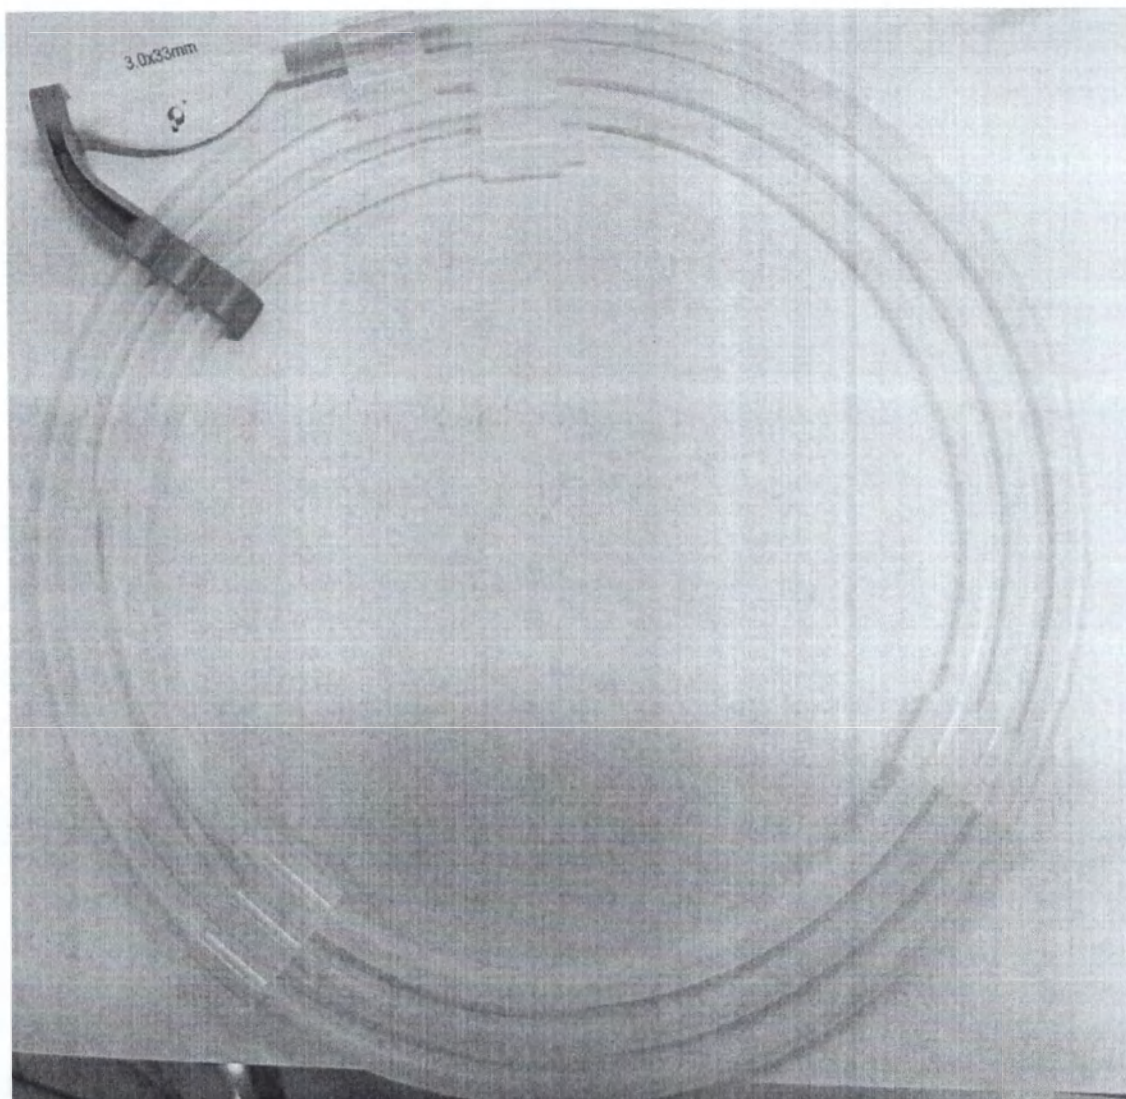


Фото 39. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC3033 длина 33 мм, диаметр 3 мм)

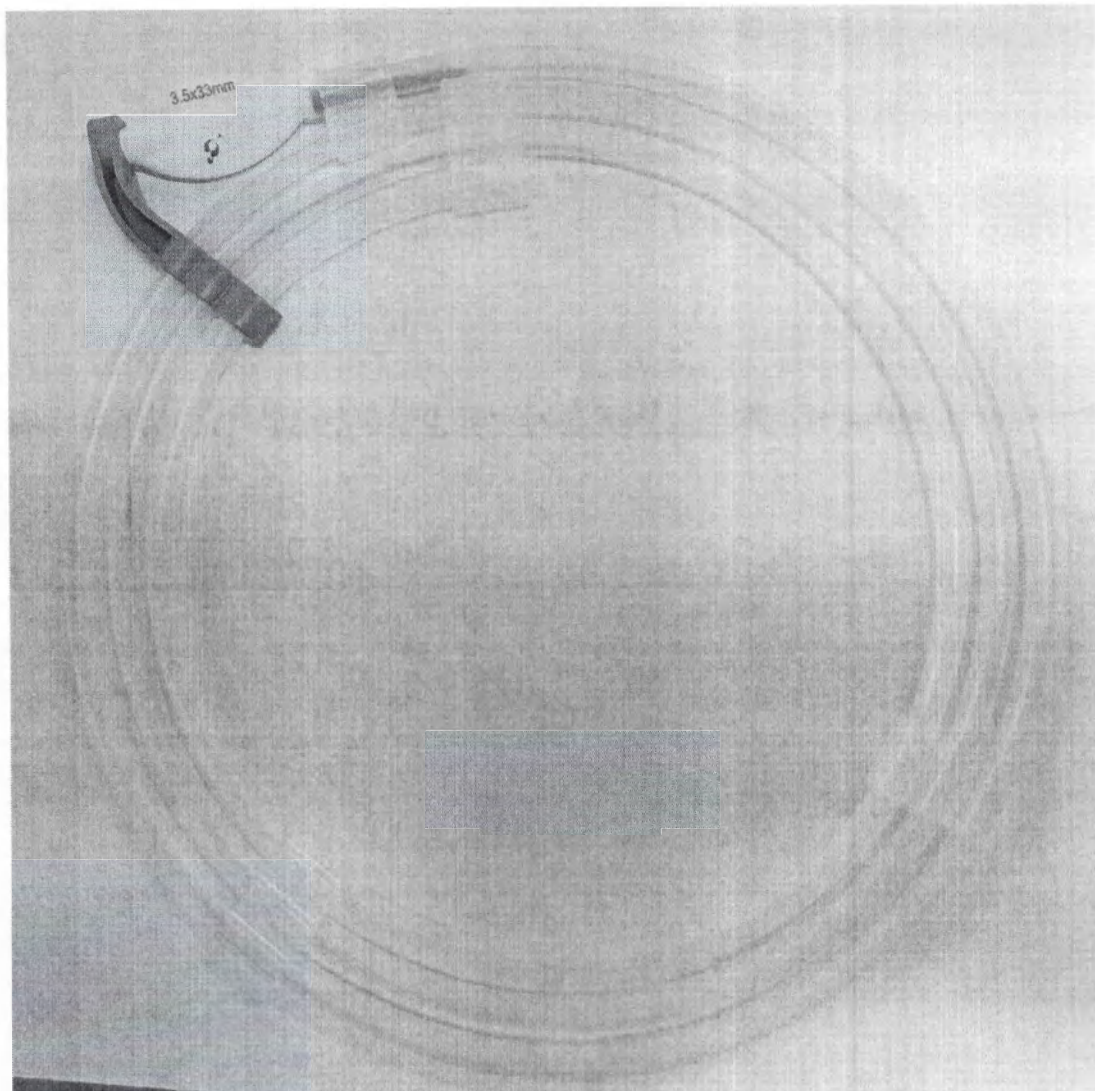


Фото 40. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC3533 длина 33 мм, диаметр 3,5 мм)

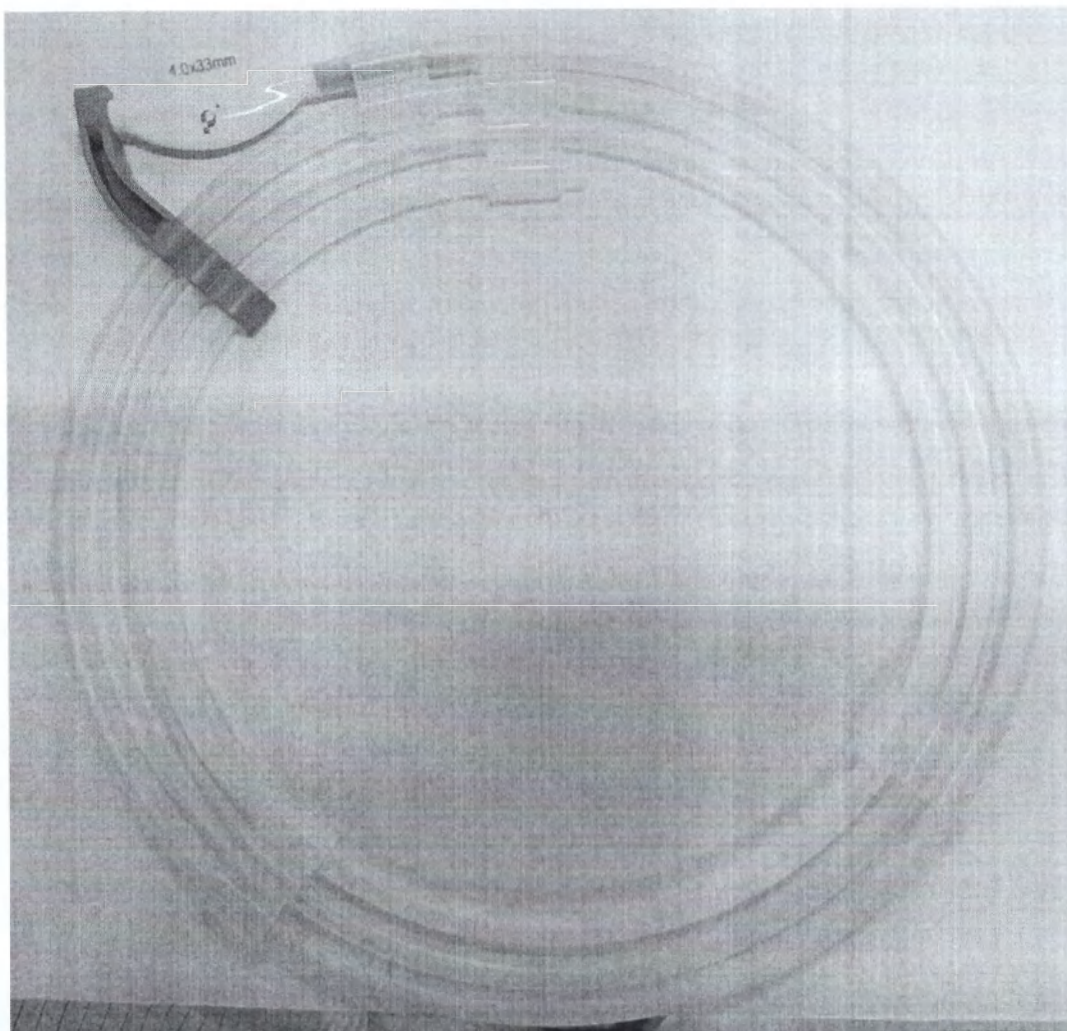


Фото 41. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC4033 длина 33 мм, диаметр 4 мм)

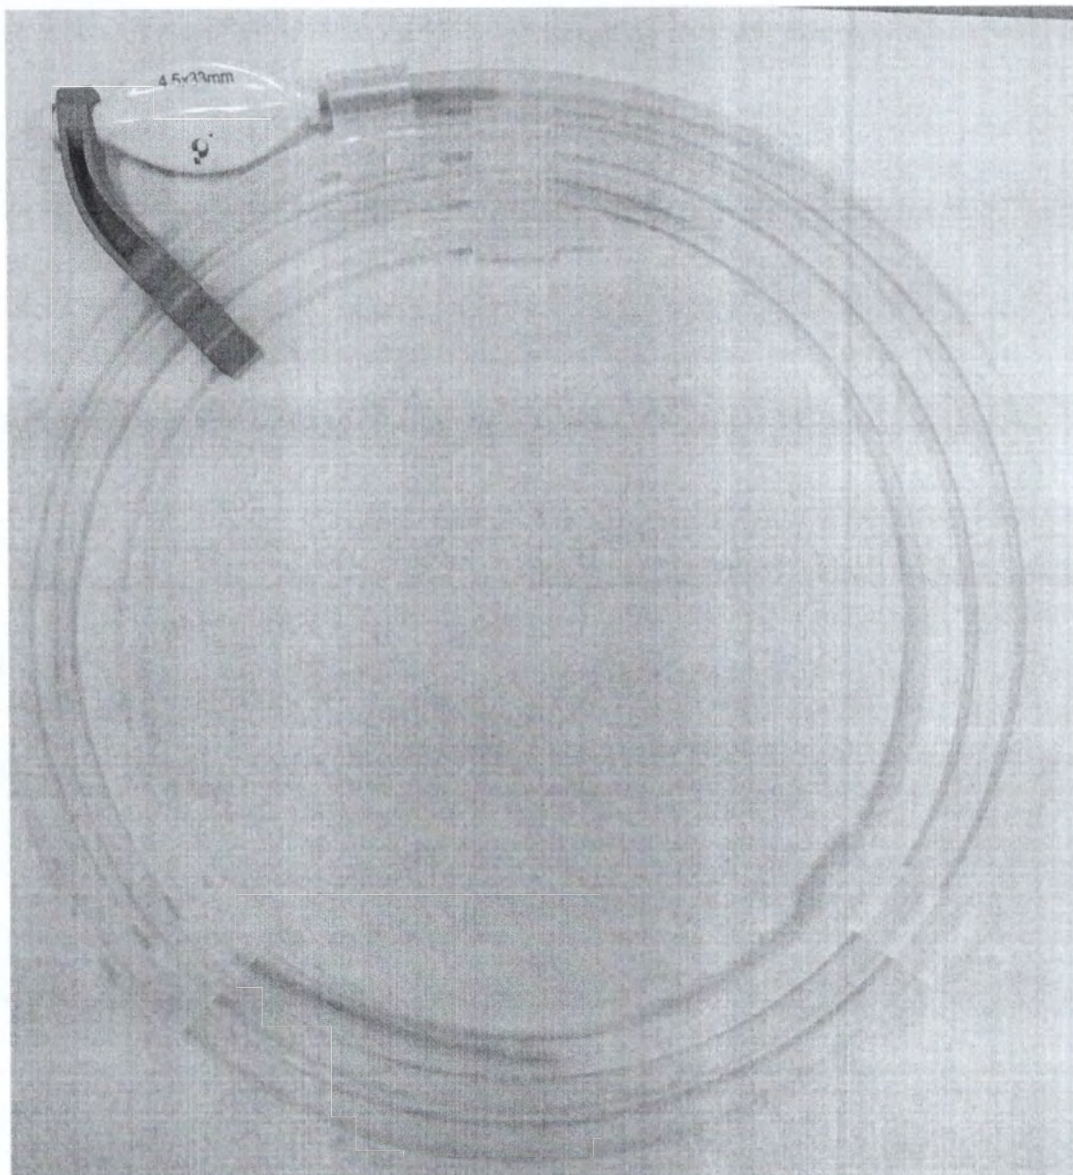


Фото 42. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC4533 длина 33 мм, диаметр 4,5 мм)

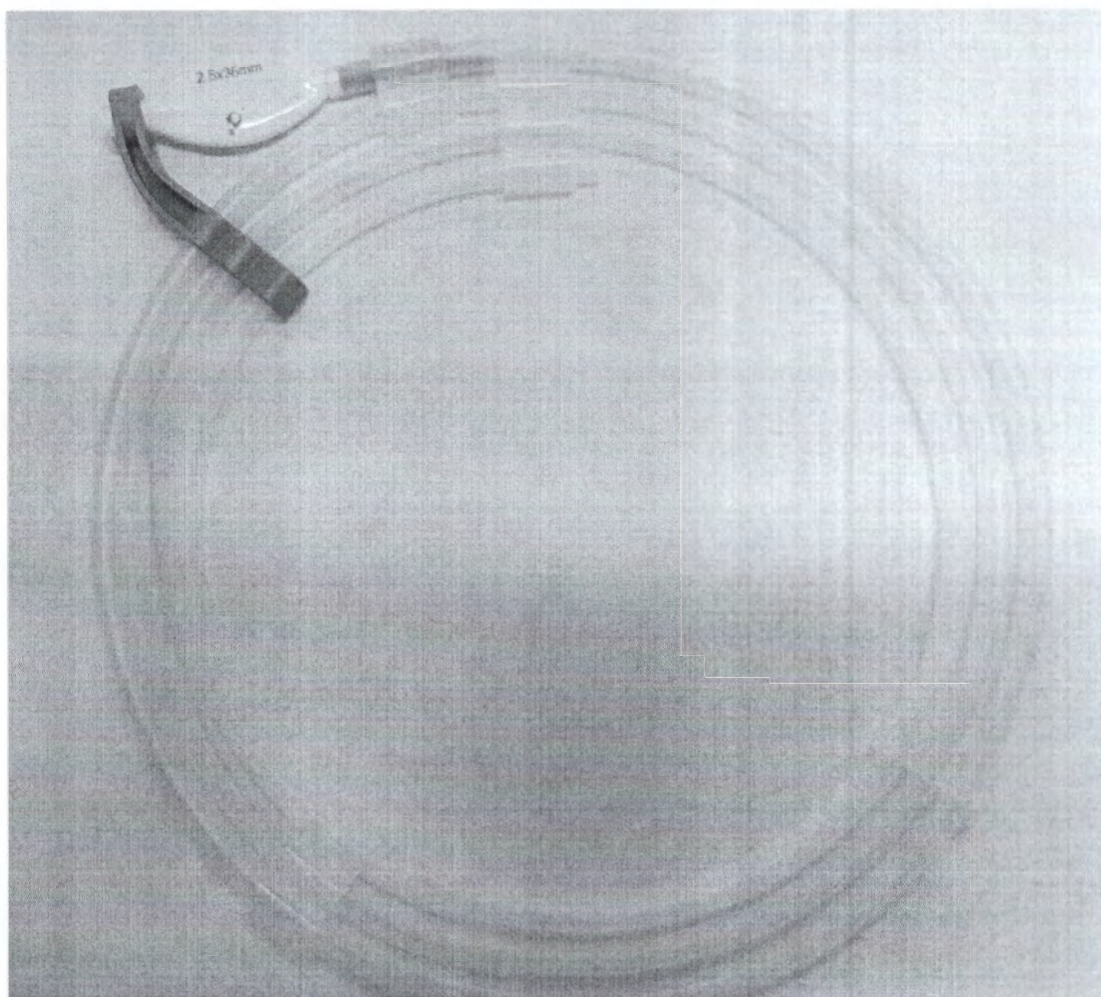


Фото 43. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC2536 длина 36 мм, диаметр 2,5 мм)

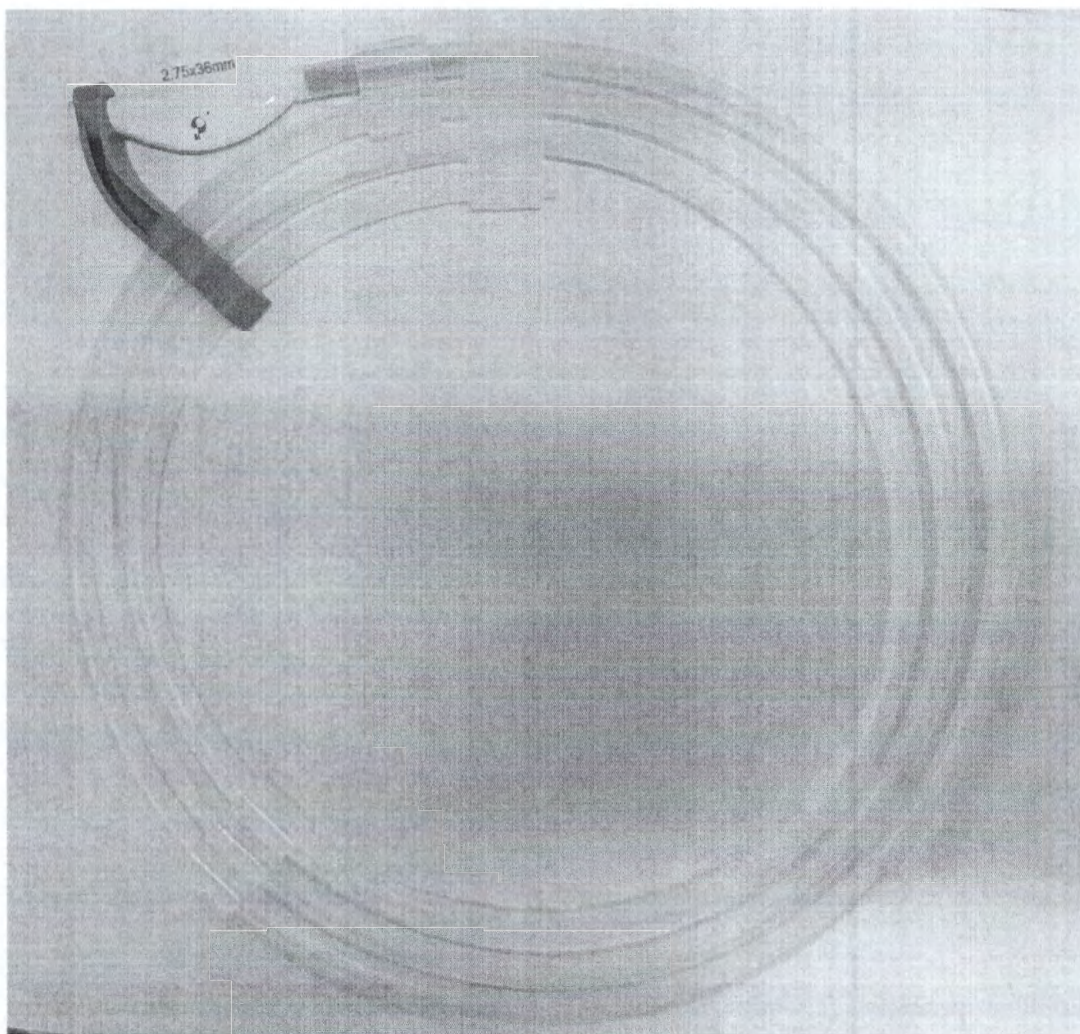


Фото 44. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC2736 длина 36 мм, диаметр 2,75 мм)

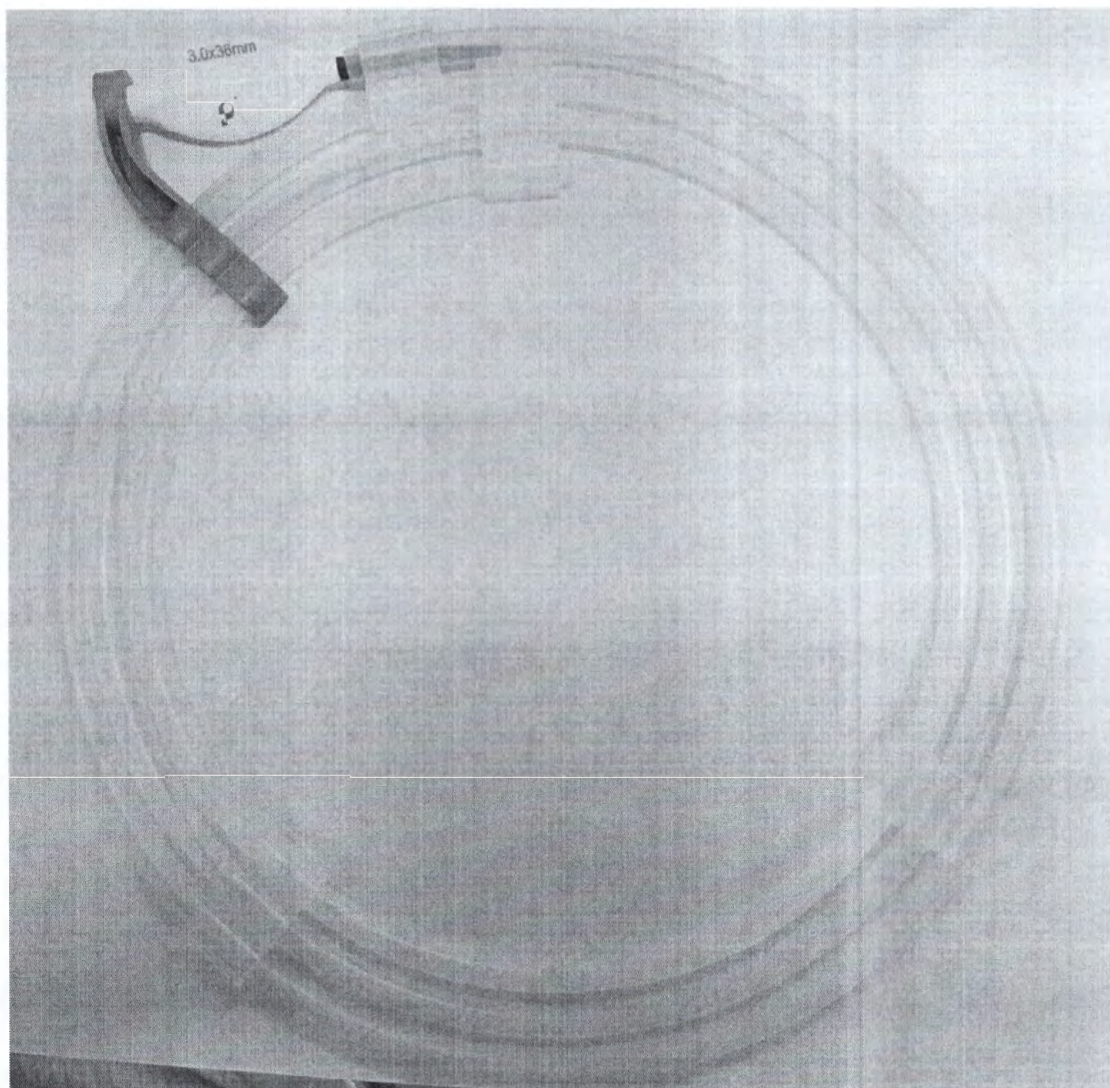


Фото 45. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC3036 длина 36 мм, диаметр 3 мм)

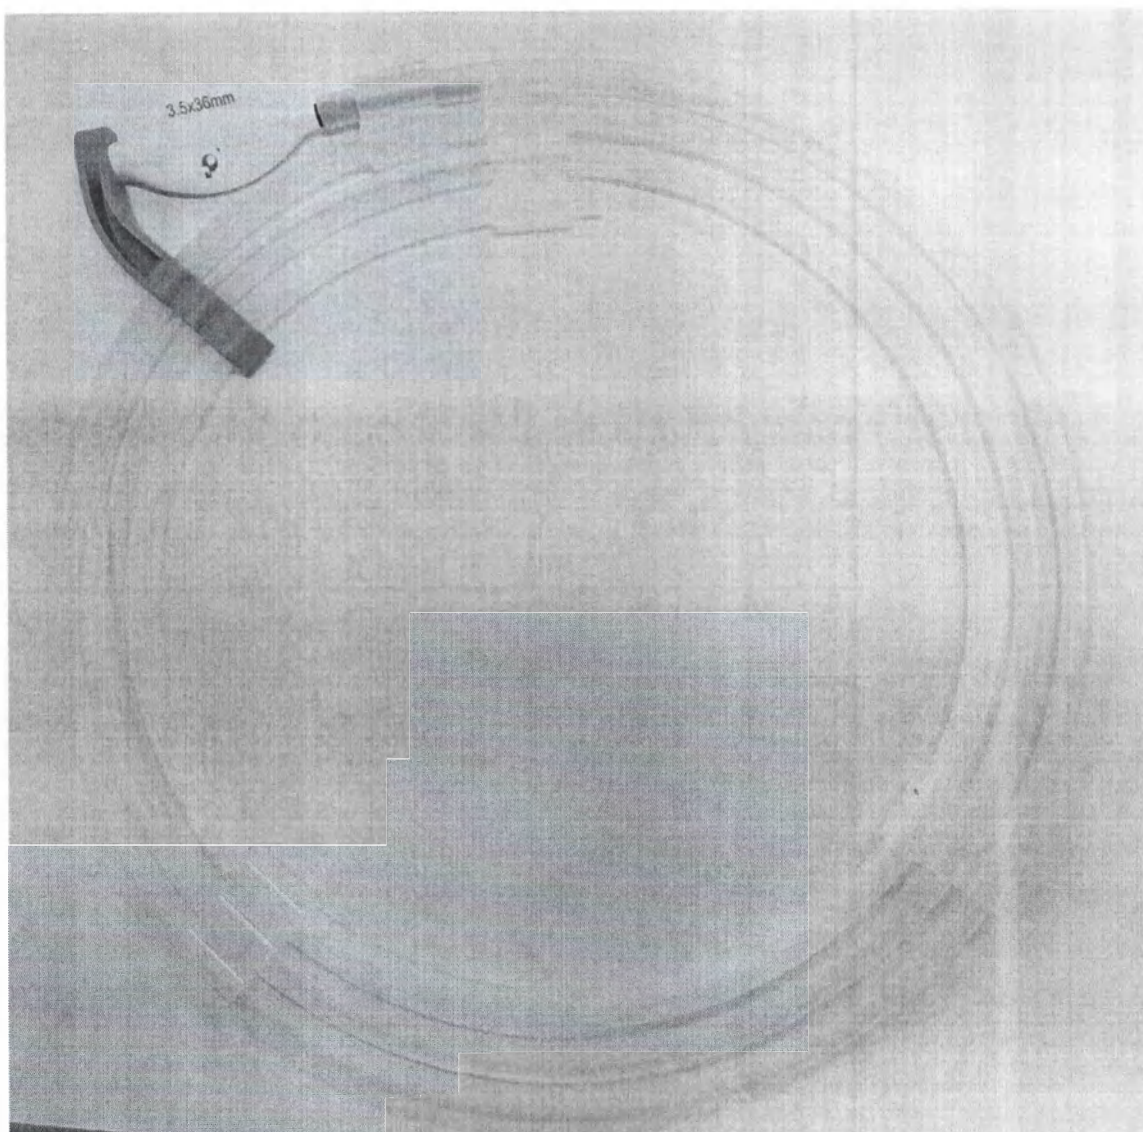


Фото 46. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC3536 длина 36 мм, диаметр 3,5 мм)

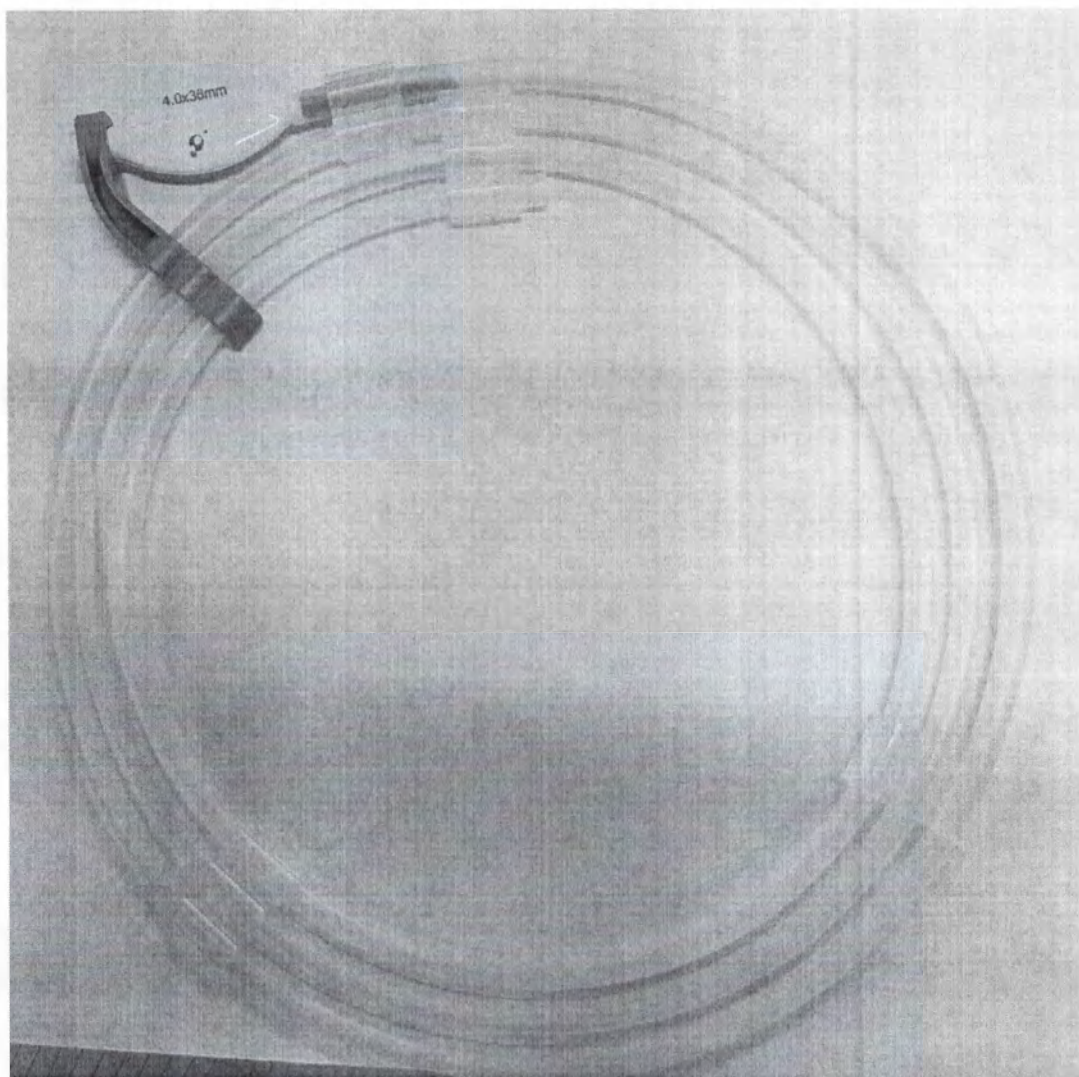


Фото 47. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC4036 длина 36 мм, диаметр 4 мм)

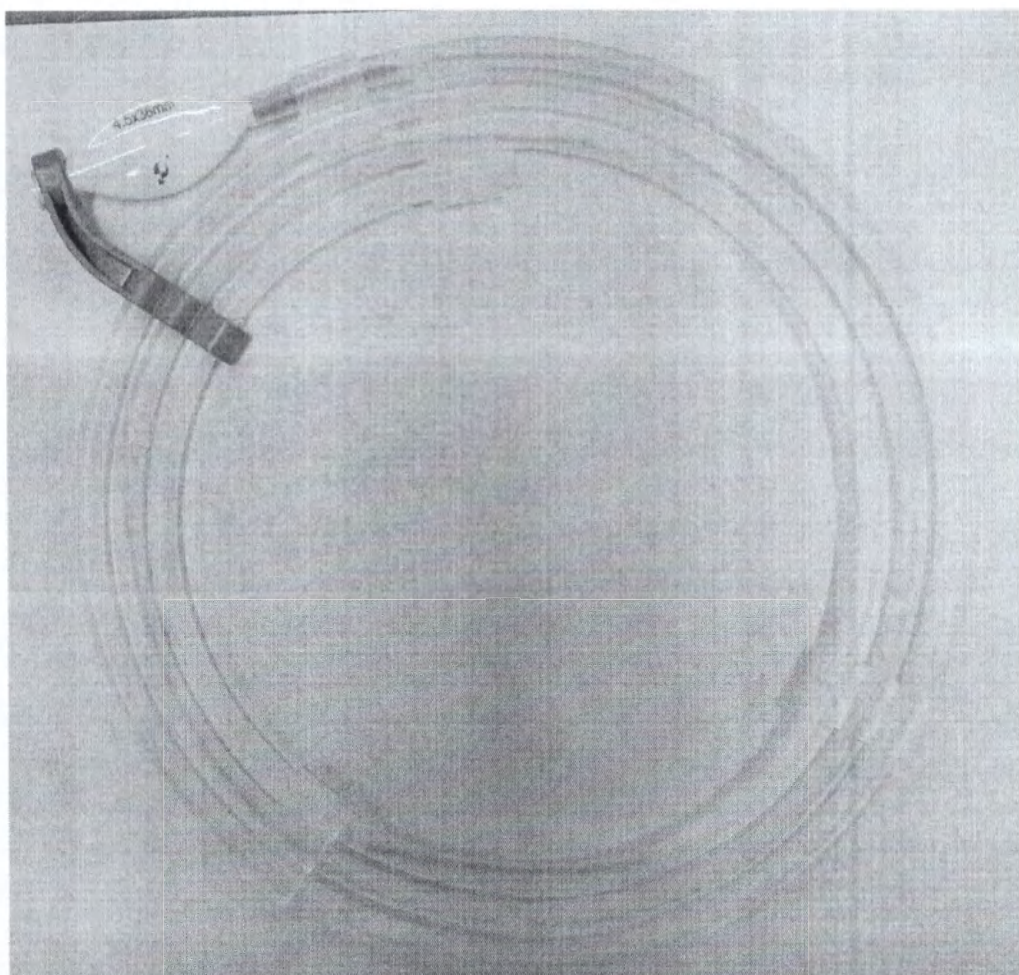


Фото 48. Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки (LPRPC4536 длина 36 мм, диаметр 4,5 мм).

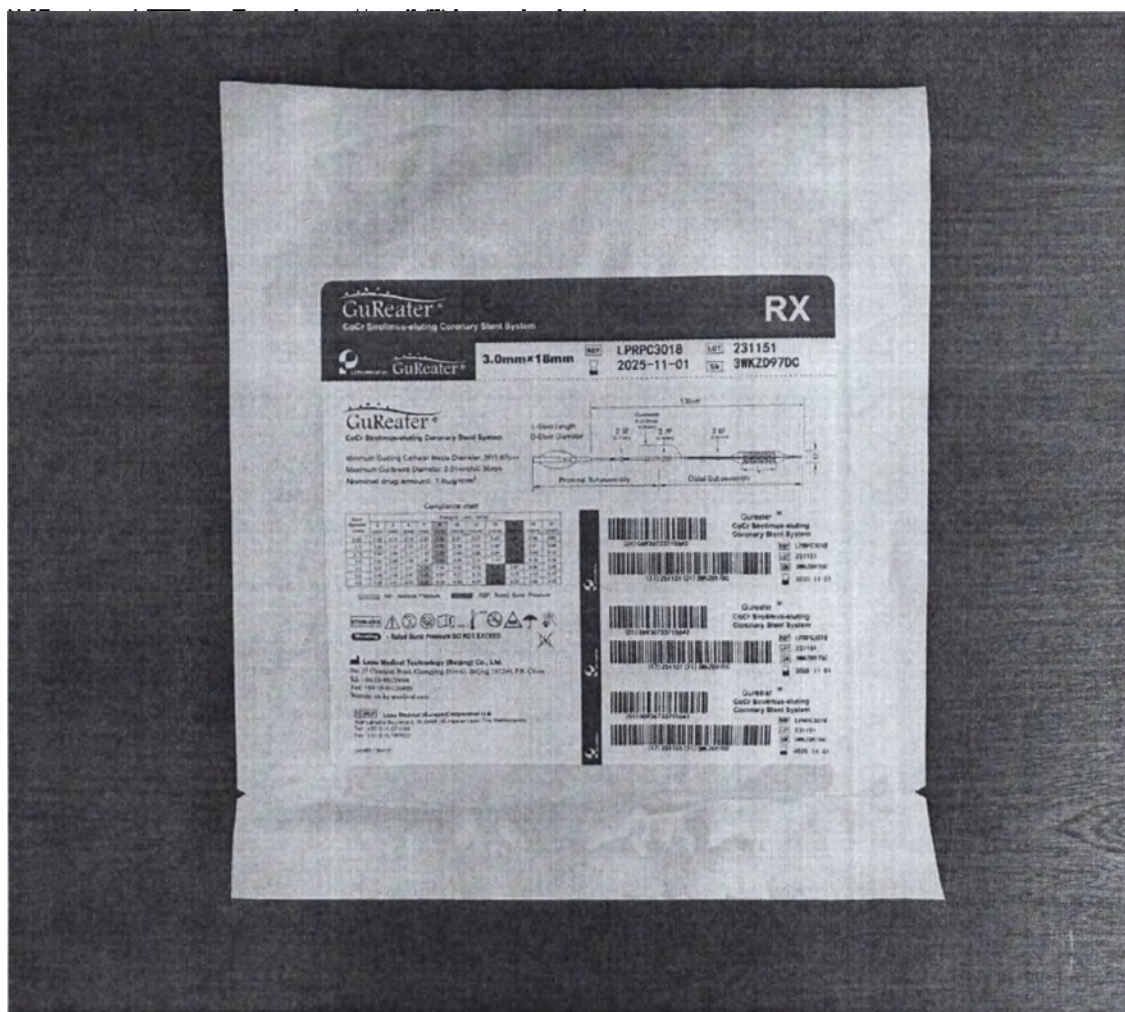


Фото 49.

«Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки». Внешний пакет. Маркировка.

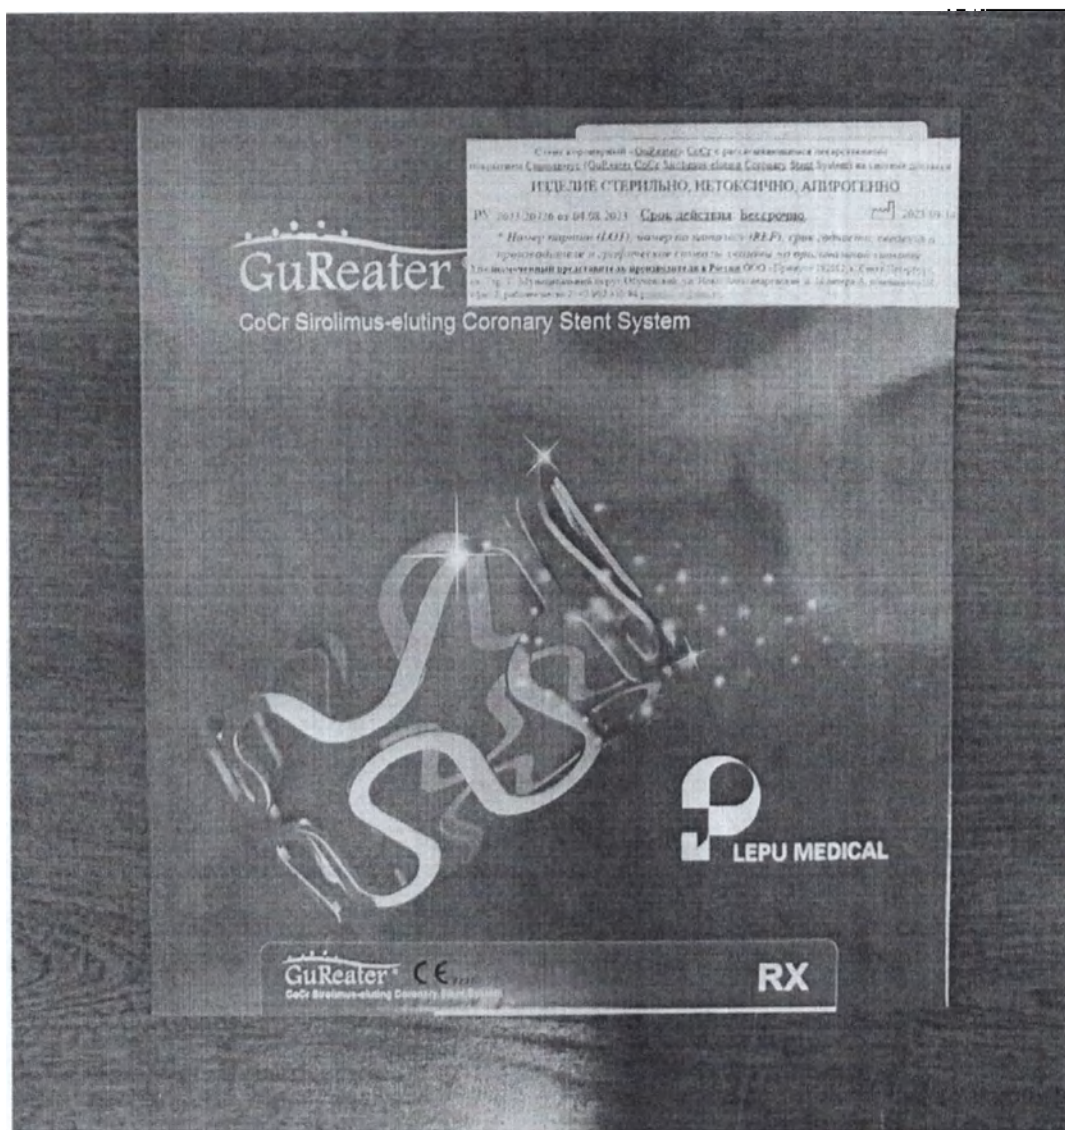


Фото 50.

«Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки». Внешняя упаковка. Картонная коробка.

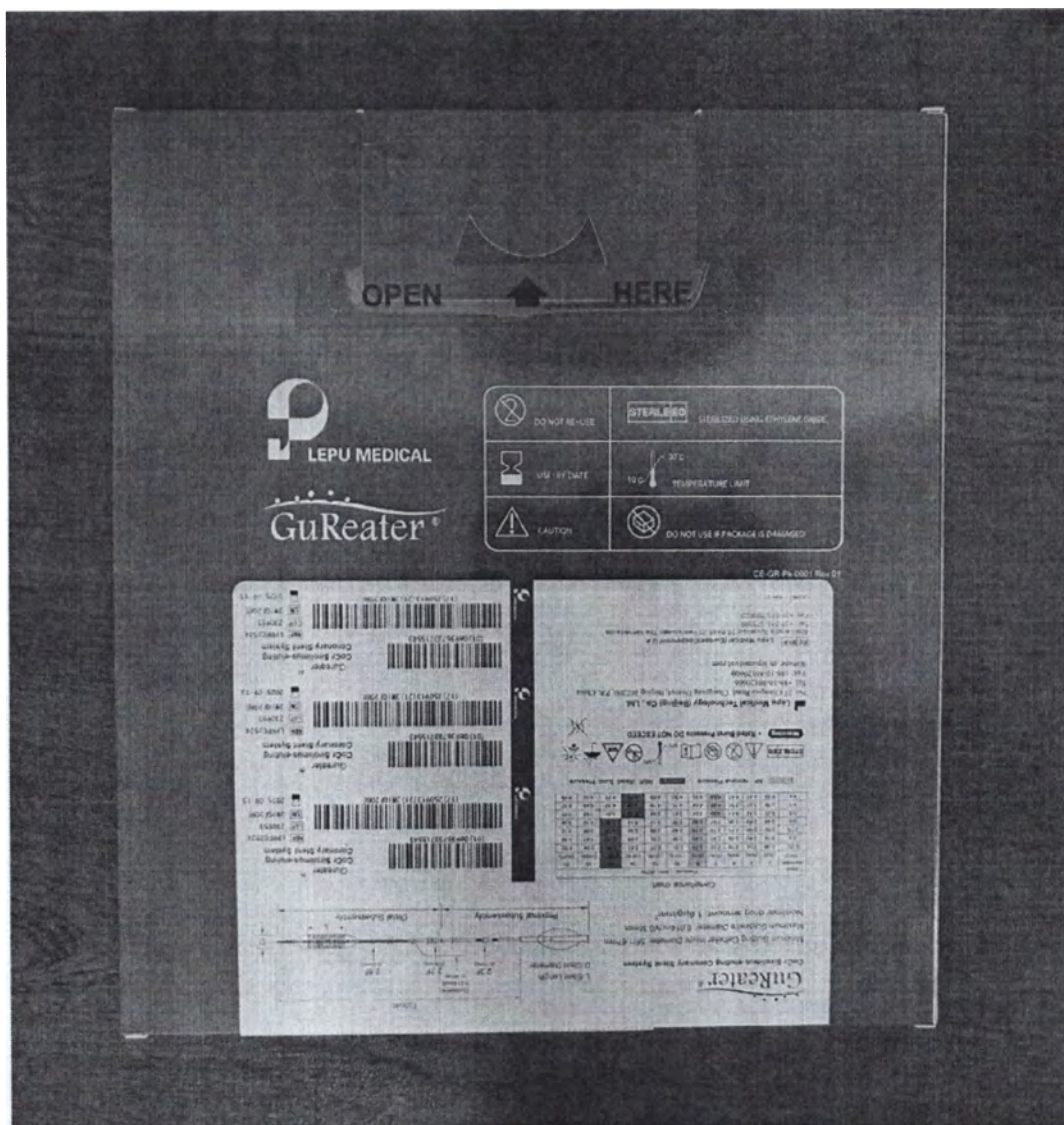


Фото 51.

«Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки». Внешняя упаковка. Картонная коробка.Макрировка.

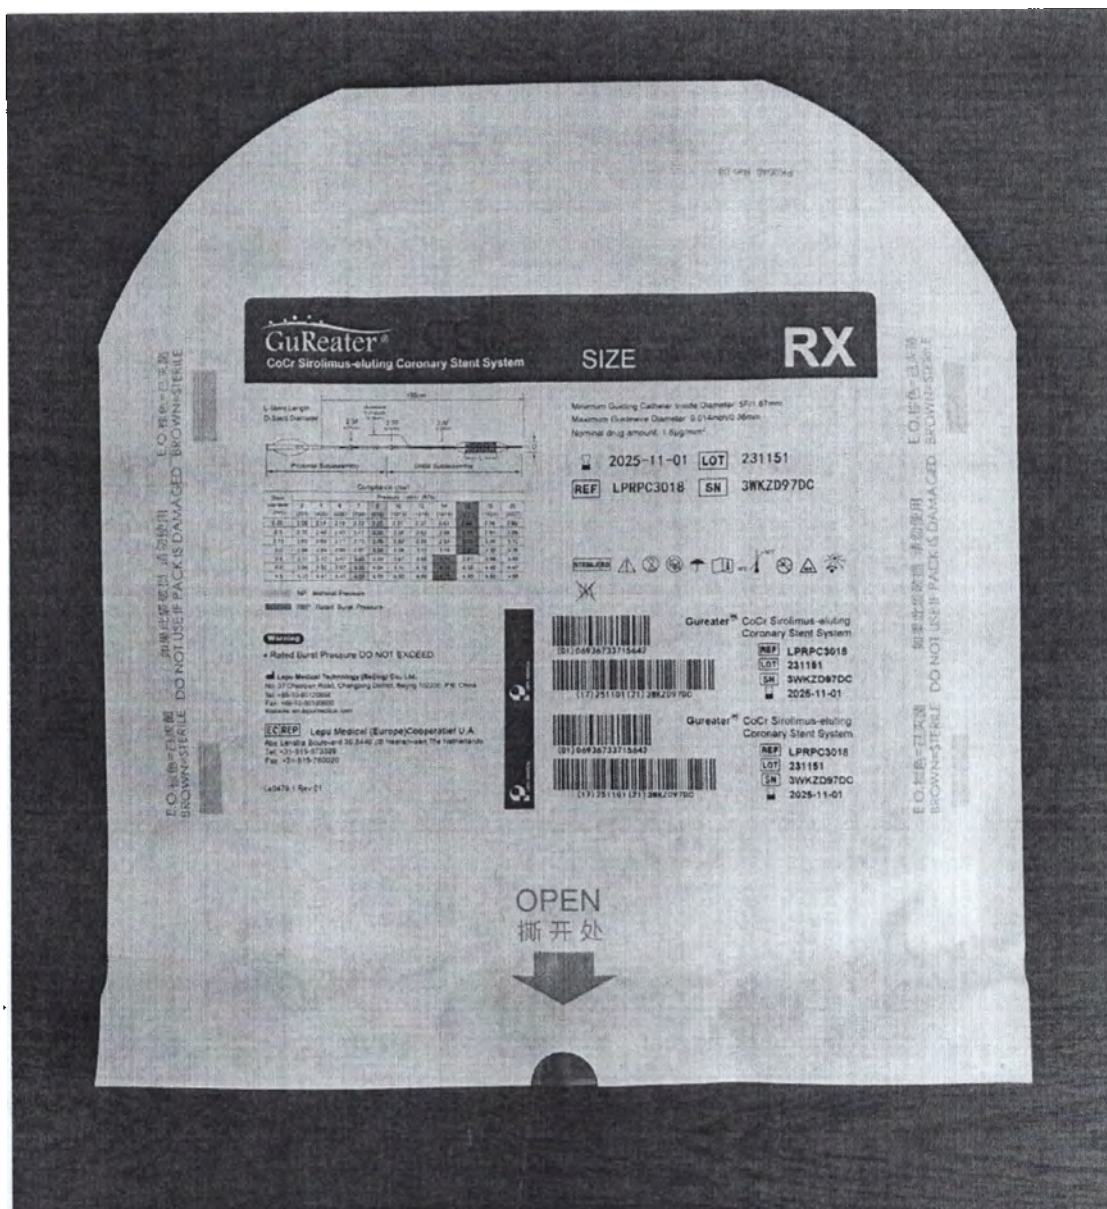


Фото 52.

«Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки». Внутренний пакет. Маркировка.

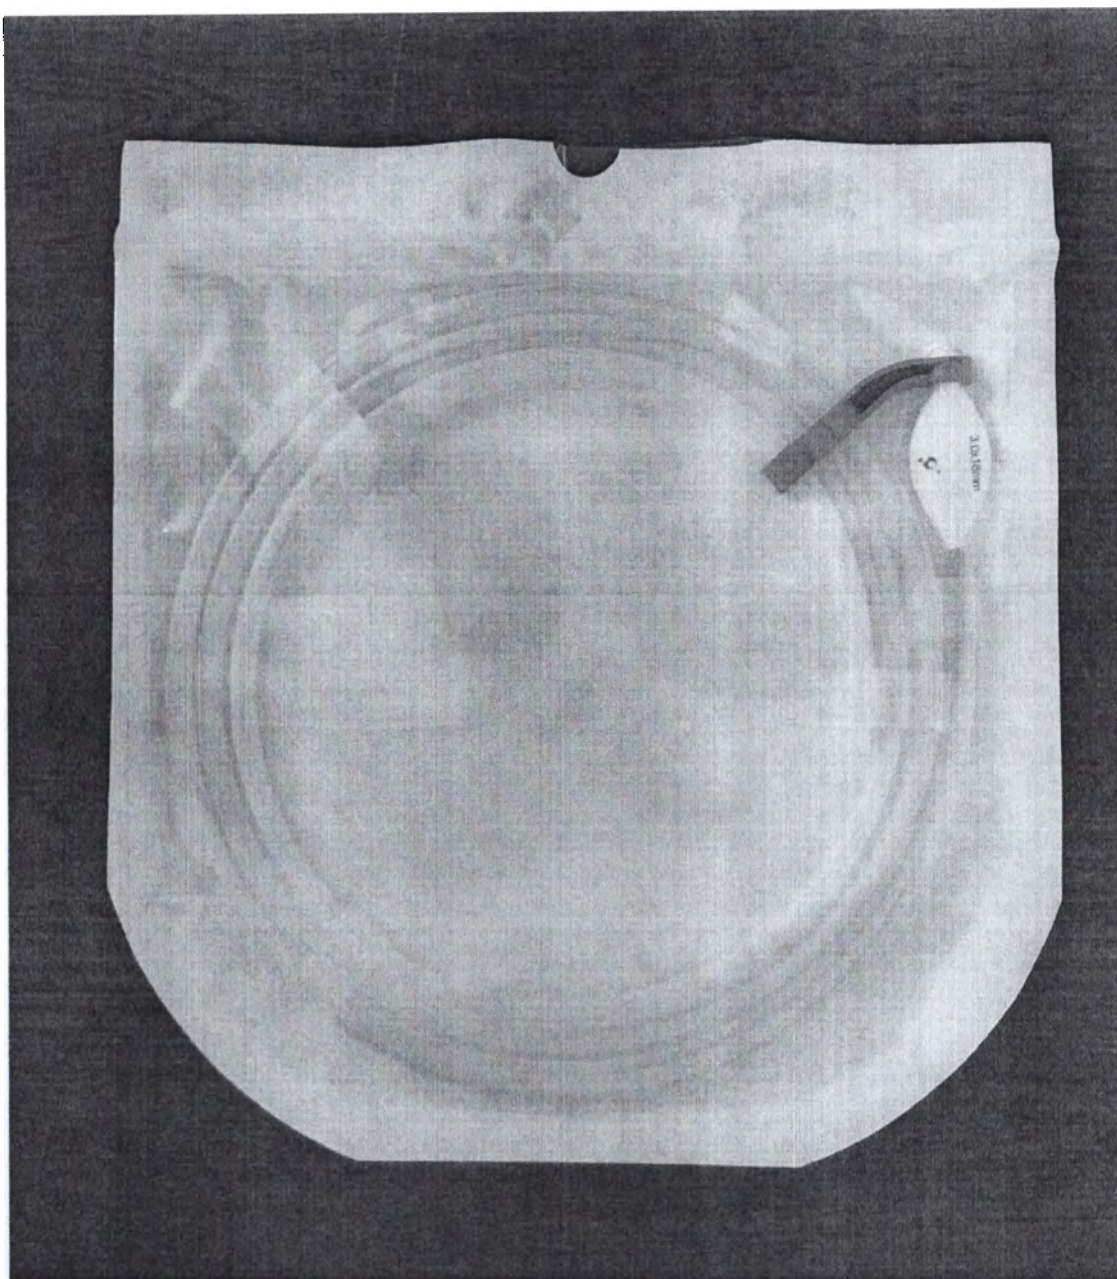


Фото 53.

«Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки». Внутренний пакет.

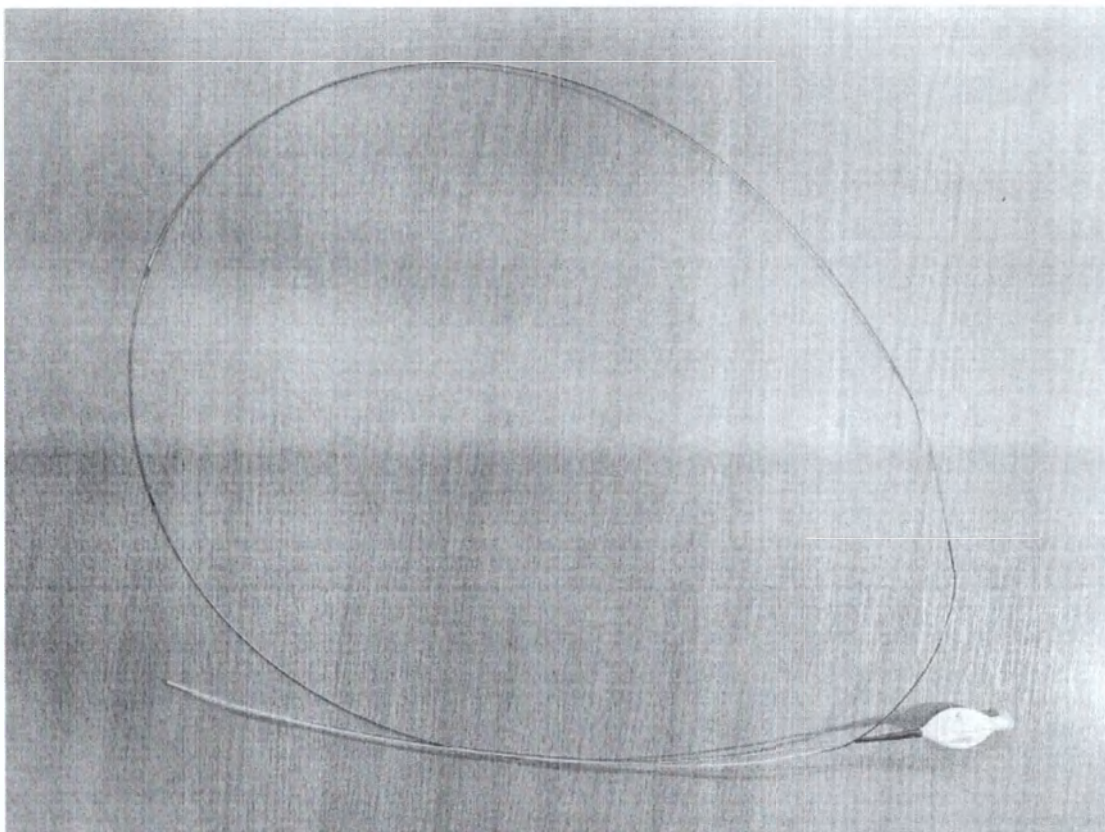


Фото 54.

«Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки». Стент без защитной трубки.

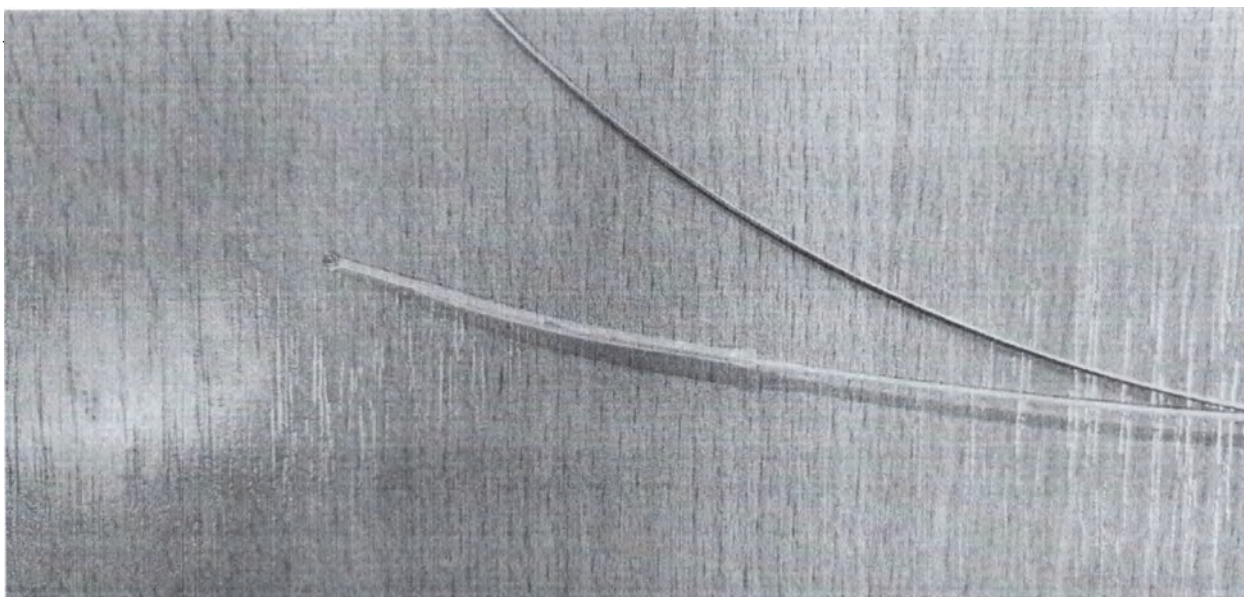


Фото 55.

«Стент коронарный «GuReater» CoCr с рассасывающимся лекарственным покрытием Сиролимус (GuReater CoCr Sirolimus-eluting Coronary Stent System) на системе доставки». Стент. Раскрываемой баллон.

