


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**


**Набор реагентов для типирования генов главного комплекса
гистосовместимости (HLA-генотипирования) геномной ДНК человека
методом секвенирования нового поколения (NGS) для *in vitro*
диагностики**



Общий вид содержимого Упаковки 1

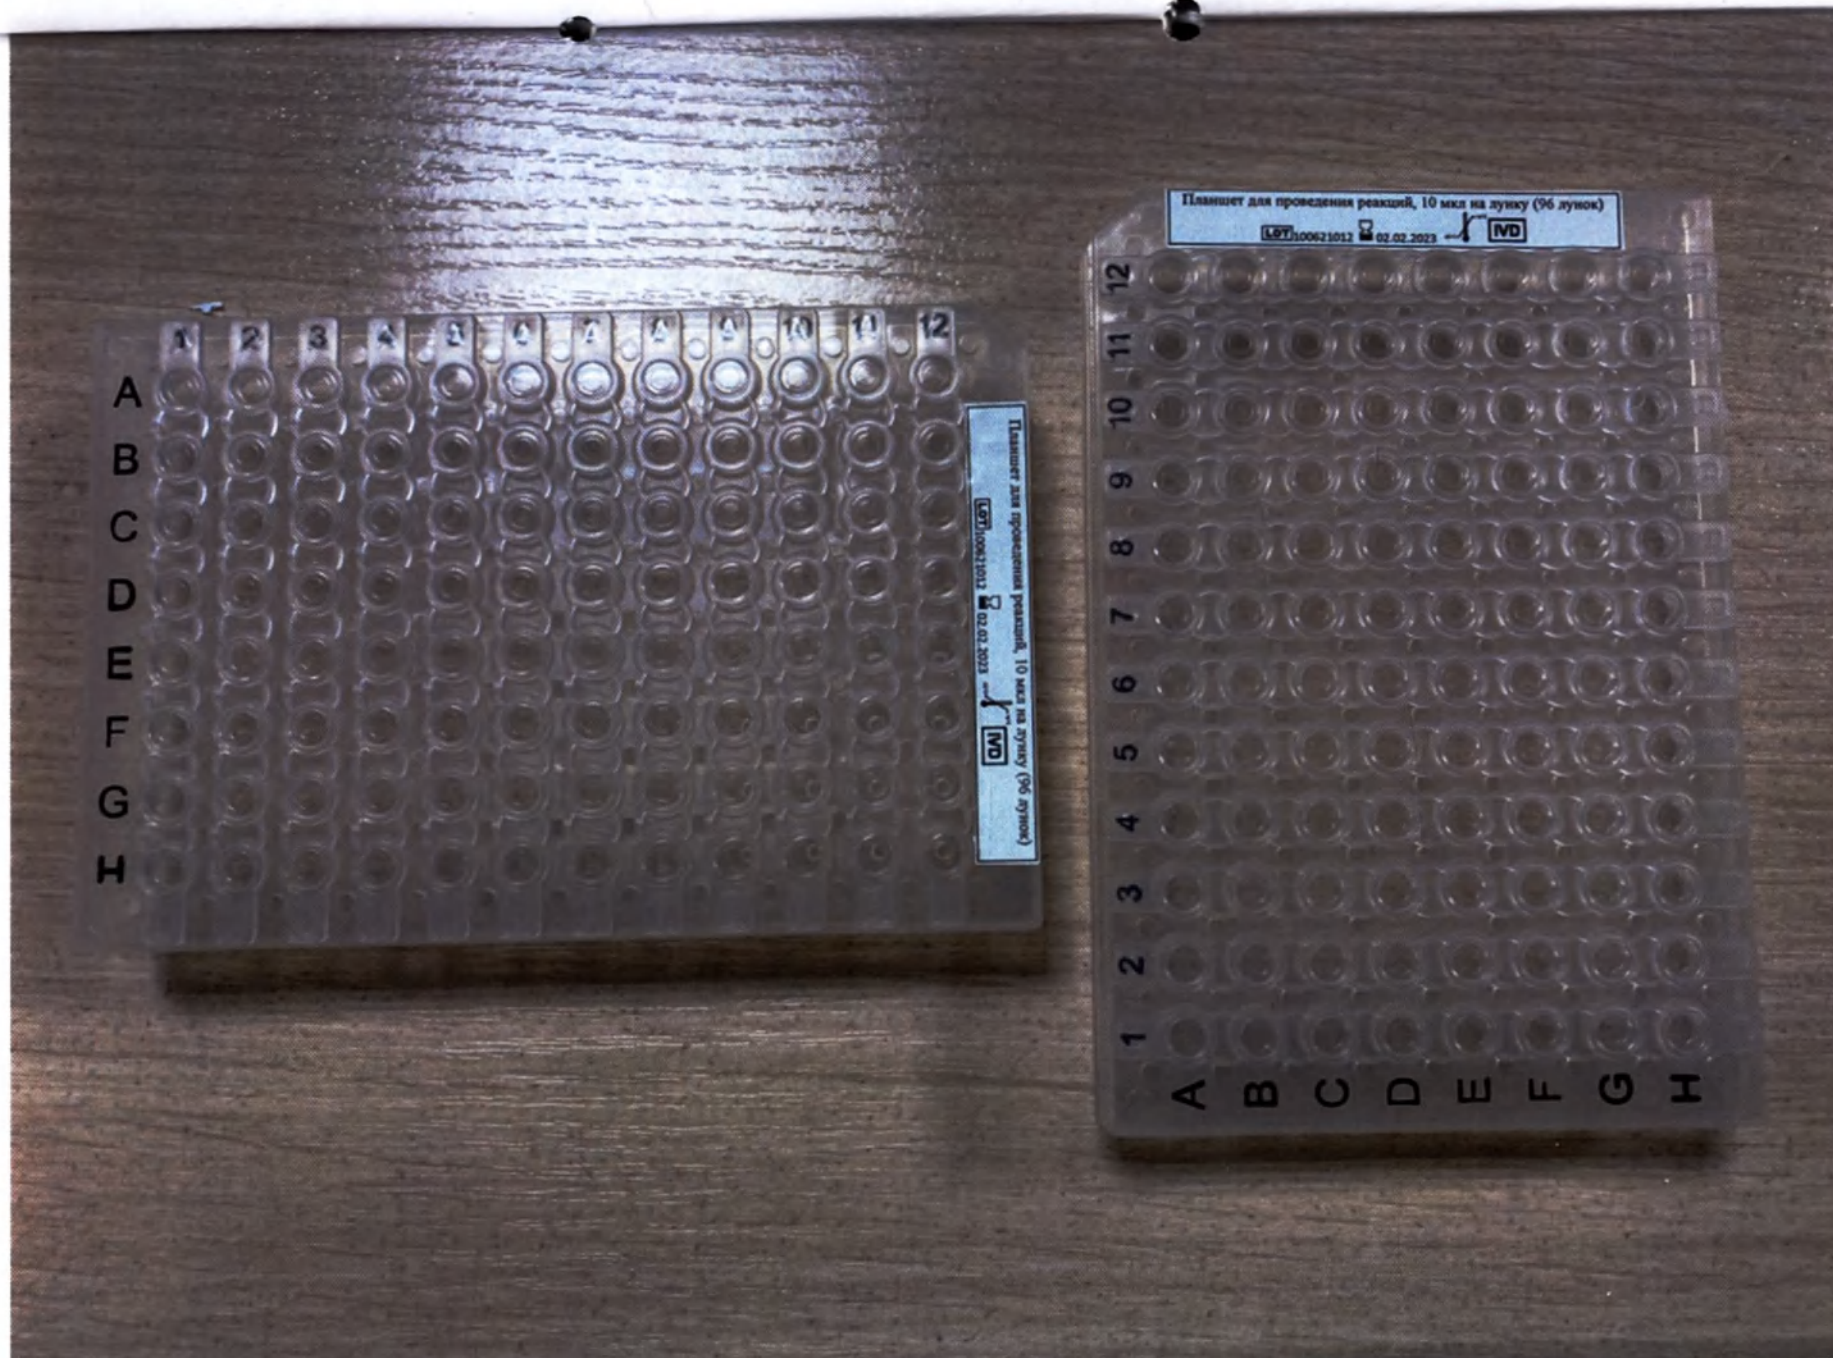

Планшет для проведения реакций, 10 мкл на лунку (96 лунок) – Упаковка 1

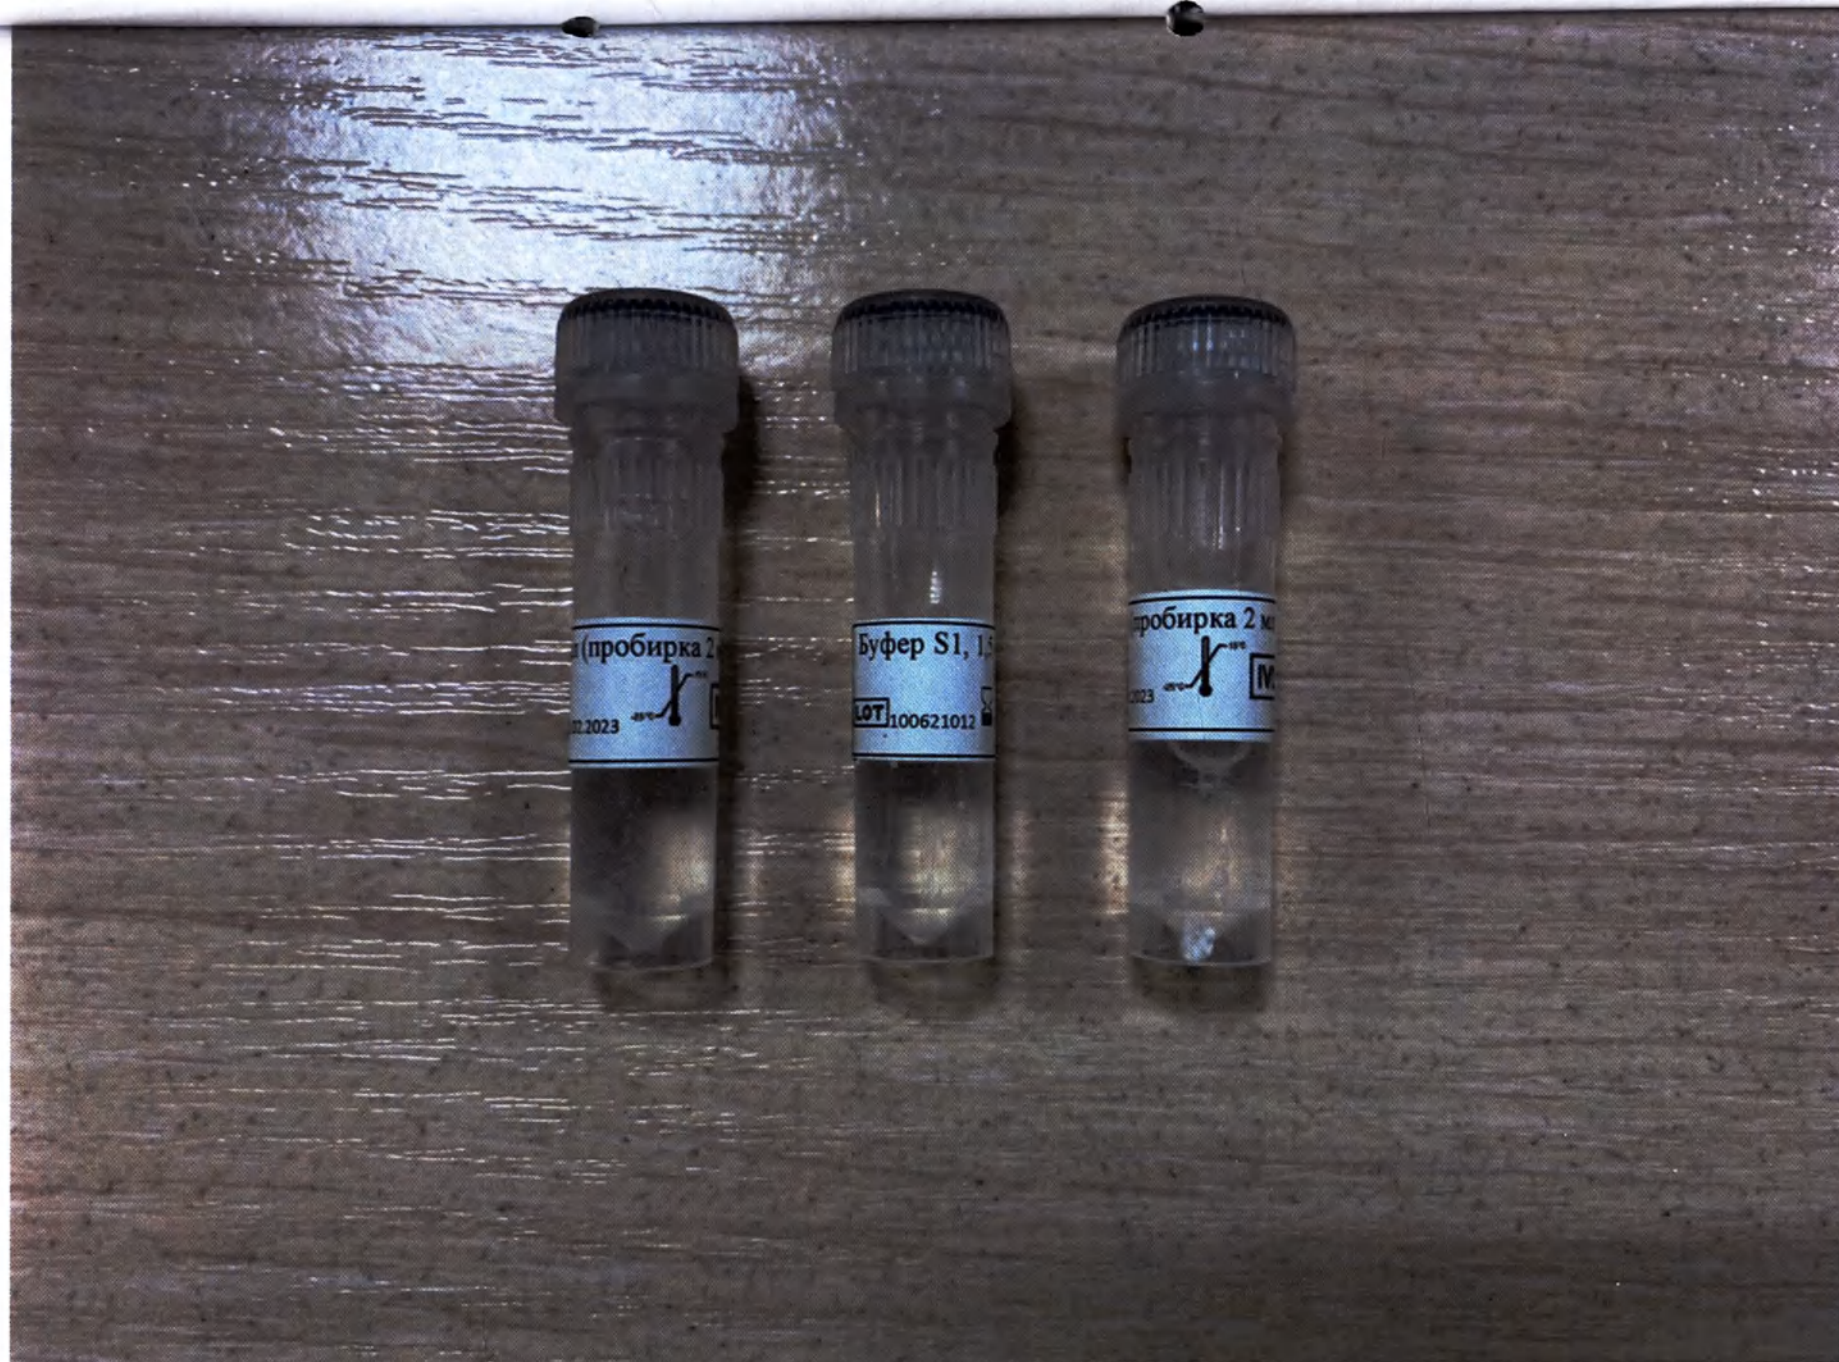

Буфер S1, 1,5 мл (пробирка 2 мл) – Упаковка 1



Буфер S2, 1,8 мл (пробирка 2 мл) – Упаковка 1

Набор реагентов для типирования генов главного комплекса гистосовместимости (HLA-генотипирования) геномной ДНК человека методом секвенирования нового поколения (NGS) для in vitro диагностики

Упаковка I, в составе:


6. Планшет для проведения реакций, 10 мкл на лунку (96 лунок) – 2 шт.
7. Буфер S1, 1,5 мл (пробирка 2 мл) – 3 шт.
8. Буфер S2, 1,8 мл (пробирка 2 мл) – 1 шт.
9. Инструкция по применению.
10. Руководство пользователя на программное обеспечение GeMS UI.

LOT 100621012

REF HLA-96S-v6

 02.02.2022

 02.02.2023



№ РУ XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX



ООО «МедТех», 108814, г. Москва, километр Калужское шоссе 24-й (п. Сосенское), владение 1, строение 1, помещение XIV/эт. 7/ком. 43

Место производства
Scisco Genetics, 6840 54th Ave NE, Seattle, WA 98115-7753, USA

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «МедТех», 108814, г. Москва, километр Калужское шоссе 24-й (п. Сосенское), владение 1, строение 1, помещение XIV/эт. 7/ком. 43, Тел. +7 (495) 101-62-12, E-mail: info@medtehltd.com

Маркировка Упаковки I




Общий вид содержимого Упаковки 2



Планшет для проведения реакций, 10 мкл на лунку (96 лунок) – Упаковка 2




Буфер S2, 1,8 мл (пробирка 2 мл) – Упаковка 2

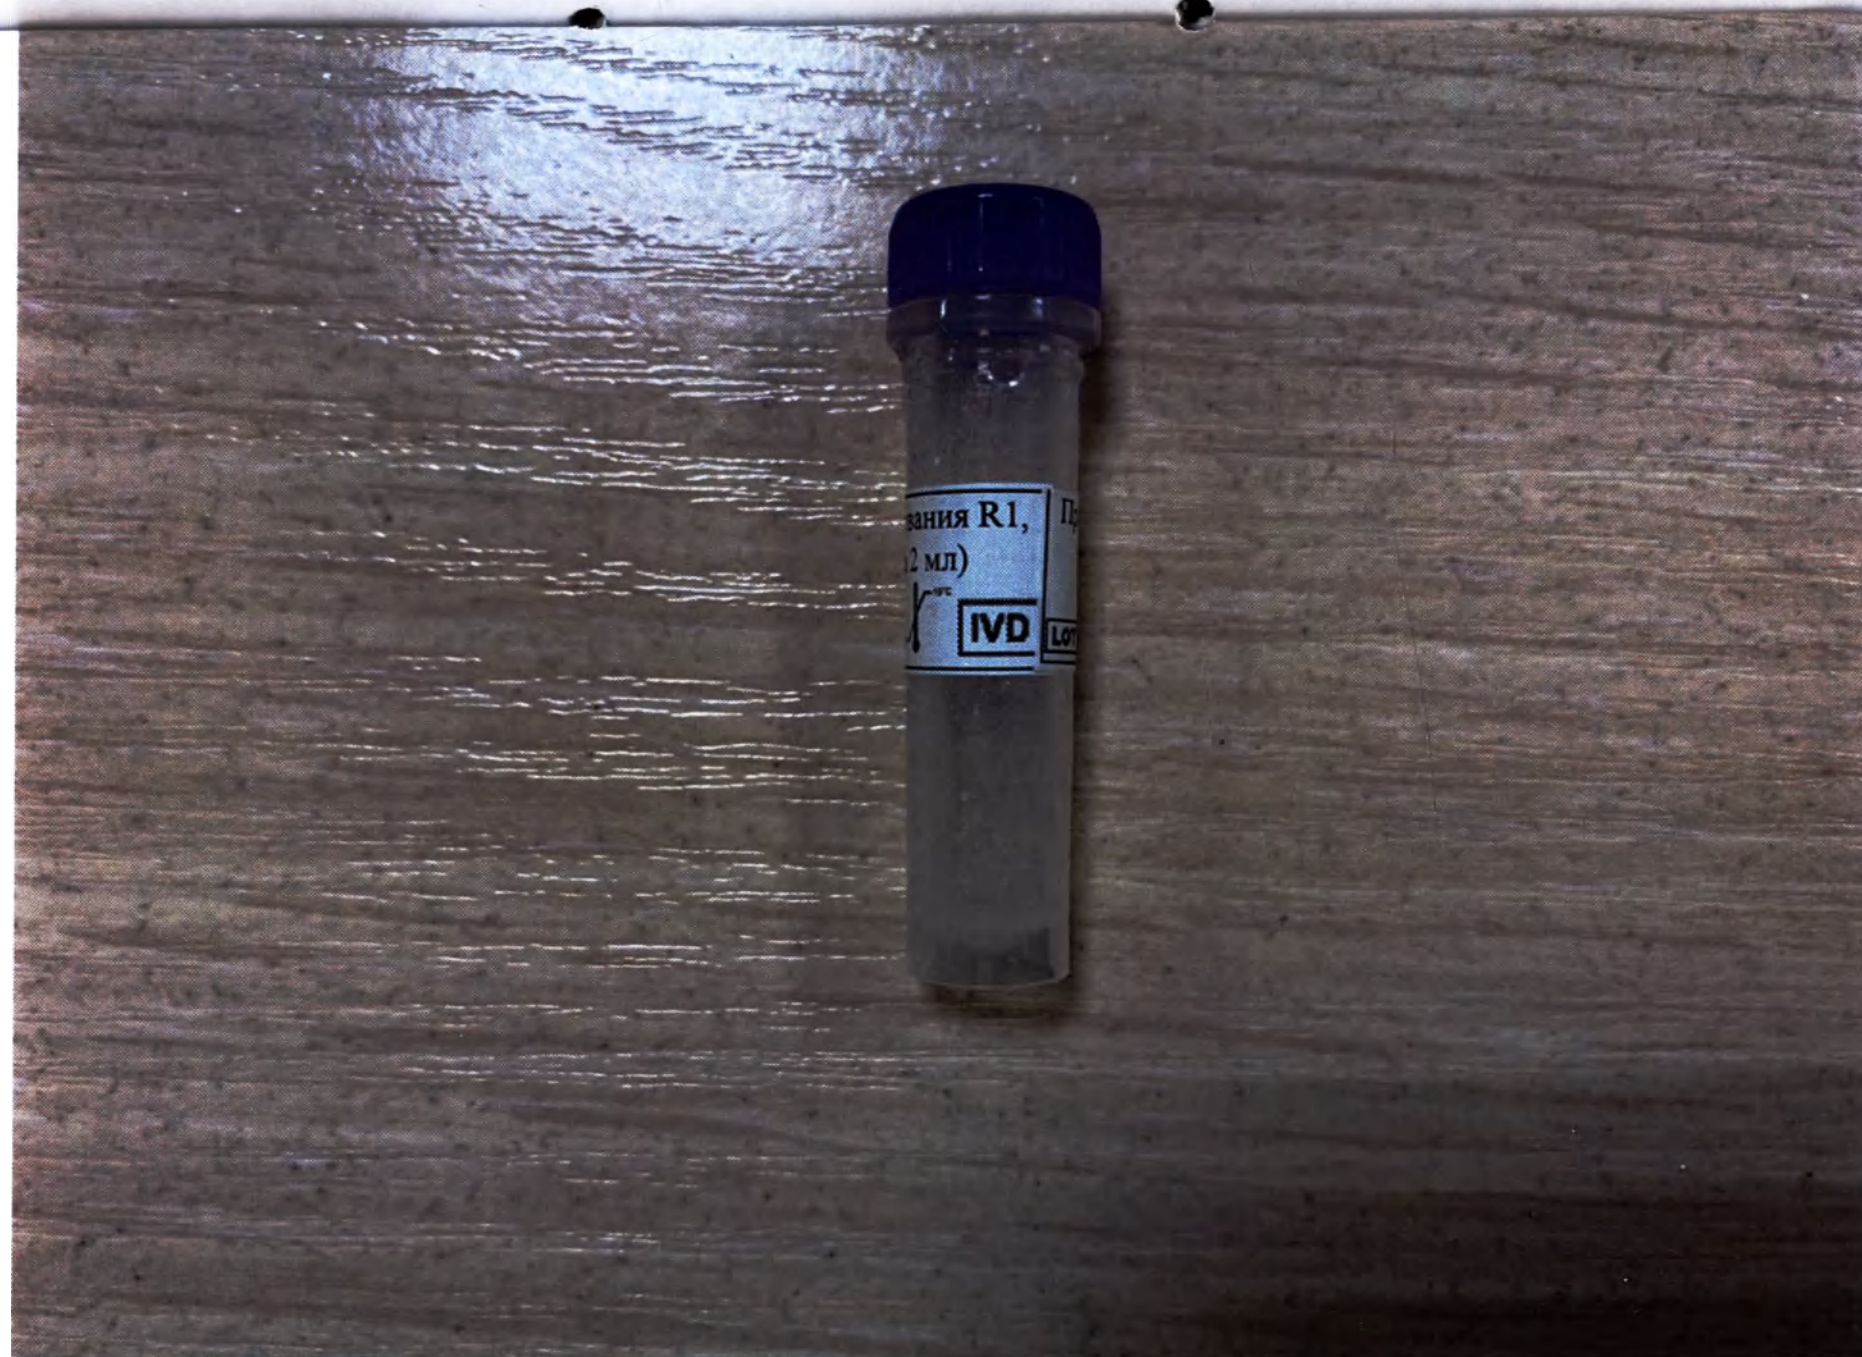

Праймер для секвенирования R1, 30 мкл (пробирка 2 мл) – Упаковка 2



Праймер для секвенирования Index, 30 мкл (пробирка 2 мл) – Упаковка 2

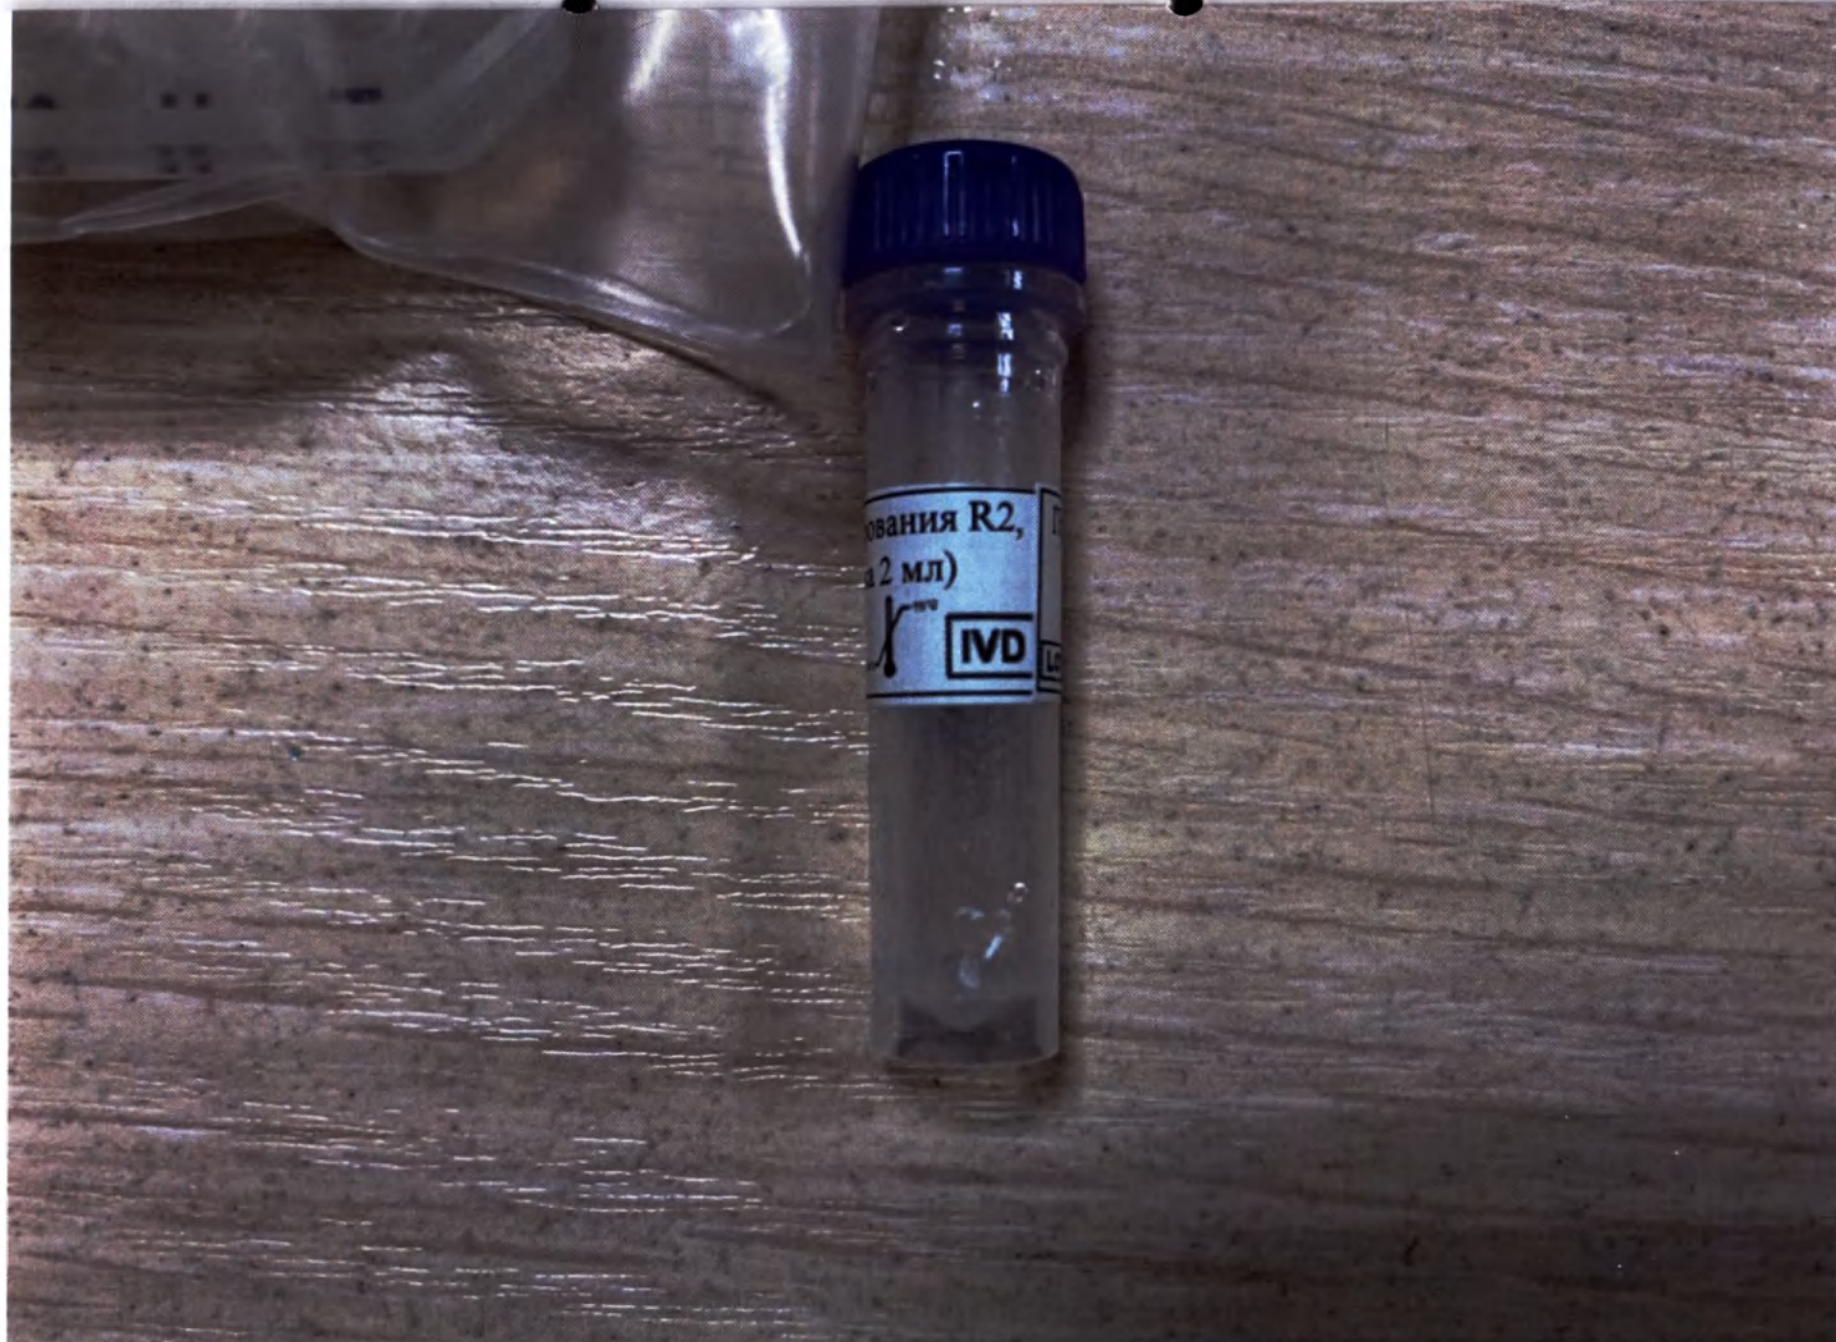

Праймер для секвенирования R2, 30 мкл (пробирка 2 мл) – Упаковка 2

Набор реагентов для типирования генов главного комплекса гистосовместимости (HLA-генотипирования) геномной ДНК человека методом секвенирования нового поколения (NGS) для in vitro диагностики

Упаковка 2, в составе:

6. Планшет для проведения реакций, 10 мкл на лунку (96 лунок) – 2 шт.
7. Буфер S2, 1,8 мл (пробирка 2 мл) – 2 шт.
8. Праймер для секвенирования R1, 30 мкл (пробирка 2 мл) – 1 шт.
9. Праймер для секвенирования Index, 30 мкл (пробирка 2 мл) – 1 шт.
10. Праймер для секвенирования R2, 30 мкл (пробирка 2 мл) – 1 шт.

LOT 100621012

REF HLA-96S-v6

 02.02.2022

 02.02.2023



№ РУ XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX



ООО «МедТех», 108814, г. Москва, километр Калужское шоссе 24-й (п. Сосенское), владение 1, строение 1, помещение XIV/эт. 7/ком. 43

Место производства

Scisco Genetics, 6840 54th Ave NE, Seattle, WA 98115-7753, USA

Уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «МедТех», 108814, г. Москва, километр Калужское шоссе 24-й (п. Сосенское), владение 1, строение 1, помещение XIV/эт. 7/ком. 43, Тел. +7 (495) 101-62-12, E-mail: info@medtehltd.com

Маркировка Упаковки 2



Внесено в программу
и (интерпретация) мнений.