


Фотографические изображения


Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HCV II cobas e analyzers), в вариантах исполнения

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HCV II cobas e analyzers/A-HCV II), вариант исполнения на 100 тестов, в составе:


1. Кассета с реагентами на три отделения (флакона): M, R1, R2, 1 шт. в упаковке
2. Калибратор 1 (A-HCV II Cal1), флакон, объем 1,3 мл, 2 шт. в упаковке
3. Калибратор 2 (A-HCV II Cal2), флакон, объем 1,3 мл, 2 шт. в упаковке
4. Этикетка для флакона, 12 шт. в упаковке
5. Инструкция по применению

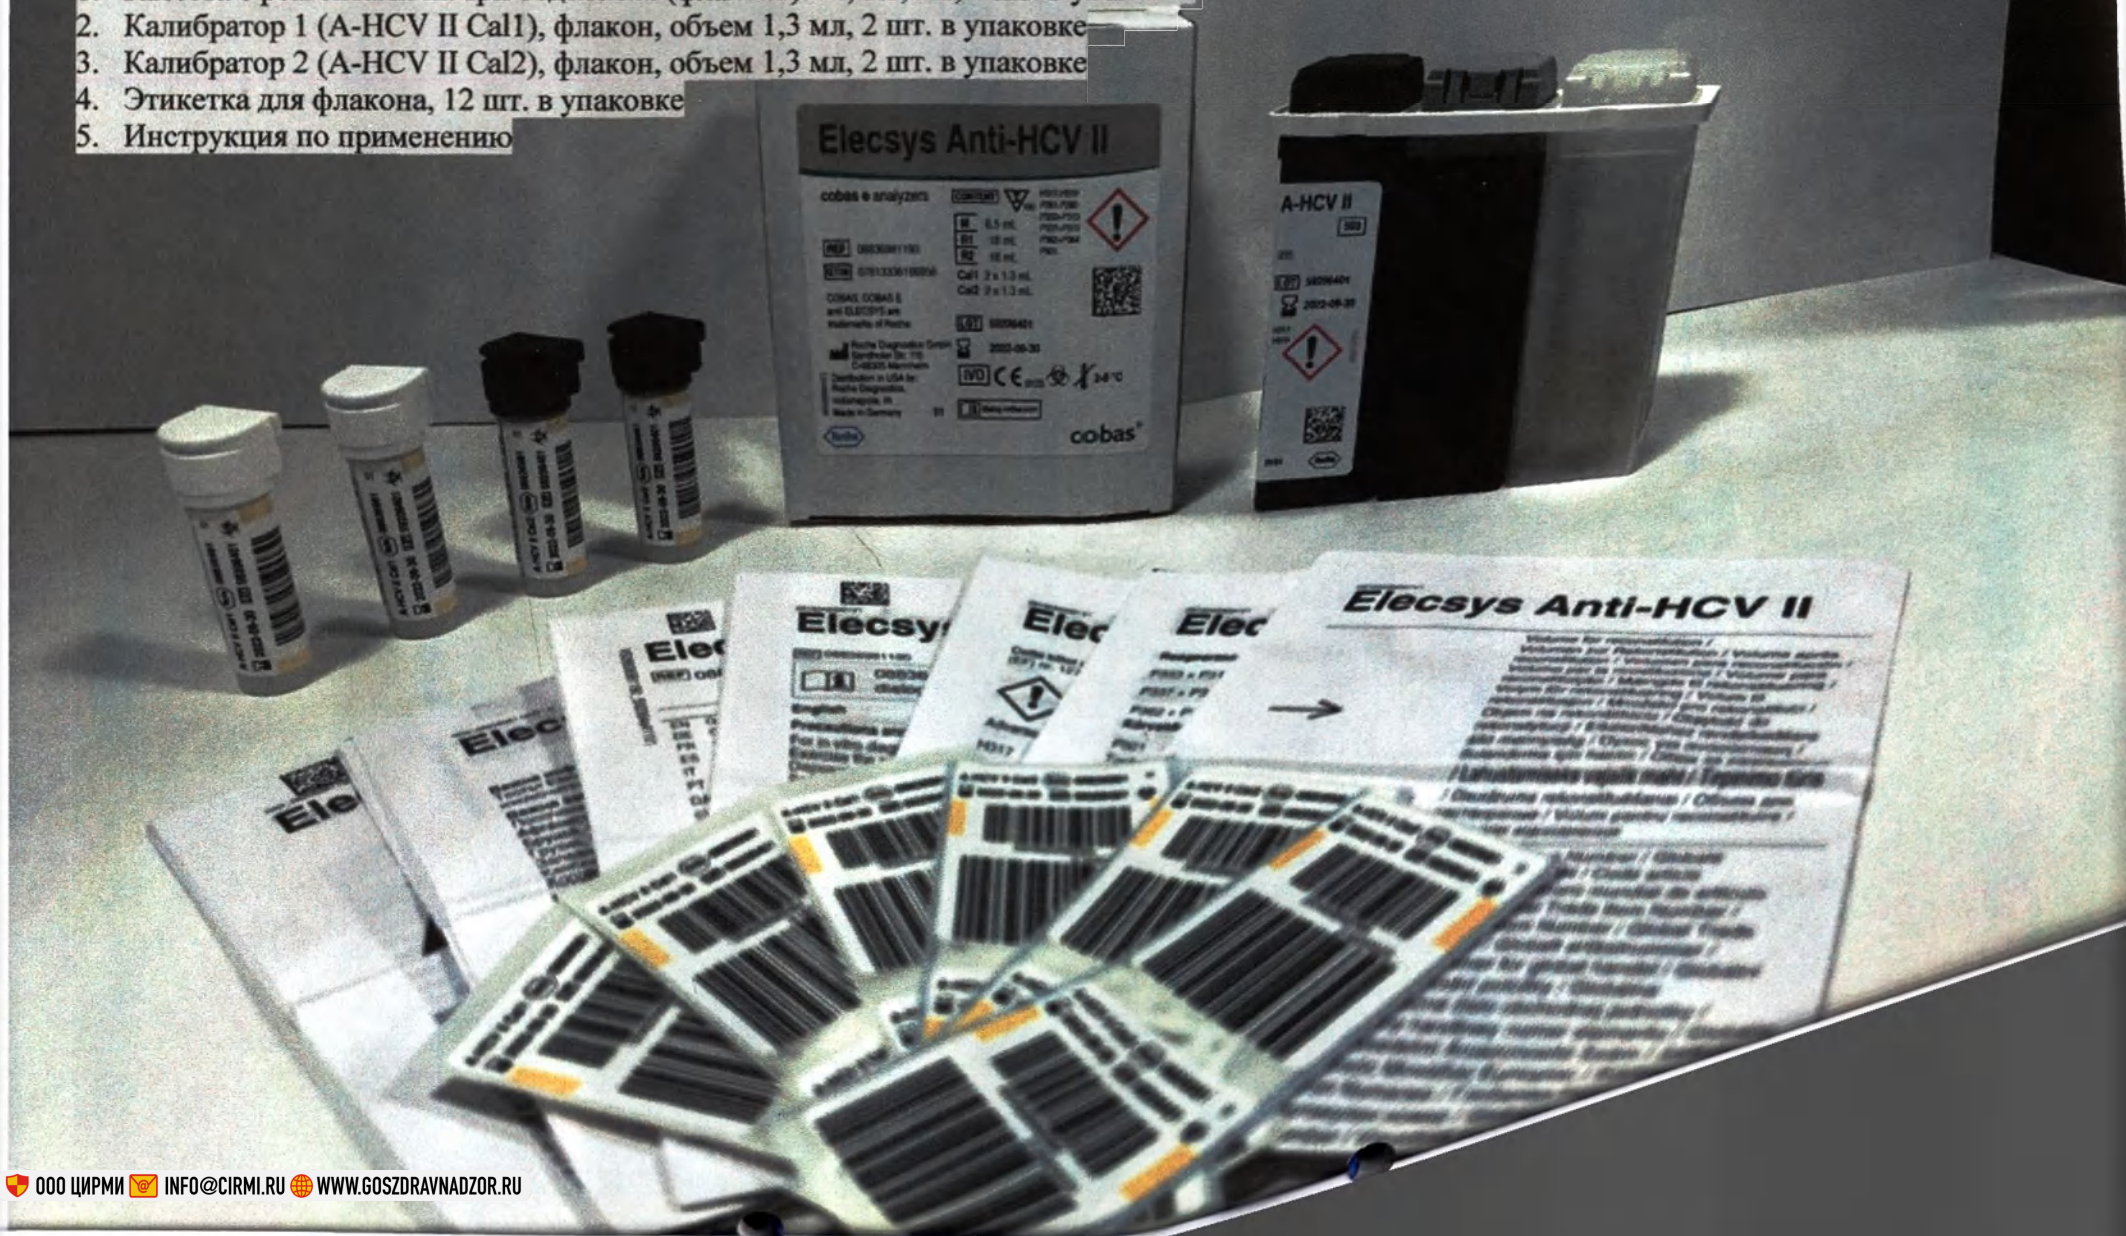

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HCV II cobas e analyzers/A-HCV II), вариант исполнения на 100 тестов

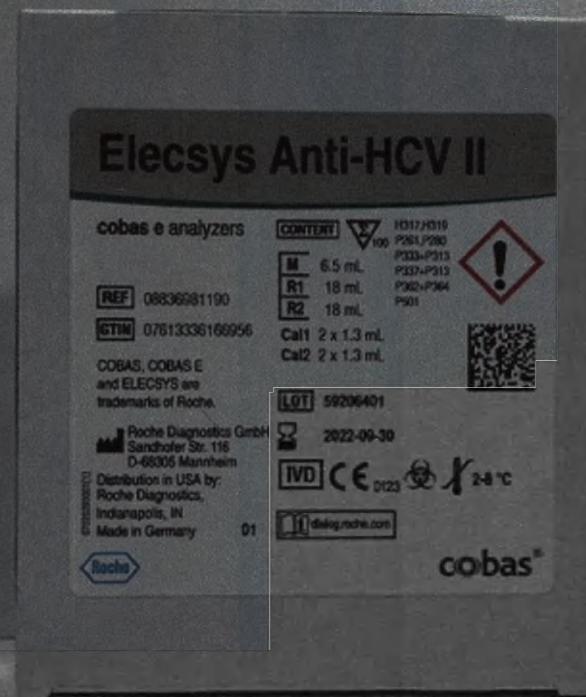

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HCV II cobas e analyzers/A-HCV II), вариант исполнения на 100 тестов

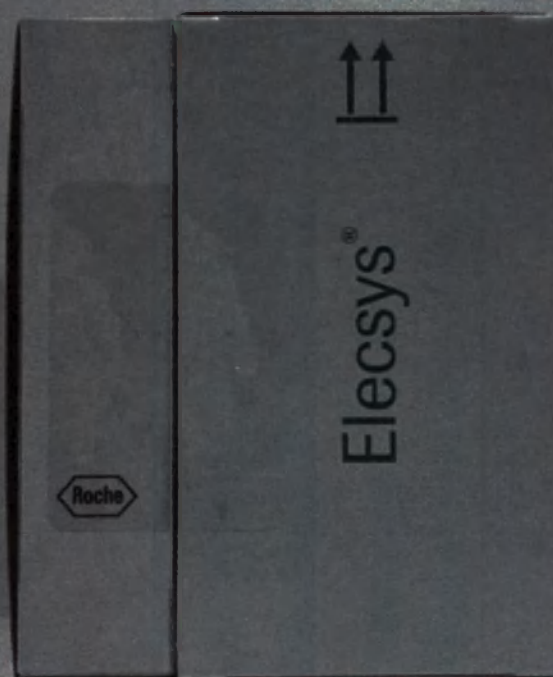

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HCV II cobas e analyzers/A-HCV II), вариант исполнения на 100 тестов

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HCV II cobas e analyzers/A-HCV II), вариант исполнения на 100 тестов, в составе:

1. Кассета с реагентами на три отделения (флаконе): M, R1, R2, 1 шт. в упаковке
2. Калибратор 1 (A-HCV II Cal1), флакон, объем 1,3 мл, 2 шт. в упаковке
3. Калибратор 2 (A-HCV II Cal2), флакон, объем 1,3 мл, 2 шт. в упаковке
4. Этикетки для флакона, 12 шт. в упаковке
5. Инструкция по применению

Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/13992 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Сыворотка крови, содержащая антитела к вирусу гепатита С (A-HCV II Cal2), была инактивирована с использованием β-пропиолактона и УФ-излучения.

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рох Диагностикс ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия


Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рох Диагностика Рус» (ООО «Рох Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64.

E-mail: moscow.reception2_dia@roche.com

Кит. номер 08836981190

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HCV II cobas e analyzers/A-HCV II), вариант исполнения на 100 тестов

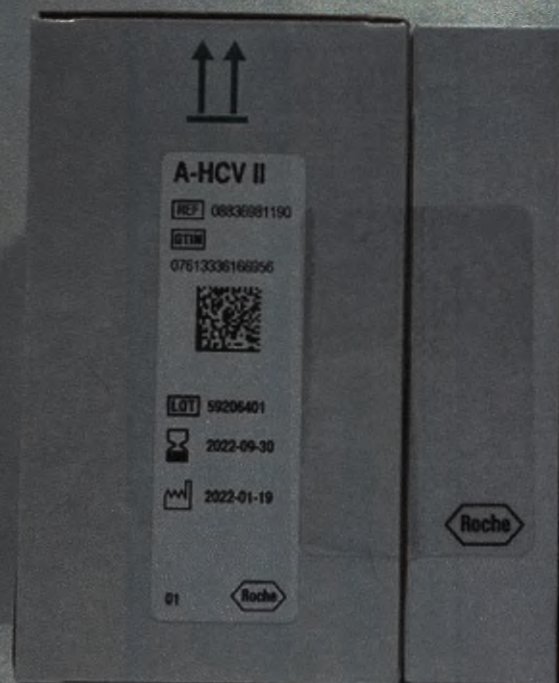

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HCV II cobas e analyzers/A-HCV II), вариант исполнения на 100 тестов

Кассета с реагентами на три отделения (флакона): M, R1, R2




Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HCV II cobas e analyzers/A-HCV II), вариант исполнения на 100 тестов

Кассета с реагентами на три отделения (флакона): M, R1, R2



Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HCV II cobas e analyzers/A-HCV II), вариант исполнения на 100 тестов

Калибратор 1 (A-HCV II Cal1), флакон, объем 1,3 мл

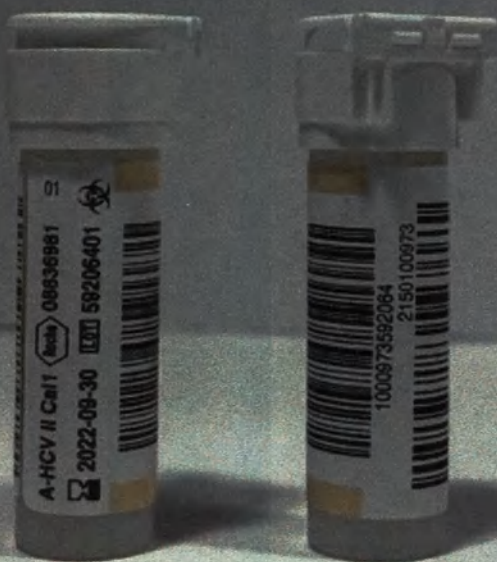



Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HCV II cobas e analyzers/A-HCV II), вариант исполнения на 100 тестов

Этикетка для флакона



Elecsys Anti-HCV II

cobas®

08C03098 1190	☐ 01		codhas @ 411 codhas @ 001 codhas @ 002
08C03098 1500		100	

Рис. 1

Системная информация

Для заказа позвоните по телефону 2150

Апрел 2012-го года 601 и 602-го года 503

References

Test: Enzyme Anti-HCV II (специфичен кодол) тест гел в vitro (анализатор). Препоръчителен при изследването обективизация алуминия к брой резистанс C (HCV) в диспозитив и изпитане изпити чинища.

Экспериментальный институт "ЕЦА" призван не только способствовать развитию науки, но и оказывать помощь в развитии науки и техники в других странах.

Исследования контрольных образцов

Детский асептический свищ шейки мочевого пузыря (ДАСВ) — это врожденная патология, характеризующаяся наличием свища между мочевым пузырем и кожей. Заболевание встречается редко, чаще всего у мальчиков. Причины ДАСВ до конца не ясны, но предполагается, что это связано с нарушением эмбрионального развития мочевого пузыря. Симптомы ДАСВ включают частое мочеиспускание, боли в области мочевого пузыря, а также образование свища, из которого вытекает моча. Лечение ДАСВ может быть консервативным или хирургическим, в зависимости от тяжести заболевания.

Историческое обоснование

[illegible]

на обнаружении антител к HCV во всем мире (концентрация/количество антител HCV в сыворотке), но различия, составив 1,6 %, что свидетельствовало о 115 различных вариантах вирусной популяции. Разнообразие антител к различным РНК HCV, выявляемый на этой стадии лечения G, была определена на уровне 1 %, что свидетельствовало о 71,1 различных вариантах. В заключение, в среднем 1,7 различных новых вирусных вариантов. В заключение

эксплуатации, инженерия, ИТ/системное программирование и другие, а также другие профессии, связанные с компьютерными технологиями.

на НСУ провоцирует при кровяном воздействии на кровь, на кровь или органы от инфекционного чинида. В развитии, из того, что организм человека крови действует уже в инфекцию, основным способом передачи НСУ является инородное приобретение микроорганизма. В виде различных реченных на группу передачи инфекции патогенность оказана, когда патогенность при применении микроорганизма патогенности или переносимости крови, на производной организм, для

Инструкция по применению

содержание HCV во всем теле у пациентов 400000 нуклеотидов. ALT в 10 раз превышает норму. Вывод: для выявления и подтверждения диагноза требуется проведение лабораторных исследований (анализ крови). Анализ крови: ALT в 10 раз превышает норму. Вывод: для выявления и подтверждения диагноза требуется проведение лабораторных исследований (анализ крови). Анализ крови: ALT в 10 раз превышает норму. Вывод: для выявления и подтверждения диагноза требуется проведение лабораторных исследований (анализ крови).

Принцип второго

Присутствует: Общественность: 18 инв.

- 1-4 недели: 50 лет опыта, 55 лет партнер с противоположным биологическим HCV-инфицированным, и 55 лет партнер с противоположным HCV-неинфицированным, никаких прививок и наркотиков, контакт в прошлом с противоположным половым партнером.
- 2-4 недели: Печень заболела несколько лет, попутно гепатитом, образовалась киста селезенки с тирозидной фазой прогрессирующей биохимической болезни и гепатитом.
- Печеньная киста, гепатиты в анамнезе и редкий, редкий медицинский контакт на протяжении ста лет в прошлом, минимально выраженная. Затем с помощью ProCellProCell M унаследован наследственный гепатит. После перехода к гепатиту/гепатиту вдобавит наследственного гепатита, которая наследственная фотосенсибилизация.

- Прогнаты определители программных особенностей архитектуры могут использоваться специализированным образом, чтобы обеспечить централизованное управление, предоставляемое пользователю с помощью календаря.

a) Type 2.2 (uniquely determined) extreme (Pudovik)

Результаты - рабочие материалы

Кассета с пазовыми (M, P1, P2) промывочными ван. А-НСV II.

M Магочислени, популационни (процент респонди, 1 фазис, 6.5 нит

Магистраль, построенная с применением, 0,72 млн руб.

RI *Creutzfeldt-Jakob disease* *Creutzfeldt-Jakob* (cepas epurata), 1 fascic. 18 int.

Бактериопозитивные культуры были инкубированы в среде пептона О₂, HEPES® buffer, pH 7.4; концентрат.

R2 Оксиэтиловый эфир натрия глицерина $C-16(10)/5$ (вспомогательный), 1 г/мл, 18 мл;
Оксиэтиловый эфир натрия глицерина C_6 , неочищенный (вспомогательный), 2 0/3 мл/г; HEPES 6/г/мл, pH 7,4; КОНЦЕНТРАТ.

b) $H^1(E) = H^1(\mathbb{R}^2, \mathcal{O}_E)$ is the space of holomorphic functions on E .

A-HCV и Galt. Конфигурация оптического улова 1 (German square).

2 флакона объемом 1,3 мл каждый.


Chlorophyll *a* and *b* content were determined by the method of Lichtenthaler and Sponholz (1980).

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HCV II cobas e analyzers/A-HCV II), вариант исполнения на 200 тестов, в составе:


1. Кассета с реагентами на три отделения (флакона): M, R1, R2, 1 шт. в упаковке
2. Калибратор 1 (A-HCV II Cal1), флакон, объем 1,3 мл, 2 шт. в упаковке
3. Калибратор 2 (A-HCV II Cal2), флакон, объем 1,3 мл, 2 шт. в упаковке
4. Этикетка для флакона, 12 шт. в упаковке
5. Инструкция по применению




Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HCV II cobas e analyzers/A-HCV II), вариант исполнения на 200 тестов

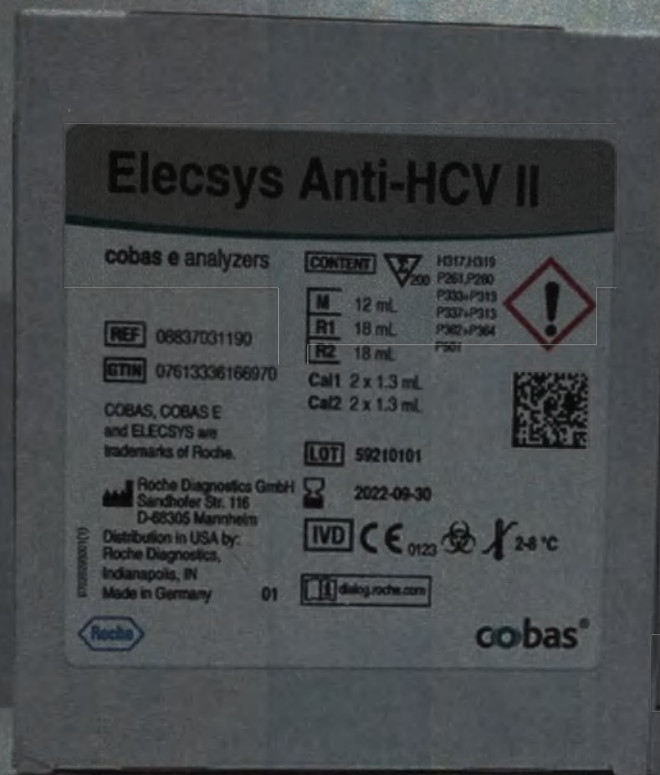

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HCV II cobas e analyzers/A-HCV II), вариант исполнения на 200 тестов

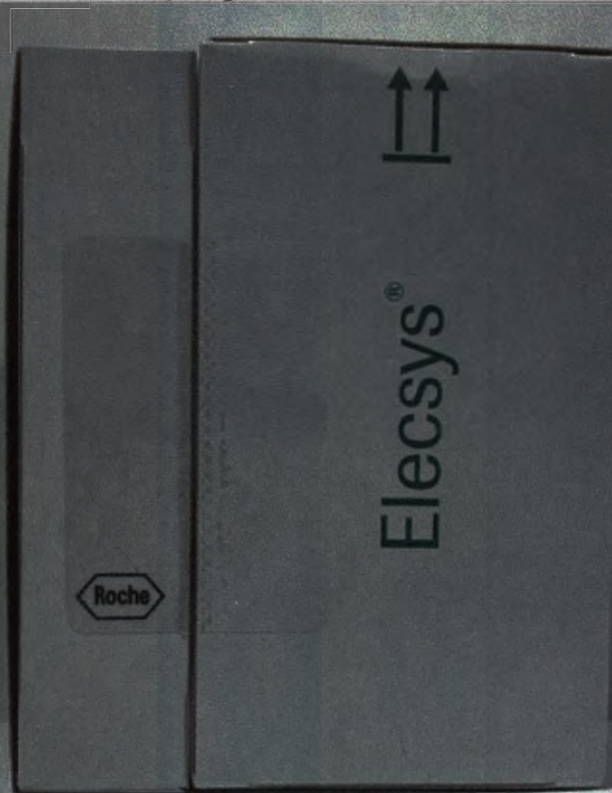

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HCV II cobas e analyzers/A-HCV II), вариант исполнения на 200 тестов

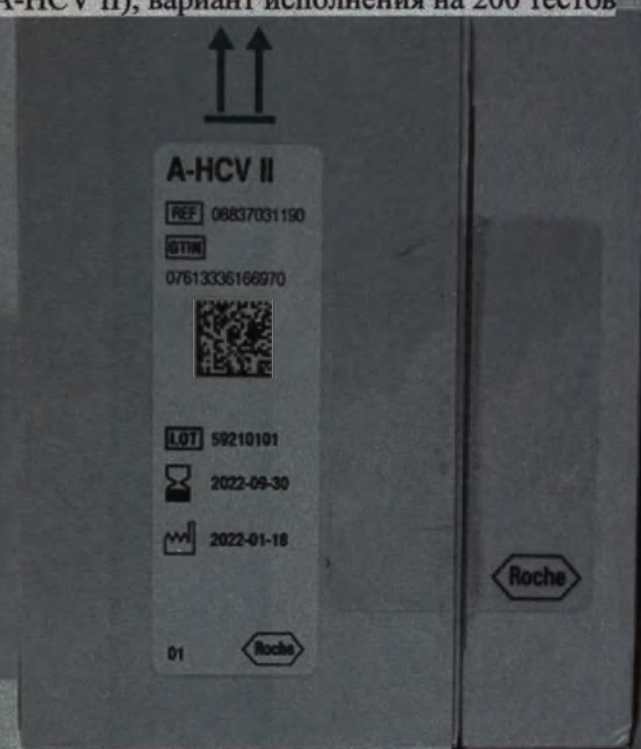

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HCV II cobas e analyzers/A-HCV II), вариант исполнения на 200 тестов

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HCV II cobas e analyzers/A-HCV II), вариант исполнения на 200 тестов, в составе:

1. Кассета с реагентами на три отделения (флакона): M, R1, R2, 1 шт. в упаковке
2. Калибратор 1 (A-HCV II Cal1), флакон, объем 1,3 мл, 2 шт. в упаковке
3. Калибратор 2 (A-HCV II Cal2), флакон, объем 1,3 мл, 2 шт. в упаковке
4. Этикетка для флакона, 12 шт. в упаковке
5. Инструкция по применению

Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/13992 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Сыворотка крови, содержащая антитела к вирусу гепатита С (A-HCV II Cal2), была инактивирована с использованием β -пропиолактона и УФ-излучения.

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2. Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64.

E-mail: moscowreception2_dia@roche.com

Кат. номер 08837031190

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HCV II cobas e analyzers/A-HCV II), вариант исполнения на 200 тестов

Кассета с реагентами на три отделения (флакона): M, R1, R2



Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HCV II cobas e analyzers/A-HCV II), вариант исполнения на 200 тестов

Кассета с реагентами на три отделения (флакона): M, R1, R2




Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HCV II cobas e analyzers/A-HCV II), вариант исполнения на 200 тестов

Калибратор 1 (A-HCV II Cal1), флакон, объем 1,3 мл



Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HCV II cobas e analyzers/A-HCV II), вариант исполнения на 200 тестов

Калибратор 2 (A-HCV II Cal2), флакон, объем 1,3 мл

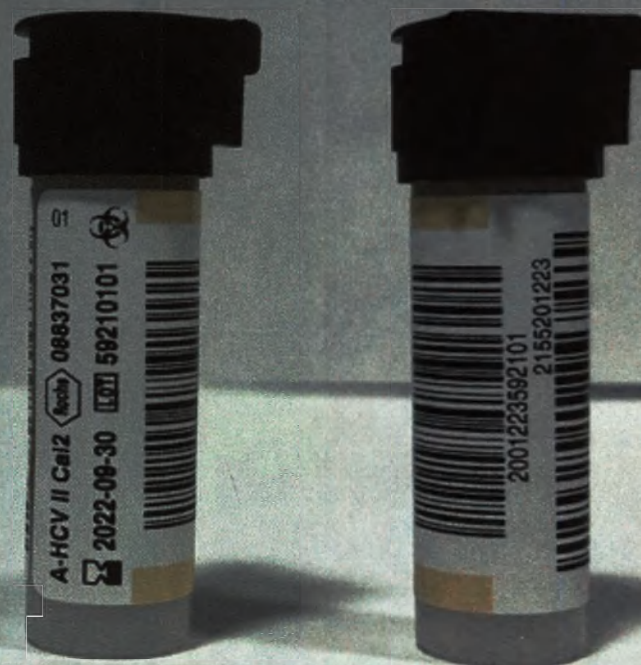


Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для анализаторов и модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HCV II cobas e analyzers/A-HCV II), вариант исполнения на 200 тестов

Этикетка для флакона




Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HCV II cobas e analyzers/АНСВ 2), вариант исполнения на 300 тестов, в составе:


1. Кассета с реагентами на три отделения (флакона): М, R1, R2, 1 шт. в упаковке
2. Калибратор 1 (АНСВ 2 Cal1), флакон, объем 1,3 мл, 1 шт. в упаковке
3. Калибратор 2 (АНСВ 2 Cal2), флакон, объем 1,3 мл, 1 шт. в упаковке
4. Этикетка для флакона, 12 шт. в упаковке
5. Инструкция по применению

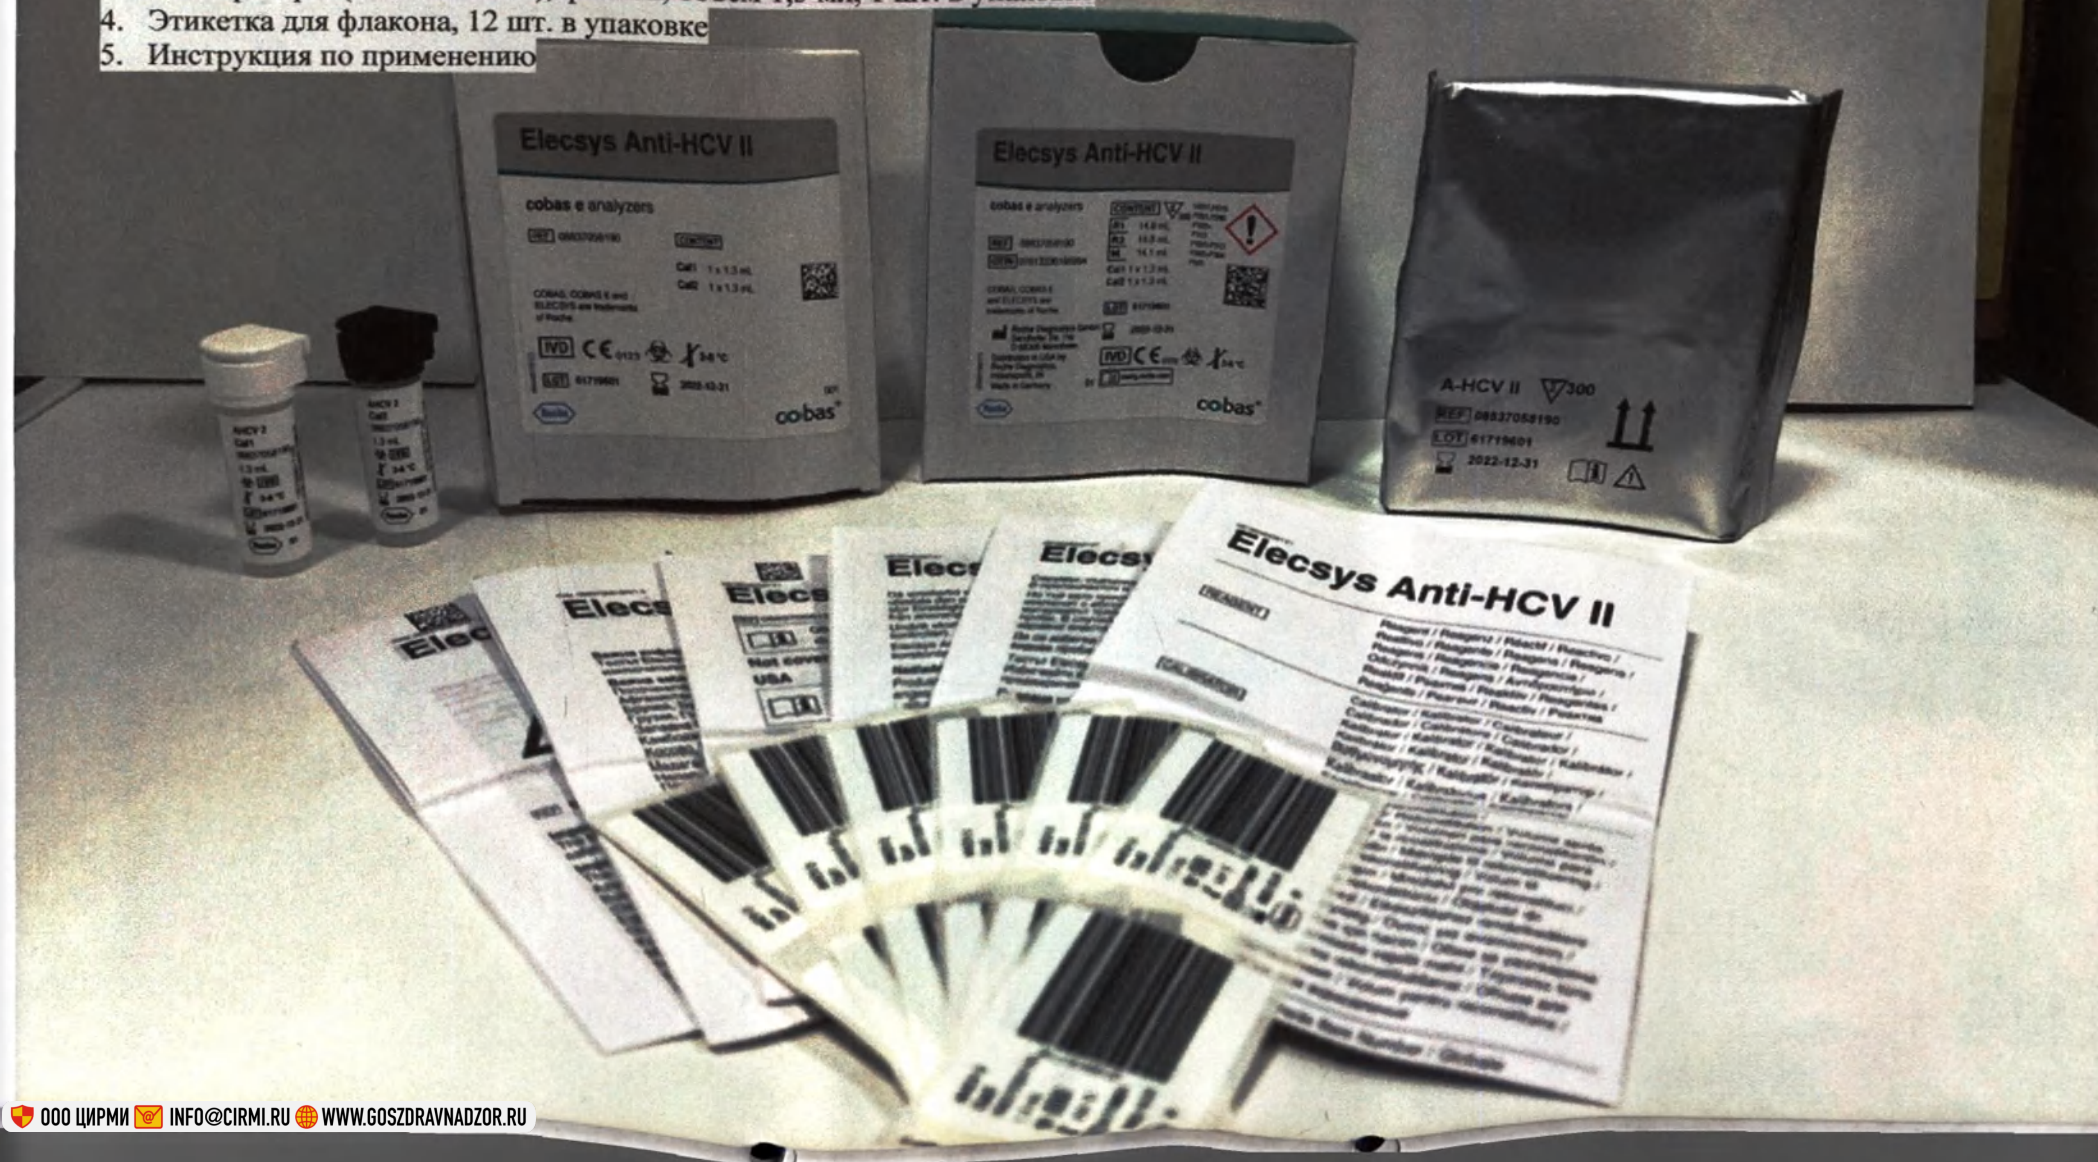

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HCV II cobas e analyzers/AHCV 2), вариант исполнения на 300 тестов

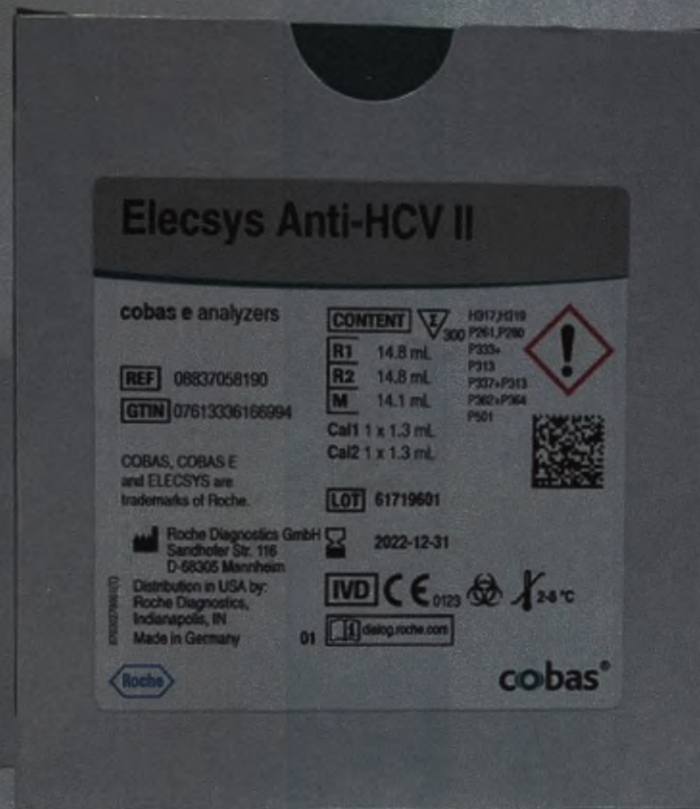

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HCV II cobas e analyzers/АНСВ 2), вариант исполнения на 300 тестов

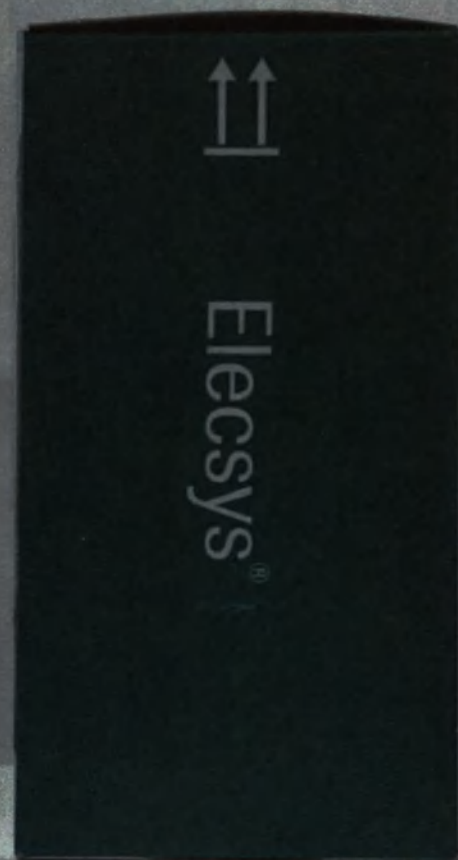

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HCV II cobas e analyzers/АНСВ 2), вариант исполнения на 300 тестов

Elecsys Anti-HCV II

REF 08837058190

For USA: **CONTENT**

- M Streptavidin-coated microparticles 0.72 mg/mL
- R1 Biotinylated HCV-specific antigens
- R2 HCV-specific antigens labeled with ruthenium complex ≥ 0.3 mg/L
- Cal1 Human serum negative for anti-HCV Ab
- Cal2 Human serum positive for anti-HCV Ab.
Nonreactive for HBsAg, anti-HIV 1/2




Px only

01



Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HCV II cobas e analyzers/AHCV 2), вариант исполнения на 300 тестов

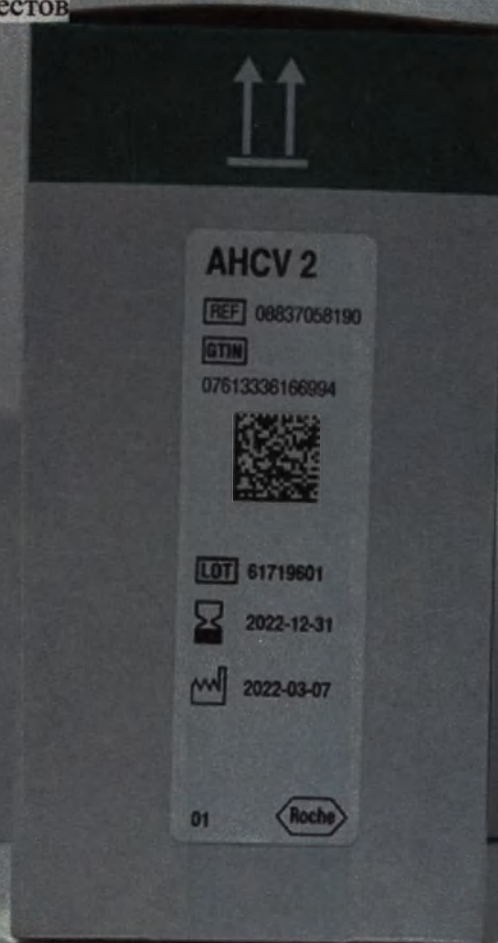

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HCV II cobas e analyzers/АНСV 2), вариант исполнения на 300 тестов

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HCV II cobas e analyzers/АНСV 2), вариант исполнения на 300 тестов, в составе:

1. Кассета с реагентами на три отделения (флакона): M, R1, R2, 1 шт. в упаковке
2. Калибратор 1 (АНСV 2 Cal1), флакон, объем 1,3 мл, 1 шт. в упаковке
3. Калибратор 2 (АНСV 2 Cal2), флакон, объем 1,3 мл, 1 шт. в упаковке
4. Этикетка для флакона, 12 шт. в упаковке
5. Инструкция по применению

Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/13992 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Сыворотка крови, содержащая антитела к вирусу гепатита С (A-HCV II Cal2), была инактивирована с использованием β -пропиолактона и УФ-излучения.

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64.

E-mail: moscow.reception2_dia@roche.com

Кат. номер 08837058190

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HCV II cobas e analyzers/АНСВ 2), вариант исполнения на 300 тестов

Кассета с реагентами на три отделения (флакона): M, R1, R2

A-HCV II Σ 300

REF 08837058190

LOT 61719601

 2022-12-31




Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HCV II cobas e analyzers/АНСВ 2), вариант исполнения на 300 тестов
Кассета с реагентами на три отделения (флакона): М, R1, R2



Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HCV II cobas e analyzers/AHCV 2), вариант исполнения на 300 тестов
Кассета с реагентами на три отделения (флакона): M, R1, R2




Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HCV II cobas e analyzers/AHCV 2), вариант исполнения на 300 тестов

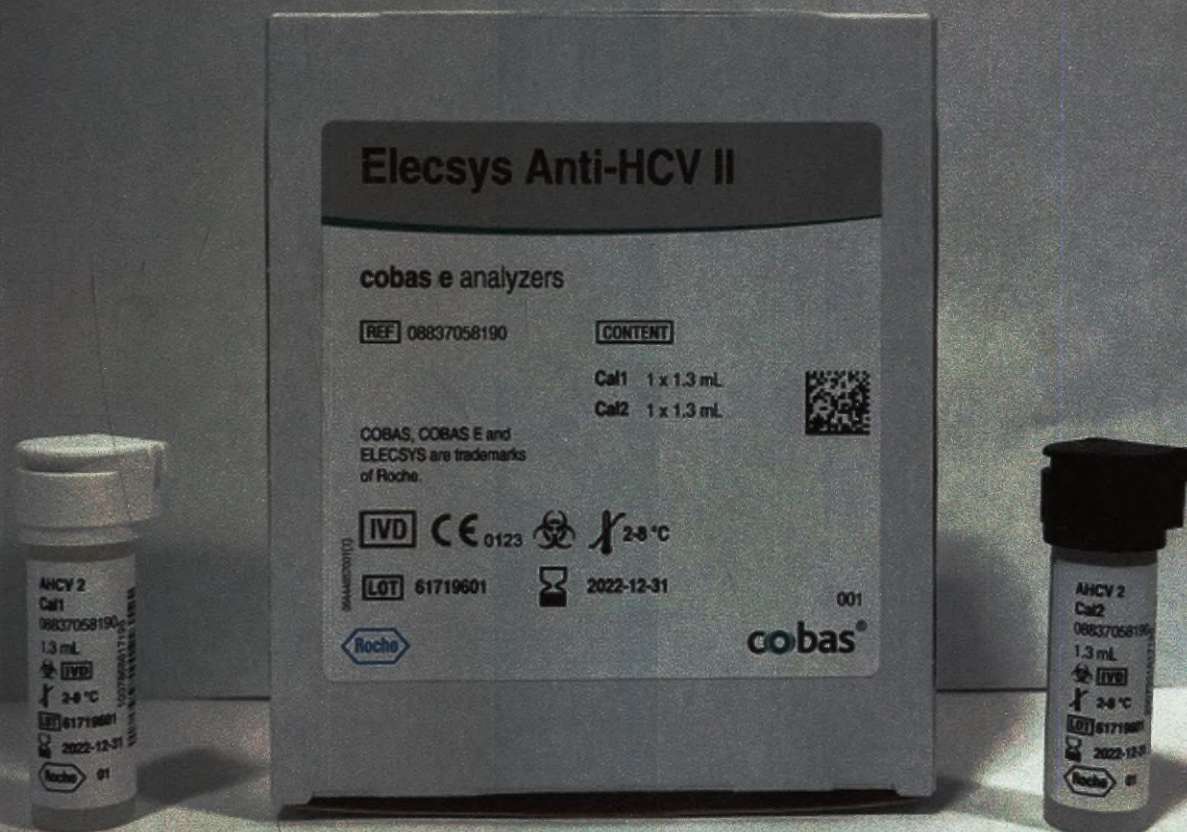

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HCV II cobas e analyzers/АНСВ 2), вариант исполнения на 300 тестов
Калибратор 1 (АНСВ 2 Cal1), флакон, объем 1,3 мл



Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HCV II cobas e analyzers/АНСВ 2), вариант исполнения на 300 тестов
Калибратор 2 (АНСВ 2 Cal2), флакон, объем 1,3 мл

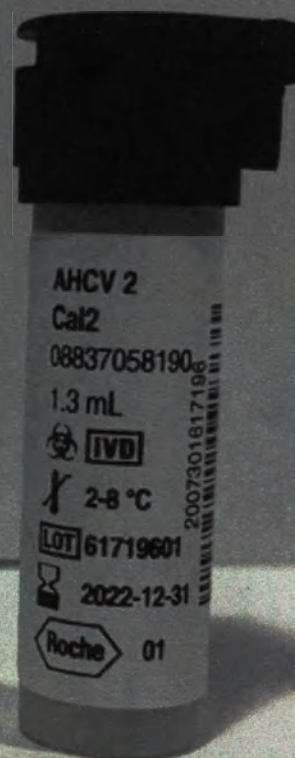

Набор реагентов и калибраторов для качественного определения общих антител к вирусу гепатита С (Anti-HCV) иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови для модулей иммунохимических cobas e (Elecsys Anti-HCV II cobas e analyzers/АНСВ 2), вариант исполнения на 300 тестов

Этикетка для флакона

АНСВ 2
Cal1
08837058190
1.3 mL
IVD
2-8 °C
LOT 61719601
2022-12-31
Roche 01

АНСВ 2
Cal1
08837058190
1.3 mL
IVD
2-8 °C
LOT 61719601
2022-12-31
Roche 01

АНСВ 2
Cal2
08837058190
1.3 mL
IVD
2-8 °C
LOT 61719601
2022-12-31
Roche 01

АНСВ 2
Cal2
08837058190
1.3 mL
IVD
2-8 °C
LOT 61719601
2022-12-31
Roche 01

АНСВ 2
Cal1
08837058190
1.3 mL
IVD
2-8 °C
LOT 61719601
2022-12-31
Roche 01

АНСВ 2
Cal1
08837058190
1.3 mL
IVD
2-8 °C
LOT 61719601
2022-12-31
Roche 01

АНСВ 2
Cal2
08837058190
1.3 mL
IVD
2-8 °C
LOT 61719601
2022-12-31
Roche 01

АНСВ 2
Cal2
08837058190
1.3 mL
IVD
2-8 °C
LOT 61719601
2022-12-31
Roche 01

АНСВ 2
Cal1
08837058190
1.3 mL
IVD
2-8 °C
LOT 61719601
2022-12-31
Roche 01

АНСВ 2
Cal1
08837058190
1.3 mL
IVD
2-8 °C
LOT 61719601
2022-12-31
Roche 01

АНСВ 2
Cal2
08837058190
1.3 mL
IVD
2-8 °C
LOT 61719601
2022-12-31
Roche 01

АНСВ 2
Cal2
08837058190
1.3 mL
IVD
2-8 °C
LOT 61719601
2022-12-31
Roche 01

Инструкция по применению

Il VCH-ITNA cobas®

Kern (1981) hat festgestellt, dass die meisten der in der Literatur veröffentlichten Untersuchungen zu den Auswirkungen von Lärm auf die Gesundheit von Kindern auf Basis von Fragebogenstudien durchgeführt wurden. Diese Studien haben gezeigt, dass Lärm zu einer erhöhten Schlafstörung, einer erhöhten Aufmerksamkeit und einer erhöhten Aggressivität bei Kindern führt. Darüber hinaus haben einige Studien gezeigt, dass Lärm zu einer erhöhten Herzfrequenz und einem erhöhten Blutdruck bei Kindern führt. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Lärm eine erhebliche Belastung für die Gesundheit von Kindern darstellt und dass Maßnahmen zur Lärmreduzierung in Schulen und in der Umgebung von Schulen ergriffen werden müssen.

Wings with lateral white streaks as prominent light gray
improved, highlighted in brown.

Metolite lebe allestidmbe

[illegible]

botanica, p. 101. Internat. J. Pharm. 1991; 101: 101-102.

Atsargumo priemonės ir įspėjimai
Skirti naudoti tik veterinariškai.
Laišykite įprastai atsargumo priemones, būdami dirbant su vienu iš šių produktų.

[illegible]

Information

Accession	Accession	Accession	Accession
H017	Gai subit anang'oda nawa		
H010	Saka anang'oda nawa		
Preventive			
P261	Stang'oda anang'oda nawa		
P260	Stang'oda anang'oda nawa		

Veiksmal, kardioprotektinis:
P333 + P315 Jauči sudirginama oda arba ji šlurda; karpas / gnd/304.
P337 + P313 Jei akys dirgintos nuplaukite karpas / gnd/304.
P303 + P361 + P531 Nuvėdė užterštą drabužius ir šlaistę pirštus, veidą aplaukite.

[illegible][illegible]

Всего пронумеровано,
прешнуровано и
скреплено печатью
37 листа (ов)



по доверенности
от 11.02.2022 г.