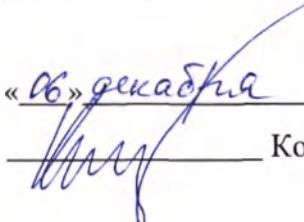


УТВЕРЖДАЮ


Руководитель подразделения молекулярной диагностики
ООО «Эбботт Лэбораториз» в России и странах СНГ

« 06 » декабря 2022 года
 Коничева Е.Р.


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

Набор контролей «Alinity m HR HPV CTRL Kit» для контроля качества
выявления ДНК вируса папилломы человека высокого онкогенного риска
методом полимеразной цепной реакции на анализаторе Alinity m, производства
Abbott Molecular Inc. (Эбботт Молекуляр Инк.), США.

2022

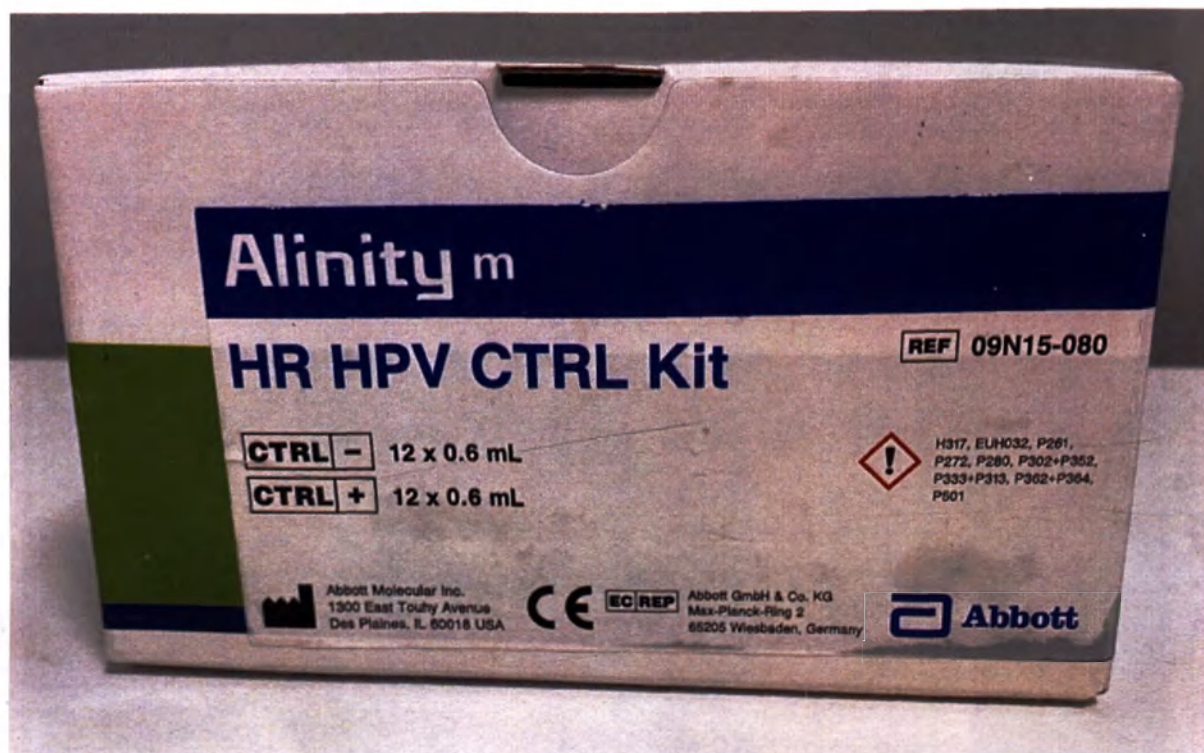

Фотографическое изображение 1. Внешний вид потребительской упаковки Набора контролей «Alinity m HR HPV CTRL Kit» (вид спереди)

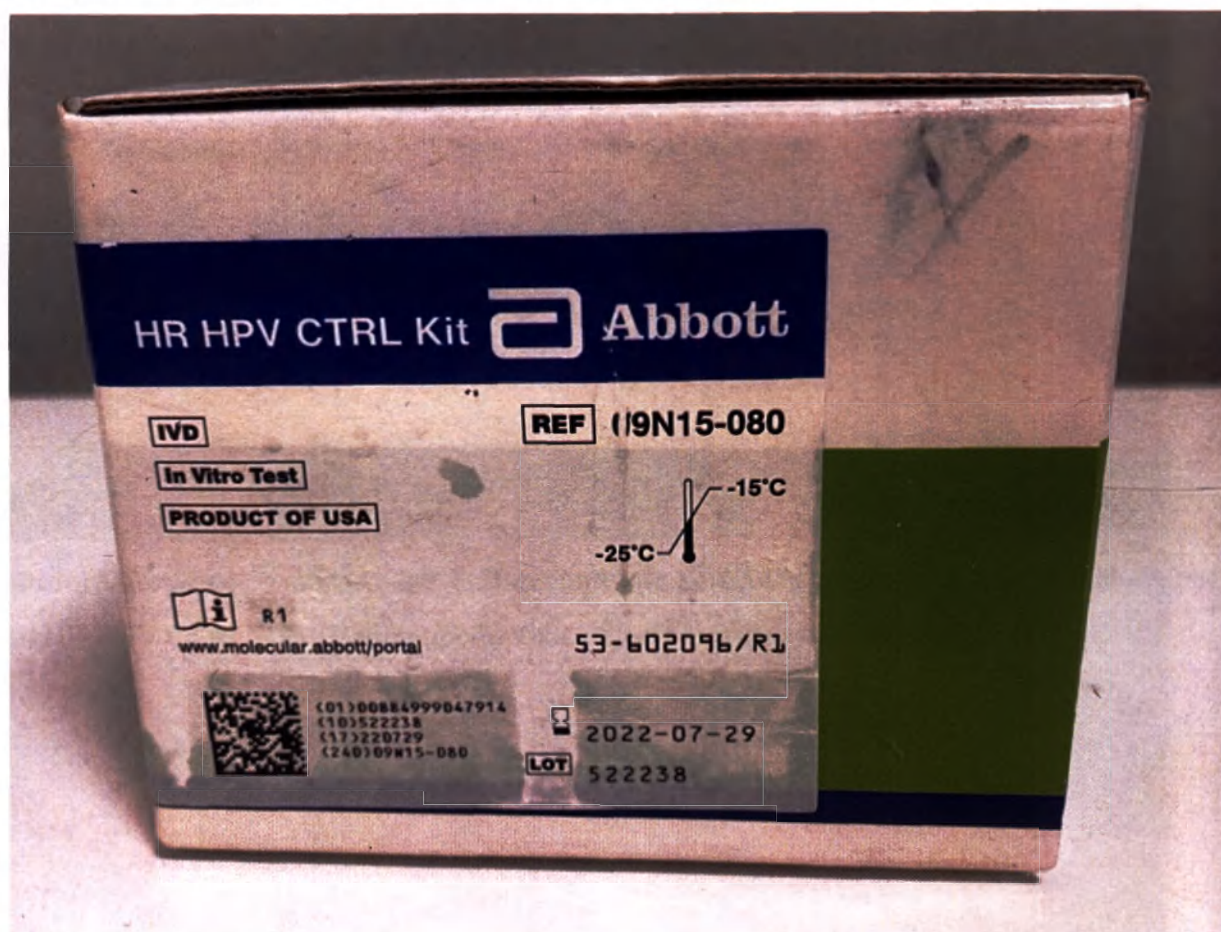

Фотографическое изображение 2. Внешний вид потребительской упаковки Набора контролей «Alinity m HR HPV CTRL Kit» (вид сбоку)



Фотографическое изображение 3. Состав потребительской упаковки Набора контролей «Alinity m HR HPV CTRL Kit»



Фотографическое изображение 4. Внешний вид компонентов Набора контролей «Alinity m HR HPV CTRL Kit»: Набор пробирок с отрицательным контролем (0,6 мл) - 12 шт.



Фотографическое изображение 5. Набор пробирок с отрицательным контролем в индивидуальных упаковках



Фотографическое изображение 6. Внешний вид компонентов Набора контролей «Alinity m HR HPV CTRL Kit»: Набор пробирок с положительным контролем (0,6 мл) - 12 шт.



Фотографическое изображение 7. Набор пробирок с положительным контролем в индивидуальных упаковках

Прошито, пронумеровано общим числом

5 (пять) листов

Руководитель подразделения молекулярной
диагностики ООО «Эбботт Лэбораториз» в
России и странах СНГ

Коничева Е.Р. 