



«Набор реагентов для выявления мутаций гена *PIK3CA* методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени "Real-time-PCR-PIK3CA-5R" по ТУ 21.20.23-007-57201404-2020»,
вариант исполнения – «Набор реагентов на 36 реакций "Real-time-PCR-PIK3CA-5R (36)"».


Фотография 1. Общий вид и маркировка изделия

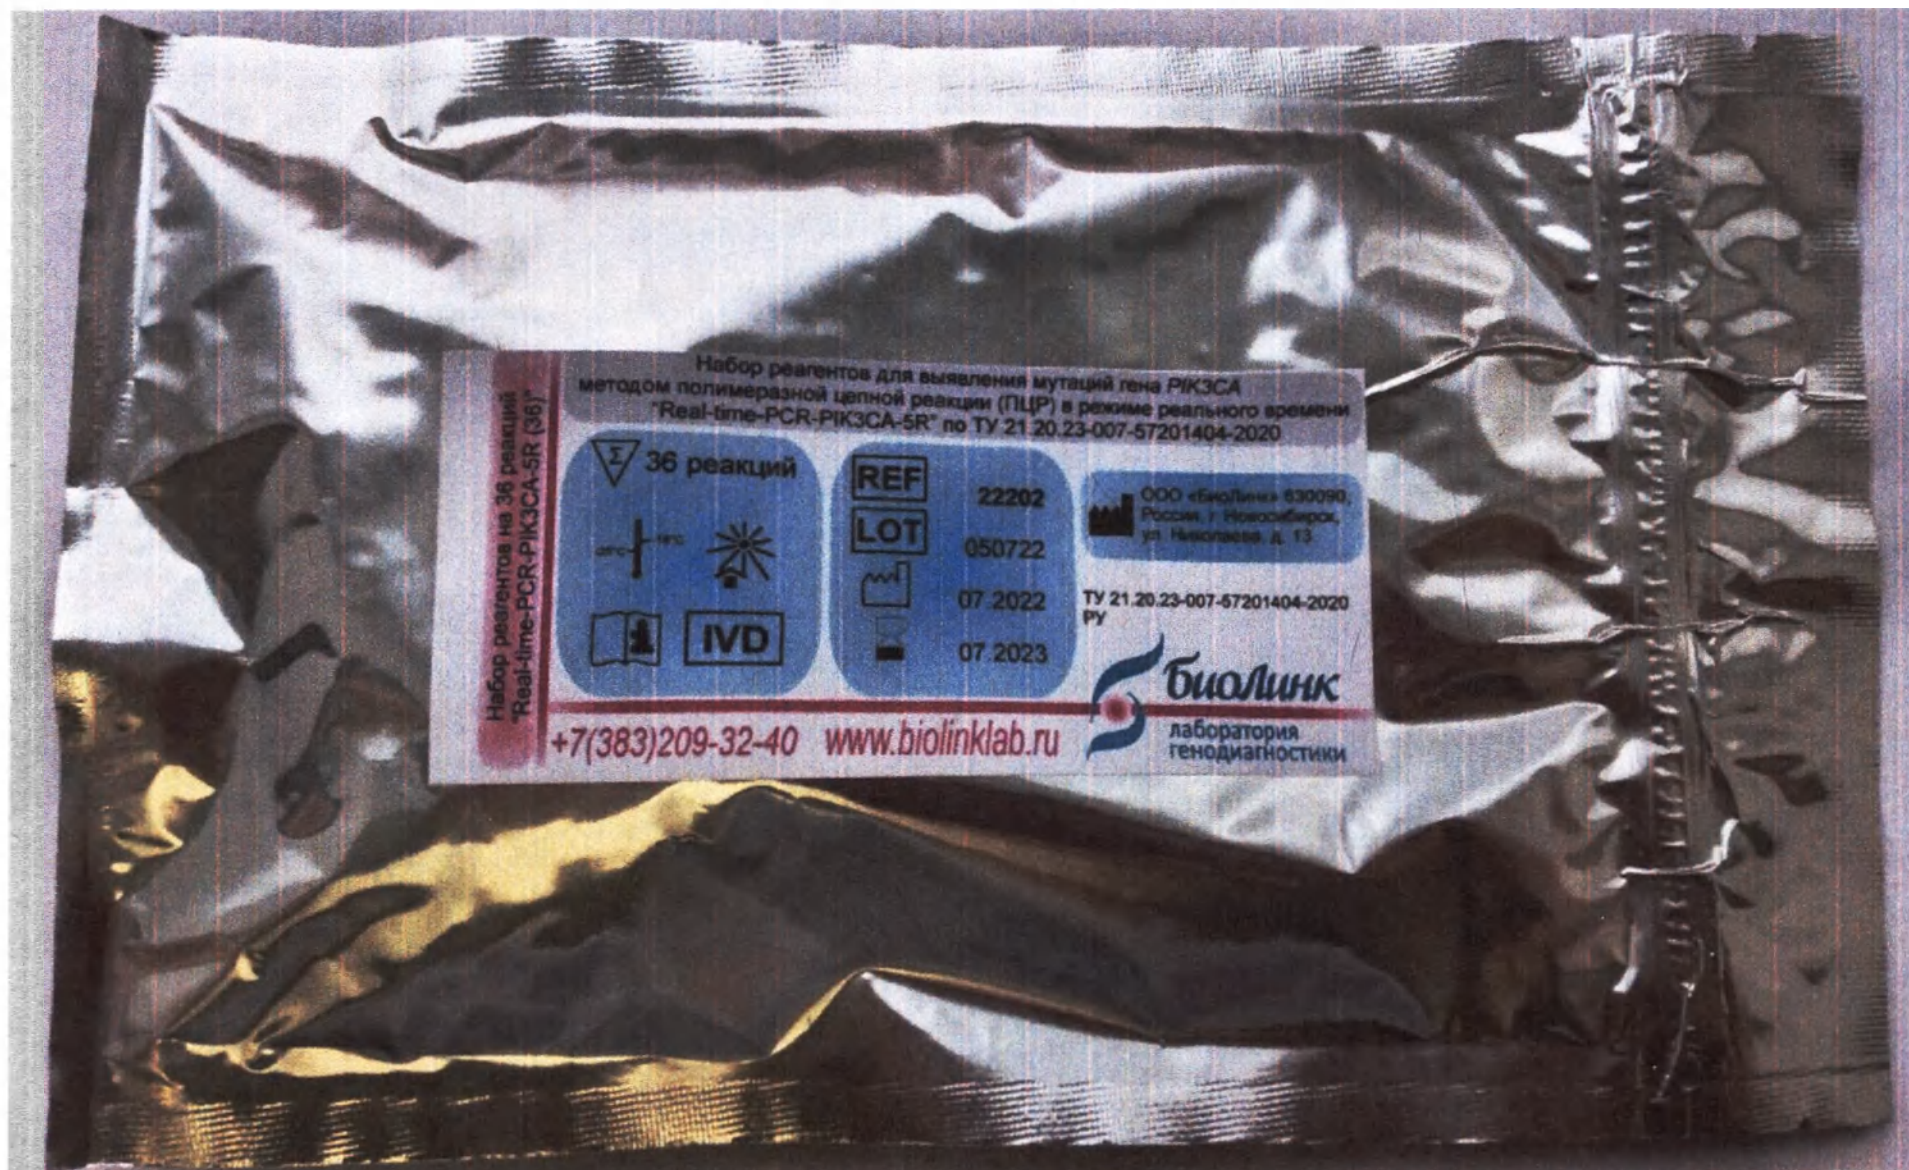

Фотография 2. Общий вид и маркировка изделия

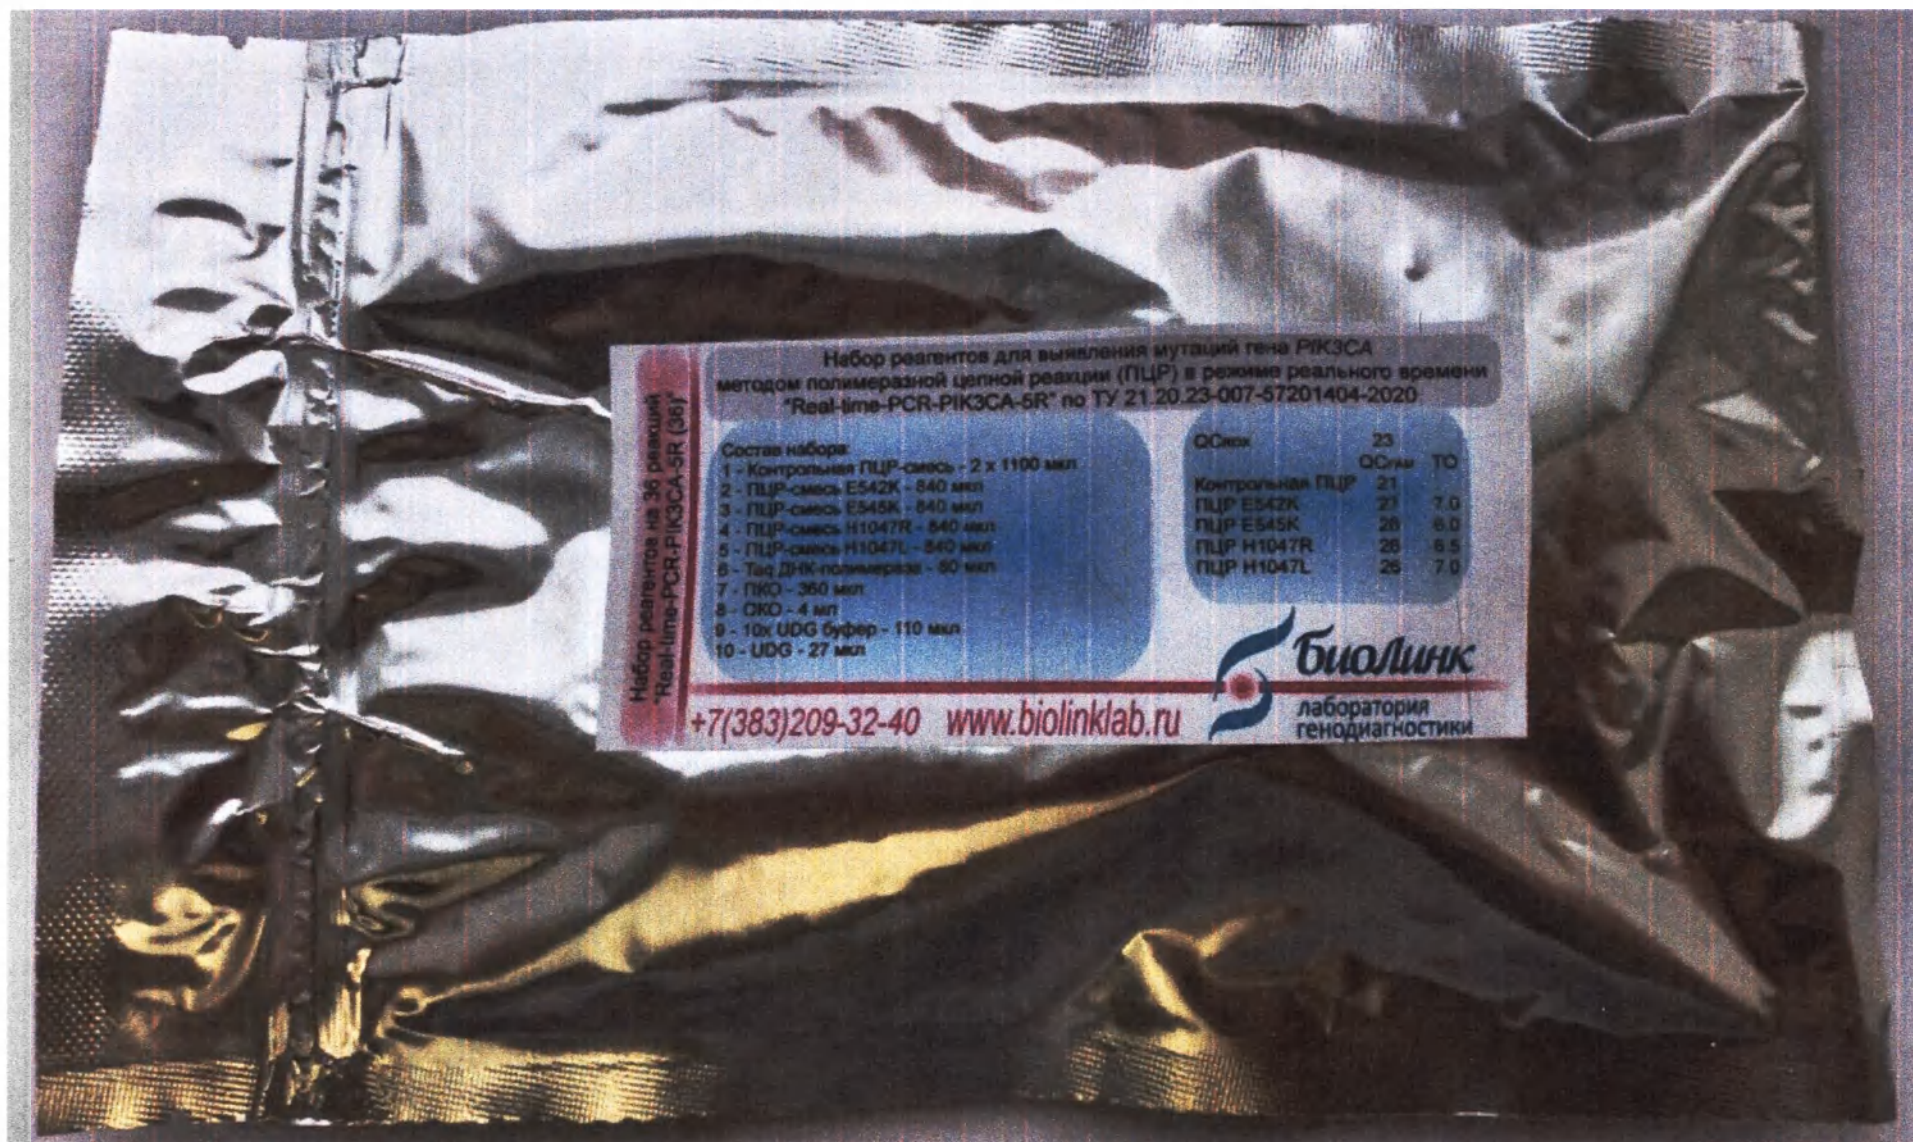


Фотография 3. Пробирки с реагентами

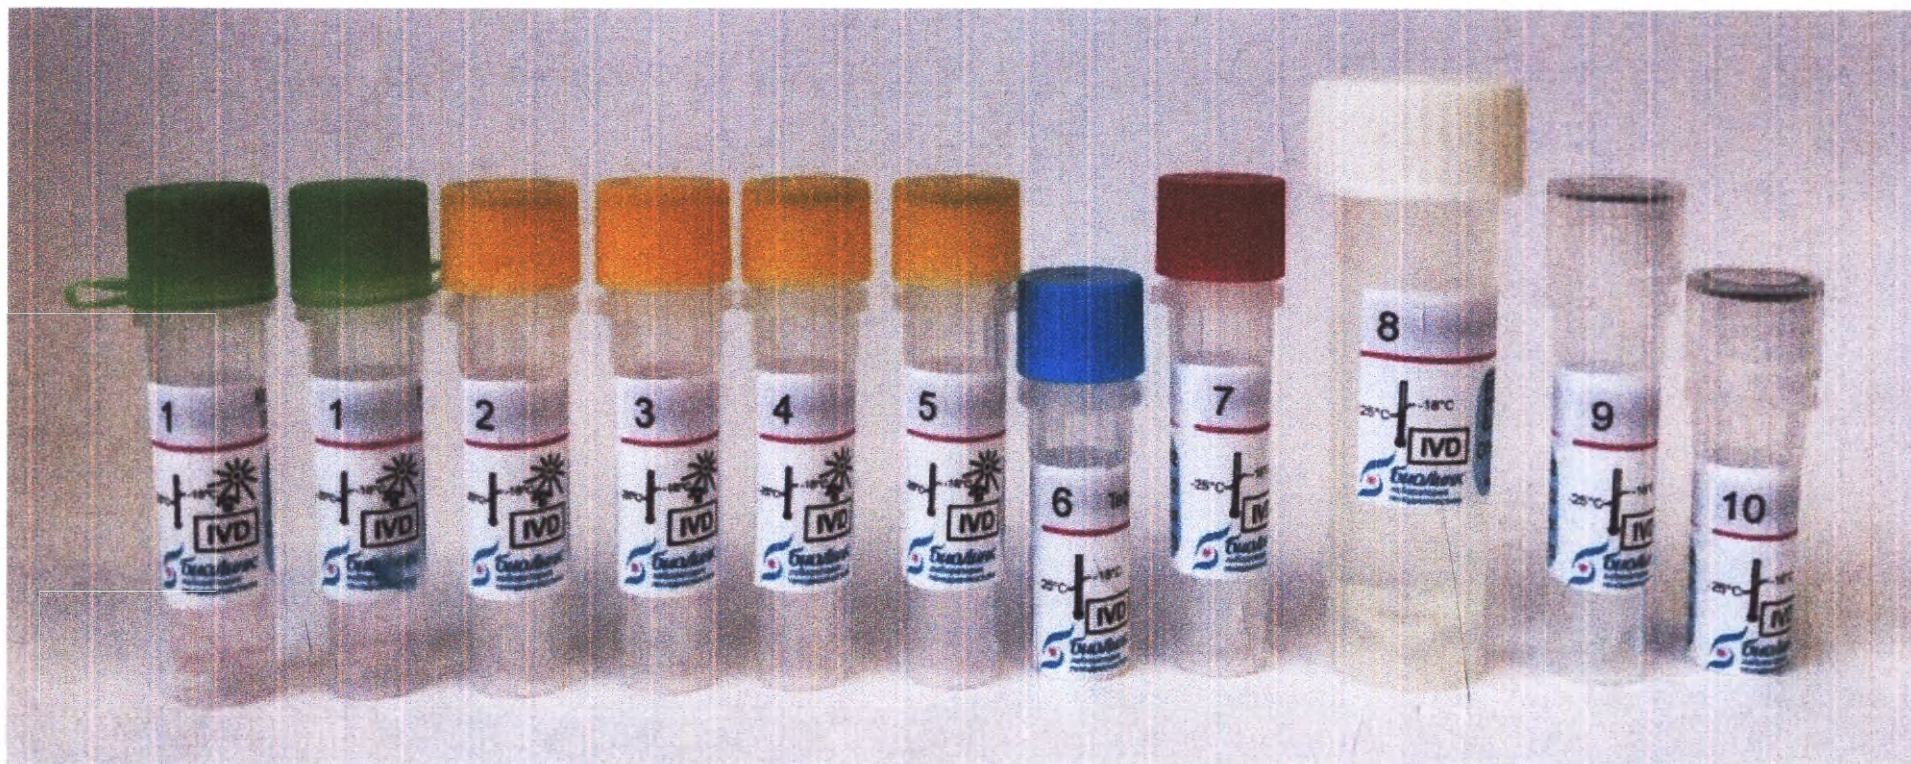

Фотография 4. Пробирки с реагентами



Фотография 5. Пробирки с реагентами

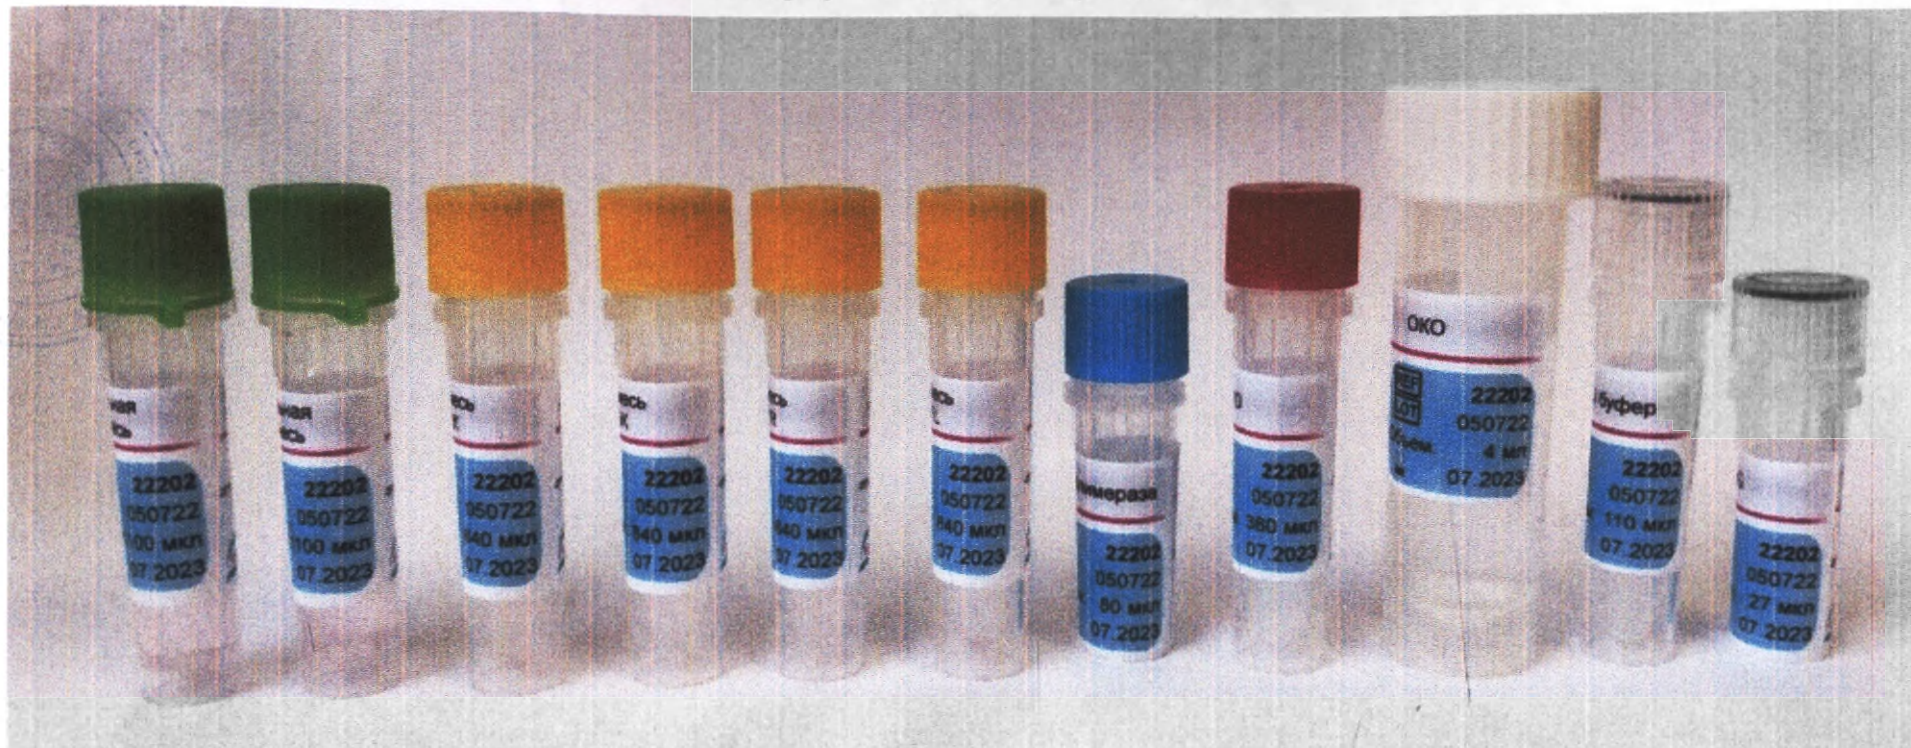


Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью.

5

листов

Директор ООО «БИОЛИНК»



/ Корниенко А. А. /

« 30 » ноября 2022 г.

