

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по регистрации, Россия и СНГ

ООО «Дентсплай Сирона»



Хаиндрава В.Г.

2022г.

**Фотографическое изображение
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

производства

Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Steinzeugstrasse 50, 68229 Mannheim, Germany

Абатмент EstheticBase PS прямой D3.8/GH5/A0 для дентального имплантата Xive® (EstheticBase PS straight D3.8/GH5/A0)





Абгамент EstheticBase PS прямой D3.8/GH5/A0 для детального имплантата Xive®	
Xive® EstheticBase PS прямой D3.8/G5/A0	От xxxxxx
RU № РЭН 2019/8732	
REF 32462345	SM на упаковке
Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях см. в инструкции	
Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта	
Производитель: Dentsply Implants Manufacturing GmbH, Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Германия	Уполномоченный представитель в РФ: ООО «Дентсплай Сирона», 115432, г. Москва, пр-т Анджопова, д. 18, корп. 6 Тел.: +7 (495) 725-10-87
Страна происхождения: Германия	As Medipharma.com

Абатмент EstheticBase PS угловой D3.8/GH5/A15 для дентального имплантата Xive® (EstheticBase PS angled D3.8/GH5/A15)





Абатмент EstheticBase PS угловой D3.8/GH5/A15 для дентального имплантата Xive®

EstheticBase PS angled D3.8/GH5/A15

РУ № РЗН 2019/8732

От xxxxxx

REF 32462445

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции

Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта

Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
Германия

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Дентсплай Сирона»,
115432, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6
Тел. +7 (495) 725-10-87

Страна происхождения:
Германия



MP Абатмент дентальный PS D3.8/GH5 для дентального имплантата Xive® (MP Abutment PS D3.8/GH5)




REF 46-2955 / 32462955 LOT B190002122

MP Aufbau PS D3.8/GH5

Moignon MP PS D3.8/GH5

Moncone MP PS D3.8/GH5

MP Pilar PS D3.8/GH5

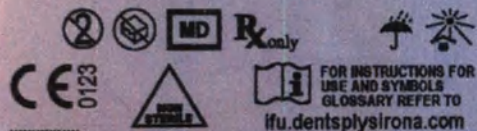

2019-02-21

2029-02-20

(01)07382532231391(11)200329(17)300330(10)B123456789

Dentsply
Sirona

Made in Germany

Dentsply Implants Manufacturing GmbH
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Germany

210002364



MP Абатмент денальный PS D3.8/GH5 для денального имплантата Xive®

MP Abutment PS D3.8/GH5

РУ № РЗН 2019/8732

От xxxxxx

REF 32462955

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции

Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта

Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
Германия

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Дентсплай Сирона»,
115432, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6
Тел. +7 (495) 725-10-87

Страна происхождения:
Германия



Винт-заглушка PS D3.8 для дентального имплантата Xive® (Cover Screw PS D3.8)





Винт-заглушка PS D3.8 для дентального имплантата Xive®

Cover Screw PS D3.8

РУ № РЗН 2019/8732

От xxxxxx

REF 32451180

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции

Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта

Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
Германия

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Дентсплай Сирона»,
115432, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6
Тел. +7 (495) 725-10-87

Страна происхождения:
Германия



Формирователь десны тонкий D4.5/GH5/C для дентального имплантата Xive® (Gingiva Former slim D4.5/ GH5/C)





Формирователь десны тонкий D4.5/GH5/C для дентального имплантата Xive®

Gingiva Former slim D4.5/ GH5/C

РУ № РЗН 2019/8732

От xxxxxx

REF 32261855

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции
Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта

Производитель:
Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
Германия

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Дентсплай Сирона»,
115432, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6
Тел. +7 (495) 725-10-87

Страна происхождения:
Германия

ifu.dentsplysirona.com

Формирователь десны D3.4/GH5/C для дентального имплантата Xive® (Gingiva Former D3.4/GH5/C)





Формирователь десны D3.4/GH5/C для дентального имплантата Xive®

Gingiva Former D3.4/GH5/C

РУ № РЗН 2019/8732

От xxxxxx

REF 32261935

см. на упаковке


Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции

Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта

Производитель:
Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
Германия

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Дентсплай Сирона»,
115432, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6
Тел. +7 (495) 725-10-87

Страна происхождения:
Германия



Формирователь десны D4.5/GH5/C для дентального имплантата Xive® (Gingiva Former D4.5/GH5/C)





Формирователь десны D4.5/GH5/C для дентального имплантата Xive®

Gingiva Former D4.5/GH5/C

РУ № РЗН 2019/8732

От xxxxxx

REF 32261955

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции
Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта

 **Производитель:**
Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
Германия

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Дентсплай Сирона»,
115432, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6
Тел. +7 (495) 725-10-87

Страна происхождения:
Германия



Формирователь десны D5.5/GH5/C для дентального имплантата Xive® (Gingiva Former D5.5/GH5/C)




REF 26-1965 / 32261965 LOT B210005034

Gingivaformer D5.5/GH5/C

Vis de cicatrisation D5.5/GH5/C

Vite di guarigione D5.5/GH5/C

Moldeador gingival D5.5/GH5/C



CE 0123




FOR INSTRUCTIONS FOR
USE AND SYMBOLS
GLOSSARY REFER TO
ifu.dentsplysirona.com



2021-05-21

2031-05-20

(01)07382532224703(11)210521(17)310520(10)B210005034



Made in Germany

Dentsply Implants Manufacturing GmbH
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Germany

21002355



Формирователь десны D5.5/GH5/C для дентального имплантата Xlve®

Gingiva Former D5.5/GH5/C

РУ № РЗН 2019/8732

От xxxxxx

REF 32261965

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции
Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта



Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
Германия

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Дентсплай Сирона»,
115432, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6
Тел. +7 (495) 725-10-87

Страна происхождения:
Германия



Формирователь десны PS D3.8/ GH5/C для дентального имплантата Xive® (Gingiva Former PS D3.8/GH5/C)



REF 26-2235 / 32262235

LOT B210007990

Gingivaformer PS

D3.8/GH5/C

Vis de cicatrisation PS

D3.8/GH5/C

Vite di guarigione PS

D3.8/GH5/C

Moldeador gingival PS

D3.8/GH5/C



CE 0123



FOR INSTRUCTIONS FOR
USE AND SYMBOLS
GLOSSARY REFER TO

ifu.dentsplysirona.com



2021-08-11

2031-08-10

710171005122250001112100111173100101010210007990

Dentsply
Sirona

Made in Germany

Dentsply Implants Manufacturing GmbH
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Germany

21002354



Формирователь десны PS D3.8/ GH5/C для дентального имплантата Xive®

Gingiva Former PS D3.8/GH5/C

РУ № РЗН 2019/8732

От xxxxxx

REF 32262235

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности,
показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции

Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта

Производитель:


Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
Германия

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Дентсплай Сирона»,
115432, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6
Тел. +7 (495) 725-10-87

Страна происхождения:
Германия



Слепочный трансфер длинный D3.0/ long /C для дентального имплантата Xive® (Transfer Coping D3.0/ long /C)

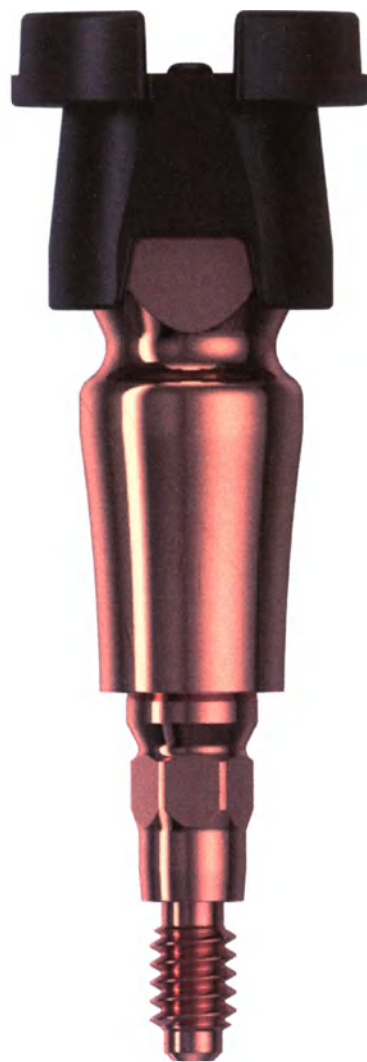



Слепочный трансфер длинный D3.0/ long /C для дентального имплантата Xive®

Transfer Coping D3.0/ long /

РУ № РЗН 2019/8732

От xxxxxx

REF 32262025

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции
Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта

Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodembacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
Германия

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Дентсплай Сирона»,
115432, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6
Тел. +7 (495) 725-10-87

Страна происхождения:
Германия



Слепочный трансфер длинный D5.5/ long /C для дентального имплантата Xive® (Transfer Coping D5.5/ long /C)





Слепочный трансфер длинный D5.5/ long /C для дентального имплантата Xive®

Transfer Coping D5.5/ long / C

РУ № РЗН 2019/8732

От xxxxxx

REF 32262065

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции
Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта


Производитель:
Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
Германия

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Дентсплай Сирона»,
115432, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6
Тел. +7 (495) 725-10-87

Страна происхождения:
Германия



Слепочный трансфер длинный D5.5/ long /C для дентального имплантата Xive® (Transfer Coping D5.5/ long /C)

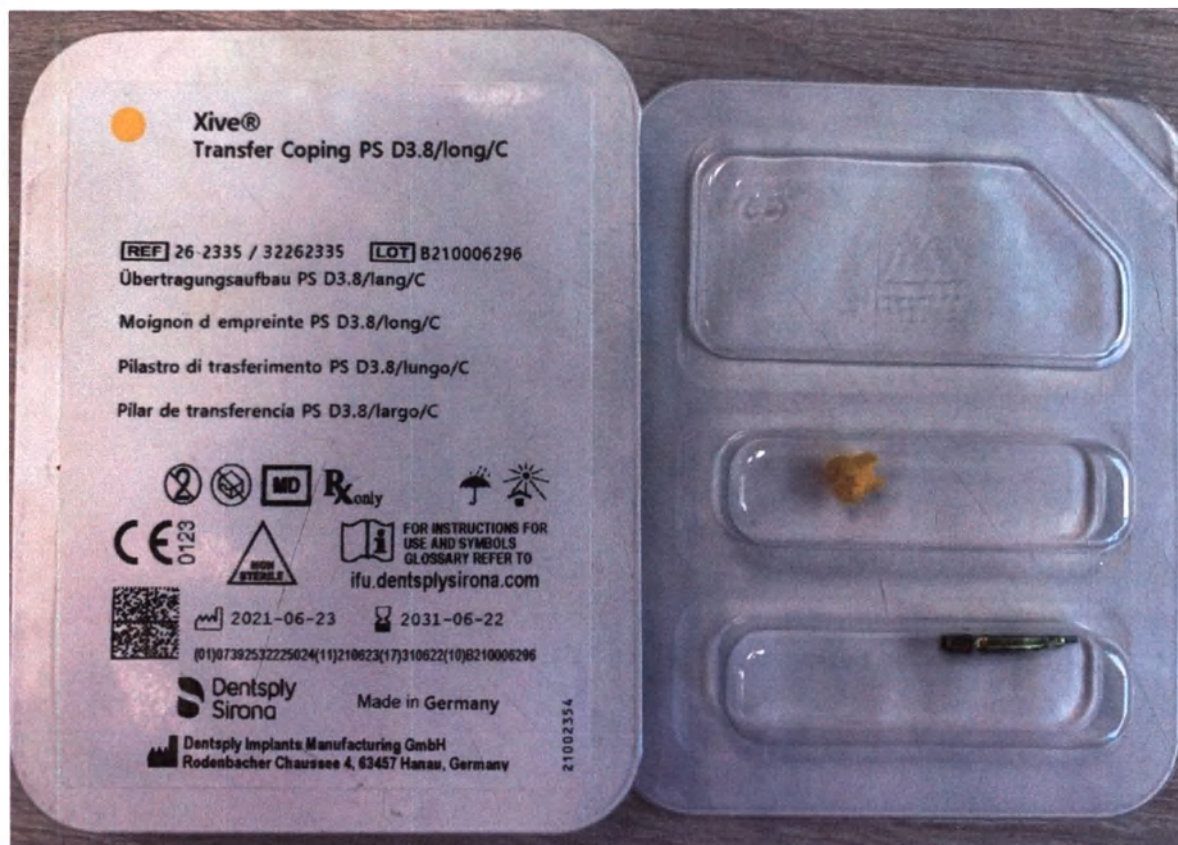

Слепочный трансфер PS длинный D3.8/ long /C для дентального имплантата Xive®

Transfer Coping D5.5/ long /C

РУ № РЗН 2019/8732

От xxxxxx

REF 32262335

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции
Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта

Производитель:
Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
Германия

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Дентсплай Сирона»,
115432, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6
Тел. +7 (495) 725-10-87

Страна происхождения:
Германия

ifu.dentsplysirona.com

Слепочный трансфер длинный D3.0/ long /C для дентального имплантата Xive® (Transfer Coping PickUp 3.0/ long /C)





Слепочный трансфер длинный D3.0/ long /C для дентального имплантата Xive®

Transfer Coping Pickup 3.0/ long /C

РУ № РЗН 2019/8732

От xxxxxx

REF 32262125

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции
Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта


Производитель:
Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
Германия

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Дентсплай Сирона»,
115432, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6
Тел. +7 (495) 725-10-87

Страна происхождения:
Германия

ifu.dentsplysirona.com

Слепочный трансфер длинный D5.5/ long /C для дентального имплантата Xive® (Transfer Coping PickUp D5.5/ long /C)

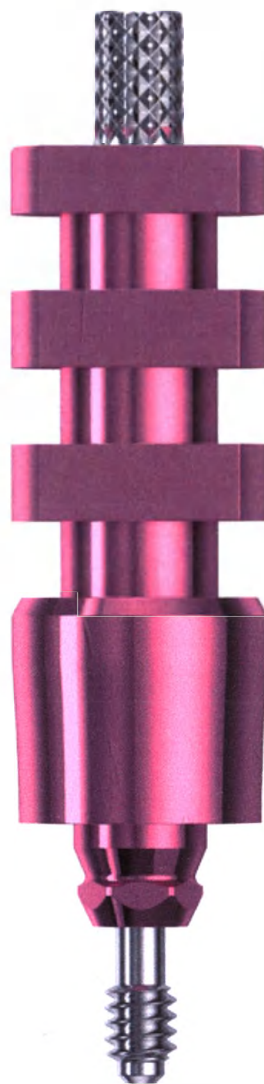



Слепочный трансфер длинный D5.5/ long /C для дентального имплантата Xive®

Transfer Coping Coping PickUp D5.5/ long /C

РУ № РЗН 2019/8732

От xxxxxx

REF 32262165

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции
Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта


Производитель:
Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
Германия

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Дентсплай Сирона»,
115432, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6
Тел. +7 (495) 725-10-87

Страна происхождения:
Германия



Оттисковый колпачок для слепочного трансфера D5.5/C для дентального имплантата Xive® (TransferCap D5.5/C (3pcs)) – 3 шт.

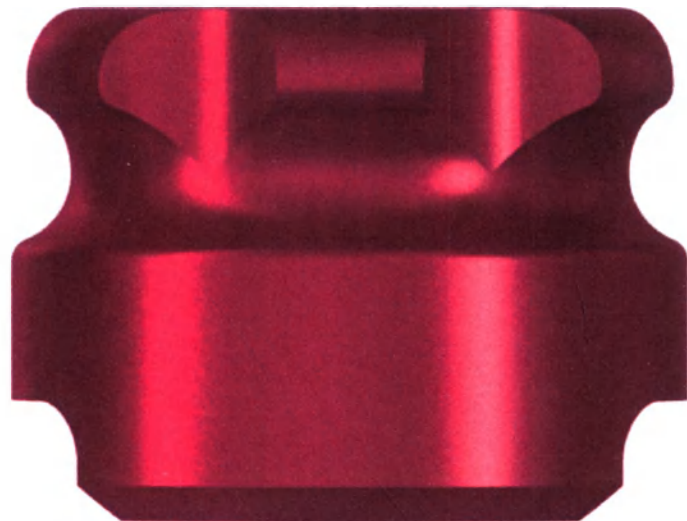



Оптический колпачок для слепочного трансфера DS.5/C для дентального имплантата Xive®

TransferCap DS.5/C (3pcs)

РУ № РЗН 2019/8732

От xxxxxx

REF 322621074


см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции
Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта

Производитель:
Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
Германия

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Дентсплай Сирона»,
115432, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6
Тел. +7 (495) 725-10-87

Страна происхождения:
Германия



Слепочный трансфер PS D3.4/GH3 для дентального имплантата Xive® (Transfer Coping Reposition PS D3.4/GH3)





Xive®

Transfer Coping Reposition
PS D3.4/GH3

REF 45-1830 / 32451830 LOT B200006051

Übertragungsaufbau Reposition
PS D3.4/GH3

Moignon d'empreinte repositionnement
PS D3.4/GH3

Moncone da impronta Técnica
di riposizionamento PS D3.4/GH3

Pilar de transferencia Técnica
de reposición PS D3.4/GH3



2020-10-21 2030-10-20
+EFRI324518302/\$\$3301020B200006051/16D20201021J

Dentsply
Sirona

Made in Germany

Dentsply Implants Manufacturing GmbH
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Germany

21002353

Слепочный трансфер PS D3.4/GH3 для дентального имплантата Xive®

Transfer Coping Reposition PS D3.4/GH

PУ № P3H 2019/8732

От xxxxxx

REF 32451830

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информации о безопасности,
показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции

Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта

Производитель:
Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
Германия

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Дентсплай Сирона»,
115432, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6
Тел. +7 (495) 725-10-87

Страна происхождения:
Германия



Слепочный трансфер PS D3.4/GH3 для дентального имплантата Xive® (Transfer Coping PickUp PS D3.4/GH3)





Xive®
Transfer Coping PickUp PS
D3.4/GH3

REF 45-1835 / 32451835 **LOT** B123456789

Übertragungsaufbau PickUp PS
D3.4/GH3

Moignon d'empreinte à ciel ouvert PS
D3.4/GH3

Pilastro di trasferimento per tecnica pick-up PS
D3.4/GH3

Pilar de transferencia técnica Pickup PS
D3.4/GH3



**Dentsply
Sirona**

Made in <Country>

Dentsply Implants Manufacturing GmbH
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Germany

210002353

Слепый трансфер PS D3.4/GH3 для дентального имплантата Xive®

Transfer Coping PickUp PSD3.4/GH3

PUNR P3H 2019/8732

От xxxxxx

REF 32451835

см. на упаковке

Только для использования врачами-стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции.
Сохраните упаковку и инструкцию до окончания использования продукта.

Производитель:
Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
Германия

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Дентсплай Сирона»,
115432, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6
Тел. +7 (495) 725-10-87

Страна происхождения:
Германия



Ретенционная втулка МР для дентального имплантата Xive® длинная D3.4 (Xive® MP Retention Sleeve long D3.4)





Xive®
MP Retention Sleeve
long D3.4

REF 46-3230 / 32463230 **LOT** B123456789

MP Retentionshülse
lang D3.4
Gaine avec rétention MP
longue D3.4
Manicotto di ritenzione MP
lungo D3.4
Casquillo con retención MP
largo D3.4



Dentsply
Sirona
Made in <Country>
Dentsply Implants Manufacturing GmbH
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Germany

21002353

Ретенционная втулка MP для дентального имплантата Xive® длиной D3.4

Xive® MP Retention Sleeve long D3.4

PУ № P3H 2019/8732

От xxxxxx

REF 32463230

см. на упаковке

Только для использования врачами-стоматологами. Информация о безопасности, показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции.
Сохраняйте упаковку и инструкцию до окончания использования продукта

Производитель:
Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
Германия

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Дентсплай Сирона»,
115432, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6
Тел. +7 (495) 725-10-87

Страна происхождения:
Германия



Ретенционная втулка МР для дентального имплантата Xive® длинная D3.8 (Xive® MP Retention Sleeve long D3.8)







Xive®
MP Retention Sleeve
long D3.8

REF 46-3240 / 32463240 **LOT** B123456789

MP Retentionshülse
 lang D3.8
 Gaine avec rétention MP
 longue D3.8
 Manicotto di ritenzione MP
 lungo D3.8
 Casquillo con retención MP
 largo D3.8



Dentsply
Sirona

Made in <Country>

Dentsply Implants Manufacturing GmbH
 Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Germany

21002354

Ретенционная втулка MP для дентального имплантата Xive® длиной D3.8

Xive® MP Retention Sleeve long D3.8

PY № P3H 2019/8732

От xxxxxx

REF 32463240

см. на упаковке

Только для использования врачами-стоматологами. Информацию о безопасности,
 показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции
 Сохраните упаковку и инструкцию до окончания использования продукта

Производитель:
 Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
 Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
 Германия

Уполномоченный представитель в РФ:
 ООО «Дентсплай Сирона»,
 115432, г. Москва,
 пр-т Андропова, д. 18, корп. 6
 Тел. +7 (495) 725-10-87

Страна происхождения:
 Германия



Ретенционная втулка МР для дентального имплантата Xive® длинная D4.5 (Xive® MP Retention Sleeve long D4.5)







Xive®
MP Retention Sleeve
long D4.5

REF 46-3250 / 32463250 **LOT** B123456789

MP Retentionshülse
 lang D4.5

Gaine avec rétention MP
 longue D4.5

Manicotto di ritenzione MP
 lungo D4.5

Casquillo con retención MP
 largo D4.5



FOR INSTRUCTIONS FOR
 USE AND SYMBOLS
 GLOSSARY REFER TO
ifu.dentsplysirona.com



2020-03-29

2030-03-30

(01)07392532231513(11)200329(17)300330(10)B123456789



Made in <Country>



Dentsply Implants Manufacturing GmbH
 Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Germany

21002280

Ретенционная втулка MP для дентального имплантата Xive® длиной D4.5

Xive® MP Retention Sleeve long D4.5

РУ № РЗН 2019/8732

От xxxxxx

REF 32463250

см. на упаковке

Только для использования врачами-стоматологами. Информация о безопасности,
 показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции.
 Сохраните упаковку и инструкцию до окончания использования продукта.



Производитель:

Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
 Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
 Германия

Уполномоченный представитель в РФ:

ООО «Дентсплай Сирона»,
 115432, г. Москва,
 пр-т Андропова, д. 18, корп. 6
 Тел. +7 (495) 725-10-87

Страна происхождения:
 Германия



ifu.dentsplysirona.com

Ретенционная втулка МР для дентального имплантата Xive® длинная D5.5 (Xive® MP Retention Sleeve long D5.5)







Xive®
MP Retention Sleeve
long D5.5

REF 46-3260 / 32463260 **LOT** B123456789

MP Retentionshülse
lang D5.5
Gaine avec rétention MP
longue D5.5
Manicotto di ritenzione MP
lungo D5.5
Casquillo con retención MP
largo D5.5



R_xonly



CE 0123



FOR INSTRUCTIONS FOR
USE AND SYMBOLS
GLOSSARY REFER TO

ifu.dentsplysirona.com



2020-03-29

2030-03-30

(01)07392532231520(11)200329(17)300330(10)8123456789



Made in <Country>

Dentsply Implants Manufacturing GmbH
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Germany

21002365

Ретенционная втулка MP для дентального имплантата Xive® длиной D5.5

Xive® MP Retention Sleeve long D5.5

РУ № РЭН 2019/8732

От xxxxxx

REF 32463260

см. на упаковке

Только для использования врачами стоматологами. Информация о безопасности,
показаниях и противопоказаниях: см. в инструкции.
Сохраните упаковку и инструкции до окончания использования продукта

Производитель:
Dentsply Implants Manufacturing GmbH,
Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau,
Германия

Уполномоченный представитель в РФ:
ООО «Дентсплай Сирона»,
115432, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6
Тел. +7 (495) 725-10-87

Страна происхождения:
Германия





Сшито и скреплено печатью 48 » лп

Директор по регистрации Россия и СНГ
ООО «Дентсплай Сирона»
Хаиндрава В. Г.

Дата: « 28 12 2022 »

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 1/21 ОТ 01.12.2021

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 1/21 ОТ 01.12.2021