

КОПИЯ

证明书

CERTIFICATE



中国国际贸易促进委员会暨中国国际商会

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ f International Trade is China Chamber of International Commerce

01325784

中国国际贸易促进委员会



China Council for the Promotion of International Trade
China Chamber of International Commerce

证明书

CERTIFICATE



223301A0/021026

号码 No.

兹证明：在所附文件上的杭州安旭生物科技股份有限公司的印章属实。

THIS IS TO CERTIFY THAT: the seal of ASSURE TECH
(HANGZHOU) CO., LTD. on the annexed DOCUMENT is genuine.



授权签字: 郭晓夫

Authorized
Signature: Guo Xiaofu

日期: 2022年11月14日
(Date: Nov. 14, 2022)

证明书查询网址 Website for verifying the certificate: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

УТВЕРЖДАЮ


Генеральный директор ООО «НАРКОЛАБ»

А. Васильев




Фотографические изображения медицинского изделия
Тест-контейнер для выявления психоактивных веществ и их
метаболитов в моче иммунохроматографическим методом для in vitro
диагностики
(«Тест-система НАРКОЛАБ»), в вариантах исполнения


2022 г.

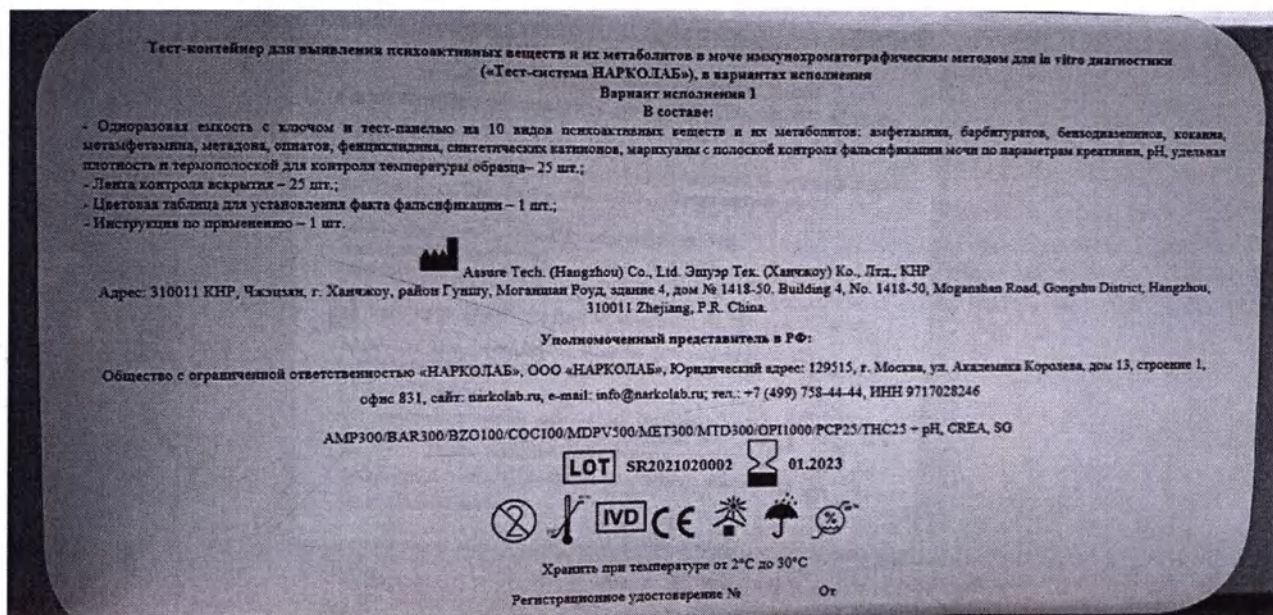


Фотографическое изображение 3. Маркировка групповой упаковки варианта исполнения 1 партии SR2021020002, срок годности 01.2023

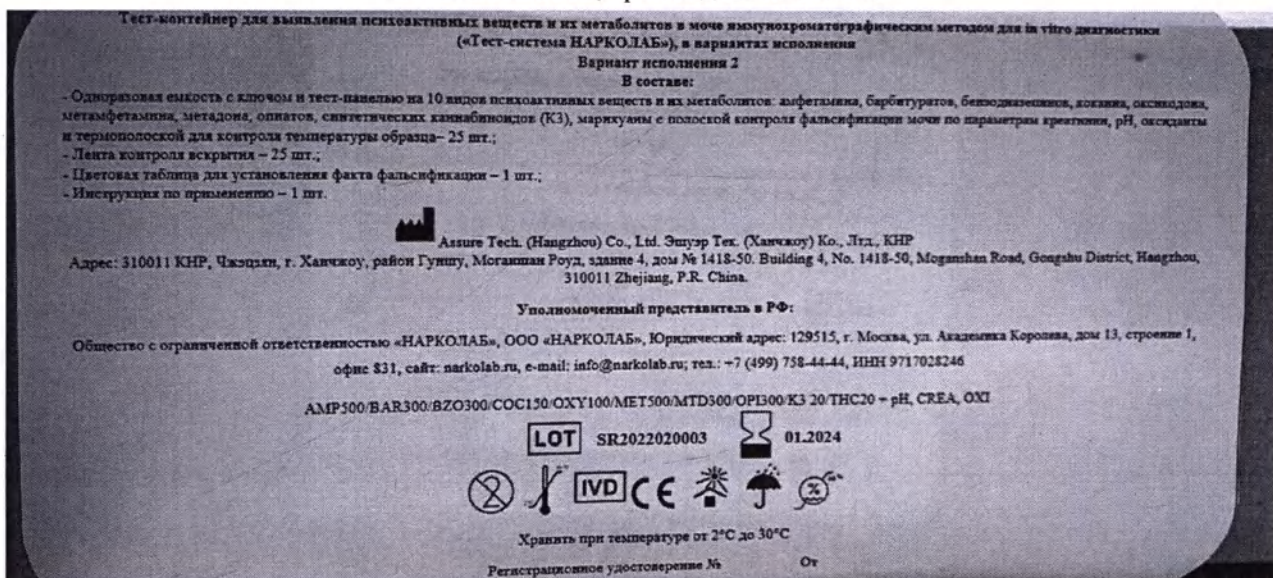


Фотографическое изображение 4. Маркировка групповой упаковки варианта исполнения 2 партии SR2022020003, срок годности 01.2024

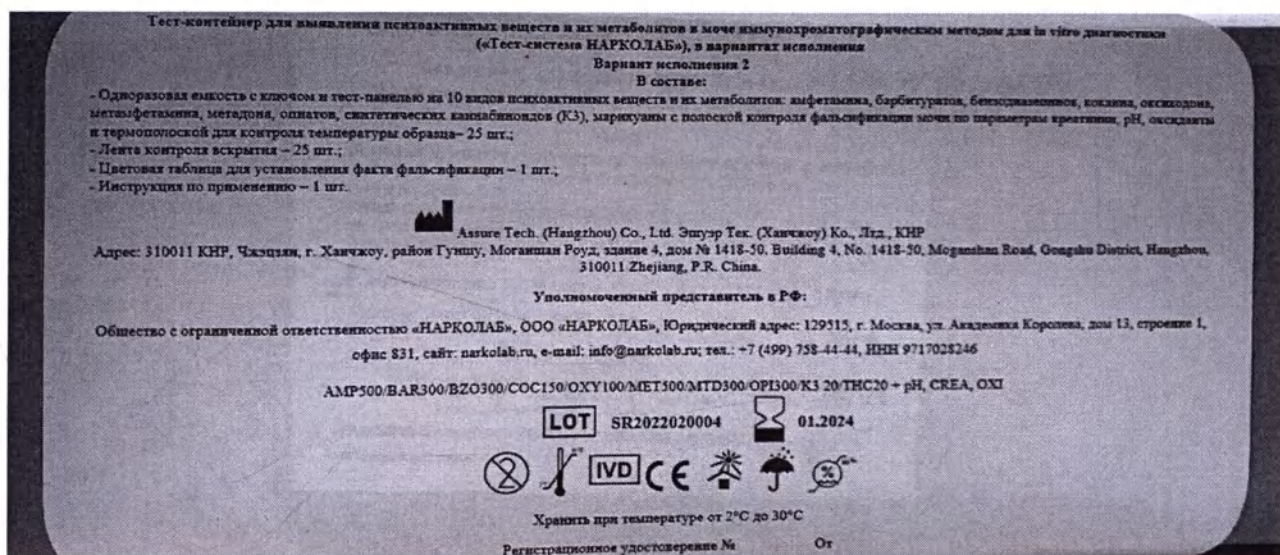

Фотографическое изображение 5. Маркировка групповой упаковки варианта исполнения 2 партии SR2022020004, срок годности 01.2024

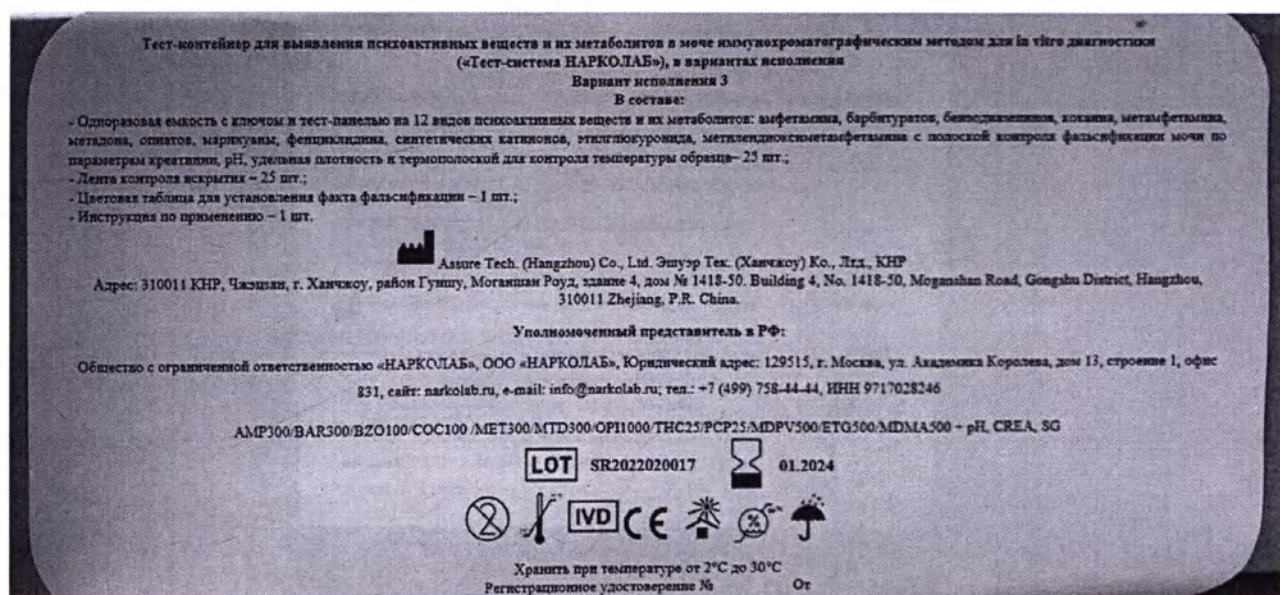


Фотографическое изображение 6. Маркировка групповой упаковки варианта исполнения 3 партии SR2022020017, срок годности 01.2024

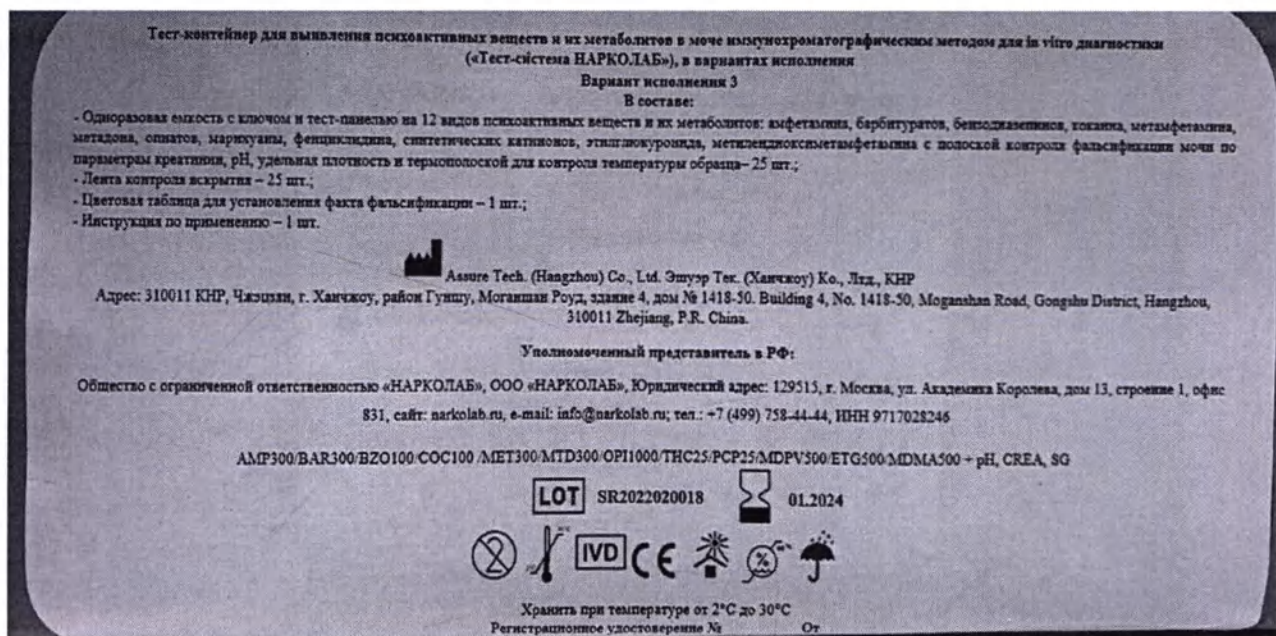


Фотографическое изображение 7. Маркировка групповой упаковки варианта исполнения 3 партии SR2022020018, срок годности 01.2024




Фотографическое изображение 8. Общий вид медицинского изделия в индивидуальной упаковке

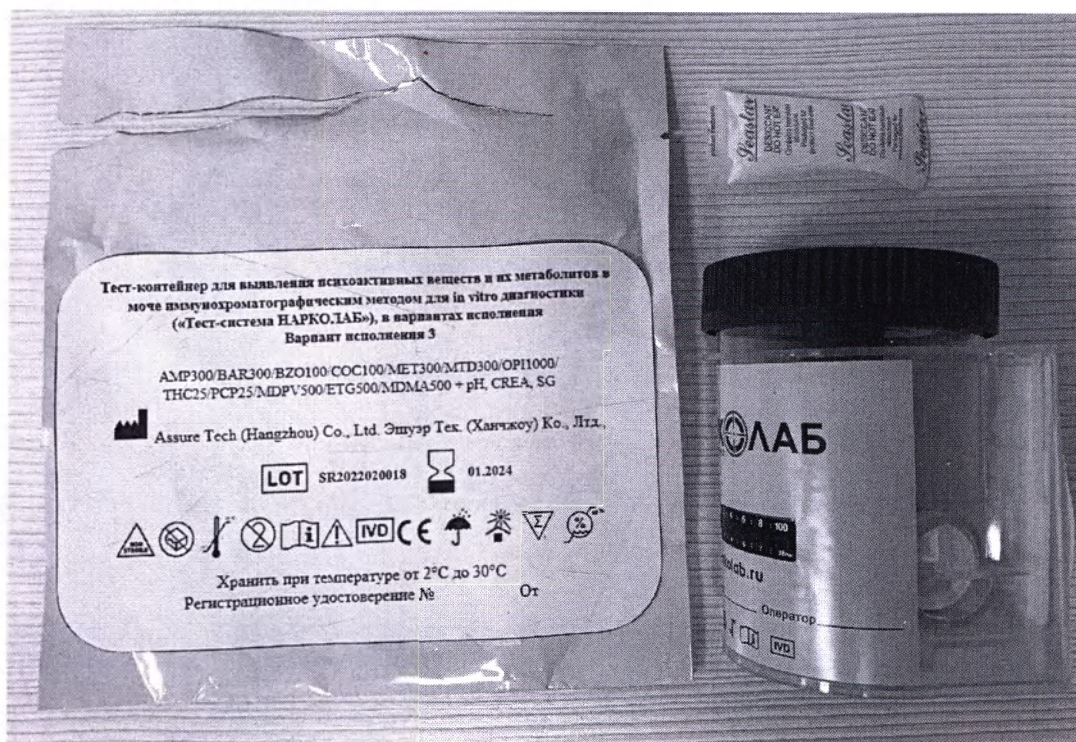


Фотографическое изображение 9. Содержимое индивидуальной упаковки

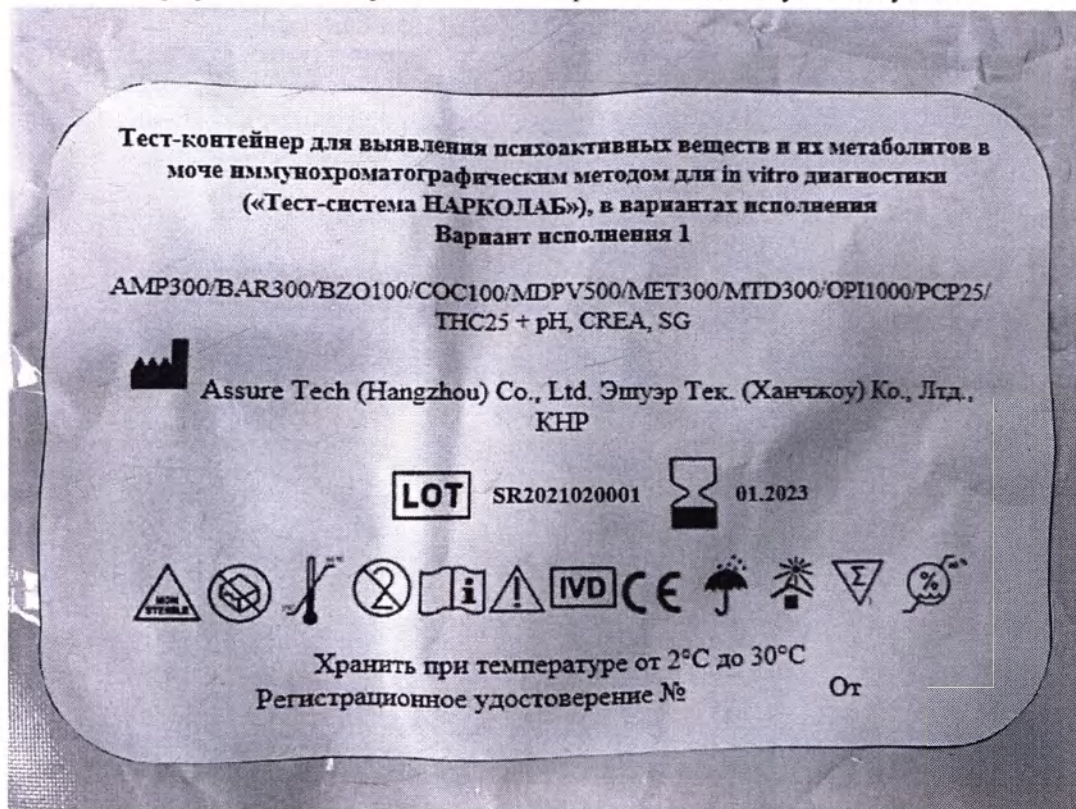


Фотографическое изображение 10. Маркировка индивидуальной упаковки варианта исполнения 1 партии SR2021020001, срок годности 01.2023

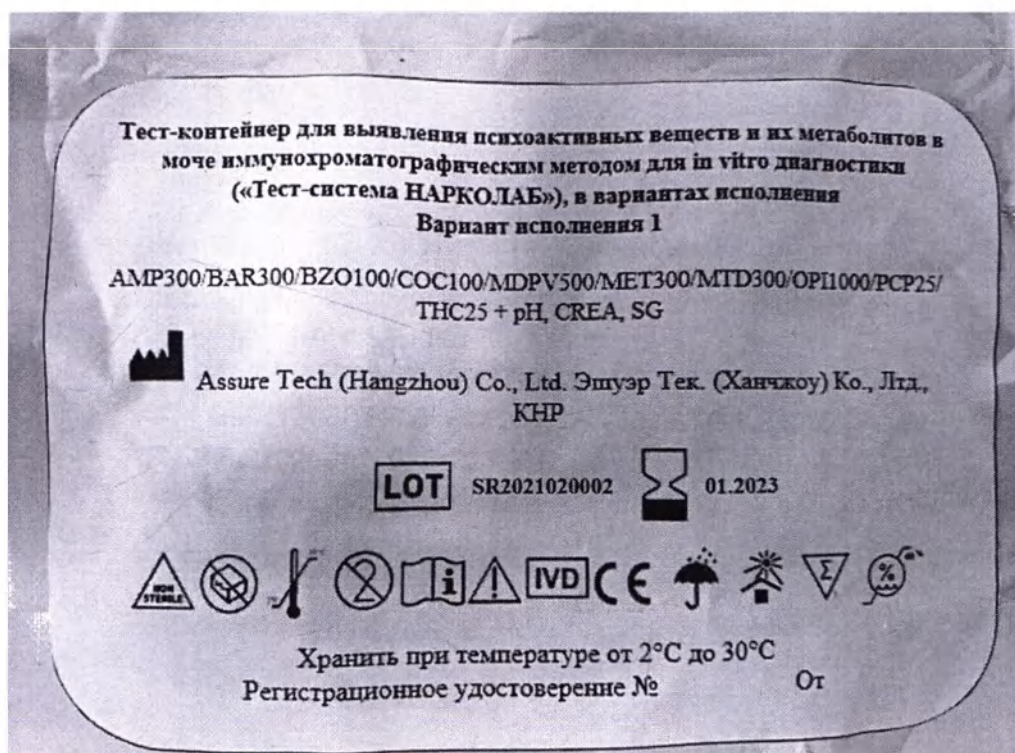


Фотографическое изображение 11. Маркировка индивидуальной упаковки варианта исполнения 1 партии SR2021020002, срок годности 01.2023

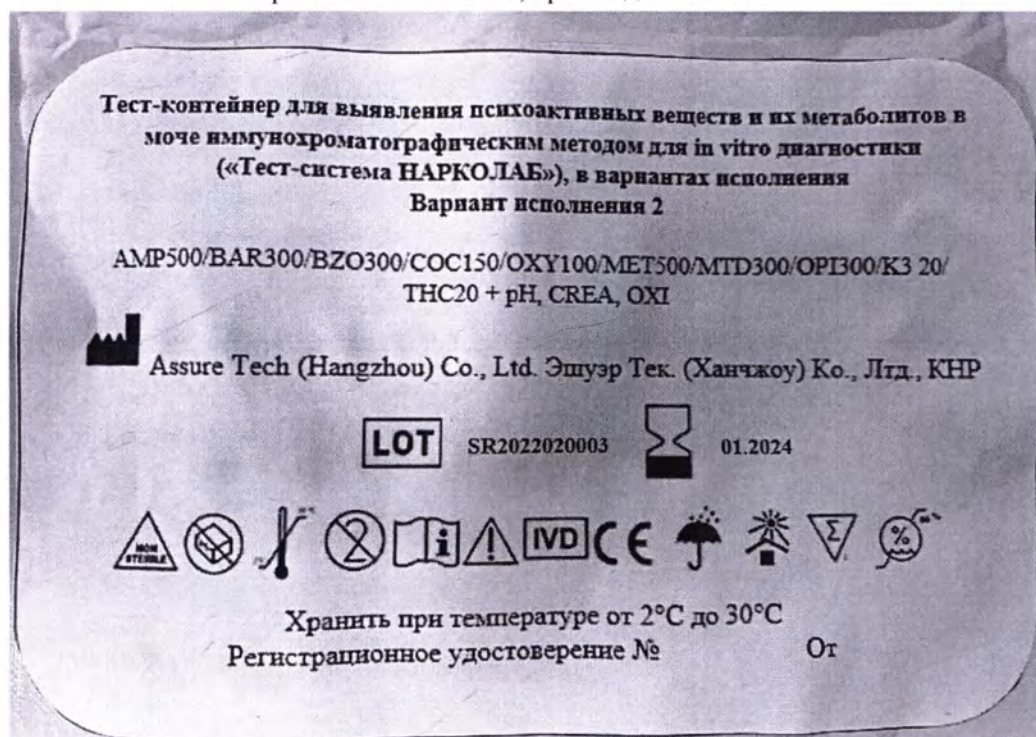


Фотографическое изображение 12. Маркировка индивидуальной упаковки варианта исполнения 2 партии SR2022020003, срок годности 01.2024

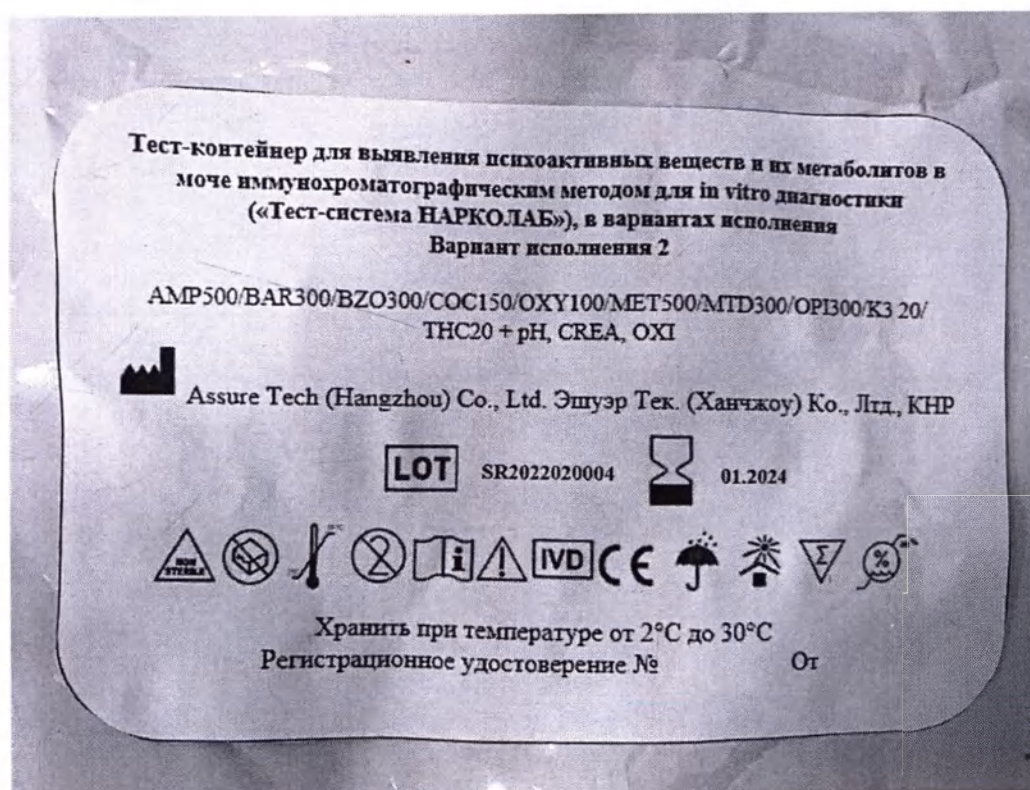

Фотографическое изображение 13. Маркировка индивидуальной упаковки варианта исполнения 2 партии SR2022020004, срок годности 01.2024

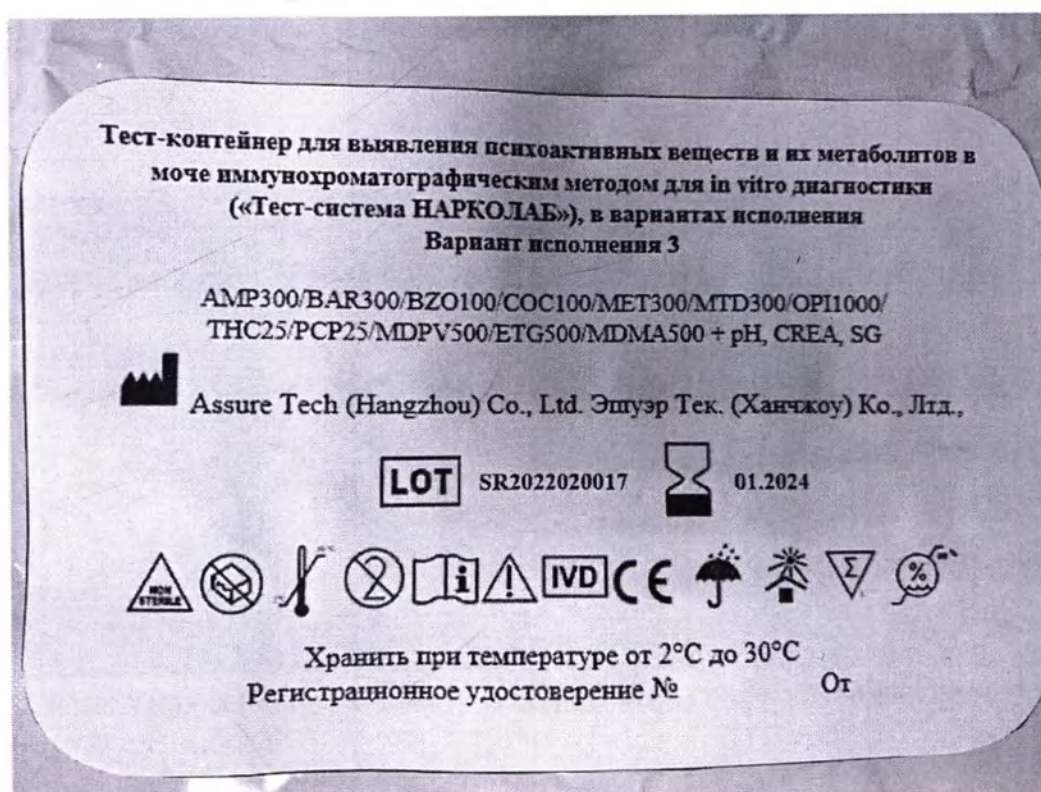


Фотографическое изображение 14. Маркировка индивидуальной упаковки варианта исполнения 3 партии SR2022020017, срок годности 01.2024

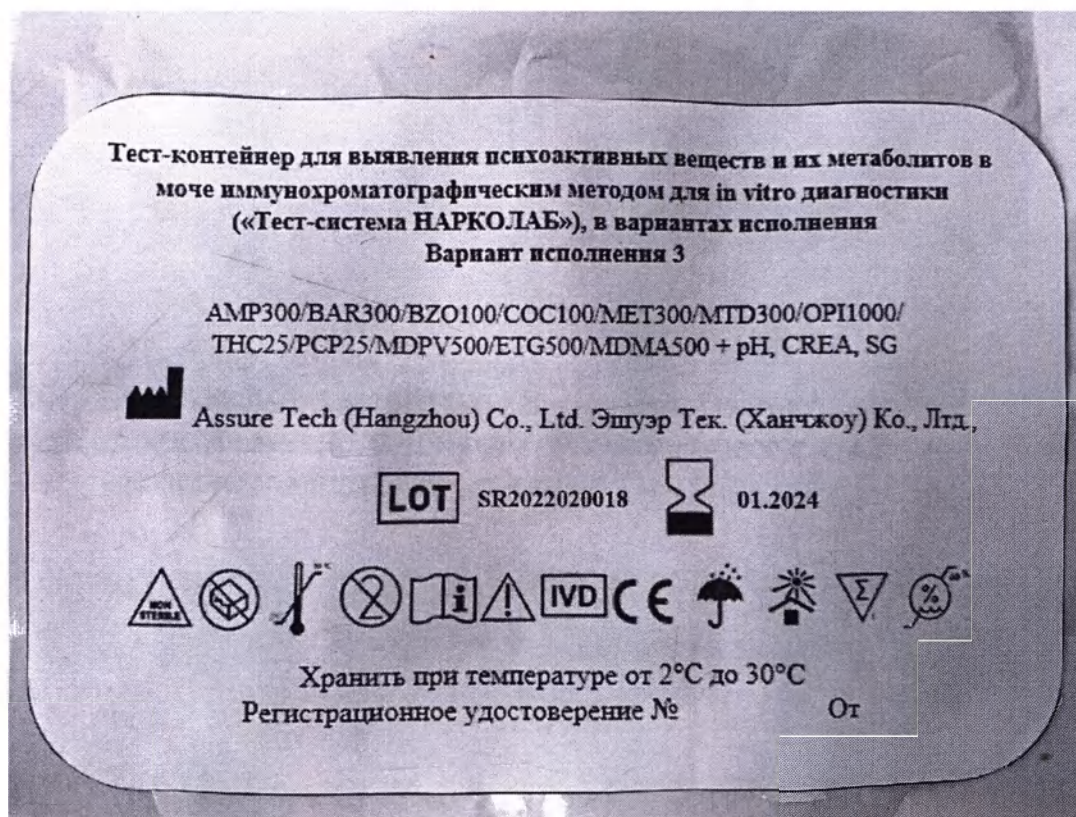

Фотографическое изображение 15. Маркировка индивидуальной упаковки варианта исполнения 3 партии SR2022020018, срок годности 01.2024




Фотографические изображения 16-19. Внешний вид тест-контейнера с ярлыком

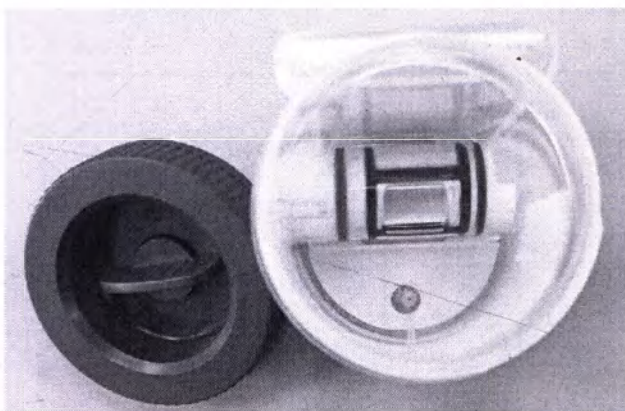


Фотографическое изображение 20. Внешний вид открытого тест-контейнера




Фотографическое изображение 21. Внешний вид ключа

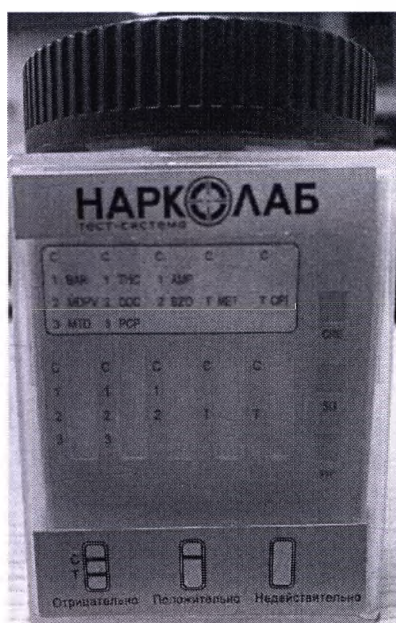

Фотографическое изображение 22. Внешний вид тест-полосок (вариант исполнения 1)

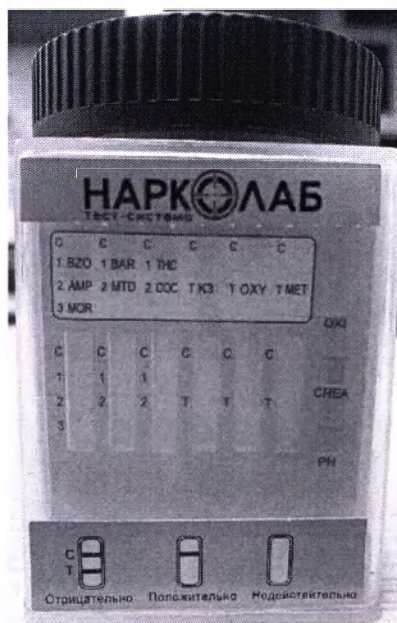

Фотографическое изображение 23. Внешний вид тест-полосок (вариант исполнения 2)

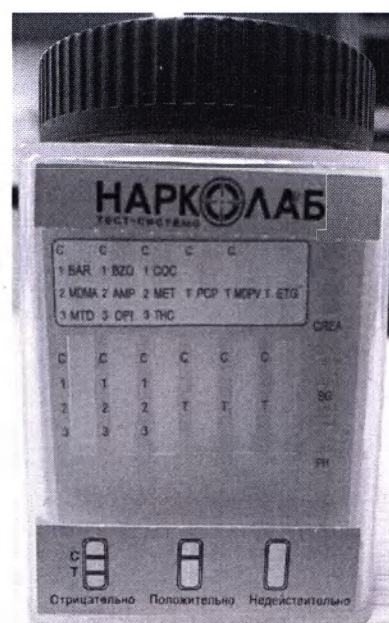

Фотографическое изображение 24. Внешний вид тест-полосок (вариант исполнения 3)

Показателн	Норма				Отклонение от нормы			
Оксиданты								
Креатинин	 100 мг/дл	 20 мг/дл	 0мг/дл	 10мг/дл				
pH	 4,0	 7,0	 9,0	 2,0	 3,0	 10,0	 11,0	 12,0
Удельная плотность	 1,003	 1,005	 1,015	 1,025	 1,000		 1,035	

Фотографическое изображение 25. Внешний вид цветовой таблицы для установления факта фальсификации

Дата	Инициалы	Контрольная лента
Дата	Инициалы	Контрольная лента
Дата	Инициалы	Контрольная лента
Дата	Инициалы	Контрольная лента
Дата	Инициалы	Контрольная лента

Фотографическое изображение 26. Внешний вид ленты контроля вскрытия



NARCOLAB
Test System /logotype/

129515, City of Moscow, Academician Korolev Street, Building
13, Construction 1

www.narkolab.ru

APPROVED BY

Director General

S.A. Vasilyev

June 7, 2022




Medical Device Photographic Images

**“Test-container for the Psychoactive Substances and their Metabolites
Detection in Urine by Immunochromatographic Method for *in vitro*
Diagnostics ("NARCOLAB Test System"), in different approaches / design
versions”**


2022




Photographic Image No. 1. Medical Device General View in Consumer Packaging

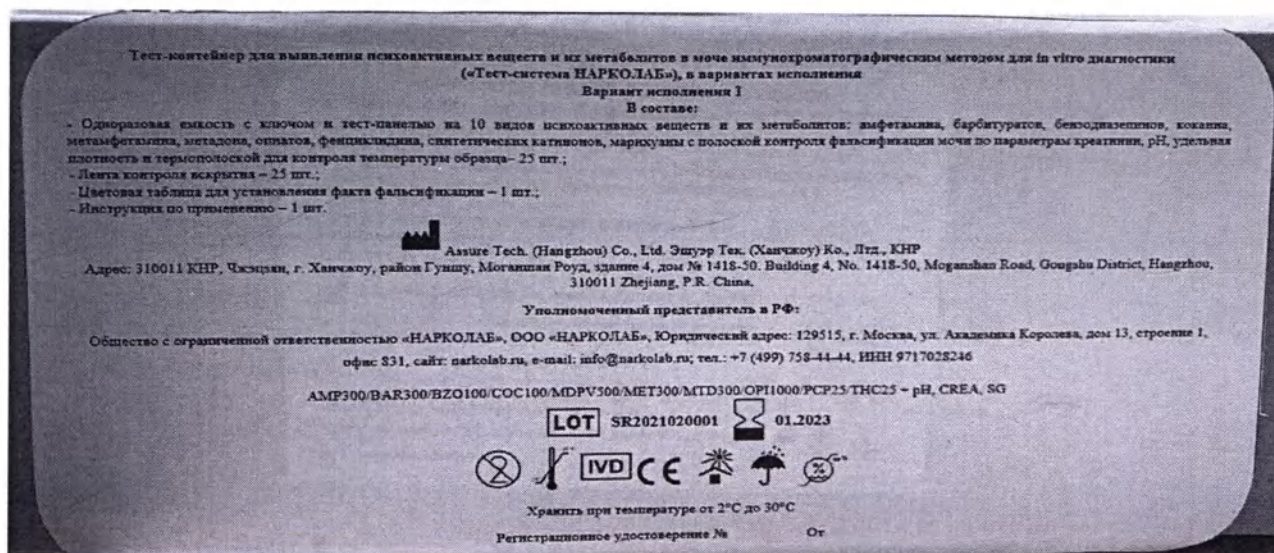


Photographic Image No. 2. Multiple Packaging Labeling of the Batch No. SR2021020001 Approach / Design Version No. 1, Shelf Life: 01.2023

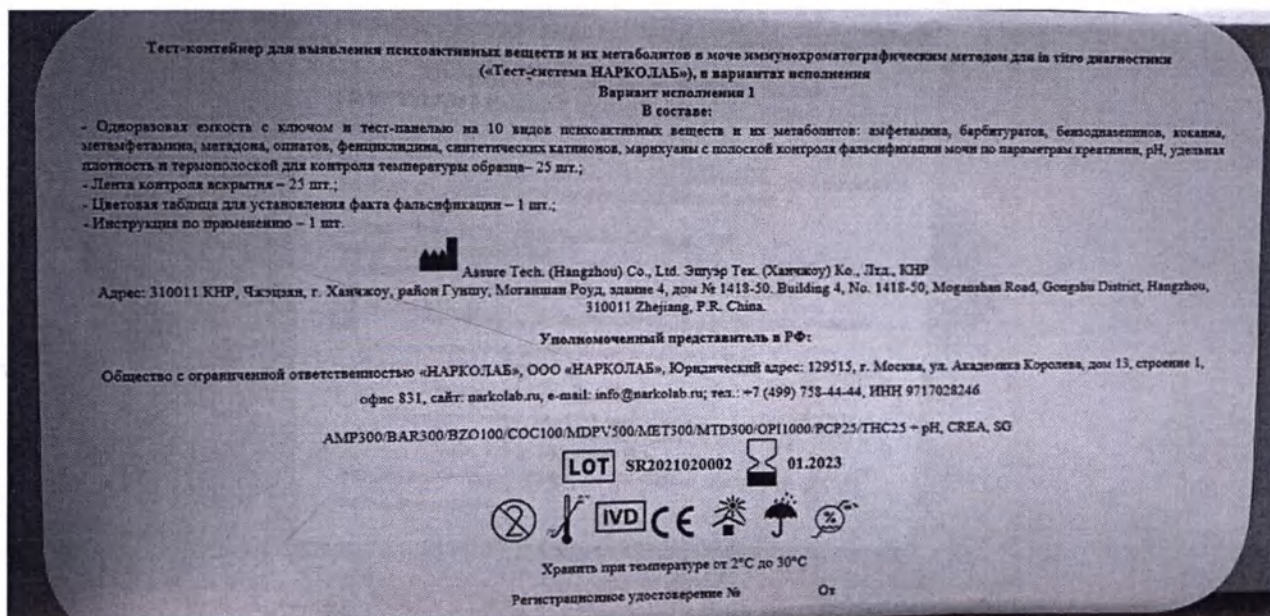


Photographic Image No. 3. Multiple Packaging Labeling of the Batch Approach / Design Version No. 1 SR2021020002, Shelf Life: 01.2023

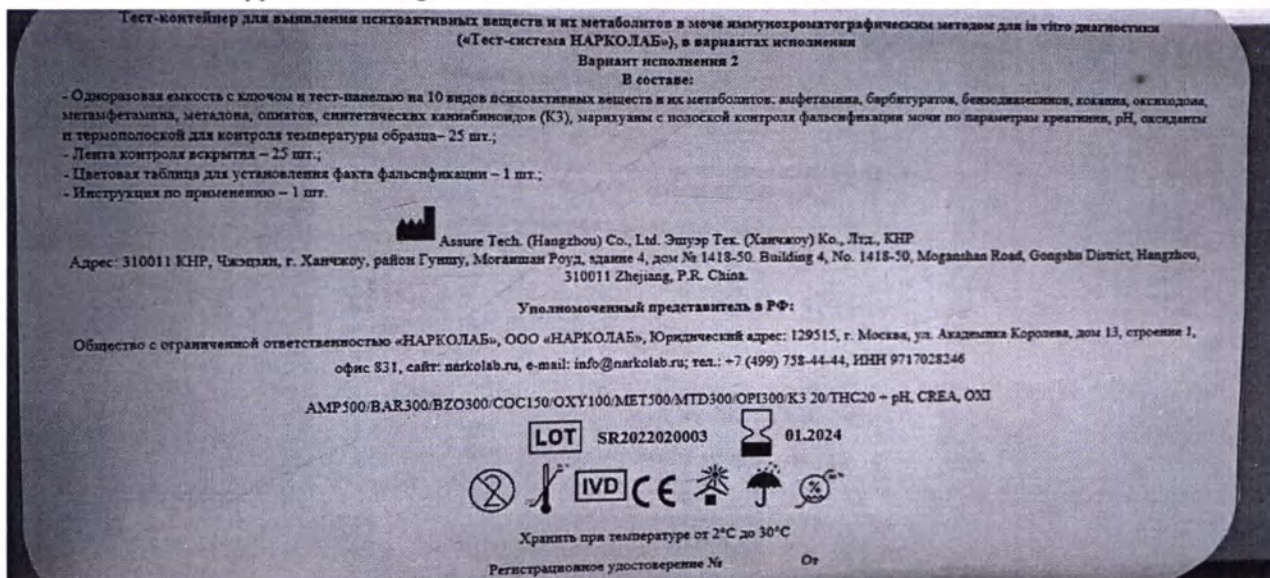


Photographic Image No. 4. Multiple Packaging Labeling of the Batch No. SR2022020003 Approach / Design Version No. 2, Shelf Life: 01.2024

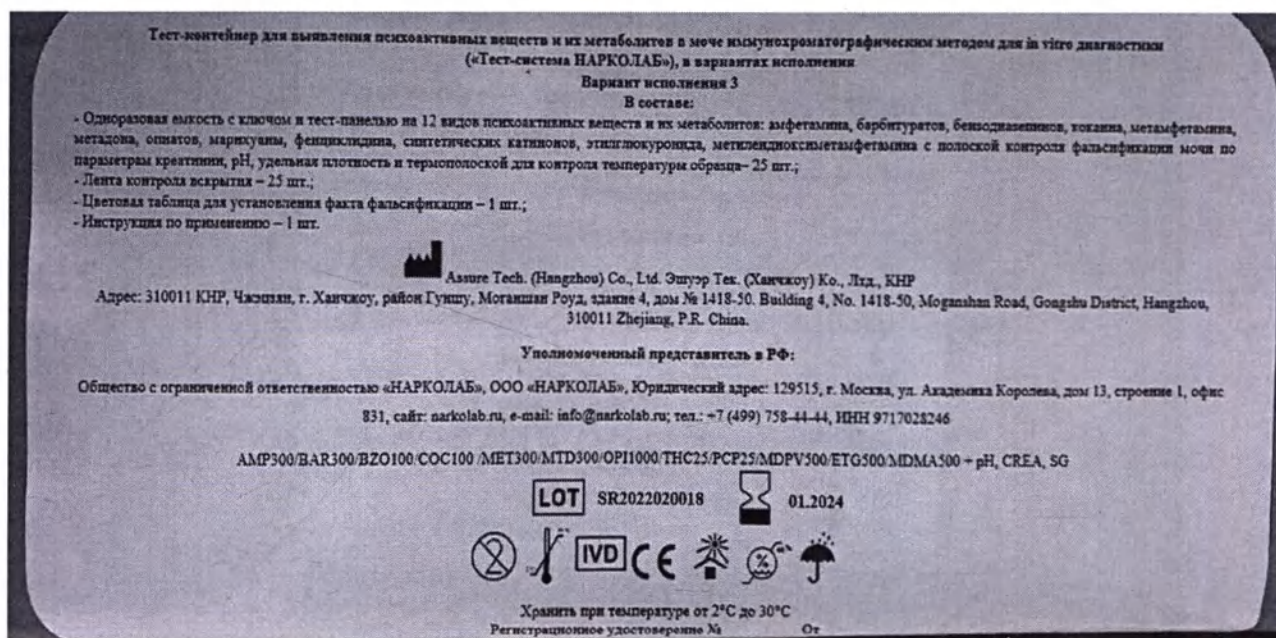


Photographic Image No. 7. Multiple Packaging Labeling of the Batch No. SR2022020018
Approach / Design Version No. 3 Shelf Life: 01.2024

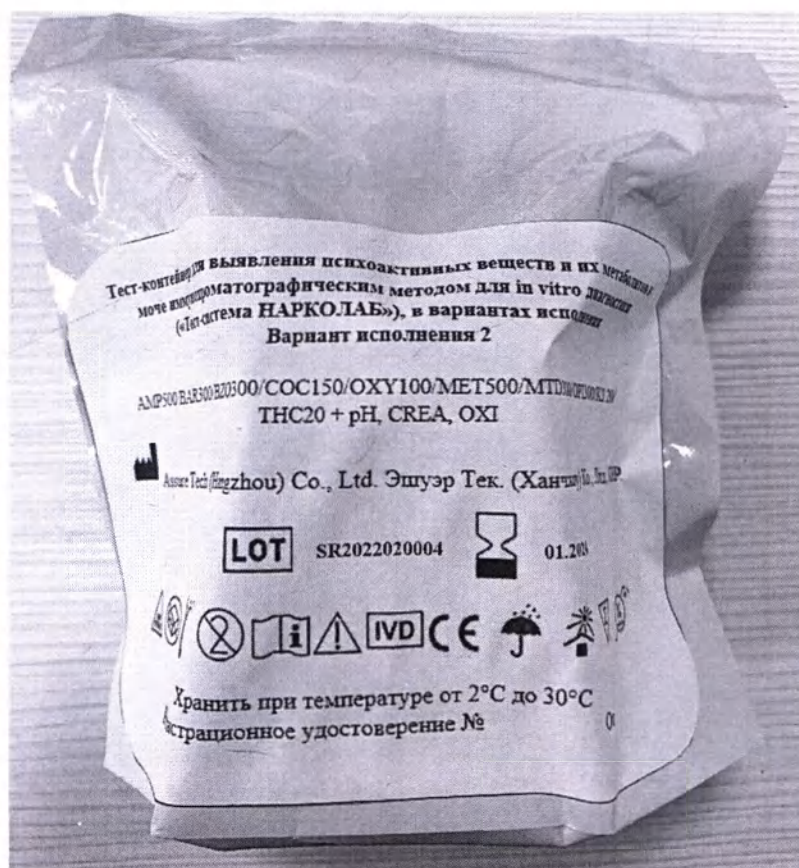


Photographic Image No. 8. Medical Device General View in Individual Packaging

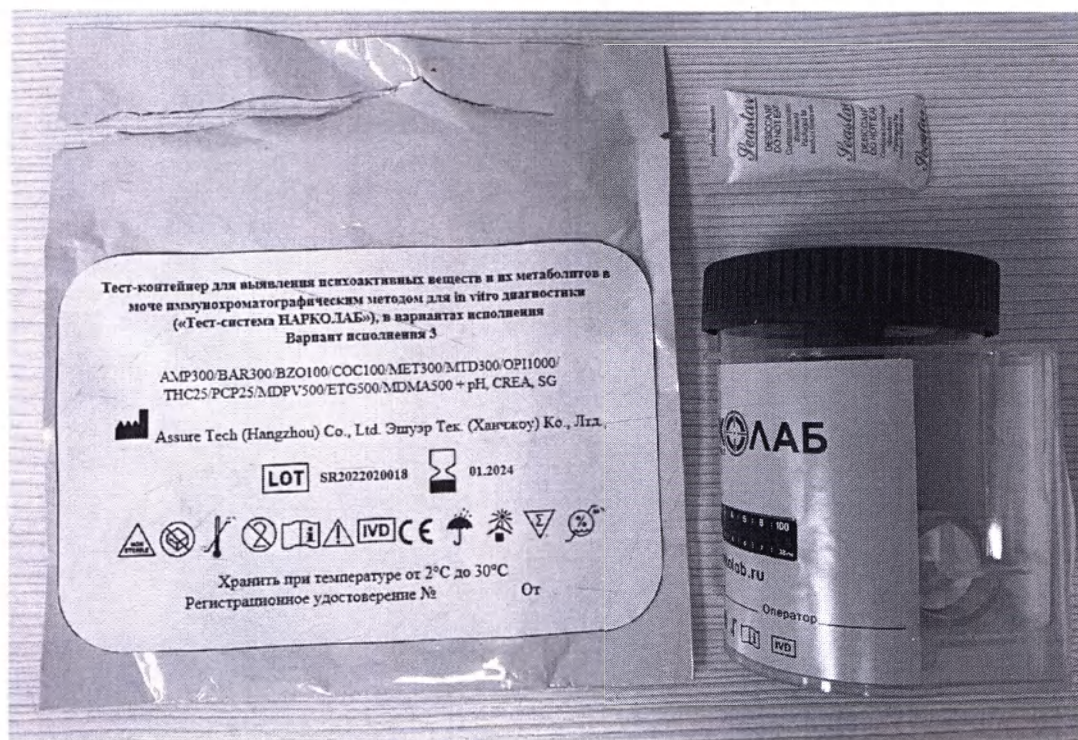


Photographic Image No. 9. Individual Packaging Contents

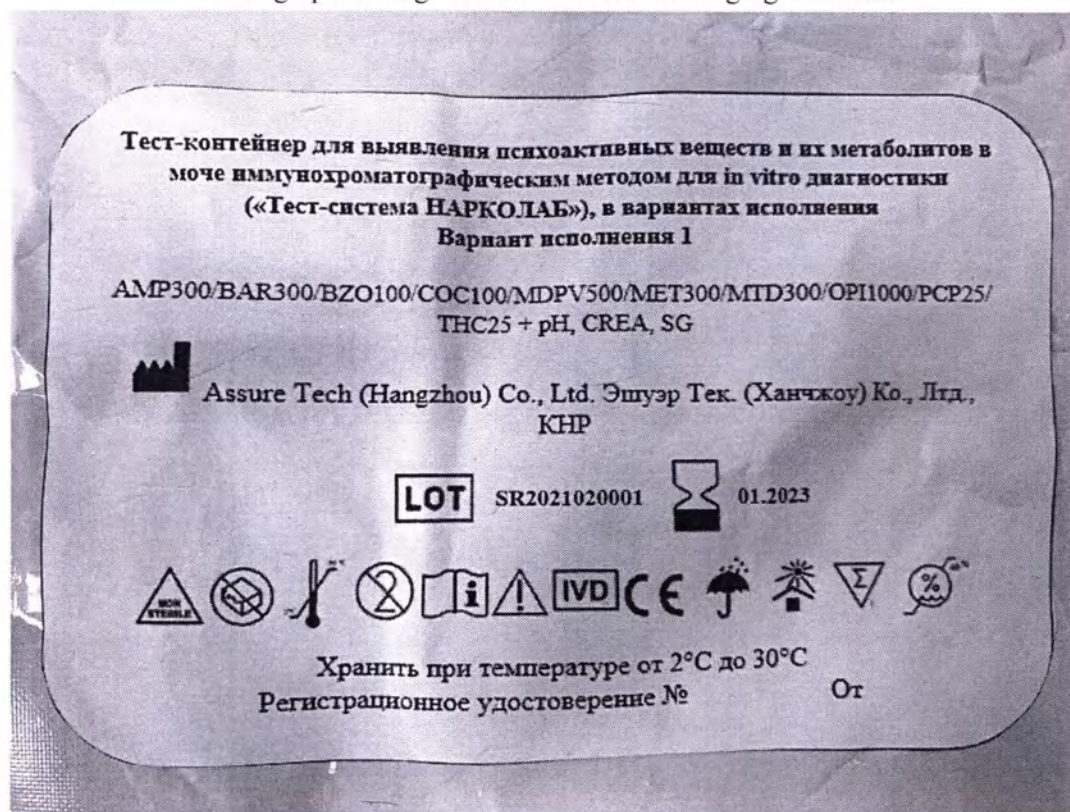


Photographic Image No. 10. Individual Packaging Labeling of the Batch No. SR2021020001
Approach / Design Version No. 1, Shelf Life: 01.2023

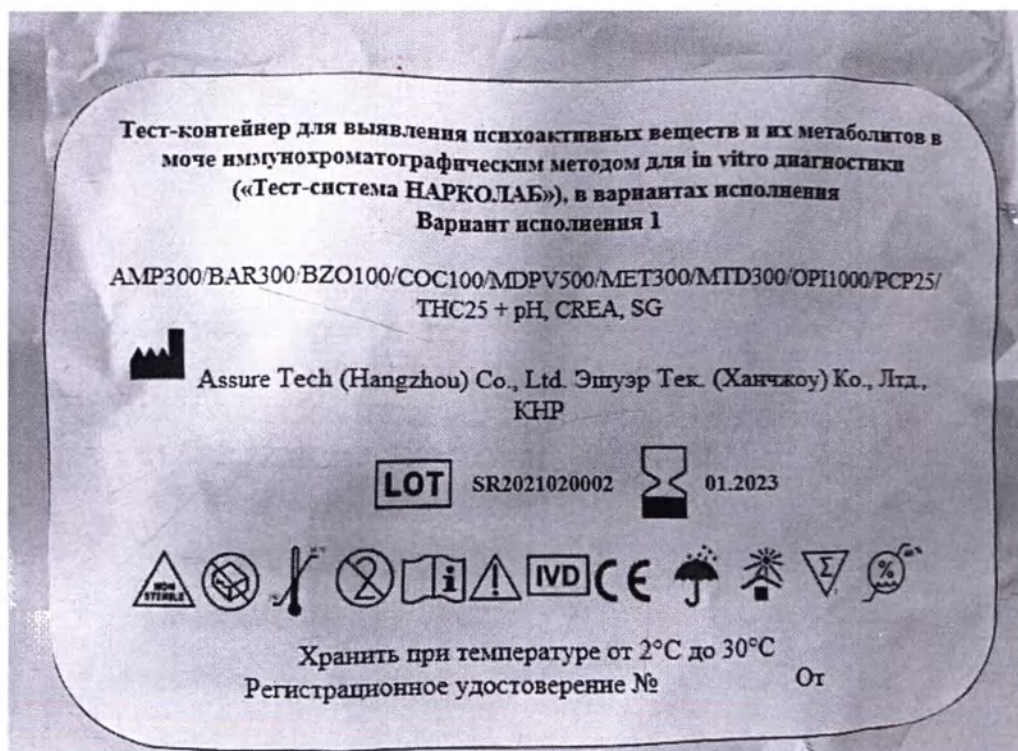


Photographic Image No. 11. Individual Packaging Labeling of the Batch No. SR2021020002
Approach / Design Version No. 1, Shelf Life: 01.2023

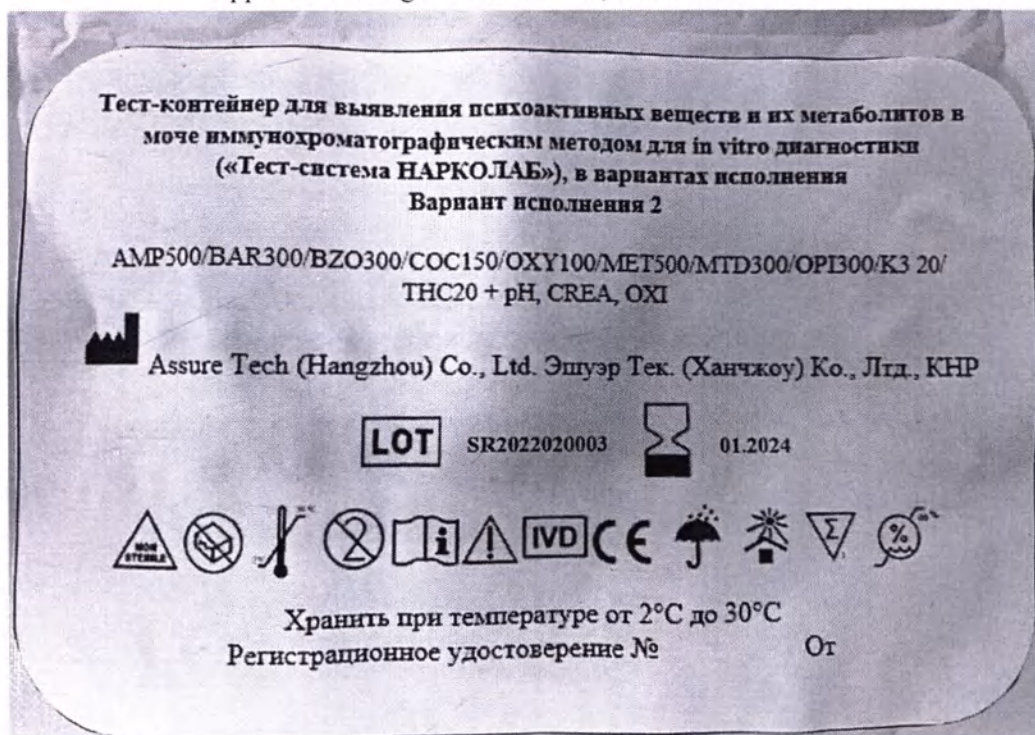


Photographic Image No. 12. Individual Packaging Labeling of the Batch No. SR2022020003
Approach / Design Version No. 2, Shelf Life: 01.2024

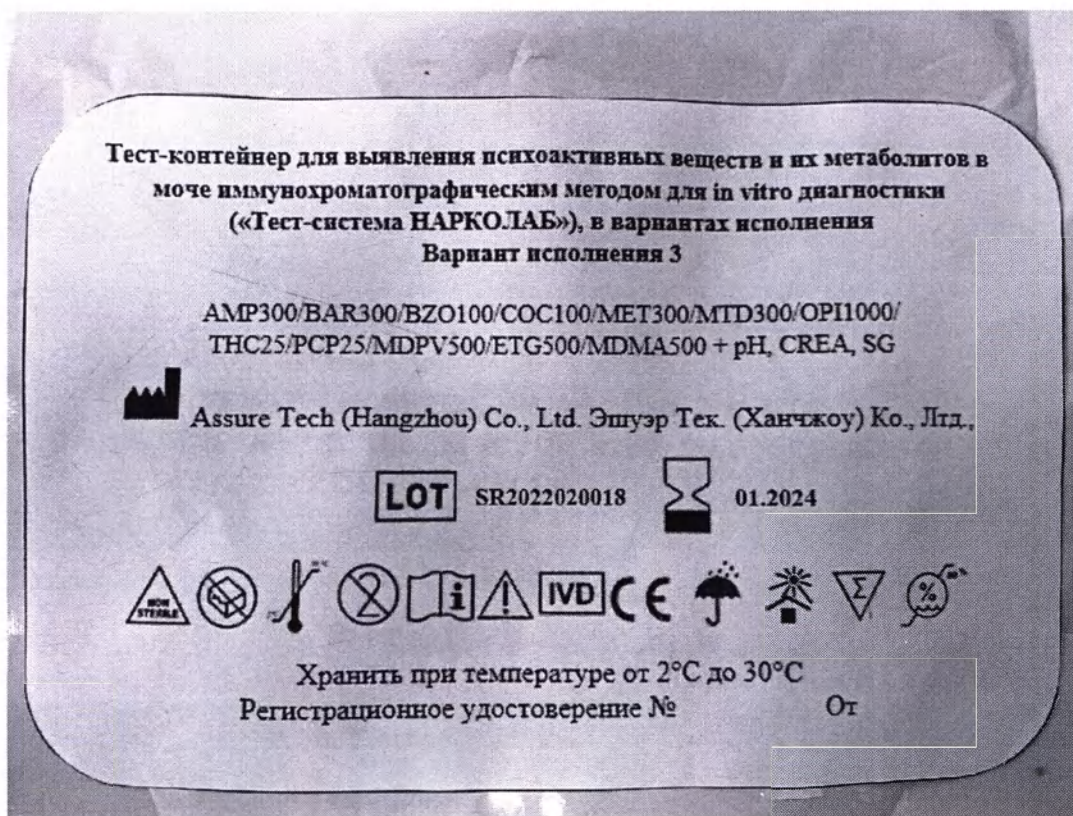

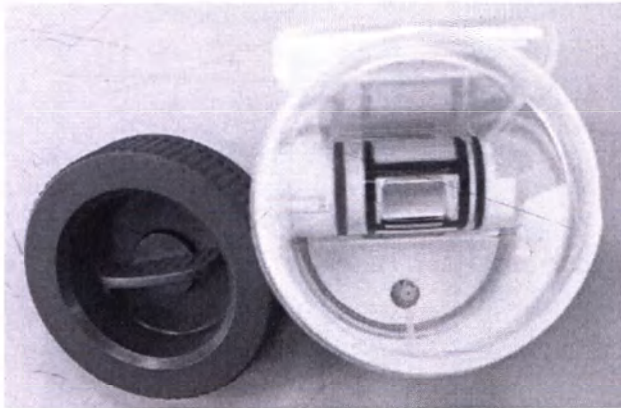


Photographic Image No. 20. Open Test Container Appearance

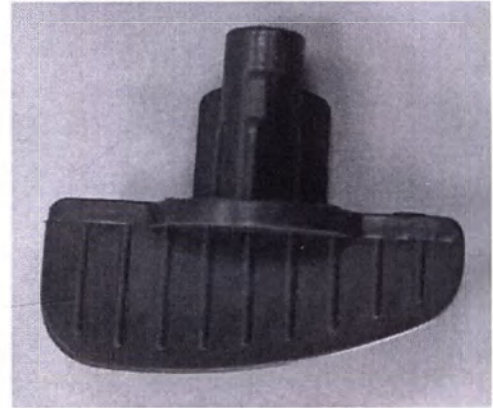

Photographic Image No. 21. Key Appearance



Photographic Image No. 22.
Test Strips Appearance
(Approach / Design Version
No. 1)

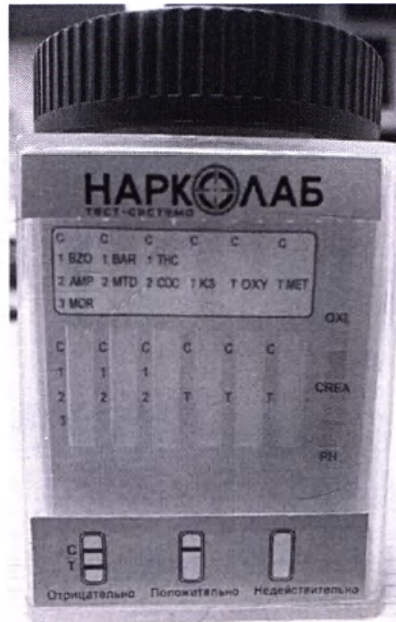

Photographic Image No. 23.
Test Strips Appearance
(Approach / Design Version
No. 2)



Photographic Image No. 24.
Test Strips Appearance
(Approach / Design Version
No. 3)

Показатели	Норма				Отклонение от нормы			
Оксиданты								
Креатинин	 100 мг/дл	 20 мг/дл	 0 мг/дл	 10 мг/дл				
pH	 4,0	 7,0	 9,0	 2,0	 3,0	 10,0	 11,0	 12,0
Удельная плотность	 1,003	 1,005	 1,015	 1,025	 1,000	 1,035		

Photographic Image No. 25. Color Table Appearance for establishing the fact of falsification

_____ Инициалы _____ Контрольная лента

_____ Инициалы _____ Контрольная лента

_____ Инициалы _____ Контрольная лента

_____ Инициалы _____ Контрольная лента

_____ Инициалы _____ Контрольная лента

а

Photographic Image No. 26. Tamper-Evident Label Appearance



证明书

CERTIFICATE



中国国际贸易促进委员会暨中国国际商会

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

China Council for the Promotion of International Trade is China Chamber of International Commerce

СЕРТИФИКАТ

ССРП

(Китайский совет по содействию международной торговле)

Китайским советом по содействию международной торговле является Китайская палата международной торговли

01325784

**Китайский Совет по содействию международной торговле
Китайская Палата международной торговли**

СЕРТИФИКАТ

№ 223301A0/021026

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, ЧТО печать компании ЭШУЭР ТЕК. (ХАНЧЖОУ) КО., ЛТД. (ASSURE TECH. (HANGZHOU) CO., LTD.) на прилагаемом ДОКУМЕНТЕ является подлинной.

Китайский совет по содействию международной торговле
**Печать: Китайский совет по содействию международной торговле
СЕРТИФИКАЦИЯ (37)**

Подпись уполномоченного лица: *подписано* (Гуо Сяофу)
Дата: 14 ноября 2022 года

Вебсайт для проверки сертификата: <http://www.rzccpit.com/validate.html>

Печать под текстом документа:

ЭШУЭР ТЕК. (ХАНЧЖОУ) КО., ЛТД. (ASSURE TECH. (HANGZHOU) CO., LTD.)

Я, Яценко Евгения Николаевна, перевела данный текст с английского и китайского языков на русский язык.

Российская Федерация
город Москва

седьмого декабря две тысячи двадцать второго года.

Я, Гончарова Элла Григорьевна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Яценко Евгении Николаевны.


Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 77/133-н/77-2022-4-1127

Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб.

Э.Г. Гончарова

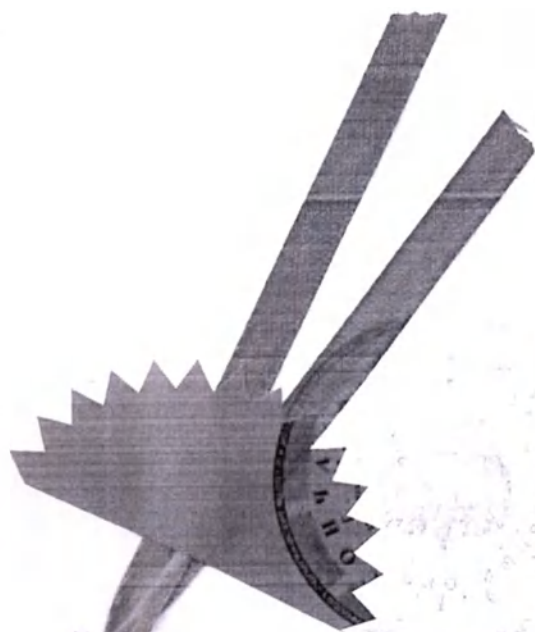

Всего выпущено
продукции и оказано
услуг
Директор
Информация



Российская Федерация

Город Москва

Седьмого декабря две тысячи двадцать второго года

**Я, Гончарова Элла Григорьевна, нотариус города Москвы, свидетельствую
верность копии с представленного мне документа.**

Зарегистрировано в реестре: № 77/133-п/77-2022-4-1138.

Уплачено за совершение нотариального действия: 1740 руб. 00 коп.



Э.Г.Гончарова

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 29 (двадцать девять) листов.

Э.Г.Гончарова