

УТВЕРЖДАЮ
Главный специалист-эксперт
по направлению МИБП
Управления по регистрации
АО «НПО «Микроген»
по доверенности



**Набор реагентов
Диагностический Рикетсиозный Провачек для РСК
по ТУ 21.10.60-157-20401675-2022**

1. Маркировка внутренней упаковки (ампулы):

МИКРОГЕН
ДИАГНОСТИКУМ
РИКЕТСИОЗНЫЙ
ПРОВАНЕКА ДЛЯ РСК
РАСТВОРИТЬ В 1 МЛ
0,9 % РАСТВОРА
НАТРИЯ ХЛОРИДА
С
ГОДЕН ДО

МИКРОГЕН
СЫВОРОТКА
ПРОВАНЕКА
ДЛЯ РСК 0,1 МЛ
ТИТР 1:
С
ГОДЕН ДО

**Набор реагентов
Диагностикум риккетсиозный Провачека для РСК
по ТУ 21.10.60-157-20401675-2022**

2. Маркировка внешней упаковки (пачки):

Размер пачки: 140x30x90 мм



УТВЕРЖДАЮ
Главный специалист-эксперт
по направлению МИБП
Управления по регистрации
АО «НПО «Микроген»
по доверенности


О.М. Волощук
2022 г.

МИКРОГЕН
ОТДЕЛ РЕГИСТРАЦИИ
ИМПОРТА И ЭКСПОРТА
МЕДИЦИНСКИХ ИМУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
МОСКВА

**Набор реагентов
Диагностикум риккетсиозный Провачека для РСК
по ТУ 21.10.60-157-20401675-2022**

3. Маркировка транспортной тары:

Размер этикетки: 148x115 мм

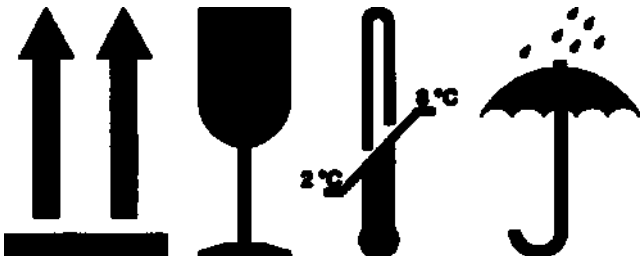 Не кантовать!	Lot Серия: Годен до: Число единиц потребит. упак. изделия:						
Набор реагентов ДИАГНОСТИКУМ РИККЕТСИОЗНЫЙ ПРОВАЧЕКА ДЛЯ РСК по ТУ 21.10.60-157-20401675-2022							
БИОПРЕПАРАТЫ							
Транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре от 2 до 8 °С. Хранить в упаковке изготовителя в течение всего срока годности при температуре от 2 до 8 °С.	 АО «НПО «Микроген» Россия, 115088, г. Москва, ул. 1-я Дубровская, д. 15, строение 2 тел. (495) 710-37-87 Адрес производства: Россия, 614089, Пермский край, г. Пермь, ул. Братская, д. 177 тел. (342) 281-84-86						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Масса брутто</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Масса нетто</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Масса нетто потребит. упак.</td> <td></td> </tr> </table>		Масса брутто		Масса нетто		Масса нетто потребит. упак.	
Масса брутто							
Масса нетто							
Масса нетто потребит. упак.							

УТВЕРЖДАЮ
Главный специалист-эксперт
по направлению МИБП
Управления Регистрации
АО «НПО «Микроген»
по доверенности

О.М. Волощук

2022 г.



Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
листа(ов)

КОПИЯ


ВЕРН



МИКРОГЕН
ДОСТОВЕРНОСТИ
ВСПОЩУК

Б.П.

Представитель
АО БИО МИКРОГЕН
по доверенности
ОМ Влопущук

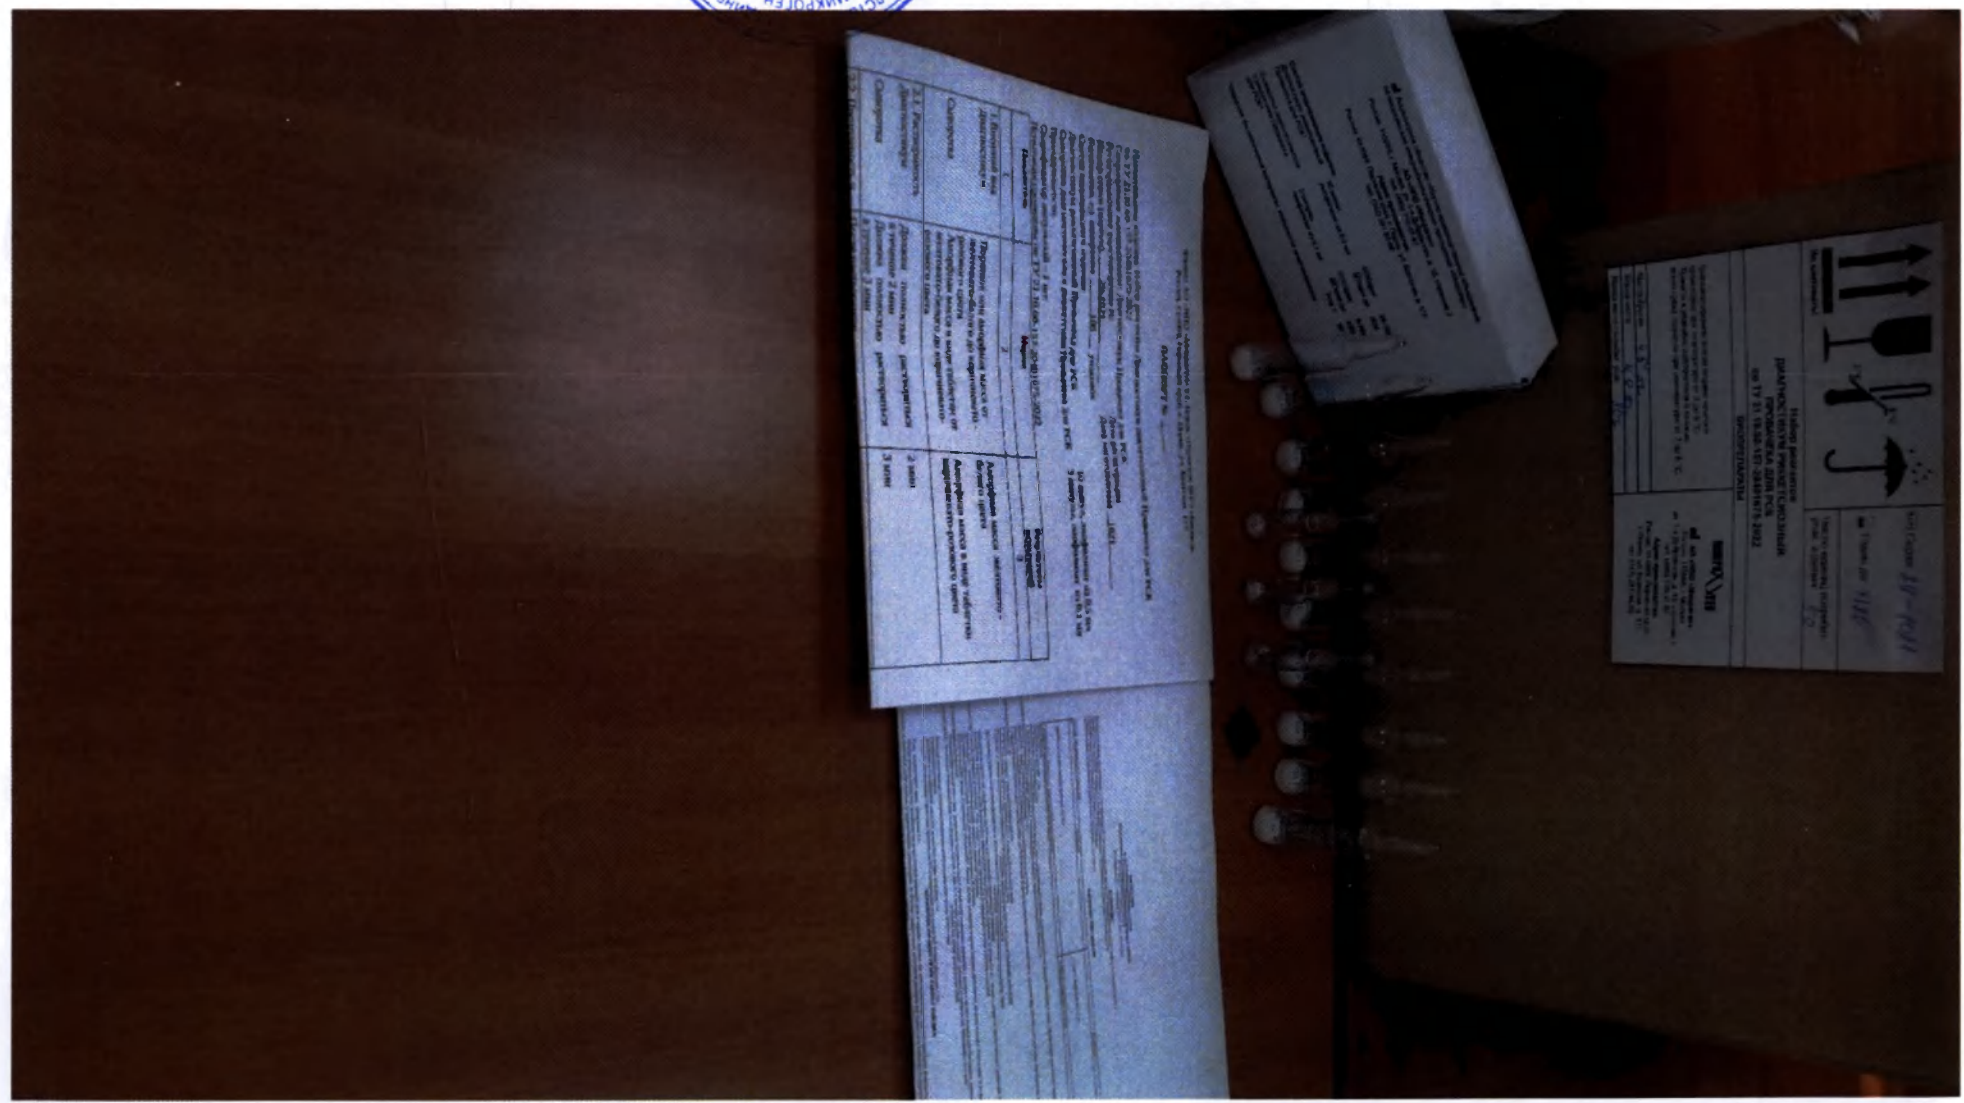

Подлежащее хранению в холодильнике при температуре от +2 до +8 °С.
 Срок годности: 12 месяцев с даты изготовления.
 Дата изготовления: 15.05.2012
 Место изготовления: Россия, г. Москва

Инструкция по применению
 для определения наличия антител к вирусу гепатита С (anti-HCV) в сыворотке крови человека.

Вид теста: Иммуноферментный анализ (ИФА).
 Тип тест-системы: Качественный.

Инструкция по применению
 для определения наличия антител к вирусу гепатита С (anti-HCV) в сыворотке крови человека.

Вид теста: Иммуноферментный анализ (ИФА).
 Тип тест-системы: Качественный.

Параметр	Результат
1. Вид теста	Иммуноферментный анализ (ИФА)
2. Тип тест-системы	Качественный
3. Вид образца	Сыворотка крови
4. Вид контроля	Отрицательный
5. Вид результата	Отрицательный

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
АО НПО МИКРОГЕН
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
ОМ Влощук



Микрогены
Дипломатическая доставка для РСК
Проводимая для РСК
по ТУ 21.14.01-2014

Микрогены
Дипломатическая доставка для РСК
Проводимая для РСК
по ТУ 21.14.01-2014

Микрогены
Дипломатическая доставка для РСК
Проводимая для РСК
по ТУ 21.14.01-2014

Микрогены
Дипломатическая доставка для РСК
Проводимая для РСК
по ТУ 21.14.01-2014

Микрогены
Дипломатическая доставка для РСК
Проводимая для РСК
по ТУ 21.14.01-2014

Микрогены
Дипломатическая доставка для РСК
Проводимая для РСК
по ТУ 21.14.01-2014

Микрогены
Дипломатическая доставка для РСК
Проводимая для РСК
по ТУ 21.14.01-2014

Микрогены
Дипломатическая доставка для РСК
Проводимая для РСК
по ТУ 21.14.01-2014

Микрогены
Дипломатическая доставка для РСК
Проводимая для РСК
по ТУ 21.14.01-2014

Микрогены
Дипломатическая доставка для РСК
Проводимая для РСК
по ТУ 21.14.01-2014

Микрогены
Дипломатическая доставка для РСК
Проводимая для РСК
по ТУ 21.14.01-2014

Микрогены
Дипломатическая доставка для РСК
Проводимая для РСК
по ТУ 21.14.01-2014