

УТВЕРЖДАЮ
Главный специалист-эксперт
по направлению МИБП
Управления по регистрации
АО «НПО «Микроген»
по доверенности



О.М. Волощук

20__ г.

**Набор реагентов
«Антиген кардиолипидный для реакции микропреципитации (РМП)
раствор для диагностических целей»
по ТУ 21.20.23-180-20481675-2022**

1. Маркировка внутренней упаковки:

ампулы

МИКРОГЕН
АНТИГЕН
КАРДИОЛИПИДНЫЙ
для РМП
2 мл
с
годен до

флакона

МИКРОГЕН
АНТИГЕН
КАРДИОЛИПИДНЫЙ
для РМП
ХОЛИН-ХЛОРИД 70%
5 мл
с
годен до

**Набор реагентов
«Антиген кардиолипидный для реакции микропреципитации (РМП)
раствор для диагностических целей»
по ТУ 21.20.23-160-20401675-2022**

УТВЕРЖДАЮ
Главный специалист-эксперт
по направлению МИБП
Управления по регистрации
АО «НПО «Микроген»
по доверенности

О.М. Волощук

20 22 г.

2. Маркировка внешней упаковки (пачки):

Размер пачки: 115x25x70 мм



**Набор реагентов
«Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации (РМП)
раствор для диагностических целей»
по ТУ 21.20.23-160-20401675-2022**

3. Маркировка транспортной тары:

Размер этикетки: 148x115 мм

УТВЕРЖДАЮ
Главный специалист-эксперт
по направлению МИБП
Управления по регистрации
АО «НПО «Микроген»
по доверенности



О.М. Волощук

20 14.

Не кантовать!	LOT Серия: Годен до:
Число единиц потребит. упак. изделия:	
Набор реагентов АНТИГЕН КАРДИОЛИПИНОВЫЙ ДЛЯ РЕАКЦИИ МИКРОПРЕЦИПИТАЦИИ (РМП) РАСТВОР ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ по ТУ 21.20.23-160-20401675-2022	
БИОПРЕПАРАТЫ	
Транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре от 10 до 25 °С. Замораживание не допускается. Хранить в упаковке изготовителя в течение всего срока годности при температуре от 10 до 25 °С. Замораживание не допускается.	МИКРОГЕН АО «НПО «Микроген» Россия, 115088, г. Москва, 1-я Дубровская ул., д. 18, строение 2 тел. (495) 710-37-87 Адрес производства: Россия, 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Братская, д. 177 тел. (342) 281-84-86
Масса брутто	
Масса нетто	
Масса нетто потребит. упак.	

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью


3 листа(ов)

Руби
КОПИЯ ВЕРНА

**ПЕЧАТЬ
АО НПО МИРОГЕН
ПО ДОВЕРЕННОСТИ**




Не кантовать!	Lot Серия: <u>220-0322</u> Годен до: <u>1123</u> Число единиц потребит. упак. изделия: <u>90</u>
Набор реагентов АНТИГЕН КАРДИОЛИПИНОВЫЙ ДЛЯ РЕАКЦИИ МИКРОПРЕЦИПИТАЦИИ (РМП) РАСТВОР ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ по ТУ 21.20.23-160-20401675-2022	
БИОПРЕПАРАТЫ	
Транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре от 10 до 25 °С. Замораживание не допускается. Хранить в упаковке изотермическая в течение всего срока годности при температуре от 10 до 25 °С. Замораживание не допускается.	
Масса брутто <u>74.02</u> Масса нетто <u>72.91</u> Масса нетто потребит. упак. <u>902</u>	МИКРОХГЕН АО «НПО «Микроген» Россия, 115088, г. Москва, 1-я Дубровская ул., д. 15, строение 2 тел. (495) 710-37-07 Адрес производства: Россия, 614009, Пермский край, с. Пермь, ул. Братская, д. 177 тел. (342) 261-04-06

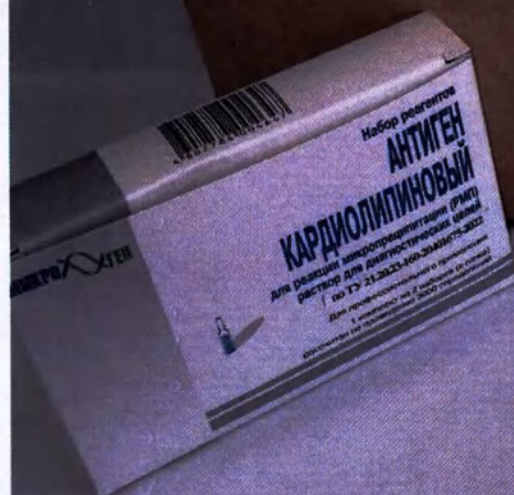

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
АО НПО МИКРОГЕН
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
О. В. ВОЛОЩУК



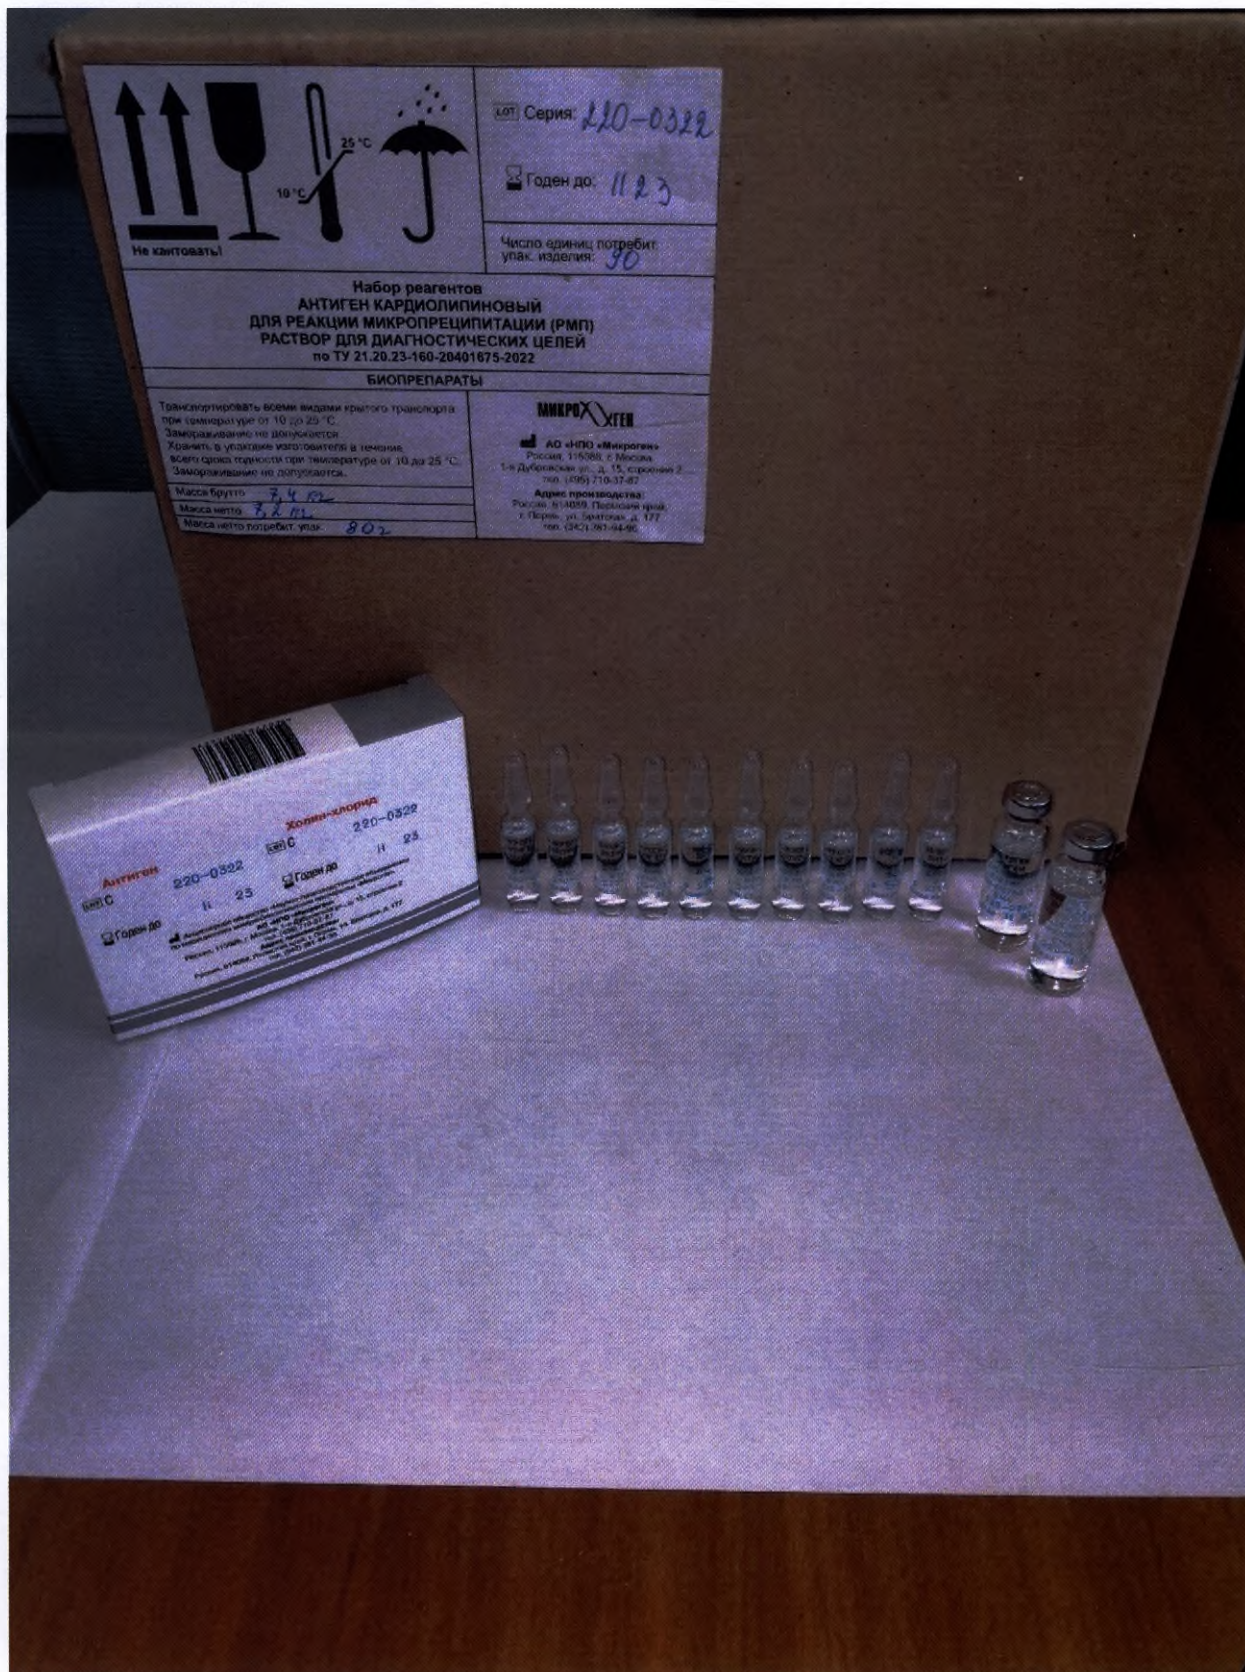

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
 АО НПО МИКРОГЕН
 ПО ДОВЕРЕННОСТИ
 ОМ ВОПОЩУК

