

PHILIPS

Руководитель по нормативному
регулированию ООО "ФИЛИПС"




Горкуша Д.В.


2022» декабря 2022г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

«Система рентгеновская диагностическая цифровая DuraDiagnost F30 с принадлежностями».

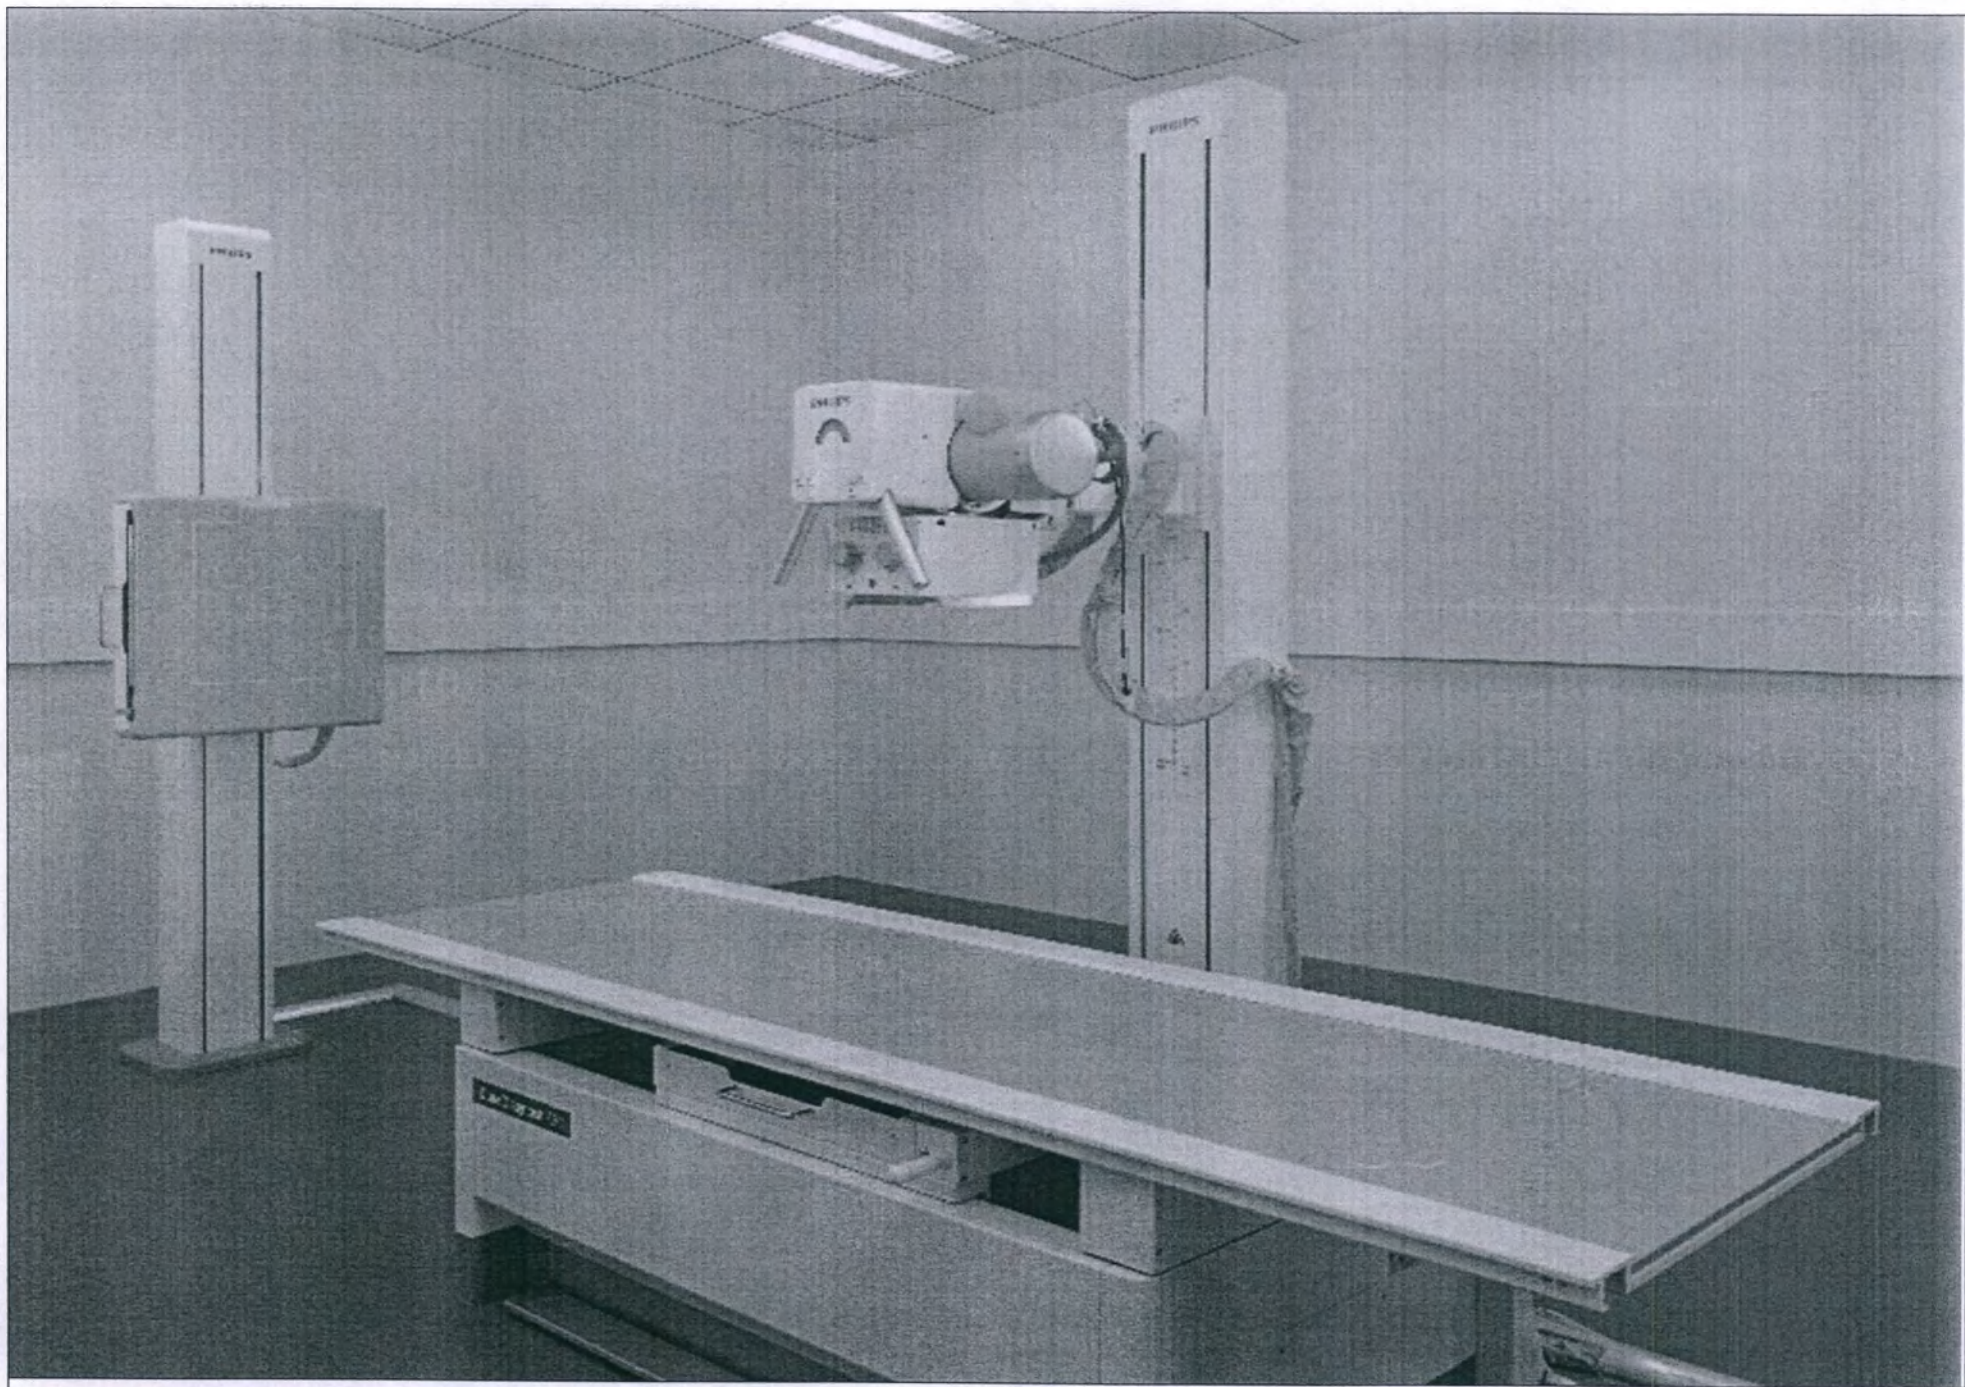


Фотография общего вида медицинского изделия.

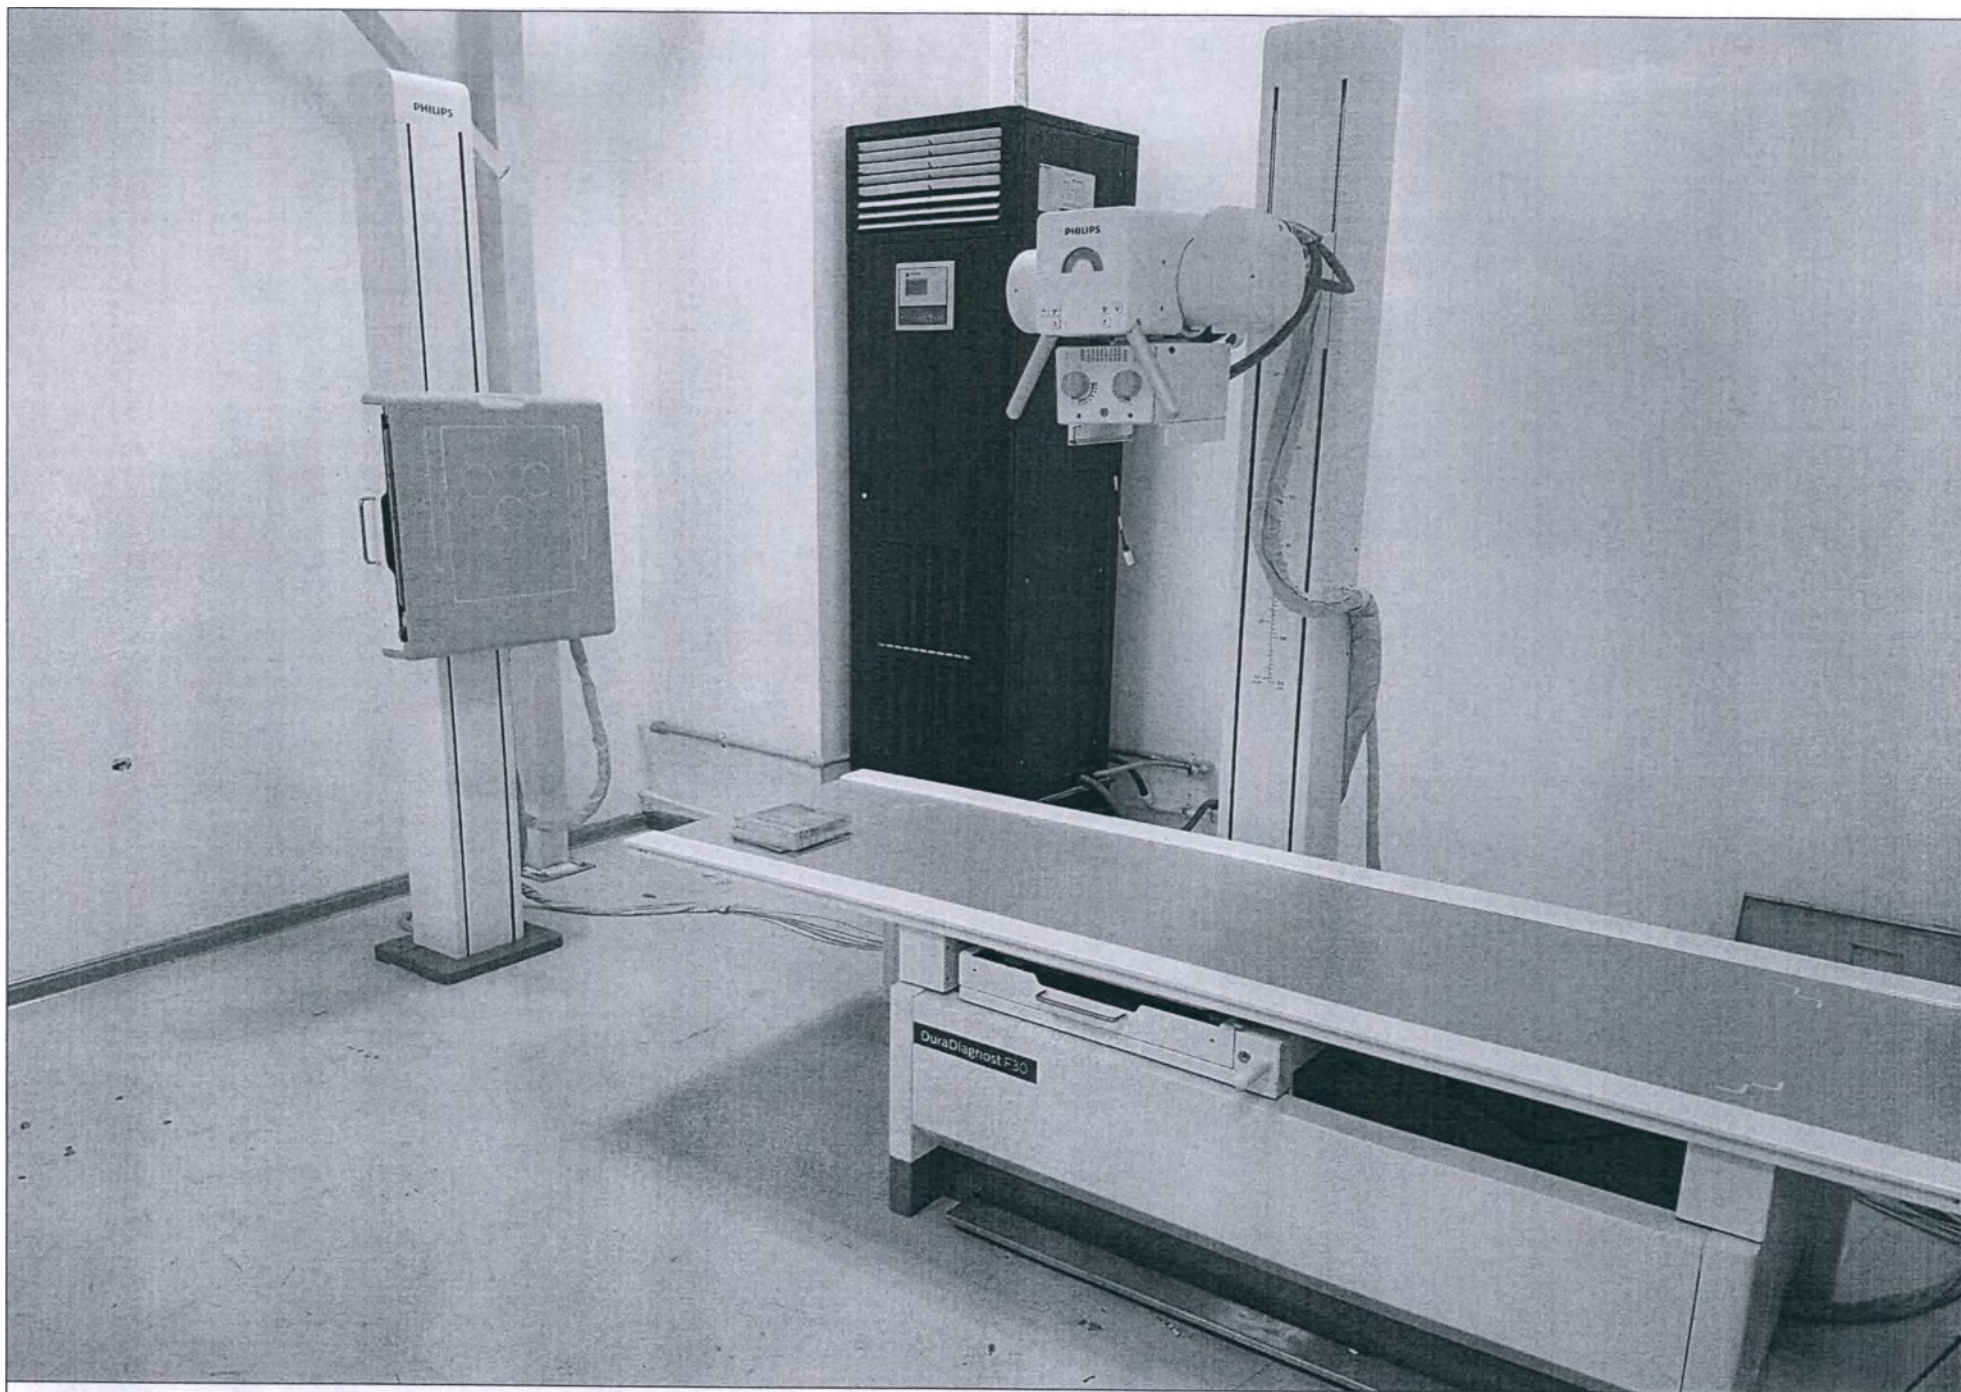

Фотография общего вида медицинского изделия.


Состав

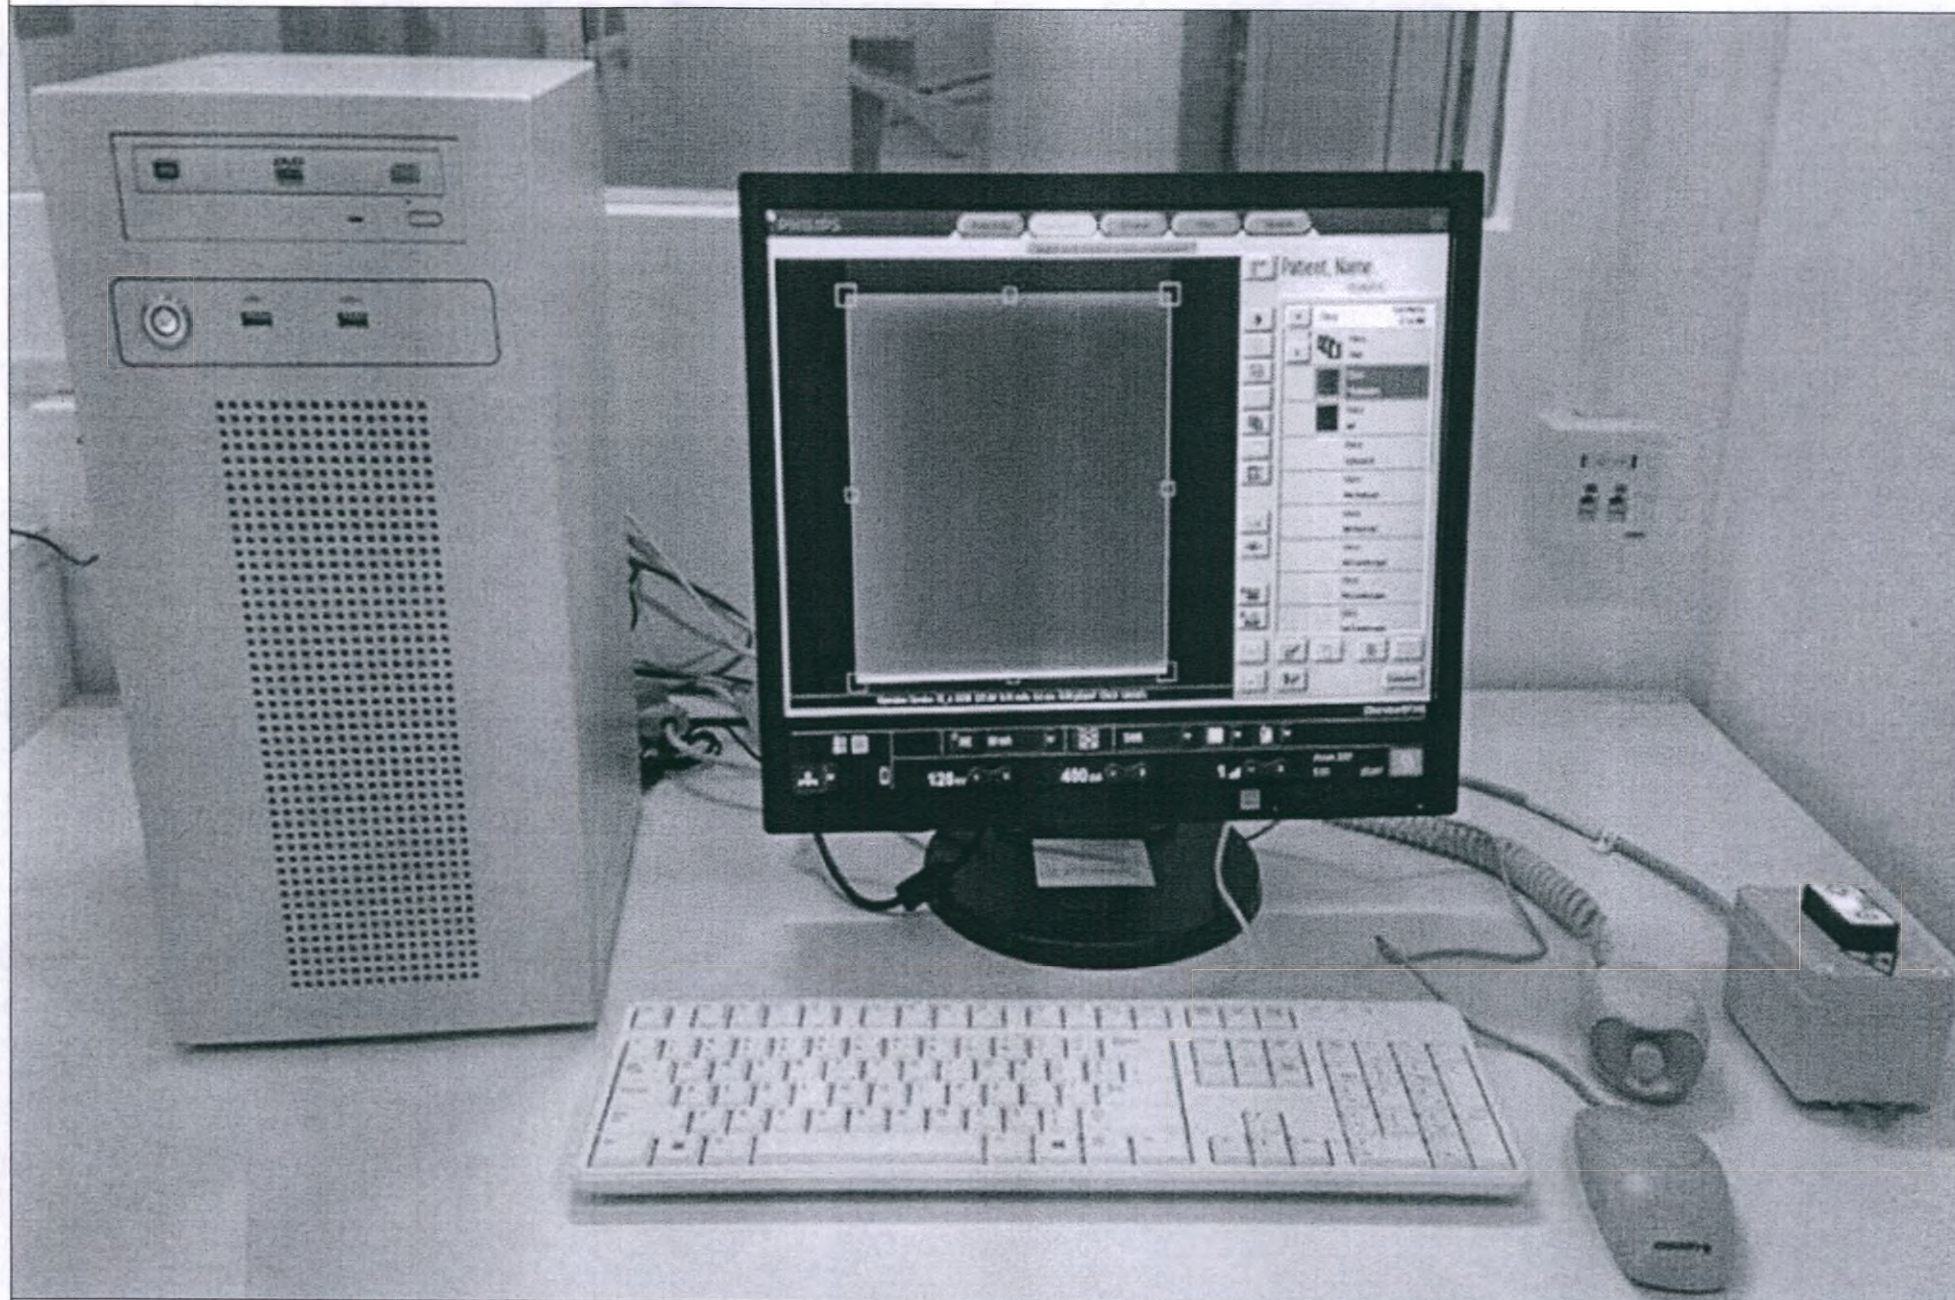


1а. Рабочая станция в Eleva Workspot составе: 1.1. Системный блок с предустановленным программным обеспечением; 1.2. Монитор; 1.3. Клавиатура; 1.4. Мышь. – Общий вид




16. Рабочая станция в составе Eleva Workspot: 1.1. Системный блок с предустановленным программным обеспечением;

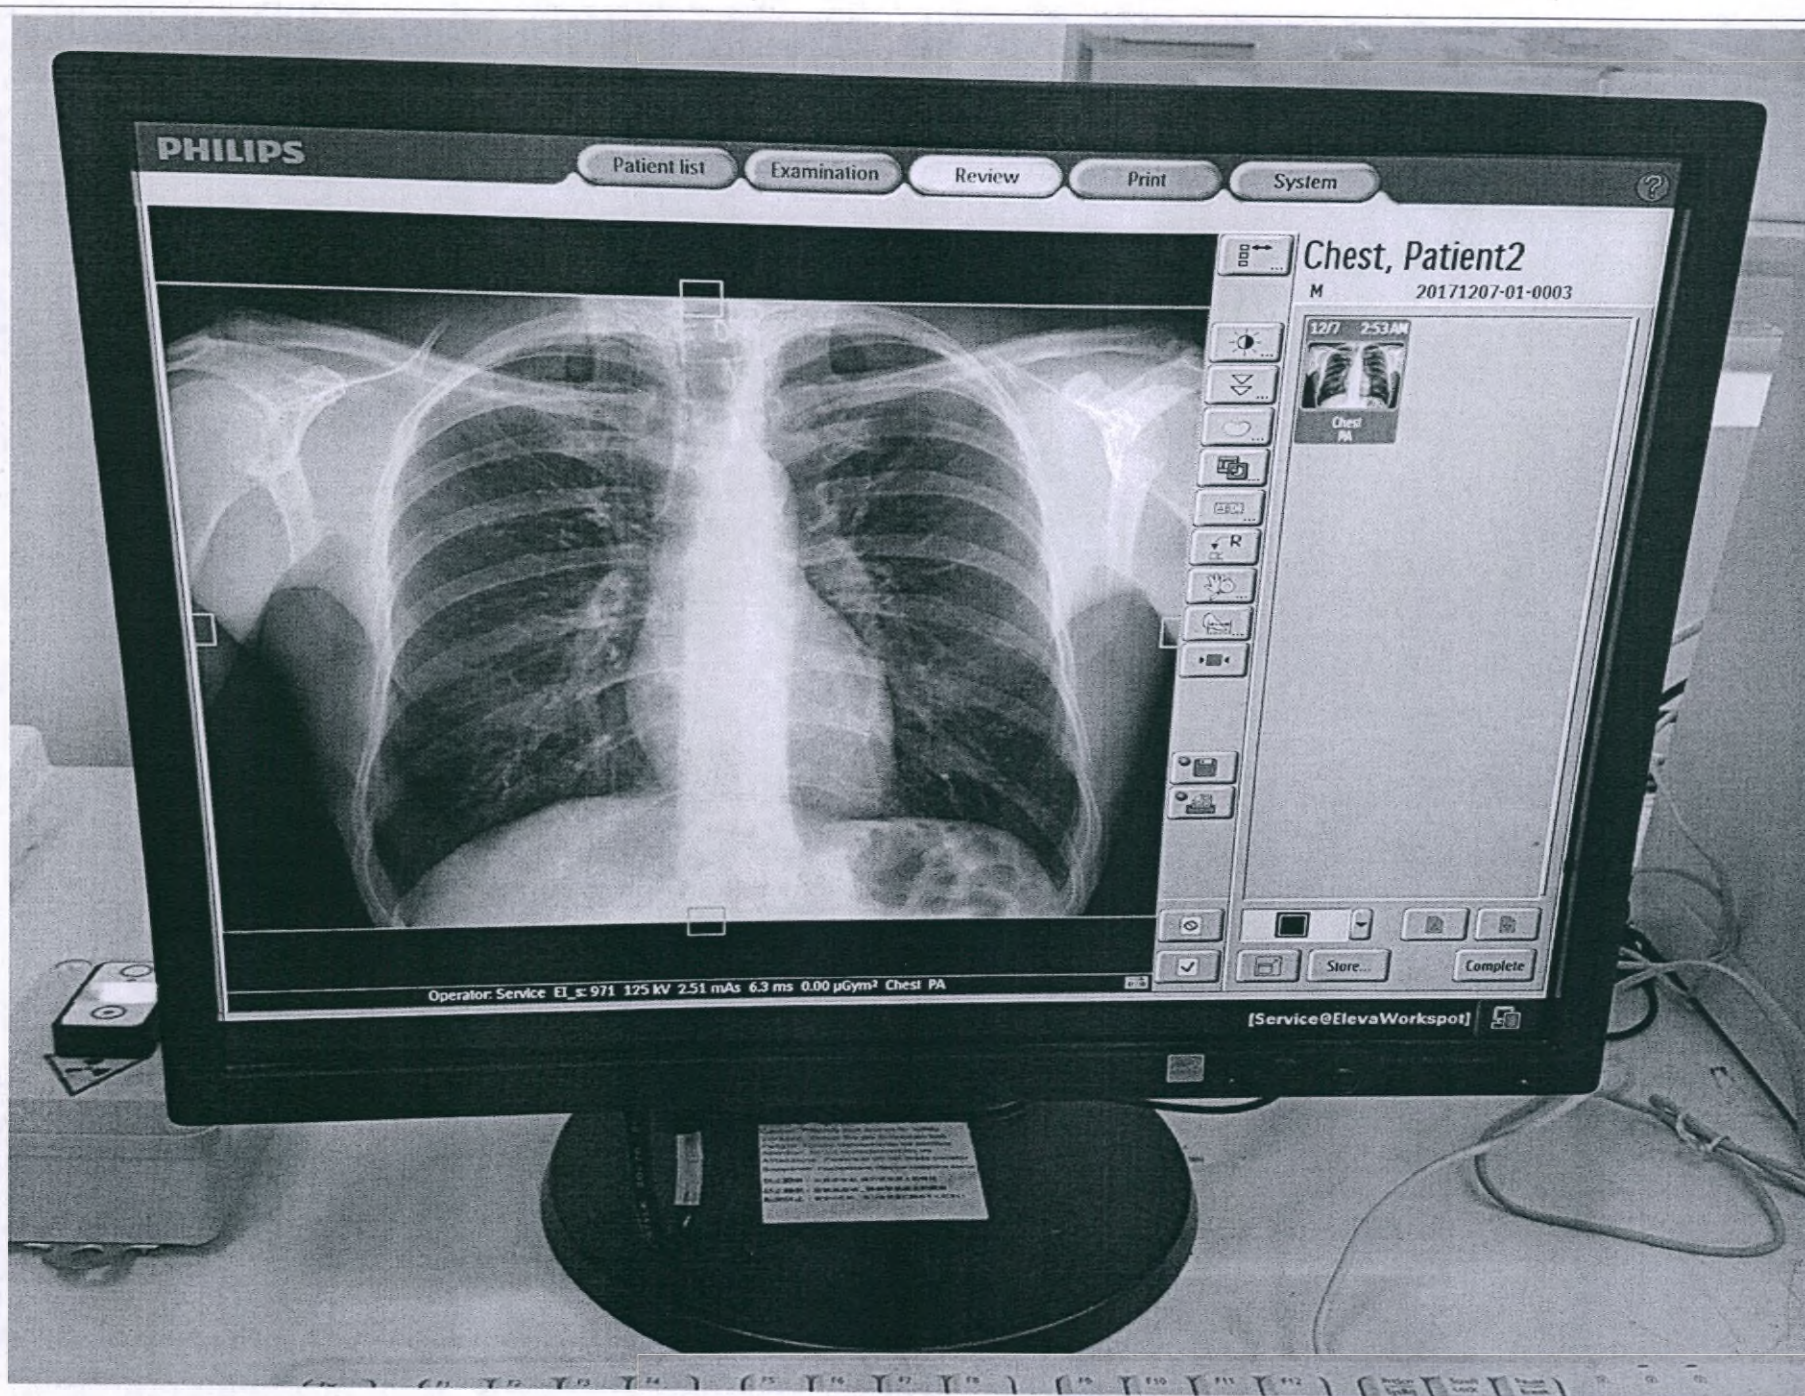


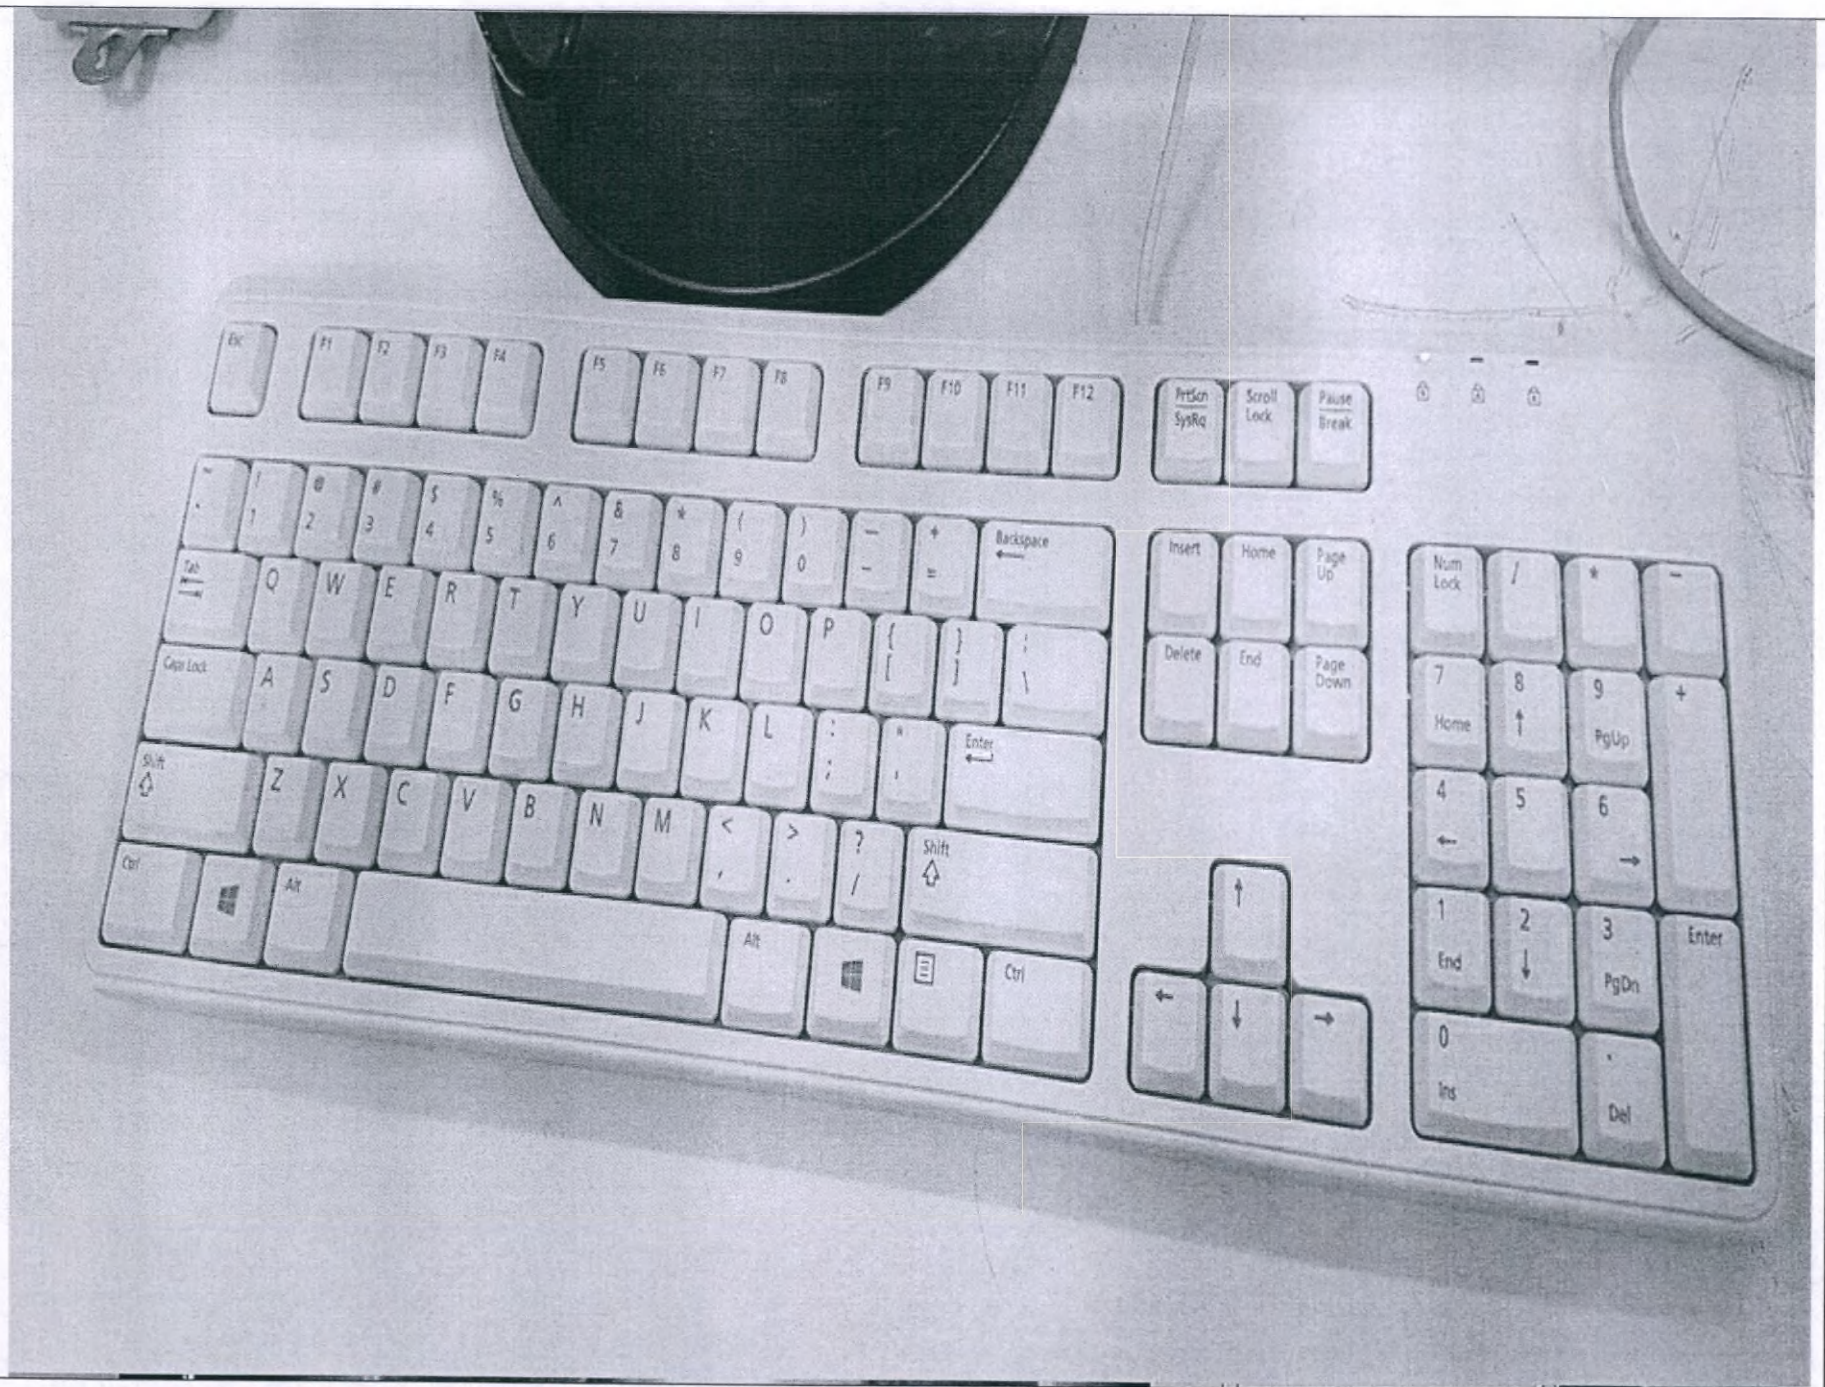


1г. Рабочая станция в составе Eleva Workspot: 1.3. Клавиатура;

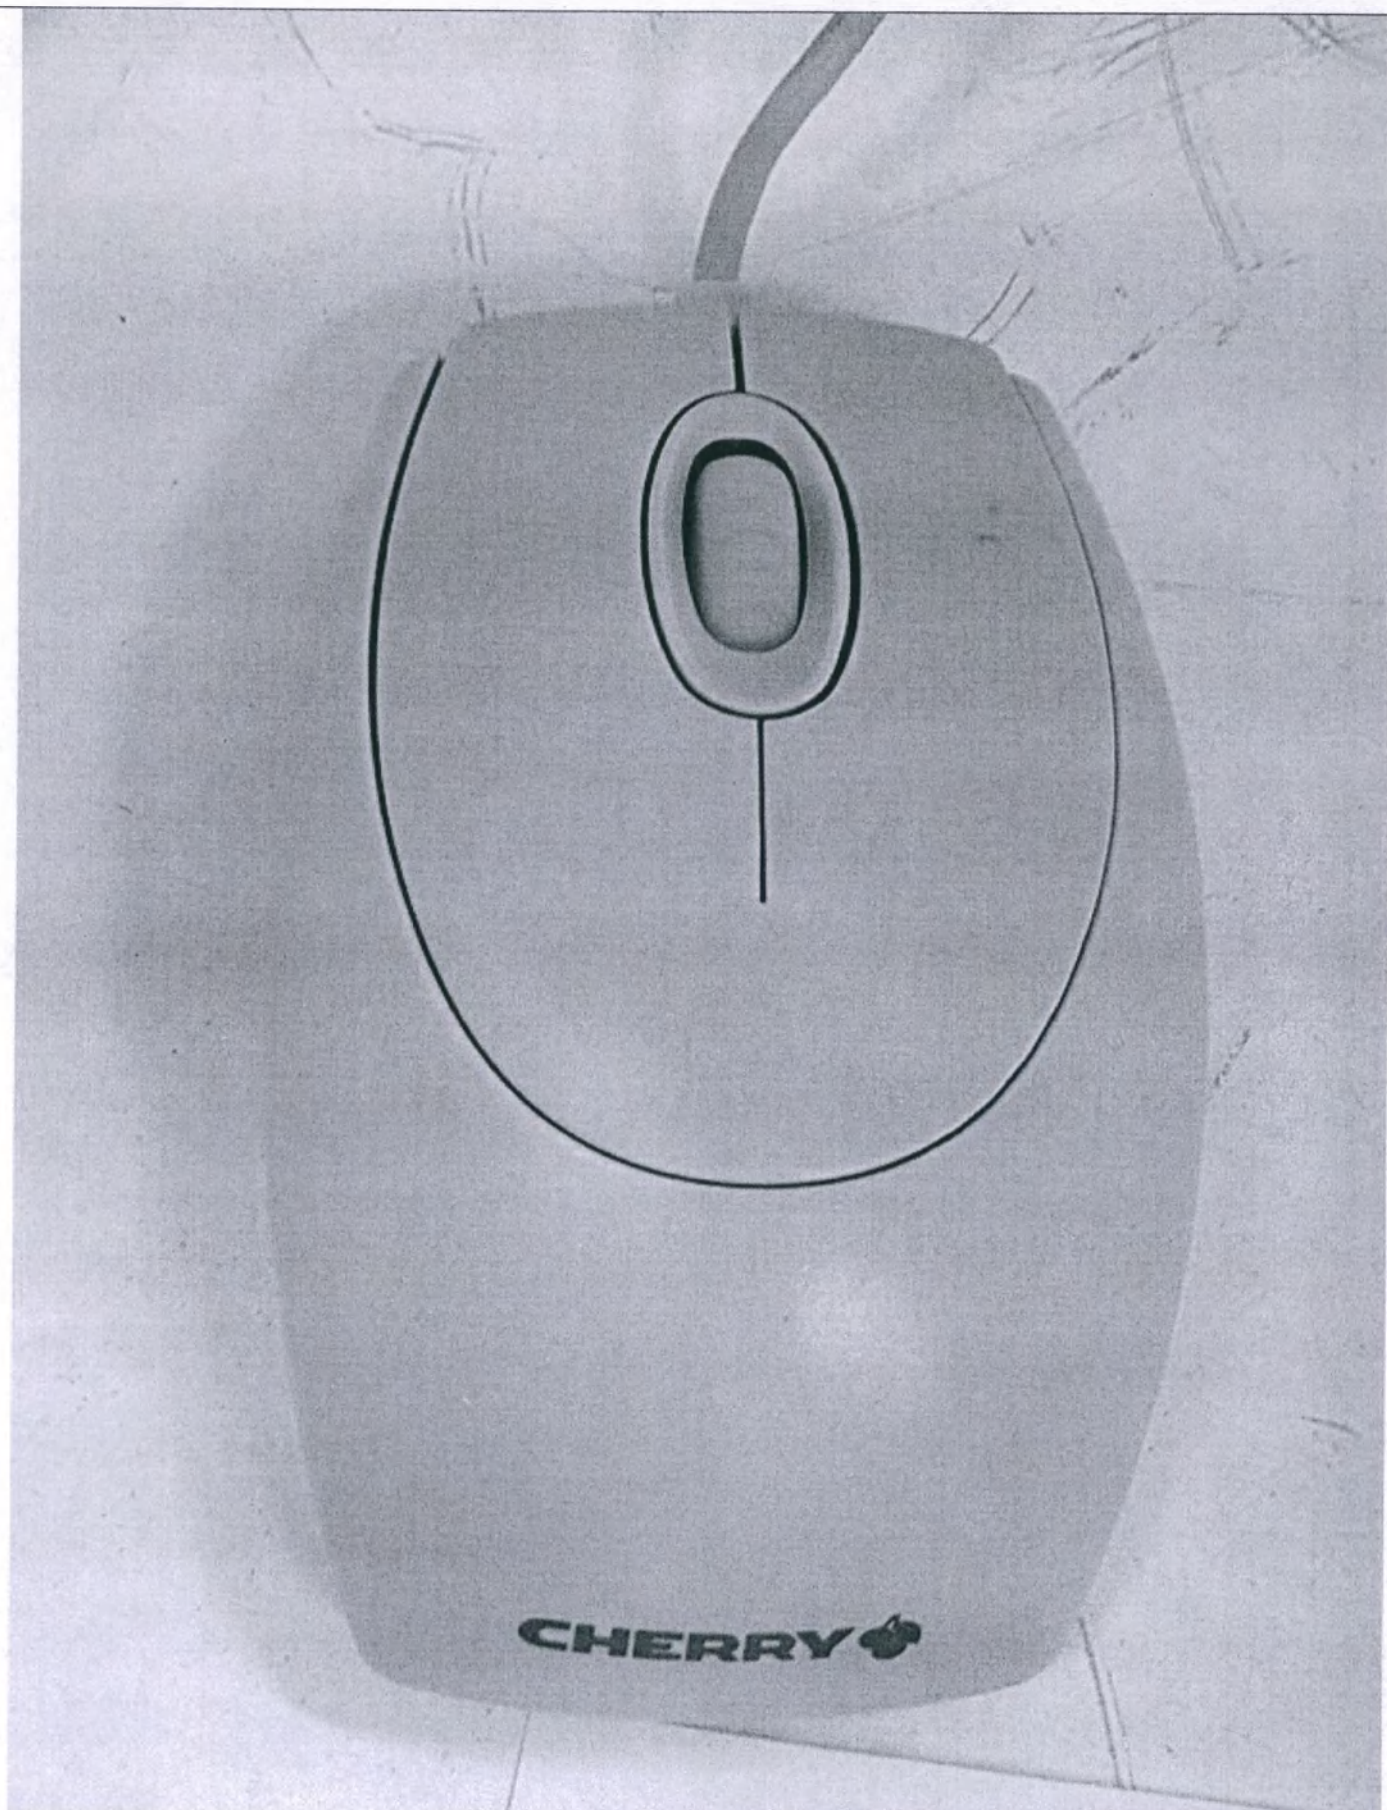


1д. Рабочая станция в составе Eleva Workspot: 1.4. Мышь.

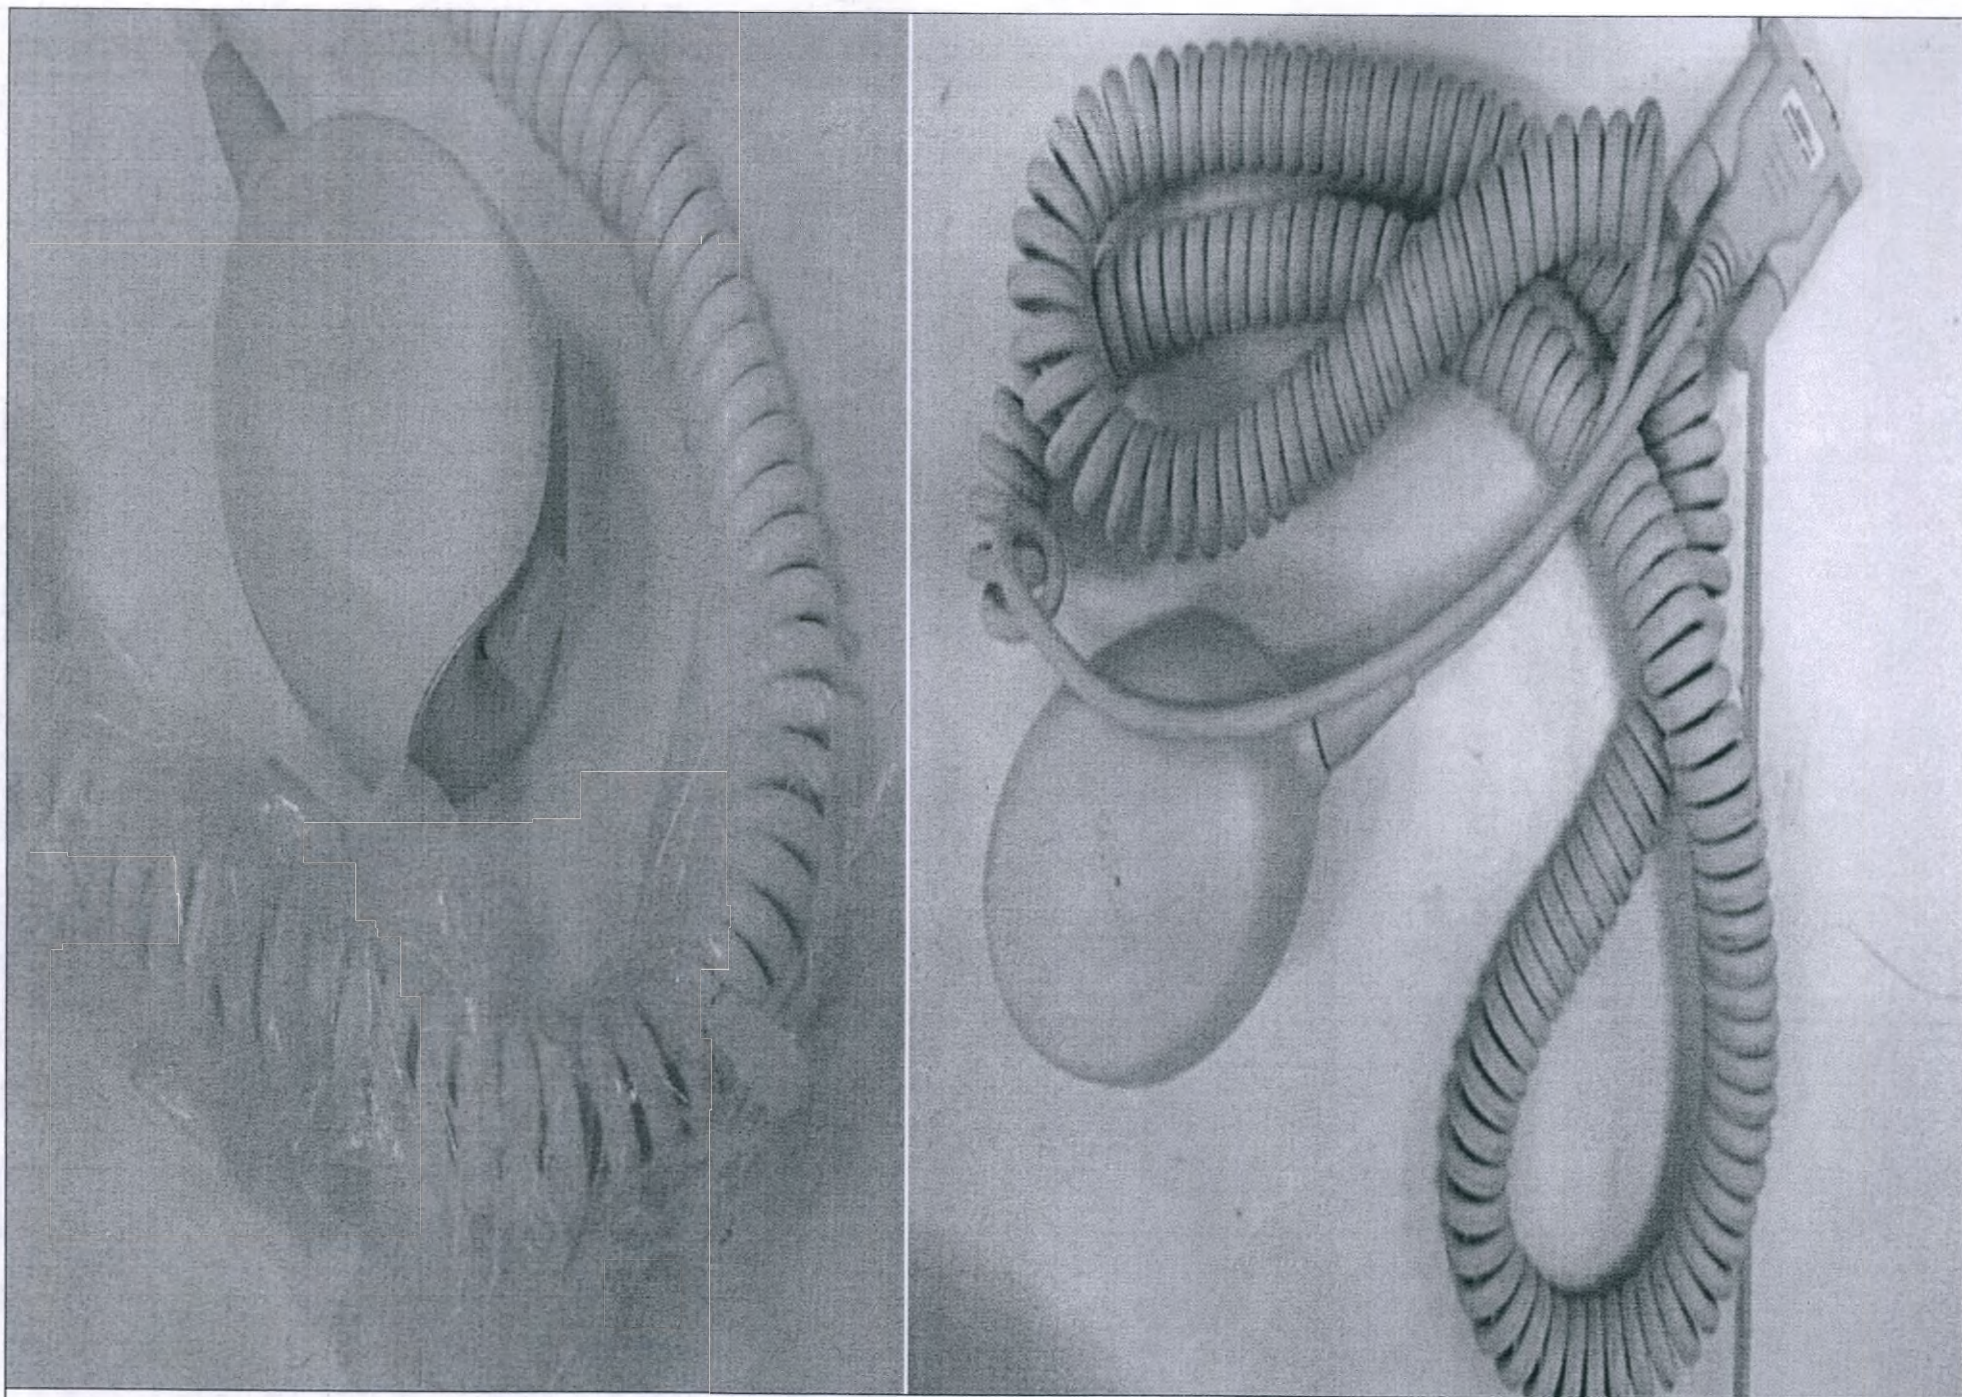


2. Выключатель экспозиции ручной.

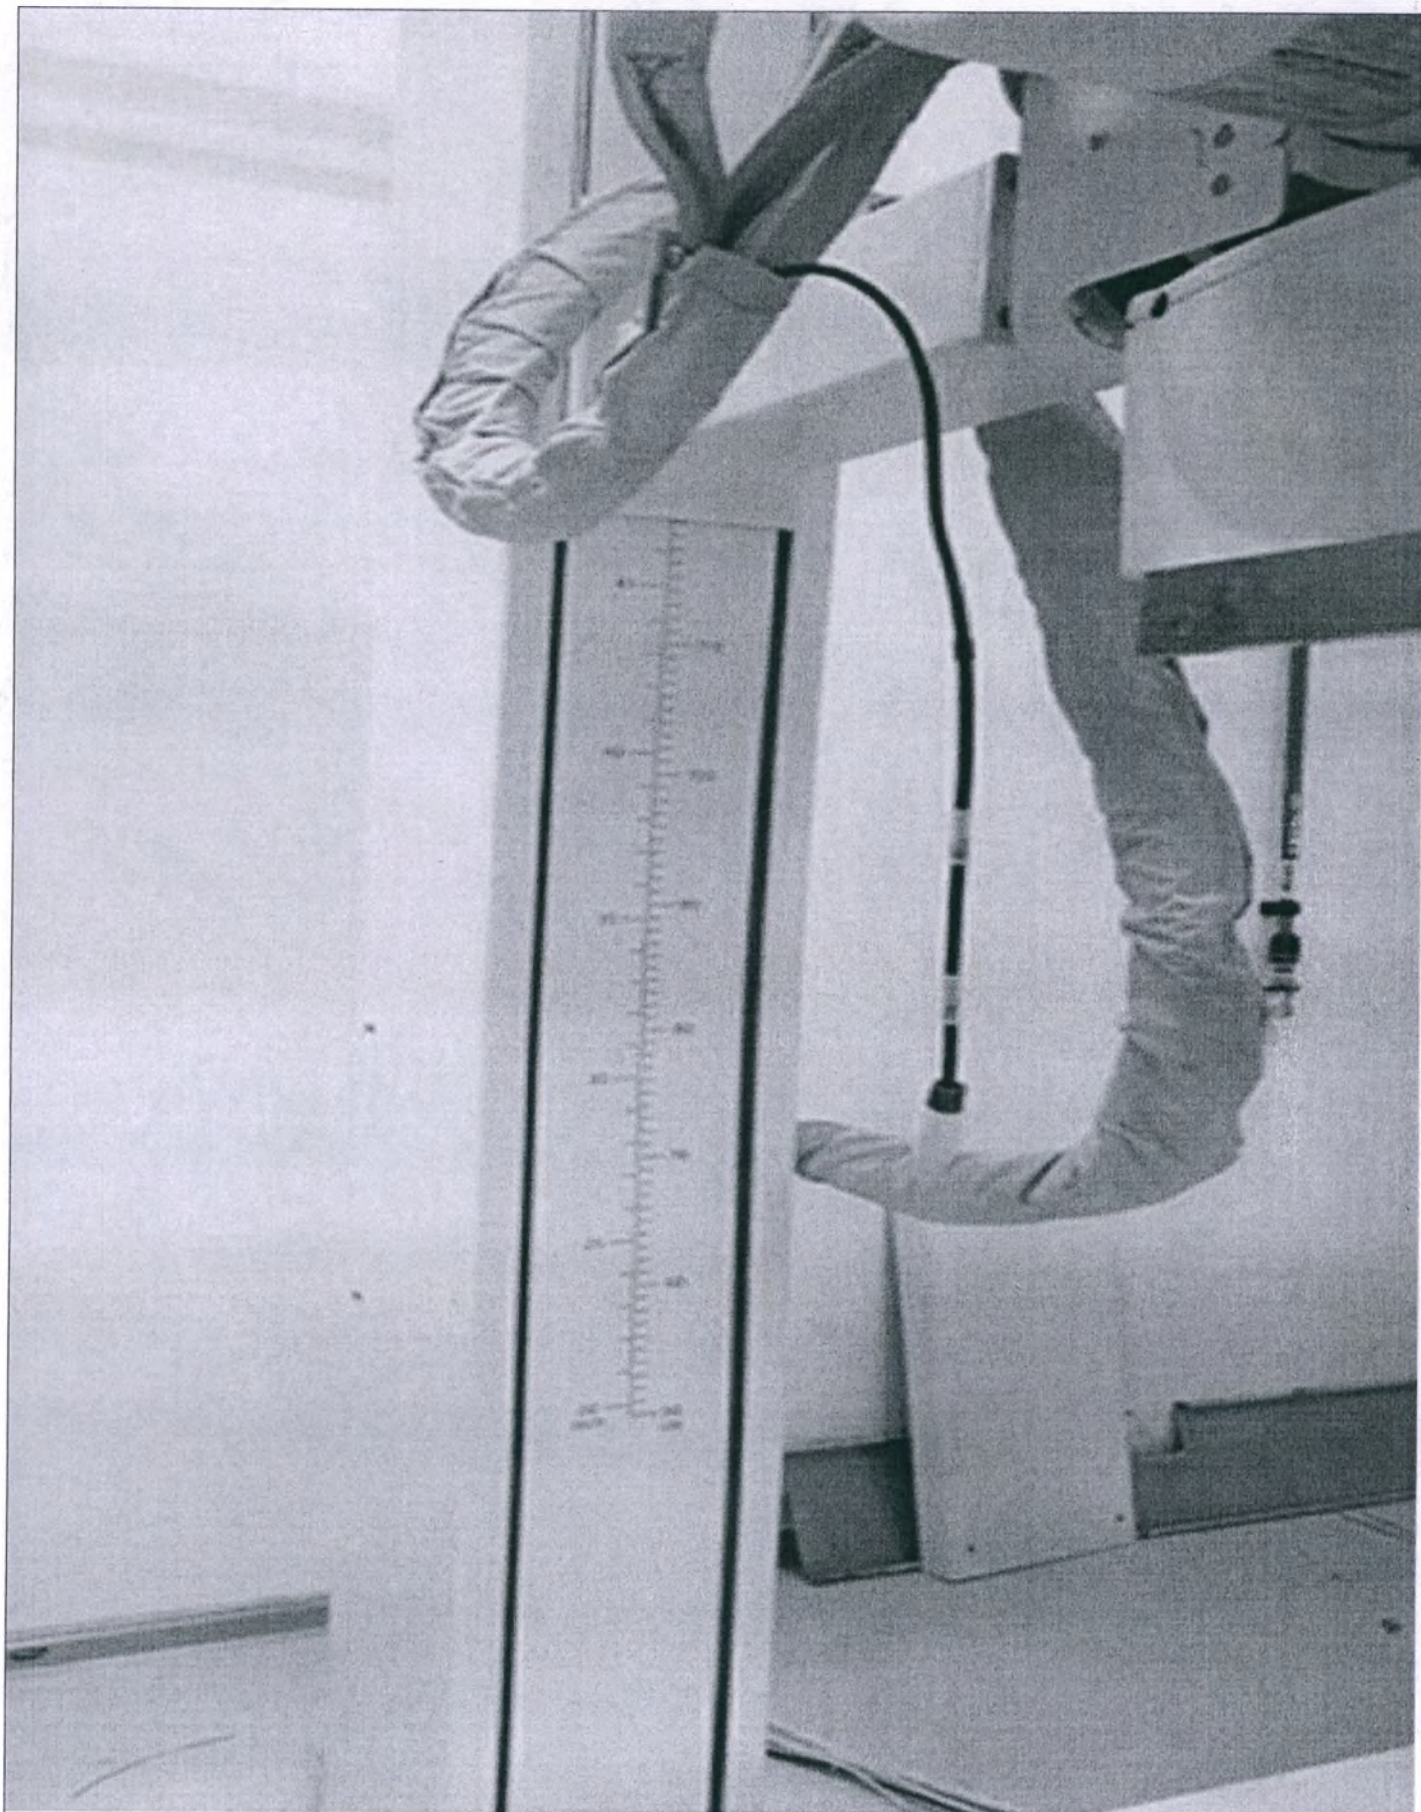


За. Стойка трубки: 3.1.а. Колонна стойки трубки;

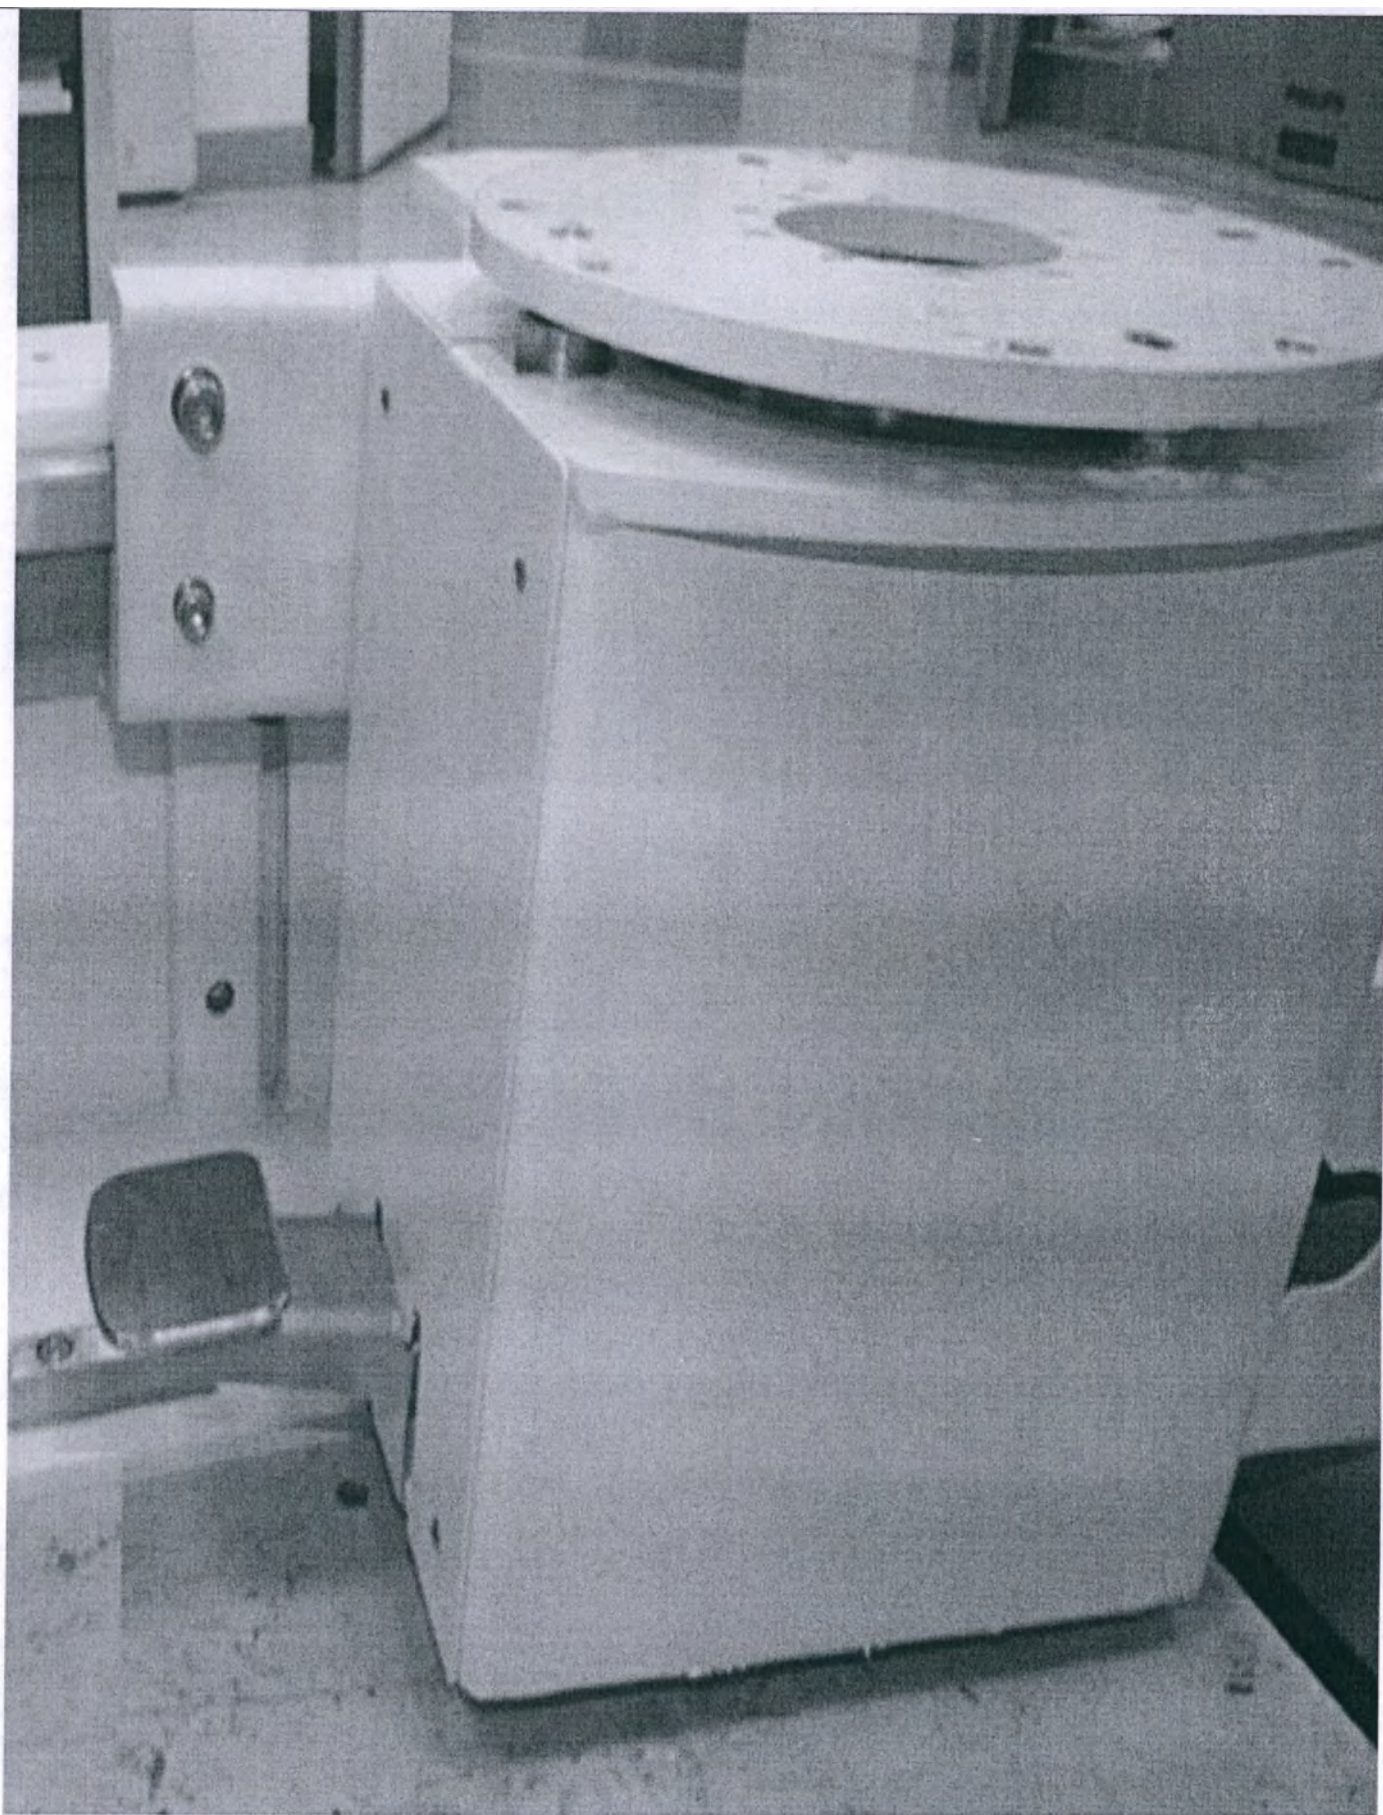


3б. Стойка трубки: 3.1.б. Основа колонны;

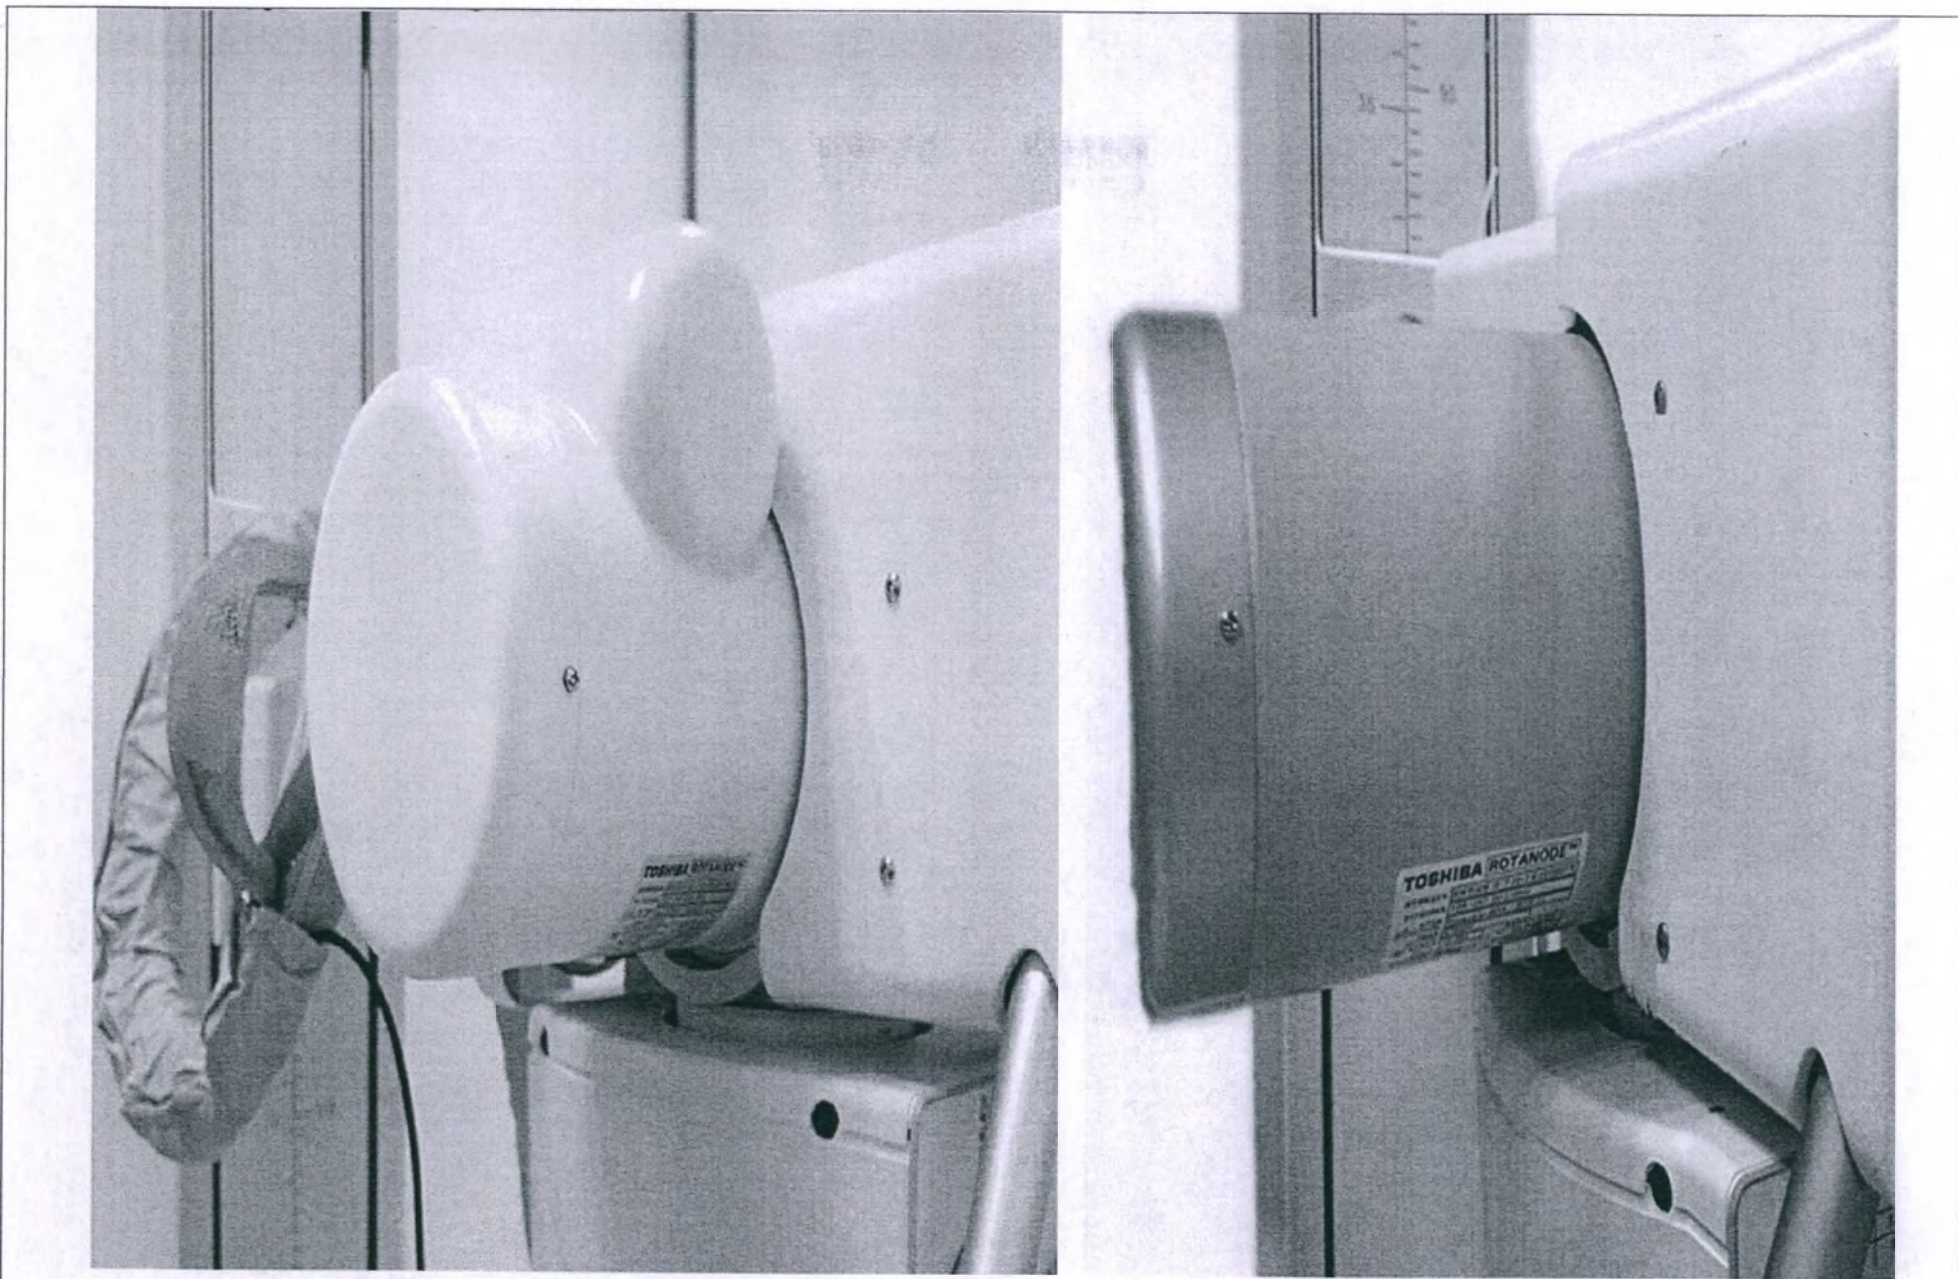


3в. Стойка трубки: 3.2. Блок рентгеновской трубки.

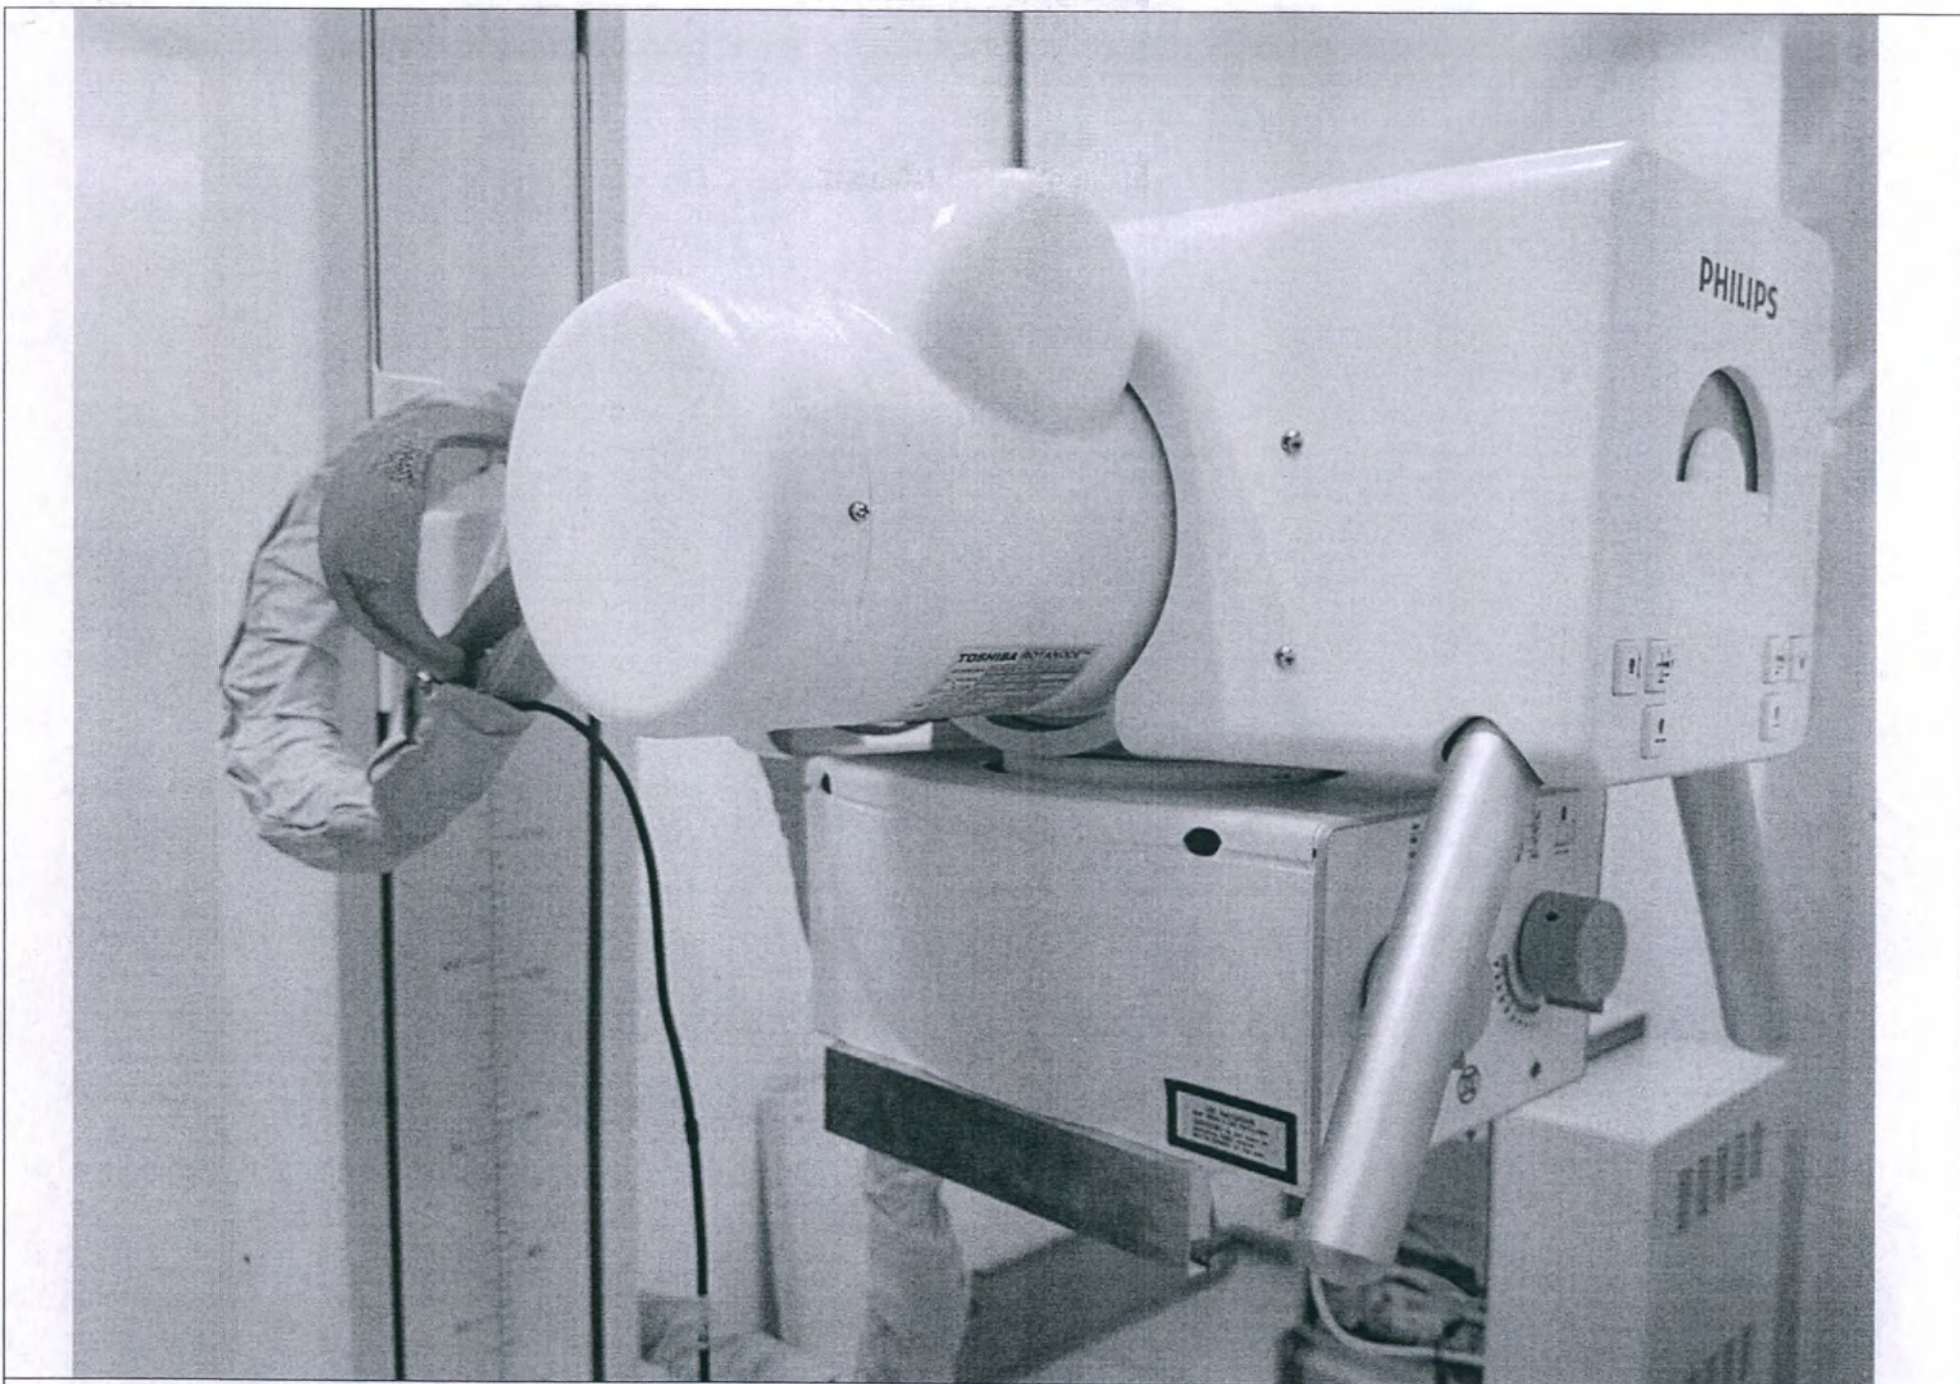


3д. Стойка трубки: 3.3. Коллиматор.

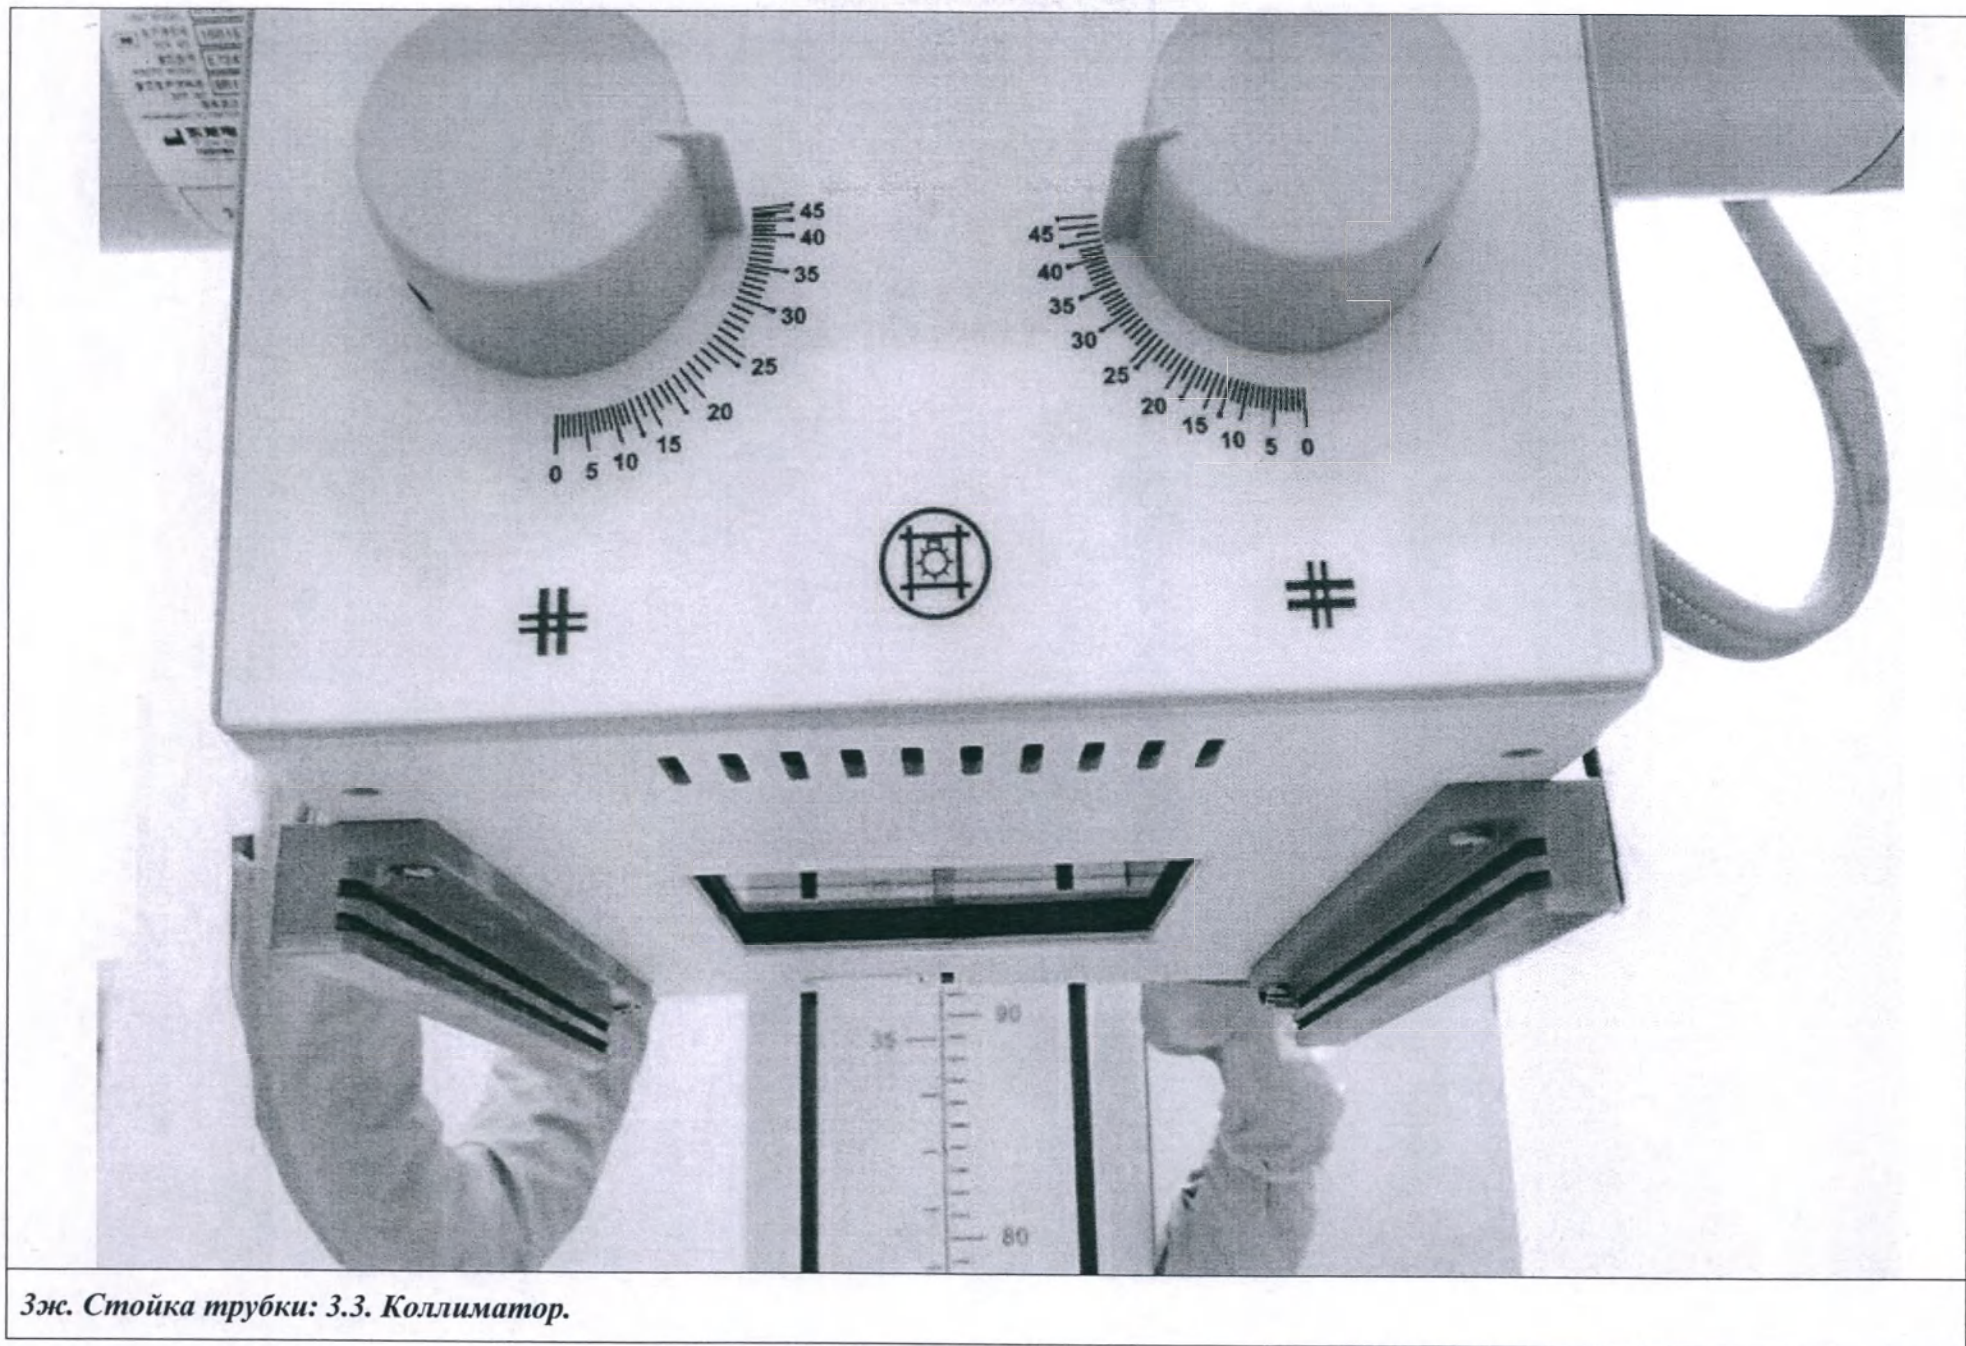


Зж. Стойка трубки: 3.3. Коллиматор.

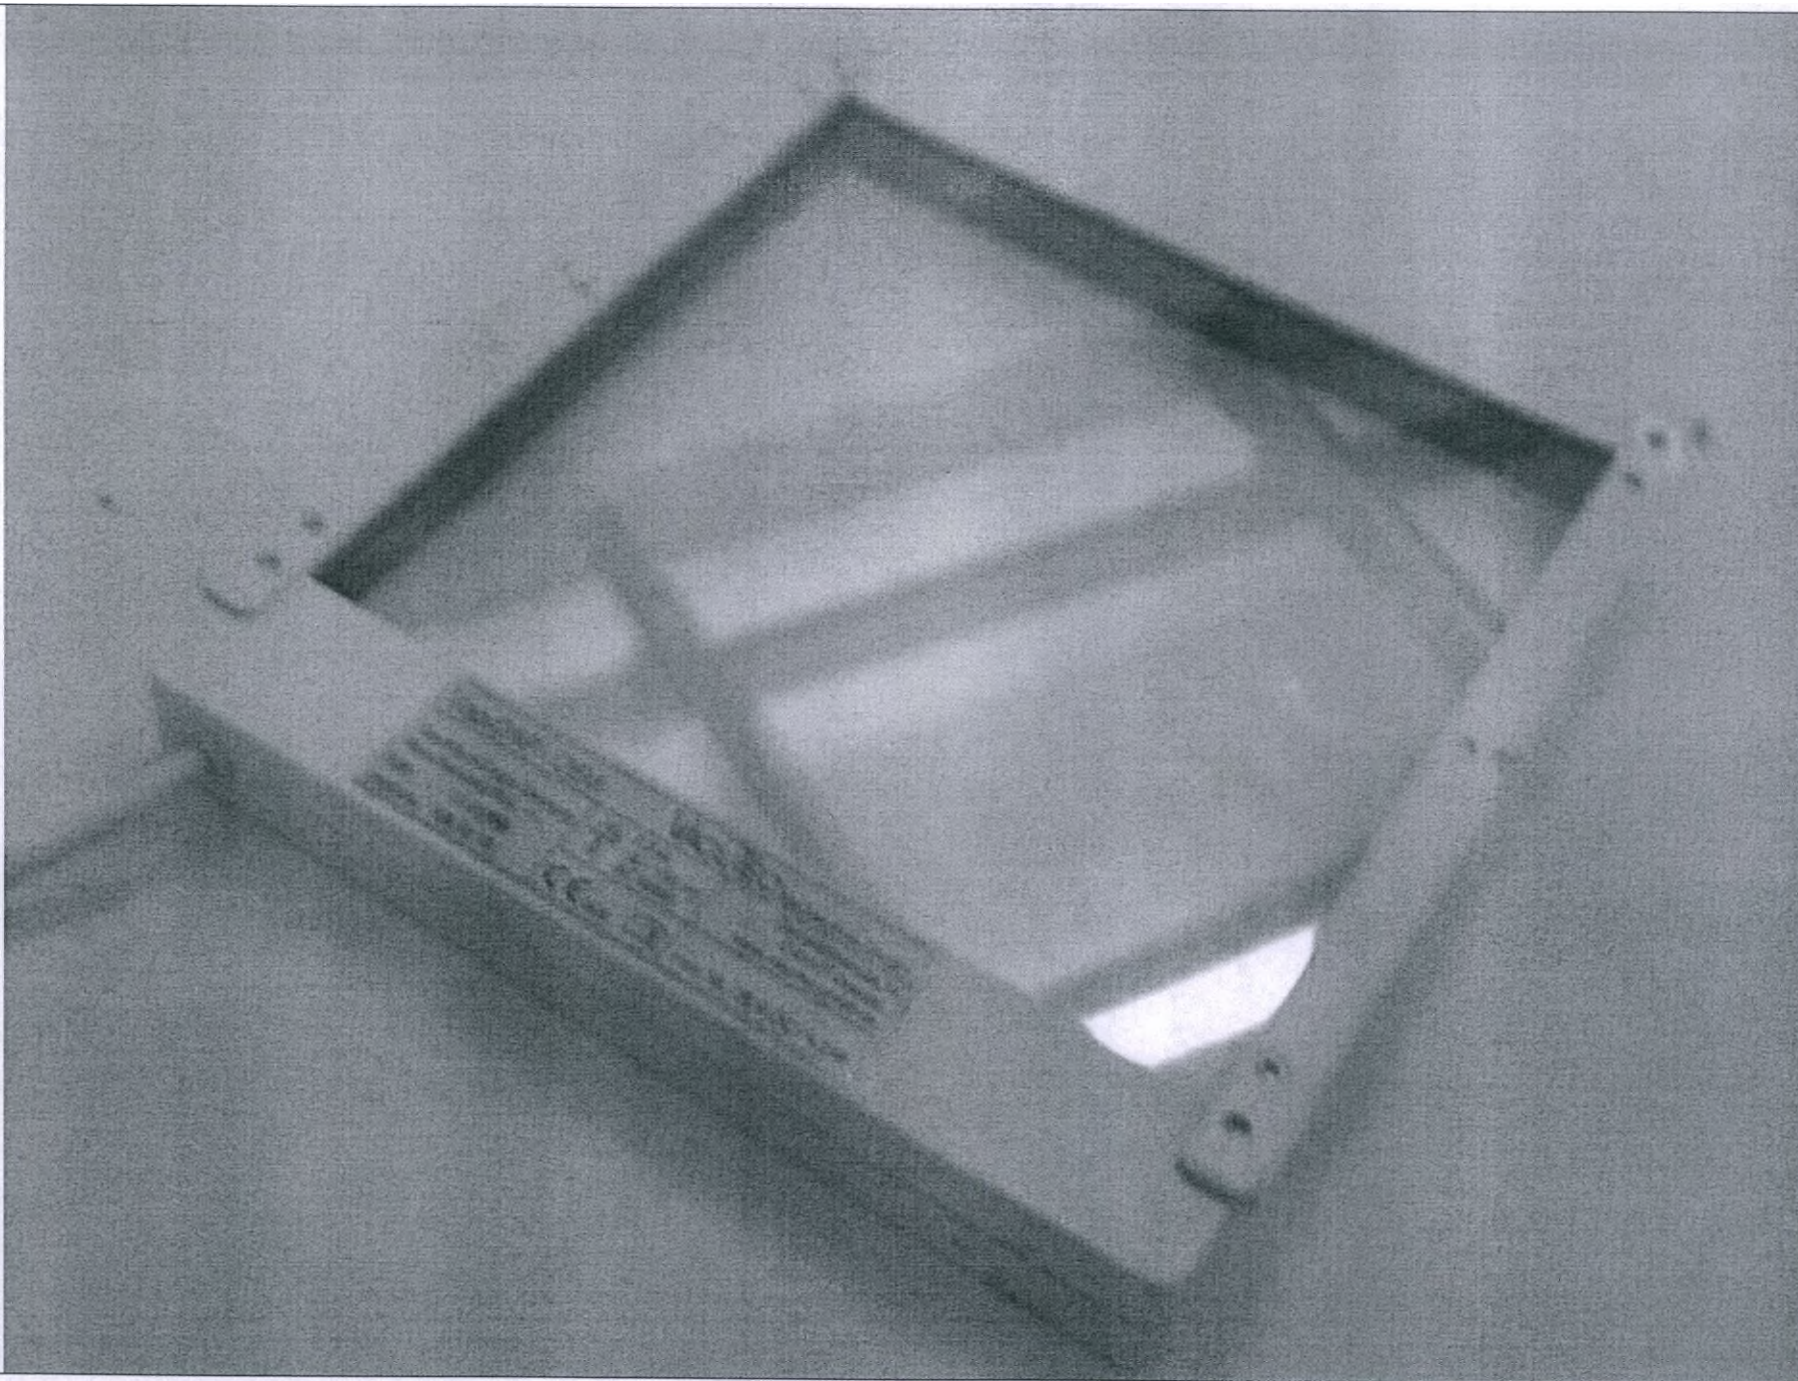


3з. Стойка трубки: 3.4. Дозиметр.

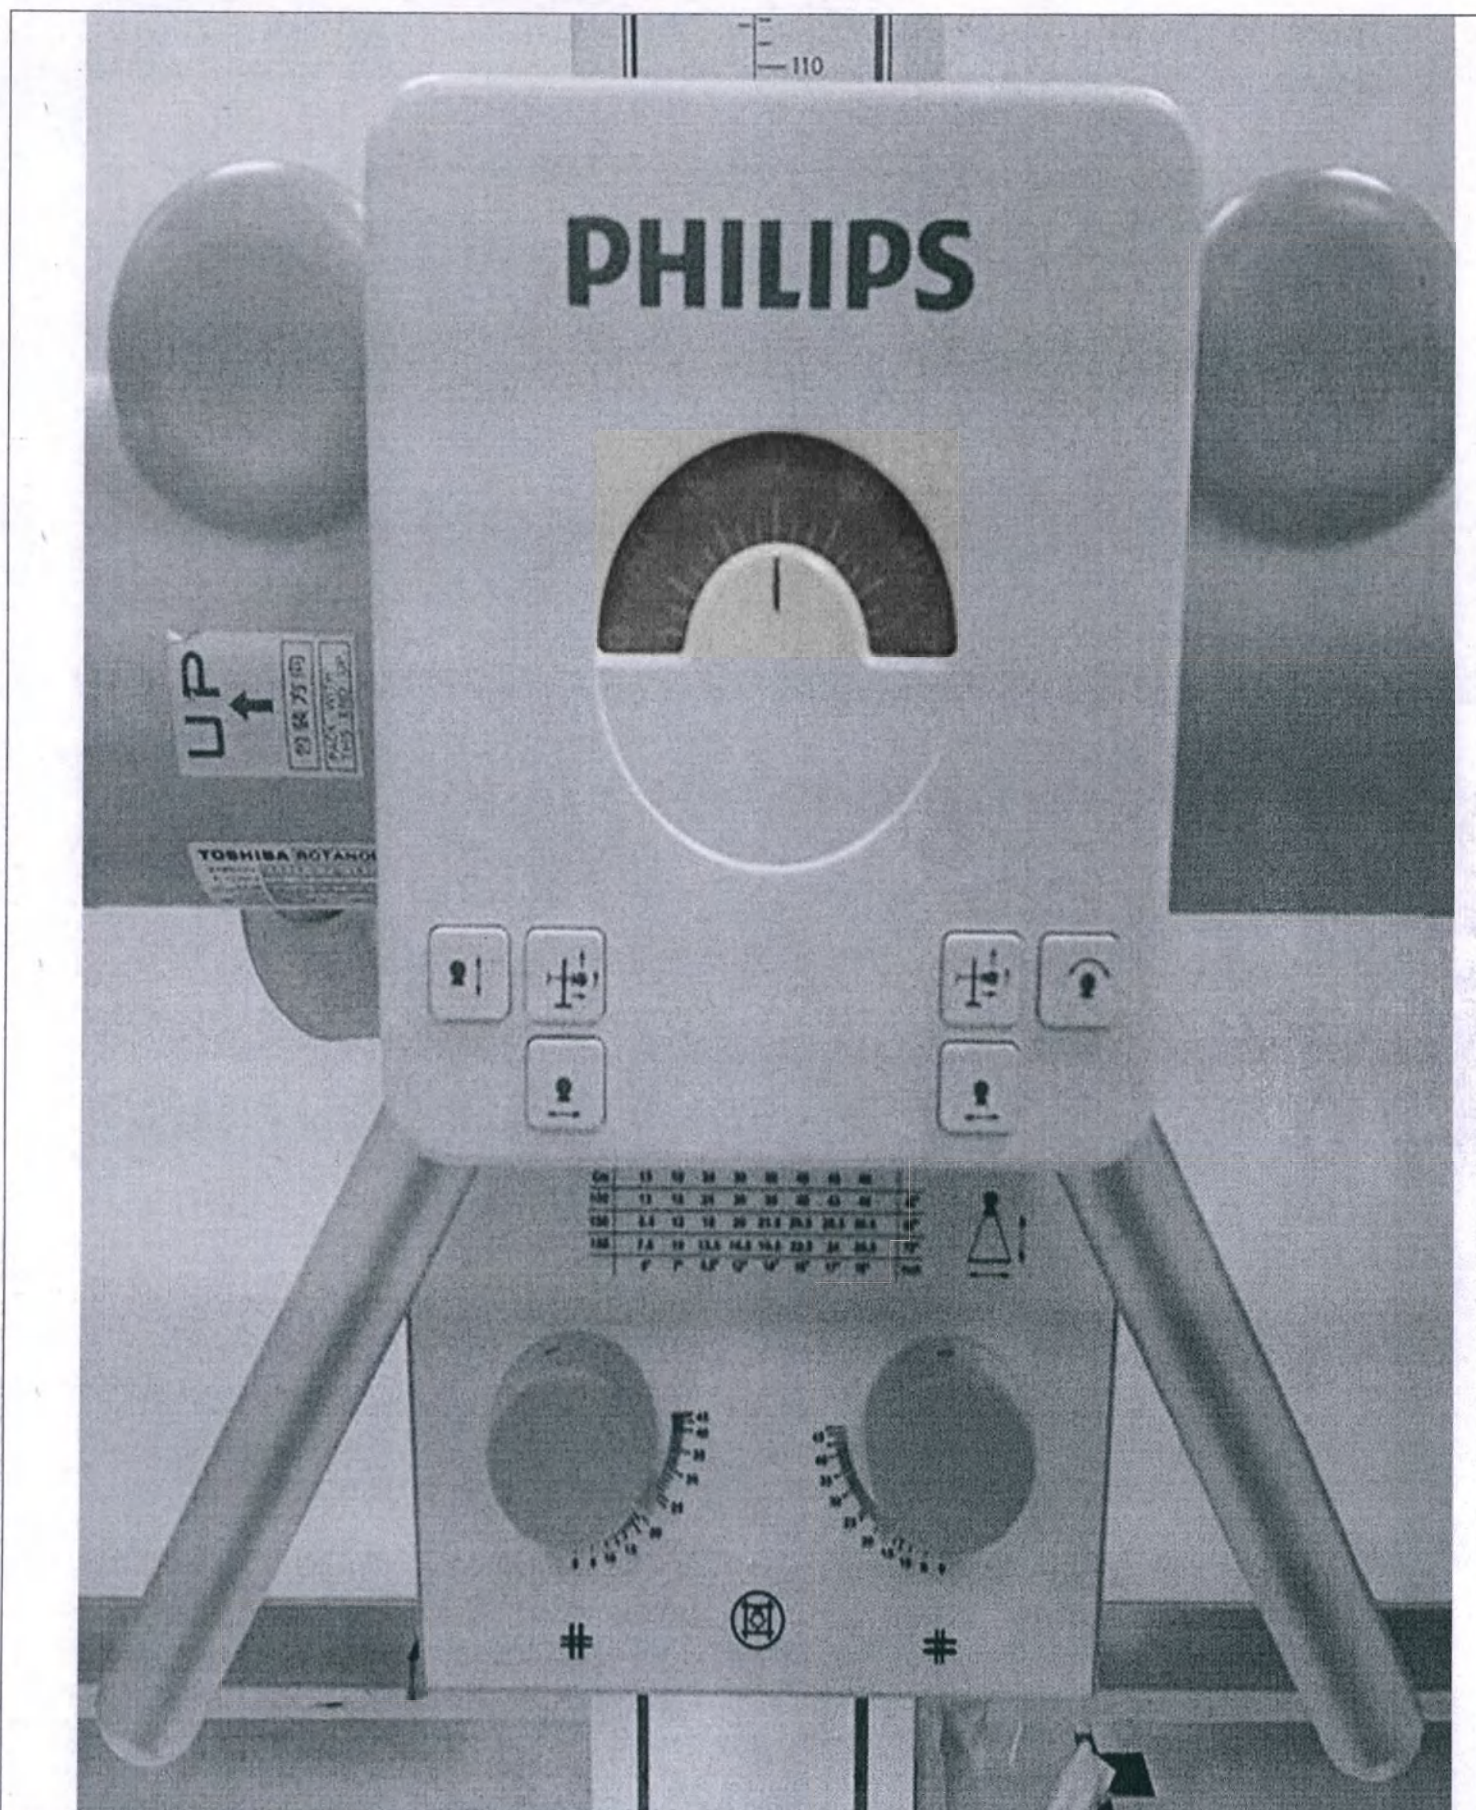


3и. Стойка трубки: 3.5. Рукоятка управления.

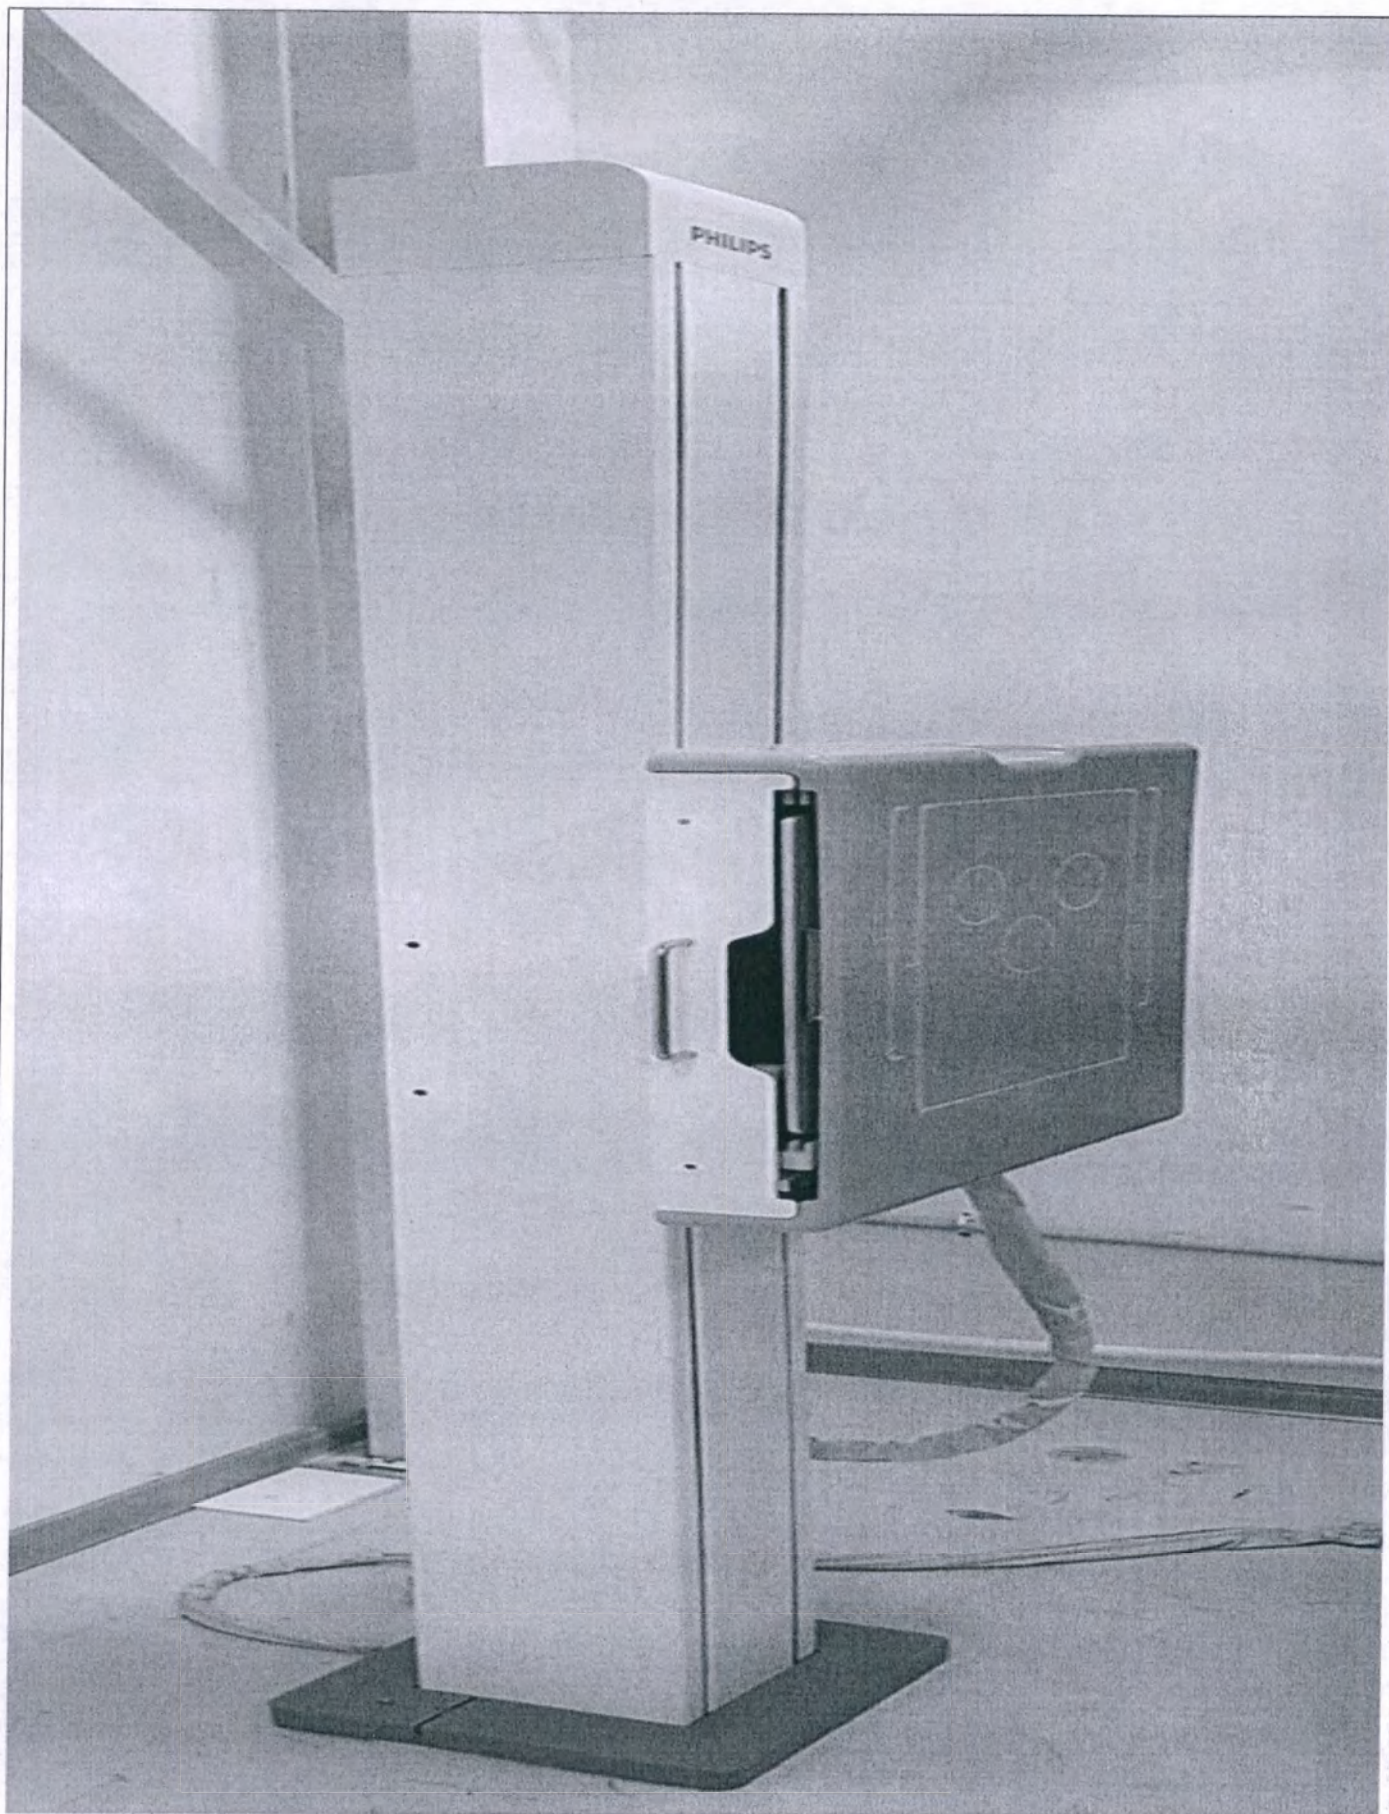


4. Стойка вертикальная.

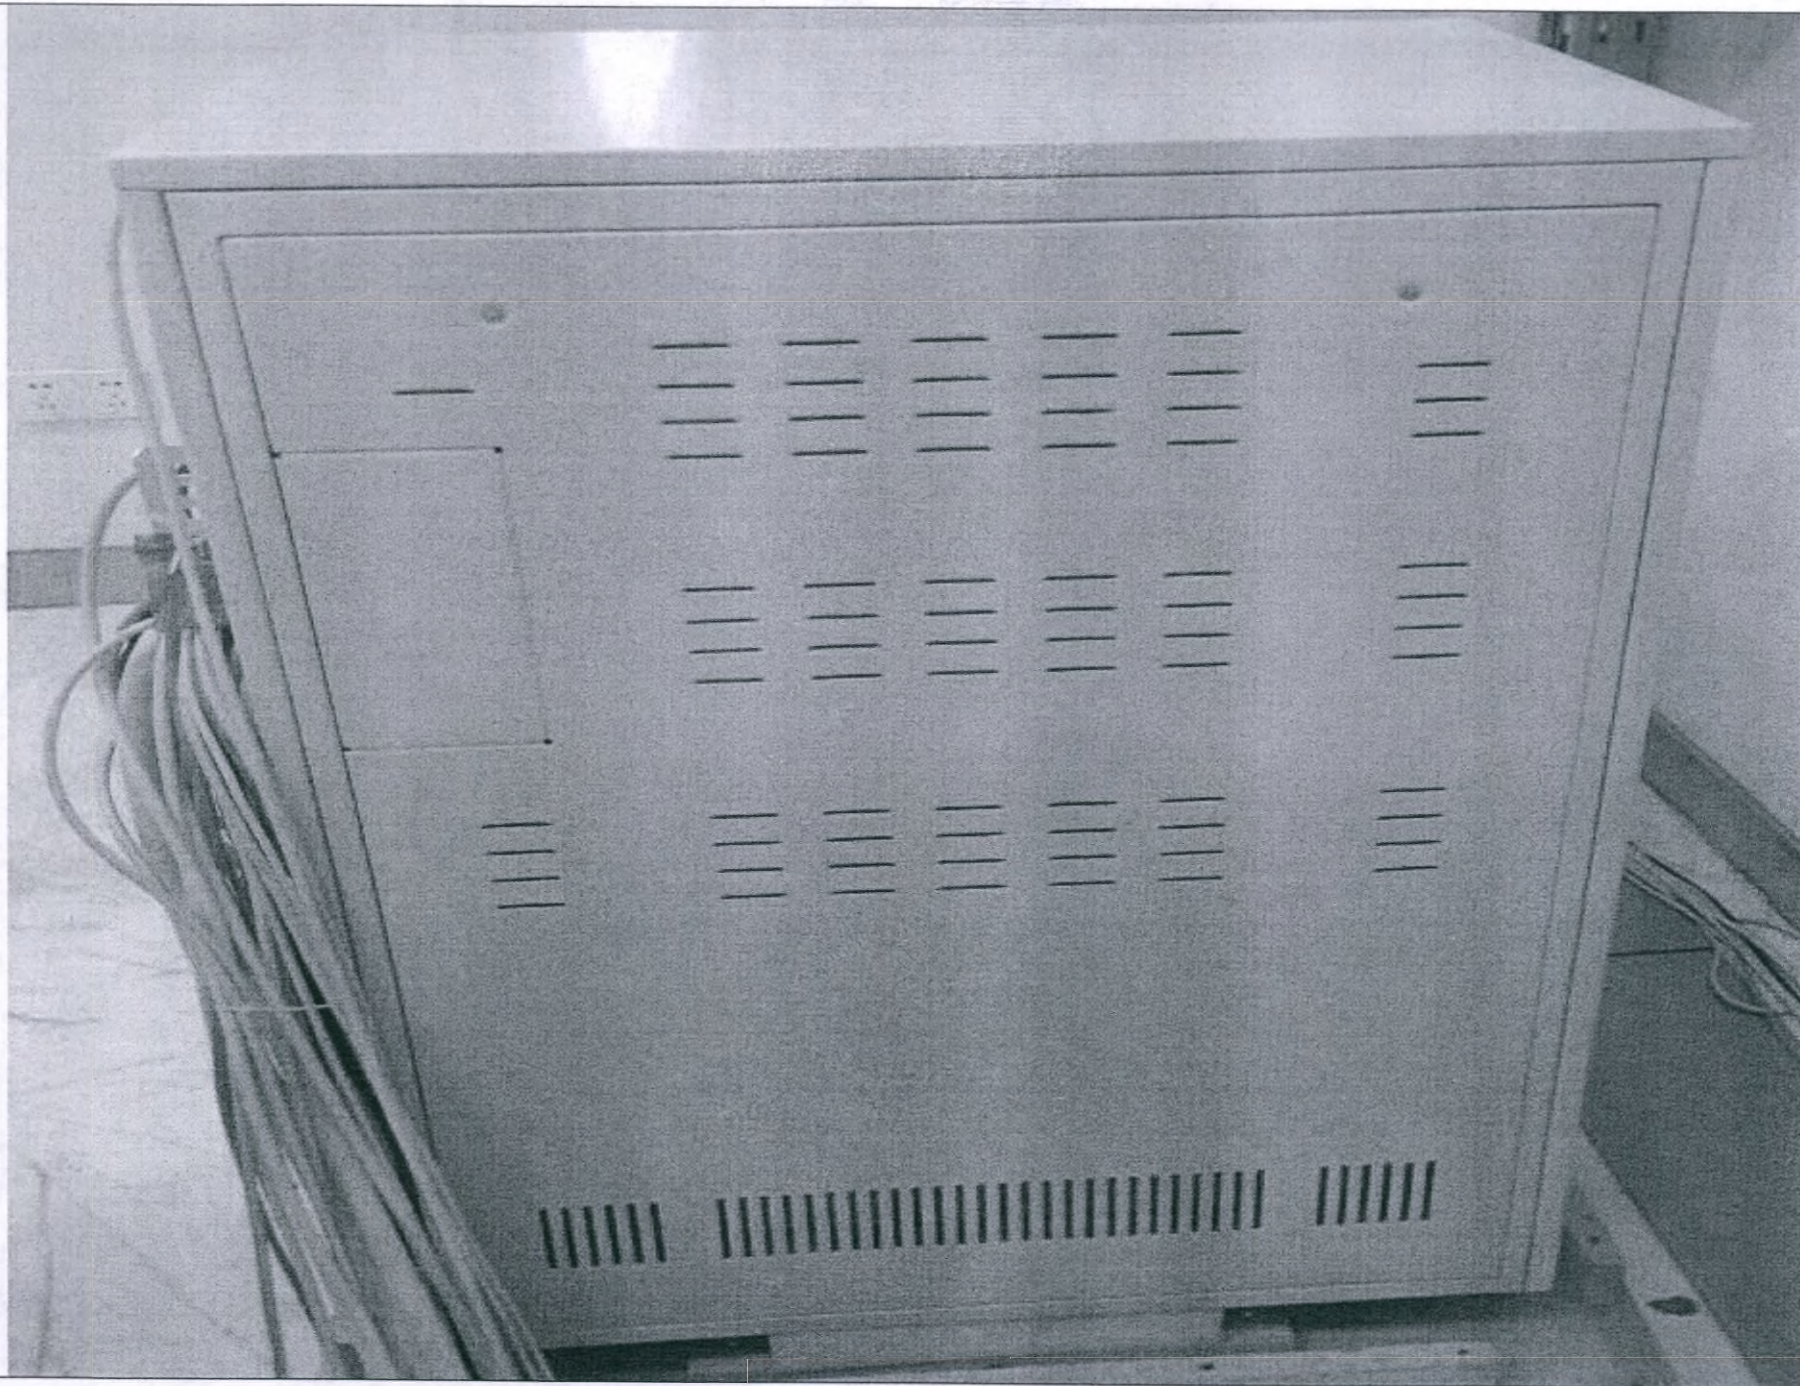


5а. Генератор 50 кВт серии ECO-Cabinet.

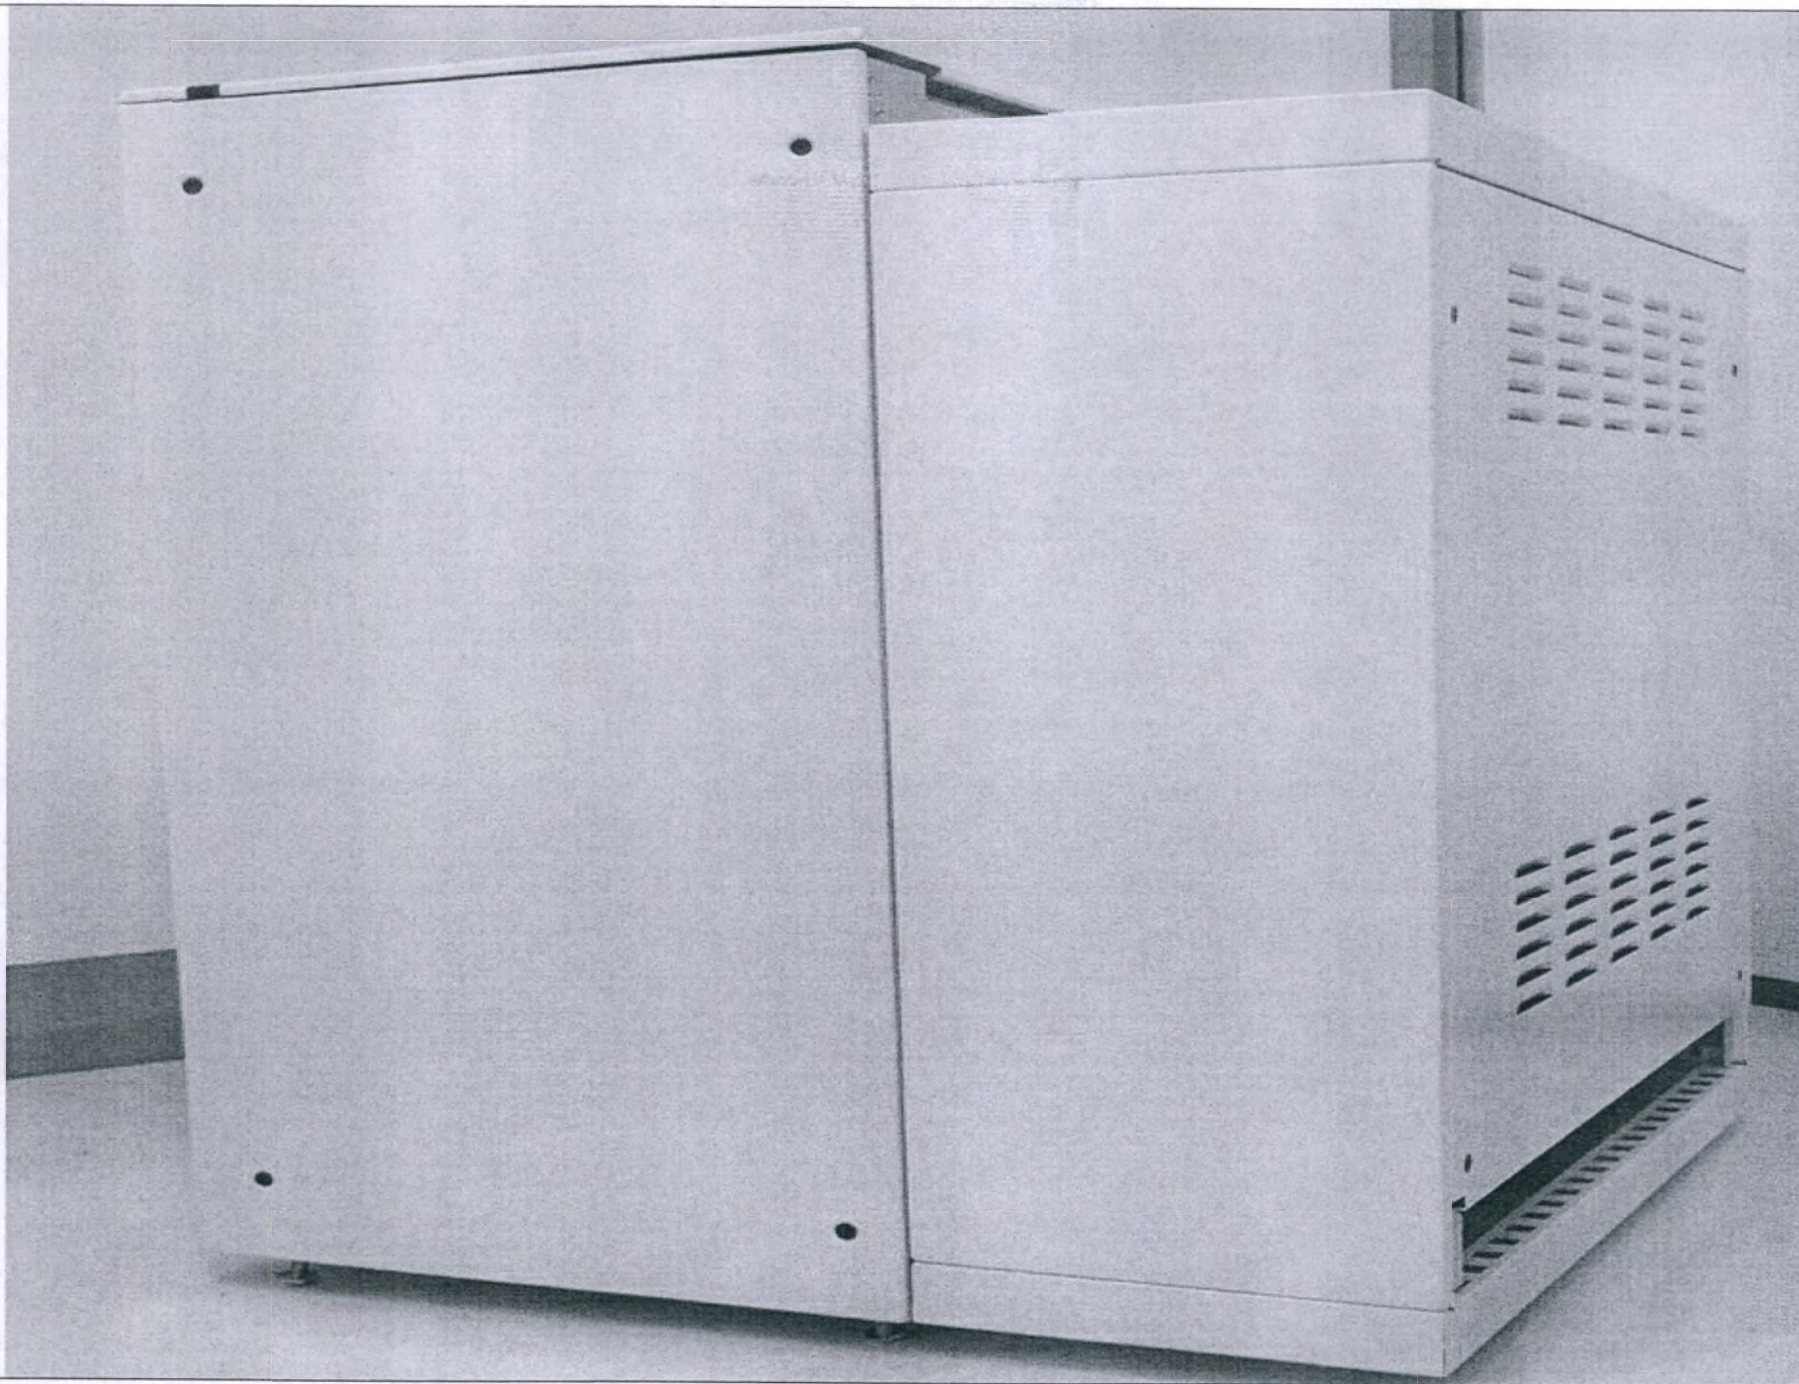


56. Генератор 50 кВт серии ECO-Cabinet.

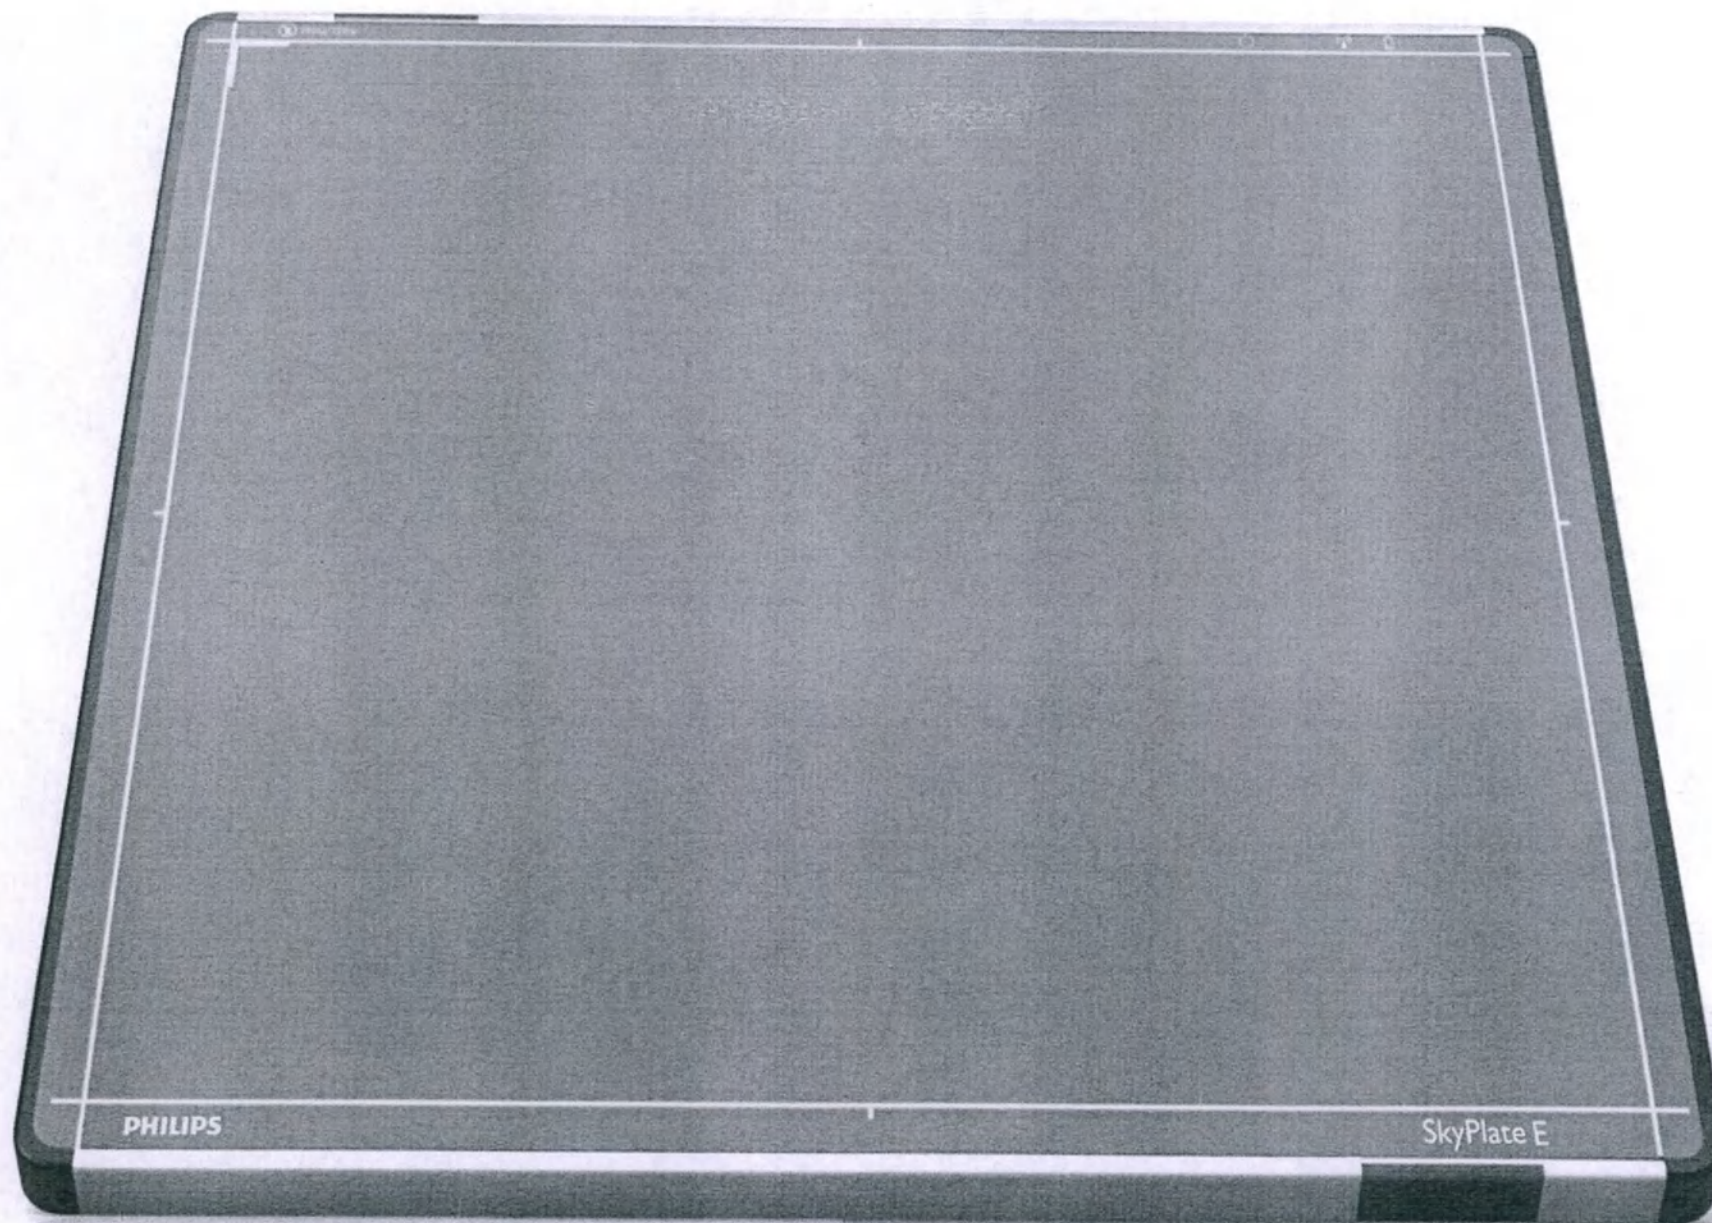


6. Детектор беспроводной переносной *Skyplate E*, не более 2 шт.

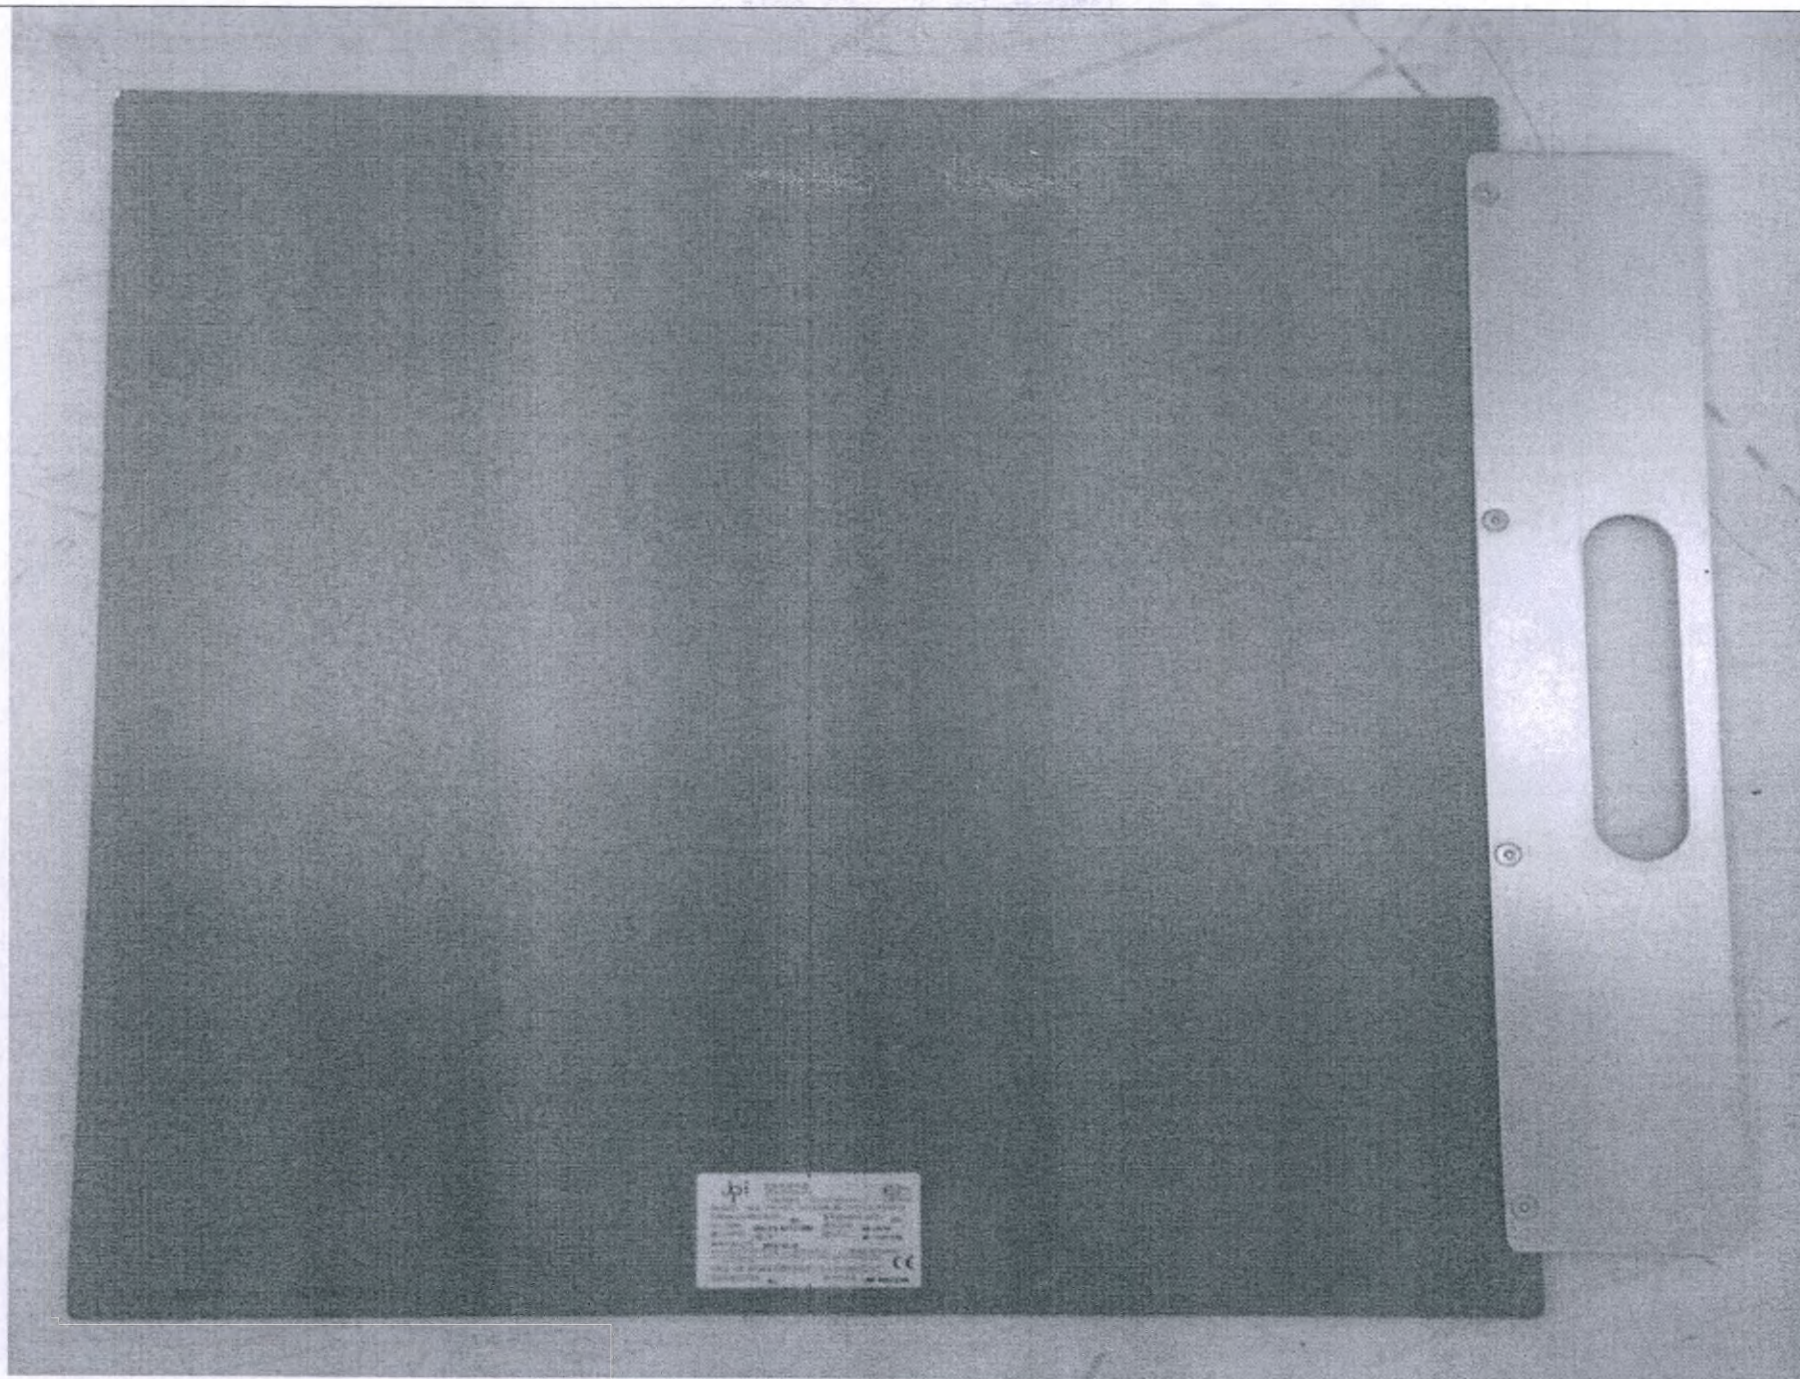


7а. Решетки сменные, вариант исполнения: решетка сменная с отношением 8.

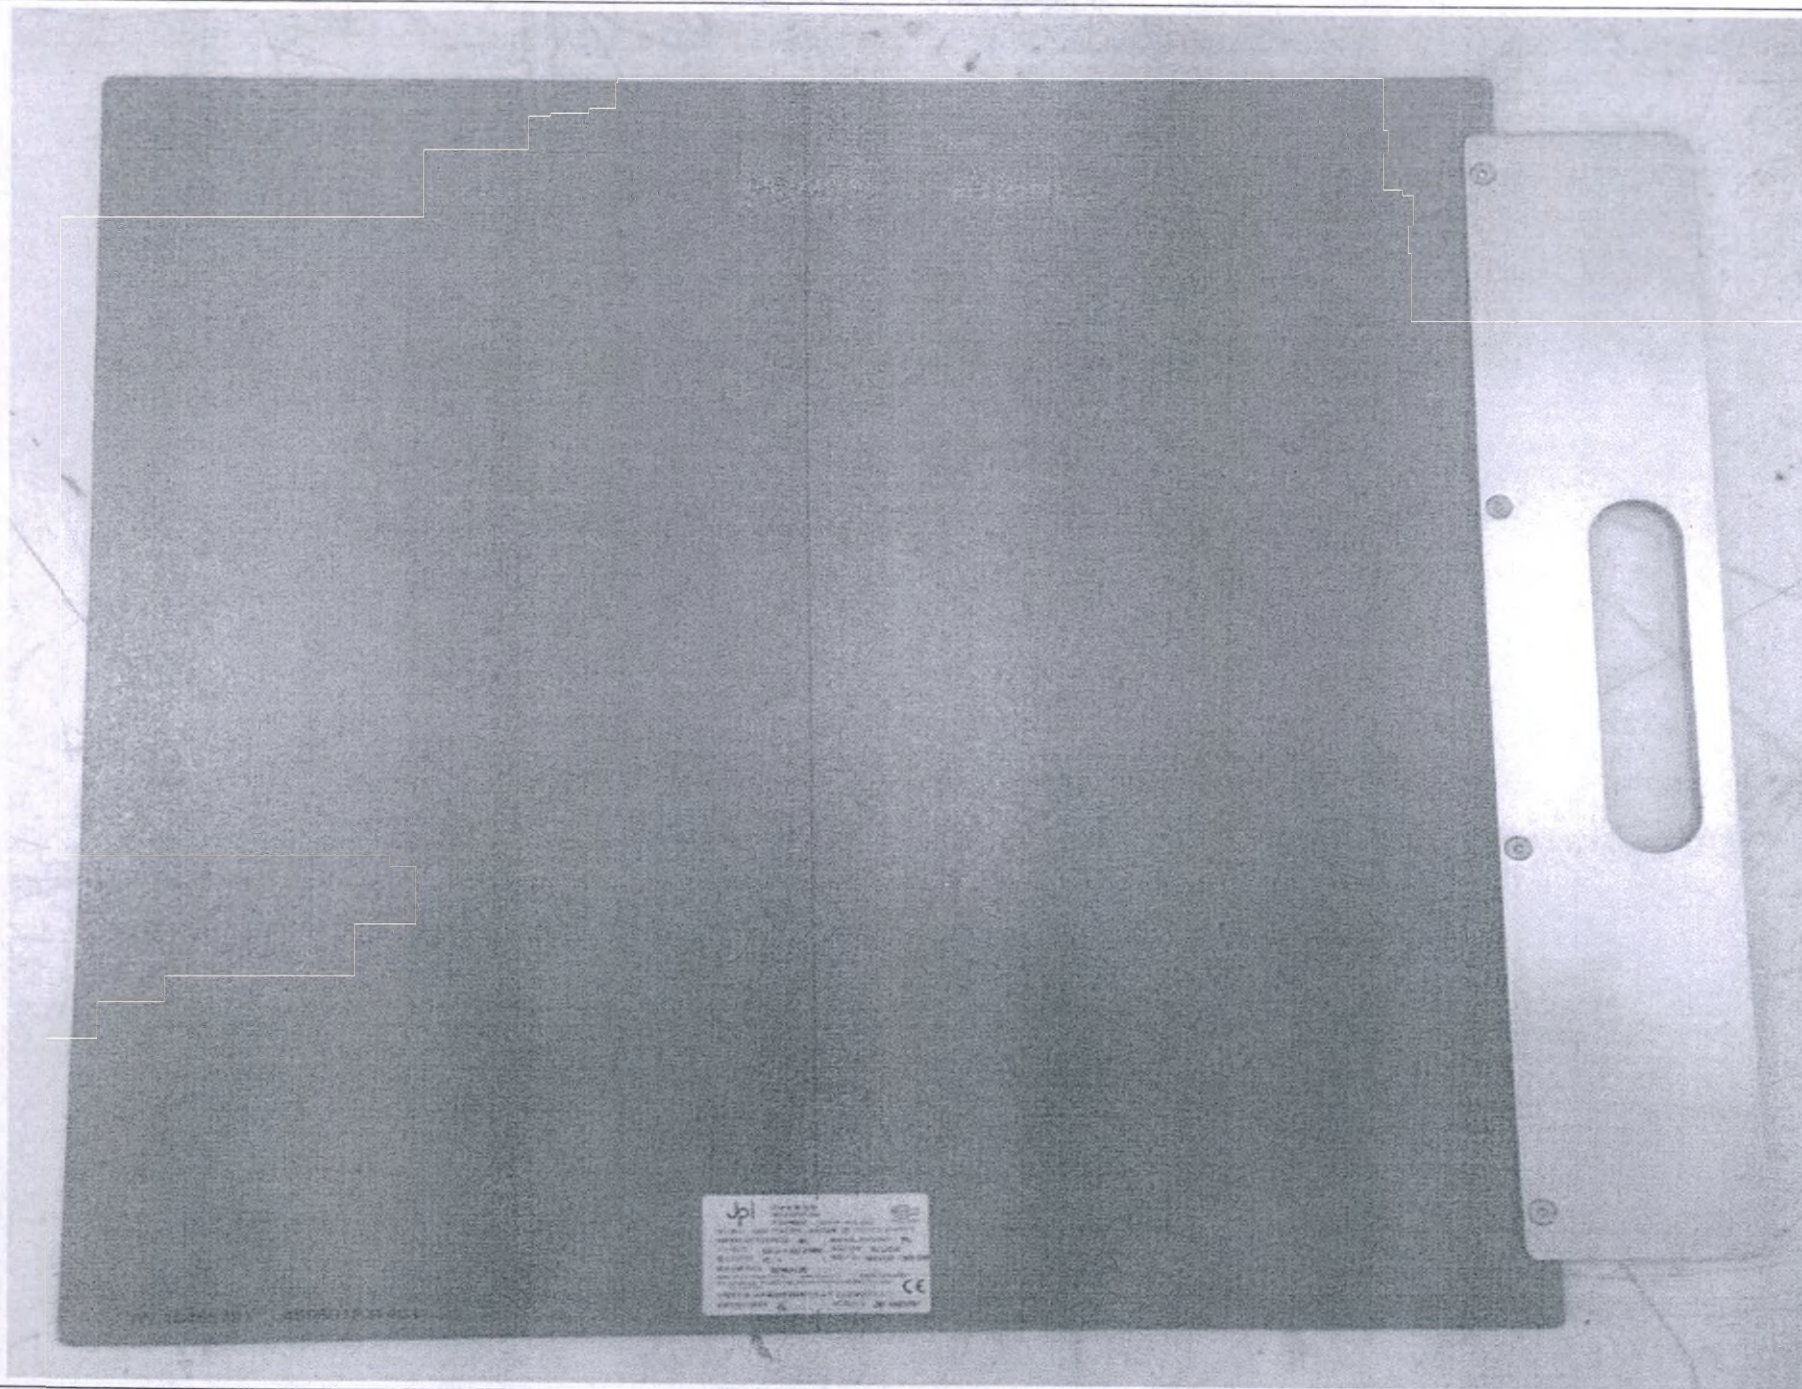

76. Решетки сменные, вариант исполнения: решетка сменная с отношением 12.

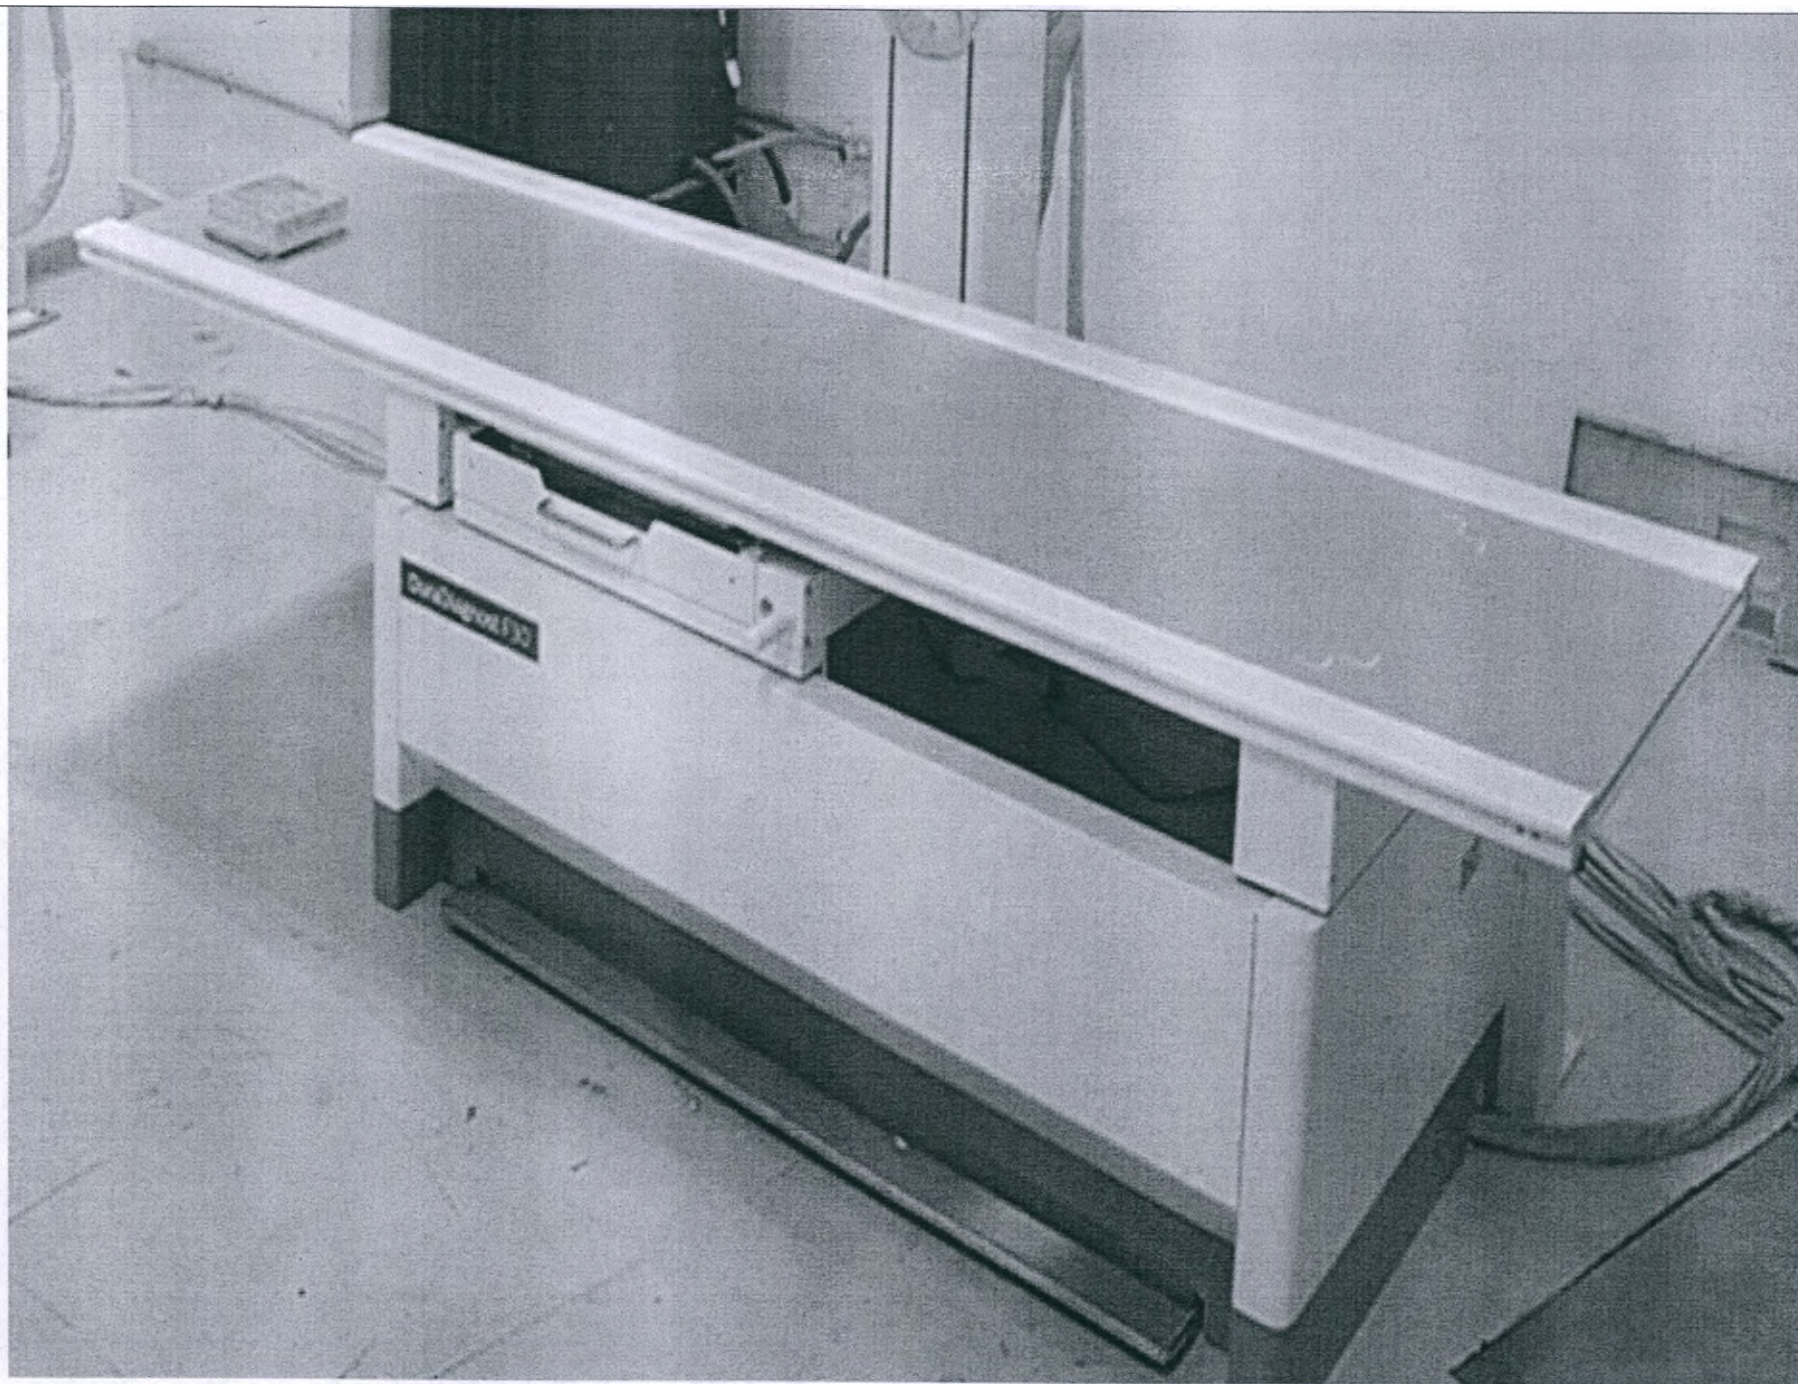


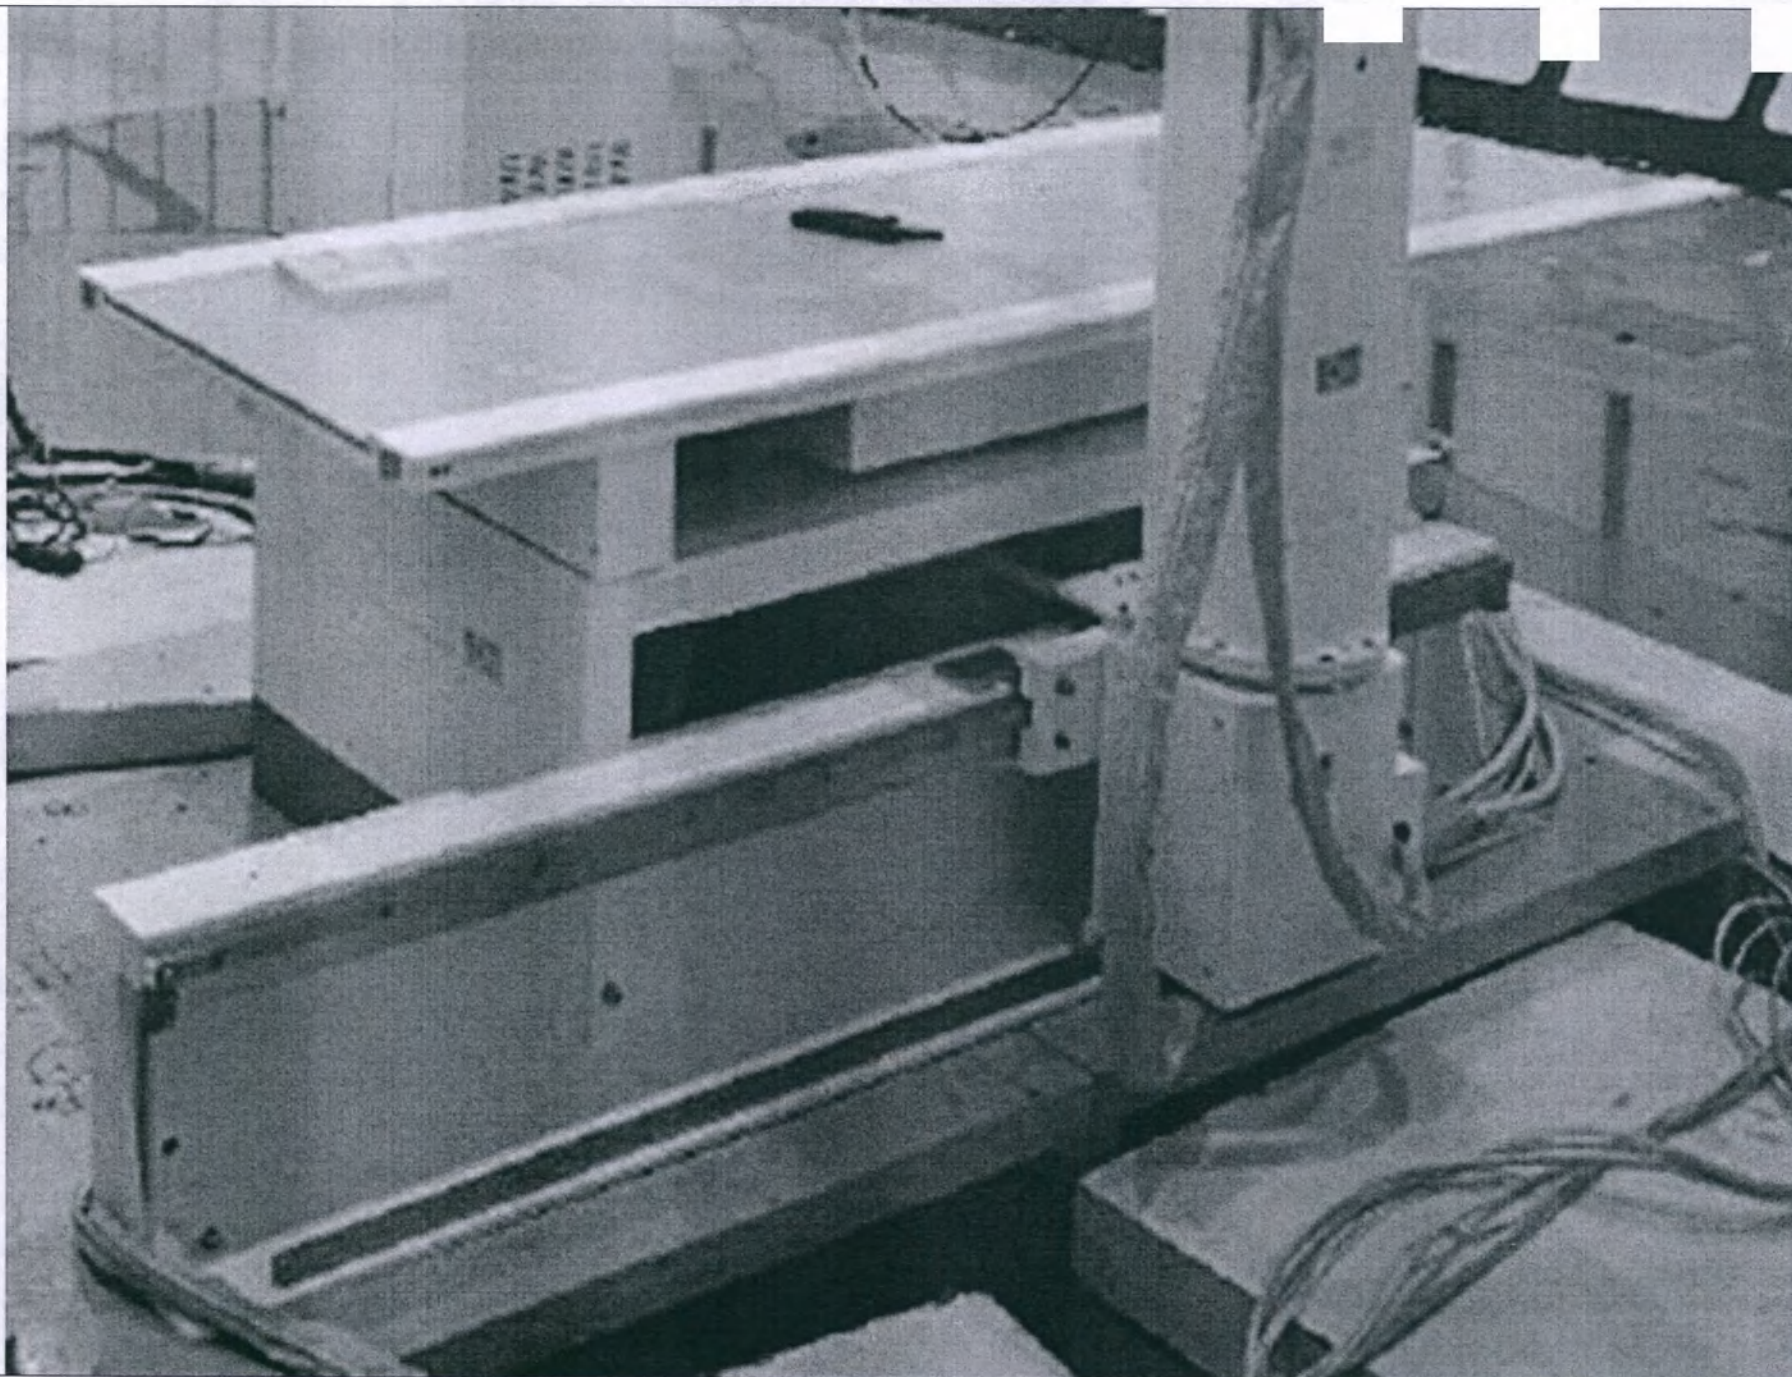

8б. Стол пациента.


Руководство по
эксплуатации


Русский

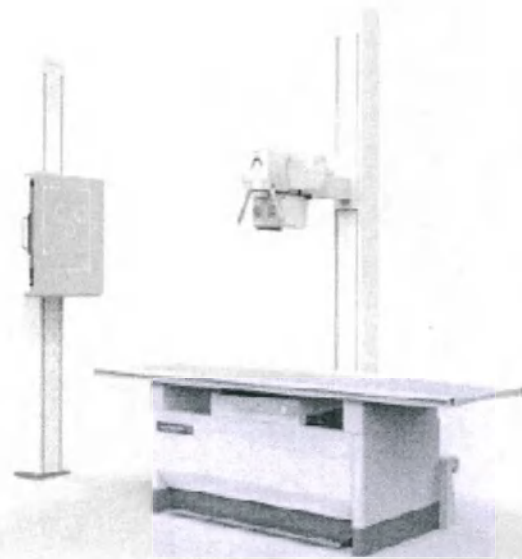

DuraDiagnost F30

PHILIPS

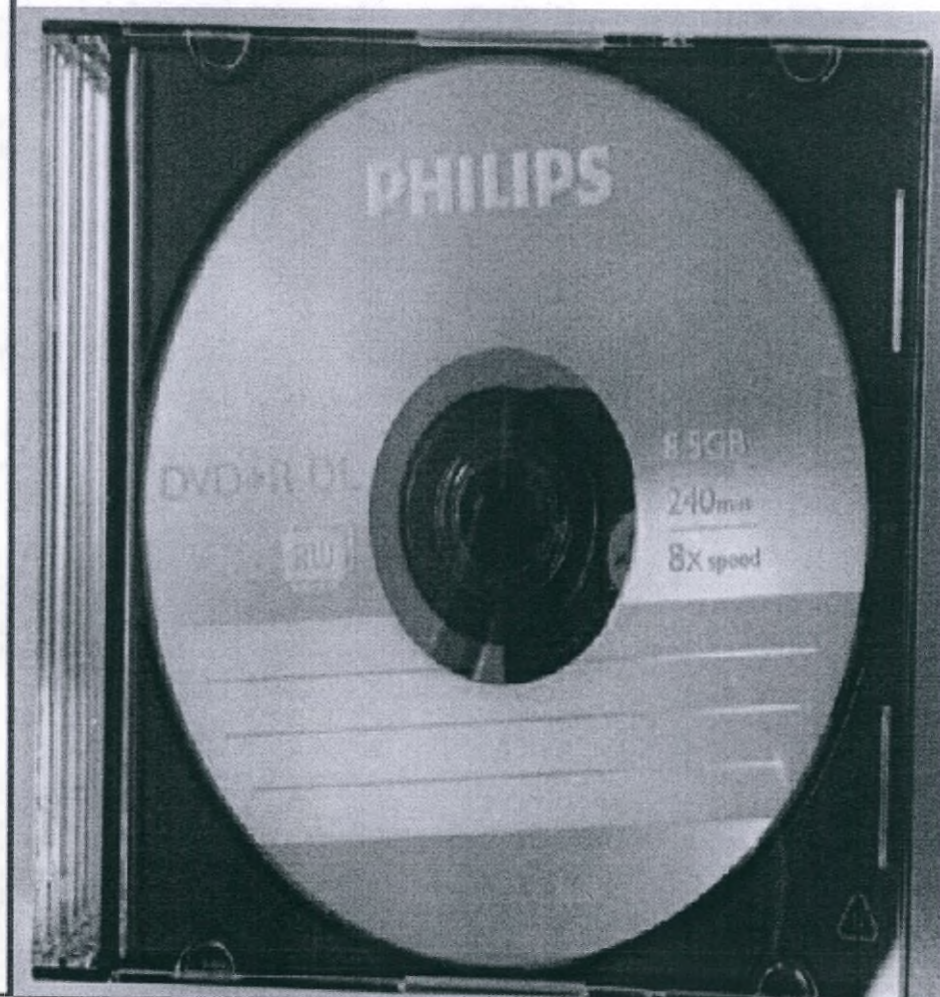


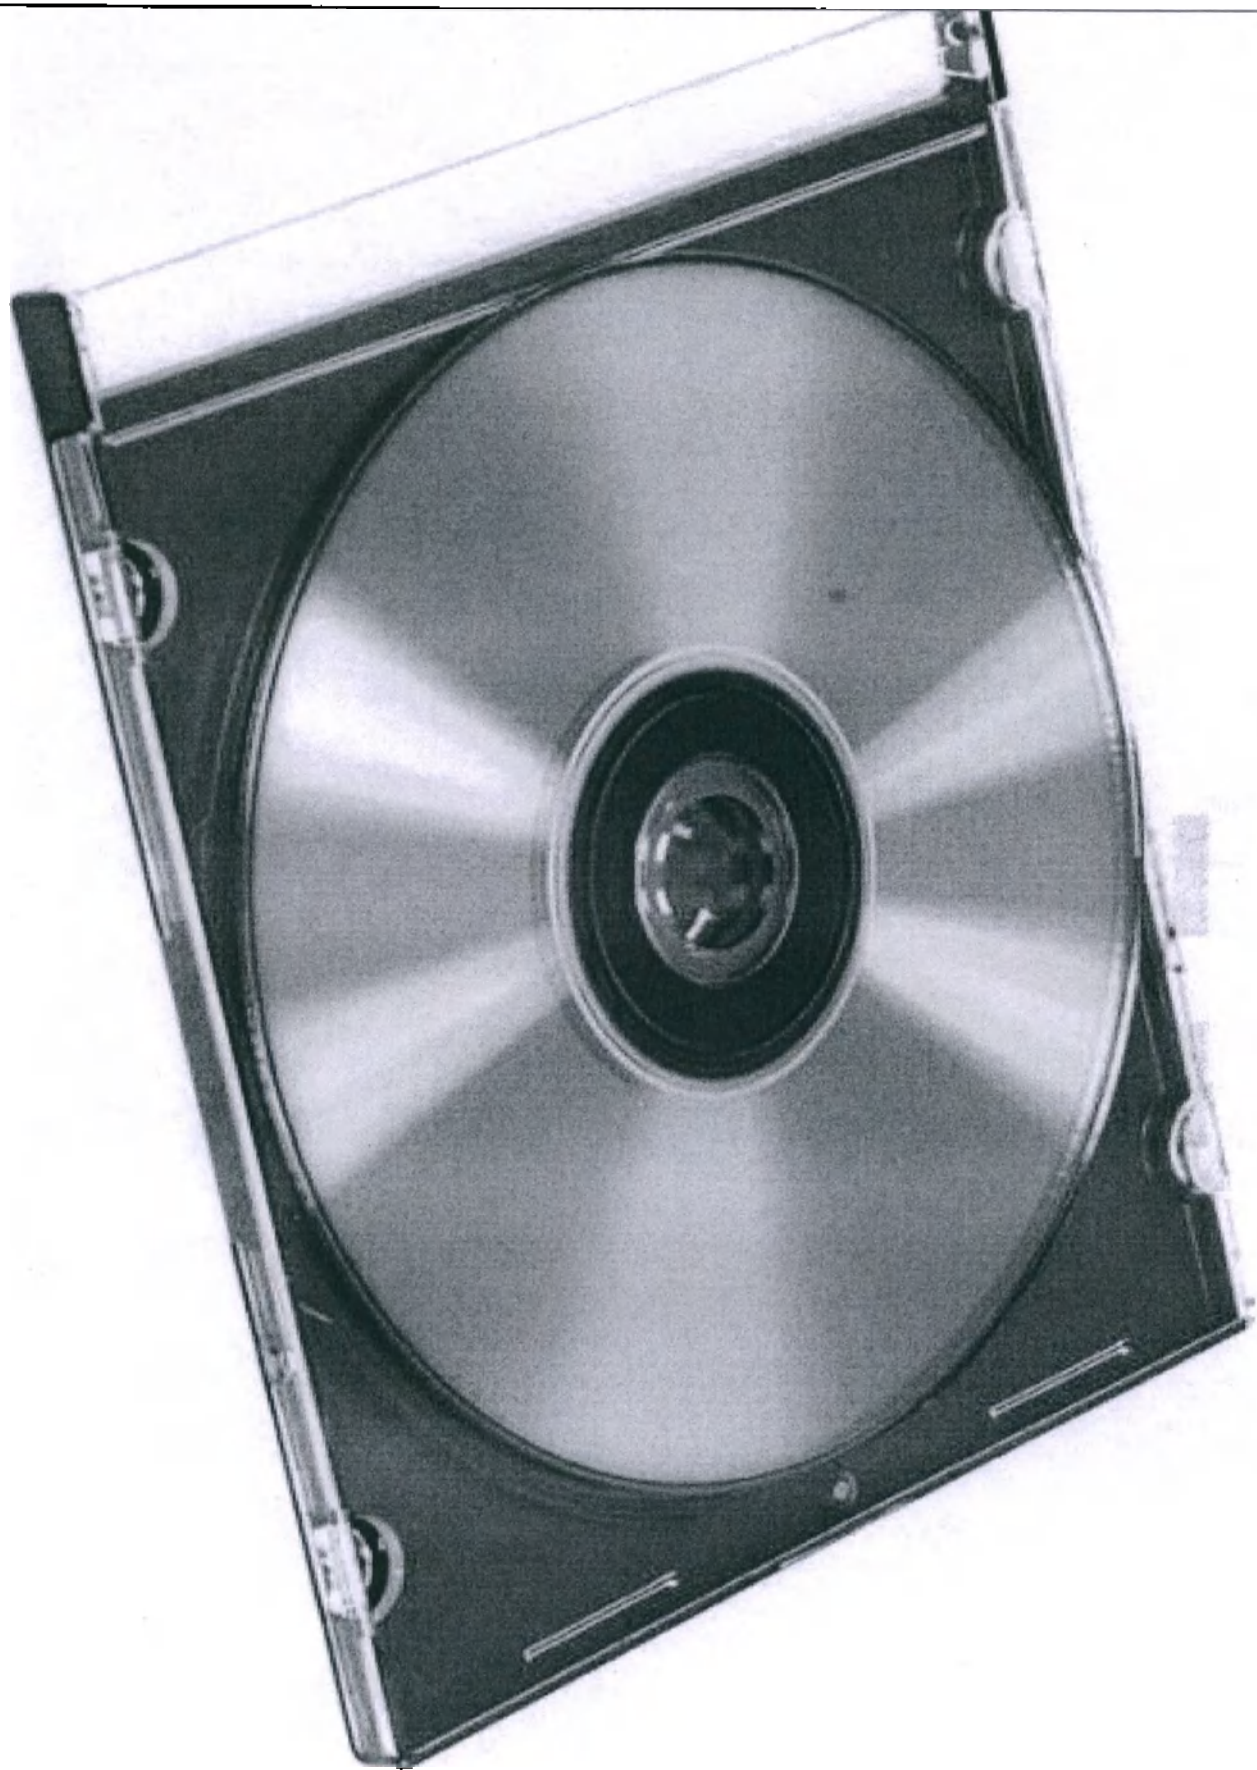


10а. Программное обеспечение «Инструмент проверки качества (QA Tool)» на ПЗУ, CD/DVD дисках, флеш-картах, USB-флеш-накопителях, виртуальном носителе: 10.1 Программное обеспечение «Инструмент проверки качества (QA Tool)» на CD/DVD дисках.




106. Программное обеспечение «Инструмент проверки качества (QA Tool)» на ПЗУ, CD/DVD дисках, флеш-картах, USB-флеш-накопителях, виртуальном носителе: 10.2 Программное обеспечение «Инструмент проверки качества (QA Tool)» на USB-флеш-накопителе

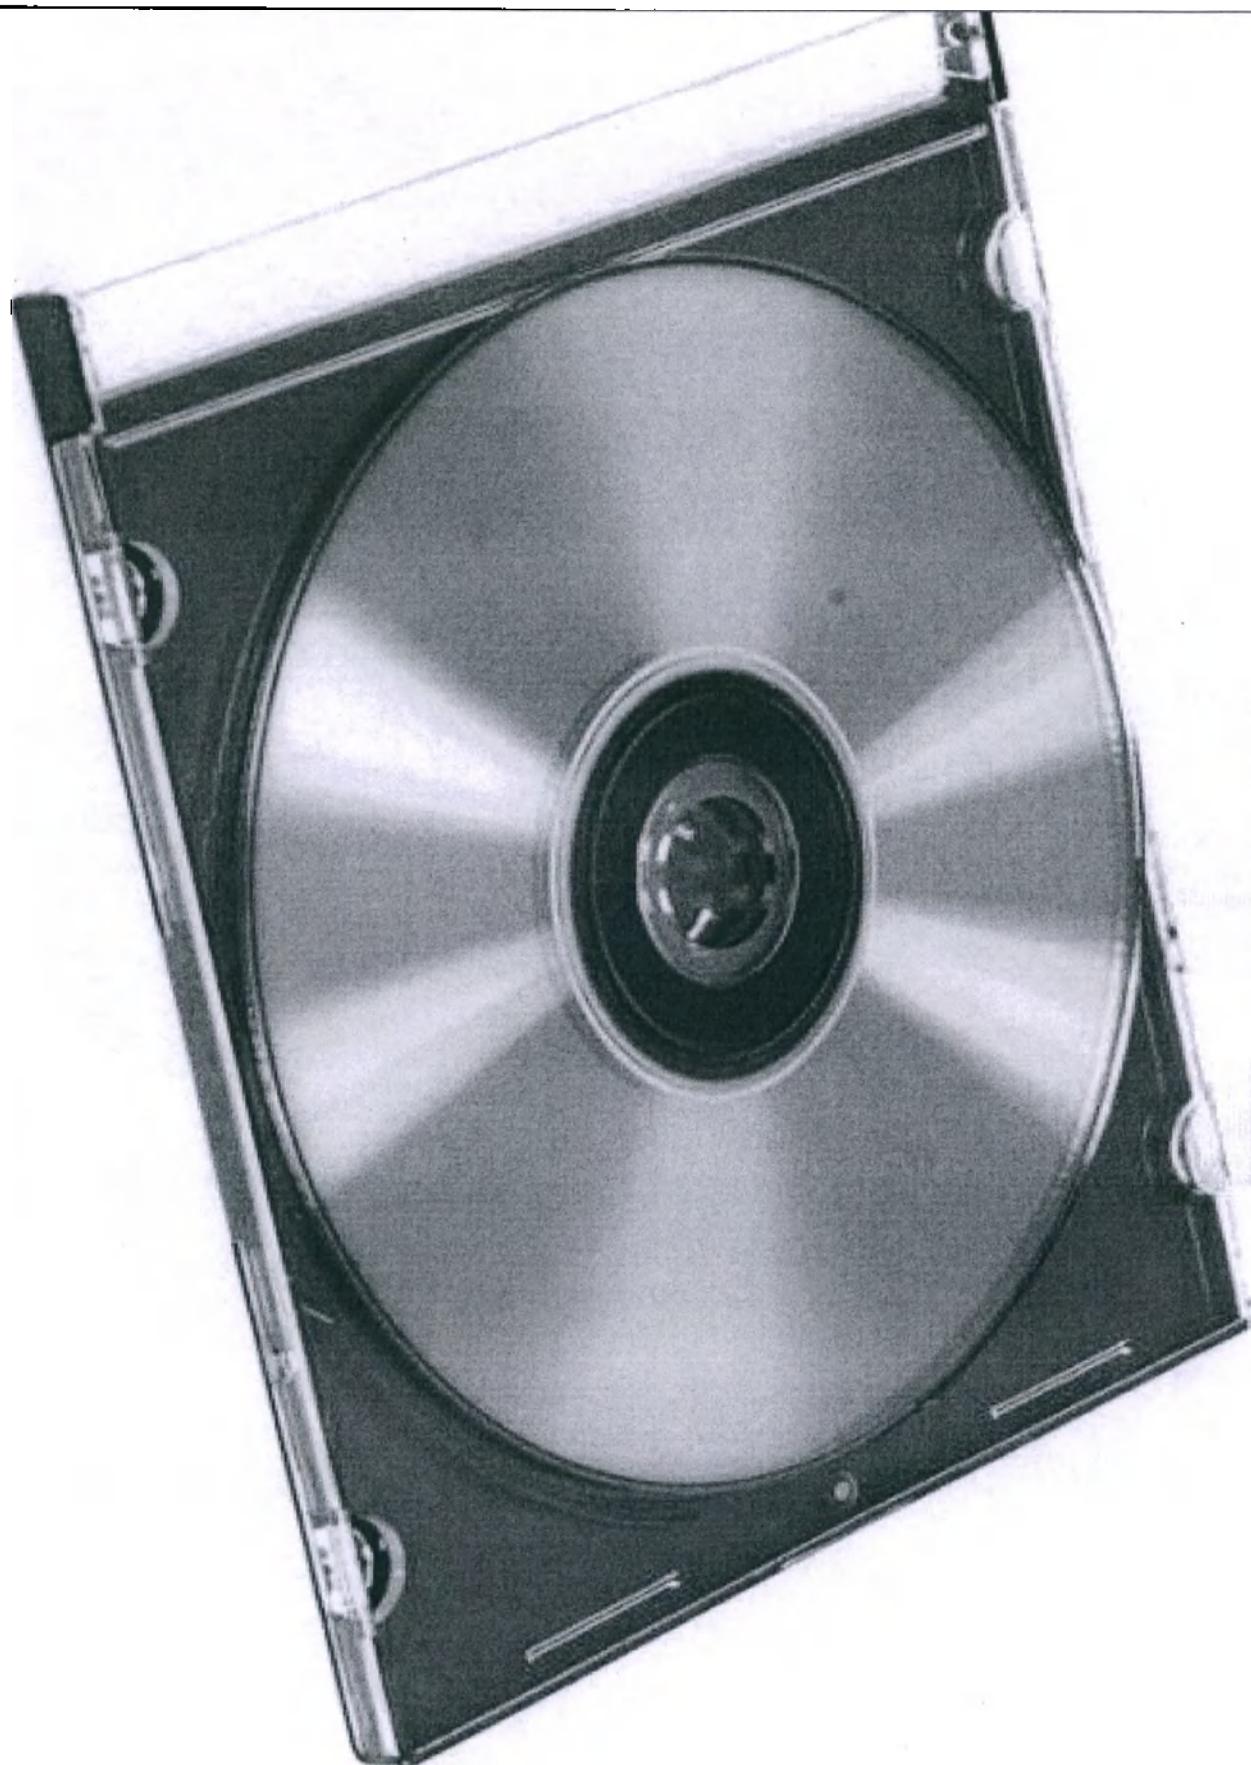


11а. Программное обеспечение «mShield» на ПЗУ, CD/DVD дисках, флеш-картах, USB-флеш-накопителях, виртуально носители: 11.1 Программное обеспечение «mShield» на CD/DVD дисках.

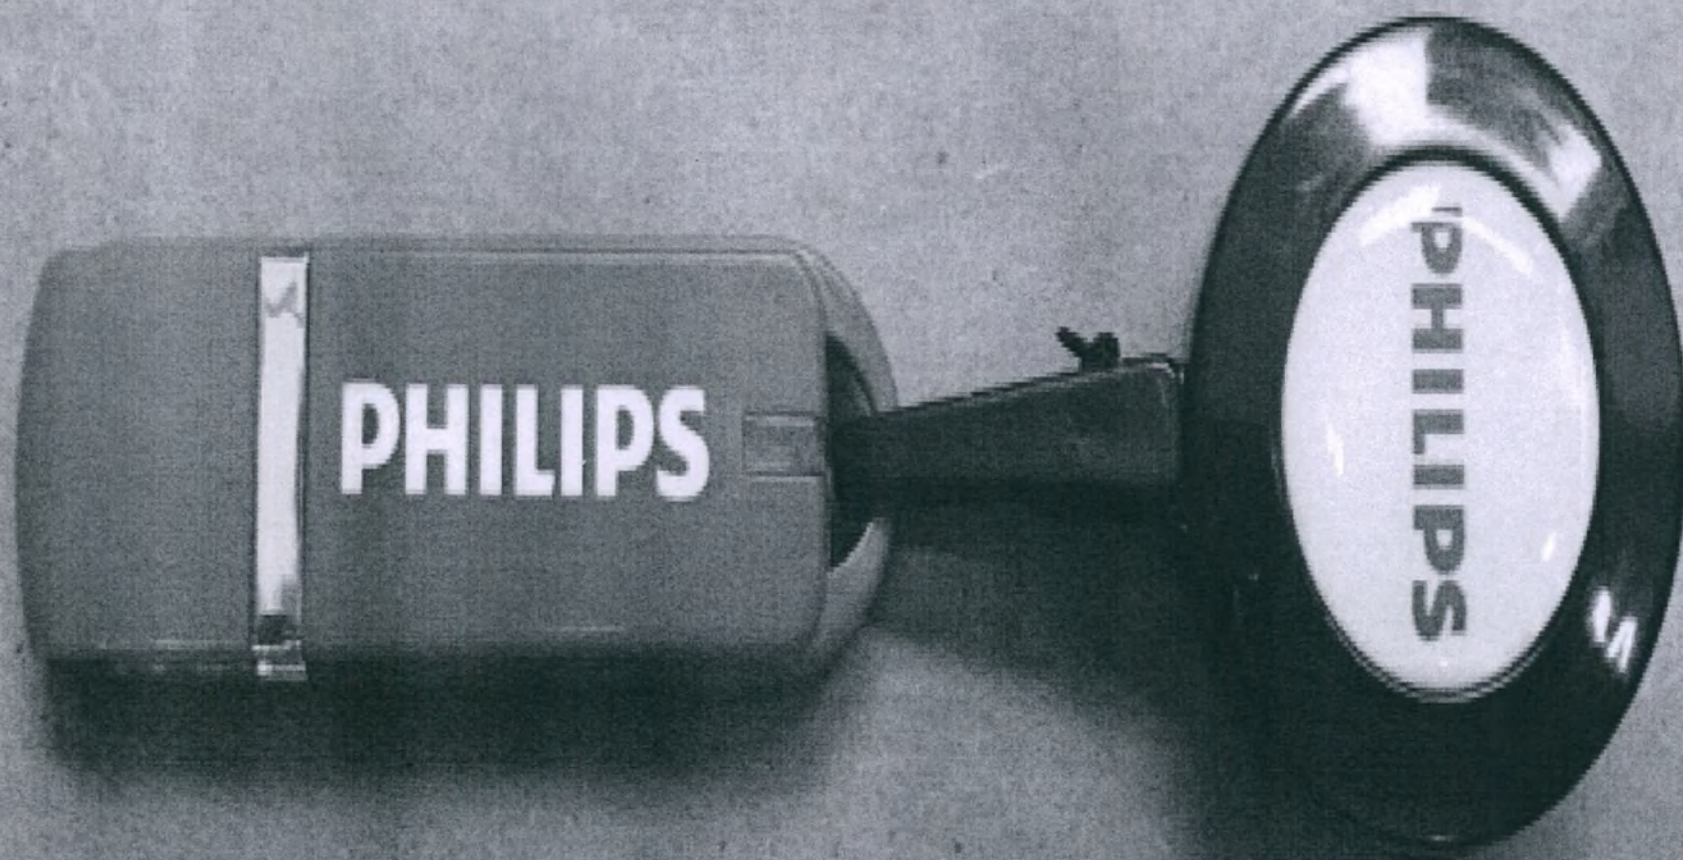


116. Программное обеспечение «mShield» на ПЗУ, CD/DVD дисках, флеш-картах, USB-флеш-накопителях, виртуальном накопителе

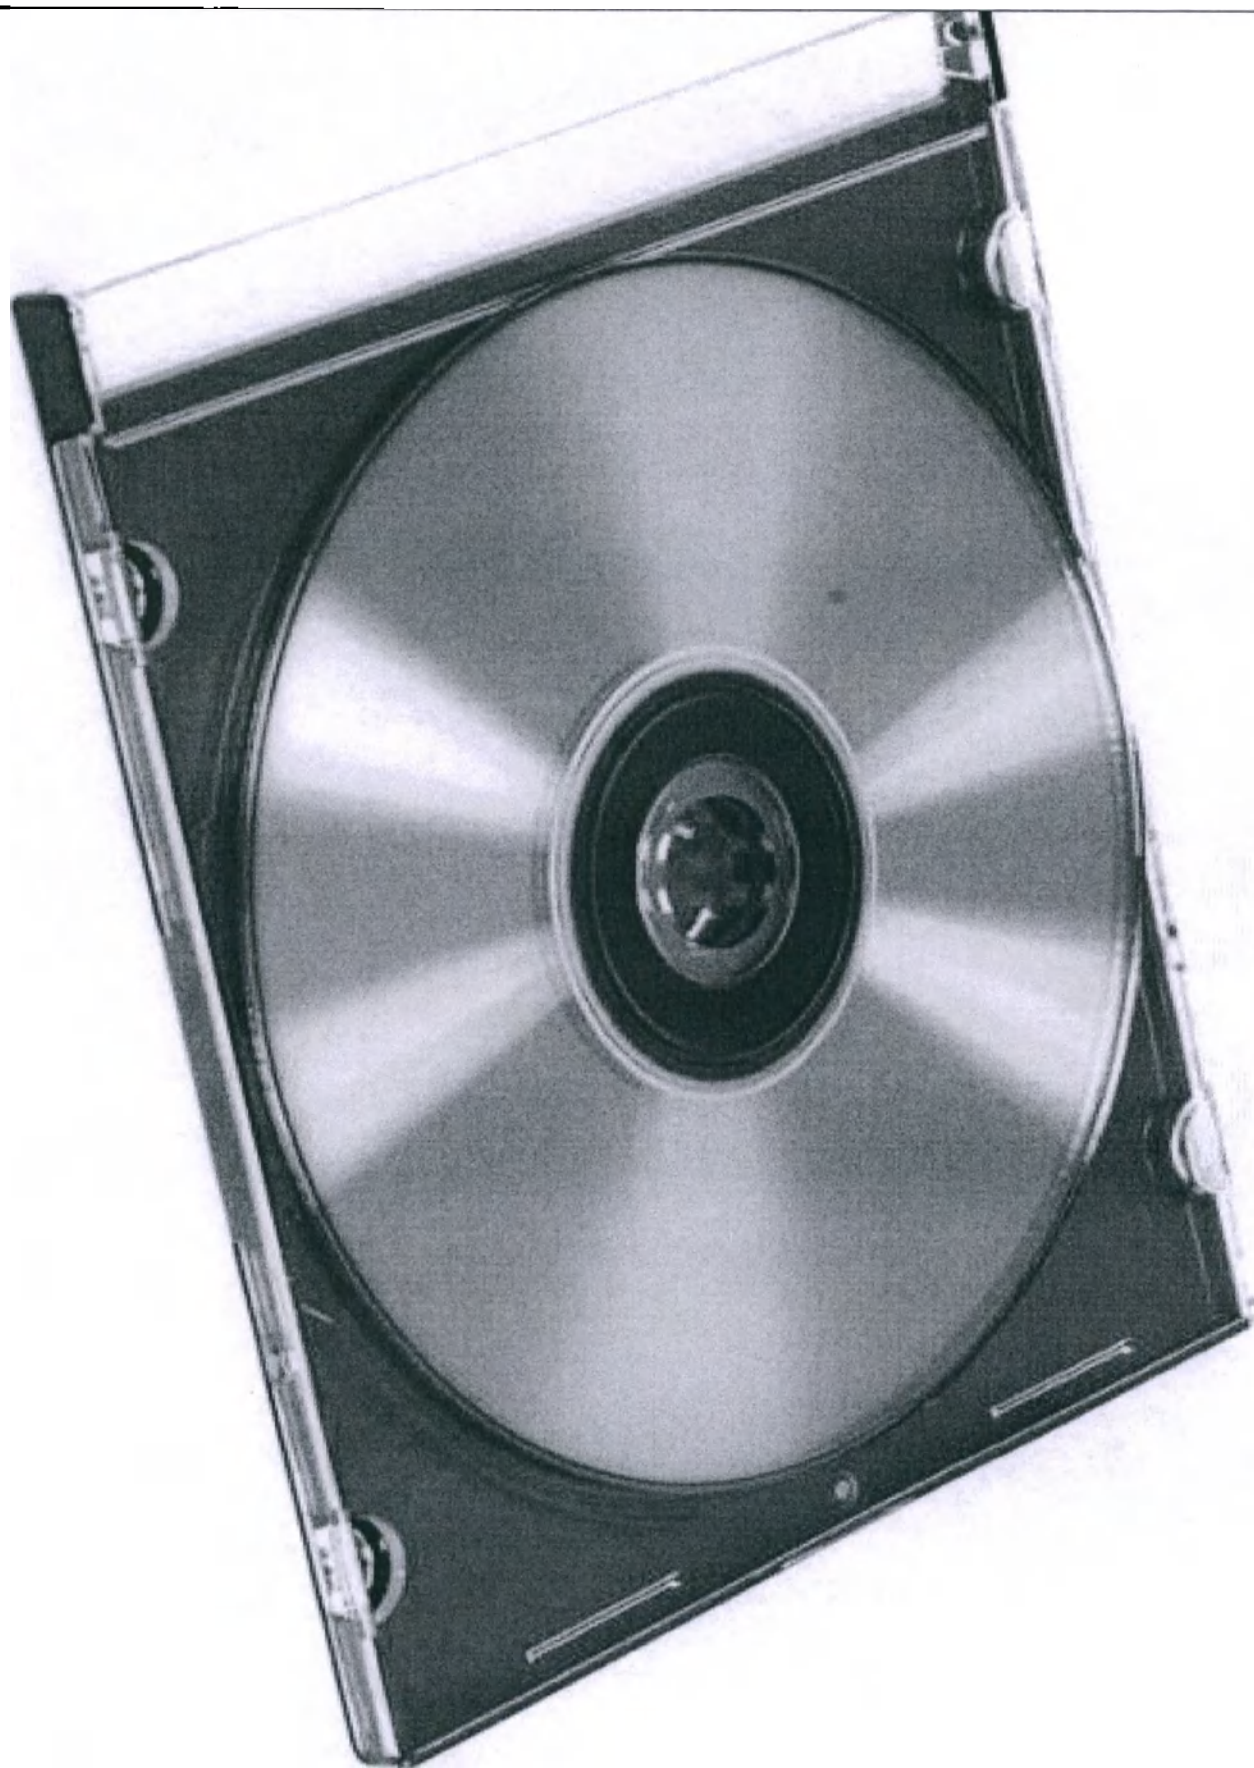


12а. Программное обеспечение «Программное обеспечение интерфейса АРМ лаборанта» на ПЗУ, CD/DVD дисках, флеш-картах, USB-флеш-накопителях, виртуальном носителе: 12.1 Программное обеспечение «Программное обеспечение интерфейса АРМ лаборанта» на CD/DVD дисках.

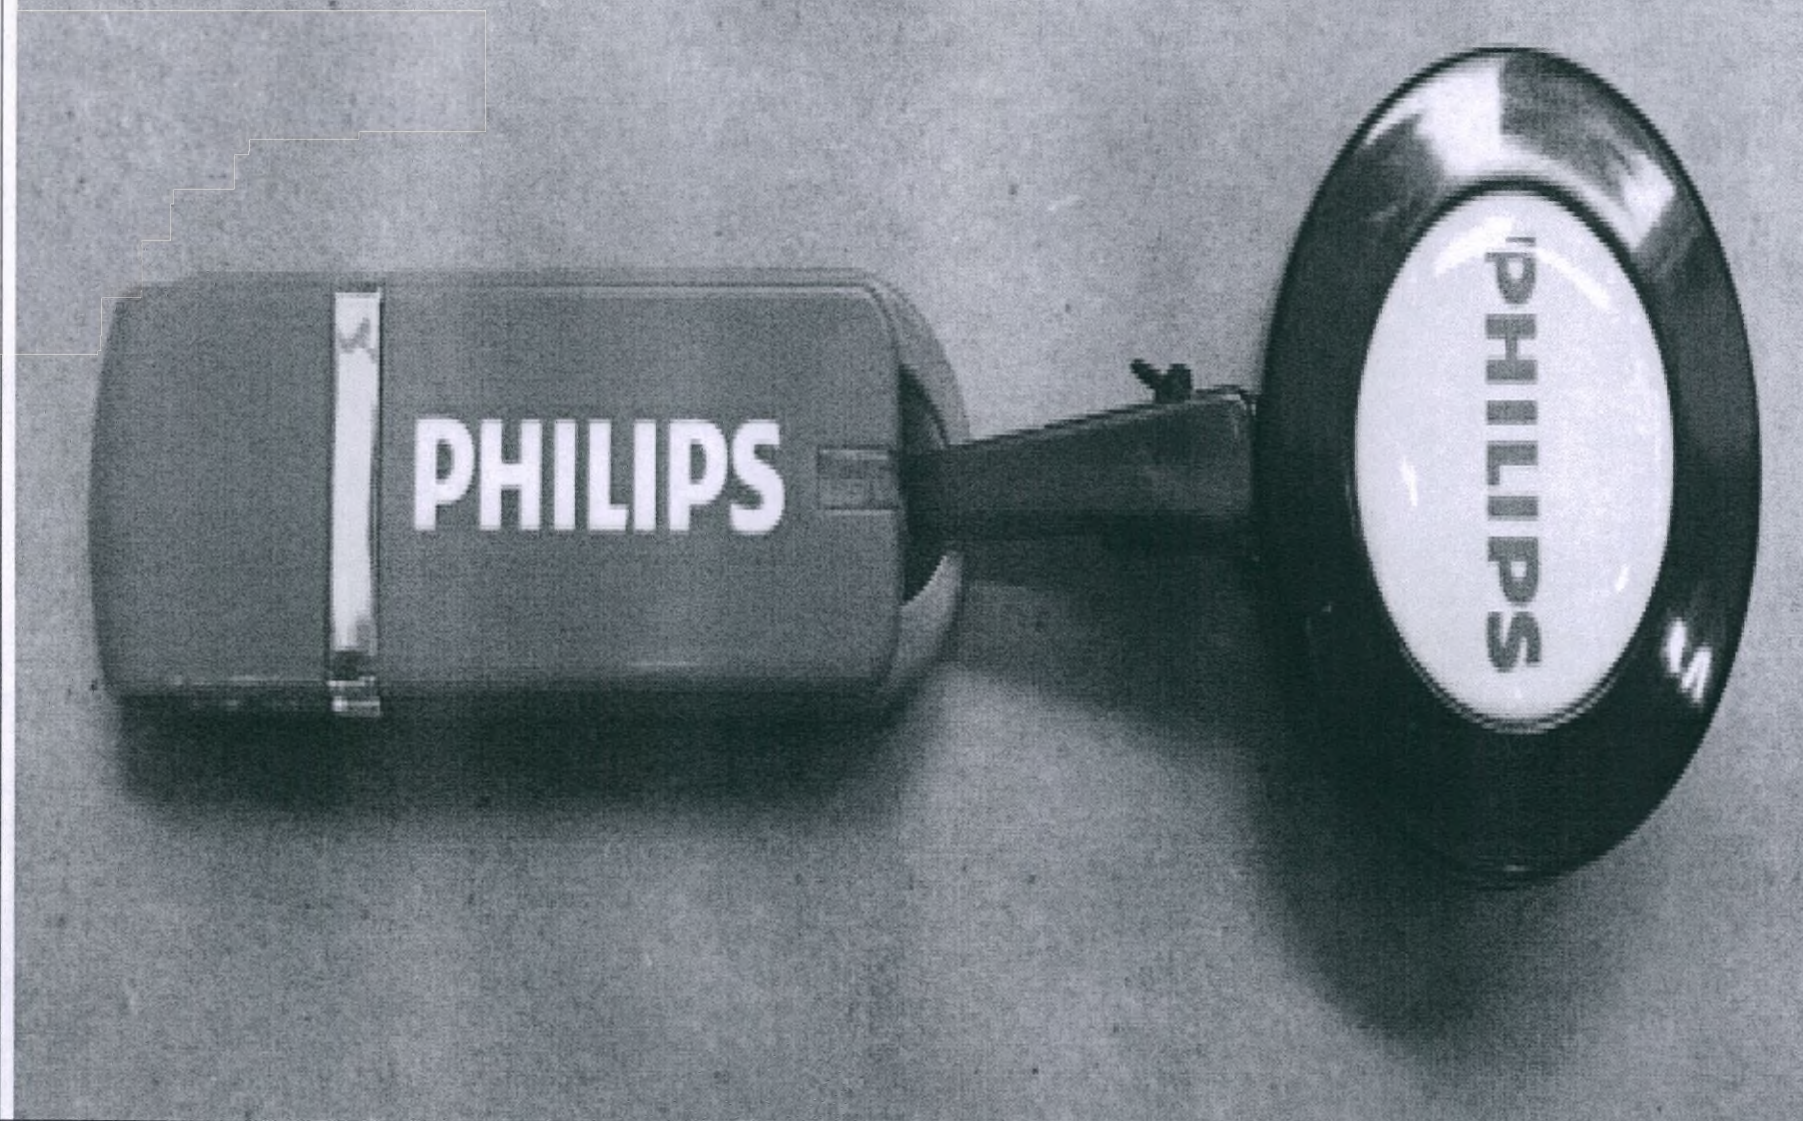


126. Программное обеспечение «Программное обеспечение интерфейса АРМ лаборанта» на ПЗУ, CD/DVD дисках, флеш-картах, USB-флеш-накопителях, виртуальном носителе: 12.2 Программное обеспечение «Программное обеспечение интерфейса АРМ лаборанта» на USB-флеш-накопителе

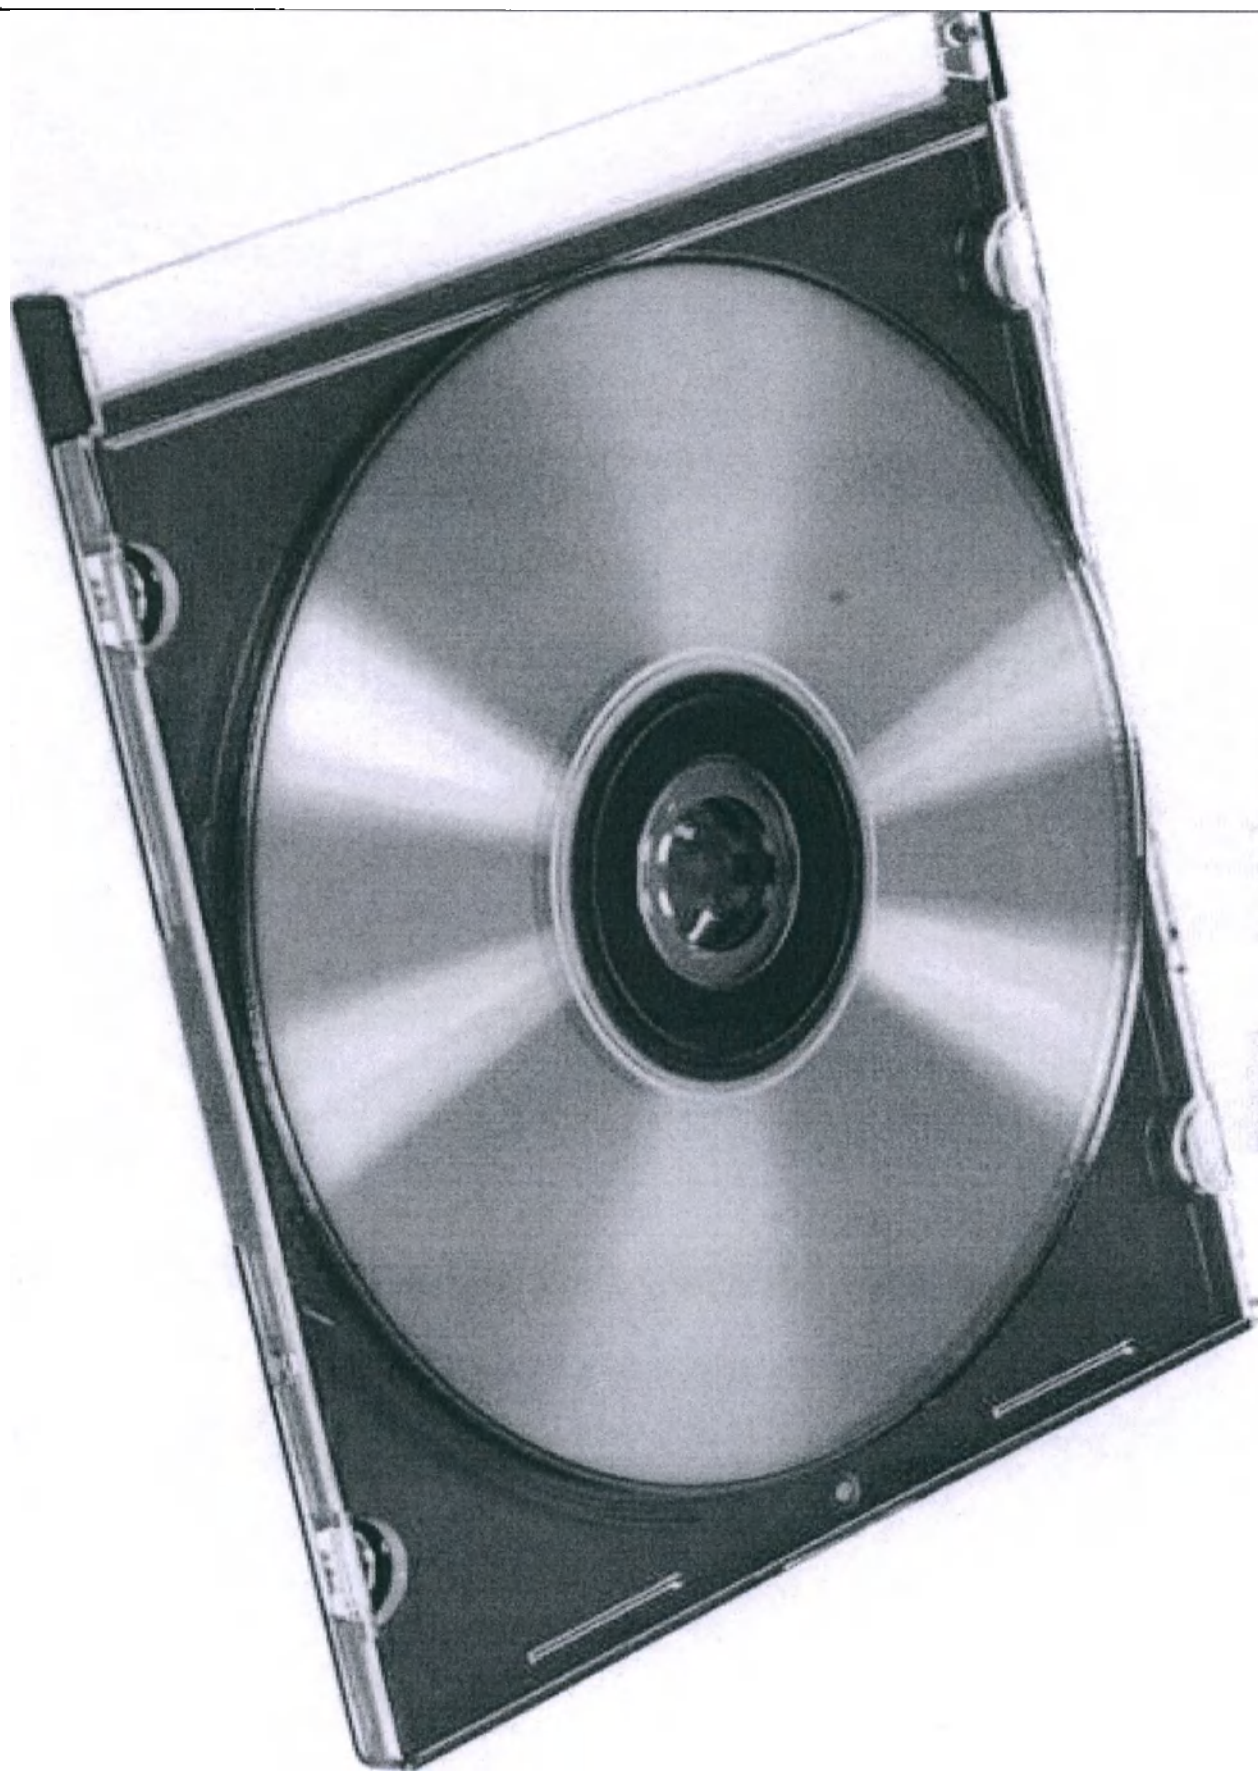


13а. Программное обеспечение «Clinical QC» на ПЗУ, CD/DVD дисках, флеш-картах, USB-флеш-накопителях, виртуальном носителе: 13.1 Программное обеспечение «Clinical QC» на CD/DVD дисках

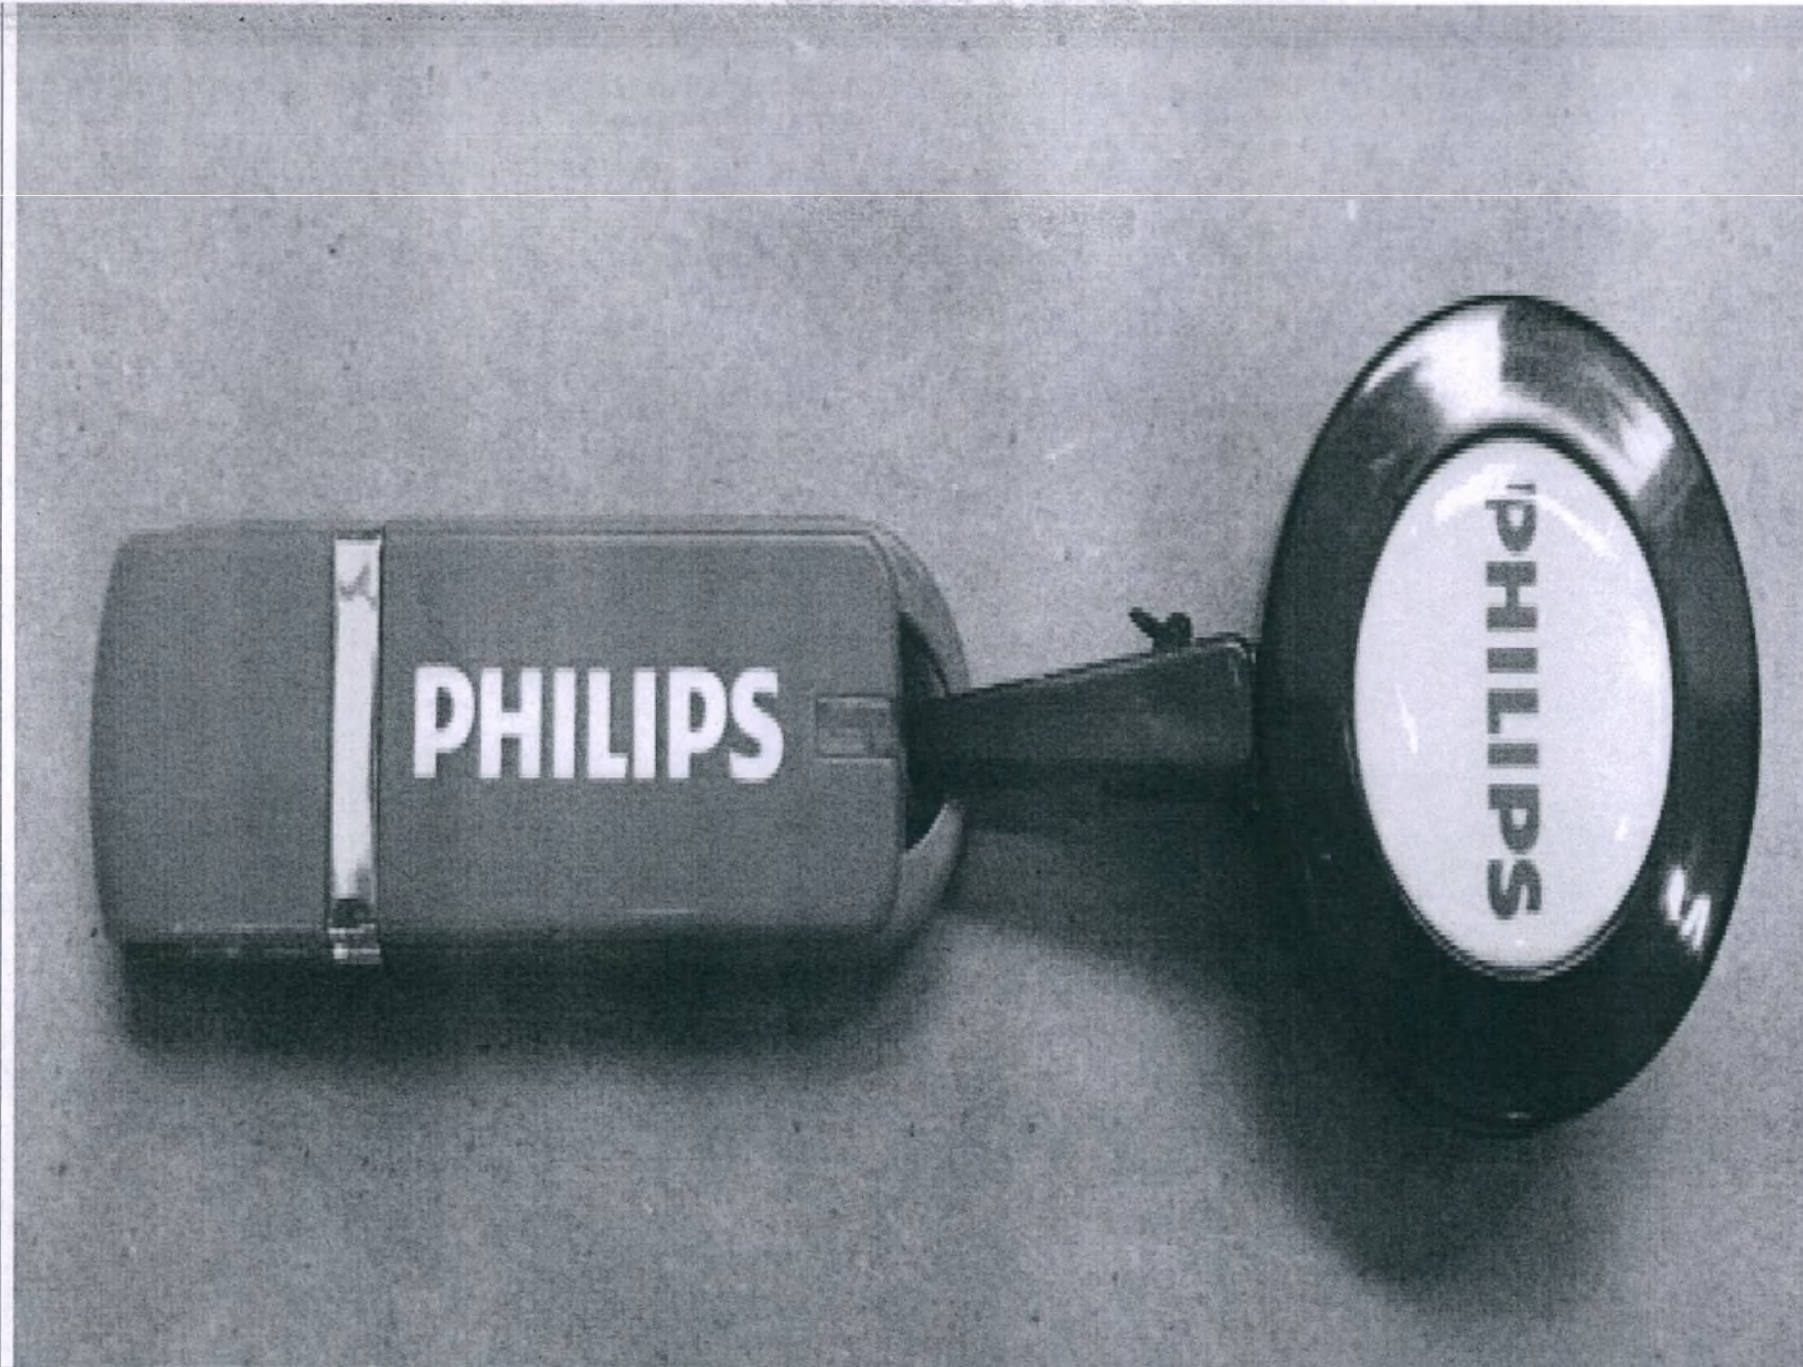


136. Программное обеспечение «Clinical QC» на ПЗУ, CD/DVD дисках, флеш-картах, USB-флеш-накопителях, виртуальном носителе:
13.2 Программное обеспечение «Clinical QC» на USB-флеш-накопителе

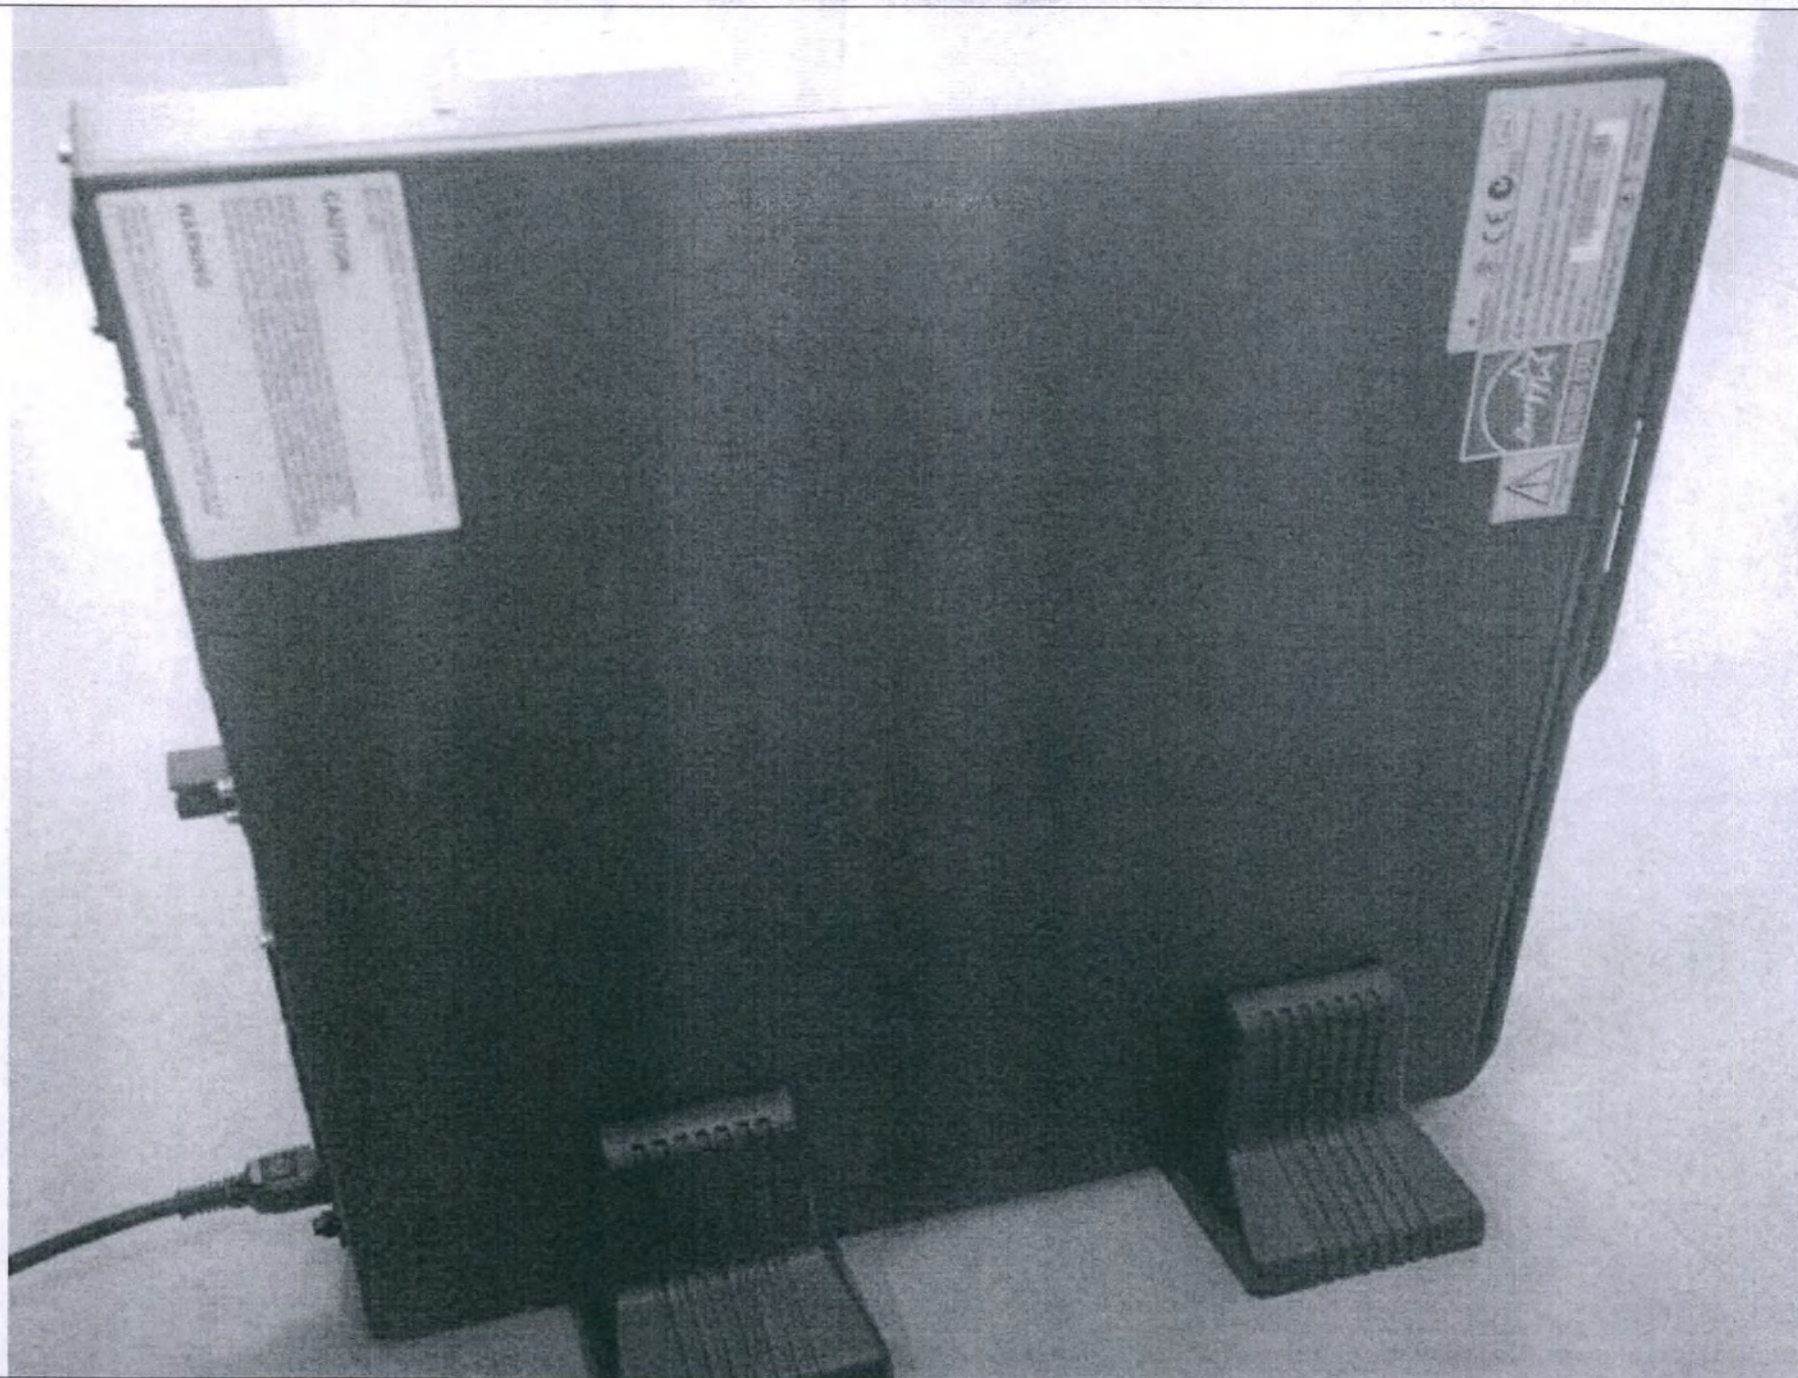


1. Источник бесперебойного питания

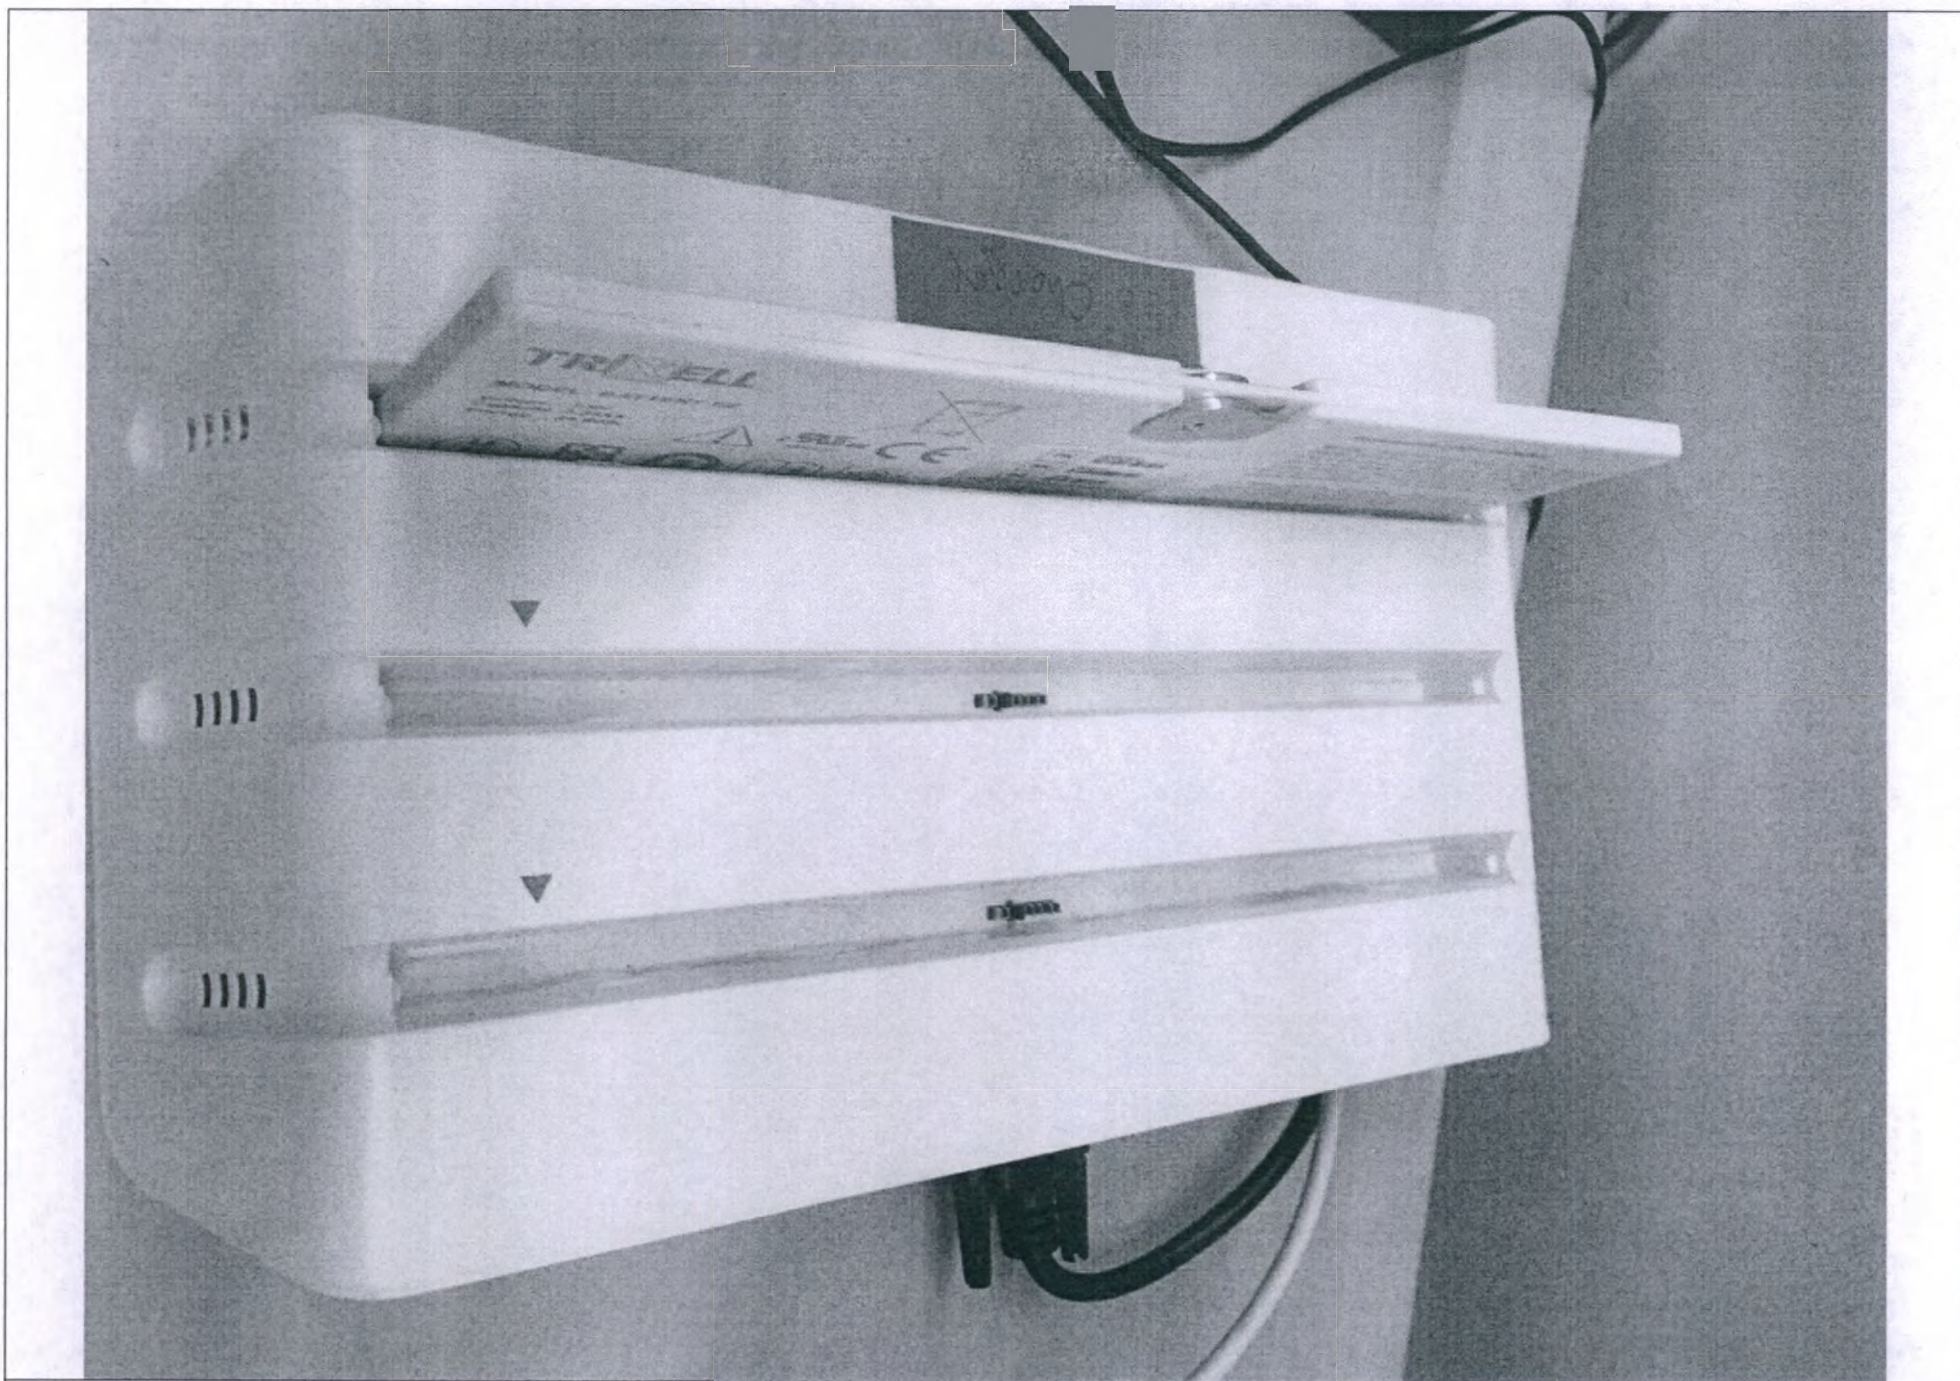

2а. Зарядное устройство для аккумулятора детектора, не более 2х шт.

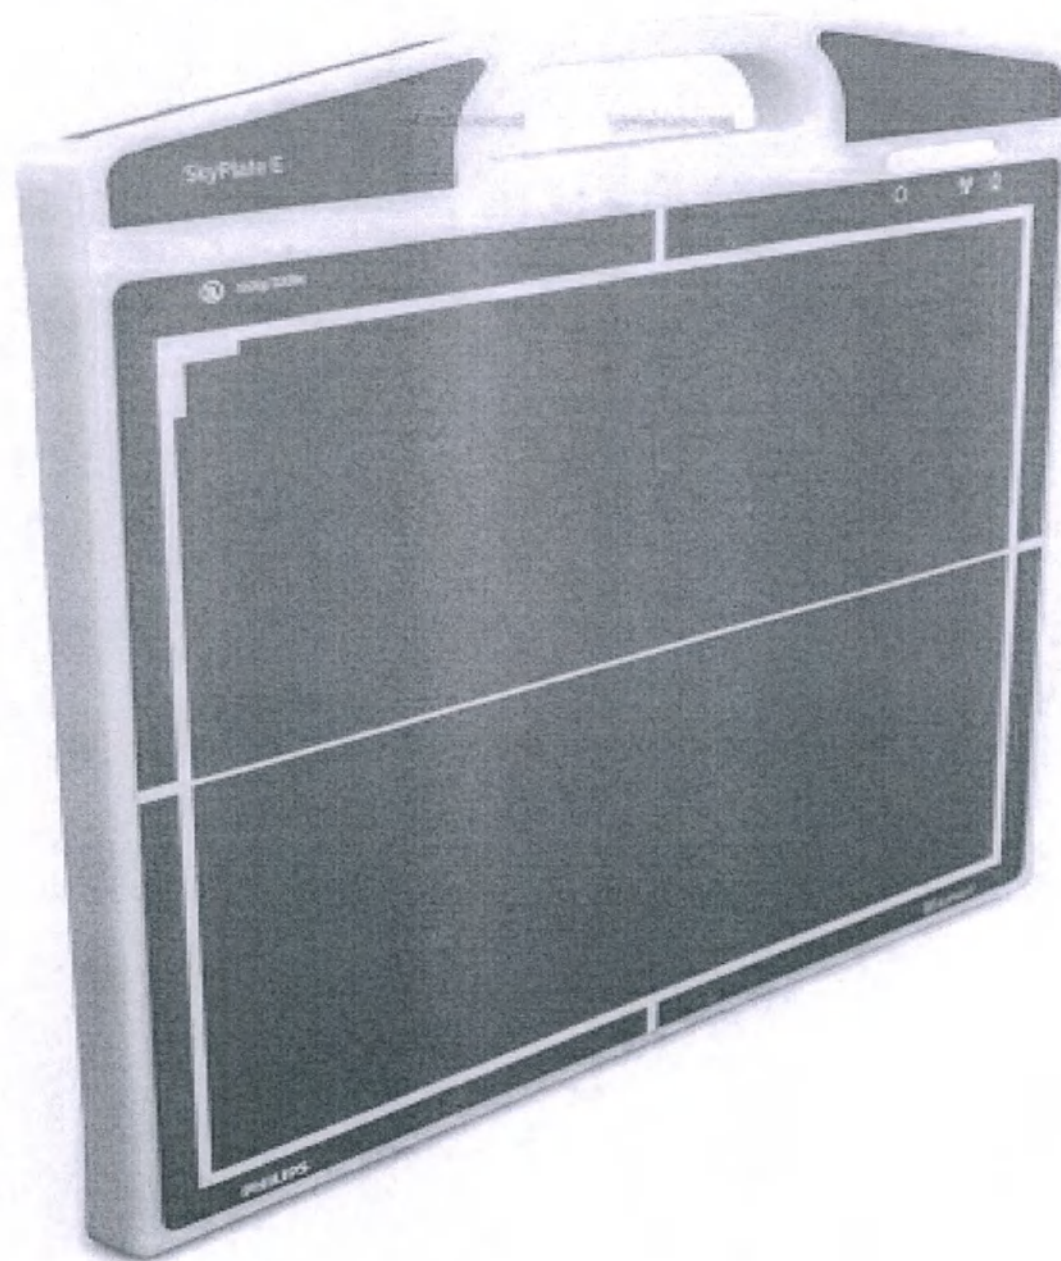


3а. Решетка защелкивающаяся вертикальная, не более 2х шт .

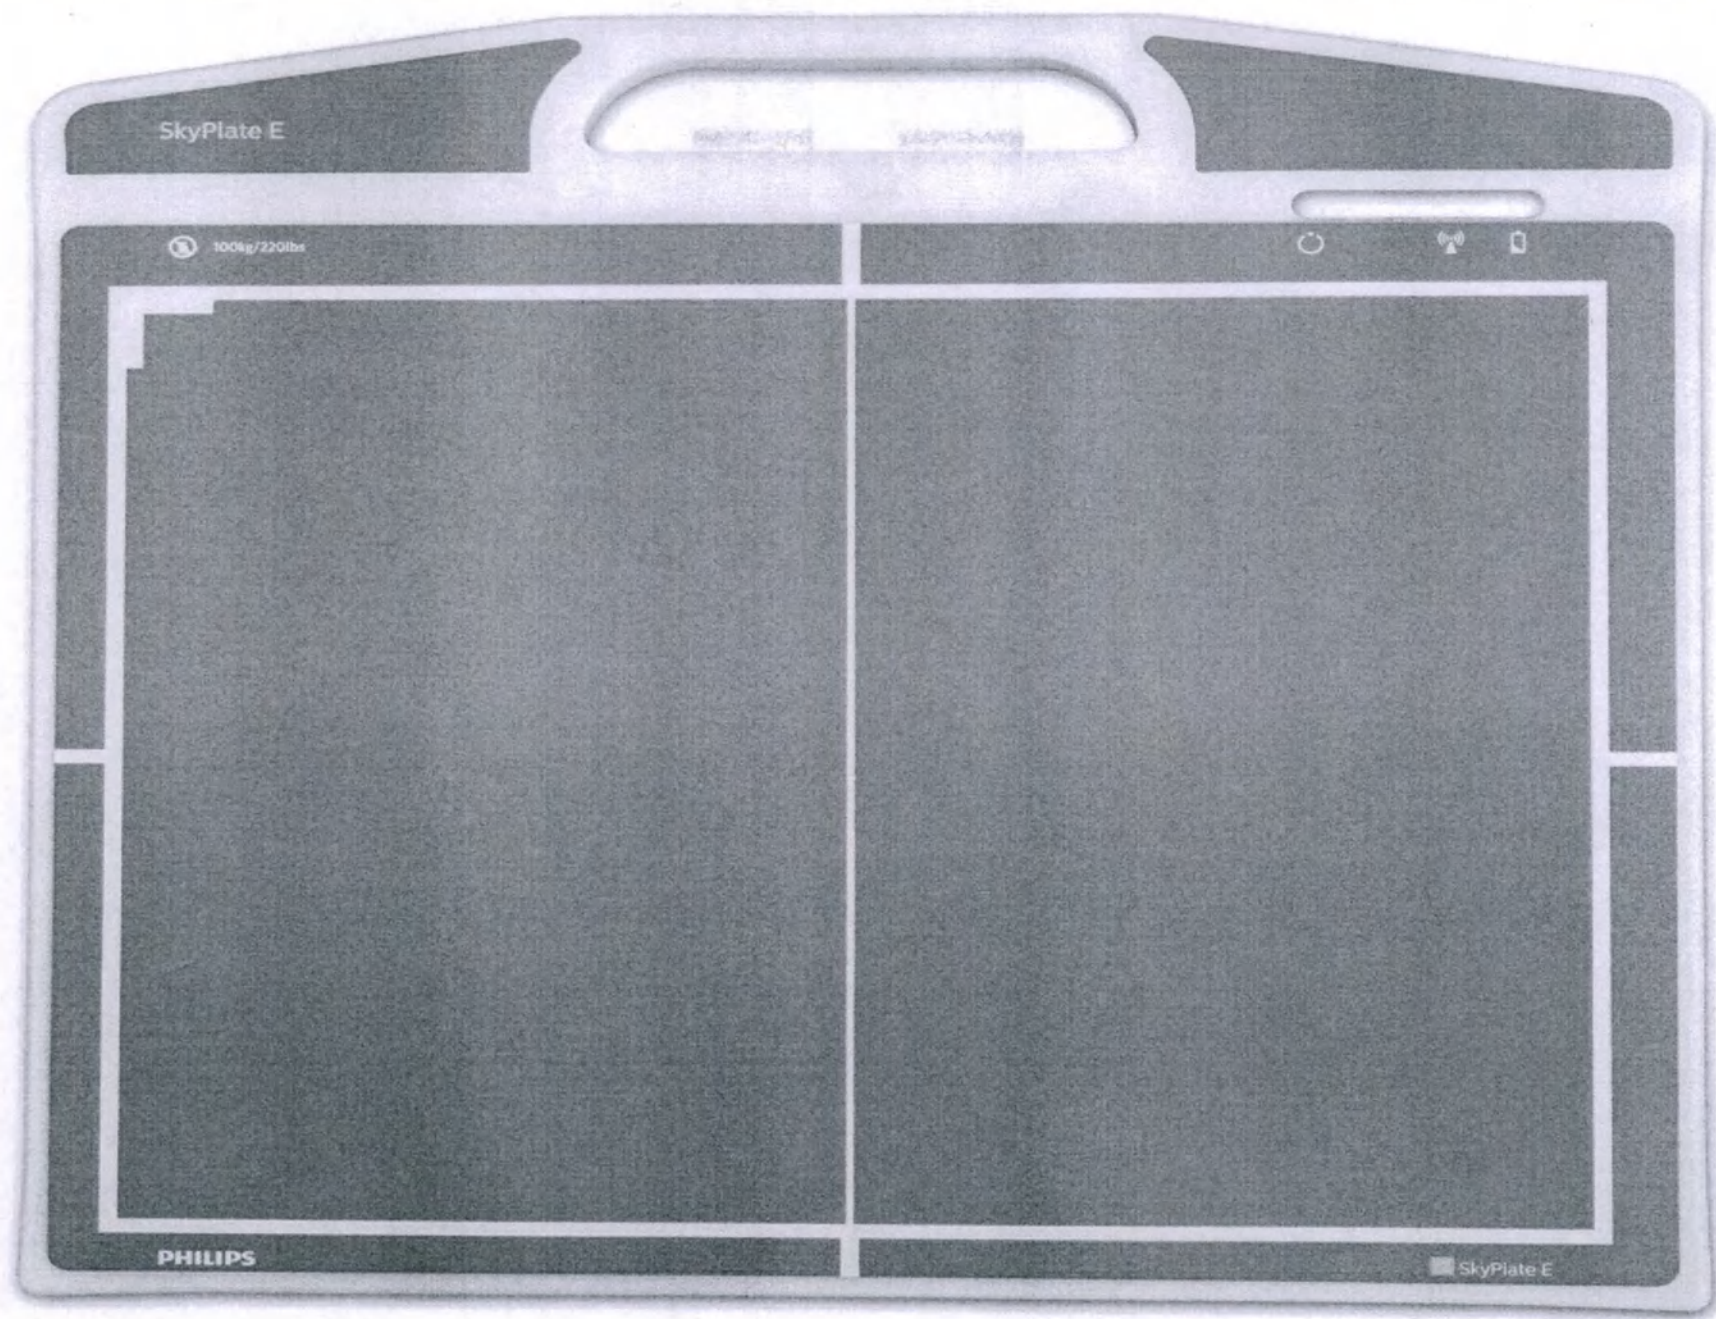


4а. Решетка защелкивающаяся горизонтальная, не более 2х шт.




5а. Аккумулятор детектора, не более 4х шт.

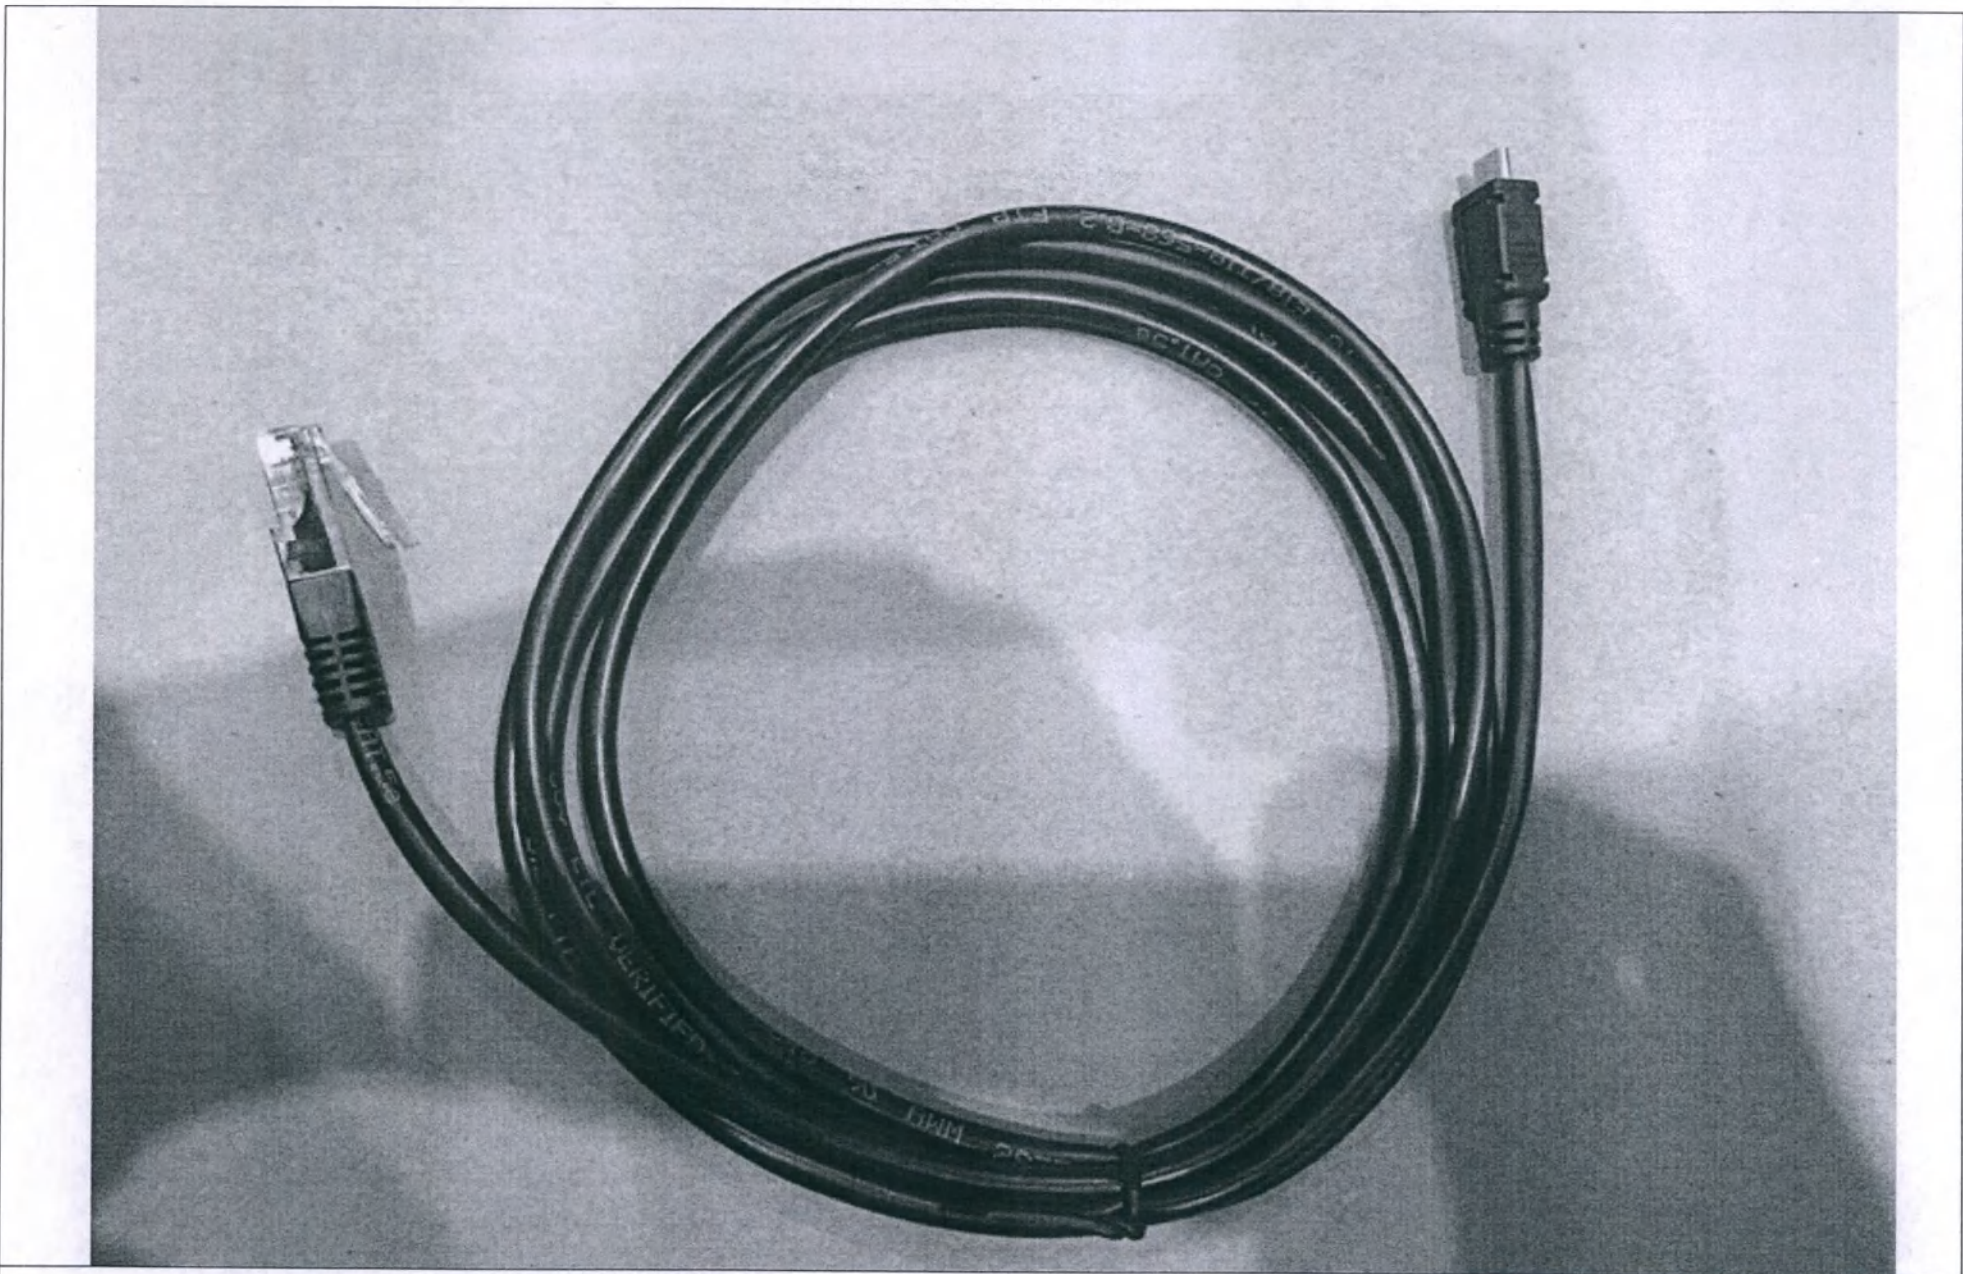


6. Кабель резервный (для детектора).

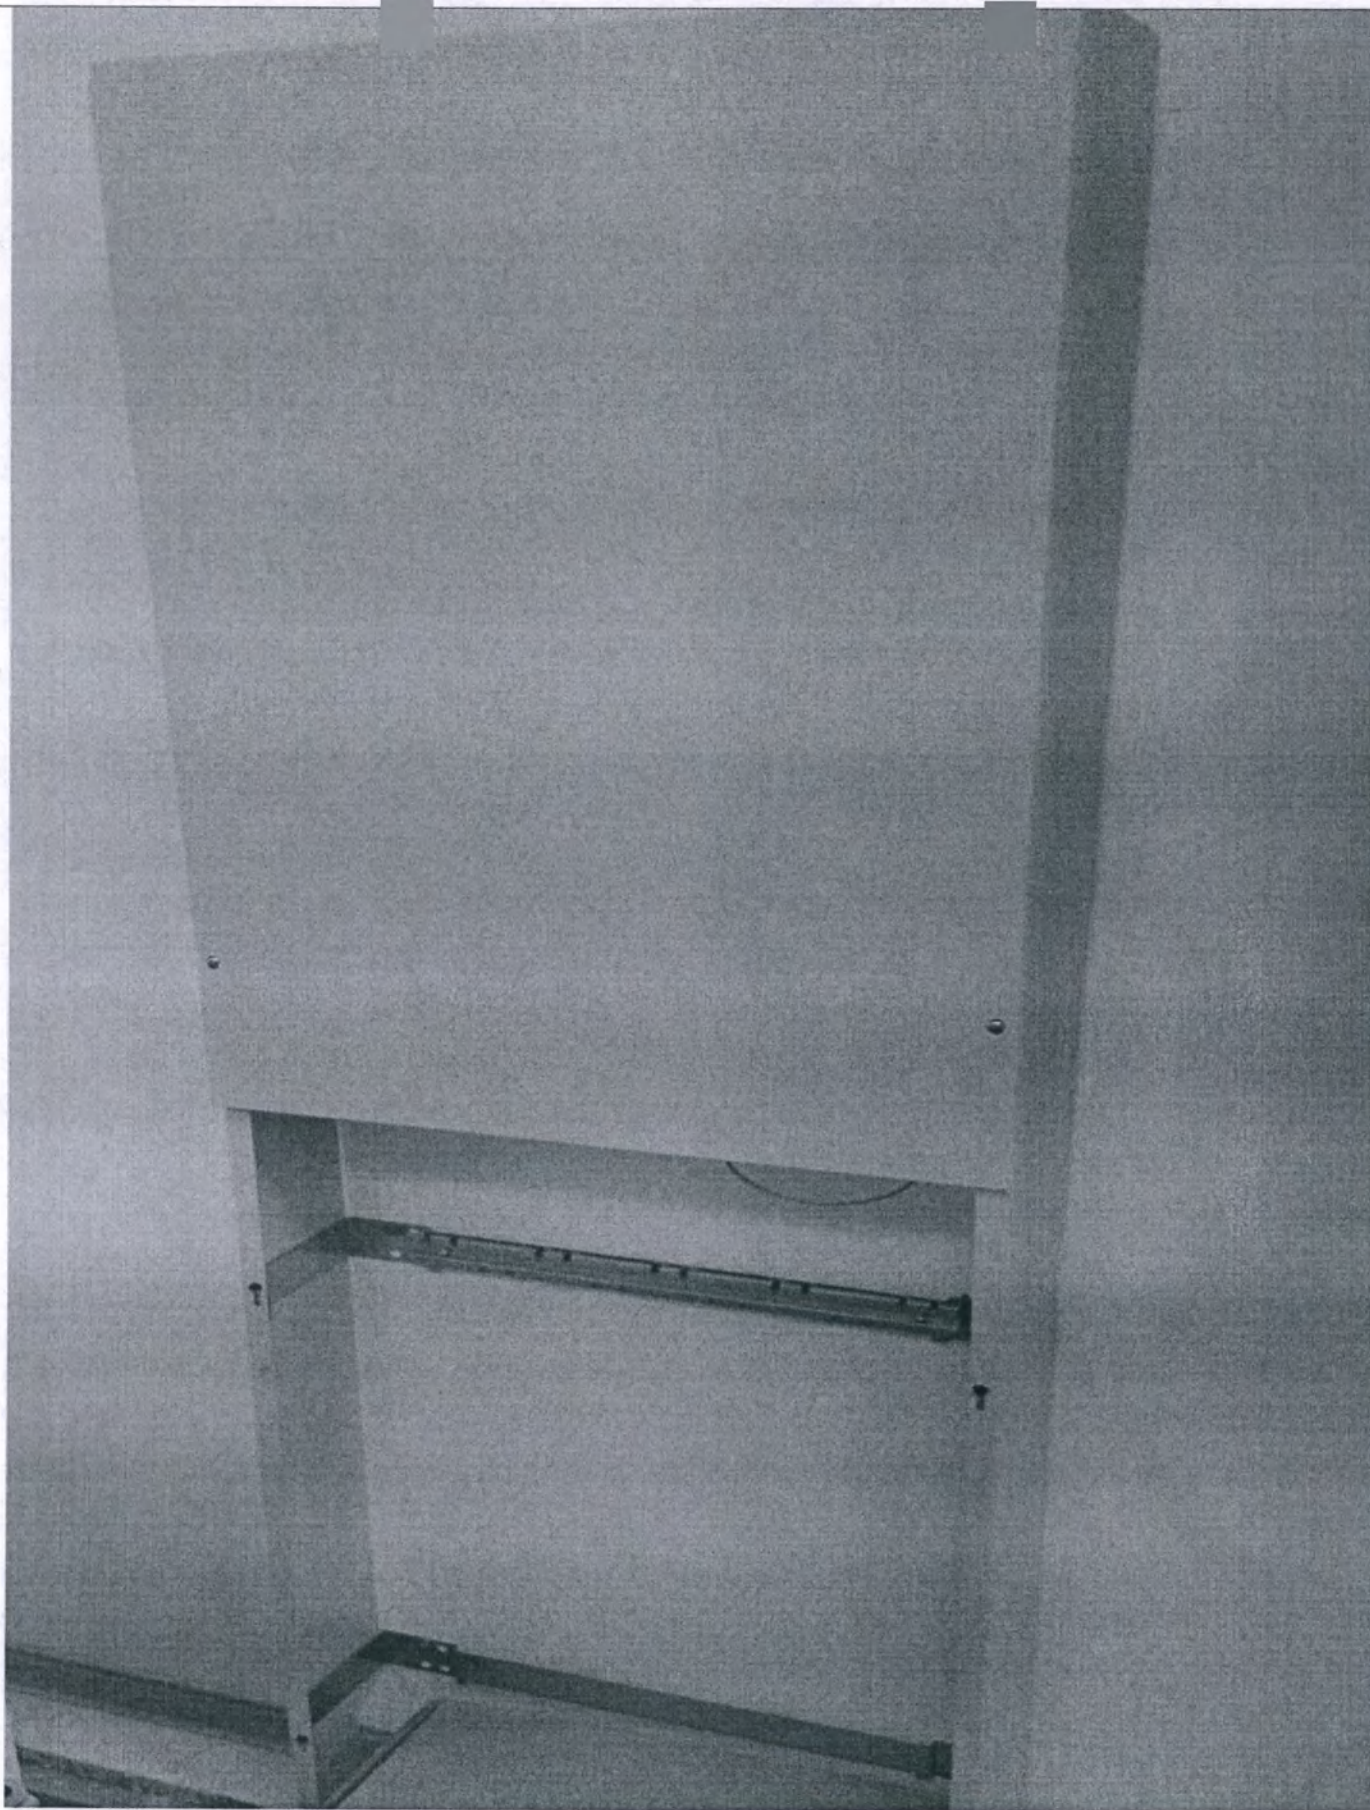


7а. Настенная распределительная коробка.

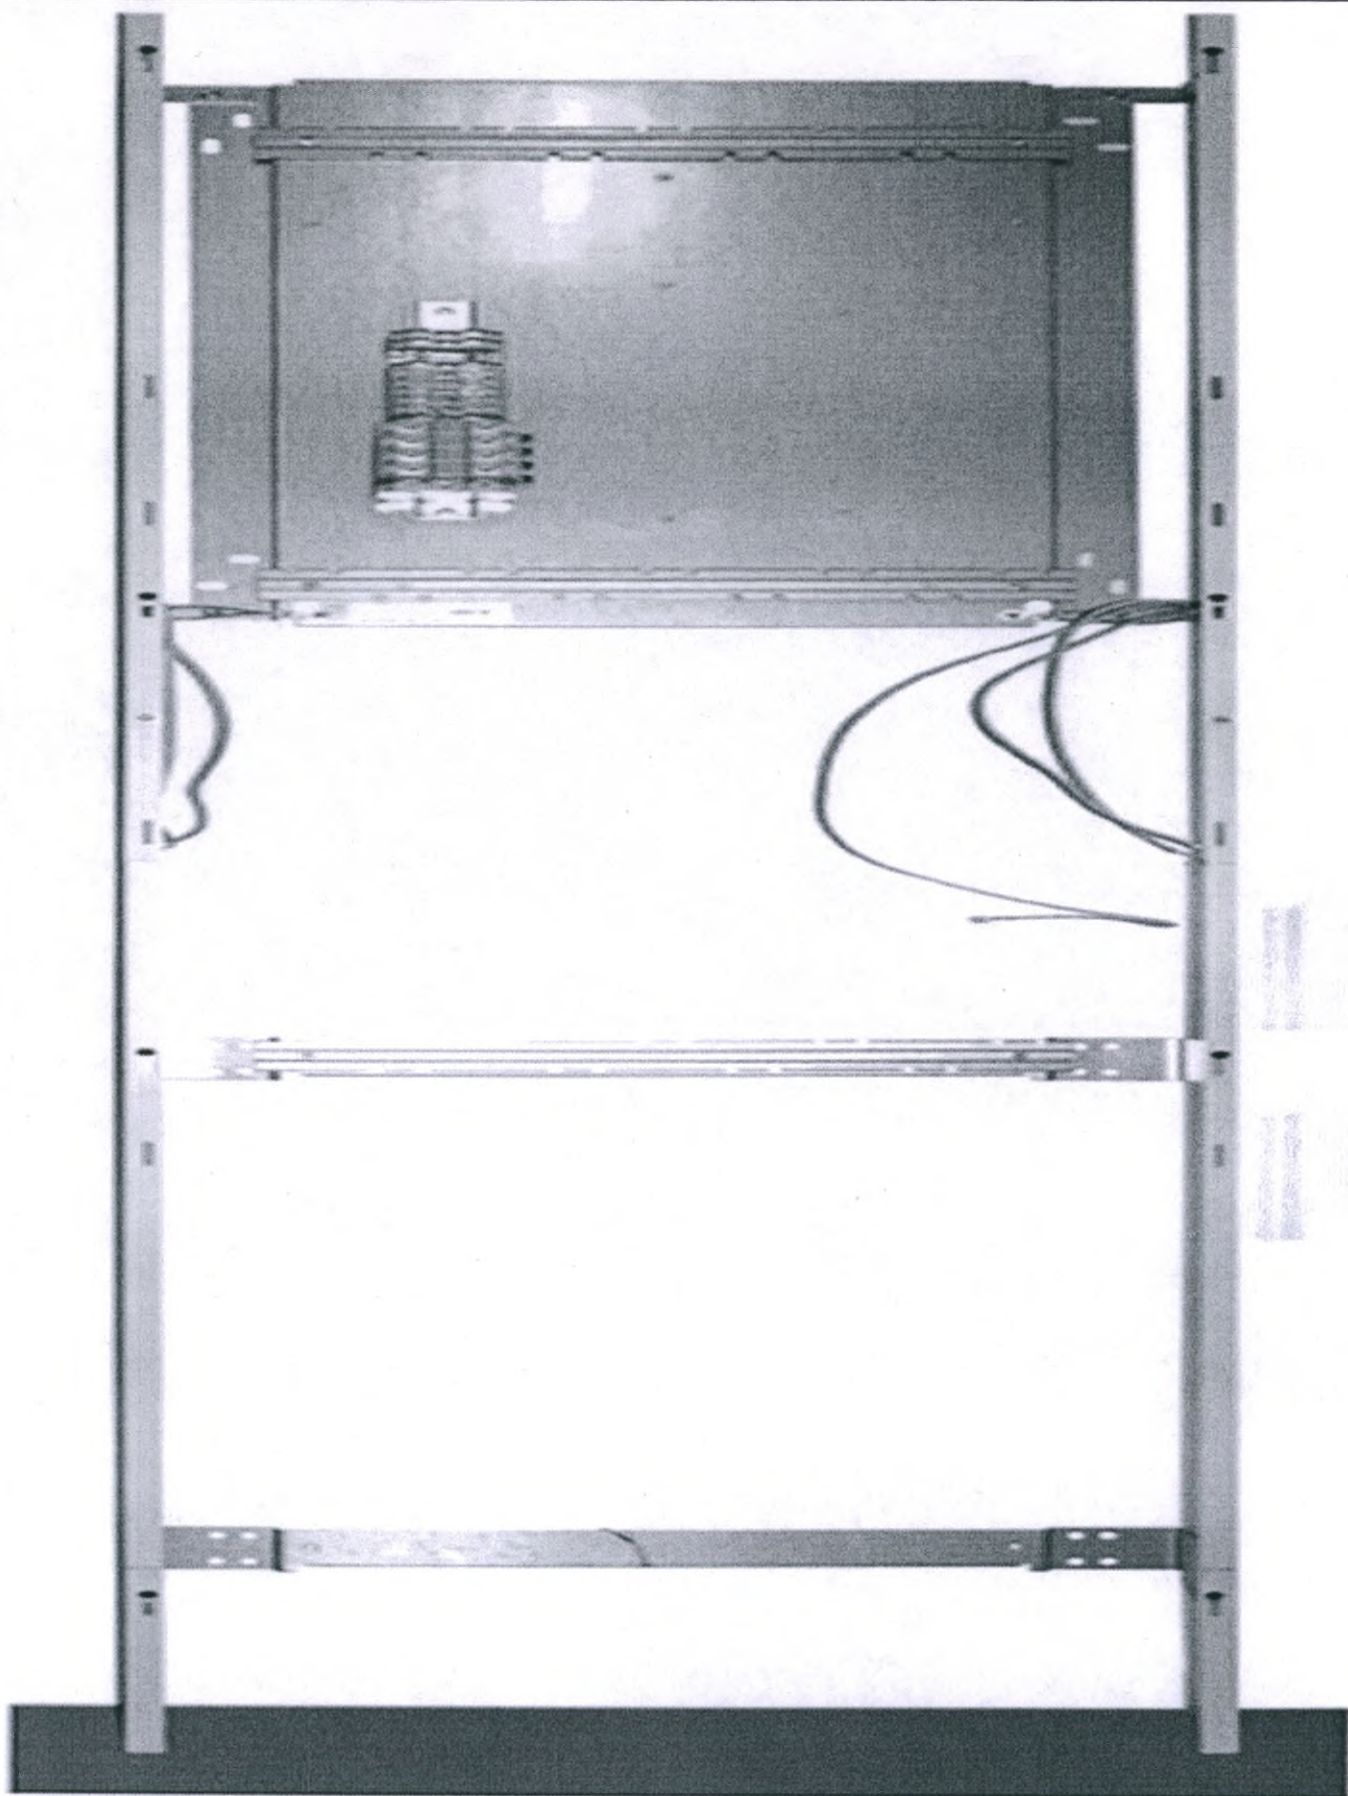


76. Настенная распределительная коробка.

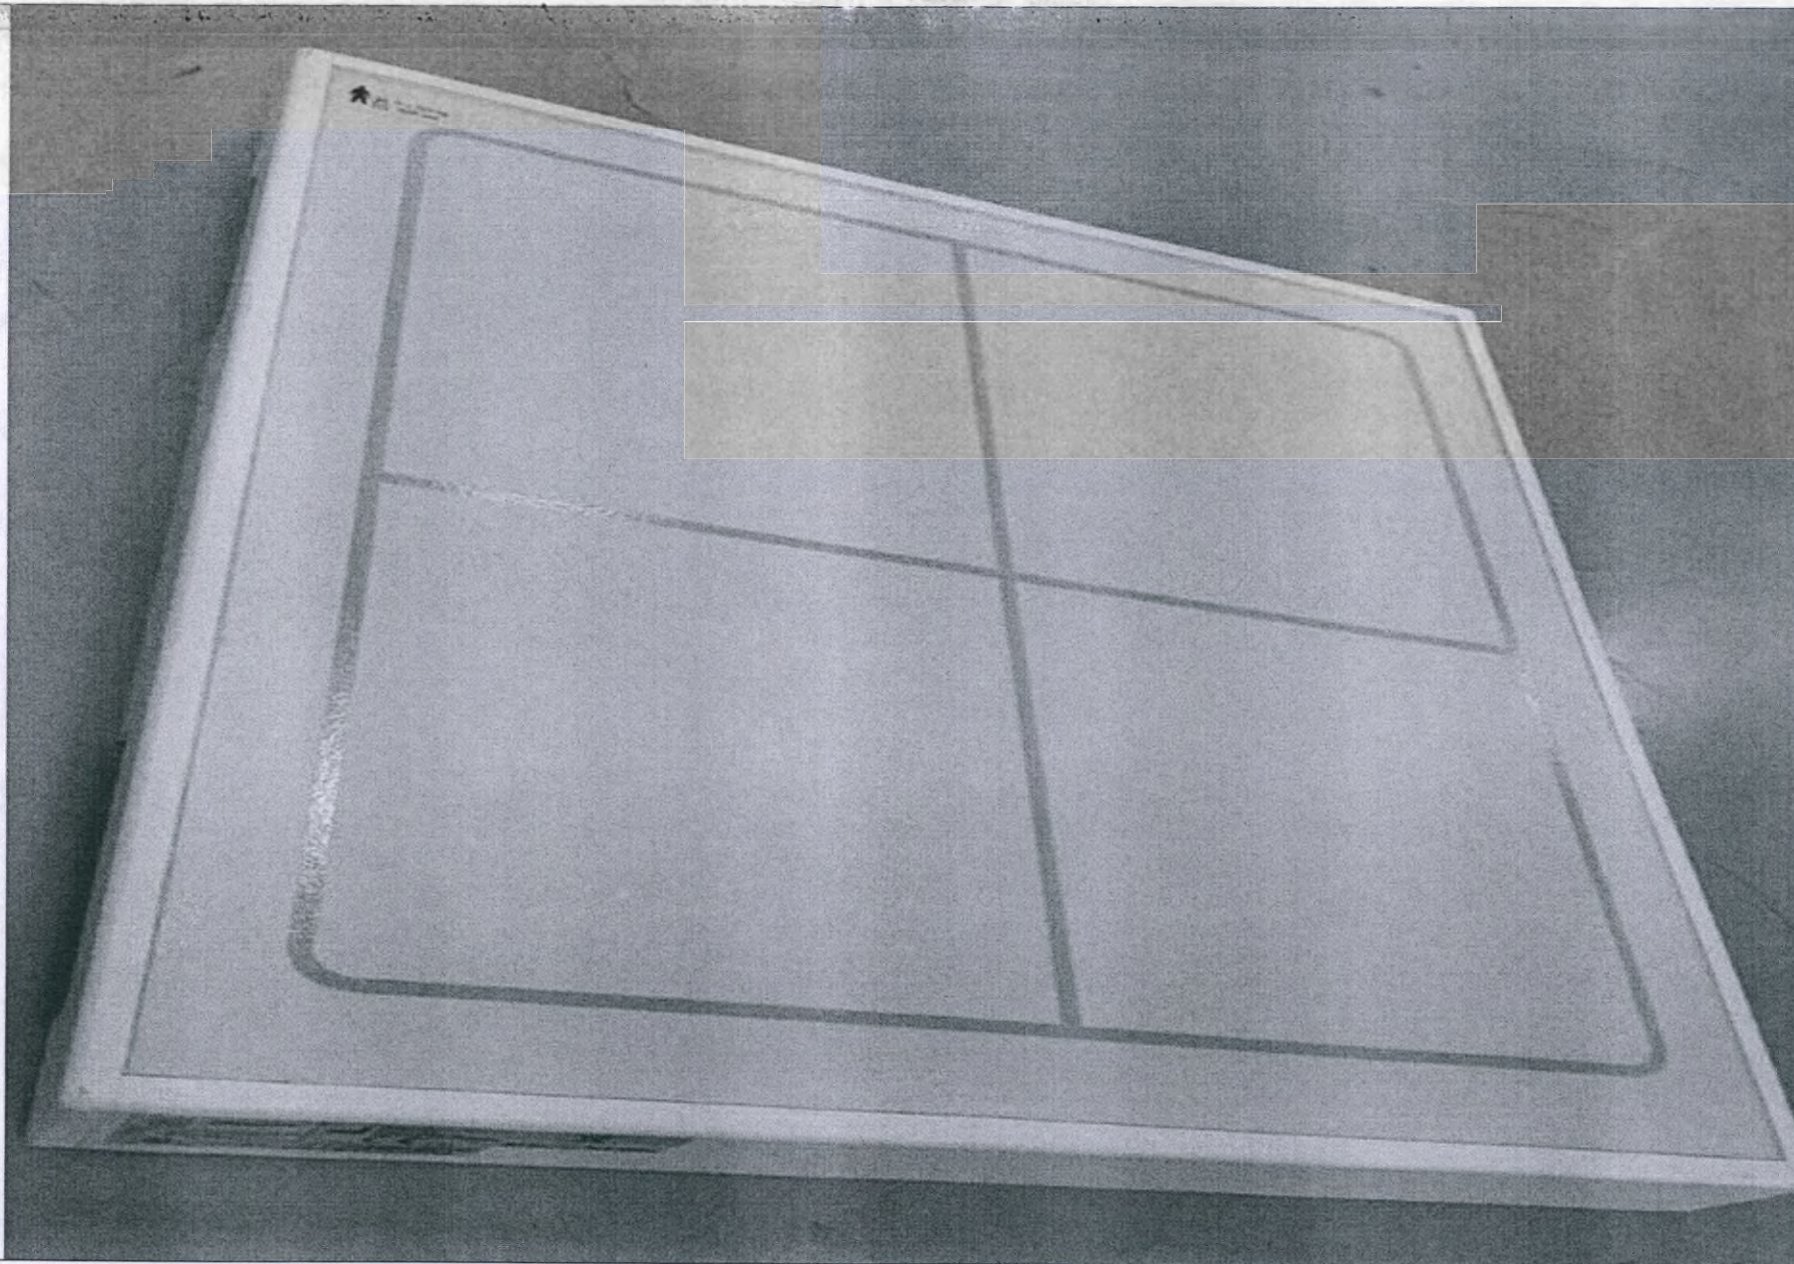

8. Защитная панель переносного детектора.

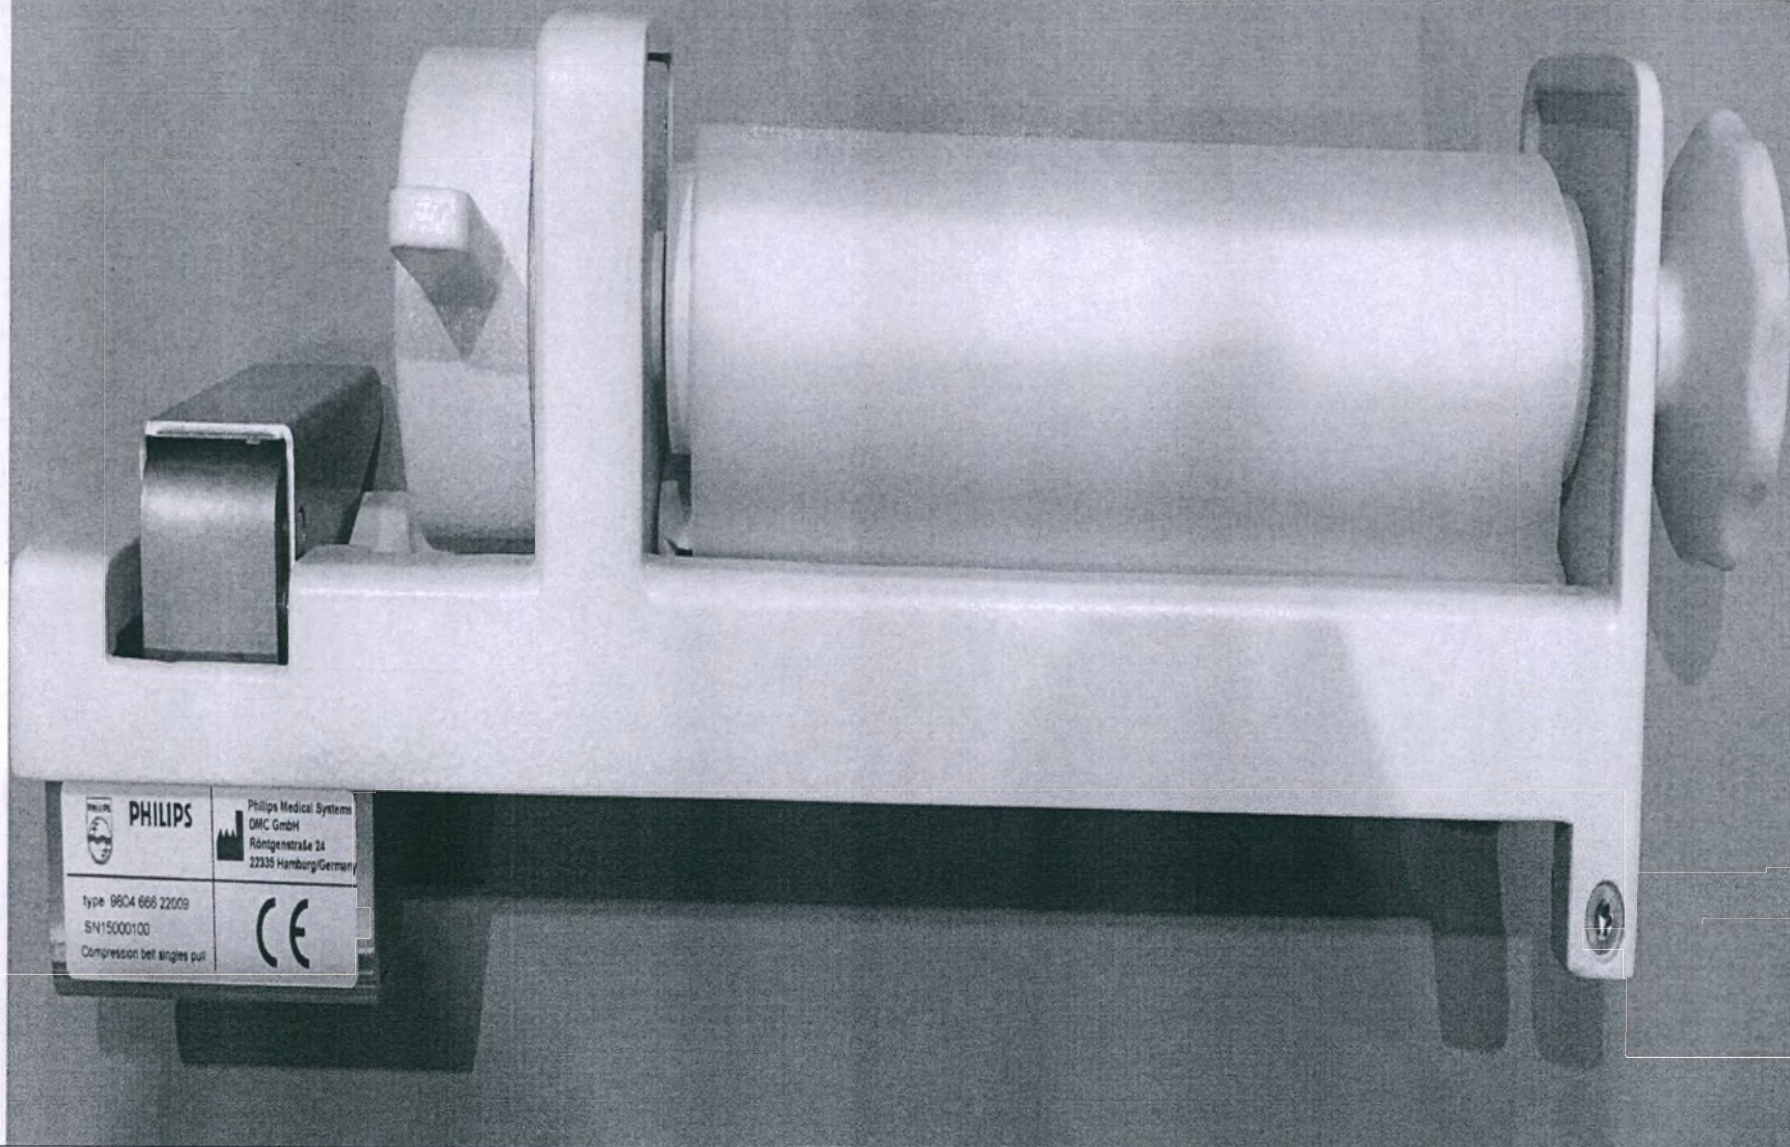


9. Лента компрессионная.

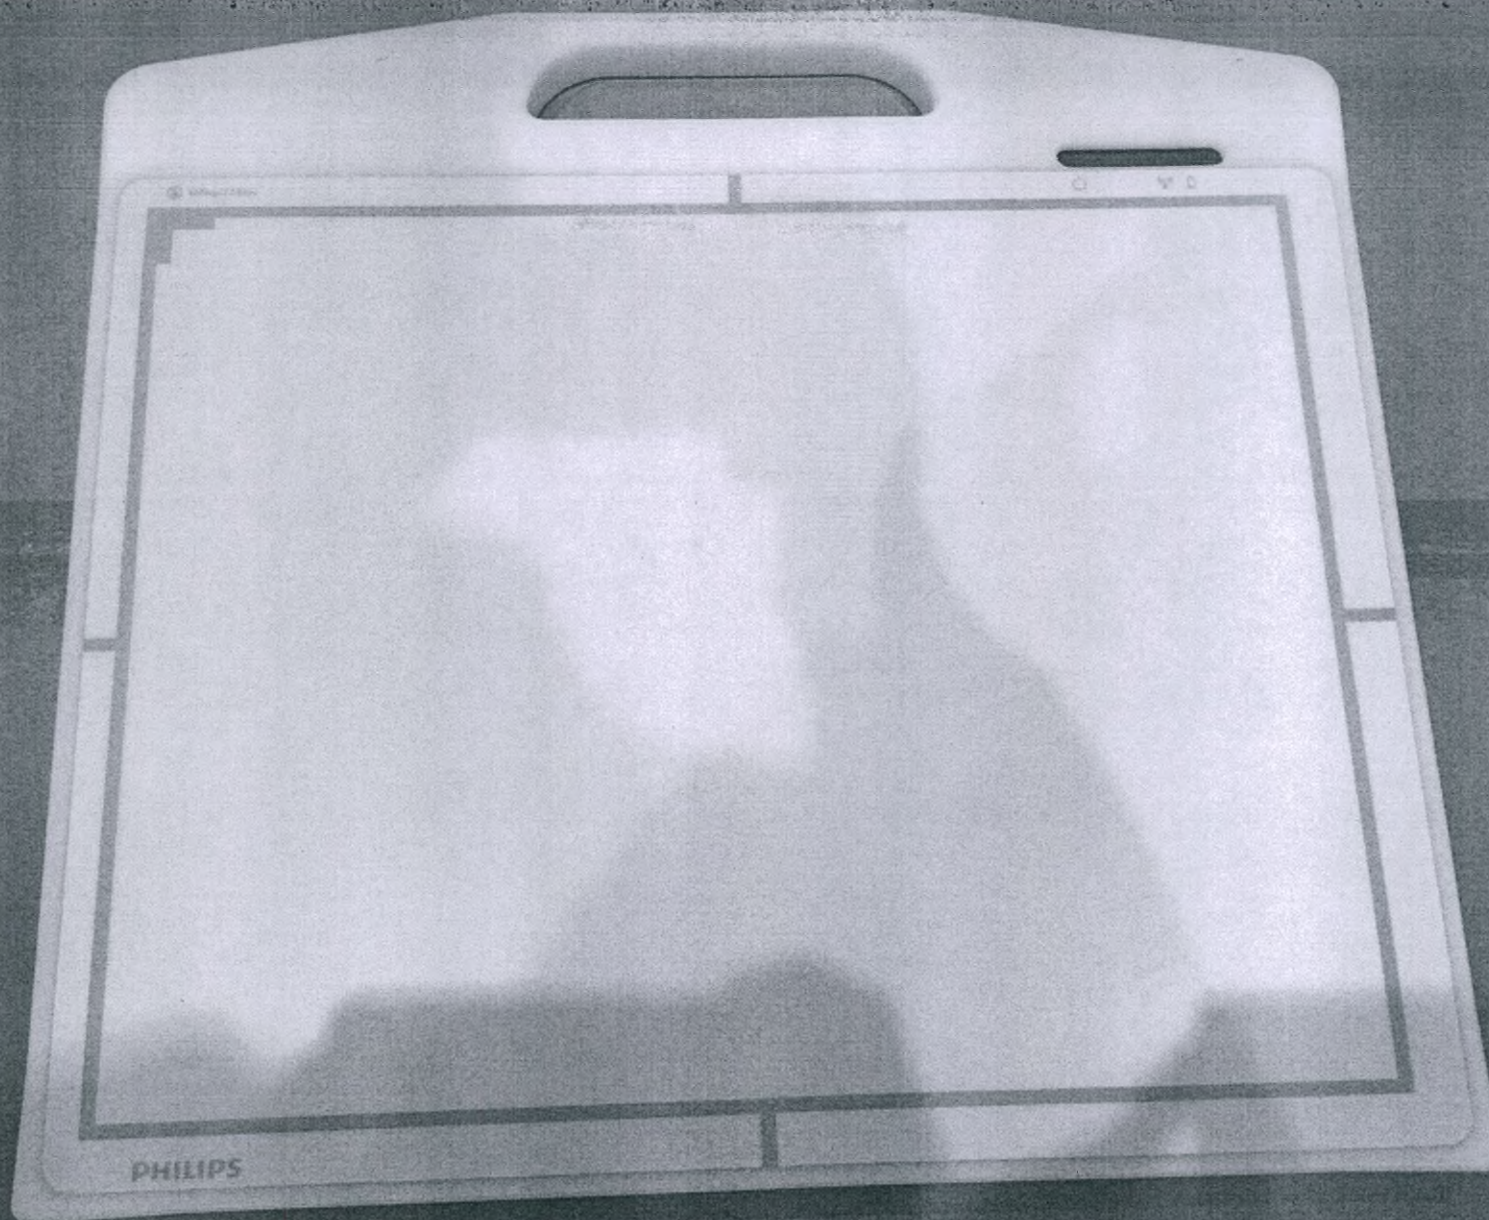


10. Рукоятка детектора, не более 2х шт.




11. Рукоятки, не более 4х шт.

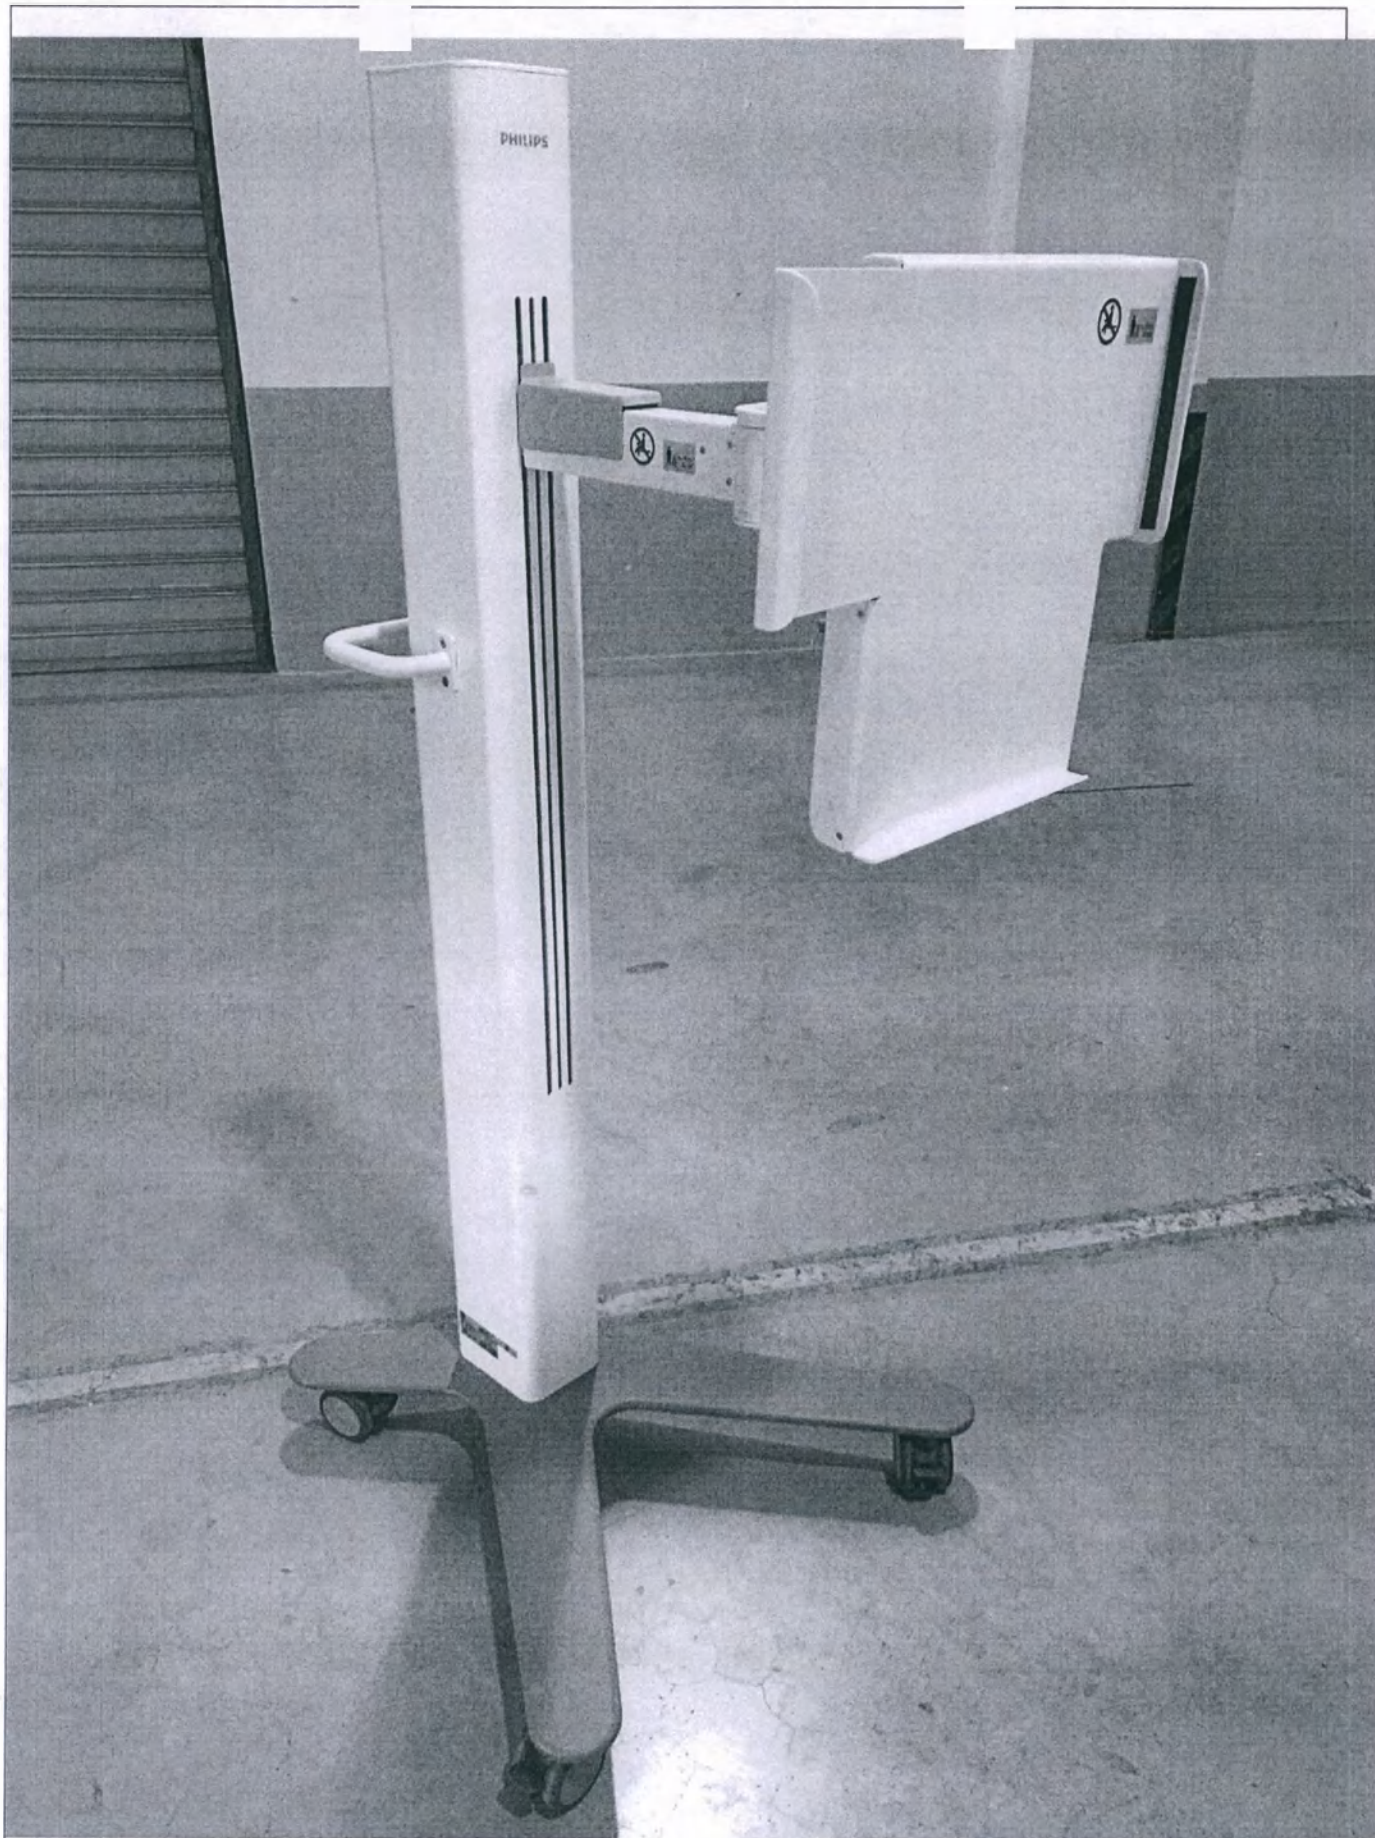


12. Мобильный держатель детектора.

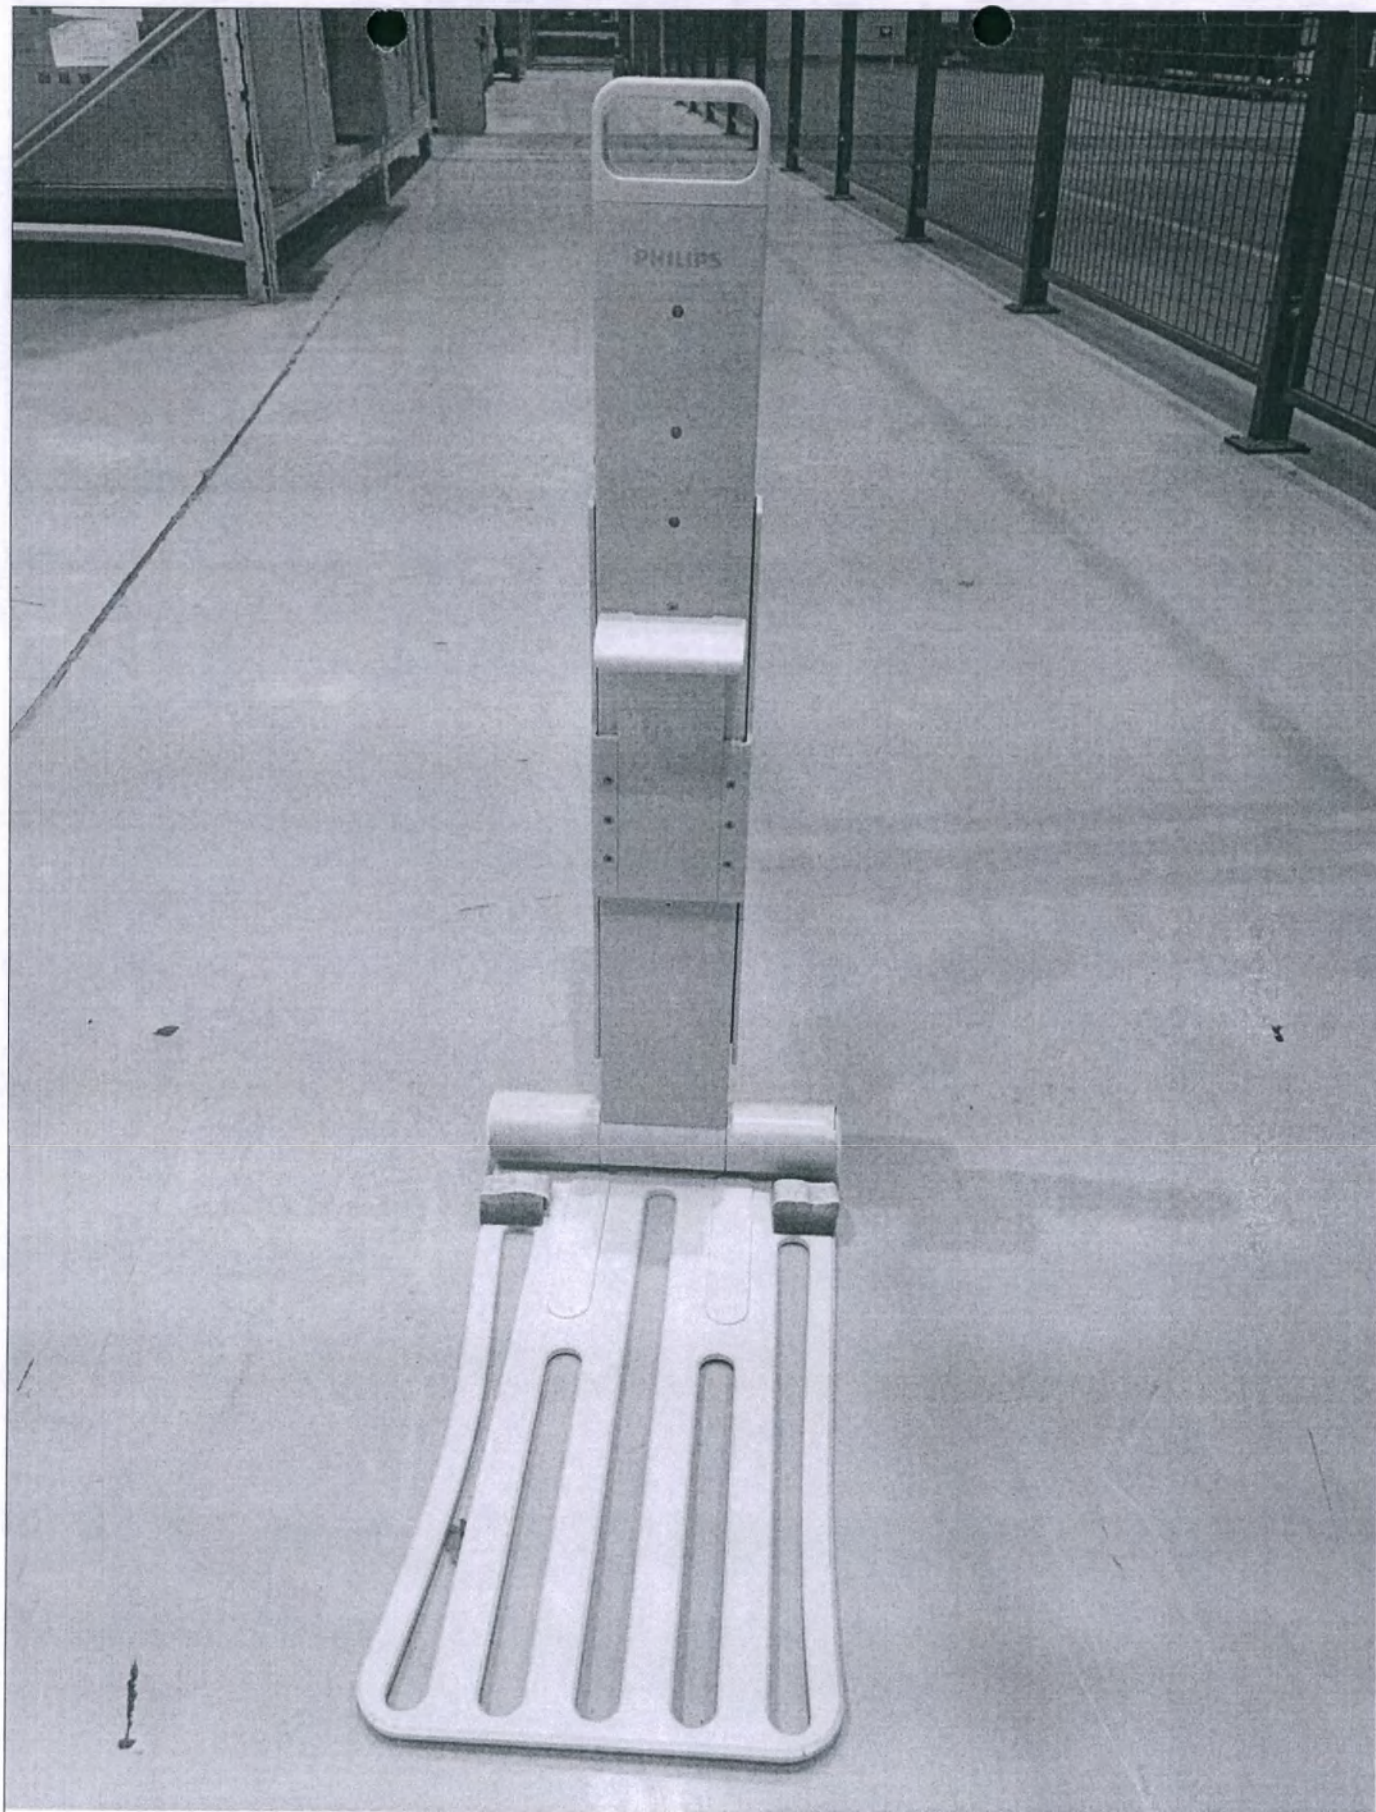

13. Прикроватный держатель переносного цифрового детектора, не более 2х шт.

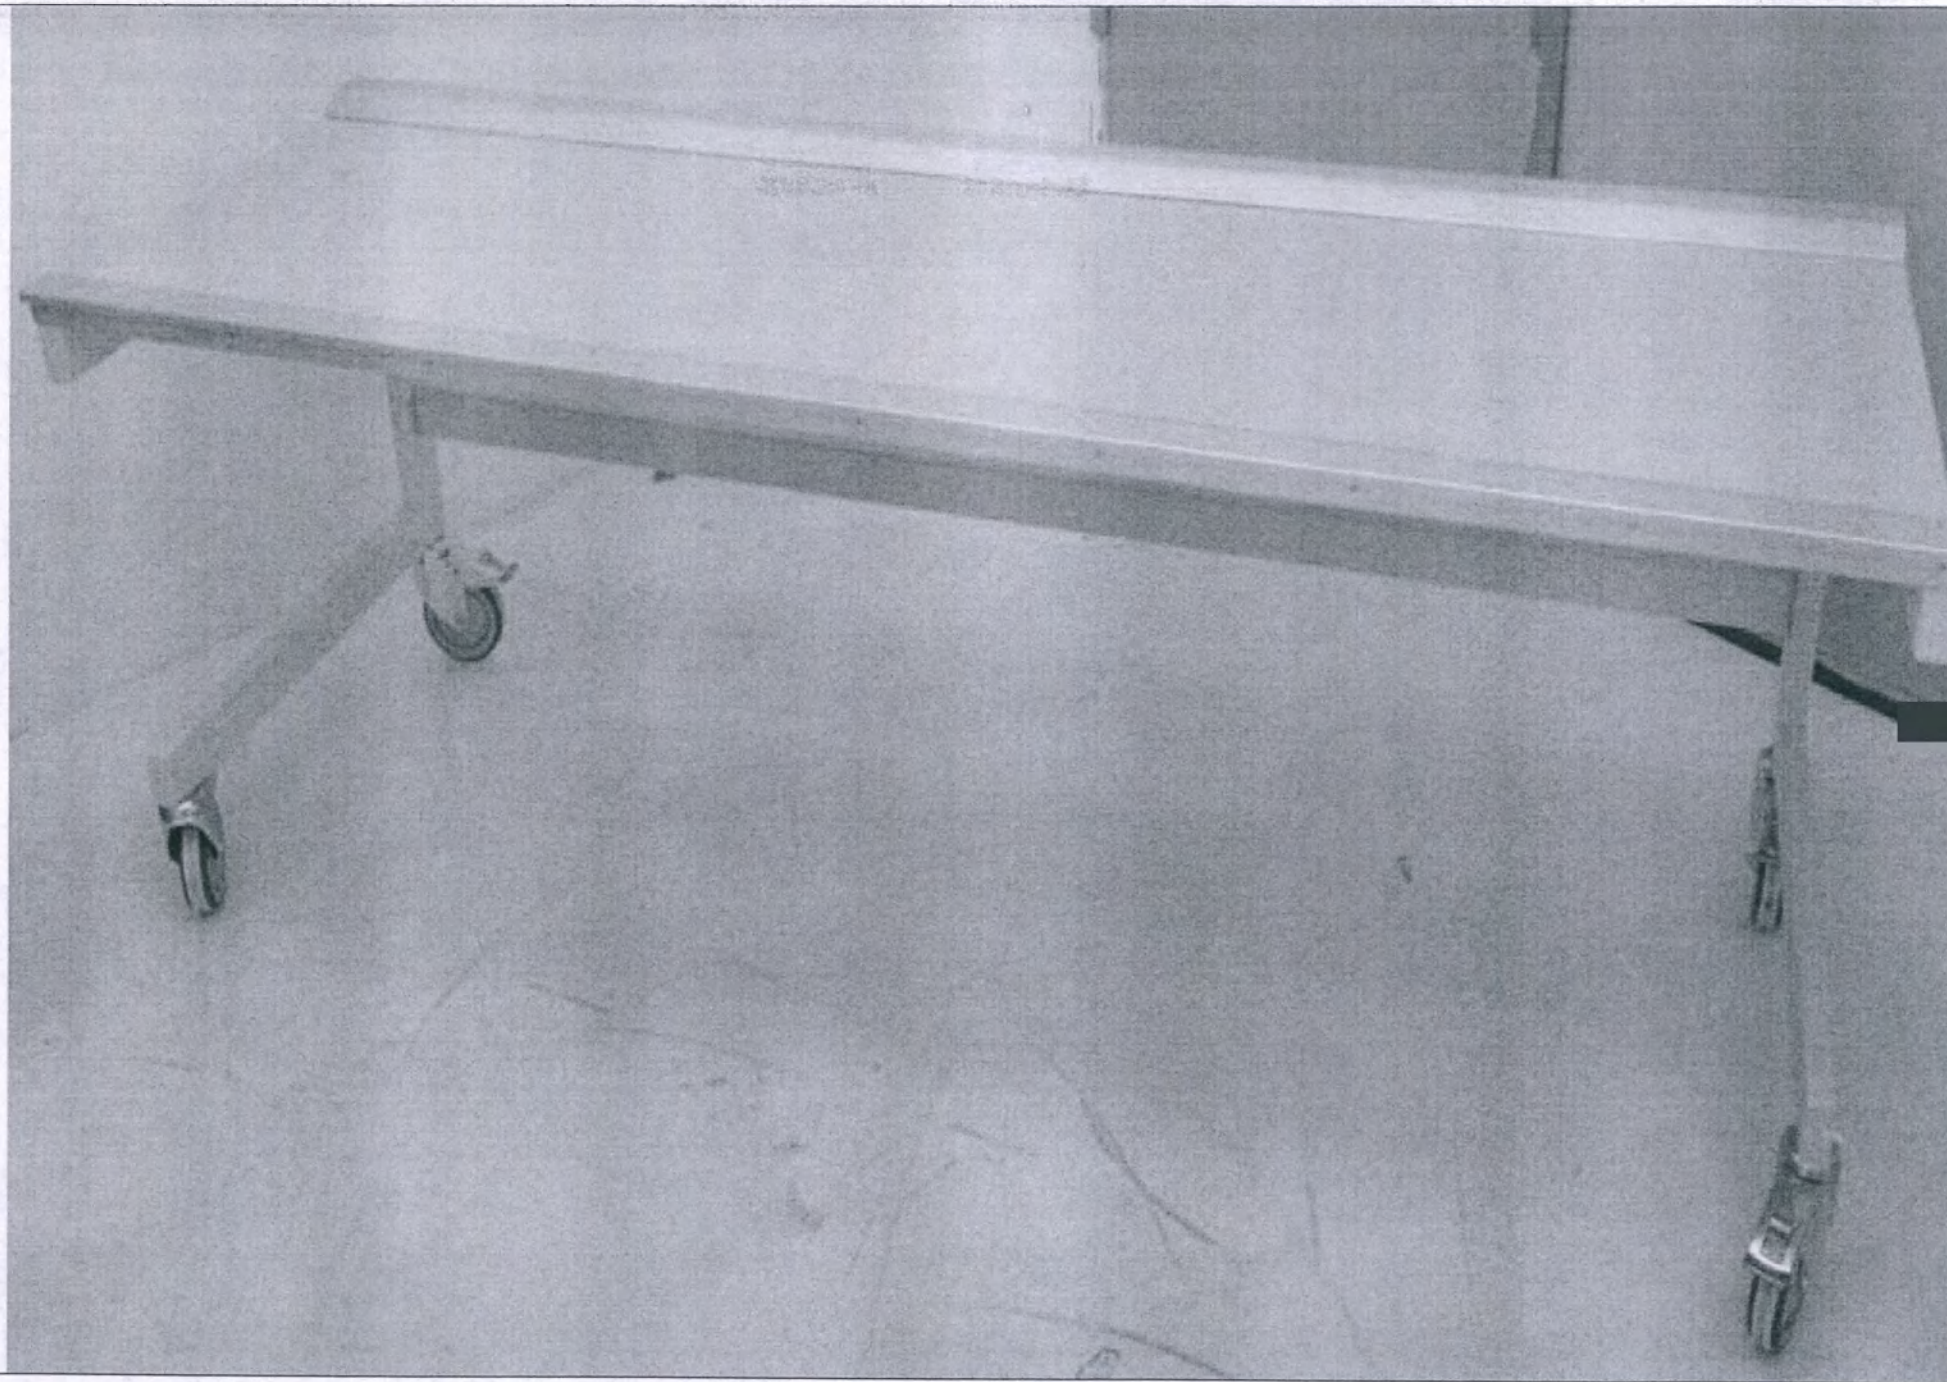


14. Тележка стола.

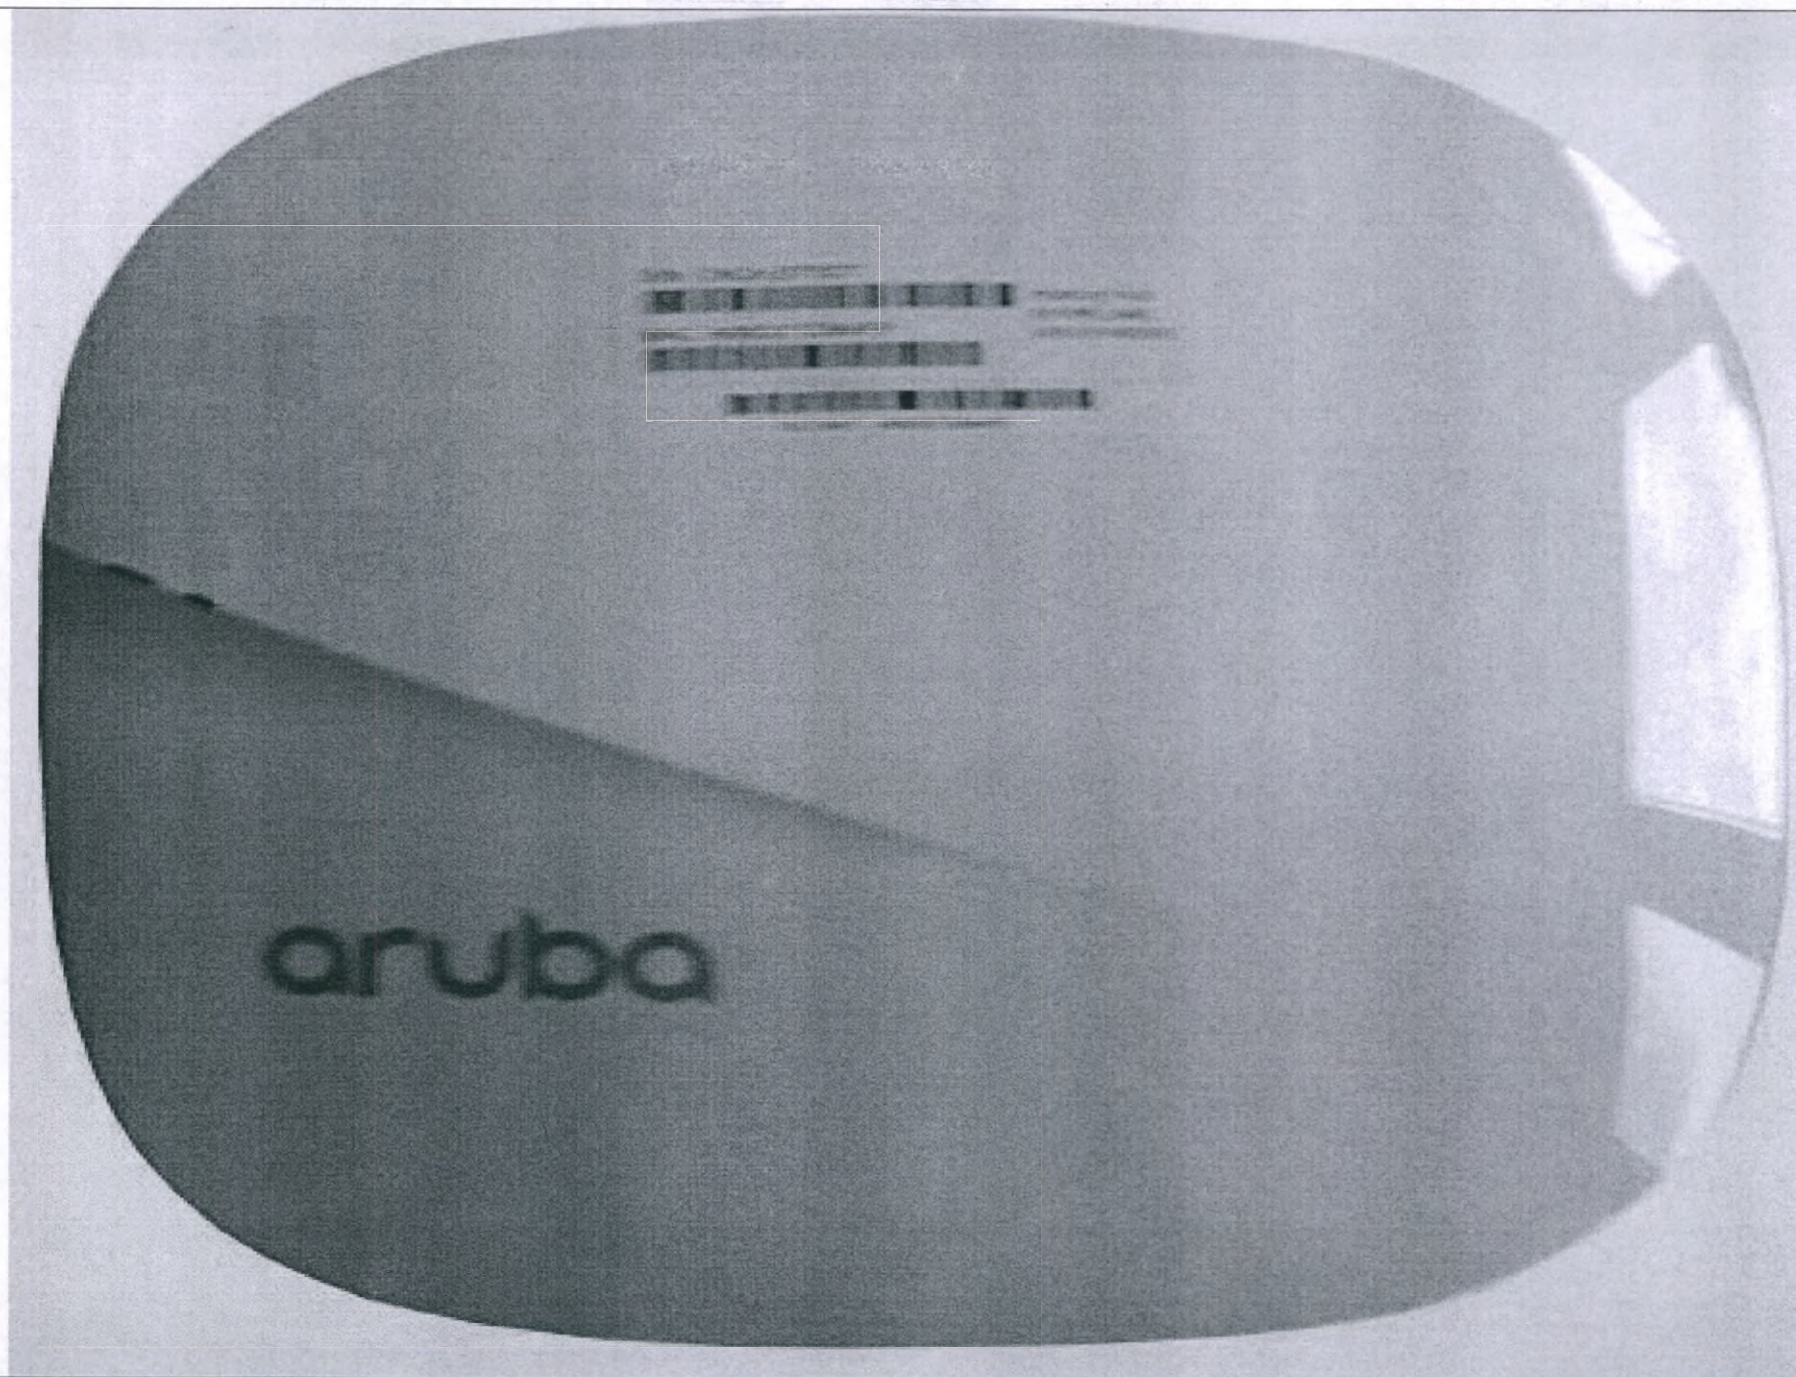


15a. Точка доступа.



156. Точка доступа.

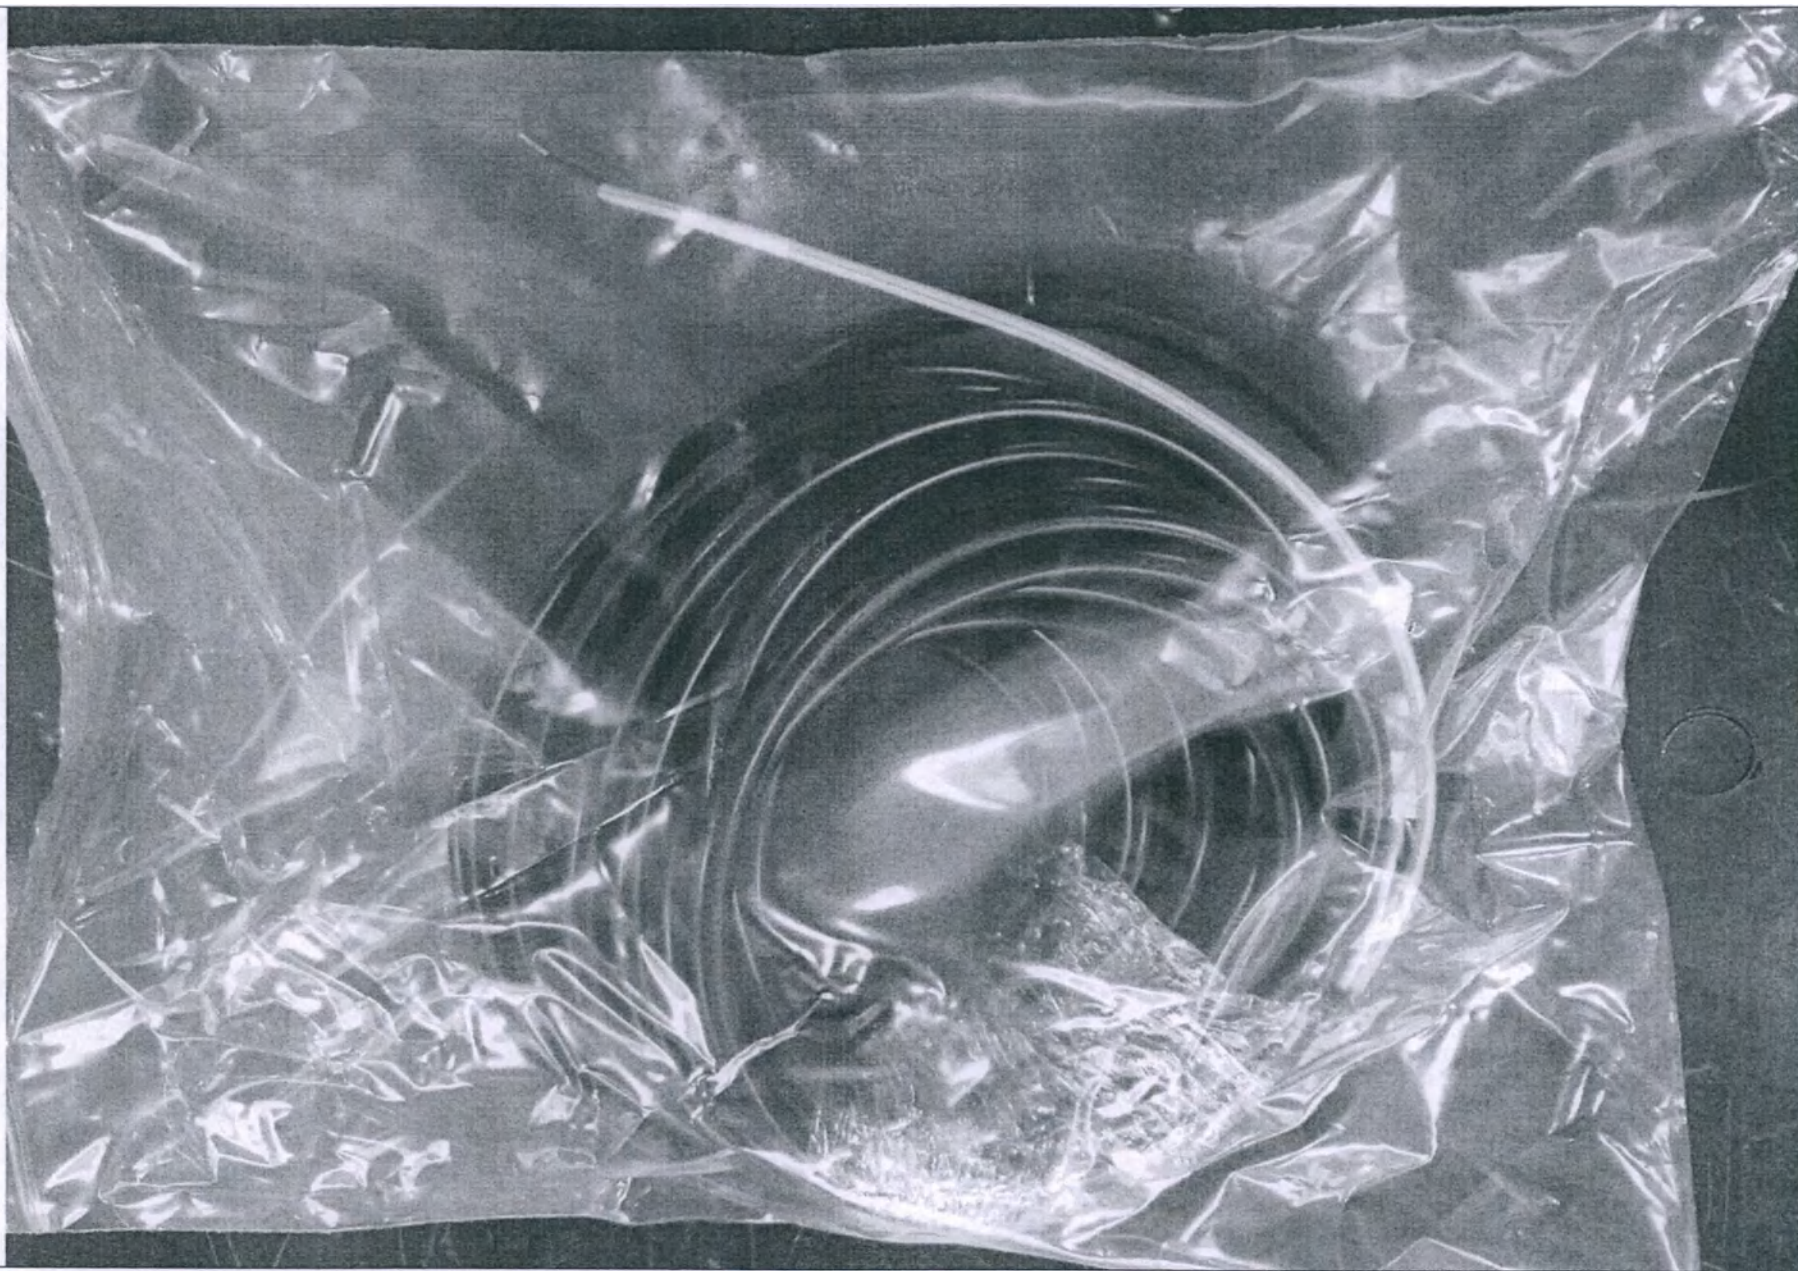


16а. Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические (от 1 до 50 шт.).

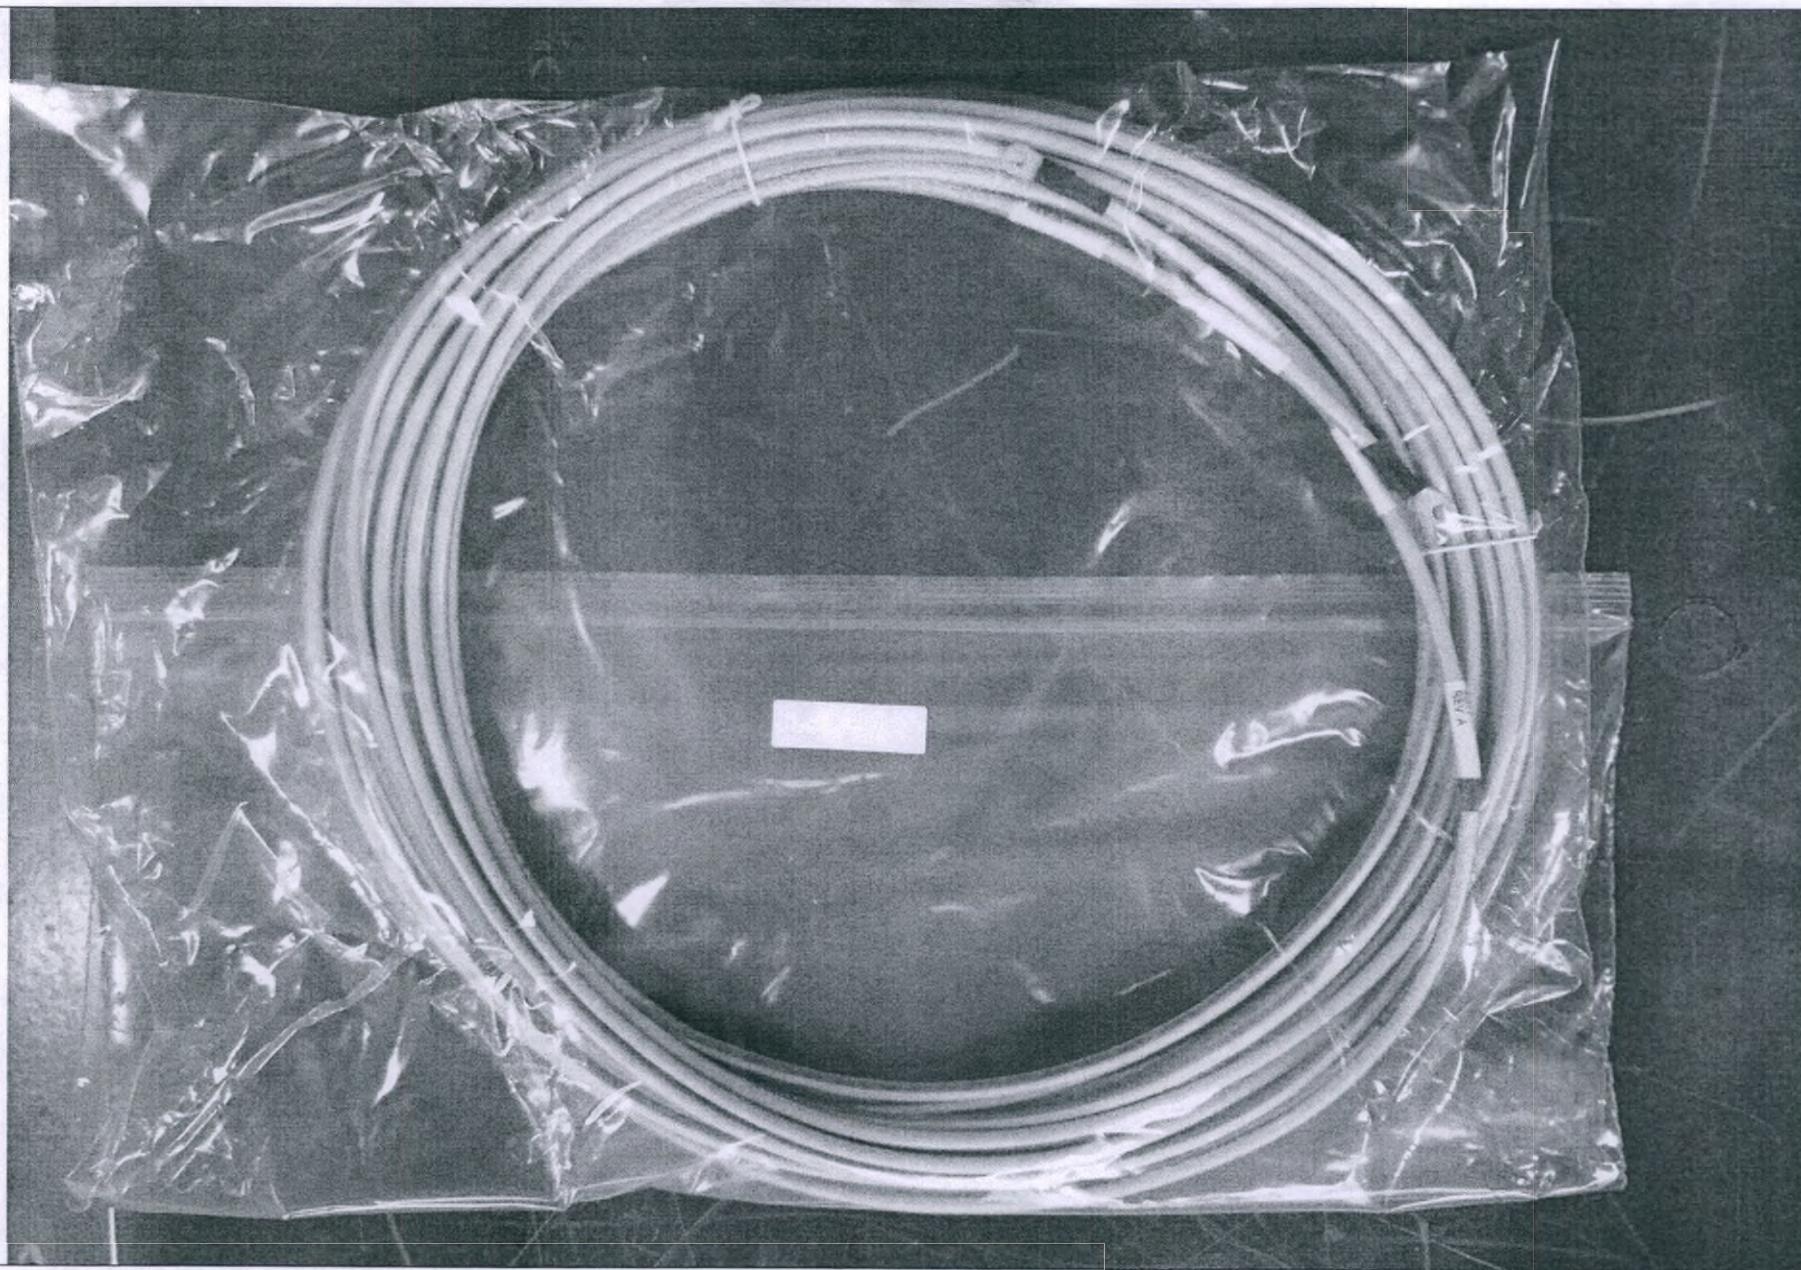


166. Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.




16в. Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.

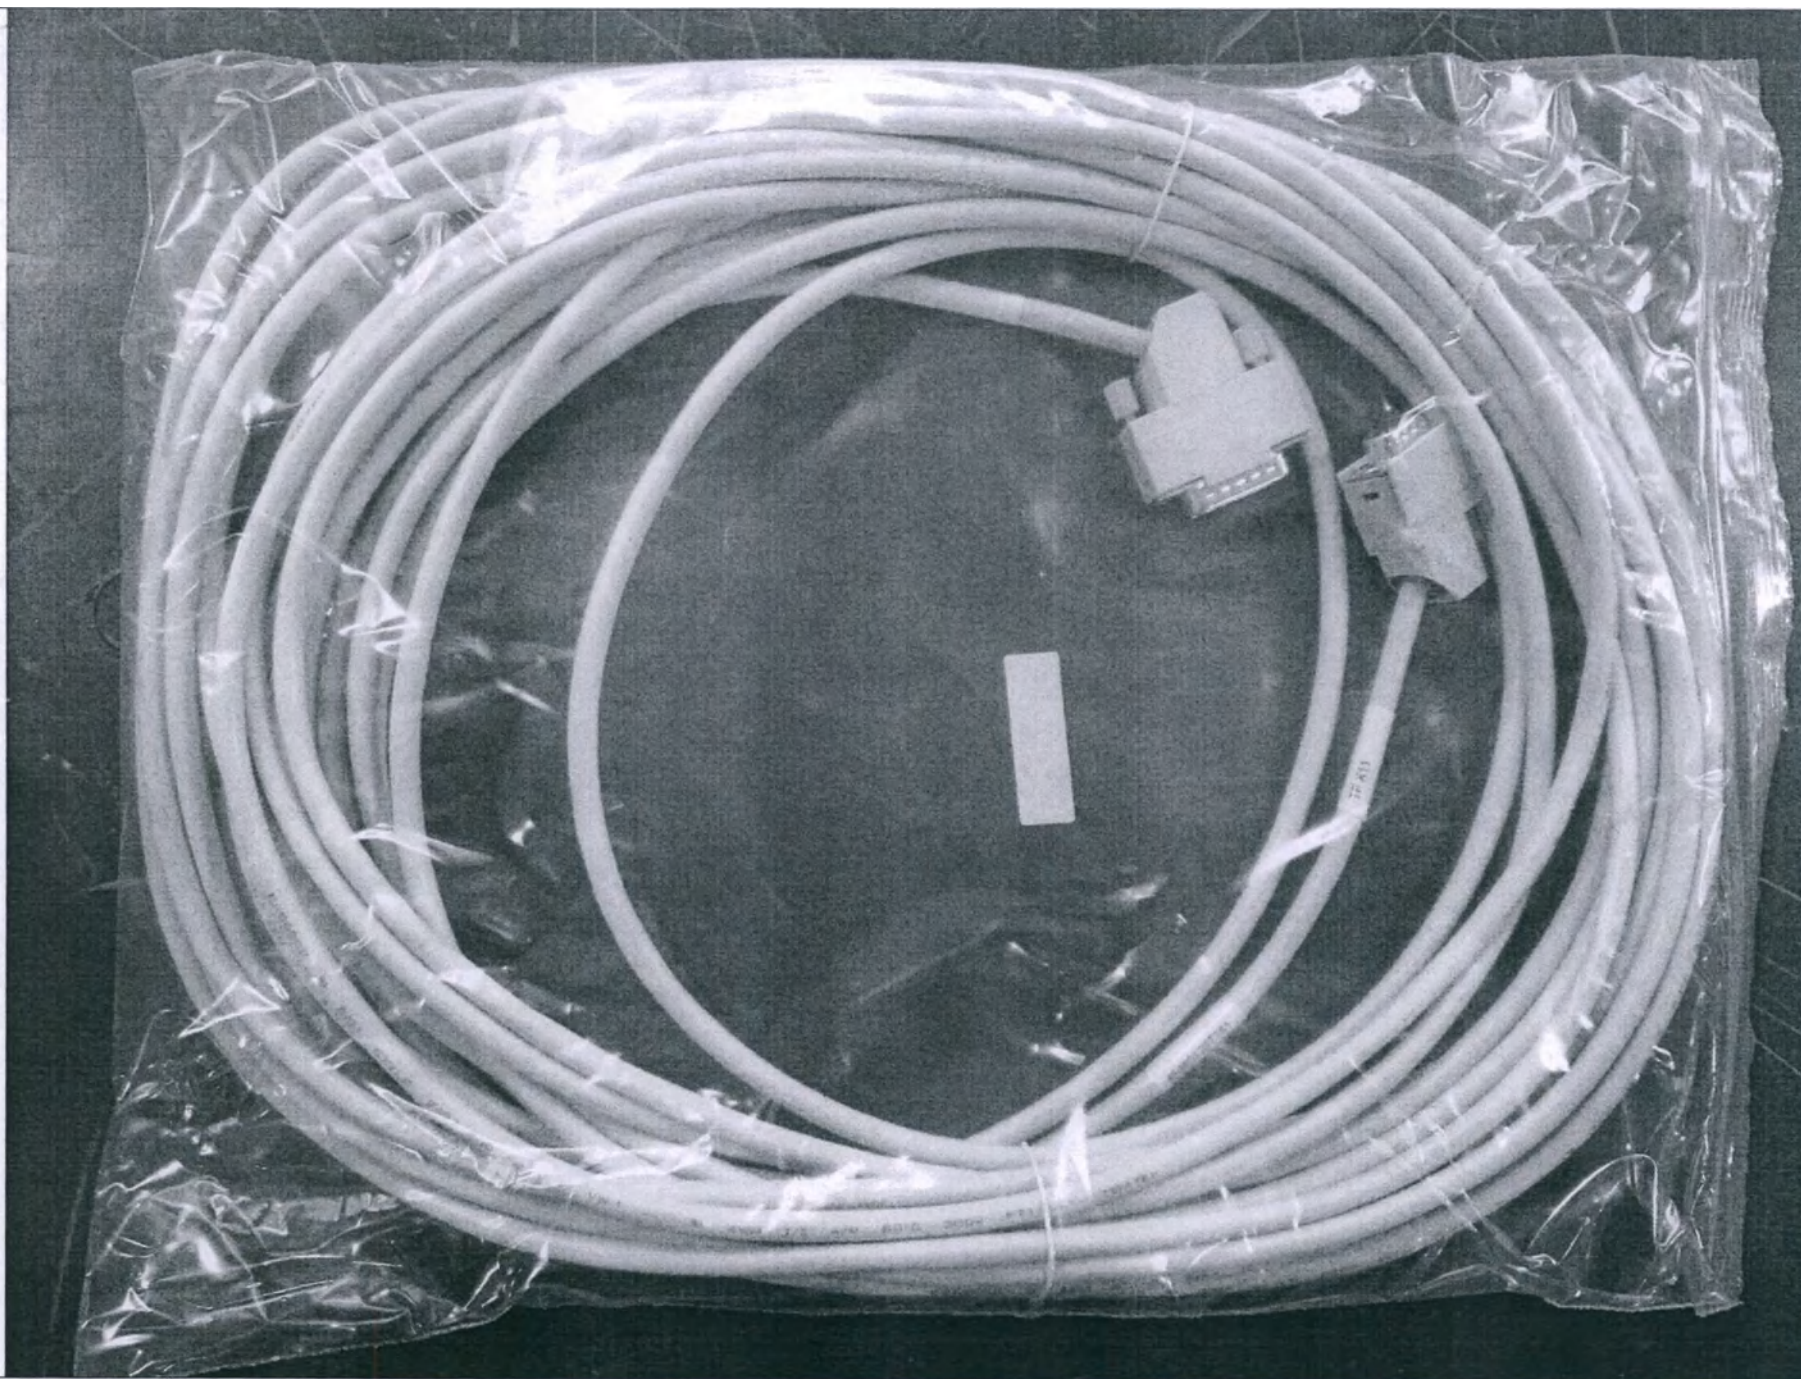


162. Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.

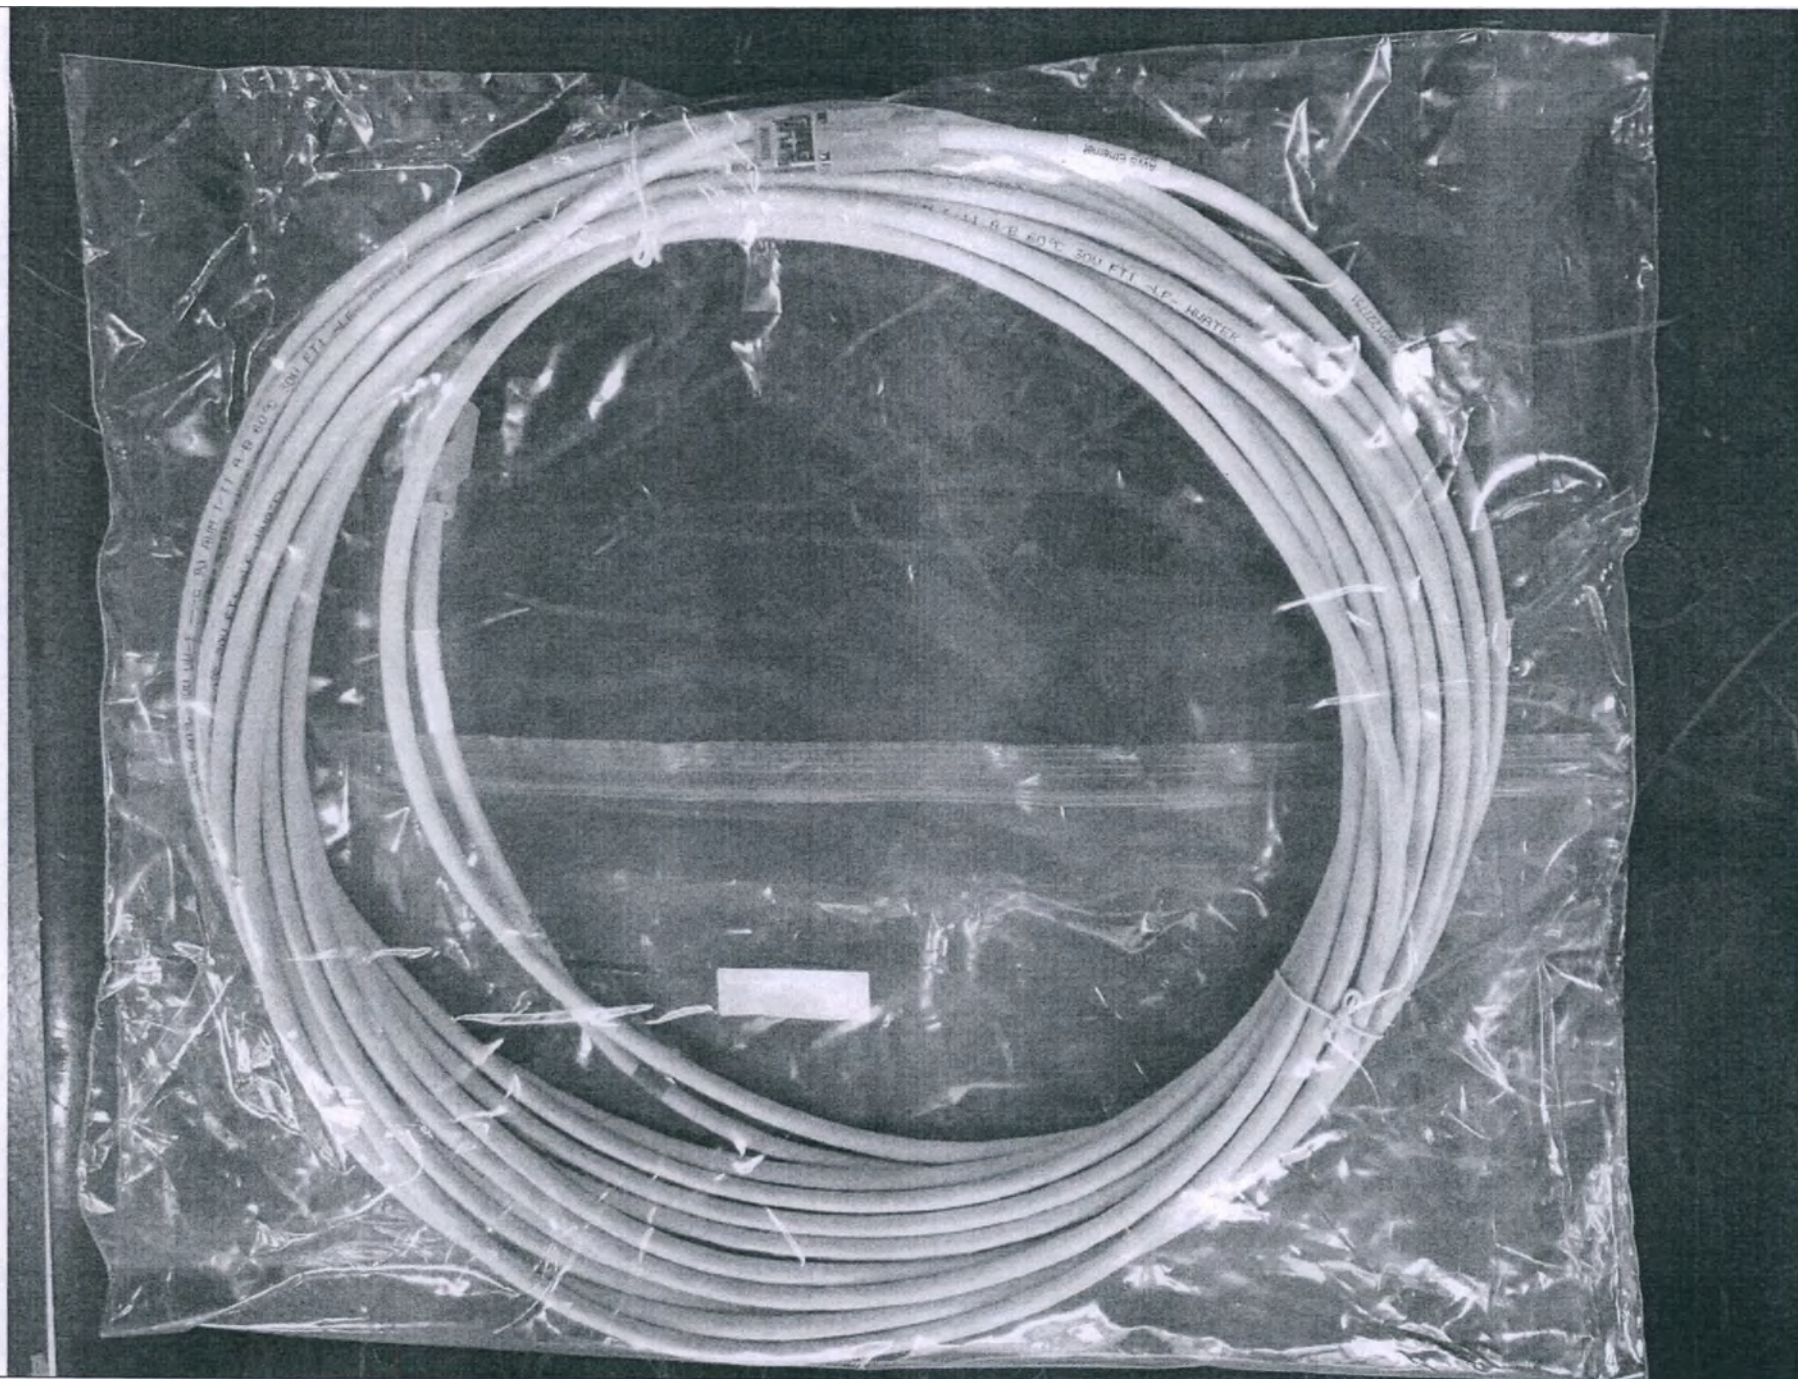


16д. Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.

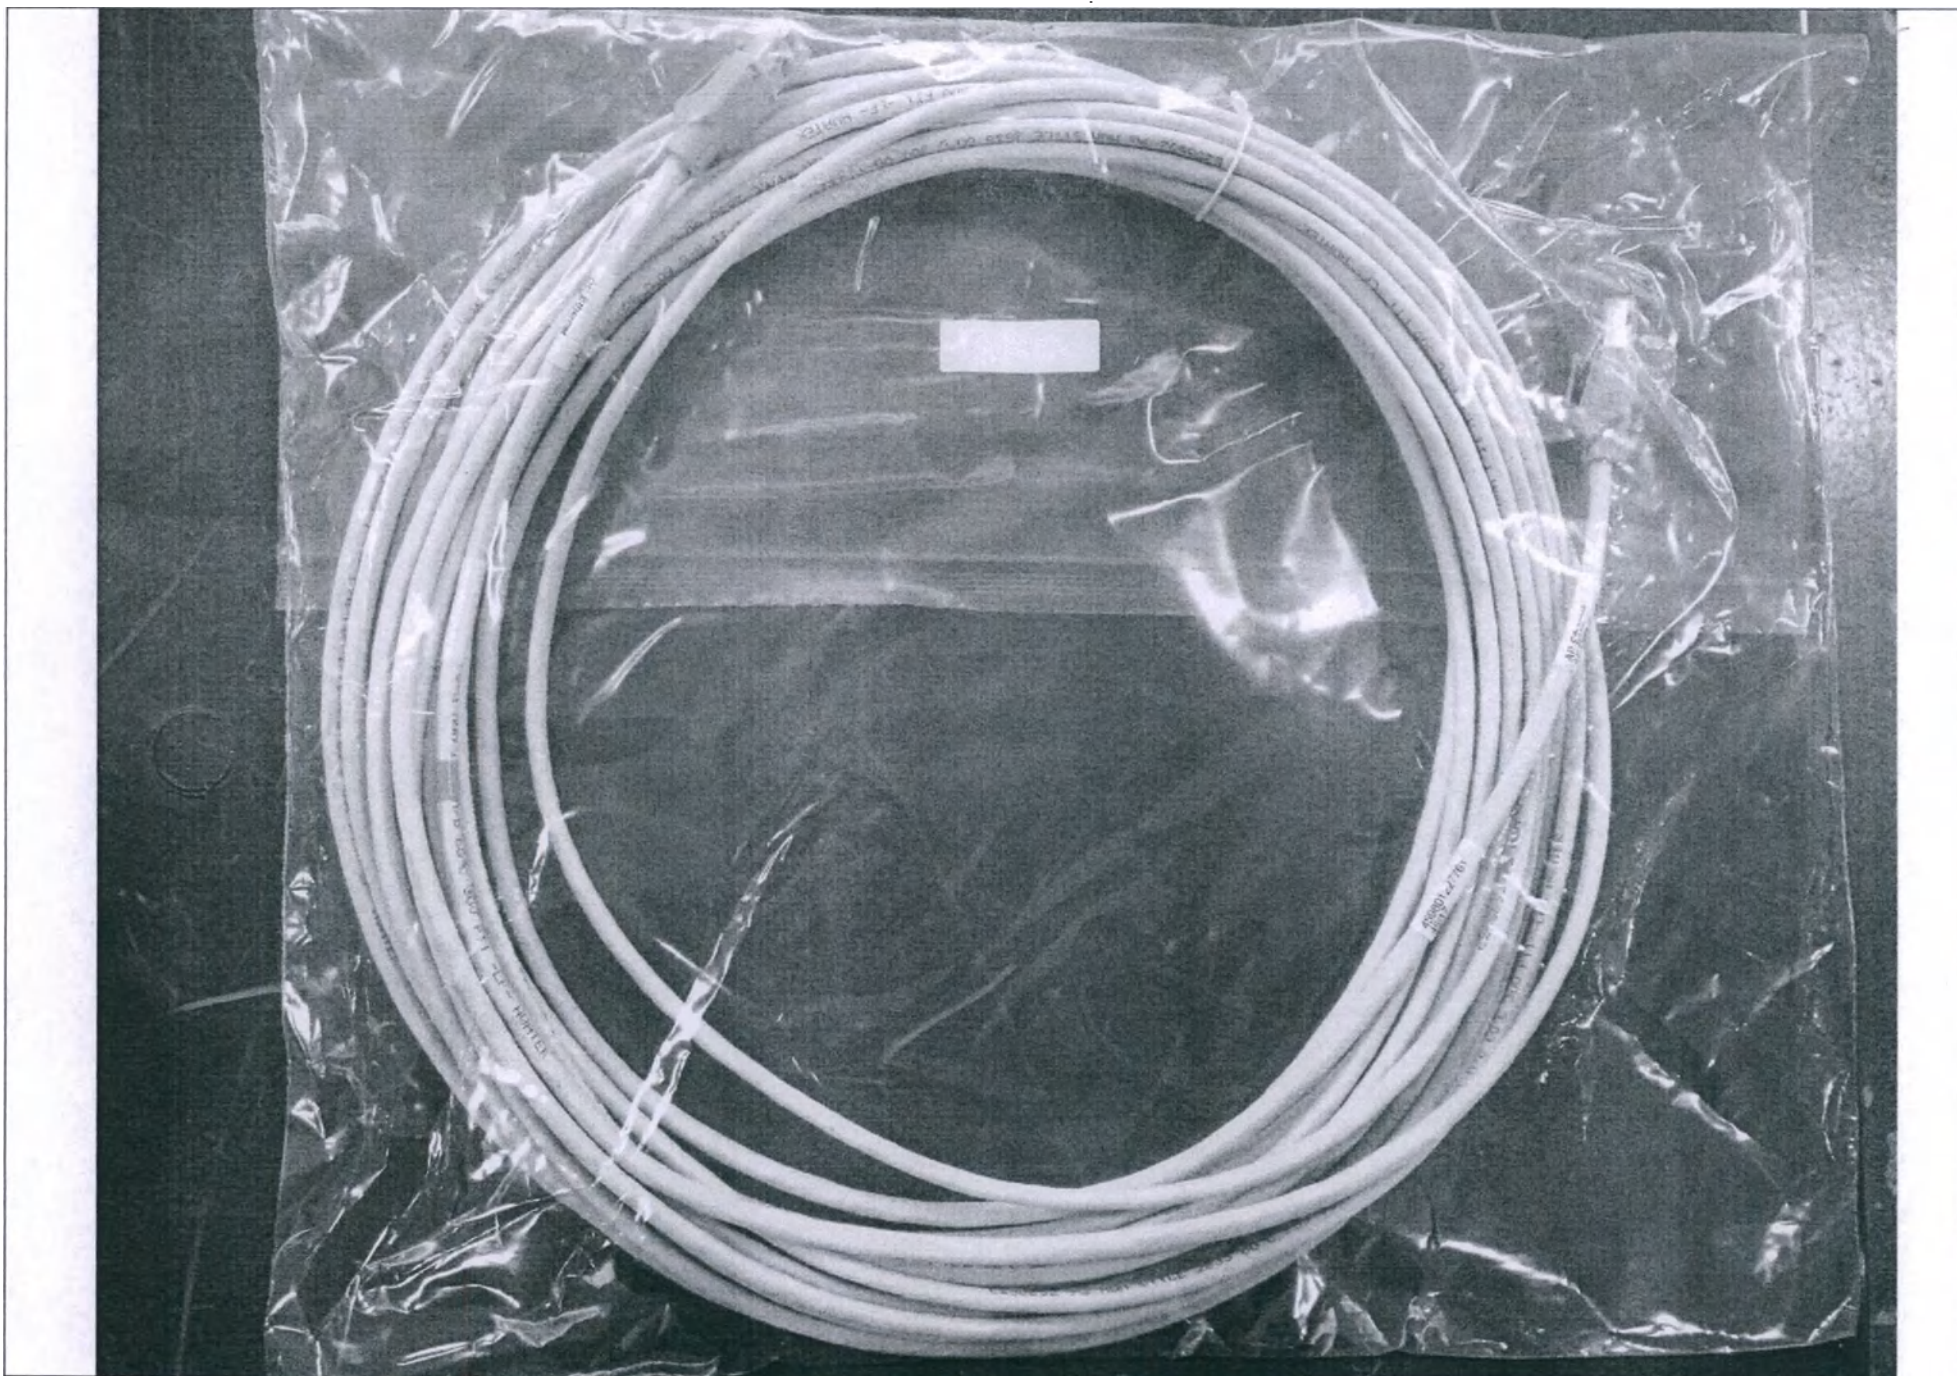


16е. Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.

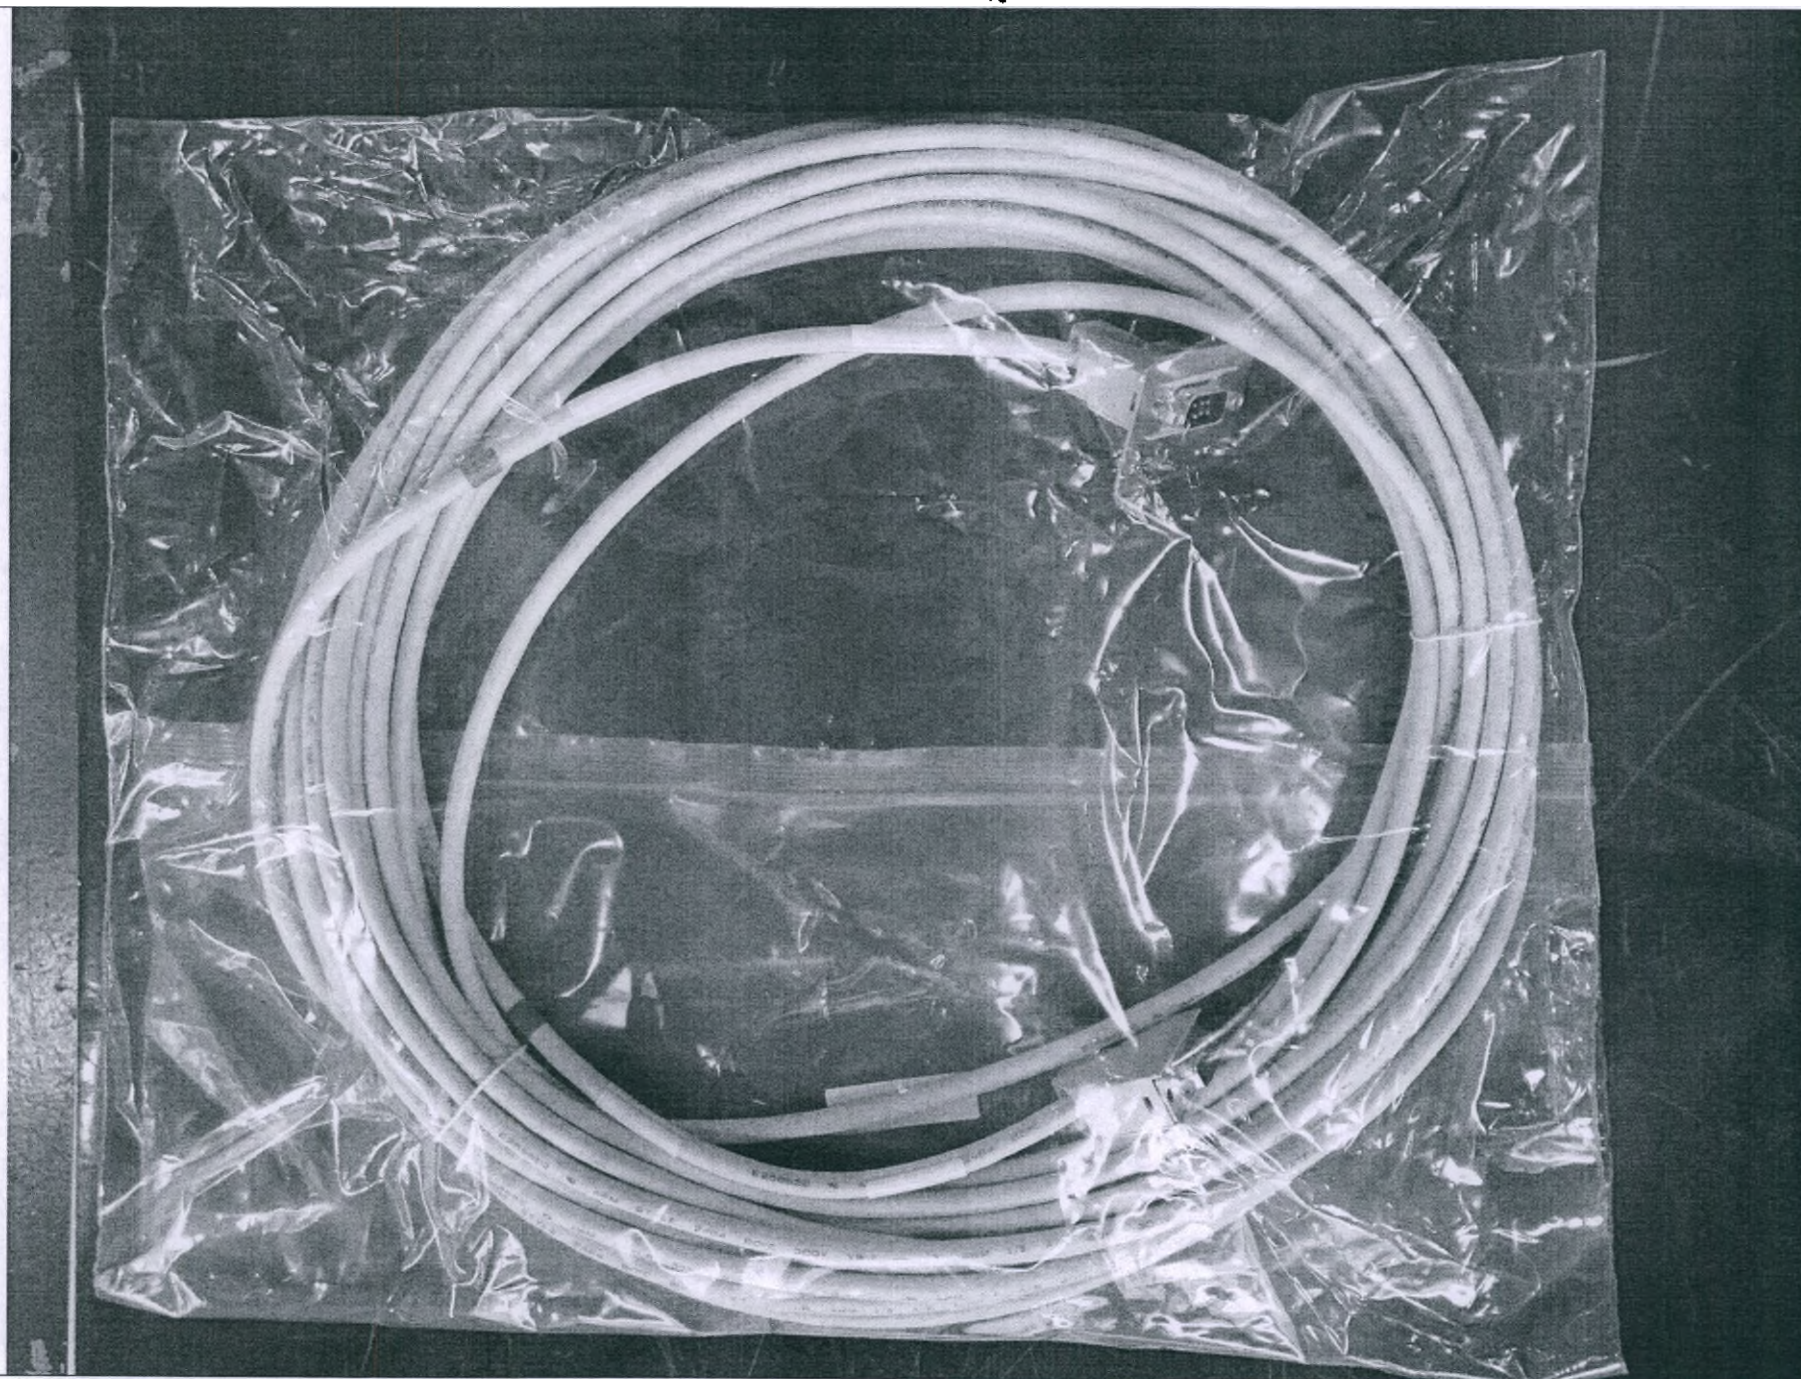


16ж. Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.

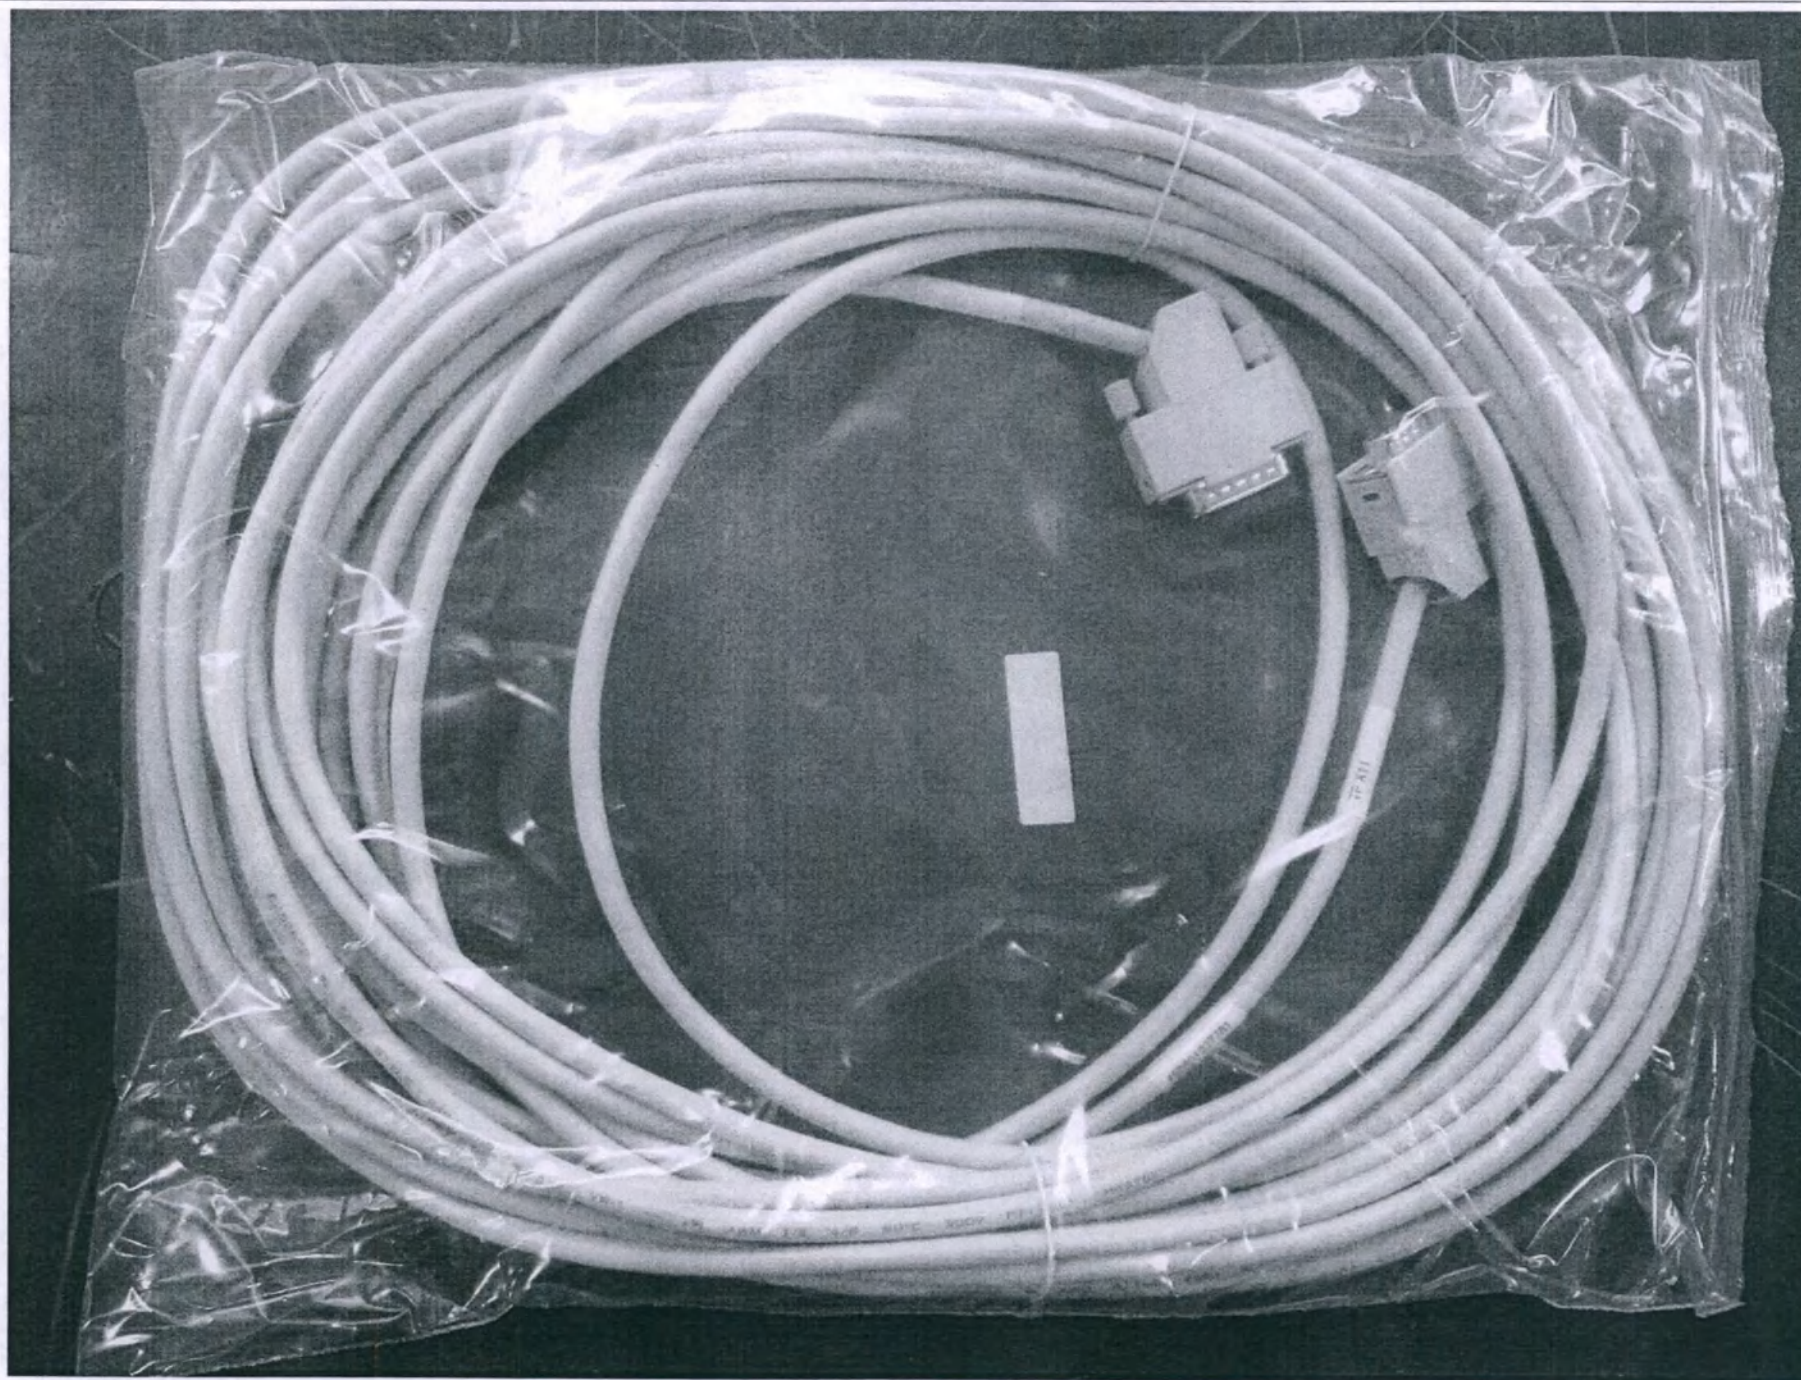


163. Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.

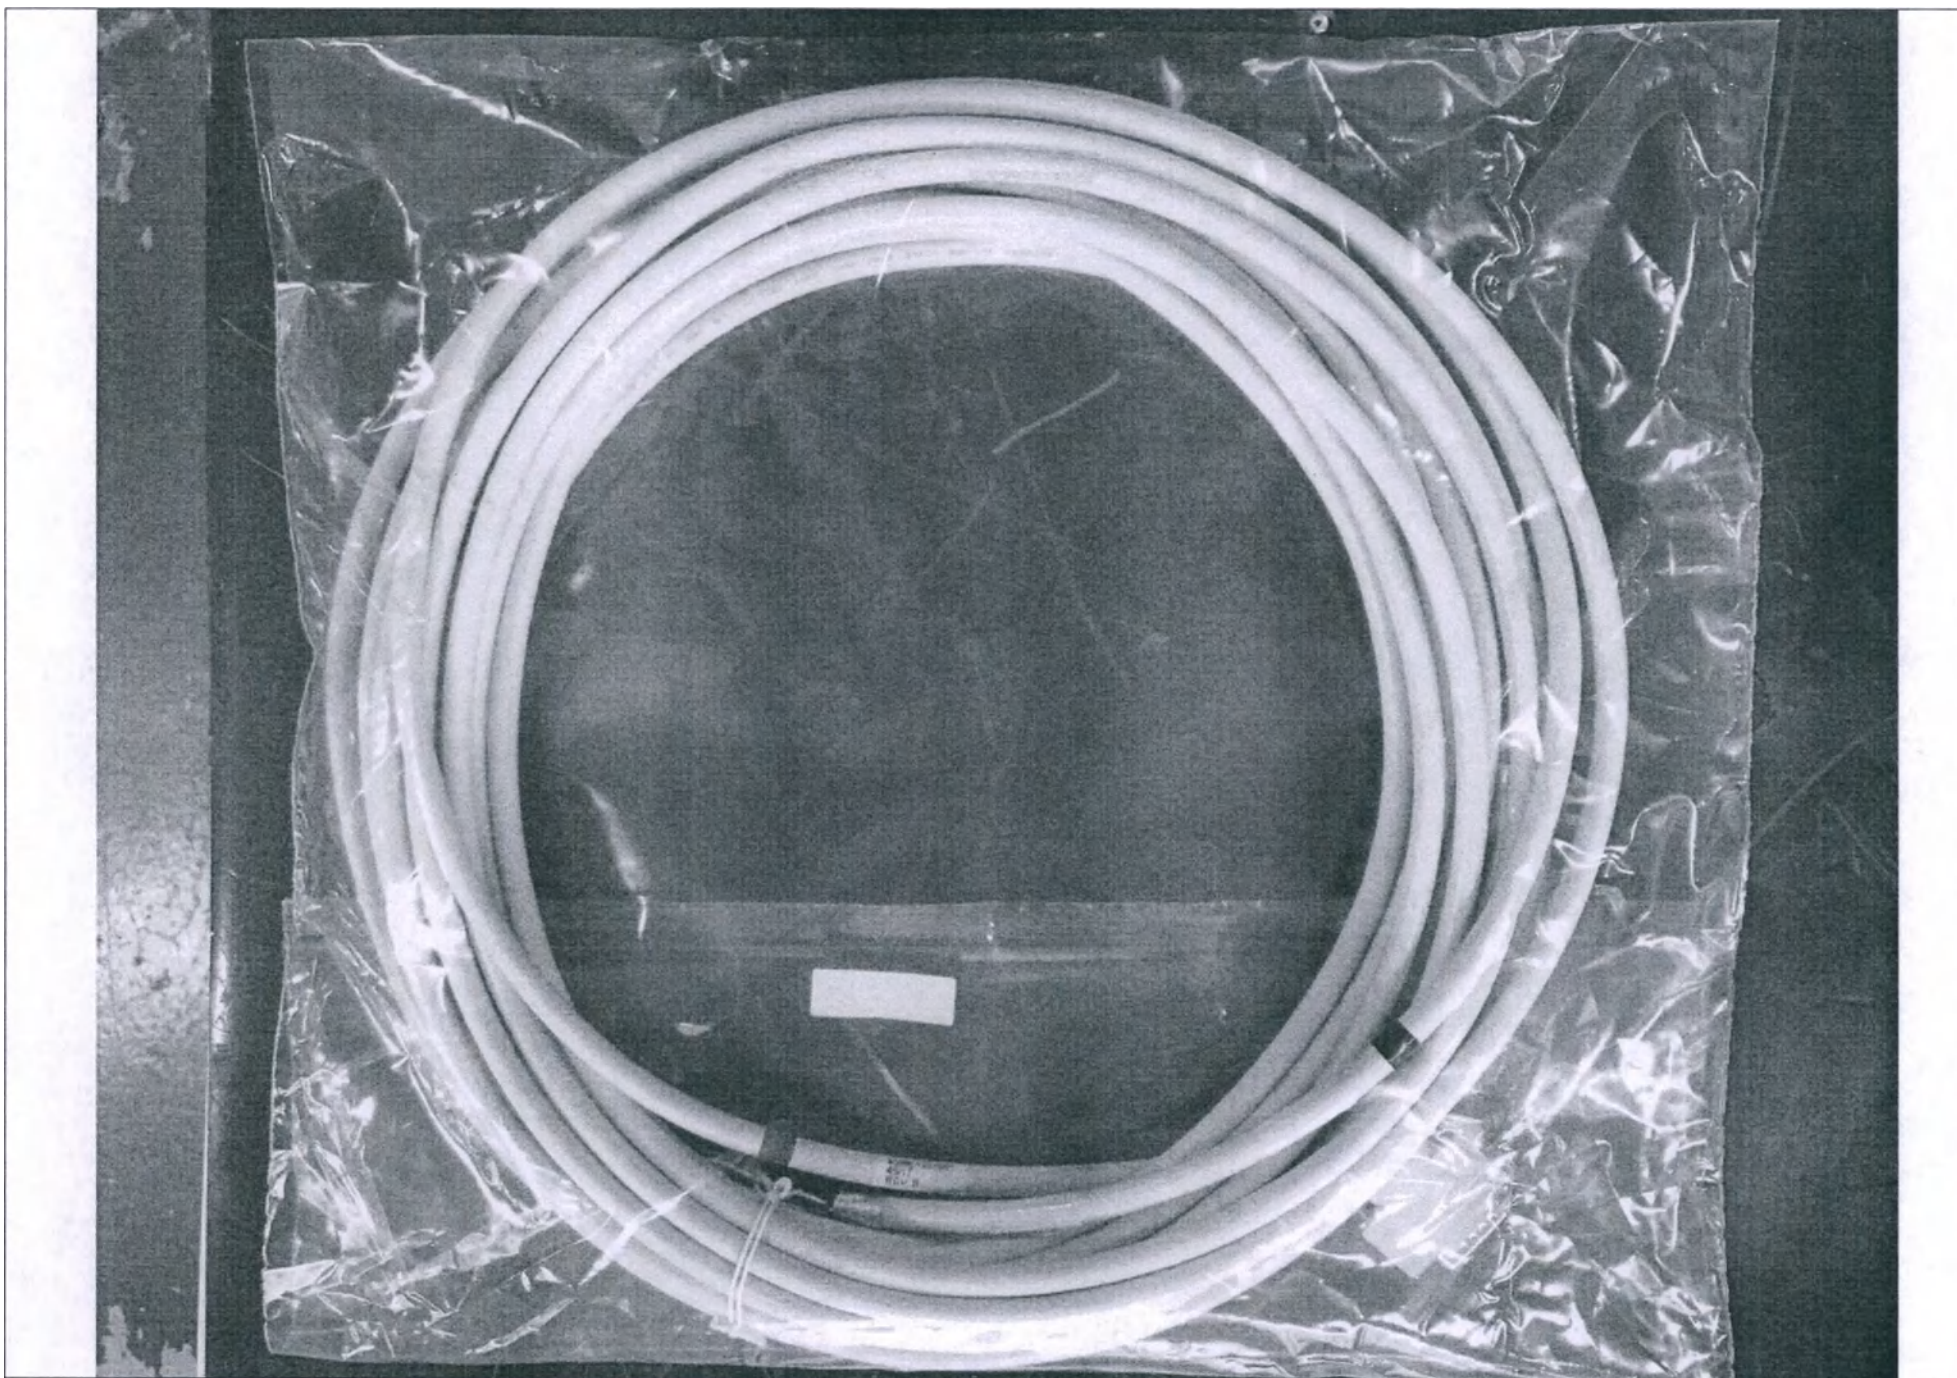


16и. Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.

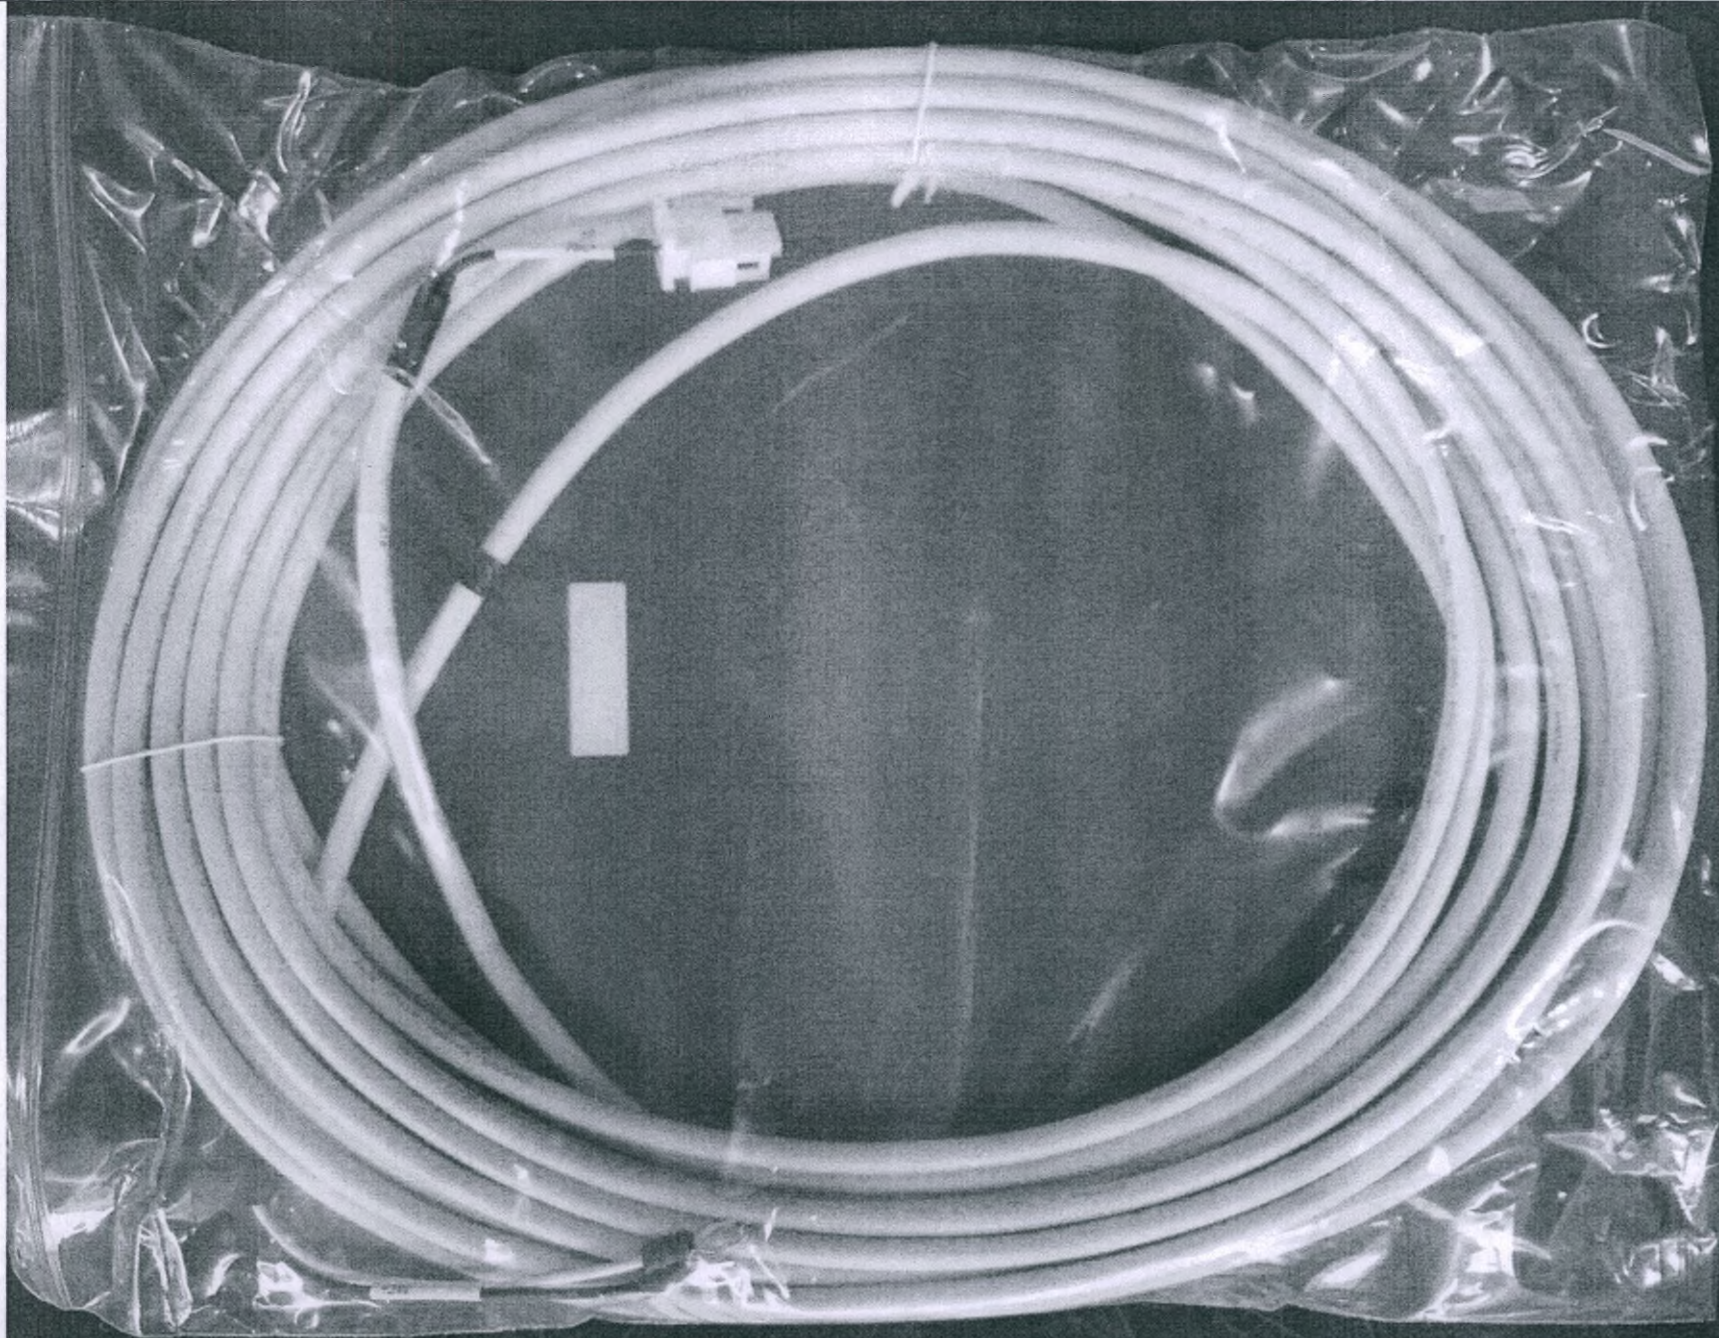


16к. Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.

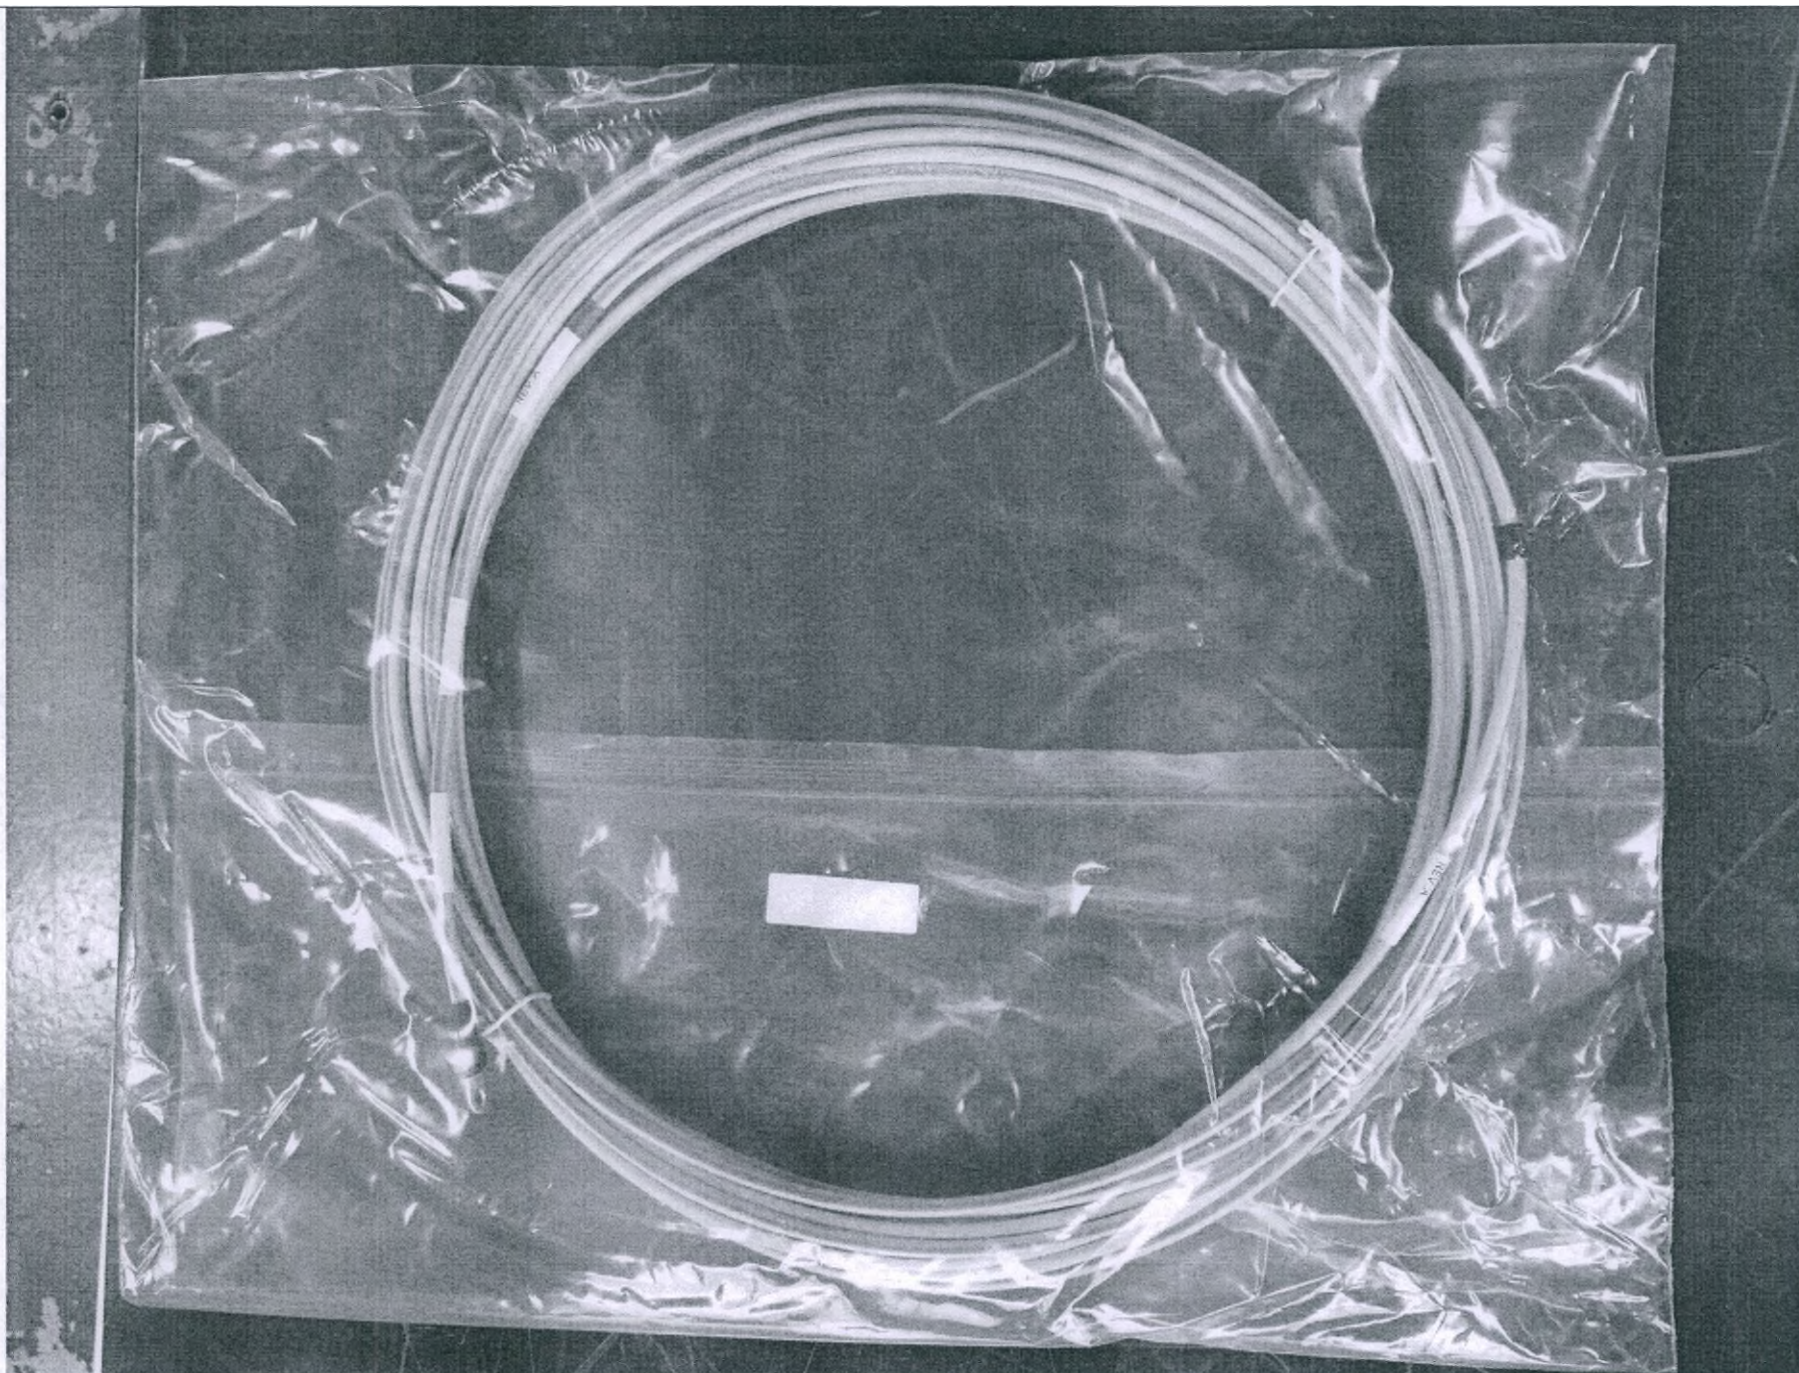


16л. Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.

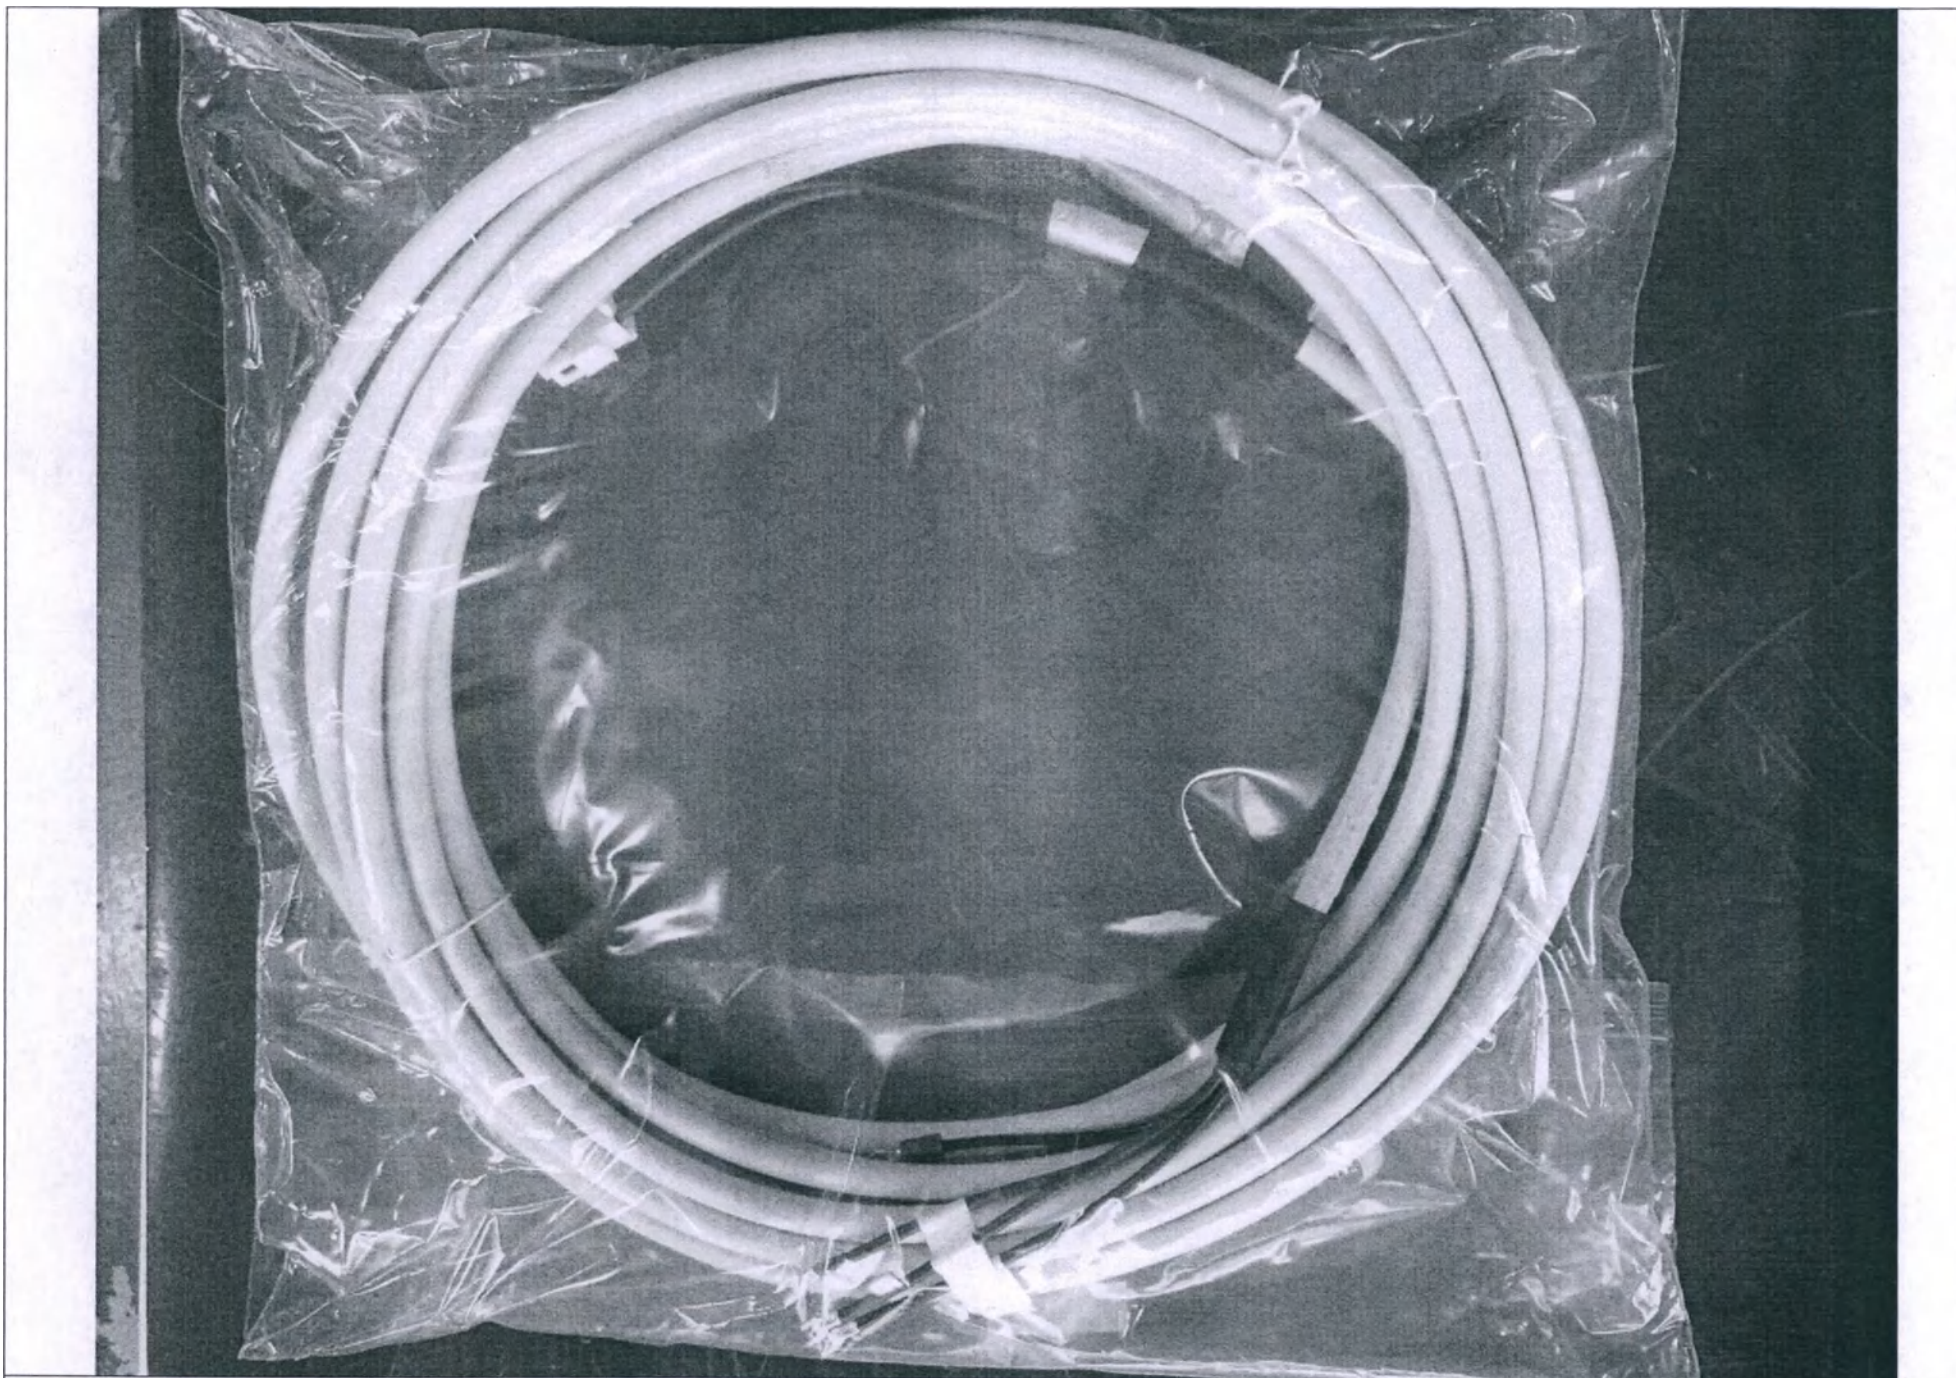

16м. Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.

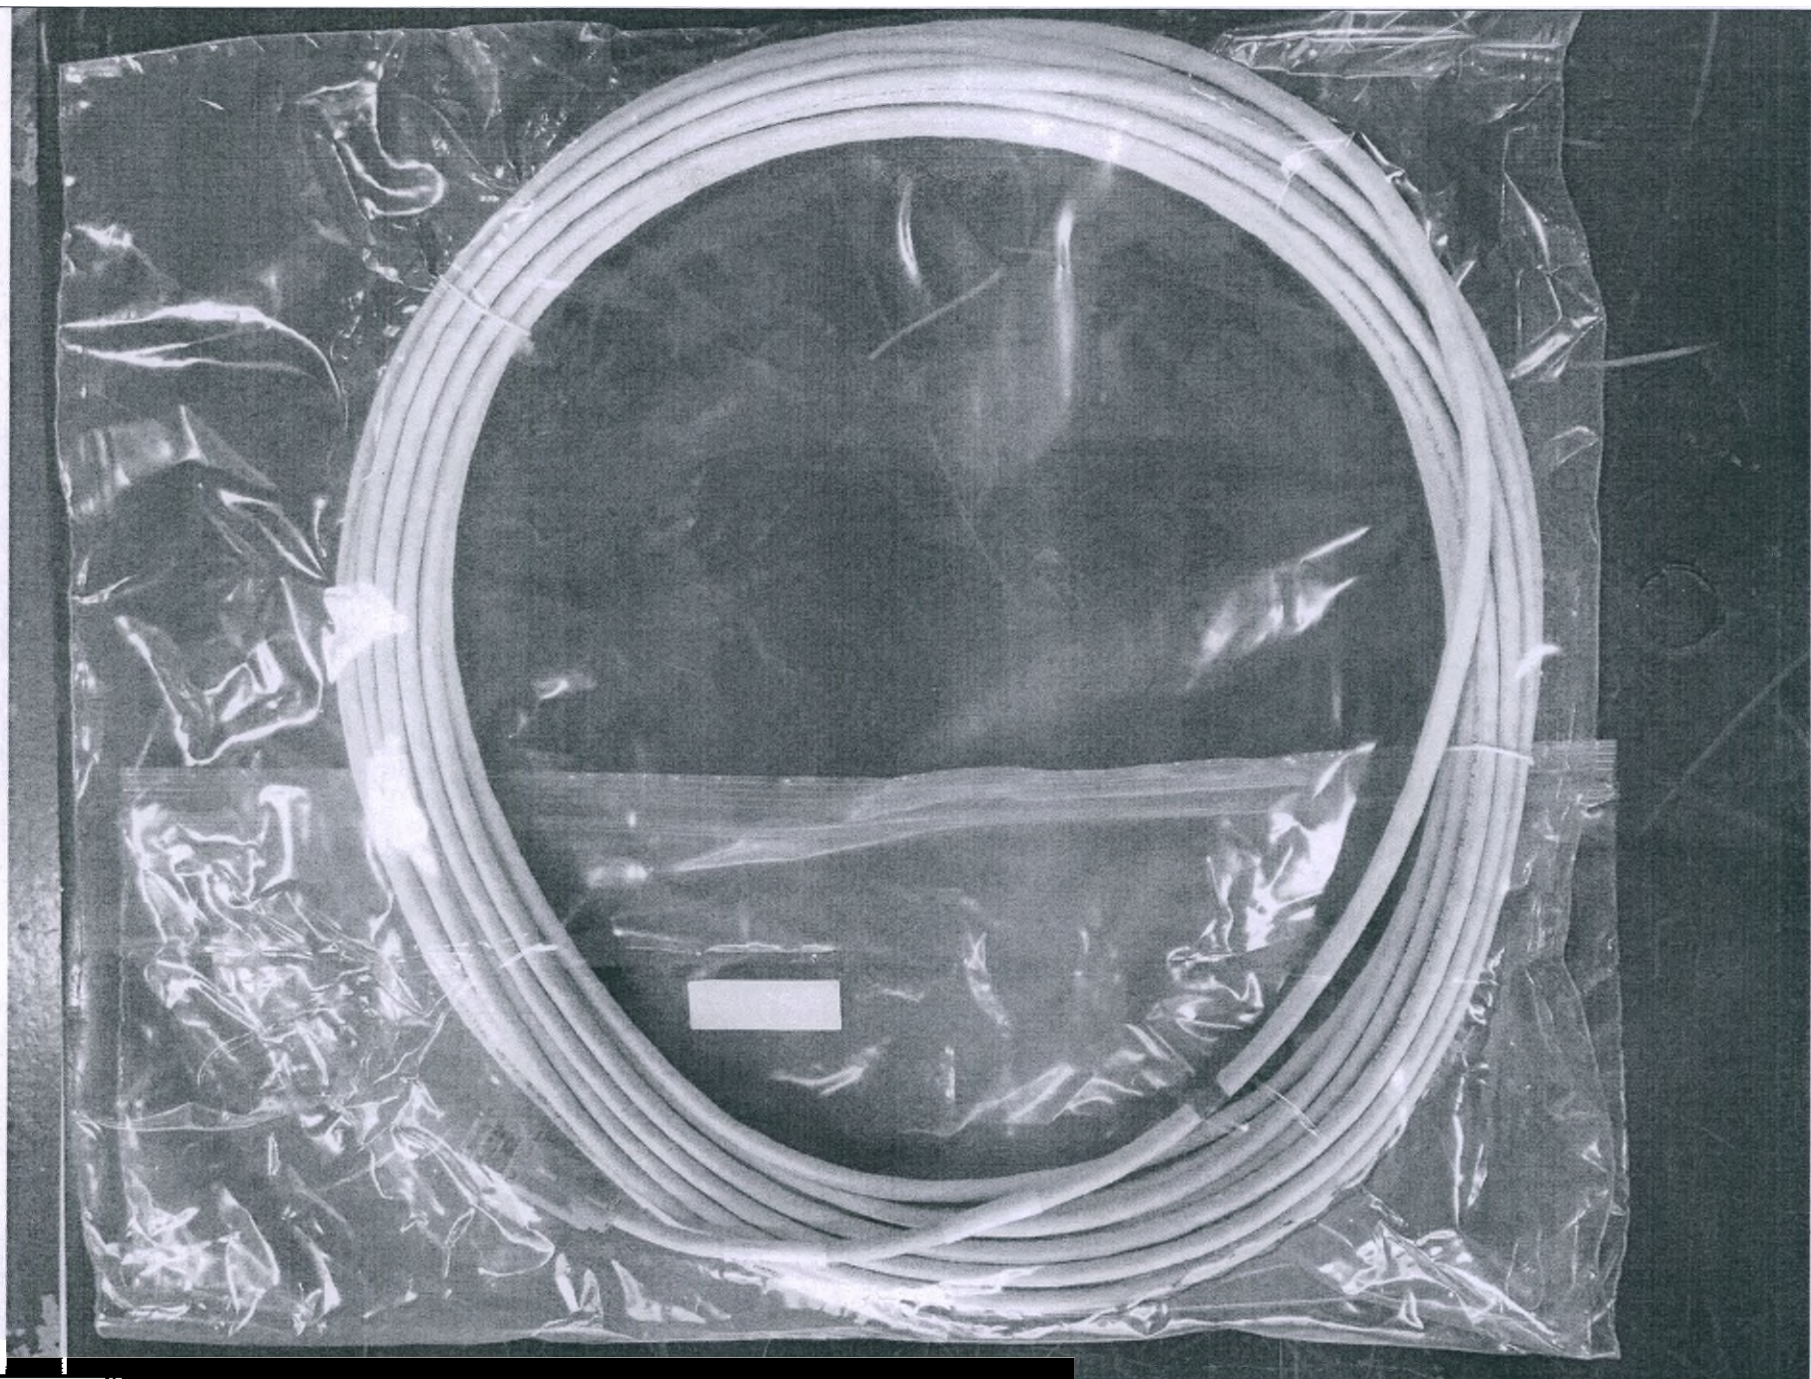


160. Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.

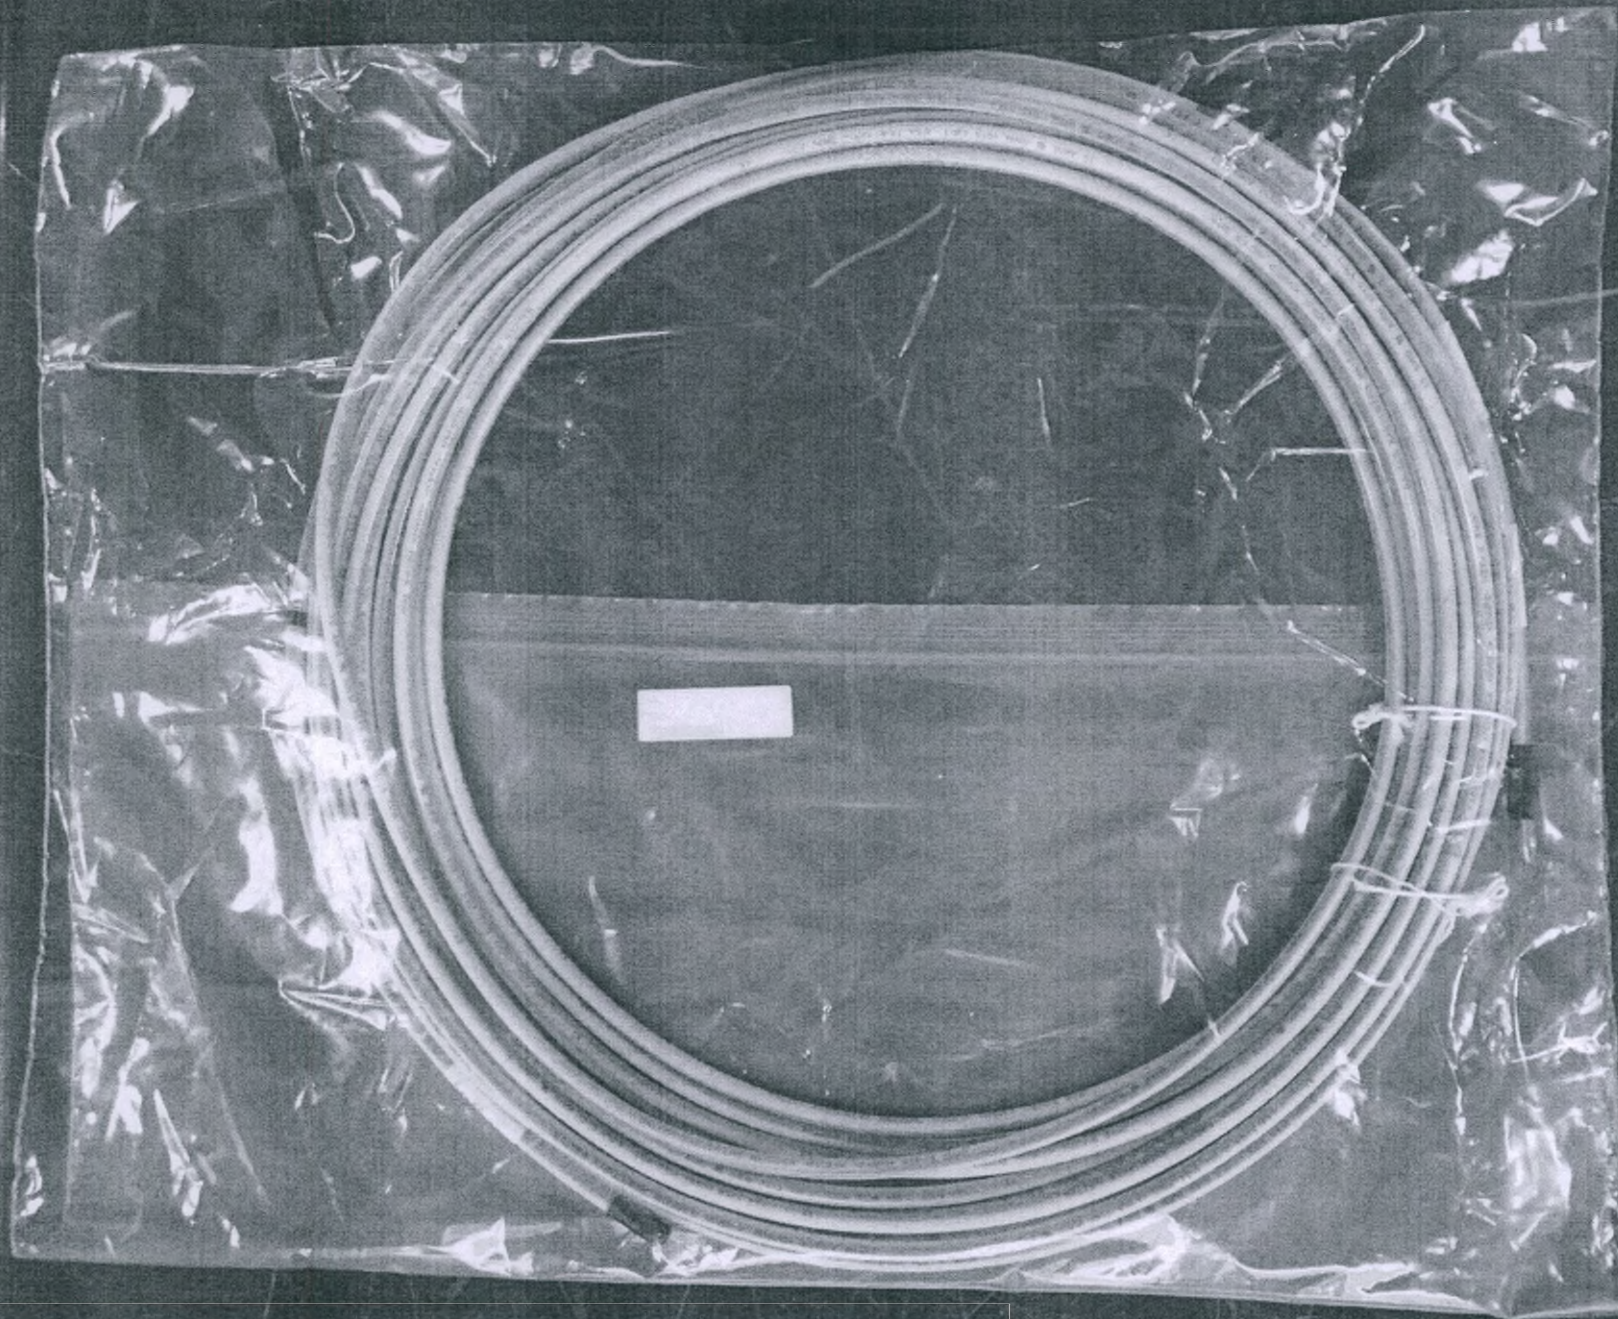


16п. Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.




16р. Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.

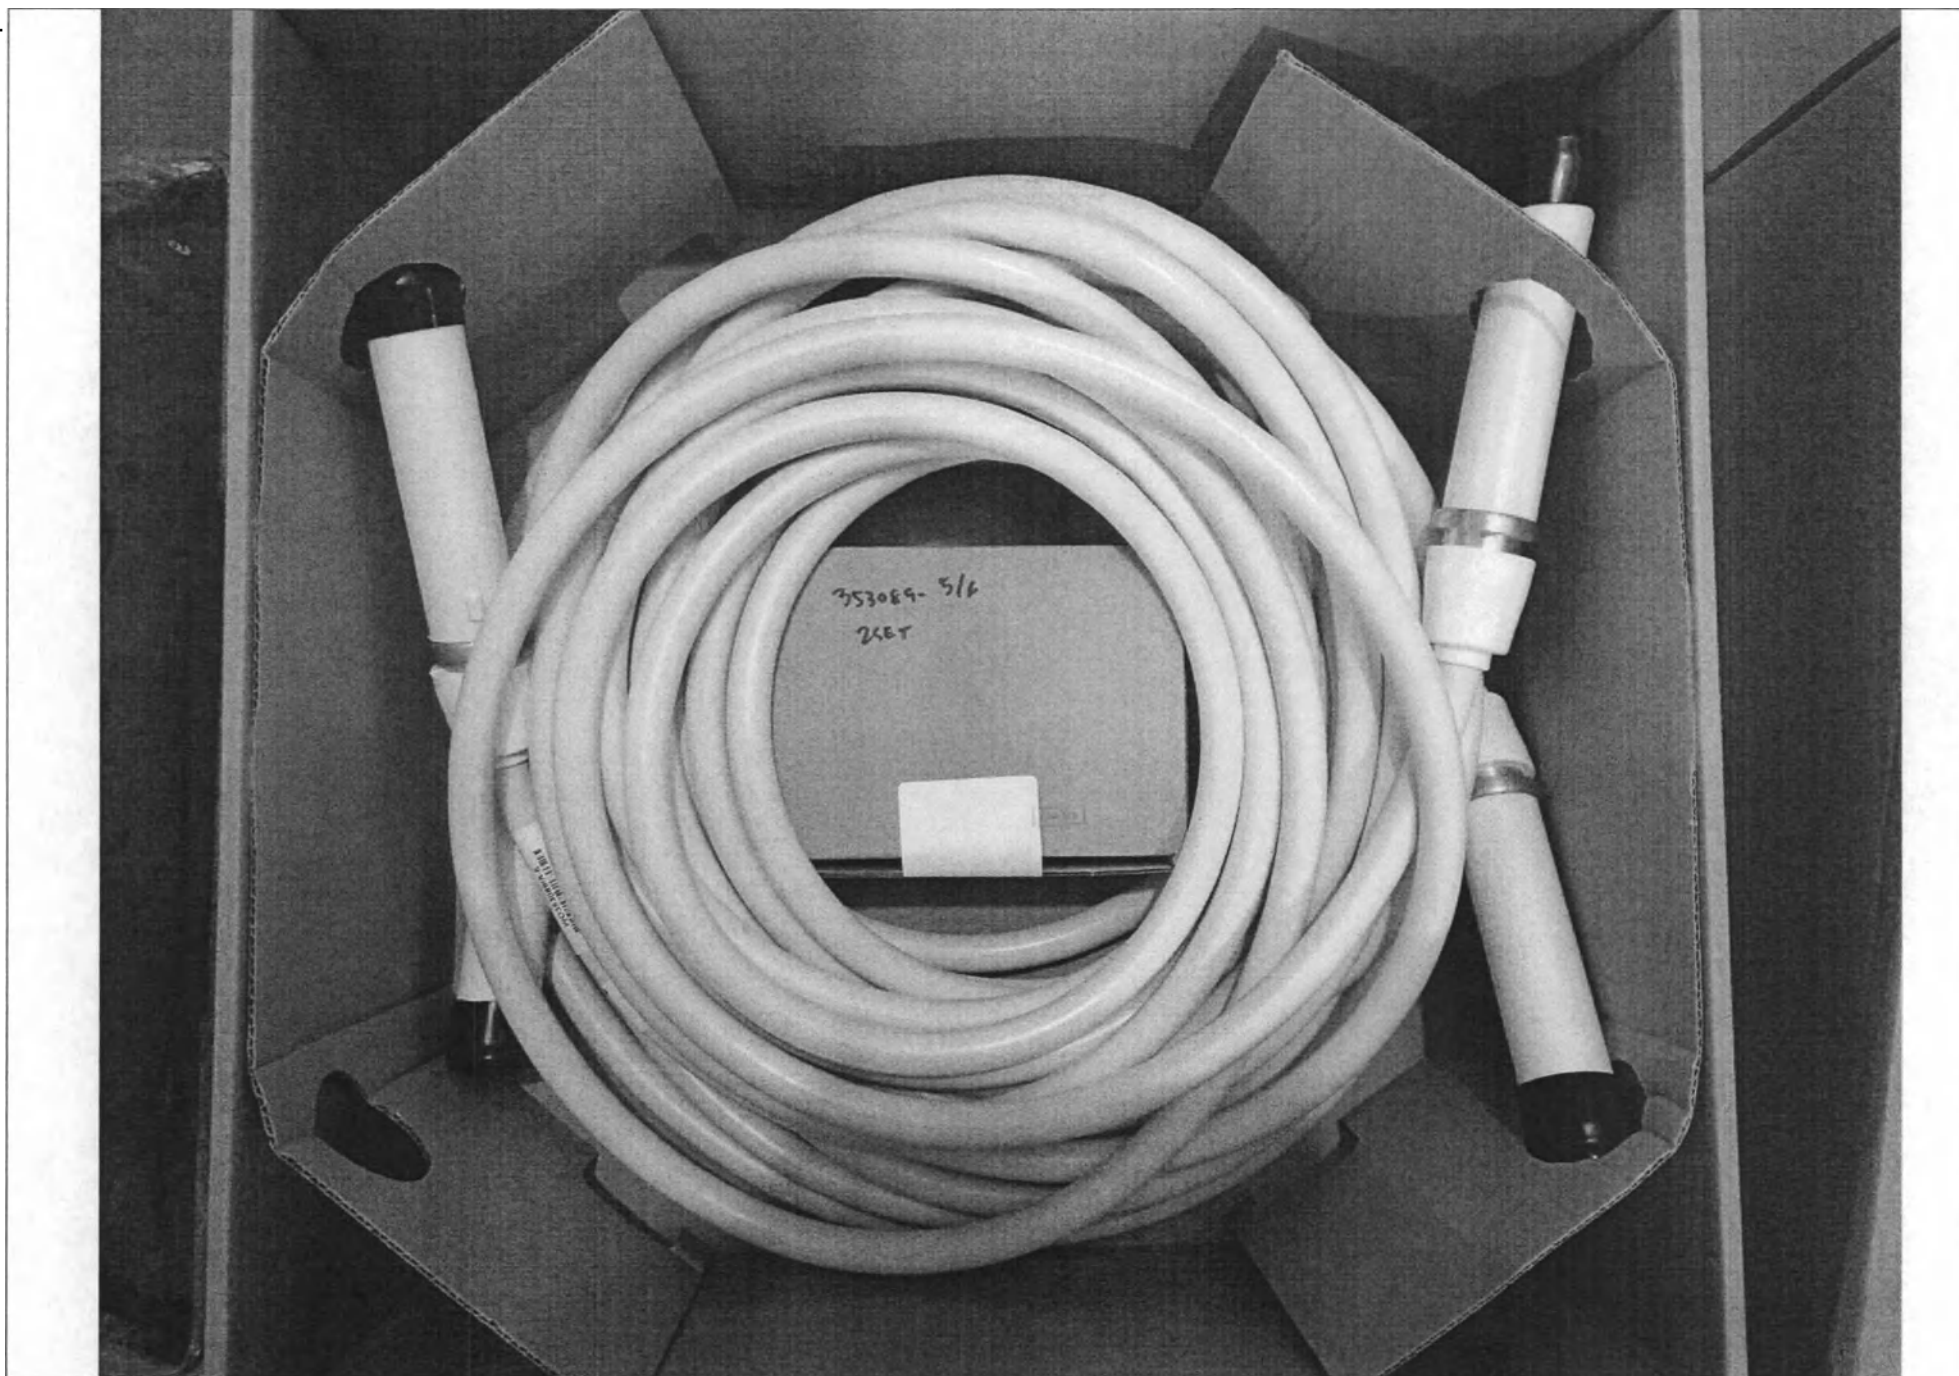


16с. Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.

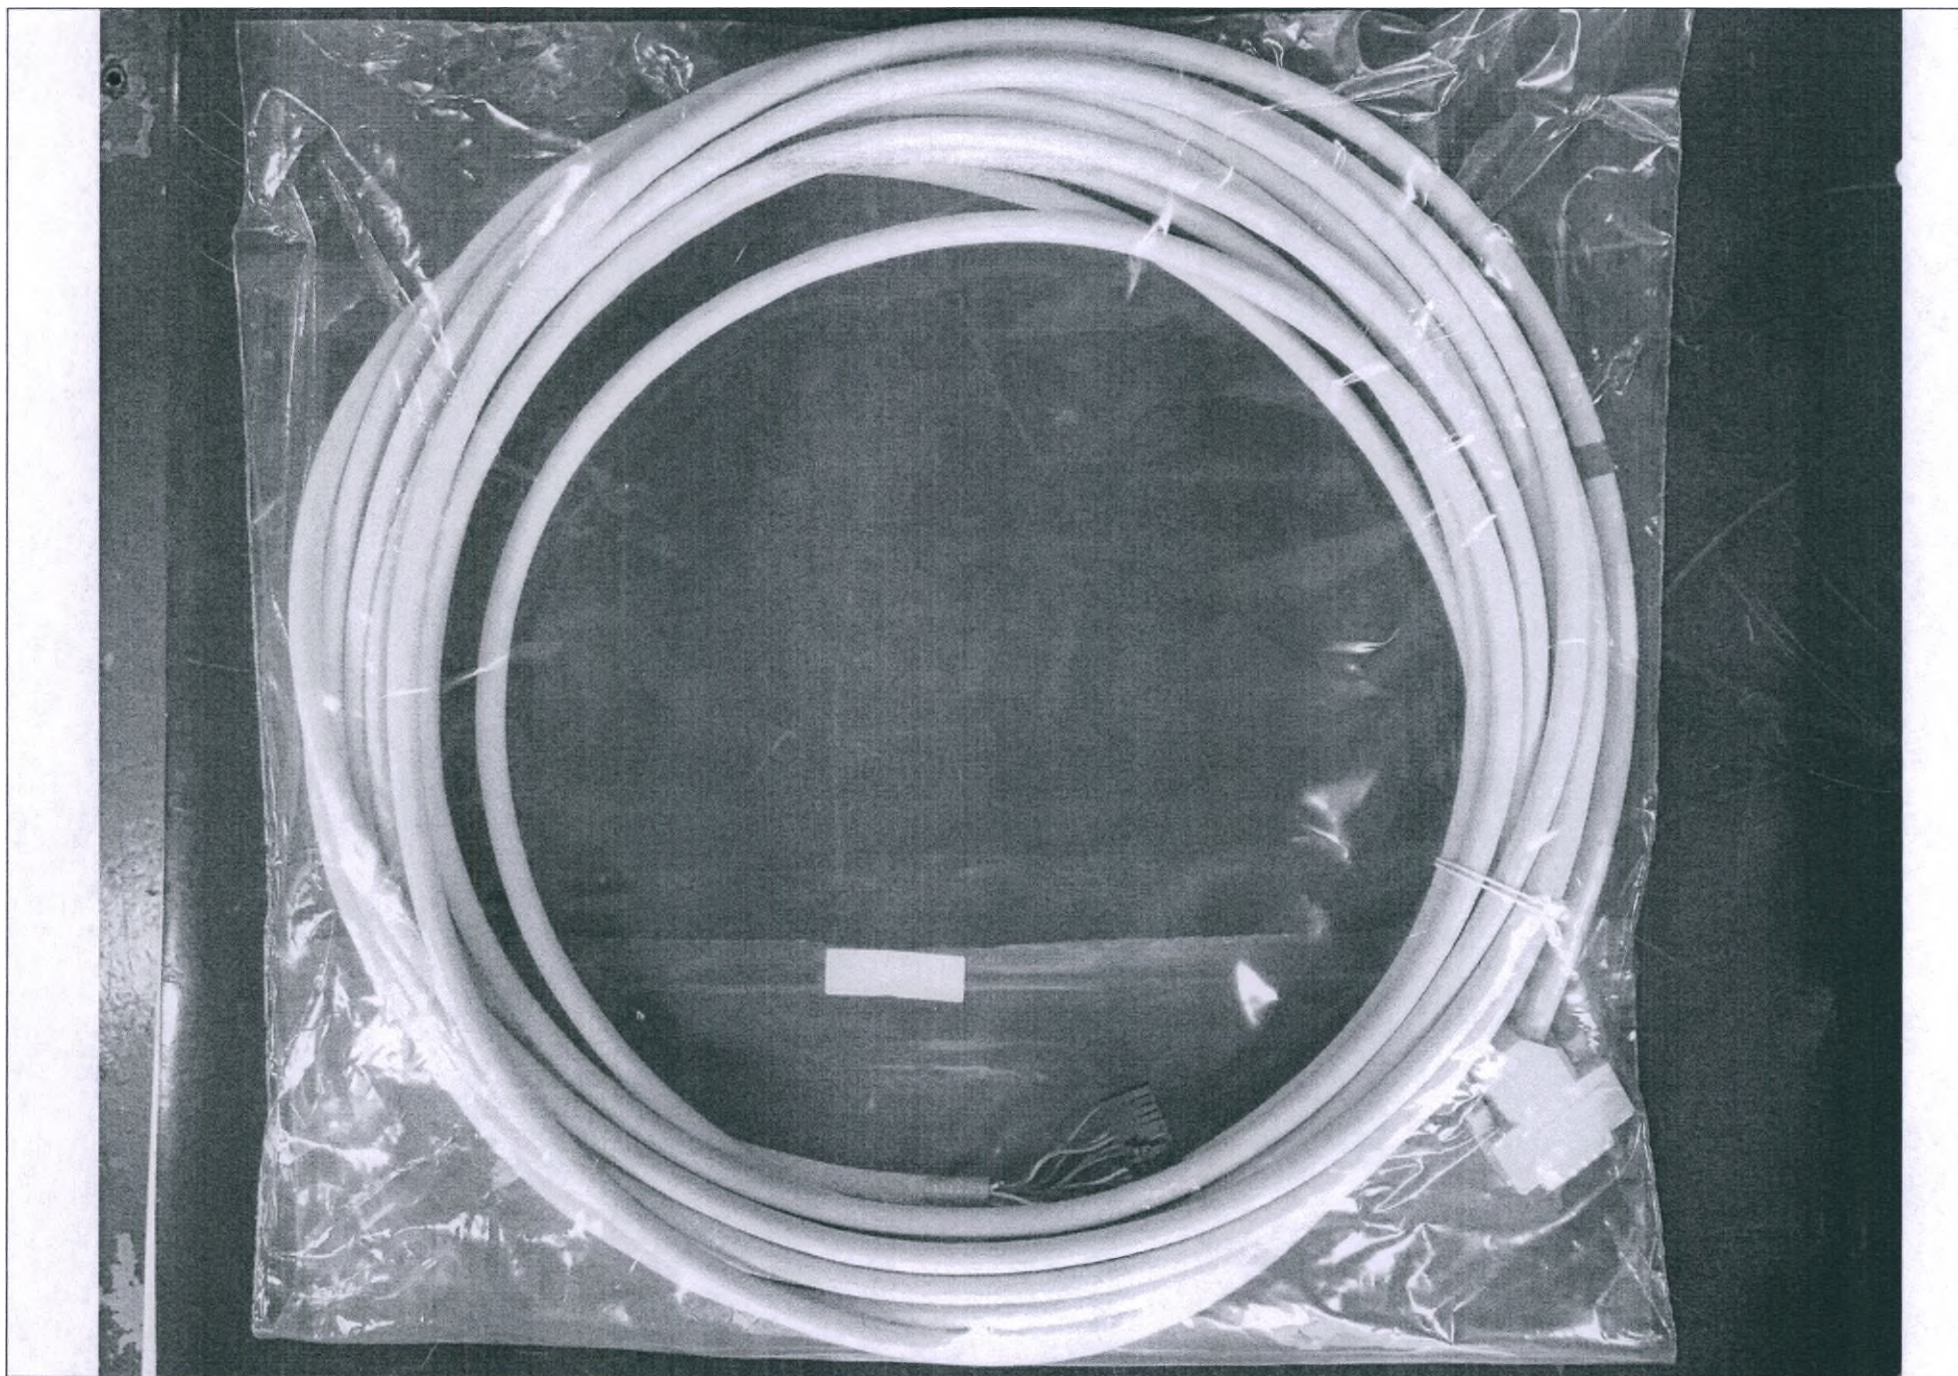

16т. Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.

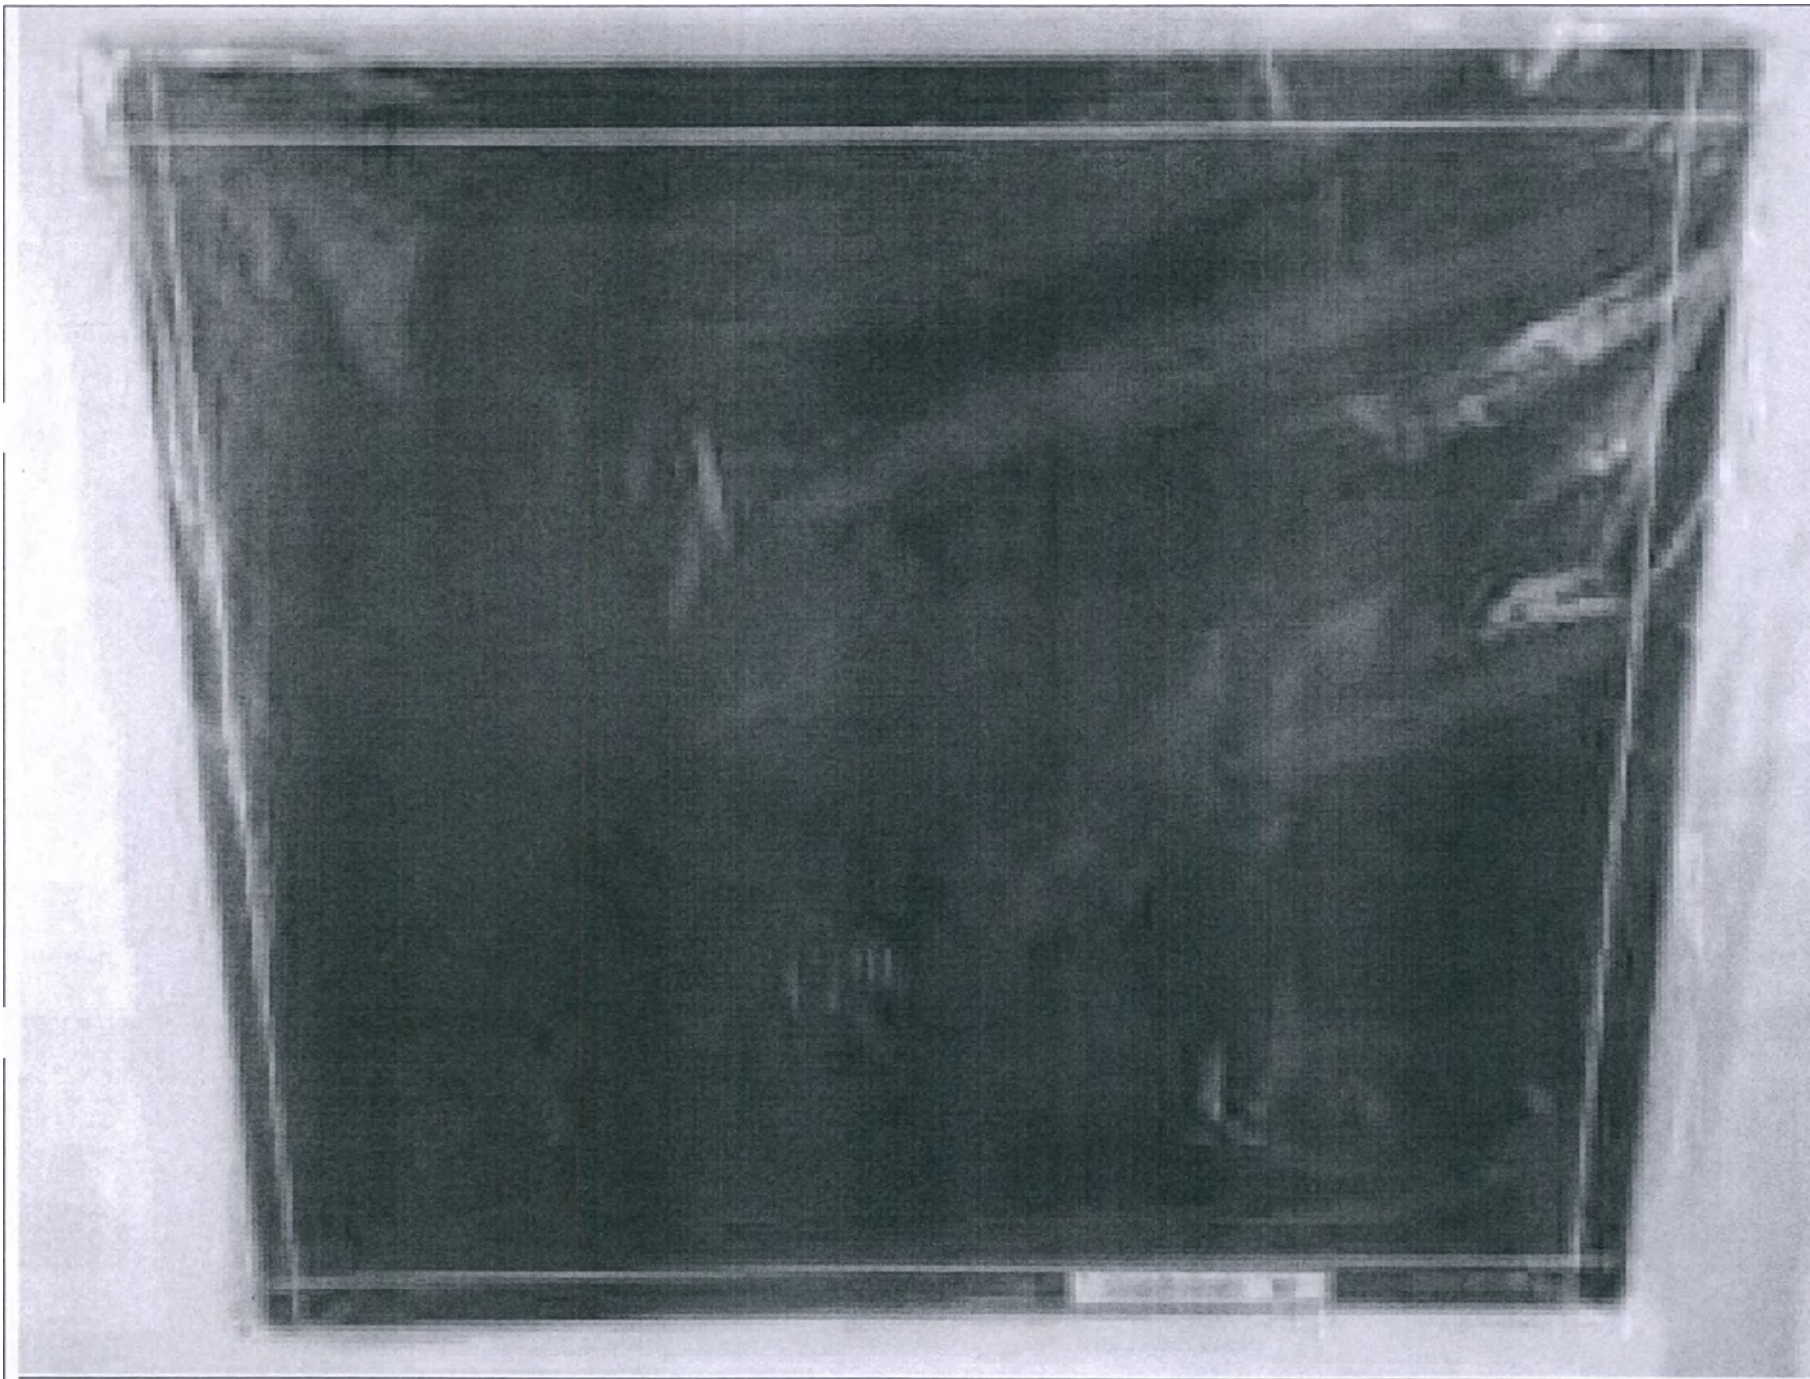

17а. Мешки переносного детектора, не более 100 шт.

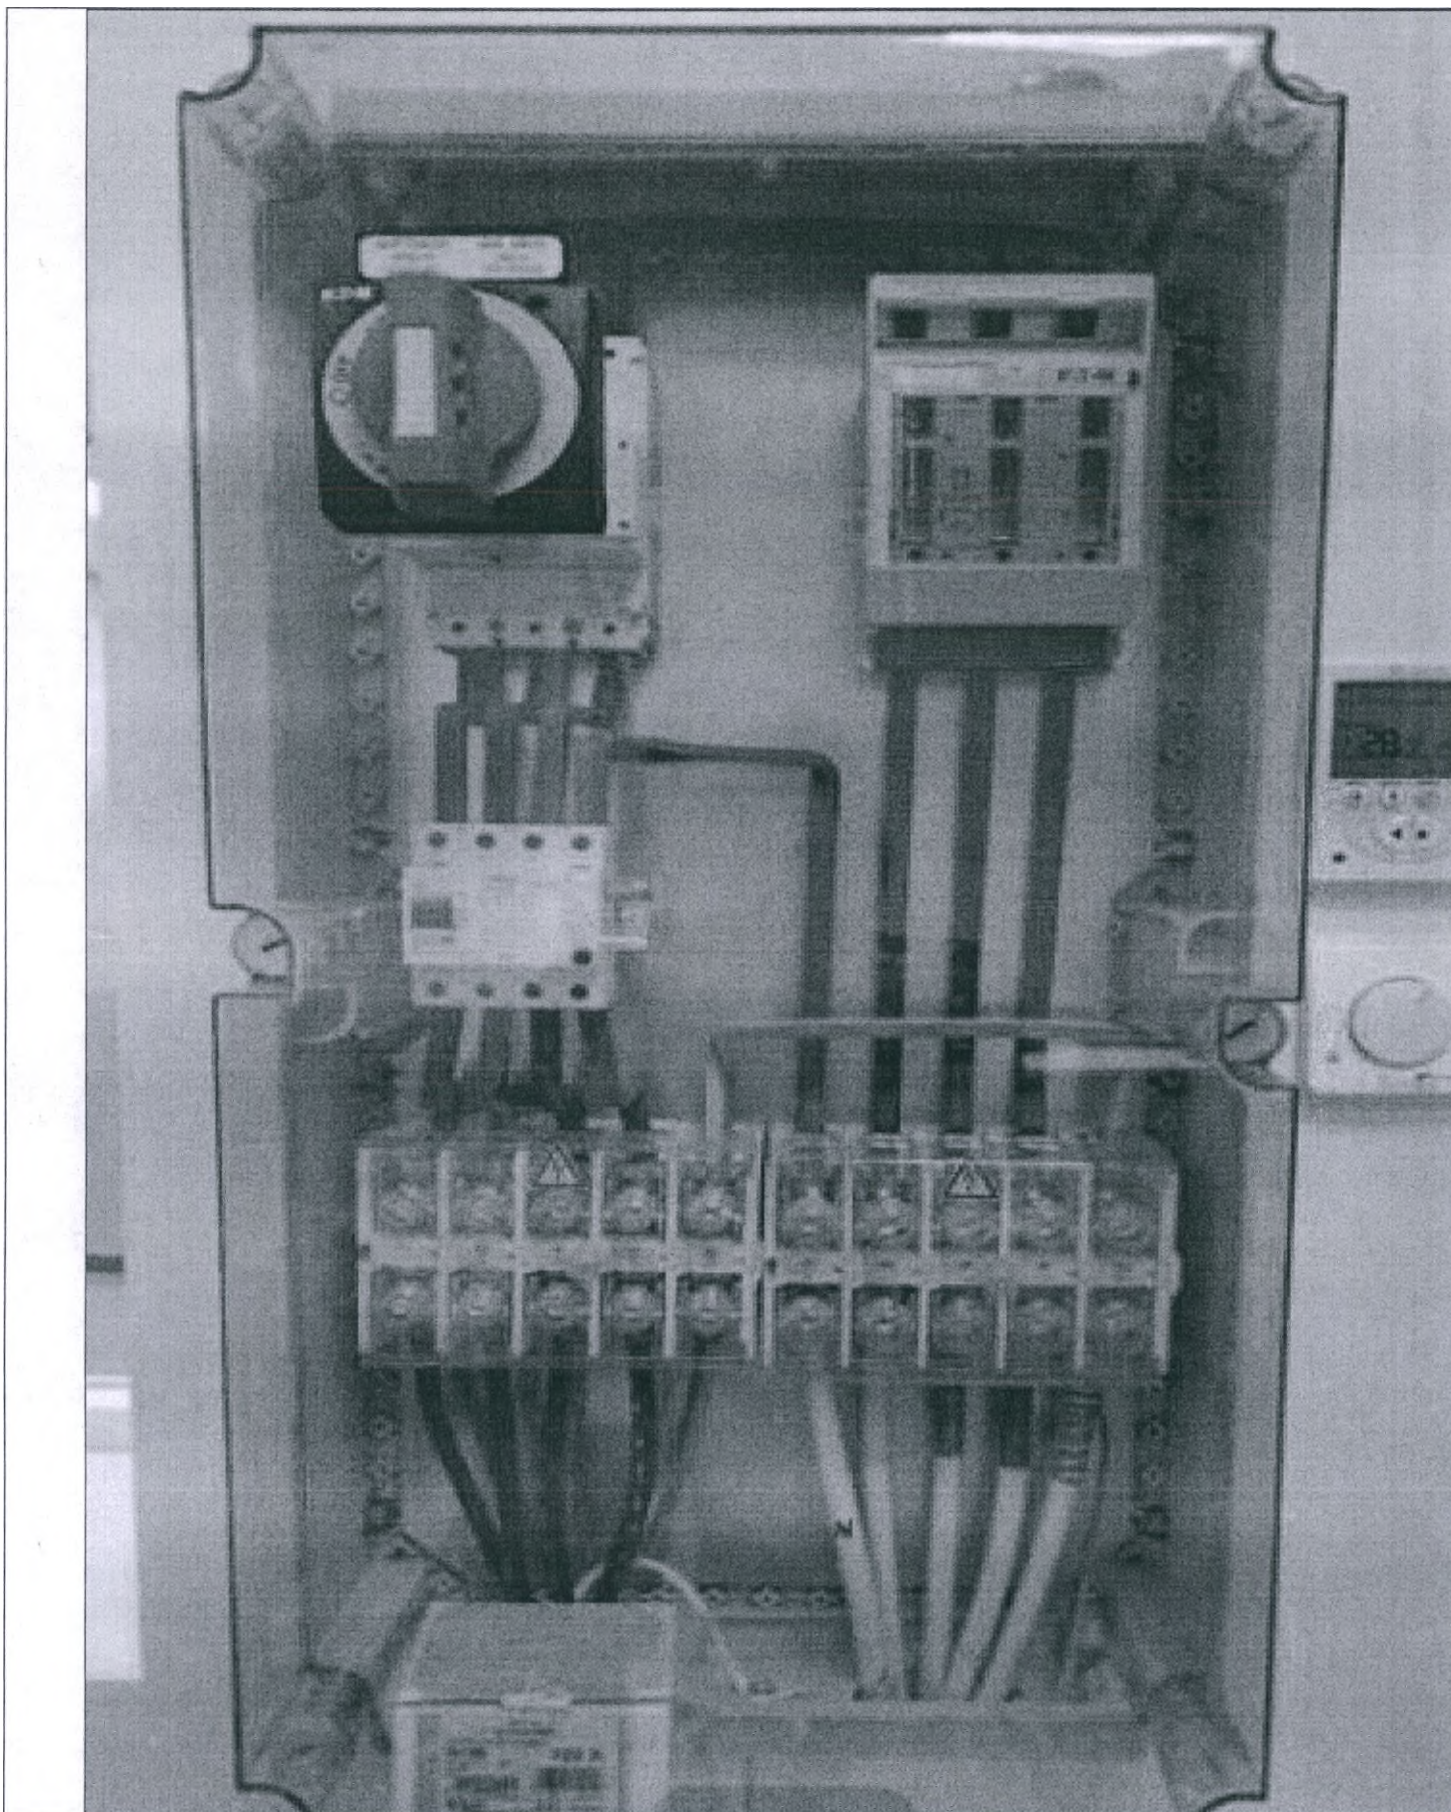

18а. Рубильник включения электропитания.



19а. Устройство переговорное.

Производитель: «Филипс Хэлскеа (Сучжоу) Ко.,
Лтд.», KHP, Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd.,
No.258, Zhong Yuan Road., Suzhou Industrial Park,
215024 Suzhou, Jiangsu Province, PEOPLE'S REPUBLIC
OF CHINA

Место производства: No.258, Zhong Yuan Road.,
Suzhou Industrial Park, 215024 Suzhou, Jiangsu
Province, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Медицинское Изделие:

Система рентгеновская диагностическая цифровая
DuraDiagnost F30 с принадлежностями

Серийный номер/номер партии:
см. на основной маркировке

Дата изготовления: см. на основной маркировке

Номинальный режим работы: см. 

Предупреждения и знаки опасности: см. 


Регистрационное удостоверение:
№ PЗН 2018/7705




Макет маркировки на русском языке.

УПАКОВКА




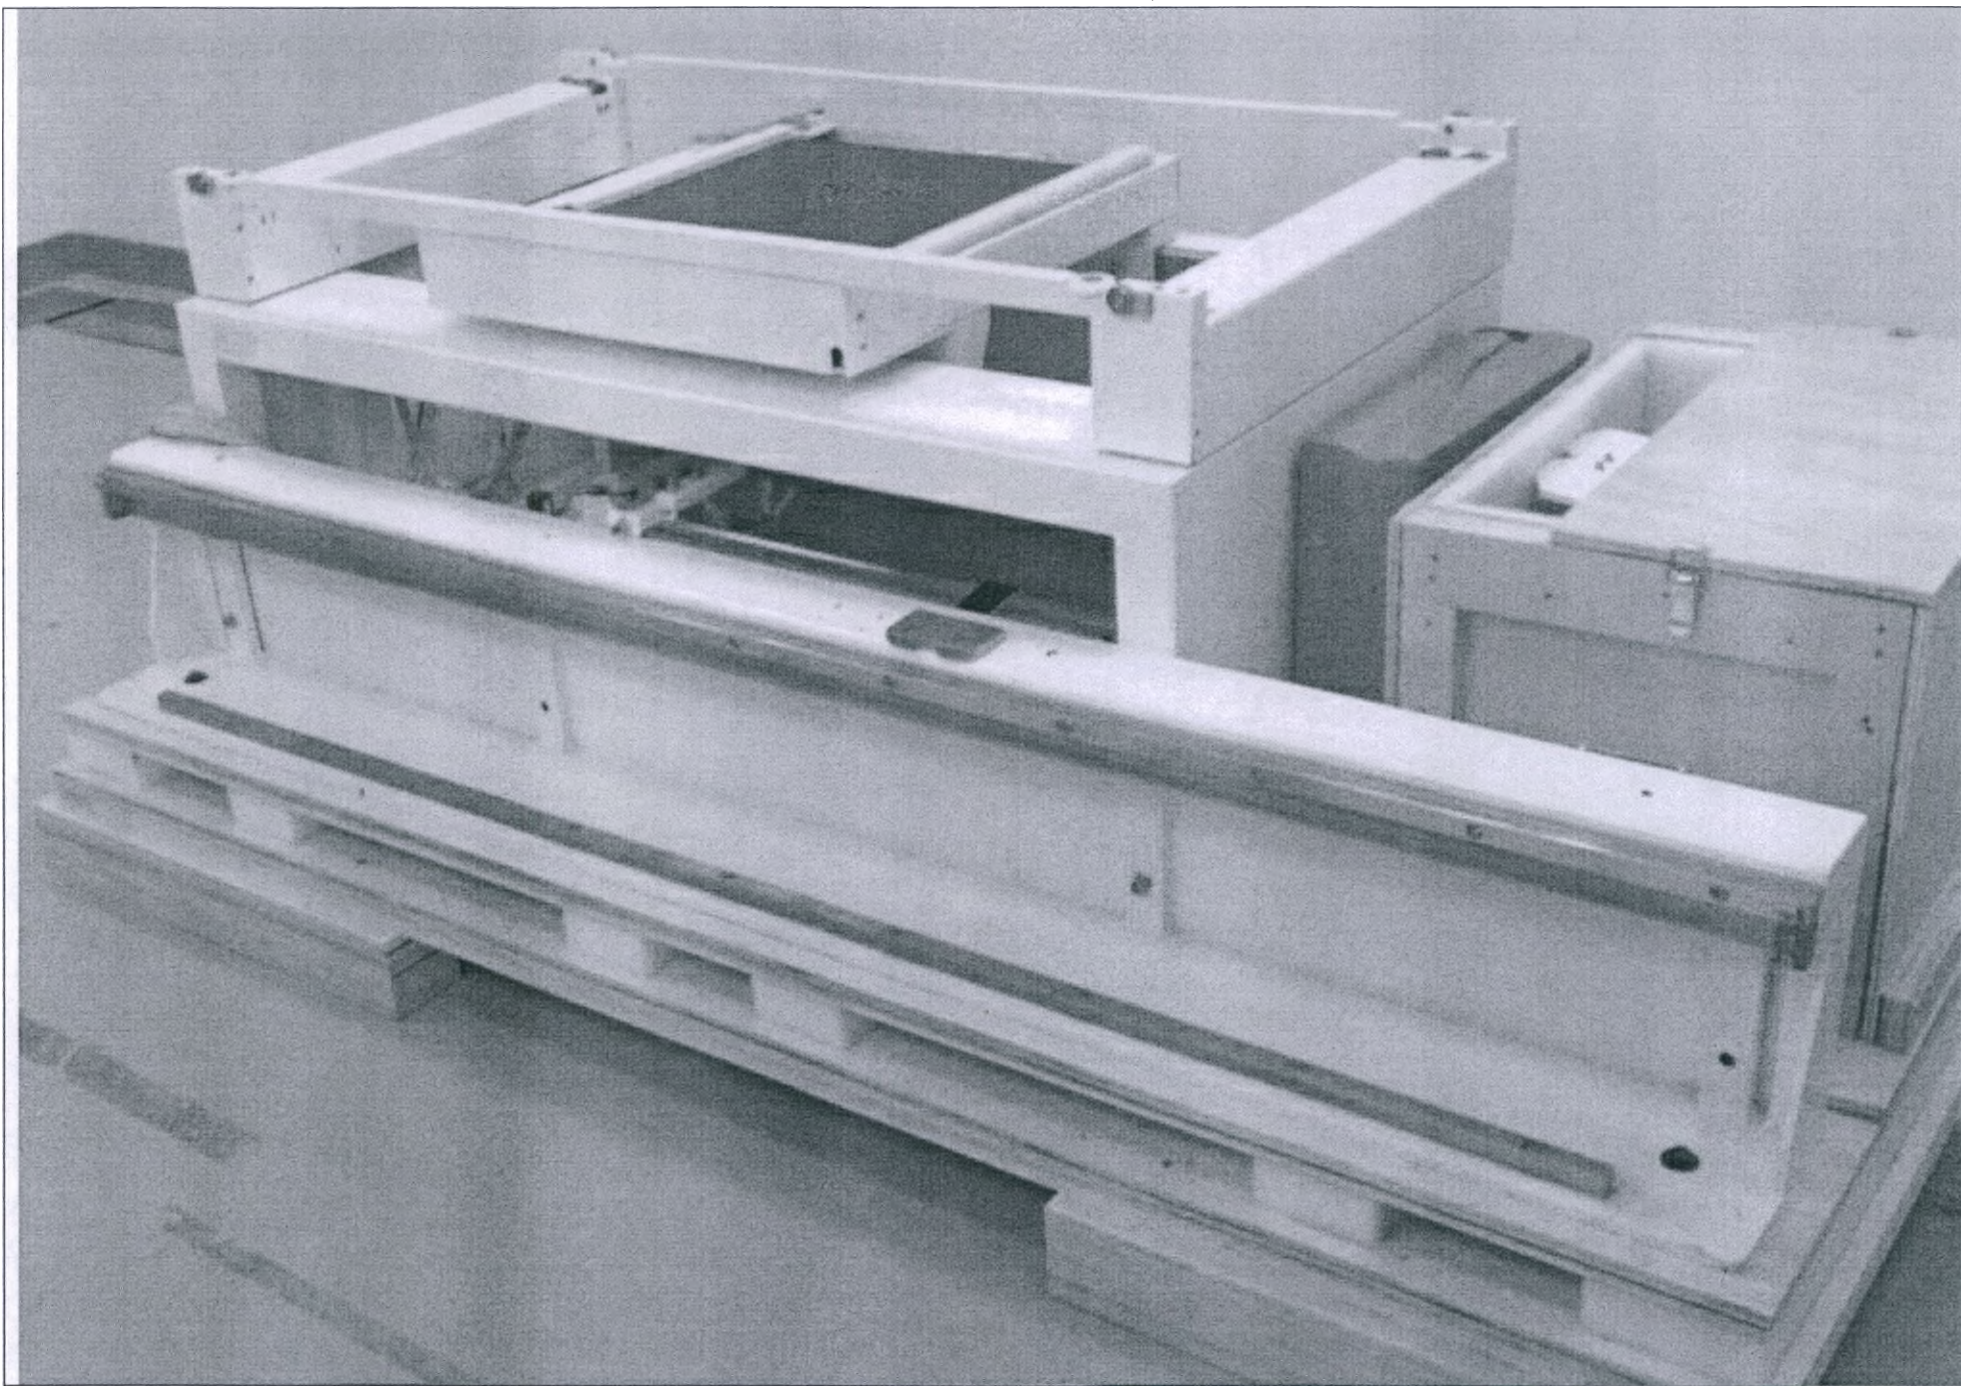


2. Упаковка основы стола пациента и основы стойки трубы.

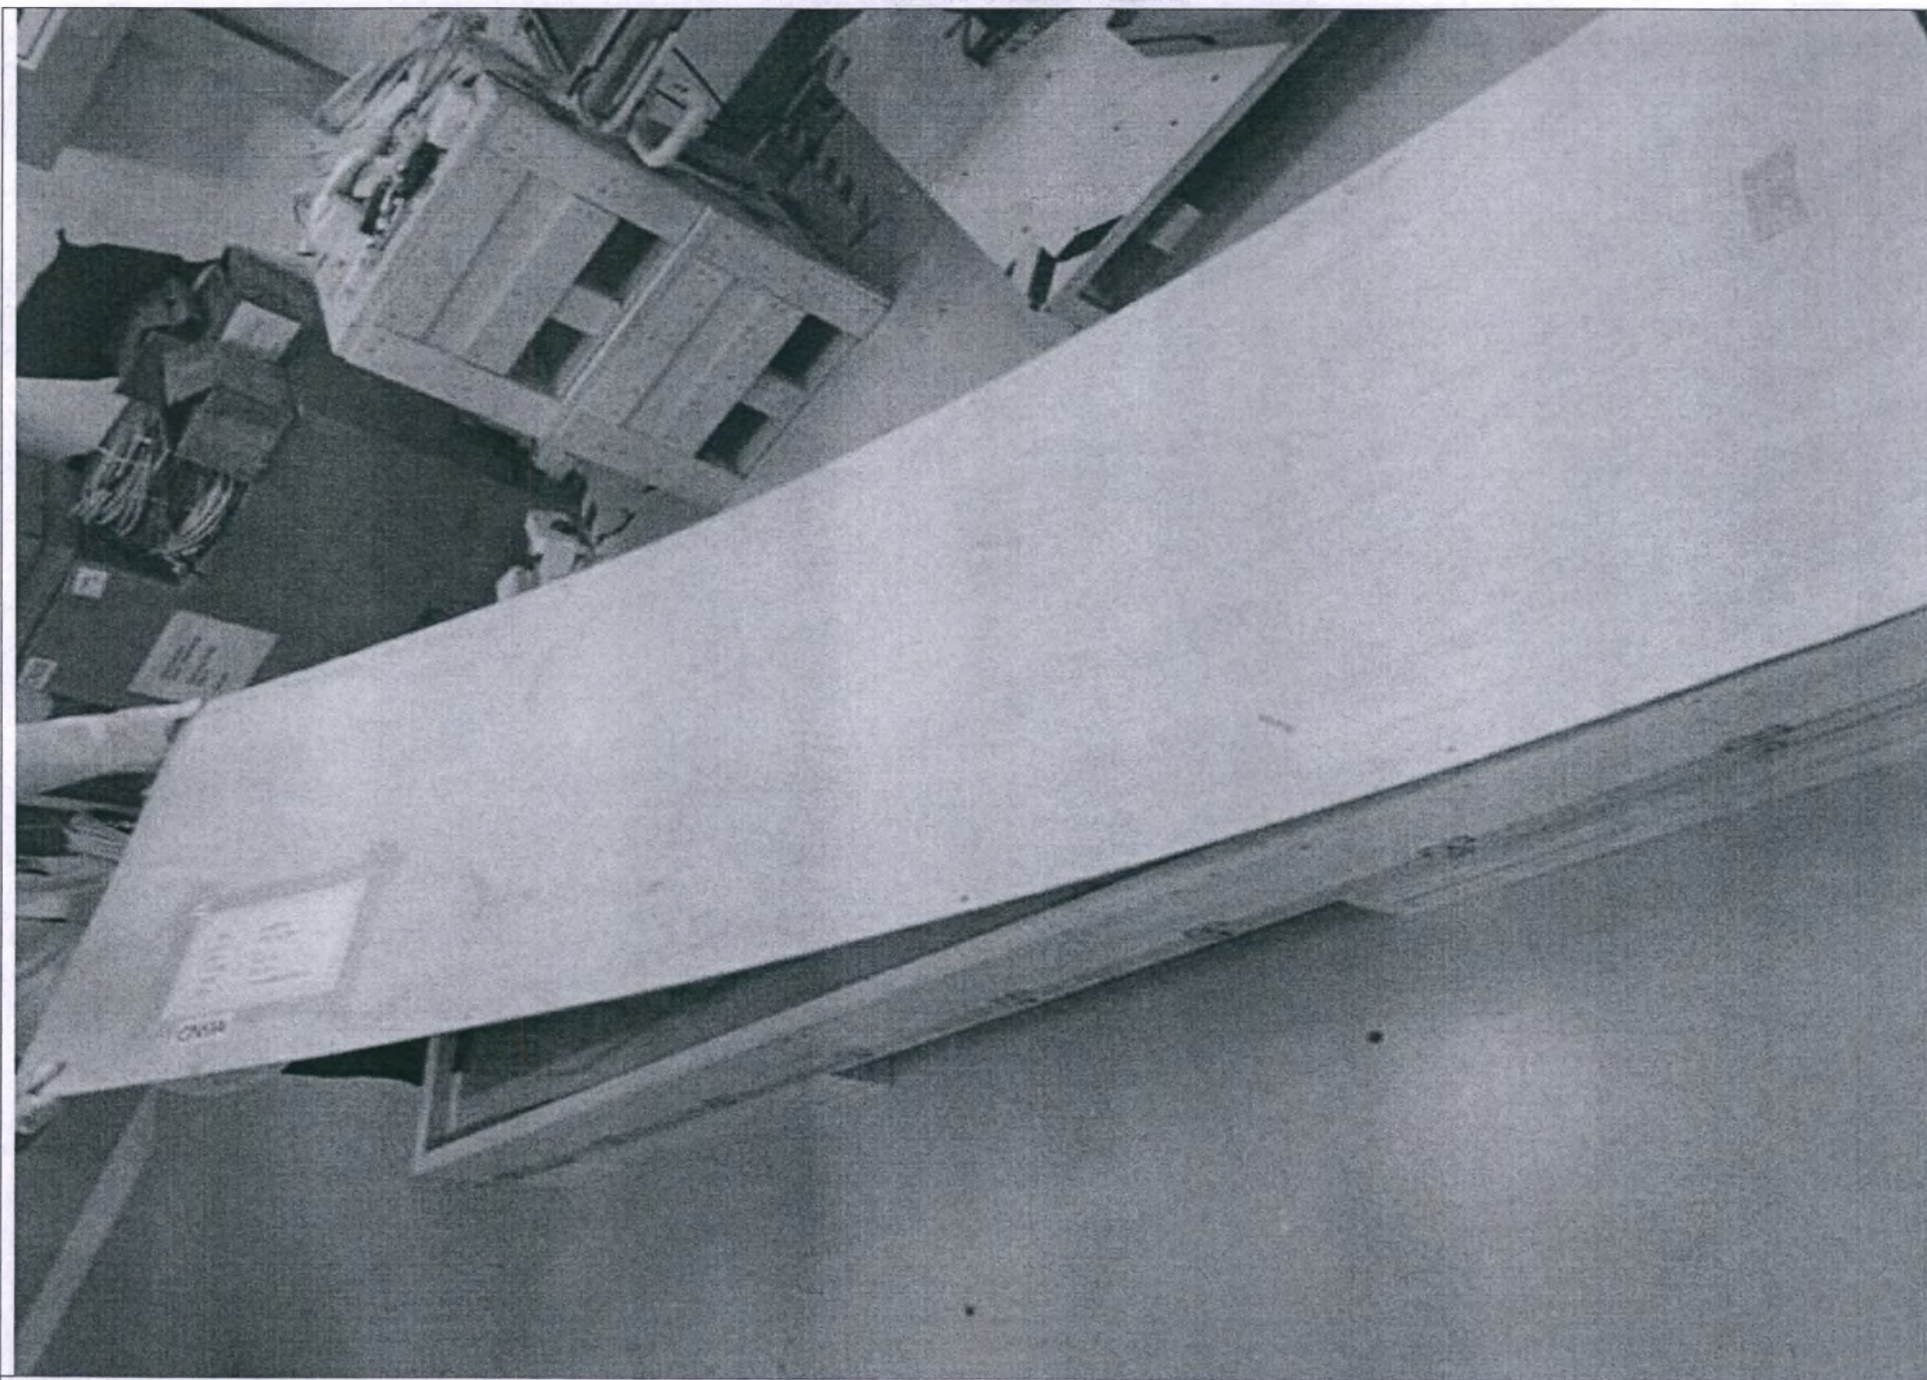

3. Упаковка деки стола пациента.

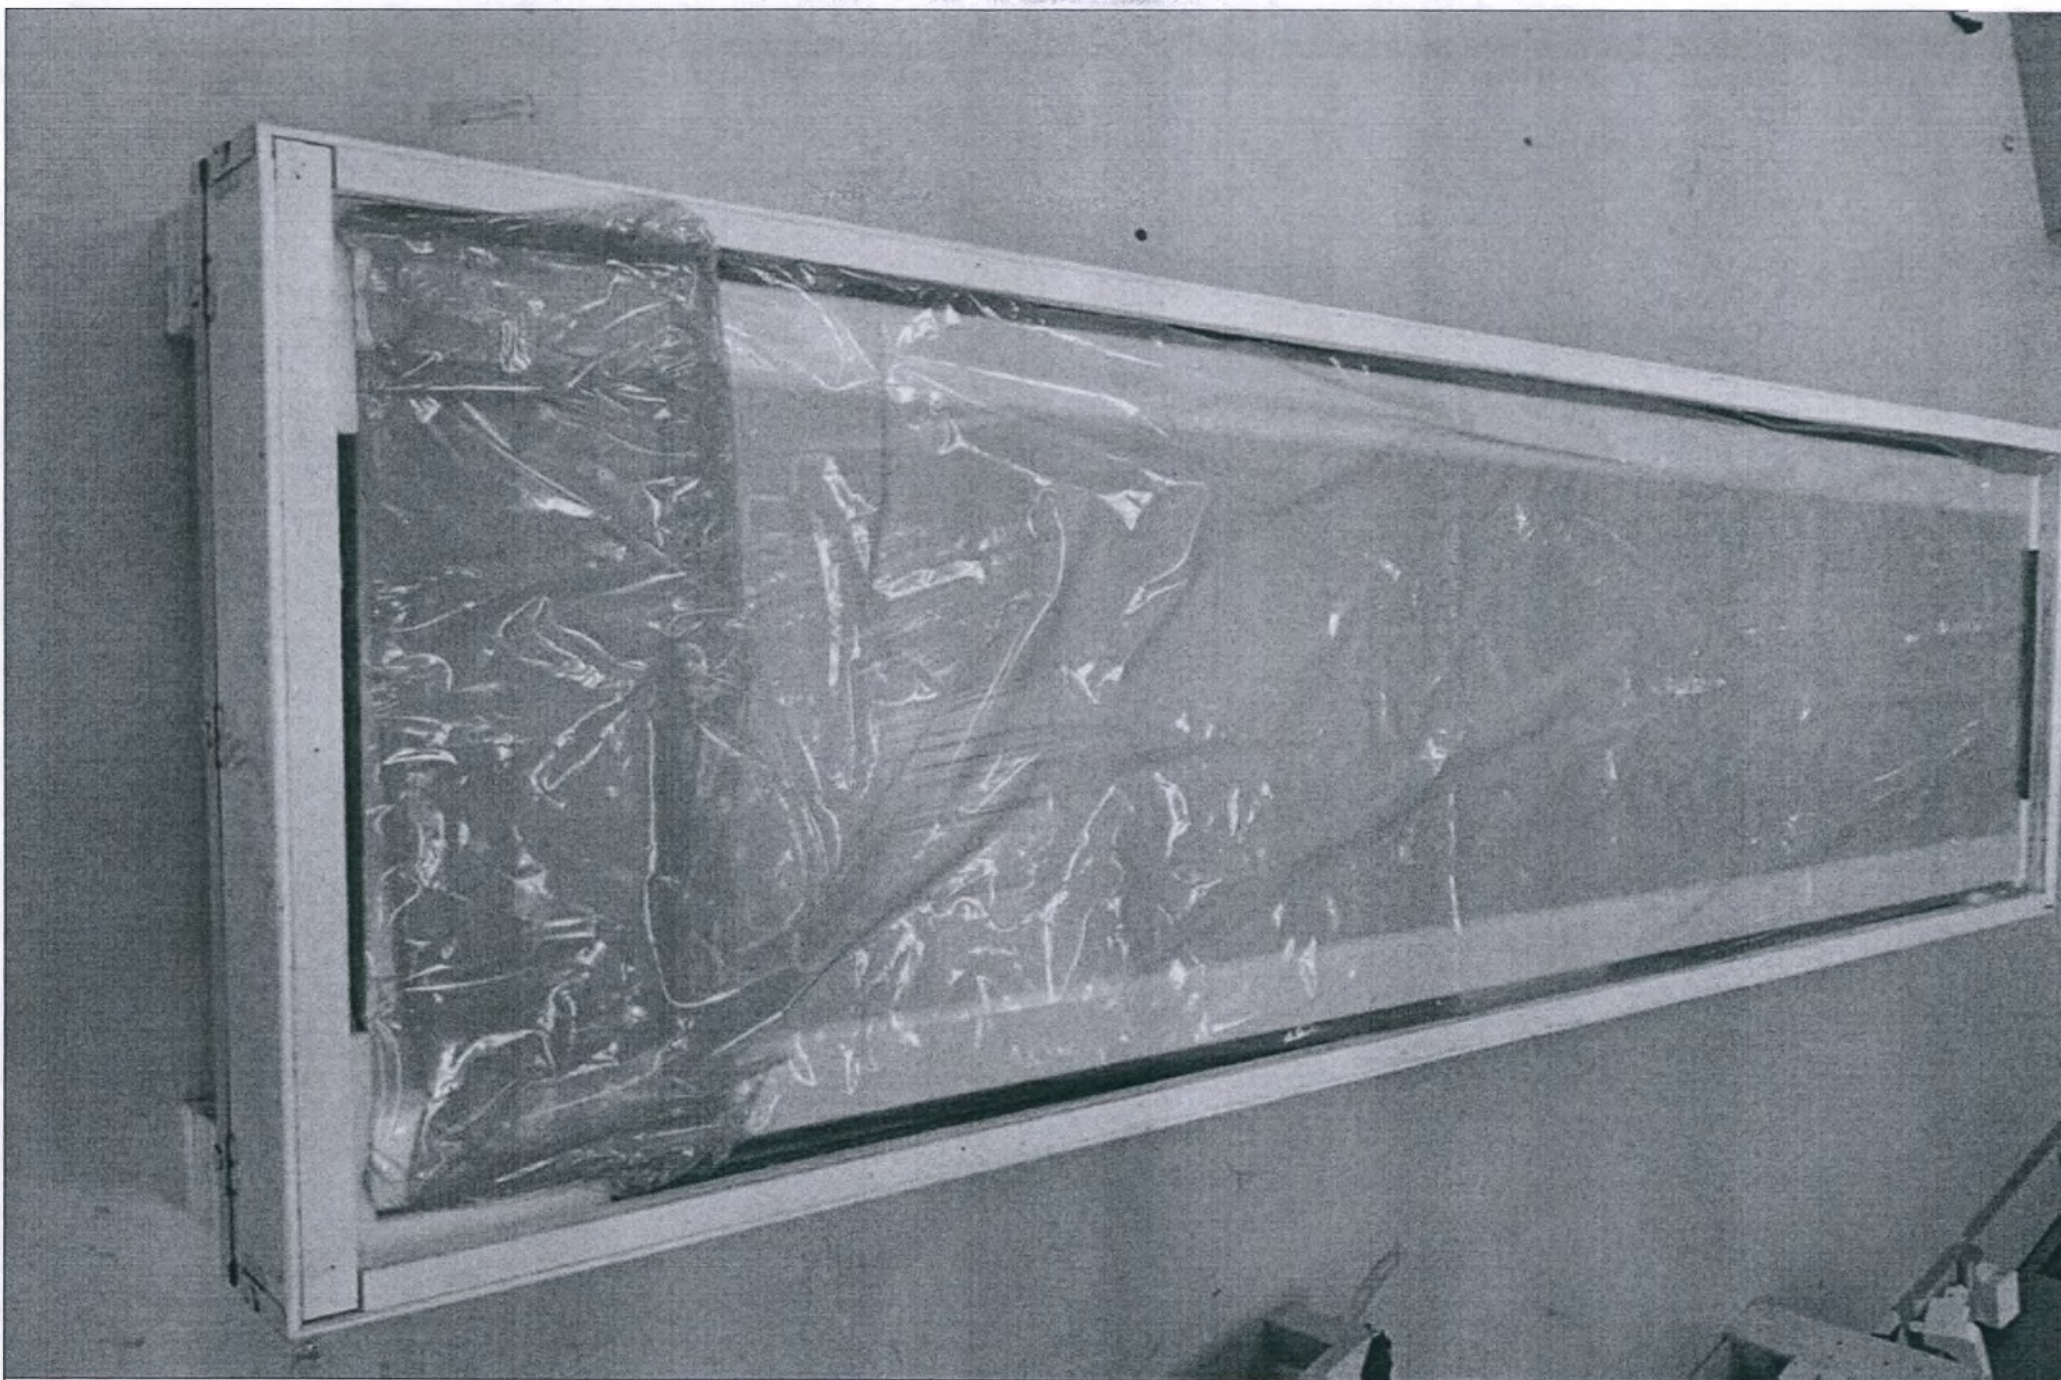


4. Упаковка деки стола пациента.

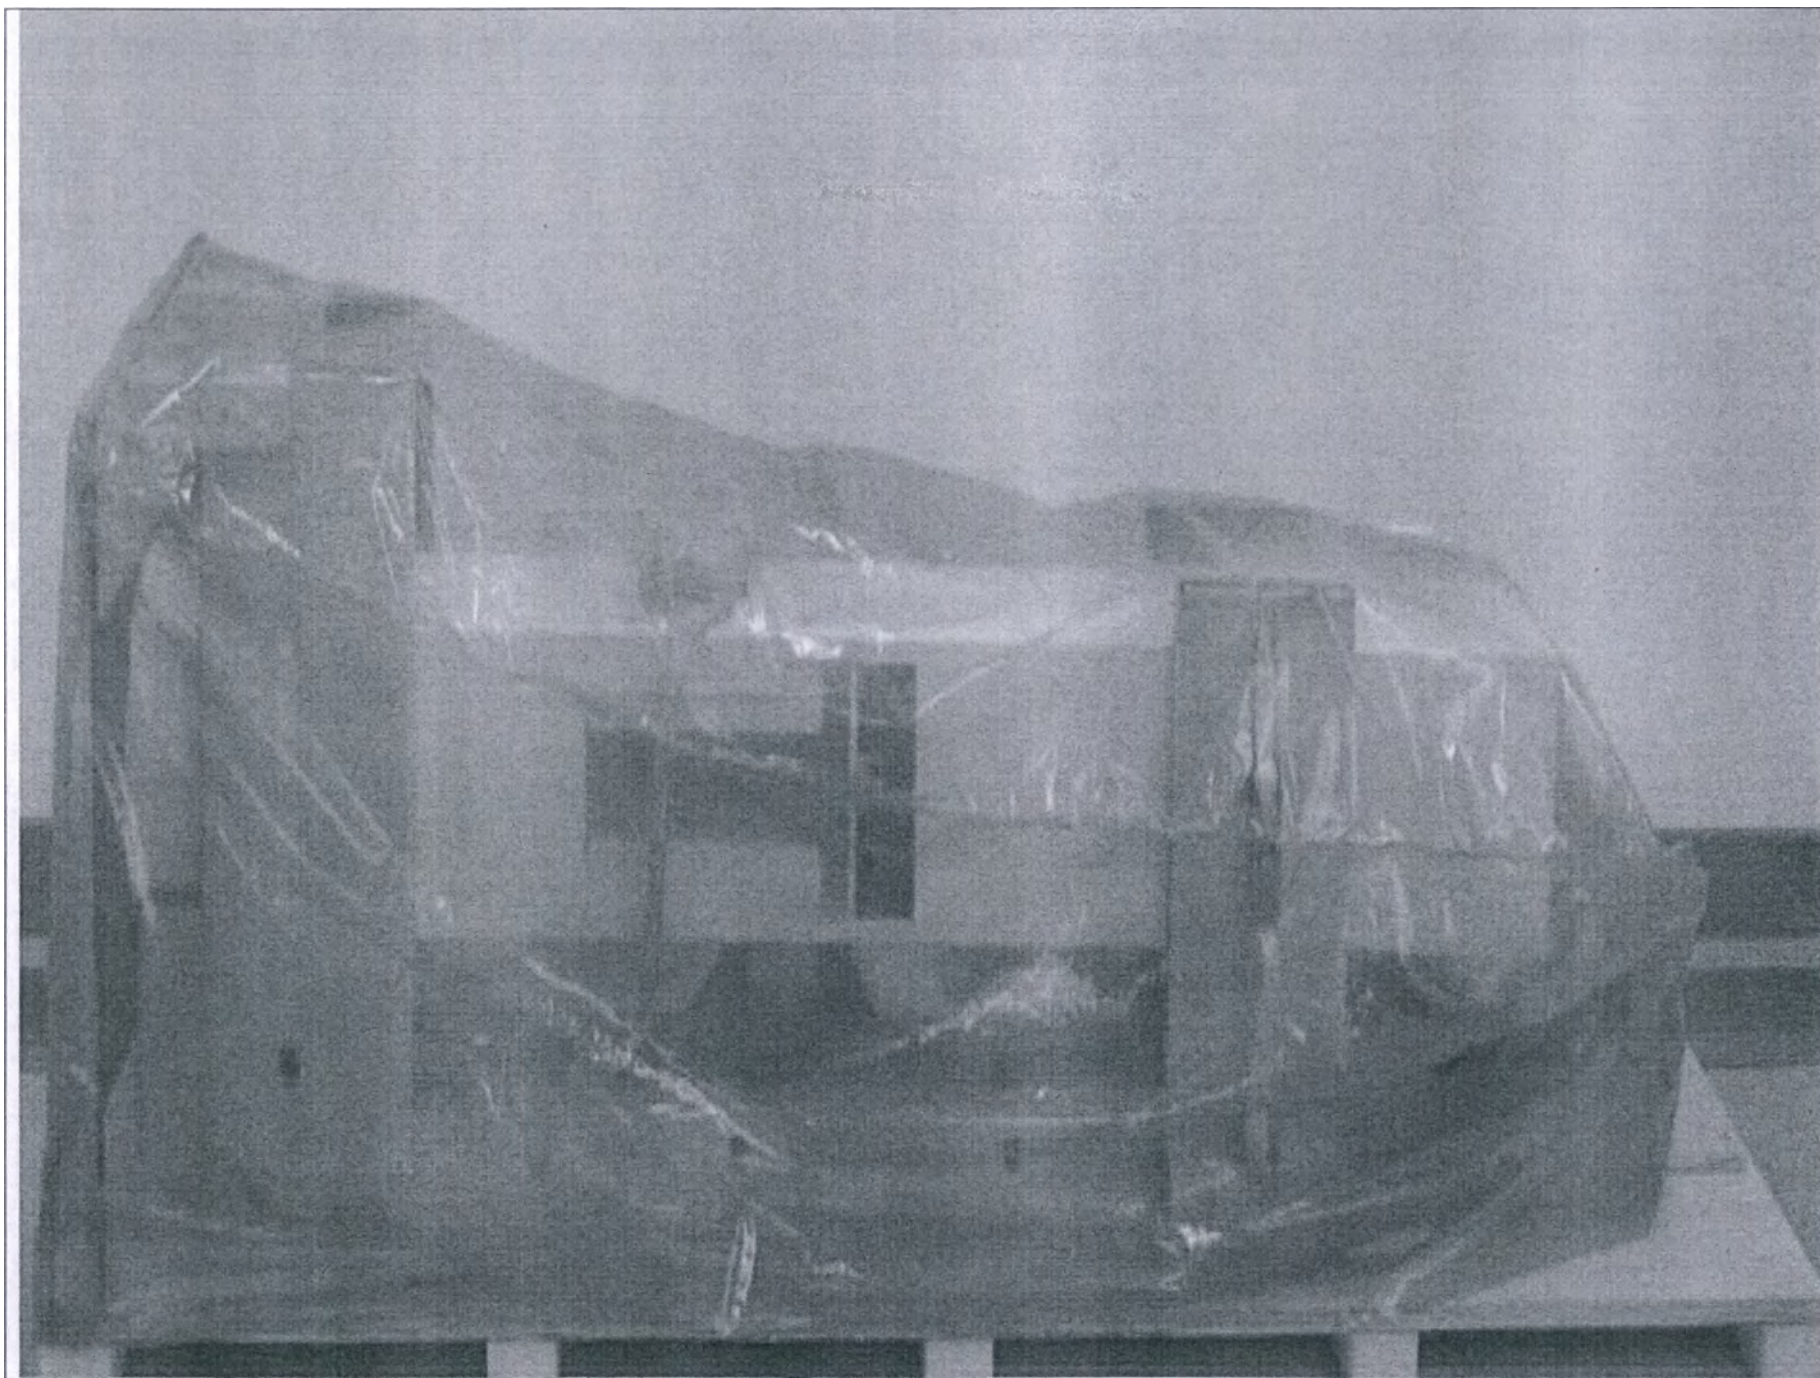


5. Упаковка стойки трубы.




6. Упаковка блока рентгеновской трубки.

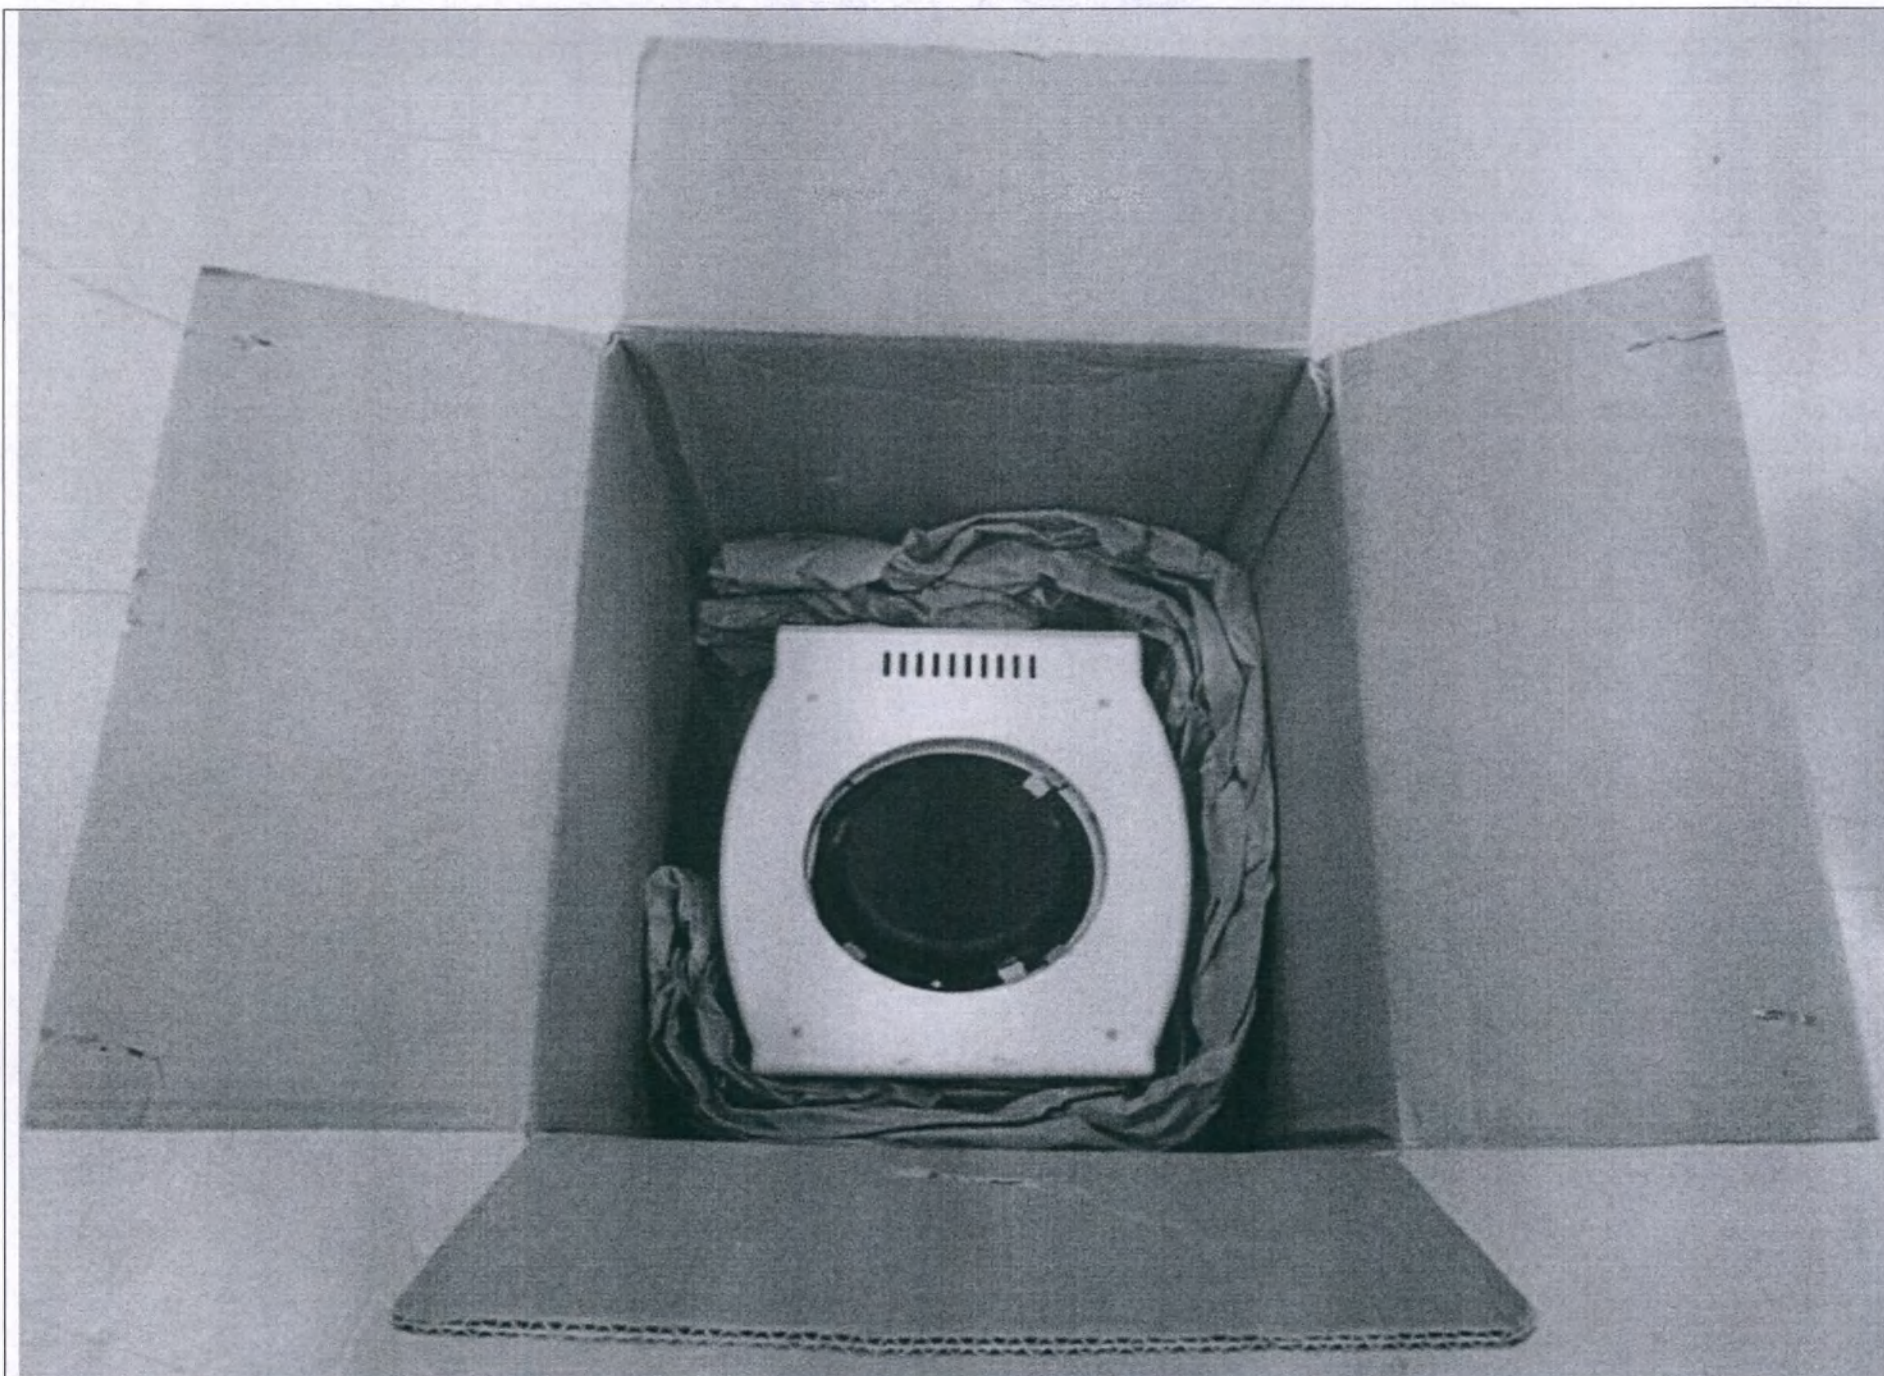

7. Упаковка коллиматора.

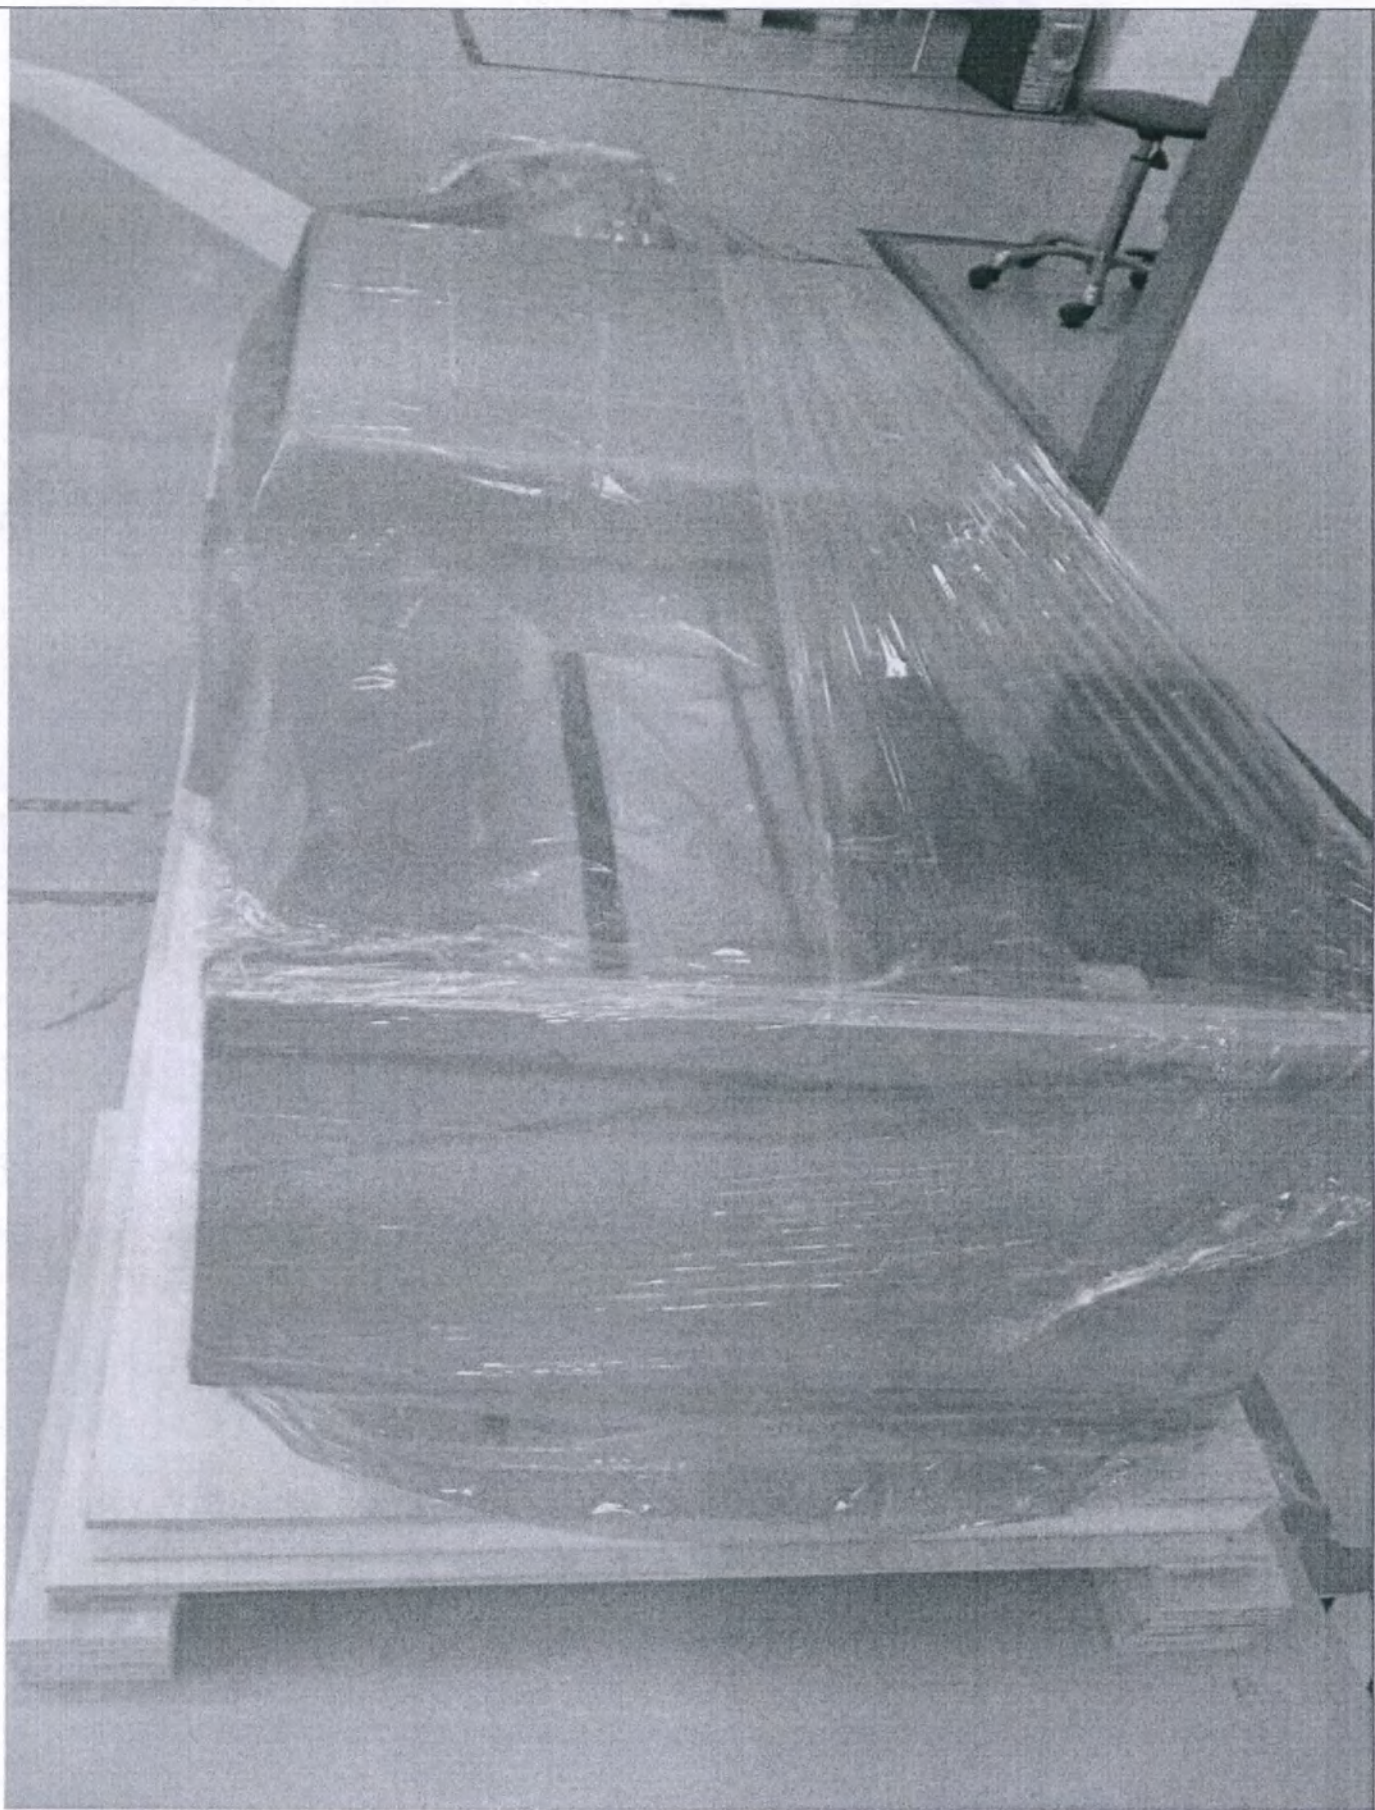


8. Упаковка вертикальной стойки.

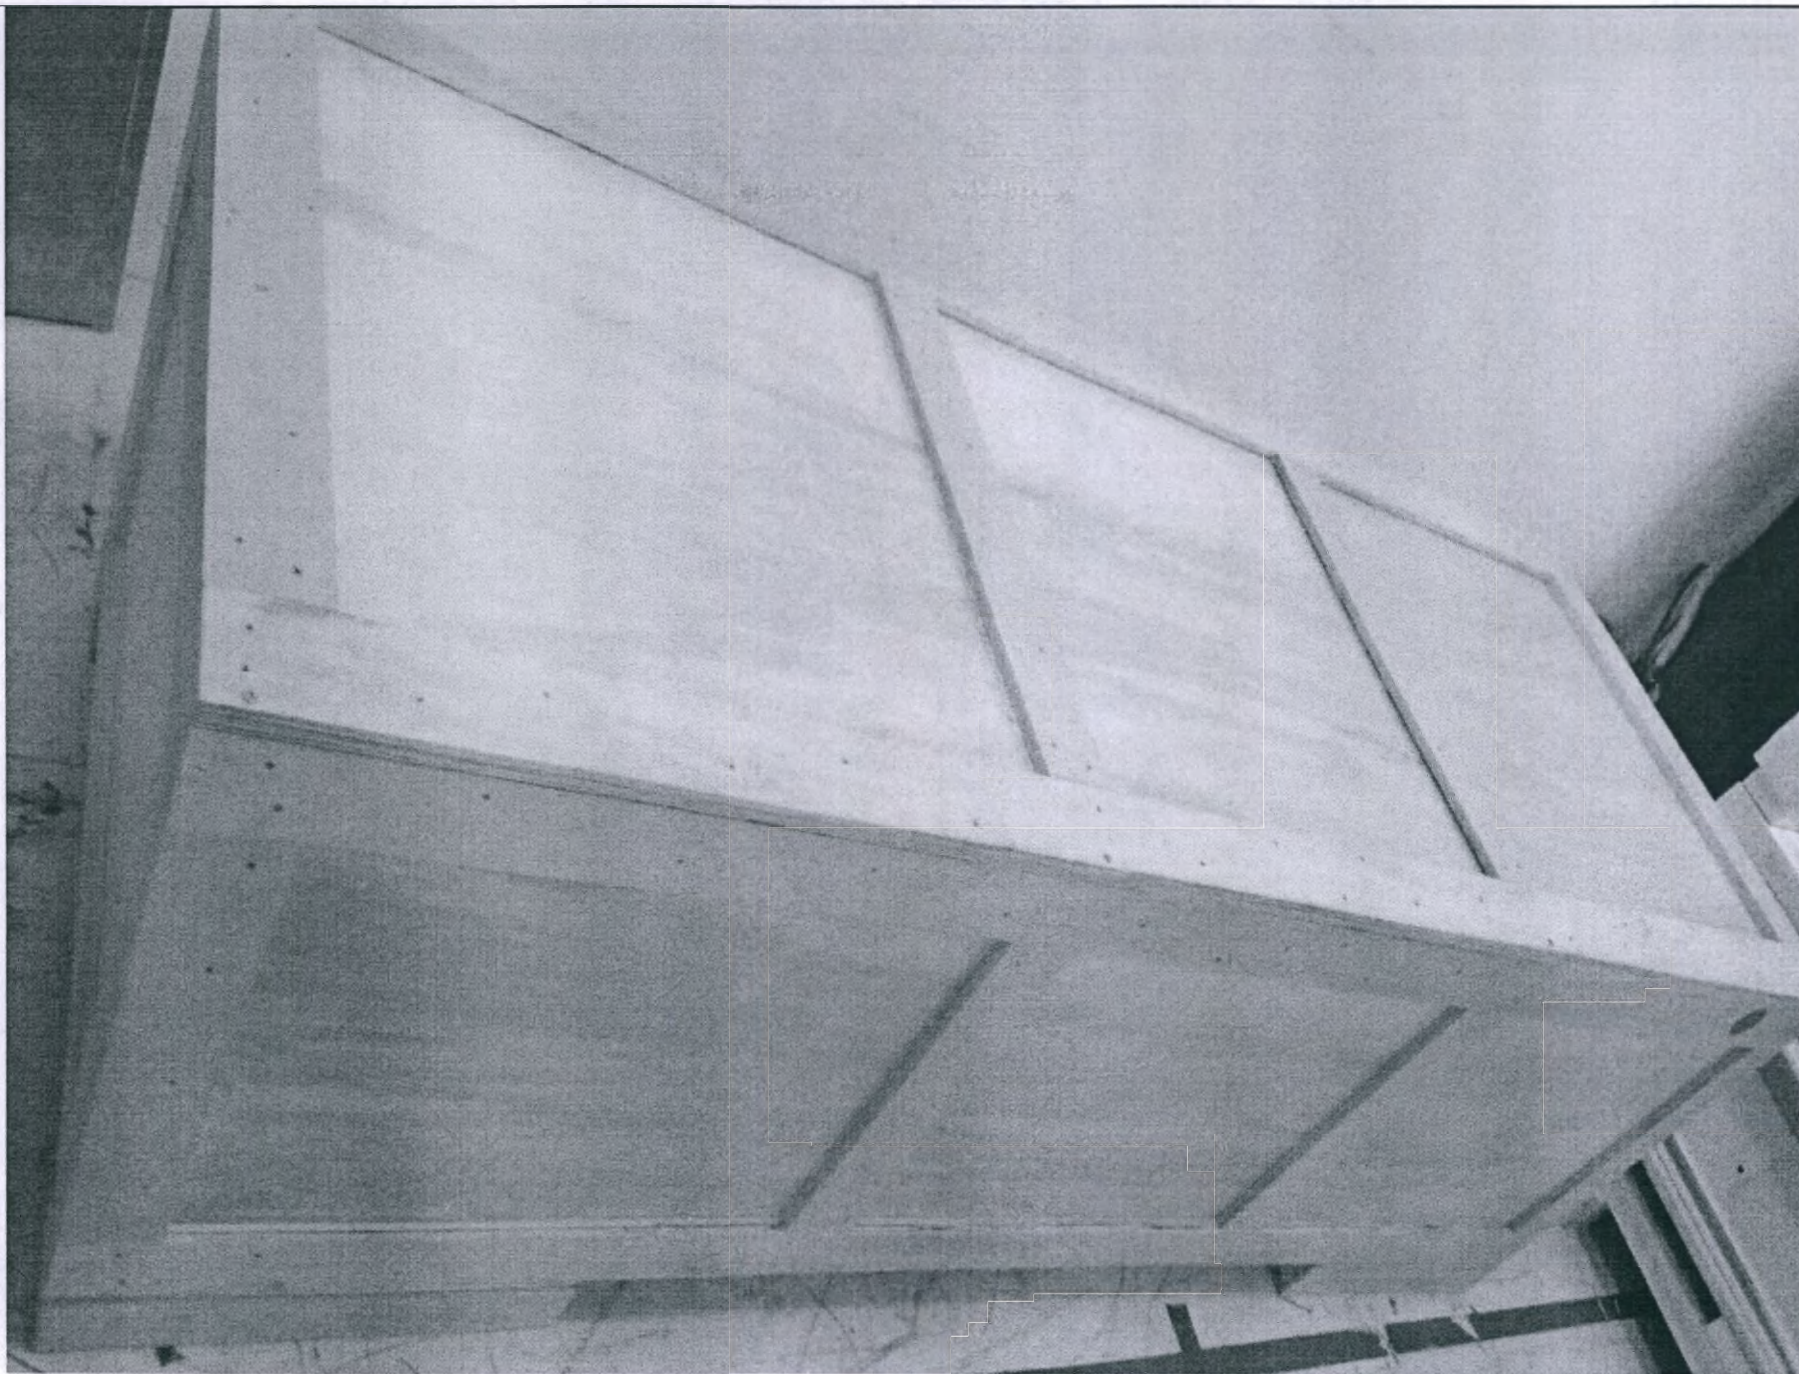


9. Упаковка основных частей системы DuraDiagnost F30: стойка вертикальная.




10. Упаковка основных частей системы DuraDiagnost F30: стойка трубки.

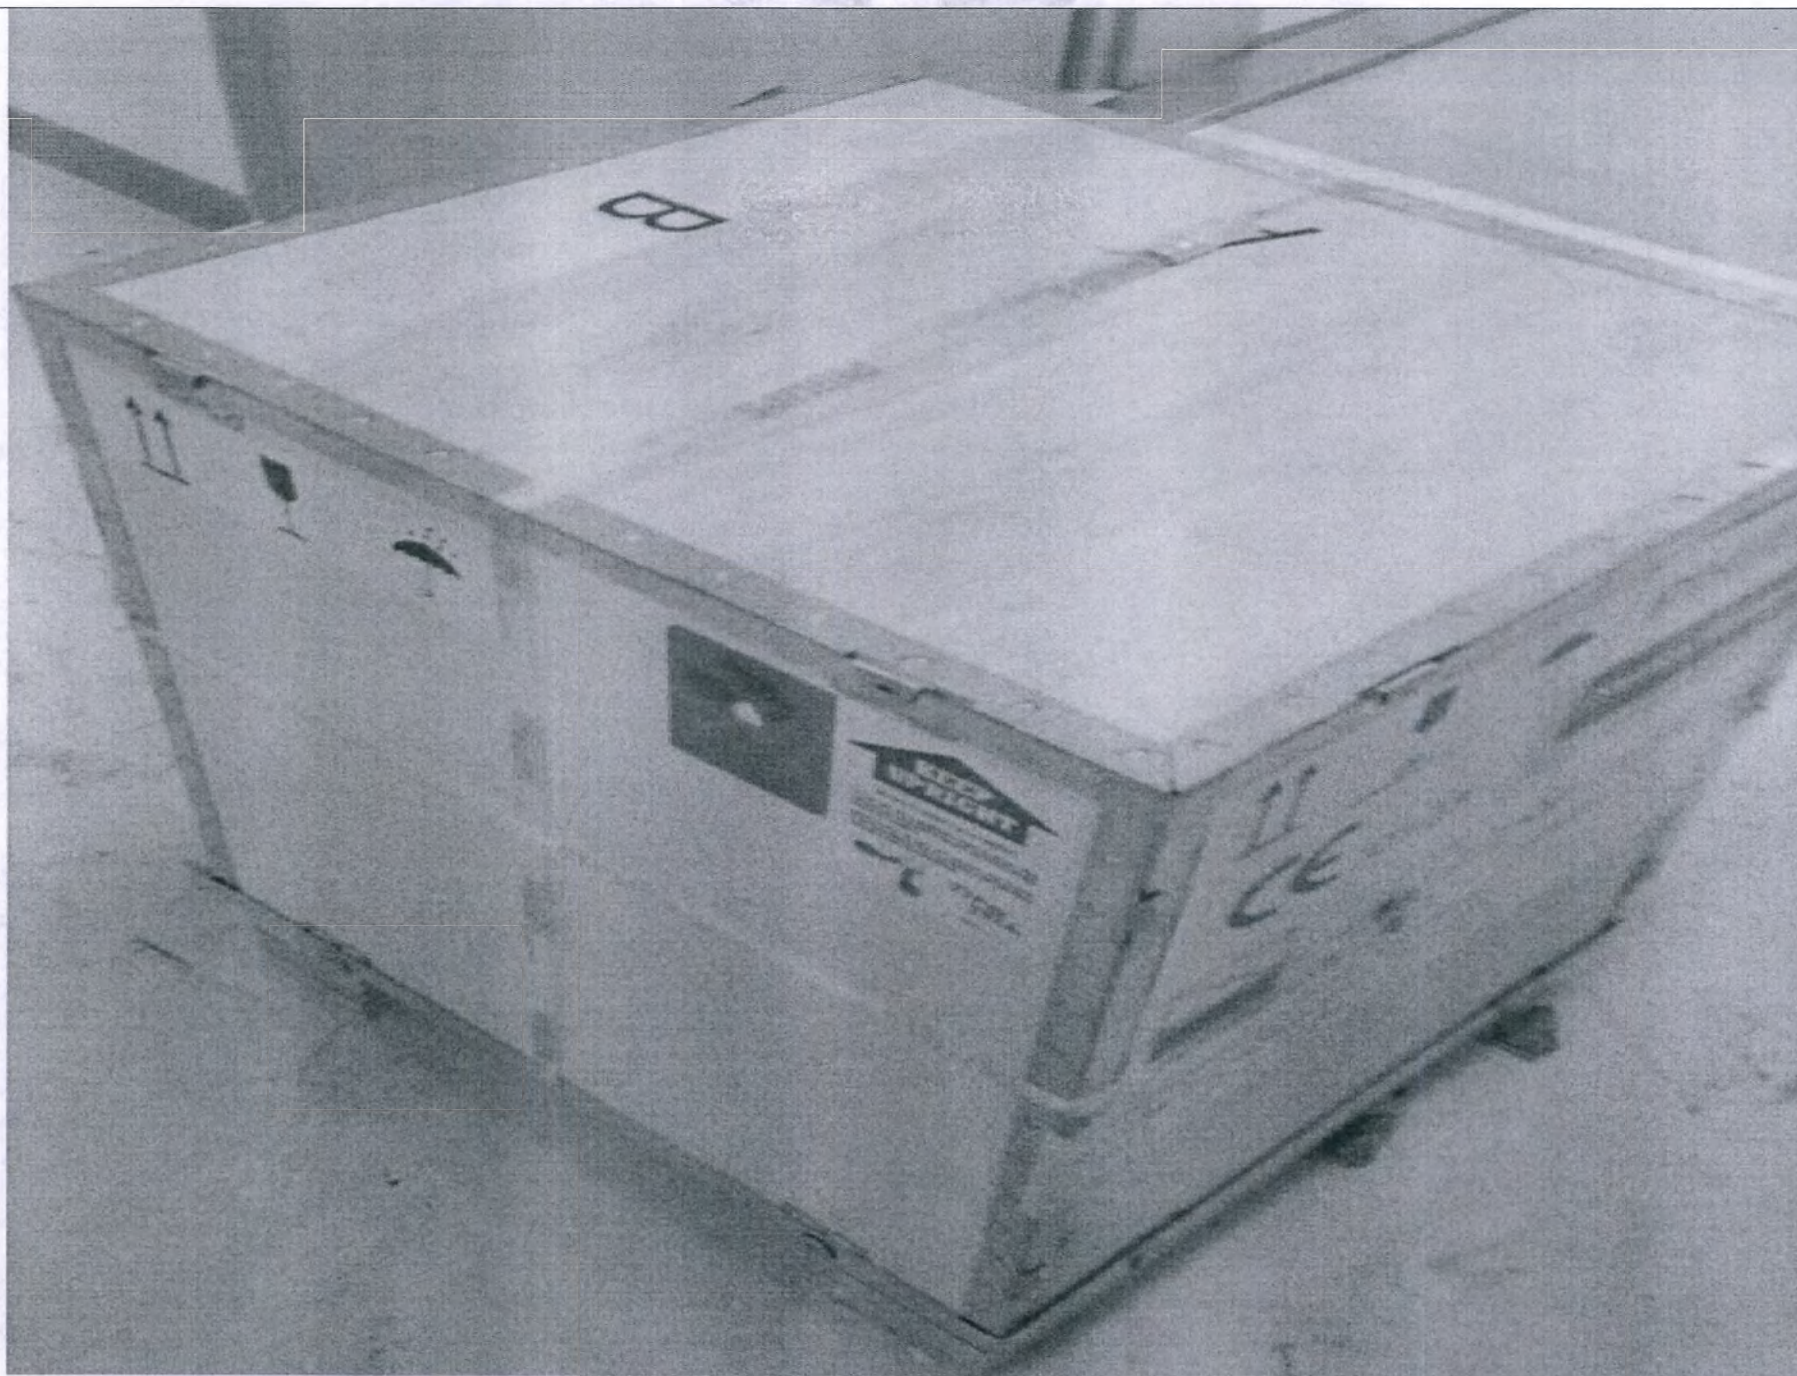


11. Упаковка основных частей системы DuraDiagnost F30: блок рентгеновской трубки .

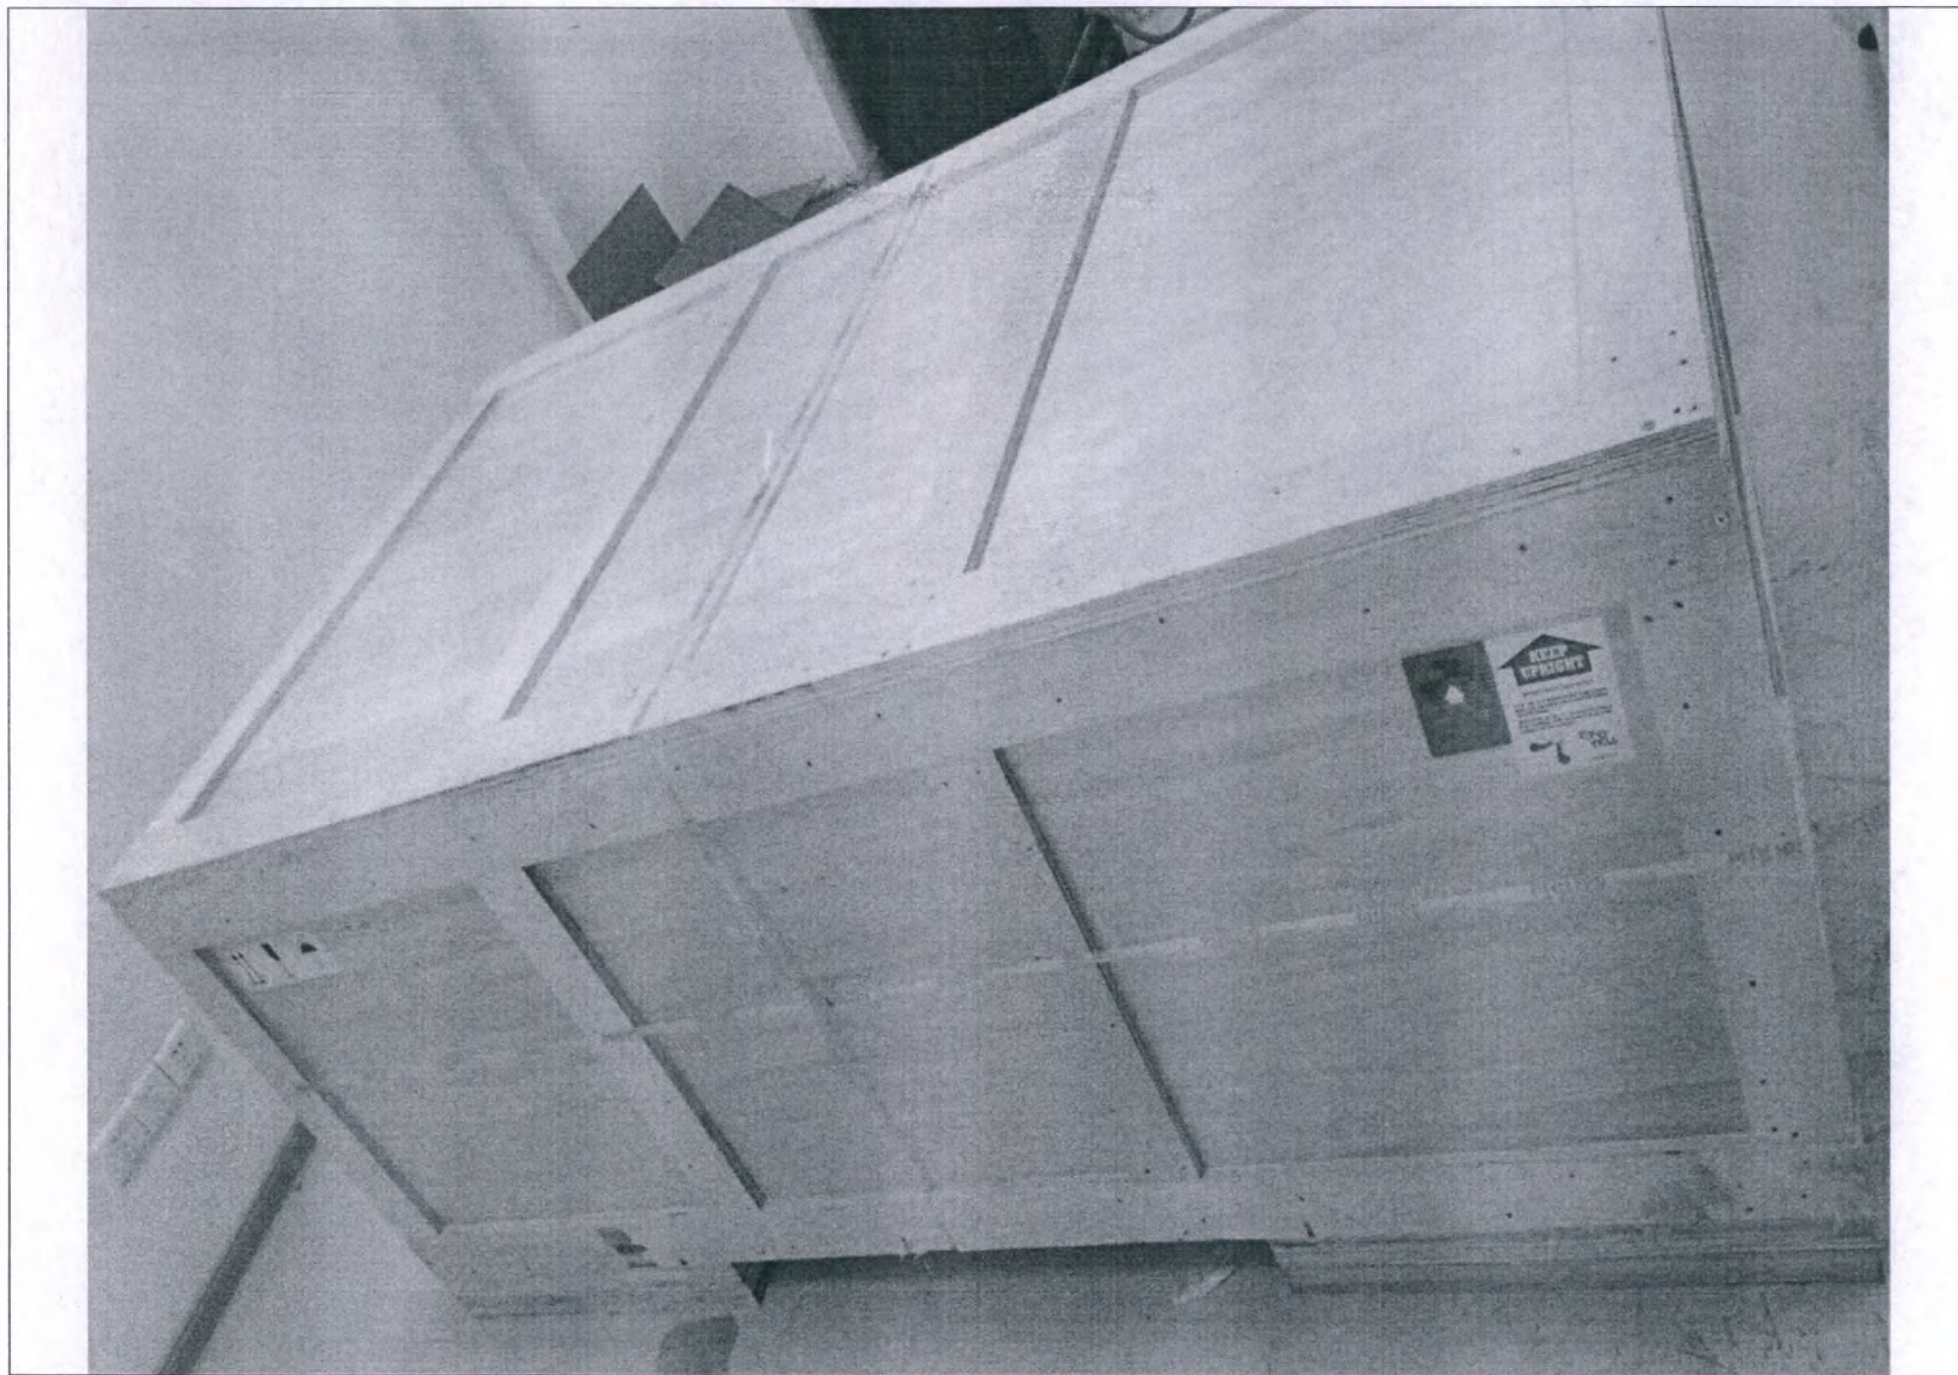


12. Упаковка основных частей системы DuraDiagnost F30: опора стола для пациента.

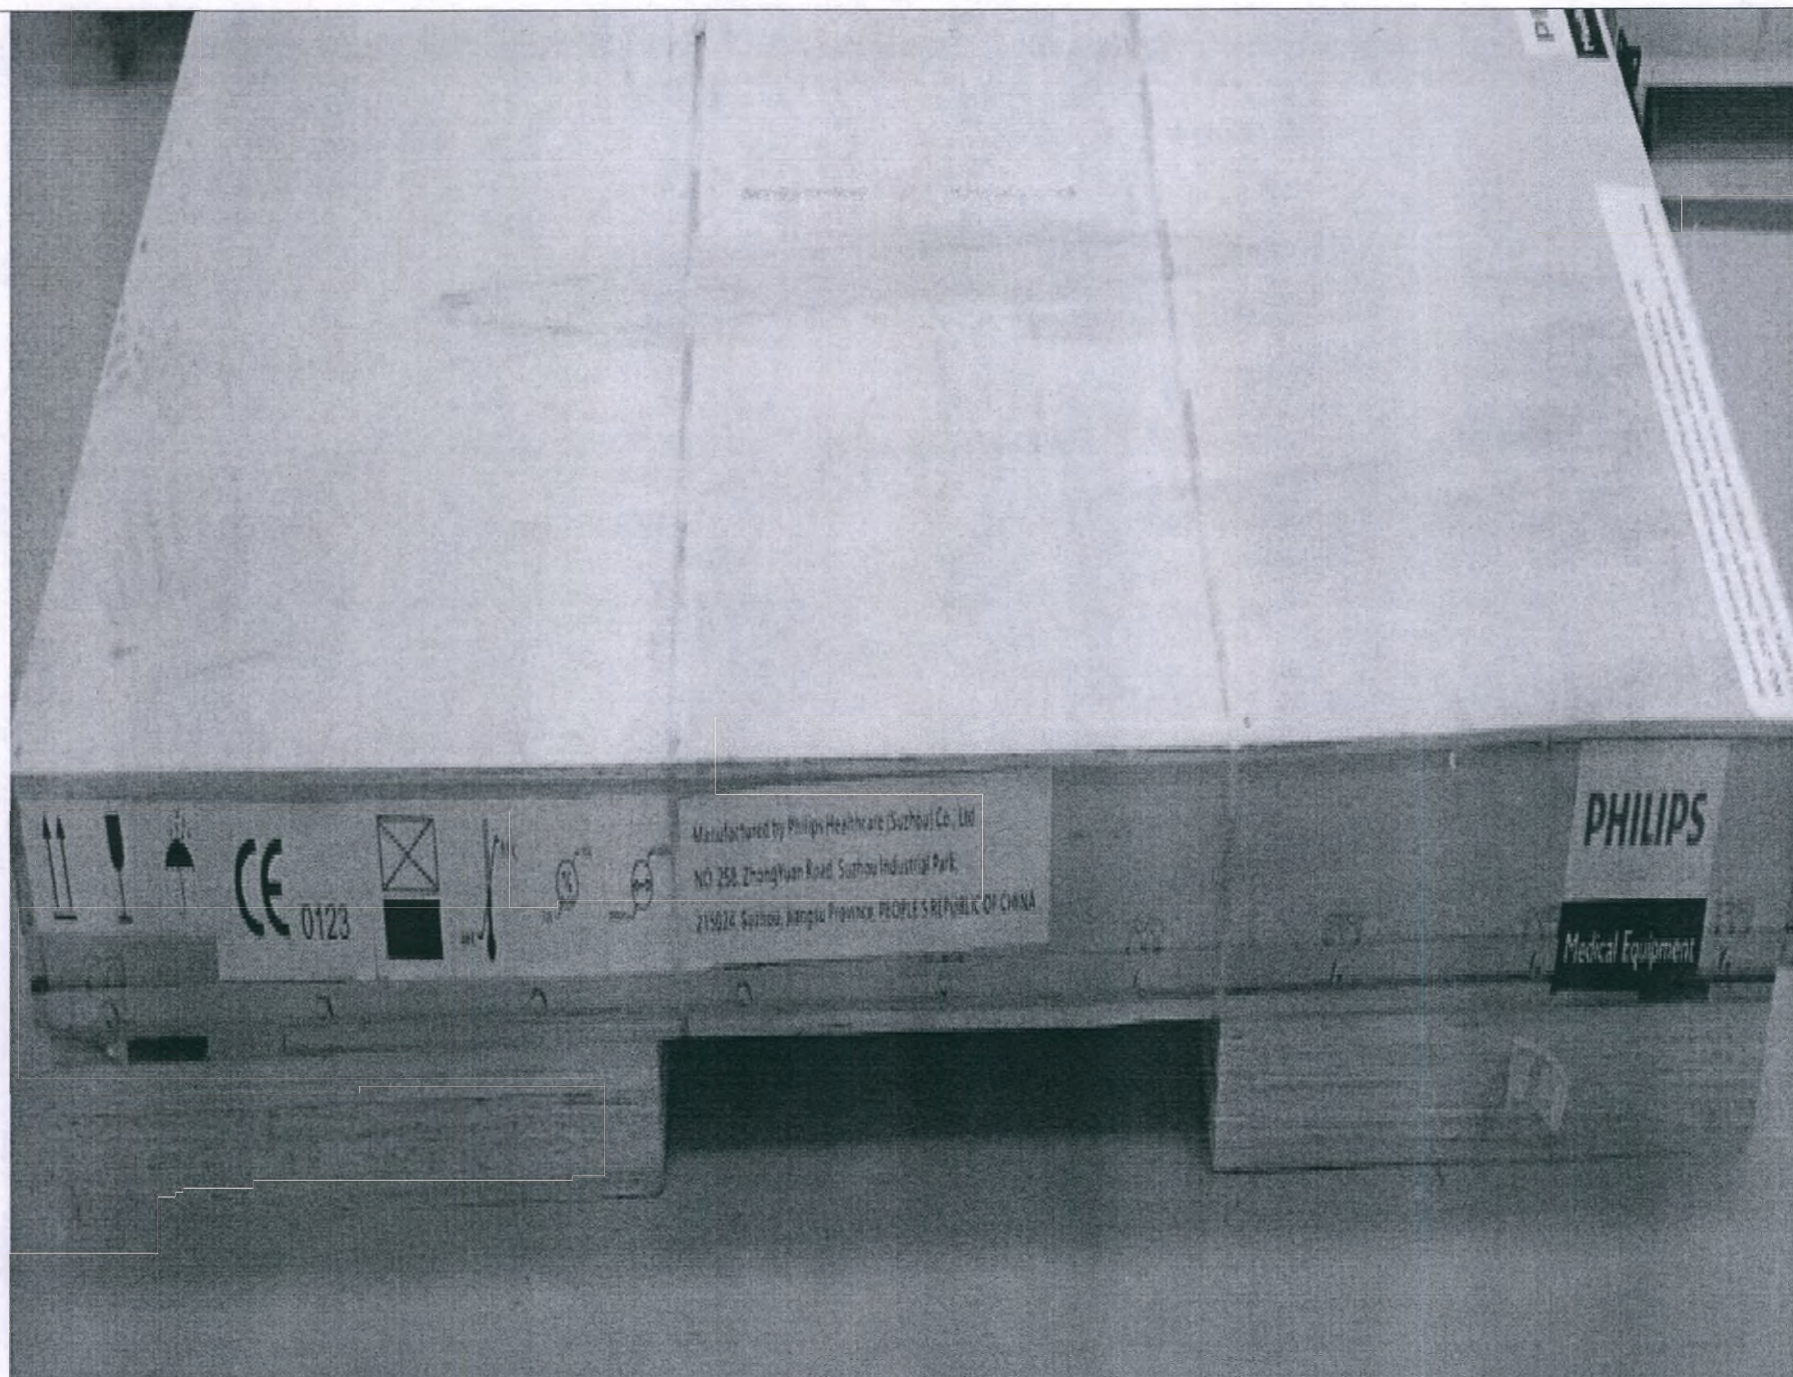

13. Упаковка основных частей системы DuraDiagnost F30: дека стола.

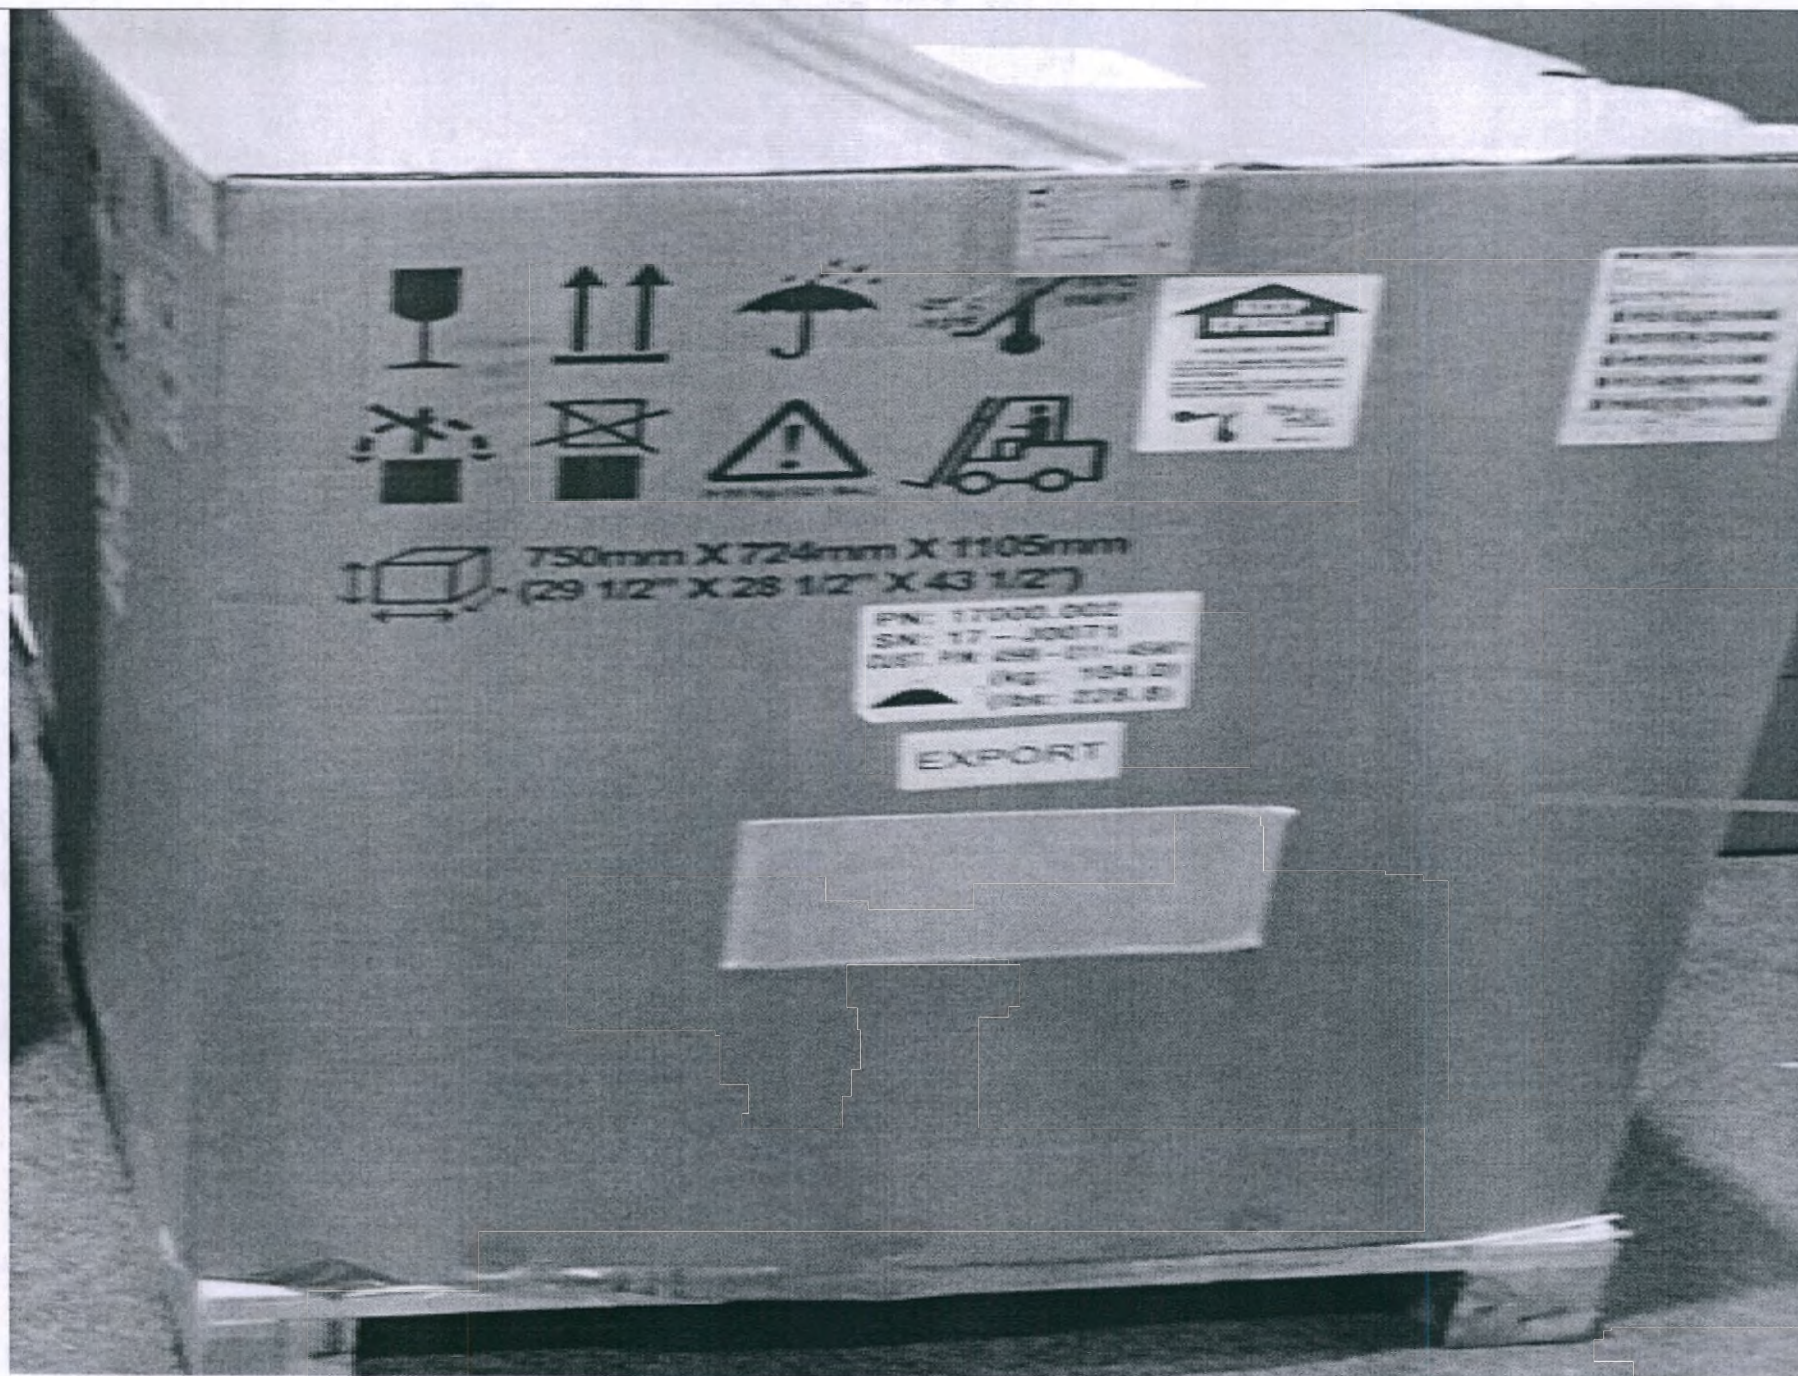

14. Упаковка основных частей системы DuraDiagnost F30: генератор 50 кВт серии ECO-Cabinet.

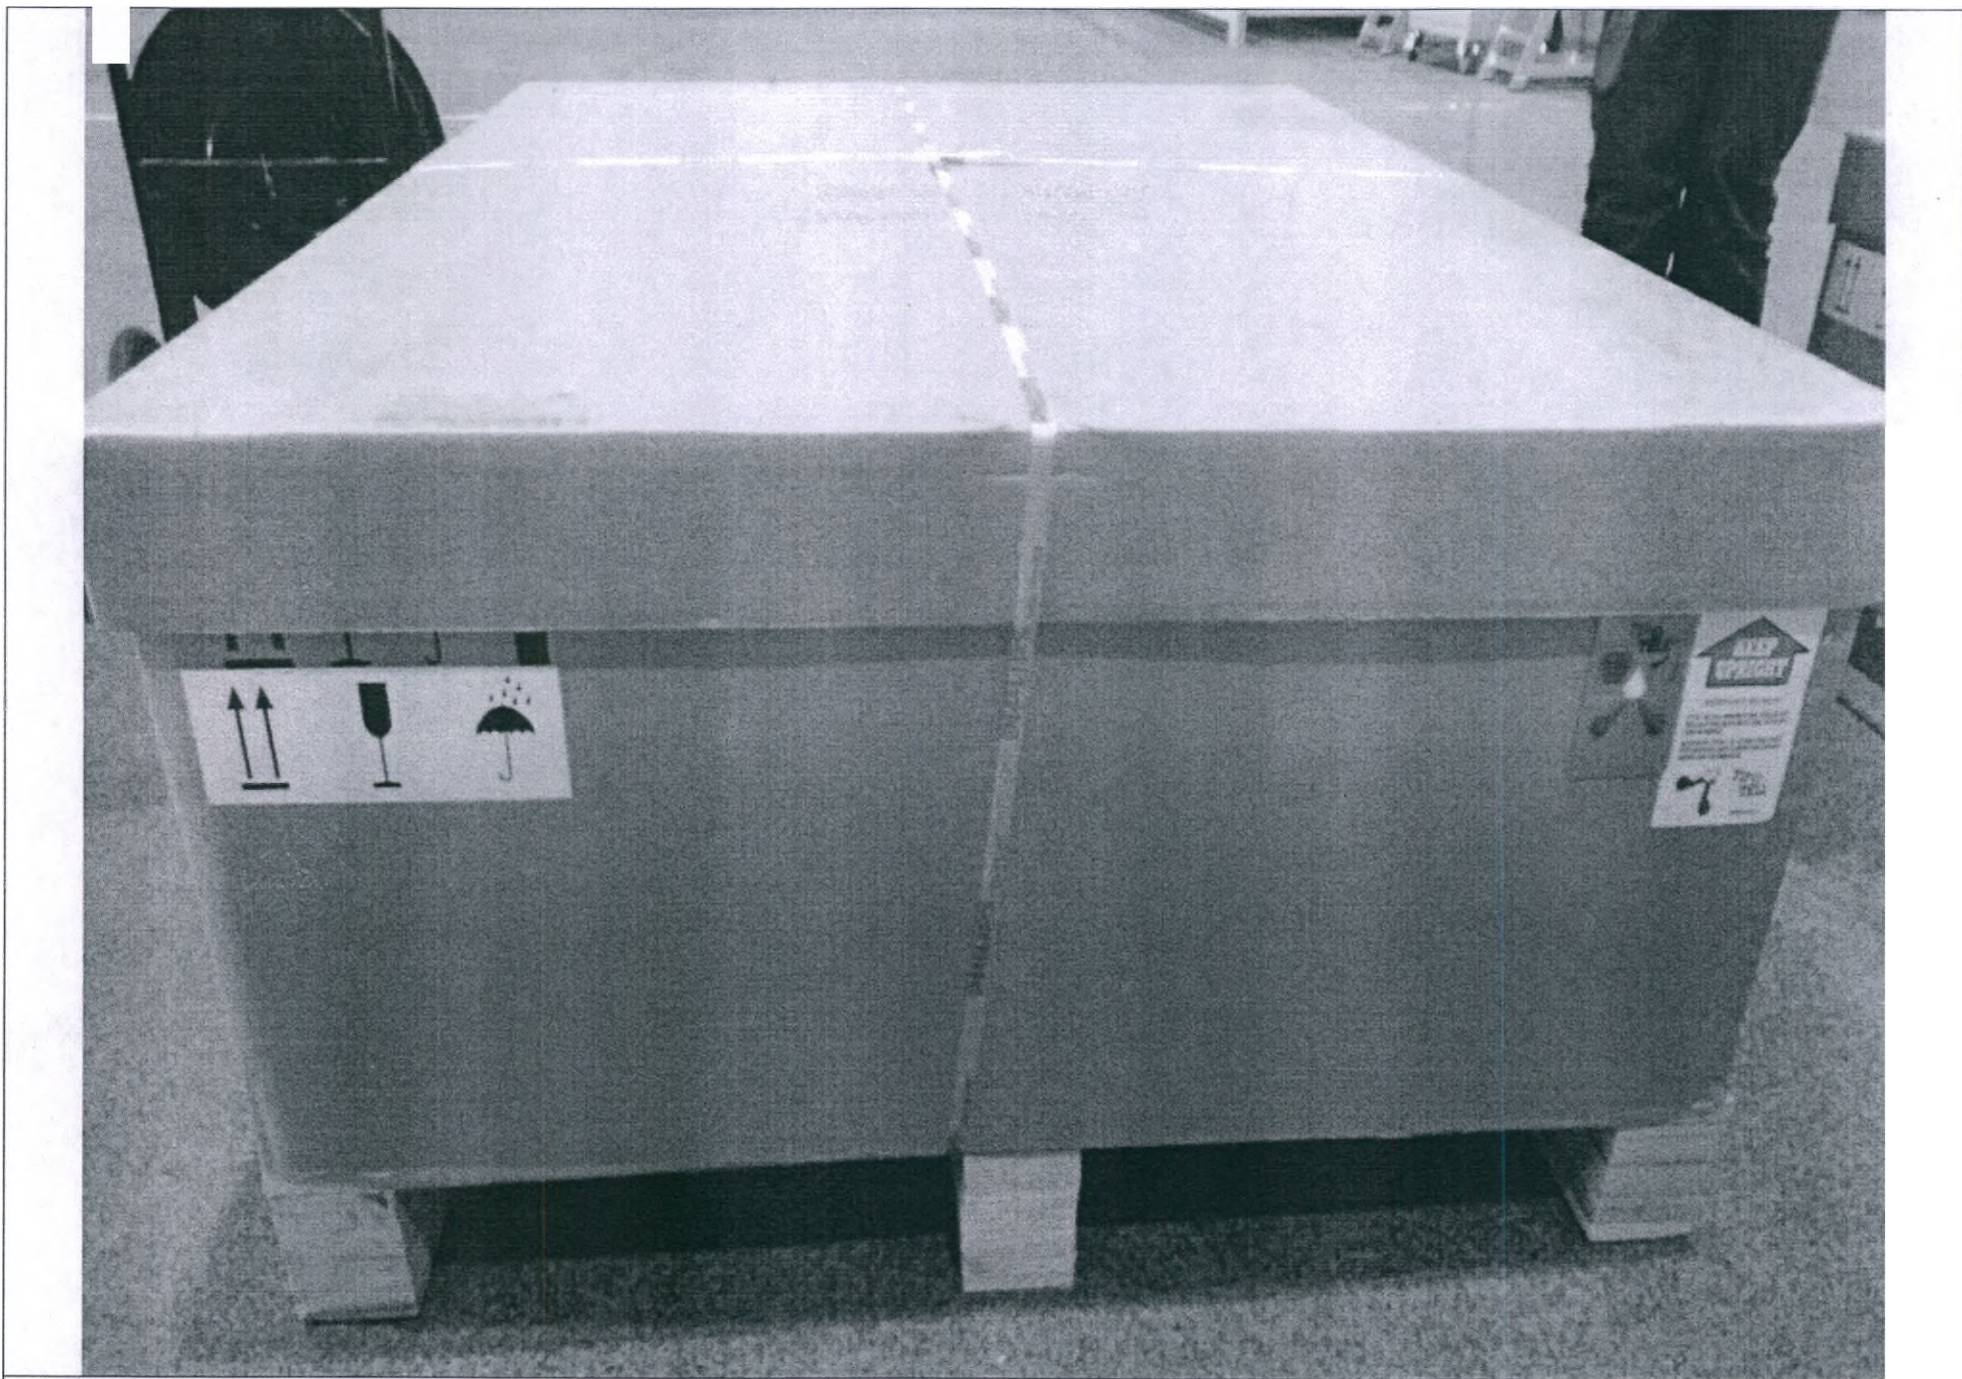

15. Упаковка основных частей системы DuraDiagnost F30: принадлежности.

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
87 листа (ов)

