

МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

ID-карты «ДиаКлон ABO/D + Перекрёстная Реакция» (DiaClon ABO/D + Reverse Grouping) для определения группы крови и резус-фактора методом прямой и перекрестной реакции для иммуногематологических исследований в in vitro диагностике, производства DiaMed GmbH / «ДиаМед ГмбХ»



Список символов

Следующие символы содержатся на маркировке.

Расшифровка символов на упаковке:

Символ	Значение
	Логотип производителя Био-Рад
	Изготовитель
	Медицинское изделие для диагностики <i>in vitro</i>
	Предел температуры (от 18 °C до 25 °C)
	Код партии
	Маркировка соответствия требованиям СЕ (подтверждает, что данное изделие соответствует применимым директивам Евросоюза)
	Использовать до
	Номер по каталогу
	Обратитесь к инструкции по применению
	Верх
	Упаковка пригодна для вторичной переработки
	Не допускать воздействия солнечного света
	Хрупкое, обращаться осторожно
	Крюками не брать
	Беречь от влаги
	Осторожно!



Макет маркировки первичной упаковки

Макет маркировки

E000116



DisCion ABO/D + Reverse Grouping
(monoclonal antibodies)
A, B, DVI-, cti/A1, B

IVD

10°C




Dr. Biotec GmbH
17080 Cressier FR
Switzerland



0123



E000216



Маркировка первичной упаковки содержит следующую информацию:



- наименование, адрес и логотип изготовителя;
- наименование медицинского изделия;
- содержание моноклональных антител;
- обозначение каждой микропробирки;
- символ «Медицинское изделие для диагностики in vitro»;
- символ «Предел температуры»;
- маркировка соответствия требованиям СЕ;
- штрих-код;
- код партии;
- срок годности - символ «Использовать до»

Макет маркировки картонной коробки (вторичная упаковка)Макет маркировки

ID-карты «ДиаКлон ABO/D + Перекрёстная Реакция» (DiaClon ABO/D + Reverse Grouping) для определения группы крови и резус-фактора методом прямой и перекрестной реакции для иммуногематологических исследований в *in vitro* диагностике, 4 × 12 шт./1 уп.




ID-карты «ДиаКлон ABO/D + Перекрёстная Реакция» (DiaClon ABO/D + Reverse Grouping) для определения группы крови и резус-фактора методом прямой и перекрестной реакции для иммуногематологических исследований в *in vitro* диагностике, 24 × 12 мм./1 уп.

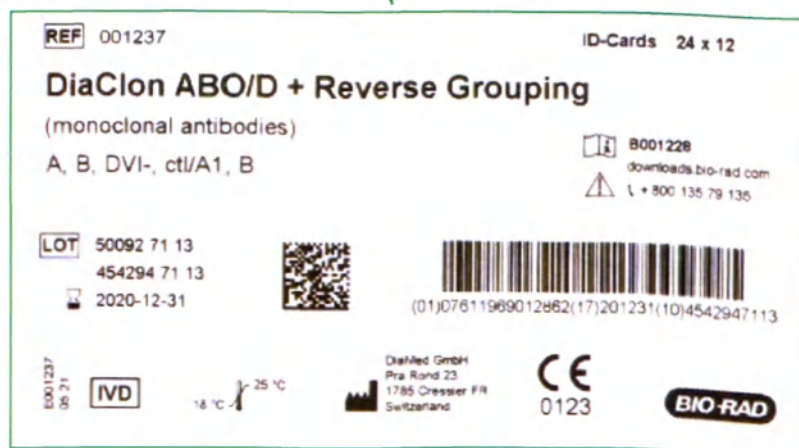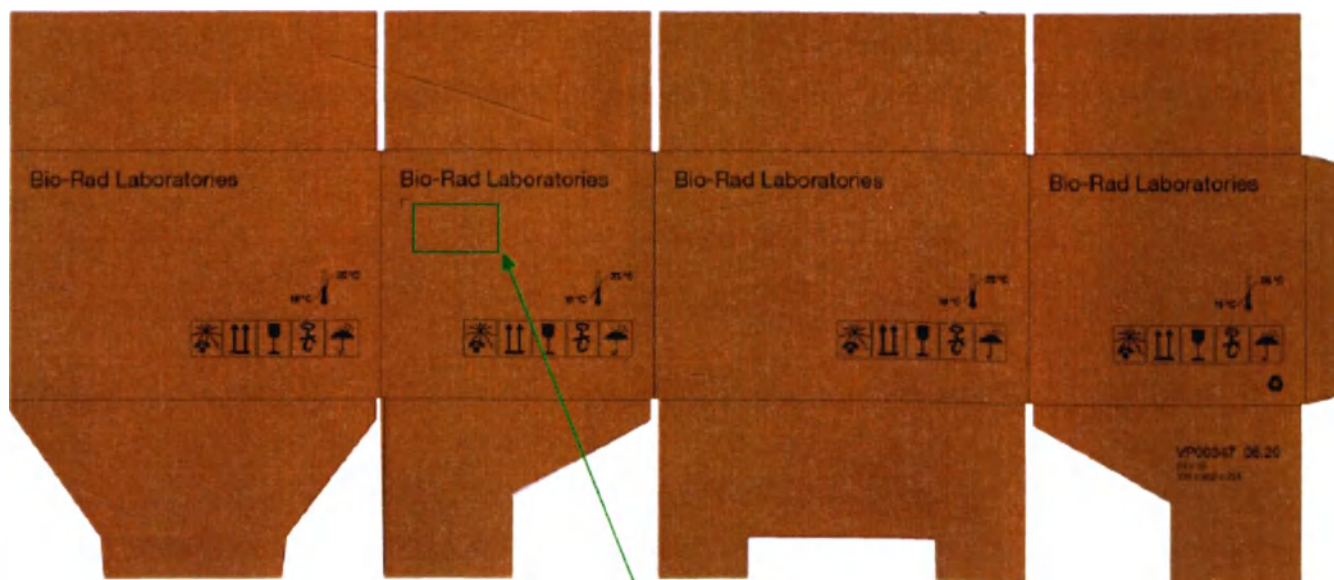



ID-карты «ДиаКлон ABO/D + Перекрёстная Реакция» (DiaClon ABO/D + Reverse Grouping) для определения группы крови и резус-фактора методом прямой и перекрестной реакции для иммуногематологических исследований в *in vitro* диагностике, 60 × 12 мм./1 уп.

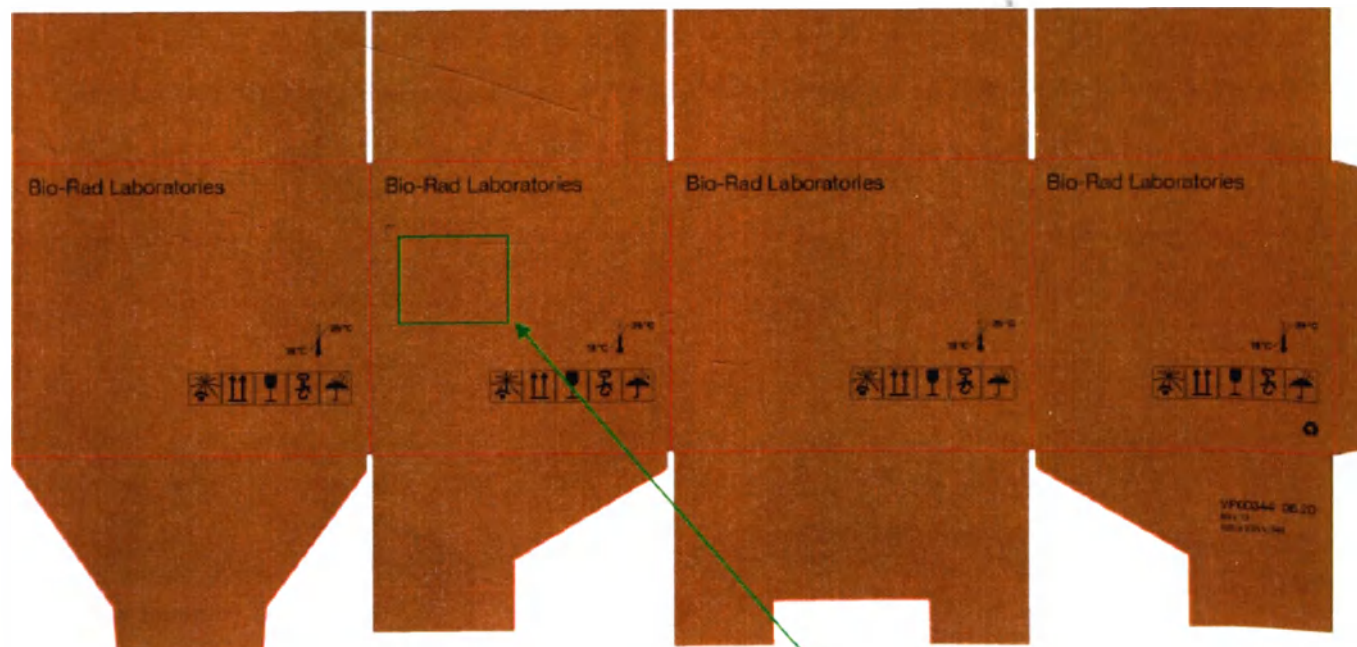

REF 001236 **ID-Cards** 60 x 12

DiaClon ABO/D + Reverse Grouping
(monoclonal antibodies)
A, B, DVI-, ctI/A1, B

LOT 50092 71 37
485448 71 37
2021-01-31

B001228
downloads bio-rad.com
t + 800 135 79 135

REF 001236
05.21



IVD 18 °C / 25 °C

DiaMed GmbH
Pra Rond 23
1785 Cressier FR
Switzerland

CE 0123 **BIO-RAD**

(01)07611966012879(17)210131(10)4654487137

ID-карты «ДиаКлон ABO/D + Перекрёстная Реакция» (DiaClon ABO/D + Reverse Grouping) для определения группы крови и резус-фактора методом прямой и перекрестной реакции для иммуногематологических исследований в *in vitro* диагностике, 112 × 12 мм./1 уп.

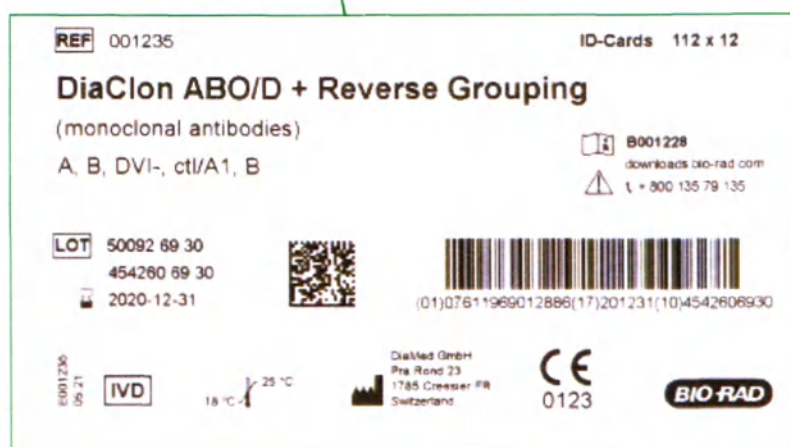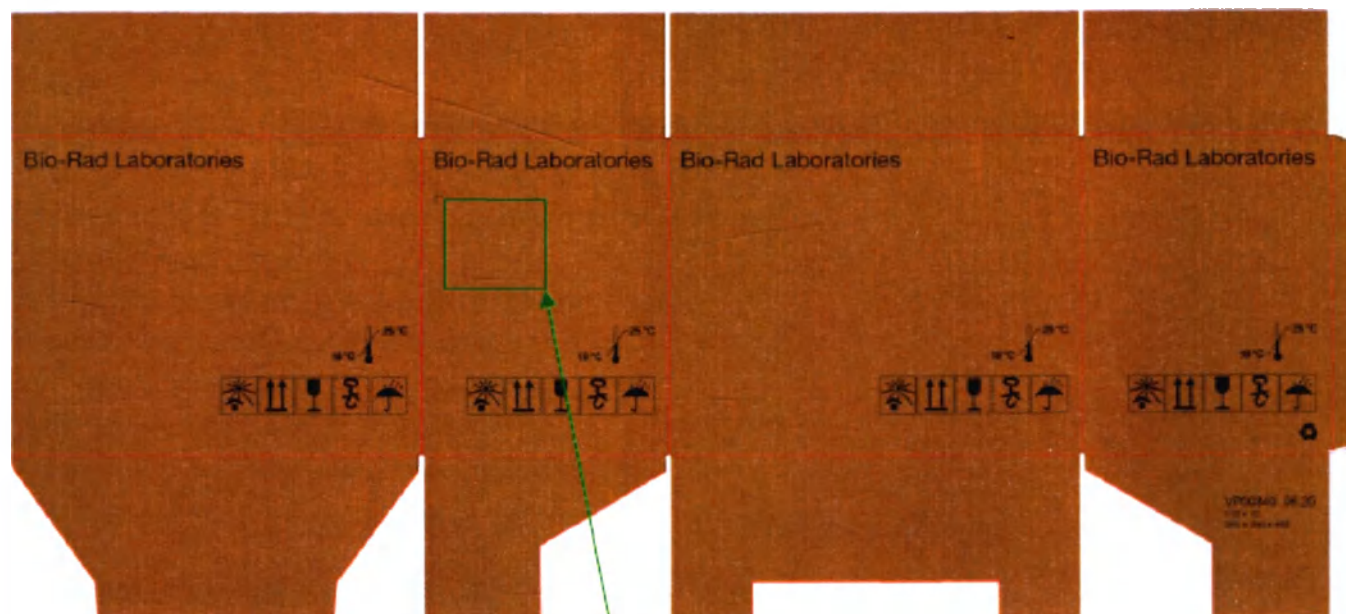

Примечание: Цвет нанесения текста маркировки и его расположение на первичной и вторичной упаковках может отличаться от партии к партии при неизменности самого текста. Данные отличия не влияют на качество, безопасность и эффективность медицинского изделия.

Маркировка каждой коробки может содержать следующую информацию:

- наименование, адрес и логотип производителя;
- наименование медицинского изделия;
- содержание моноклональных антител;
- обозначение каждой микропробирки;
- номер по каталогу;
- количество штук ID-карт в упаковке (в зависимости от варианта исполнения);
- символ «Медицинское изделие для диагностики in vitro»;
- символ «Обратитесь к инструкции по применению»;
- символ «Осторожно!»;
- сайт для скачивания инструкции по применению;
- версия инструкции по применению;
- контактный телефон.
- символ «Предел температуры»;
- маркировка соответствия требованиям СЕ;
- код партии;
- штрих-код;
- двумерный матричный штрих-код;
- срок годности - символ «Использовать до»;
- символ «Не допускать воздействия солнечного света»;
- символ «Хрупкое, обращаться осторожно»;
- символ «Крюками не брать»;
- символ «Верх»;
- символ «Упаковка пригодна для вторичной переработки»;
- символ «Беречь от влаги».

Макет маркировки на русском языке для обращения на территории Российской Федерации**REF 001234****IVD**

ID-карты «ДиаКлон ABO/D + Перекрёстная Реакция» (DiaClon ABO/D + Reverse Grouping) для определения группы крови и резус-фактора методом прямой и перекрестной реакции для иммуногематологических исследований в *in vitro* диагностике, 4 × 12 шт./1 уп.

Только для диагностики *in vitro*

Для профессионального применения

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Серийный номер, номер по каталогу, срок годности, условия хранения и графические символы указаны на оригинальной упаковке



Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Производитель: DiaMed GmbH (ДиаМед ГмбХб), Pra Rond 23, 1785 Cressier (FR), Switzerland (Швейцария)

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Био-Рад Лаборатории»

Адрес: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 5А

Телефон: (495) 721 14 04

e-mail: ra_russia.cis@bio-rad.comwww.bio-rad.com

Место производства: Швейцария

REF 001237**IVD**

ID-карты «ДиаКлон ABO/D + Перекрёстная Реакция» (DiaClon ABO/D + Reverse Grouping) для определения группы крови и резус-фактора методом прямой и перекрестной реакции для иммуногематологических исследований в *in vitro* диагностике, 24 × 12 шт./1 уп.

Только для диагностики *in vitro*

Для профессионального применения

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Серийный номер, номер по каталогу, срок годности, условия хранения и графические символы указаны на оригинальной упаковке



Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют.

Производитель: DiaMed GmbH (ДиаМед ГмбХб), Pra Rond 23, 1785 Cressier (FR), Switzerland (Швейцария)

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Био-Рад Лаборатории»

Адрес: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 5А

Телефон: (495) 721 14 04

e-mail: ra_russia.cis@bio-rad.comwww.bio-rad.com

Место производства: Швейцария

REF 001236

IVD

ID-карты «ДиаКлон ABO/D + Перекрёстная Реакция» (DiaClon ABO/D + Reverse Grouping) для определения группы крови и резус-фактора методом прямой и перекрестной реакции для иммуногематологических исследований в *in vitro* диагностике, 60 × 12 шт./1 уп.

Только для диагностики *in vitro*

Для профессионального применения

Регистрационное удостоверение № _____

Серийный номер, номер по каталогу, срок годности, условия хранения и графические символы указаны на оригинальной упаковке



Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Производитель: DiaMed GmbH (ДиаМед ГмбХб), Pra Rond 23, 1785 Cressier (FR), Switzerland (Швейцария)

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Био-Рад Лаборатории»

Адрес: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 5А

Телефон: (495) 721 14 04

e-mail: ra_russia.cis@bio-rad.com

www.bio-rad.com

Место производства: Швейцария

REF 001235

IVD

ID-карты «ДиаКлон ABO/D + Перекрёстная Реакция» (DiaClon ABO/D + Reverse Grouping) для определения группы крови и резус-фактора методом прямой и перекрестной реакции для иммуногематологических исследований в *in vitro* диагностике, 112 × 12 шт./1 уп.

Только для диагностики *in vitro*

Для профессионального применения

Регистрационное удостоверение № _____

Серийный номер, номер по каталогу, срок годности, условия хранения и графические символы указаны на оригинальной упаковке



Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Производитель: DiaMed GmbH (ДиаМед ГмбХб), Pra Rond 23, 1785 Cressier (FR), Switzerland (Швейцария)

Уполномоченный представитель производителя: ООО «Био-Рад Лаборатории»

Адрес: 105064, г. Москва, Нижний Сусальный пер., д. 5, стр. 5А

Телефон: (495) 721 14 04

e-mail: ra_russia.cis@bio-rad.com

www.bio-rad.com

Место производства: Швейцария

Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью 10 листа (ов)



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

ID-карты «ДиаКлон ABO/D + Перекрёстная Реакция»
(DiaClon ABO/D + Reverse Grouping) для определения
группы крови и резус-фактора методом прямой и
перекрестной реакции для иммуногематологических
исследований в *in vitro* диагностике


производства

DiaMed GmbH / «ДиаМед ГмбХ»

2022



Общий вид на фоне коробки ID-карты «ДиаКлон ABO D - Перекрёстная Реакция» (DiaClon ABO D + Reverse Grouping) для определения группы крови и резус-фактора методом прямой и перекрестной реакции для иммуногематологических исследований в in vitro диагностике. 4 × 12 шт., 1 уп.

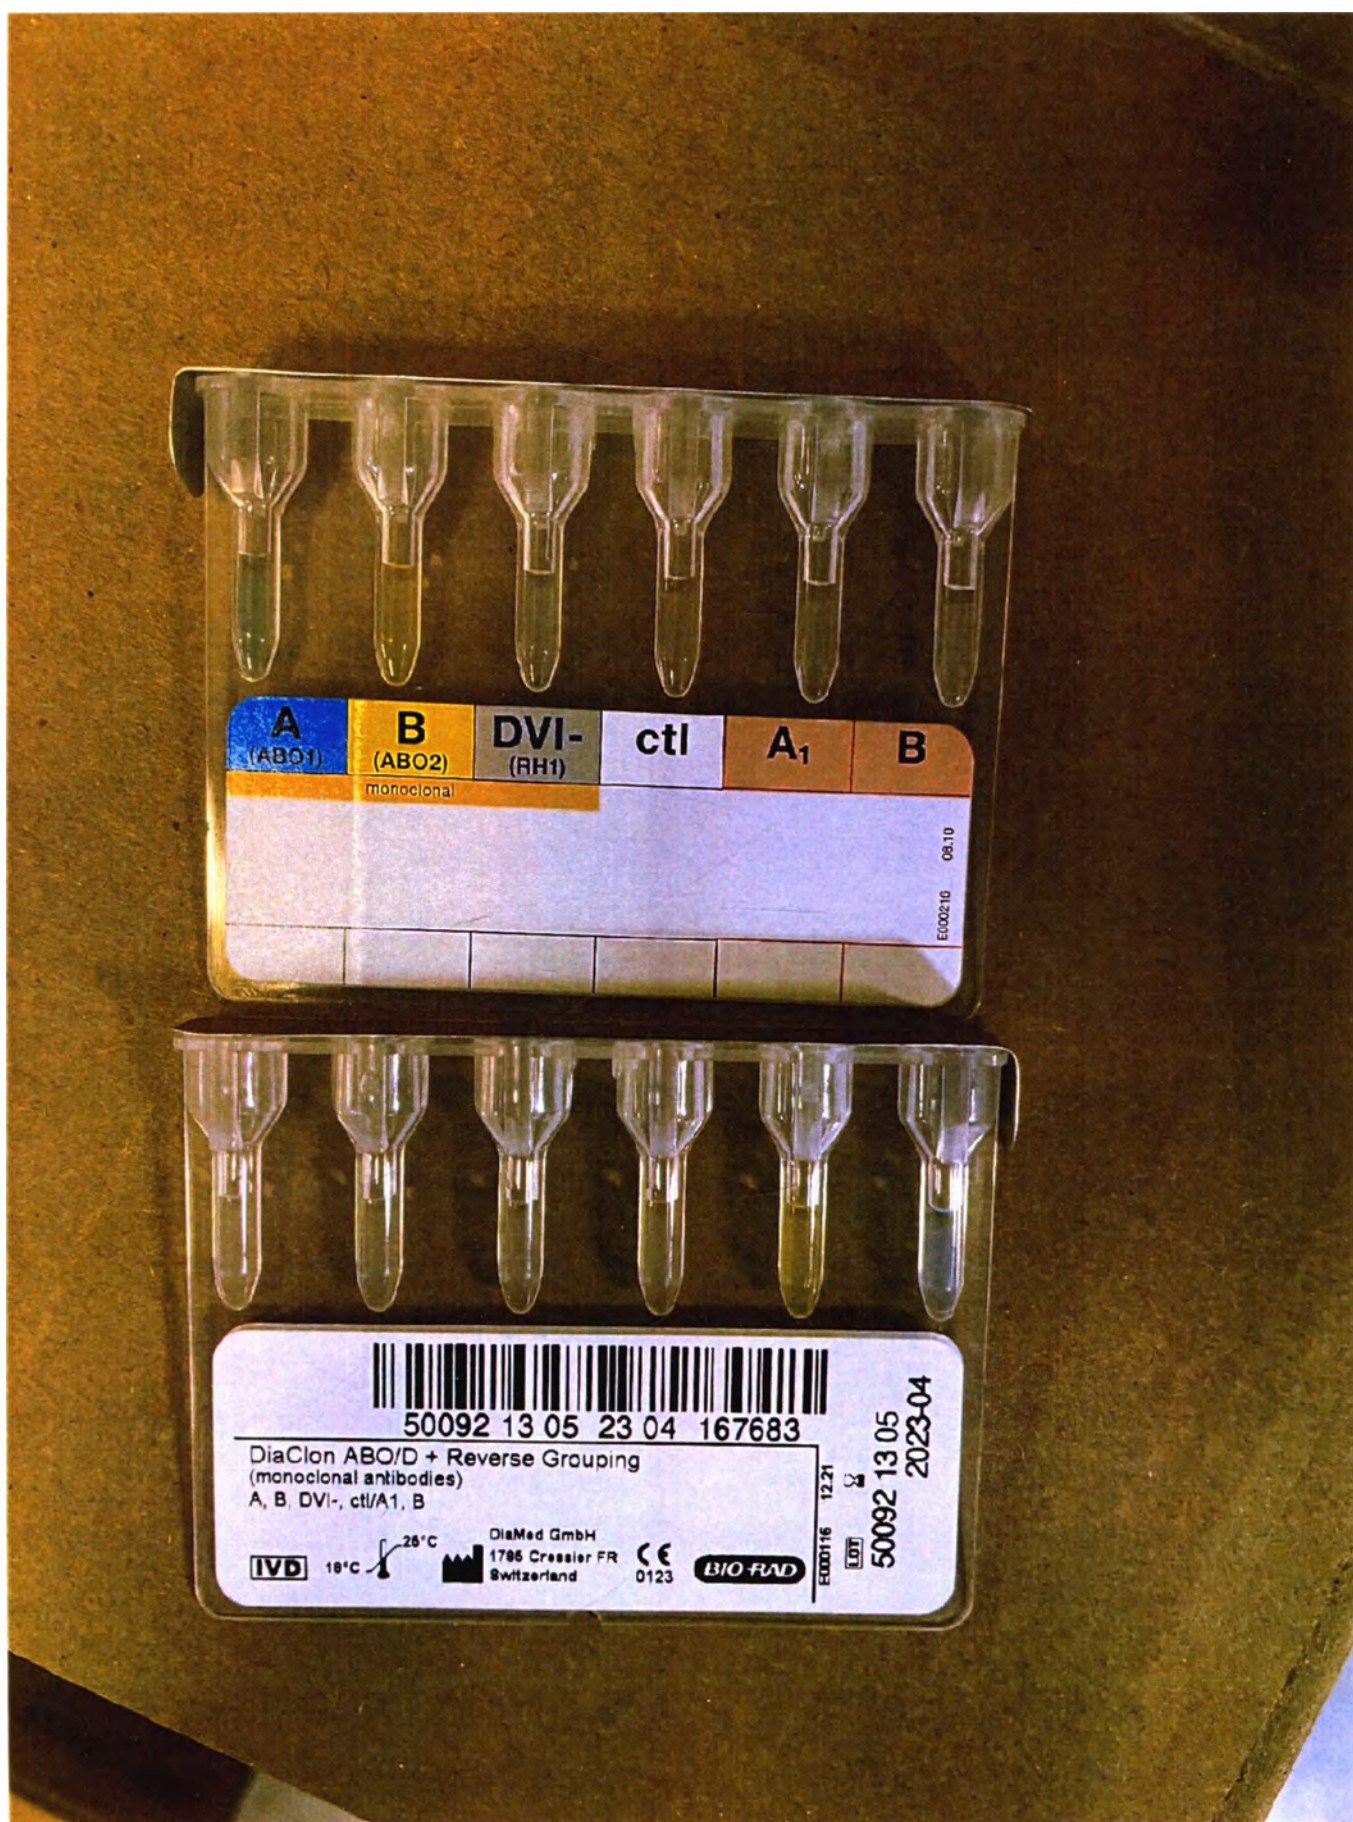

Общий вид ID-карты «ДиаКлон АВО D + Перекрёстная Реакция» (DiaClon ABO/D + Reverse Grouping) для определения группы крови и резус-фактора методом прямой и перекрестной реакции для иммуногематологических исследований в in vitro диагностике. 4 × 12 шт./1 уп.



Общий вид коробки ID-карты «ДиаКлон АВО/Д + Перекрёстная Реакция» (DiaClon ABO/D + Reverse Grouping) для определения группы крови и резус-фактора методом прямой и перекрестной реакции для иммуногематологических исследований в in vitro диагностике, 4 × 12 шт., 1 уп.

BIO-RAD

REF 001234

ID-Cards 4 x 12

DiaClon ABO/D + Reverse Grouping

(monoclonal antibodies)

A, B, DVI-, ctt/A1, B



B001228

downloads.bio-rad.com



+ 800 135 79 135



(01)07611969012855(17)230430(10)7181801305



LOT

50092 13 05

718180 13 05



2023-04-30

VP00358-E
05.21



18 °C - 25 °C




DiaMed GmbH
Pra Rond 23
1785 Cressier FR
Switzerland

CE
0123

BIO-RAD




Общий вид коробки ID-карты «ДиаКлон АВО D + Перекрестная Реакция» (DiaClon ABO D + Reverse Grouping) для определения группы крови и резус-фактора методом прямой и перекрестной реакции для иммуногематологических исследований in vitro диагностике. 4 × 12 шт. 1 уп.

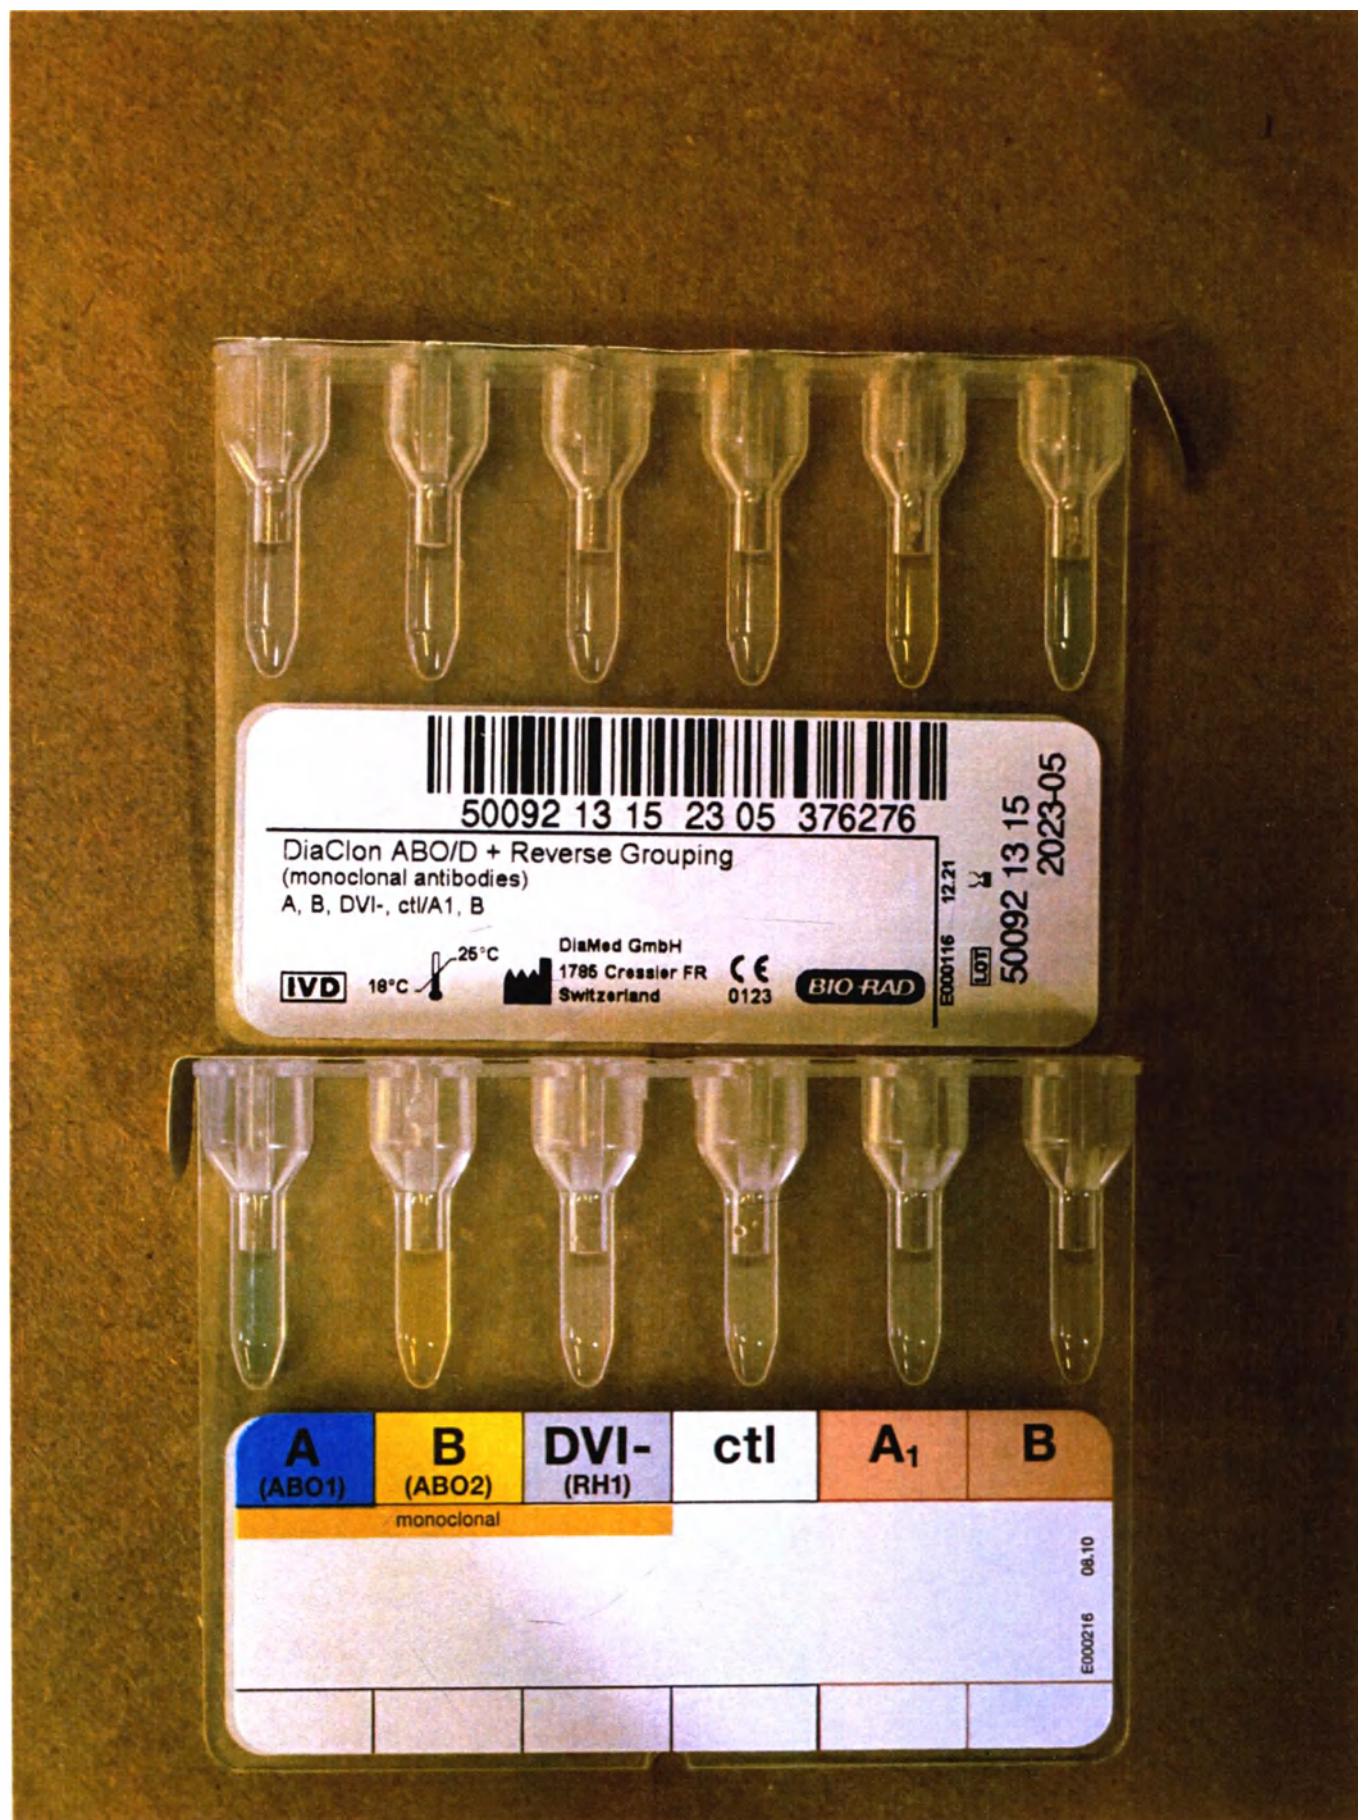

Общий вид ID-карты «ДиаКлон АВО D - Перекрёстная Реакция» (DiaClon ABO/D - Reverse Grouping) для определения группы крови и резус-фактора методом прямой и перекрестной реакции для иммуногематологических исследований в in vitro диагностике. 24 × 12 шт. 1 уп.



Общий вид на фоне коробки ID-карты «ДиаКлон ABO.D - Перекрёстная Реакция» (DiaClon ABO.D - Reverse Grouping) для определения группы крови и резус-фактора методом прямой и перекрестной реакции для иммуногематологических исследований в in vitro диагностике. 24 × 12 шт./1 уп.

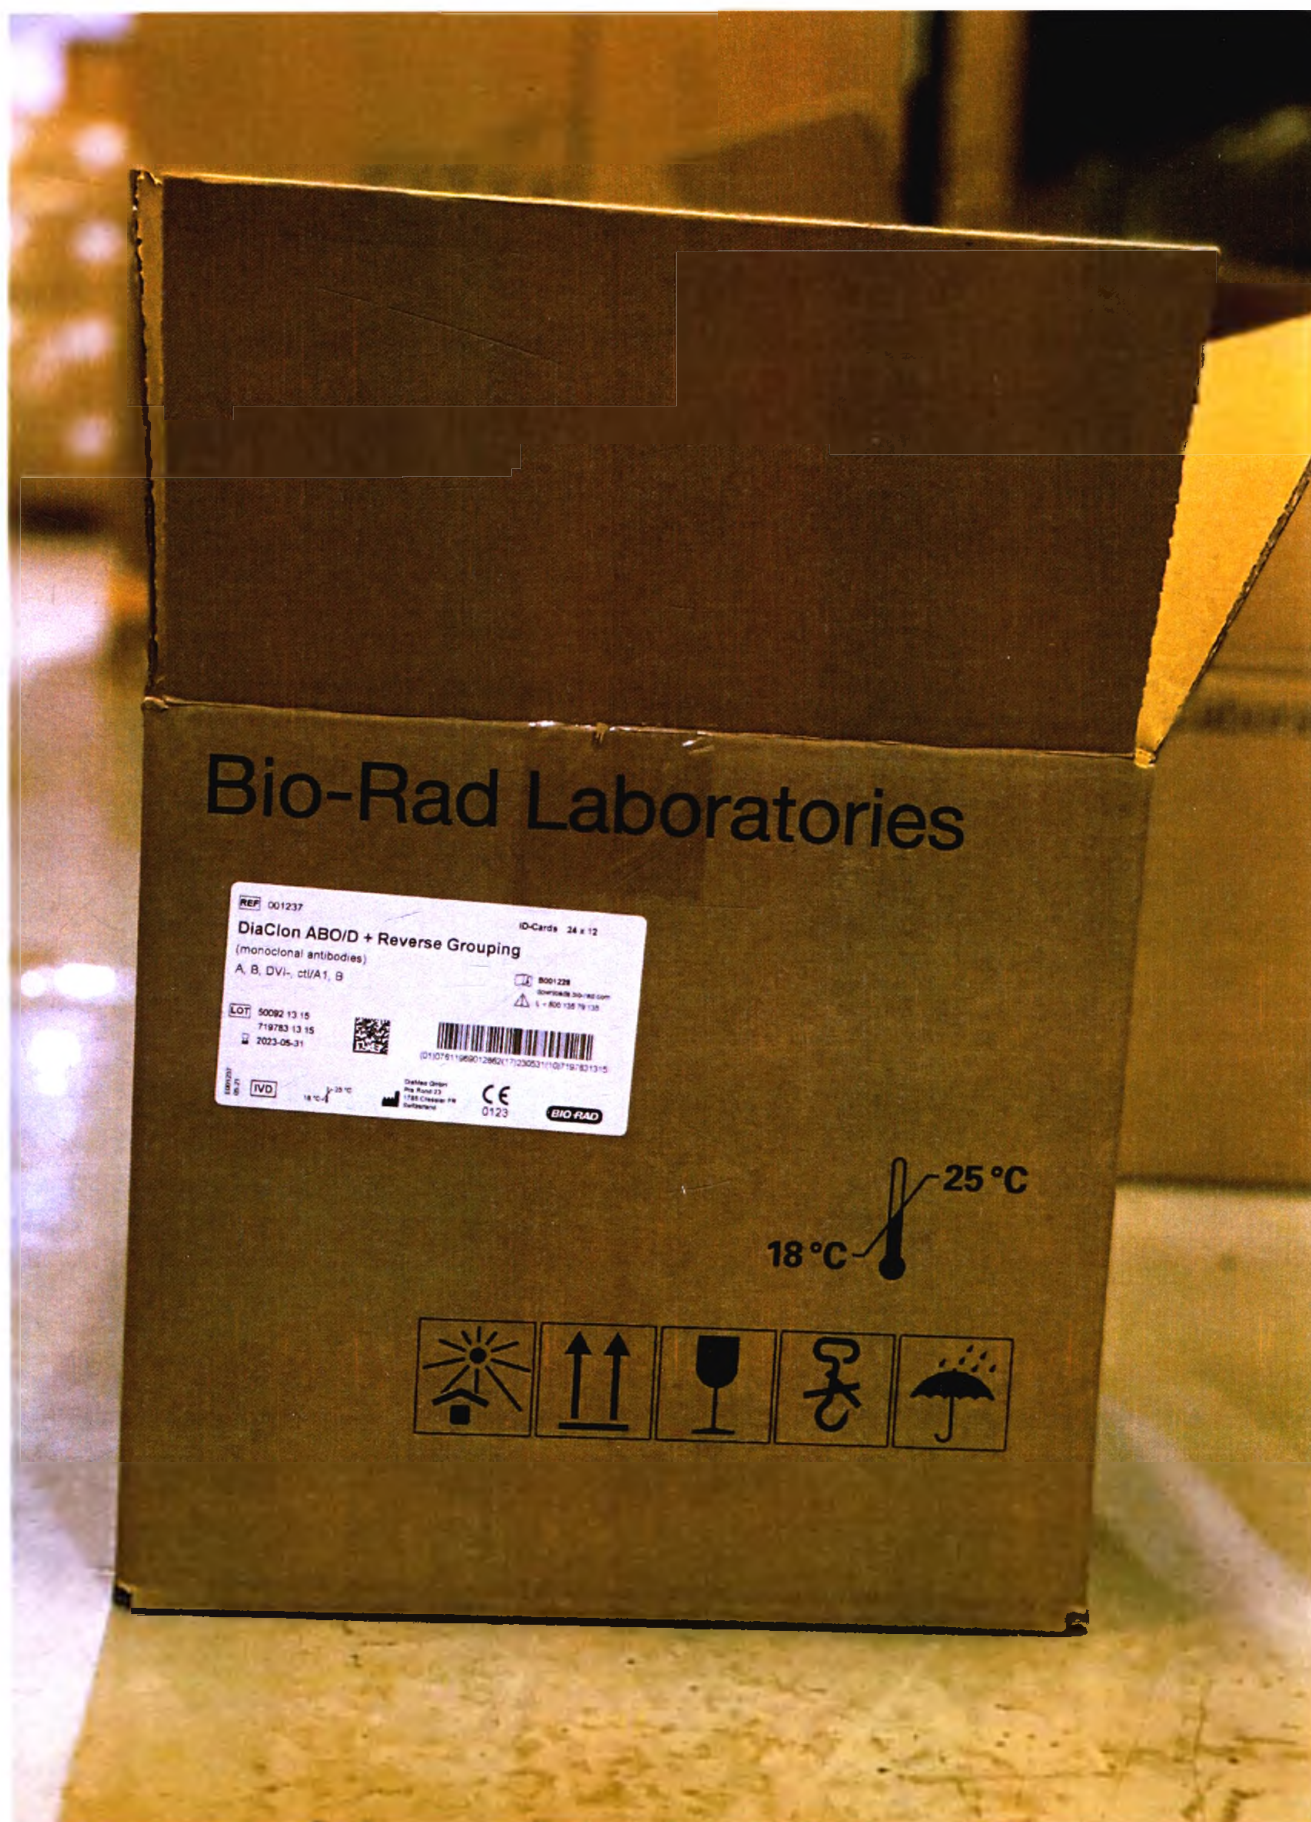

Общий вид коробки ID-карты «ДиаКлон АВО/Д + Перекрёстная Реакция» (DiaClon ABO/D + Reverse Grouping) для определения группы крови и резус-фактора методом прямой и перекрестной реакции для иммуногематологических исследований в *in vitro* диагностике, 24 × 12 шт./1 уп.

Bio-Rad Labora

REF 001237

ID-Cards 24 x 12

DiaClon ABO/D + Reverse Grouping

(monoclonal antibodies)

A, B, DVI-, cti/A1, B



B001228

downloads.bio-rad.com



+ 800 135 79 135

LOT 50092 13 15

719783 13 15



2023-05-31



(01)07611969012862(17)230531(10)7197831315

E001237
05.21

IVD

18 °C ~ 25 °C



DiaMed GmbH
Pra Rond 23
1785 Cressier FR
Switzerland



CE
0123

BIO-RAD

Общий вид коробки ID-карты «ДиаКлон ABO/D + Перекрёстная Реакция» (DiaClon ABO/D + Reverse) для определения группы крови и резус-фактора методом прямой и перекрестной реакции для иммуногематологических исследований в in vitro диагностике. 24 × 12 шт., 1 уп.



Общий вид коробки ID-карты «ДиаКлон АВО D + Перекрёстная Реакция» (DiaClon ABO D + Reverse Grouping) для определения группы крови и резус-фактора методом прямой и перекрестной реакции для иммуногематологических исследований в *in vitro* диагностике. 24 × 12 шт./1 уп.

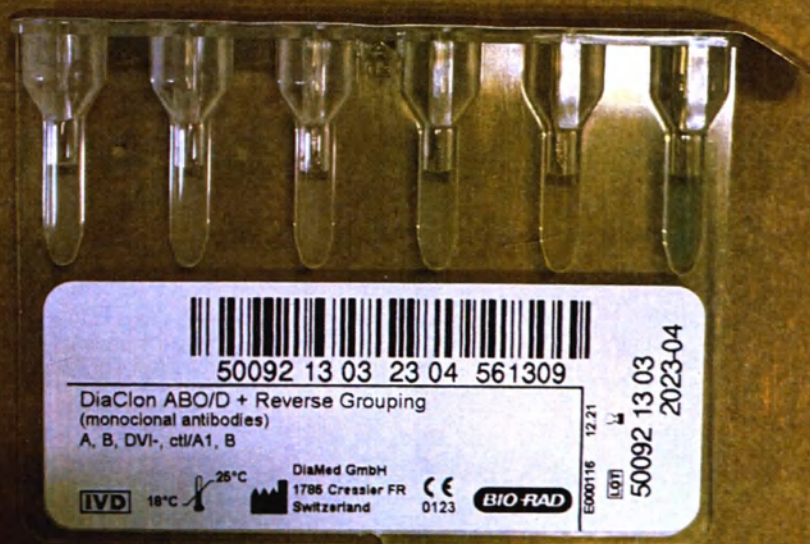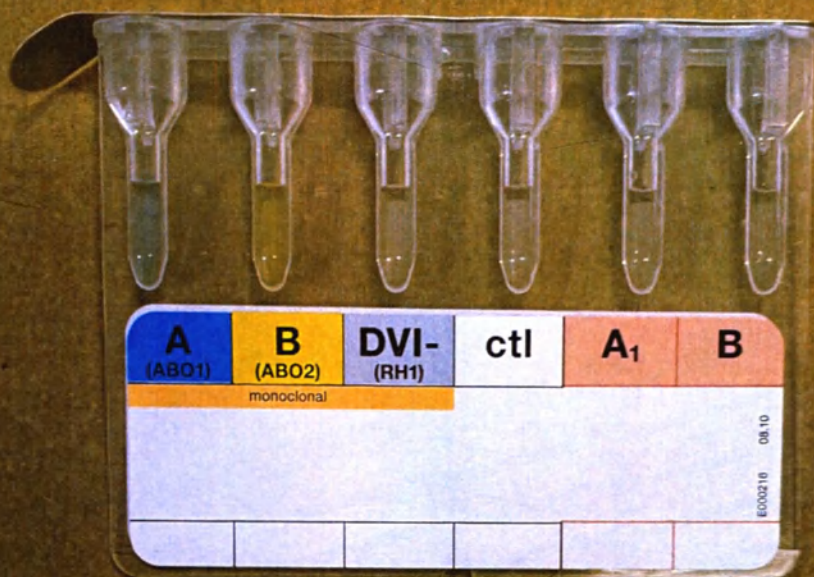

Общий вид ID-карты «ДиаКлон АВО/D – Перекрёстная Реакция» (DiaClon ABO/D + Reverse Grouping) для определения группы крови и резус-фактора методом прямой и перекрестной реакции для иммуногематологических исследований в *in vitro* диагностике. 60 × 12 шт./уп.



Общий вид на фоне коробки ID-карты «ДиаКлон ABO/D + Перекрёстная Реакция» (DiaClon ABO/D + Reverse Grouping) для определения группы крови и резус-фактора методом прямой и перекрестной реакции для иммуногематологических исследований в *in vitro* диагностике. 60 × 12 шт./1 уп.



Общий вид коробки ID-карты «ДиаКлон АВО D – Перекрёстная Реакция» (DiaClon ABO D + Reverse Grouping) для определения группы крови и резус-фактора методом прямой и перекрестной реакции для иммуногематологических исследований в in vitro диагностике. 60 × 12 шт. 1 уп.

REF 001236

ID-Cards 60 x 12

DiaClon ABO/D + Reverse Grouping

(monoclonal antibodies)

A, B, DVI-, cti/A1, B



B001228

downloads.bio-rad.com



+800 135 79 135

LOT 50092 13 03

718070 13 03



2023-04-30



(01)07611969012879(17)230430(10)7180701303

E001236
05.21



18 °C 25 °C




DiaMed GmbH
Pra Rond 23
1785 Cressier FR
Switzerland

CE
0123


BIO-RAD

Общий вид коробки ID-карты «ДиаКлон ABO/D + Перекрёстная Реакция» (DiaClon ABO D - Reverse) для определения группы крови и резус-фактора методом прямой и перекрестной реакции для иммуногематологических исследований in vitro диагностике. 60 × 12 шт./1 уп.

Bio-Rad Laboratories

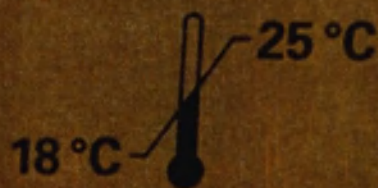

Общий вид коробки ID-карты «ДиаКлон ABO/D + Перекрёстная Реакция» (DiaClon ABO/D + Reverse Grouping) для определения группы крови и резус-фактора методом прямой и перекрестной реакции для иммуногематологических исследований в in vitro диагностике. 60 × 12 шт./1 уп.

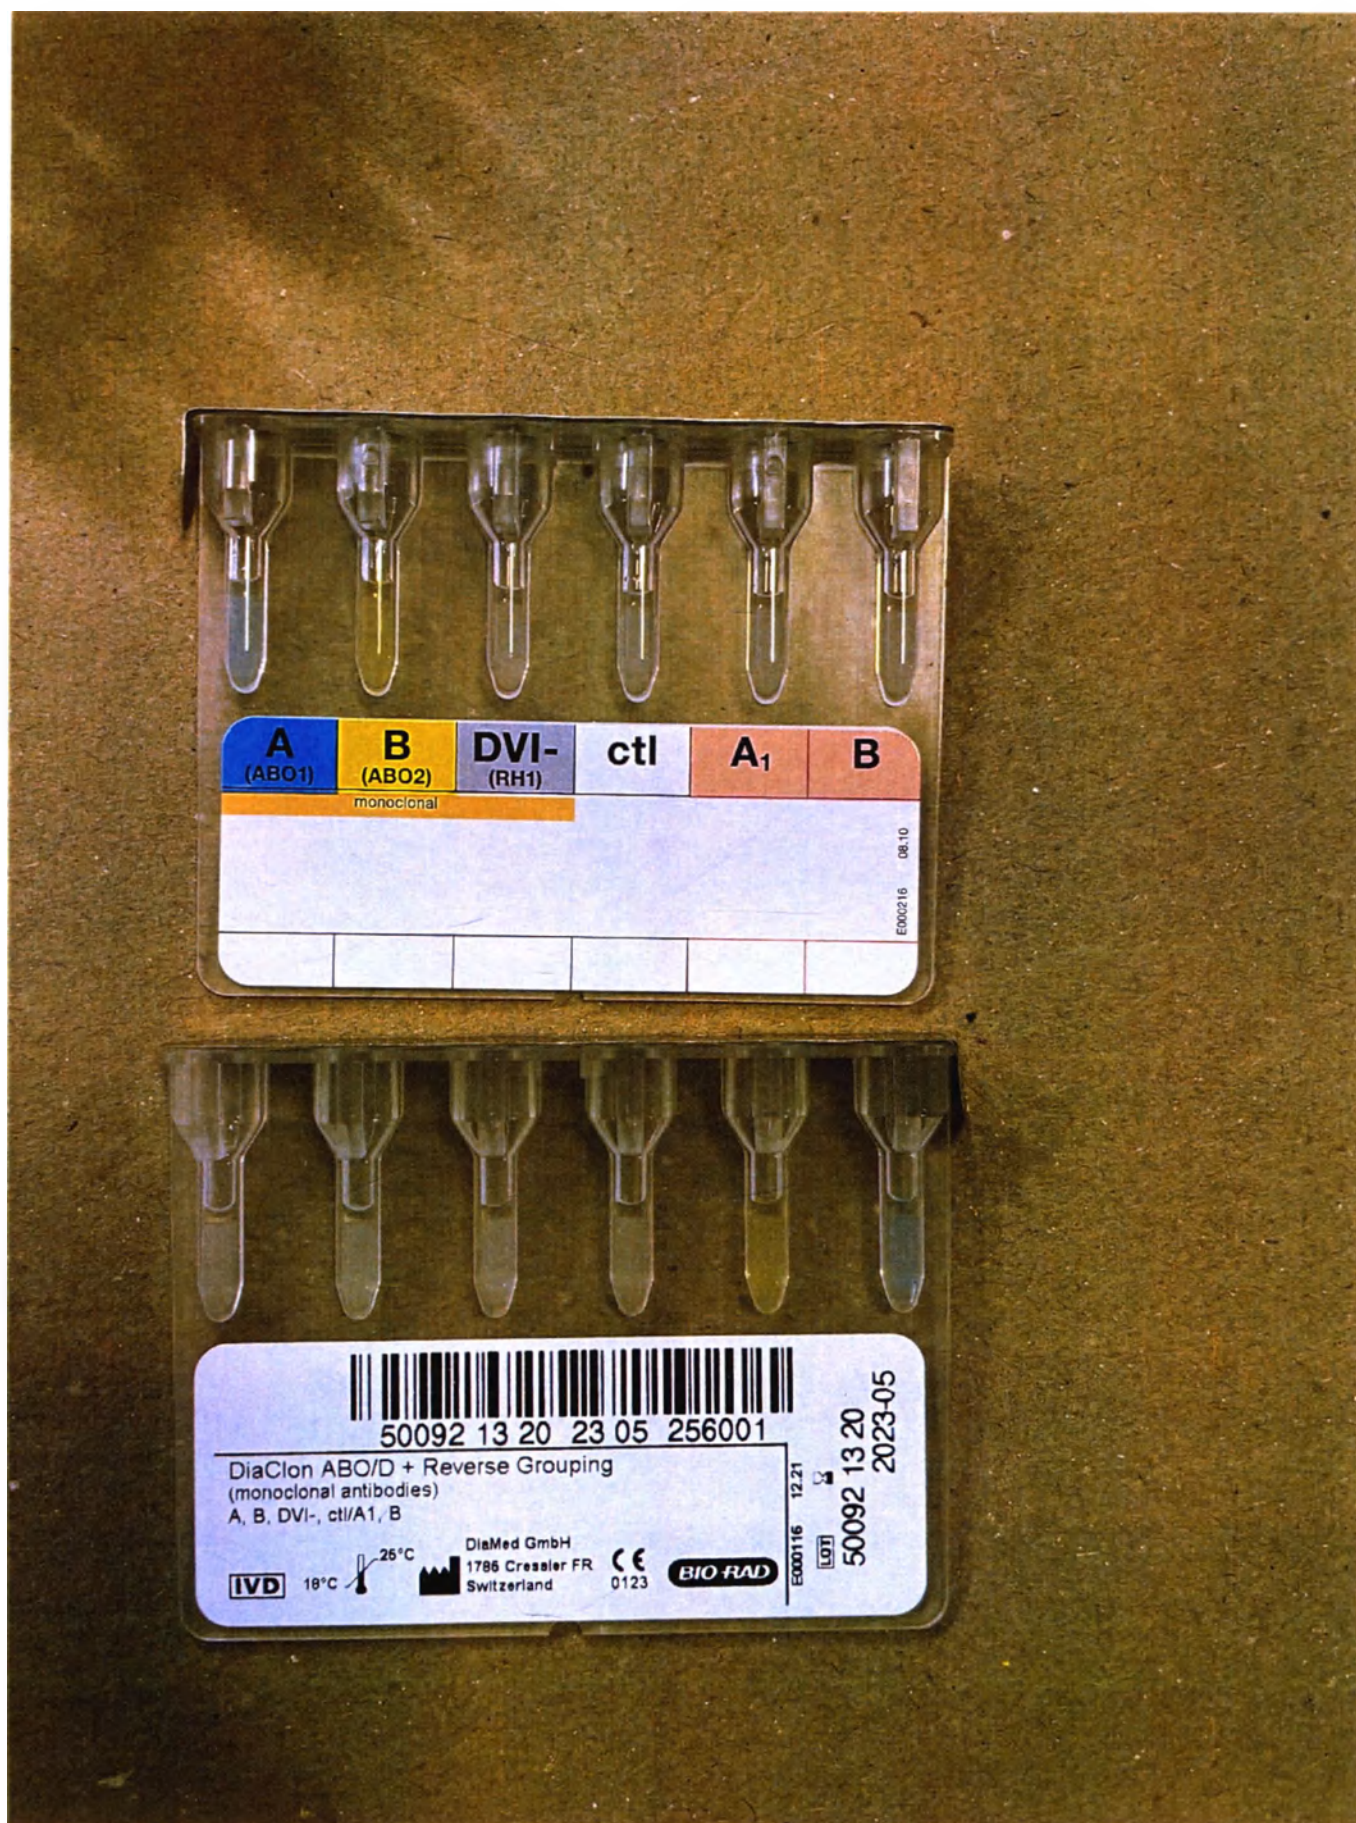

Общий вид ID-карты «ДиаКлон АВО D - Перекрёстная Реакция» (DiaClon ABO D - Reverse Grouping) для определения группы крови и резус-фактора методом прямой и перекрестной реакции для иммуногематологических исследований в in vitro диагностике. 112 × 12 шт./уп.



Общий вид на фоне коробки ID-карты «ДиаКлон ABO D + Перекрёстная Реакция» (DiaClon ABO/D + Reverse Grouping) для определения группы крови и резус-фактора методом прямой и перекрестной реакции для иммуногематологических исследований в *in vitro* диагностике. 112 × 12 шт./1 уп.



Общий вид коробки ID-карты «ДиаКлон ABO'D + Перекрёстная Реакция» (DiaClon ABO'D + Reverse Grouping) для определения группы крови и резус-фактора методом прямой и перекрестной реакции для иммуногематологических исследований в in vitro диагностике. 112 × 12 шт./1 уп.

REF 001235

ID-Cards 112 x 12

DiaClon ABO/D + Reverse Grouping

(monoclonal antibodies)

A, B, DVI-, cti/A1, B



B001228

downloads.bio-rad.com



+800 135 79 135

LOT

50092 13 20

721291 13 20



2023-05-31



(01)07611969012886(17)230531(10)7212911320

E001235
05.21



18 °C 25 °C




DiaMed GmbH
Pra Rond 23
1785 Cressier FR
Switzerland

CE
0123

BIO-RAD

Общий вид коробки ID-карты «ДиаКлон АВО D - Перекрёстная Реакция» (DiaClon ABO D - Reverse) для определения группы крови и резус-фактора методом прямой и перекрестной реакции для иммуногематологических исследований в in vitro диагностике. 112 × 12 шт./1 уп.

Bio-Rad Laboratories

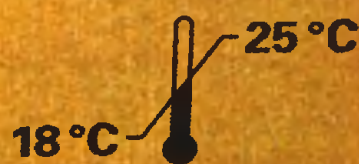

Общий вид коробки ID-карты «ДиаКлон АВО D - Перекрестная Реакция» (DiaClon ABO D - Reverse Grouping) для определения группы крови и резус-фактора методом прямой и перекрестной реакции с помощью иммуногематологических исследований в микро-диагностике. 112 × 120 × 140 мм

Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью 20 листа (ов)

