



Фотографические изображения

«Реагенты в кассете для количественного определения этанола в сыворотке, плазме крови и моче на модулях биохимических cobas c (ETOH2/Ethanol Gen.2 cobas c systems), в вариантах исполнения»


реагенты в кассете для количественного определения этанола в сыворотке, плазме крови и моче на модулях биохимических cobas c (ЕТОН2/Ethanol Gen.2 cobas c systems), вариант исполнения на 850 тестов

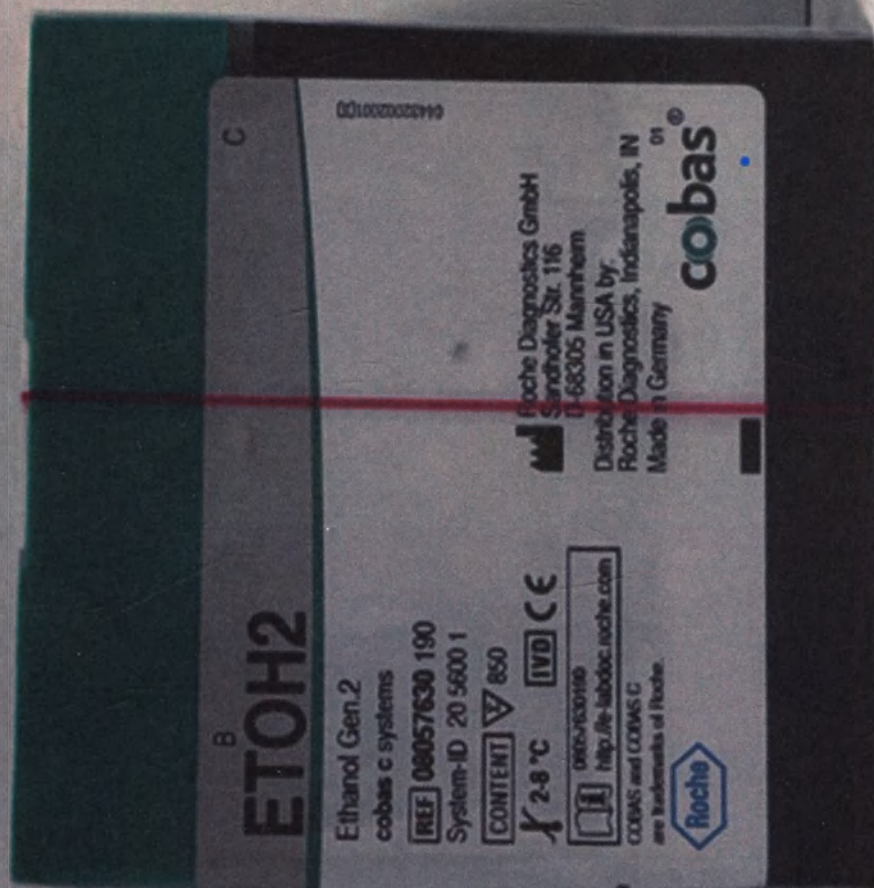

реагенты в кассете для количественного определения этанола в сыворотке, плазме крови и моче на модулях биохимических cobas c (ETOH2/Ethanol Gen.2 cobas c systems), вариант исполнения на 850 тестов

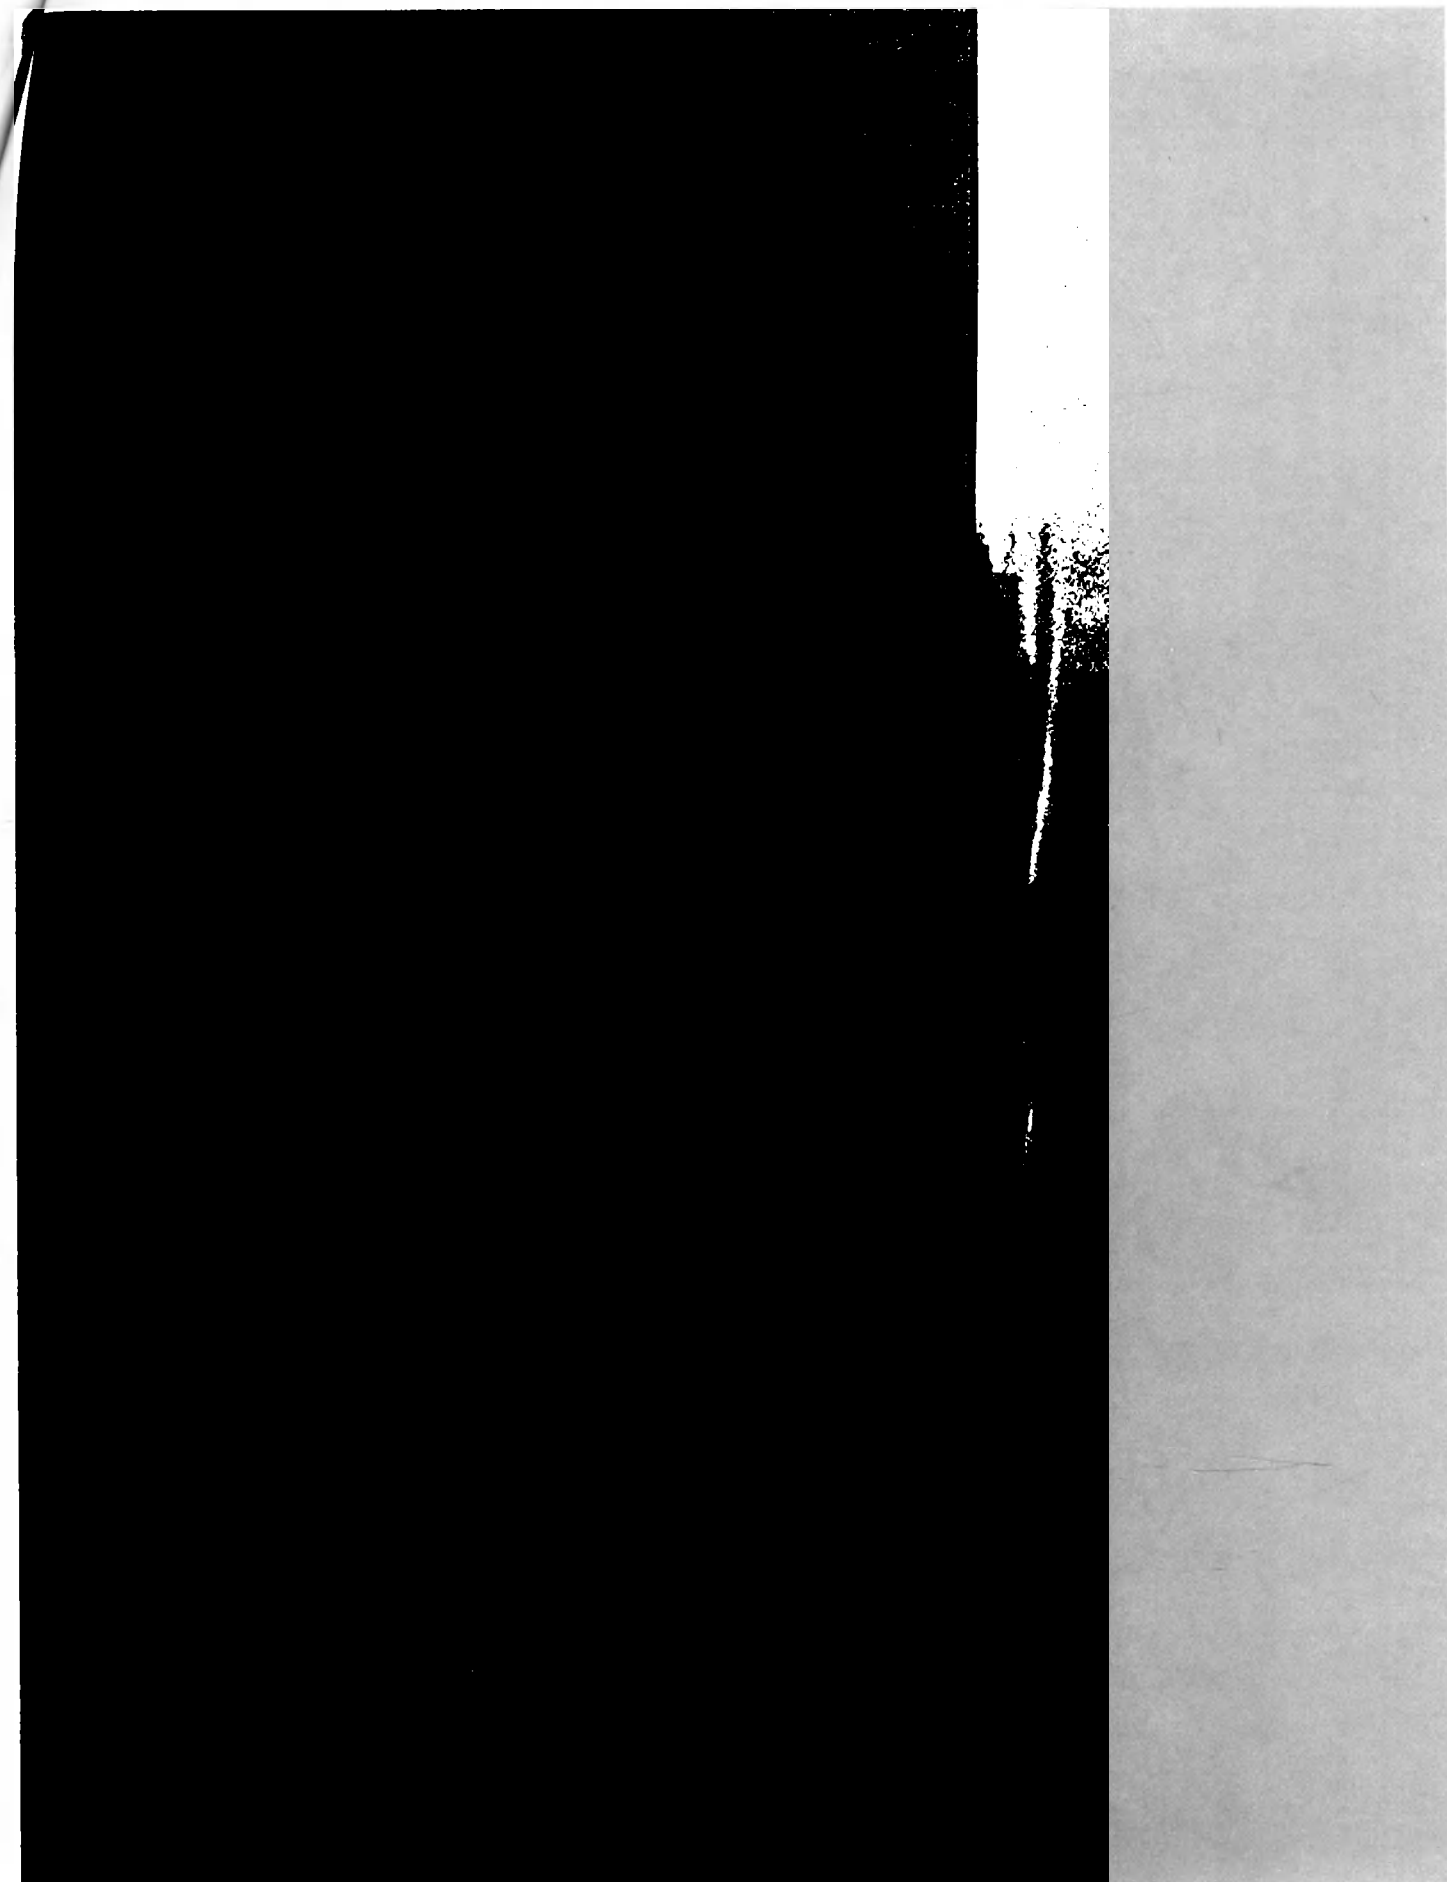

реагенты в кассете для количественного определения этанола в сыворотке, плазме крови и моче на модулях биохимических cobas c (ETOH2/Ethanol Gen.2 cobas c systems), вариант исполнения на 850 тестов

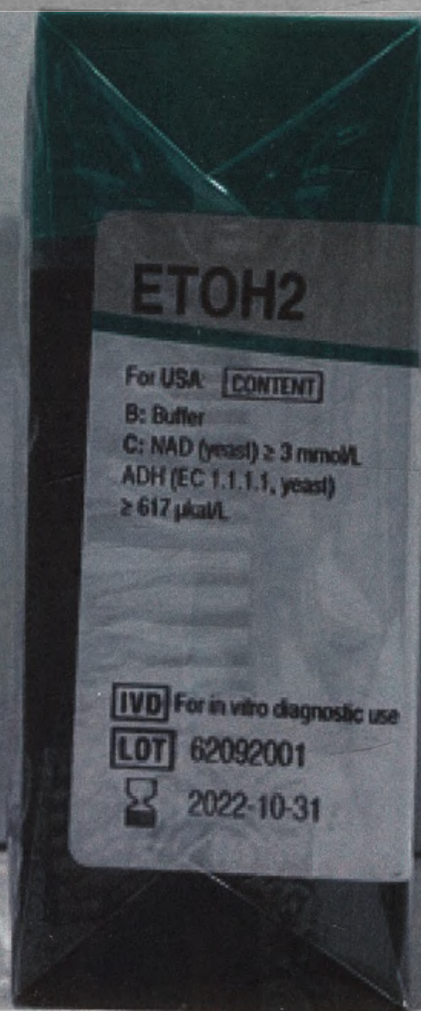

агенты в кассете для количественного определения этанола в сыворотке, плазме крови и моче на модулях биохимических cobas с (ETOH2/Ethanol Gen.2 cobas с systems), вариант исполнения на 850 тестов

 Реагенты в кассете для количественного определения этанола в сыворотке, плазме крови и моче на модулях биохимических cobas с (ETOH2/Ethanol Gen.2 cobas с systems), вариант исполнения на 850 тестов

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Промежуточные: «Roche Diagnostics GmbH» ("Roche Diagnostik GmbH"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия


Назначение предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рос Дианостика Рус» (ООО «Рос Дианостика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.rosdiagnostics2_dia@roche.com


Инструкция по применению на русском языке на бумажном носителе предоставляется отдельно (для запроса необходимо обратиться к уполномоченному представителю на территории РФ, контакты см. выше)

Кат. номер 08057630190

агенты в кассете для количественного определения этанола в сыворотке, плазме крови и моче на модулях
химических cobas c (ЕТОН2/Ethanol Gen.2 cobas c systems), вариант исполнения на 850 тестов

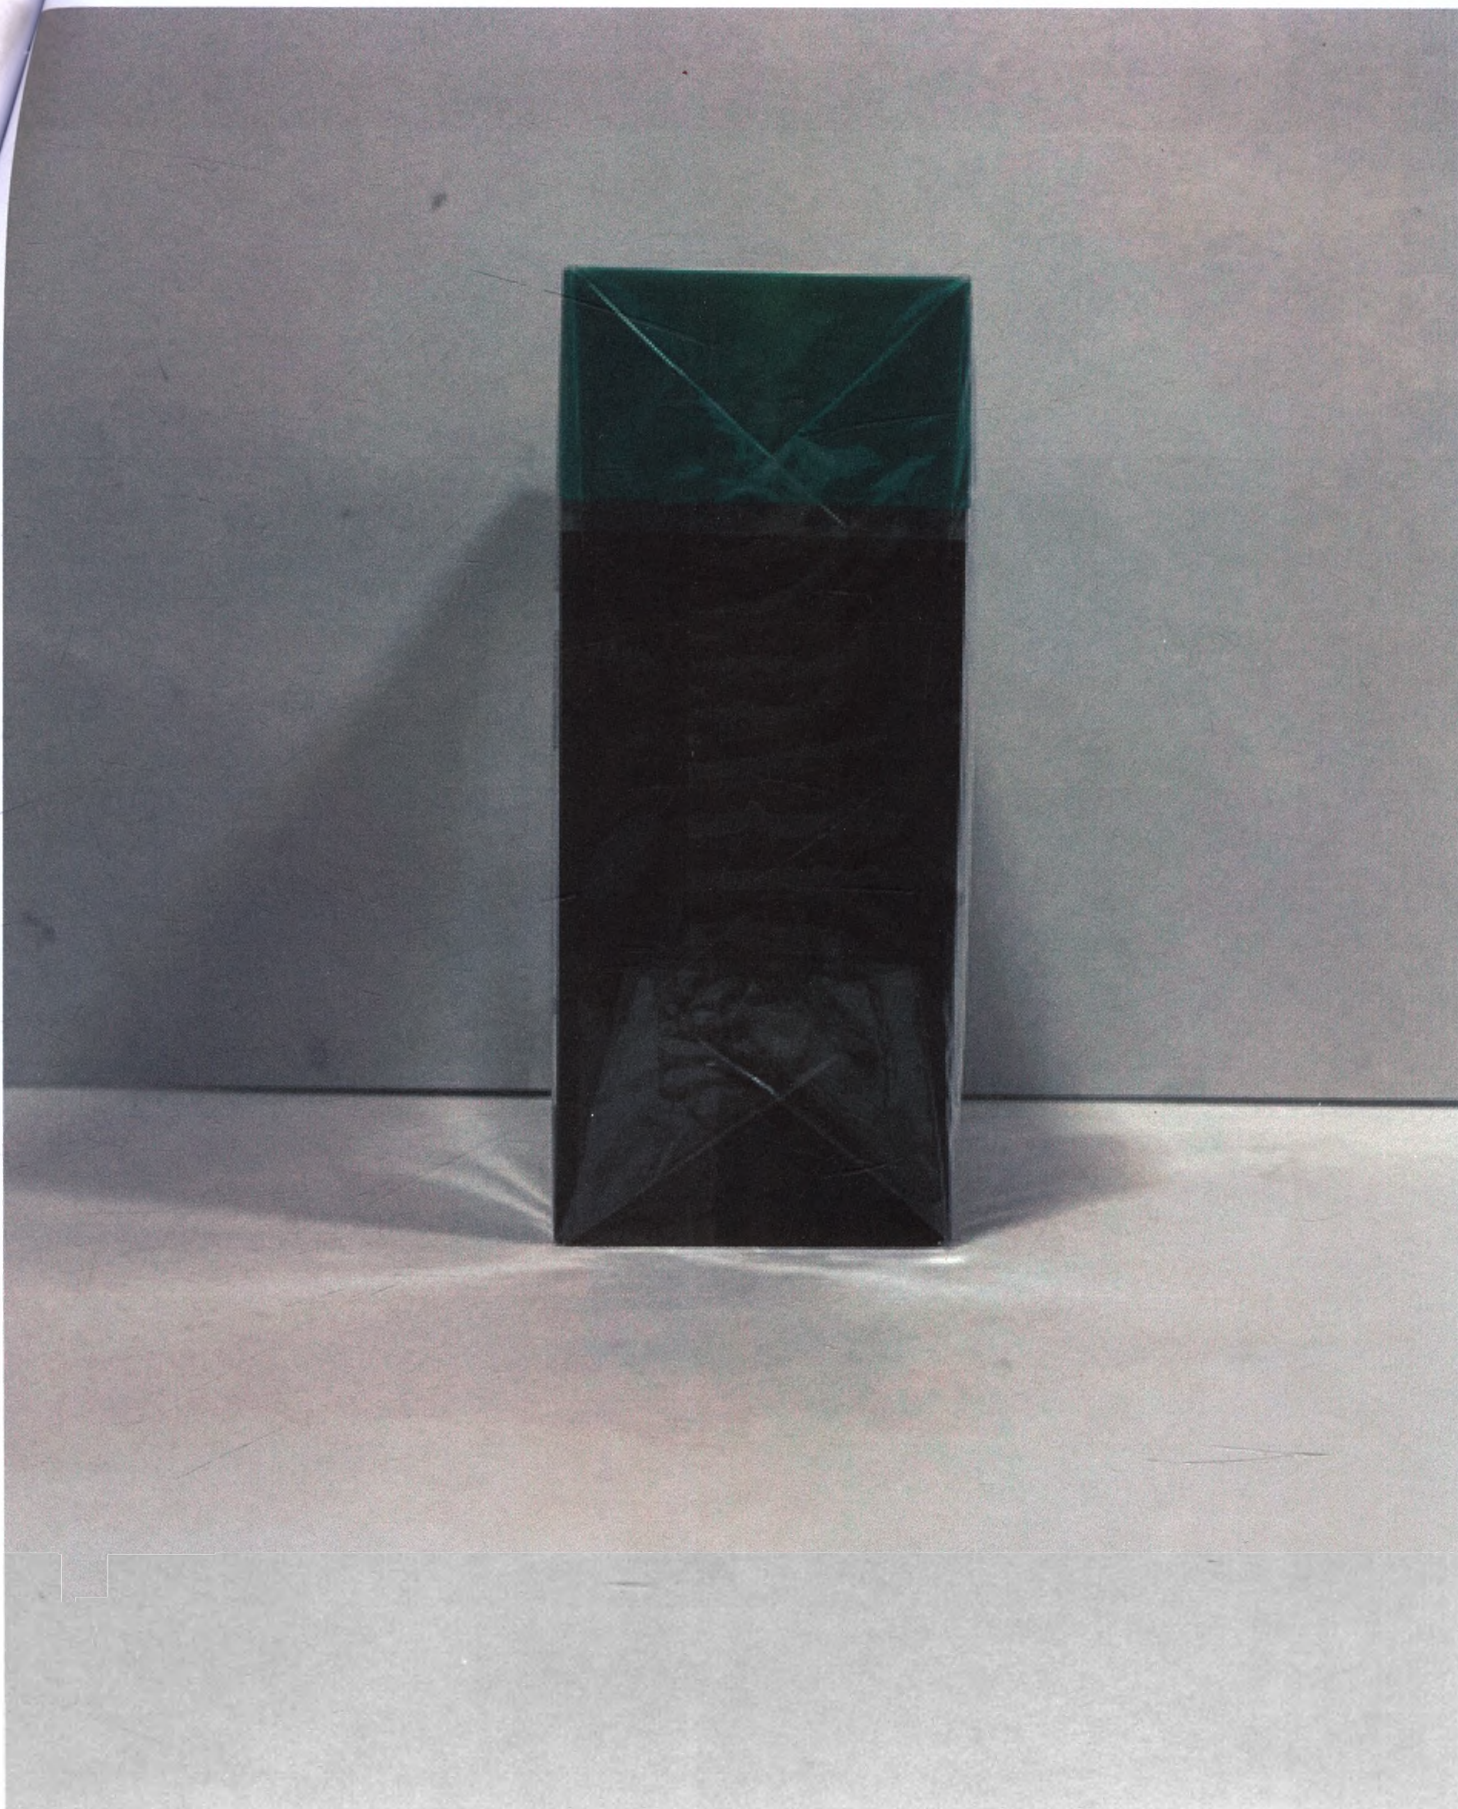

агенты в кассете для количественного определения этанола в сыворотке, плазме крови и моче на модулях химических cobas c (ЕТОН2/Ethanol Gen.2 cobas c systems), вариант исполнения на 150 тестов

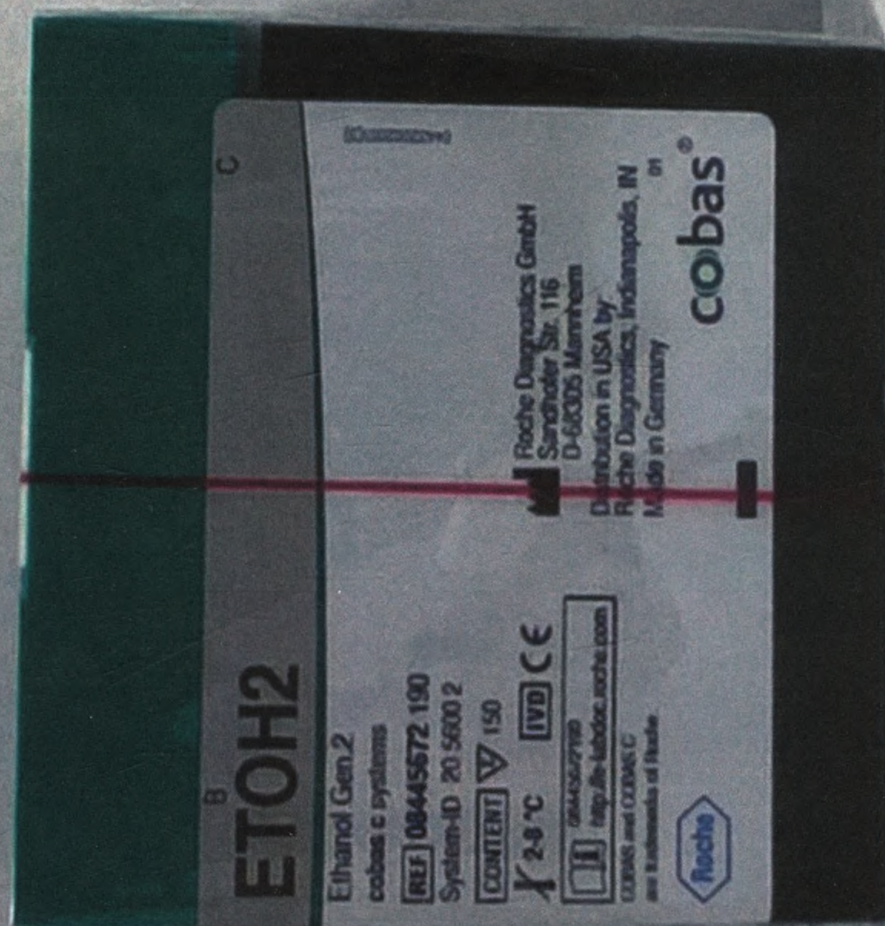

агенты в кассете для количественного определения этанола в сыворотке, плазме крови и моче на модулях химических cobas c (ЕТОН2/Ethanol Gen.2 cobas c systems), вариант исполнения на 150 тестов



Реагенты в кассете для количественного определения этанола в сыворотке, плазме крови и моче на модулях биохимических cobas c (ETOH2/Ethanol Gen.2 cobas c systems), вариант исполнения на 150 тестов

 Реагенты в кассете для количественного определения этанола в сыворотке, плазме крови и моче на модулях биохимических cobas c (ETOH2/Ethanol Gen.2 cobas c systems), вариант исполнения на 150 тестов

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Roche Diagnostika GmbH", Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия)

Изделие предназначено только для диагностики in vitro


Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубиня площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64

E-mail: moscow.registration2_dia@roche.com

Инструкция по применению на русском языке на бумажном носителе предоставляется отдельно (для запроса необходимо обратиться к уполномоченному представителю на территории РФ, контакты см. выше)

Кат. номер 08445672190


менты в кассете для количественного определения этанола в сыворотке, плазме крови и моче на модулях химических cobas c (ETOH2/Ethanol Gen.2 cobas c systems), вариант исполнения на 150 тестов

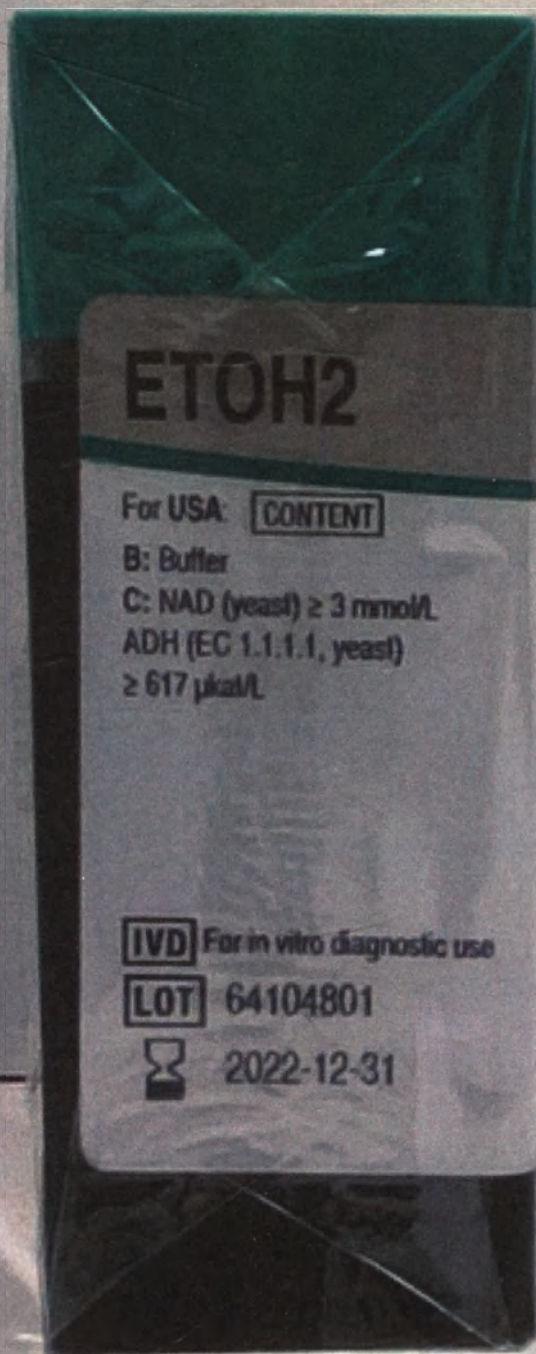

теты в кассете для количественного определения этанола в сыворотке, плазме крови и моче на модулях химических cobas c (ETOH2/Ethanol Gen.2 cobas c systems), вариант исполнения на 150 тестов



менты в кассете для количественного определения этанола в сыворотке, плазме крови и моче на модулях химических cobas c (ЕТОН2/Ethanol Gen.2 cobas c systems), вариант исполнения на 850 тестов

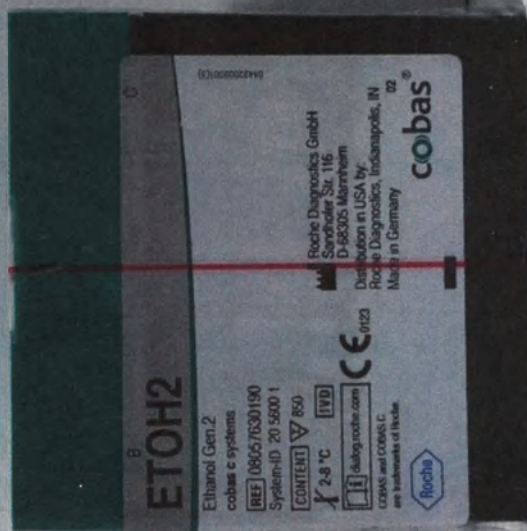

менты в кассете для количественного определения этанола в сыворотке, плазме крови и моче на модулях химических cobas c (ETOH2/Ethanol Gen.2 cobas c systems), вариант исполнения на 850 тестов




теты в кассете для количественного определения этанола в сыворотке, плазме крови и моче на модулях химических cobas c (ETOH2/Ethanol Gen.2 cobas c systems), вариант исполнения на 850 тестов




менты в кассете для количественного определения этанола в сыворотке, плазме крови и моче на модулях
химических cobas c (ETOH2/Ethanol Gen.2 cobas c systems), вариант исполнения на 850 тестов




менты в кассете для количественного определения этанола в сыворотке, плазме крови и моче на модулях химических cobas c (ETOH2/Ethanol Gen.2 cobas c systems), вариант исполнения на 850 тестов

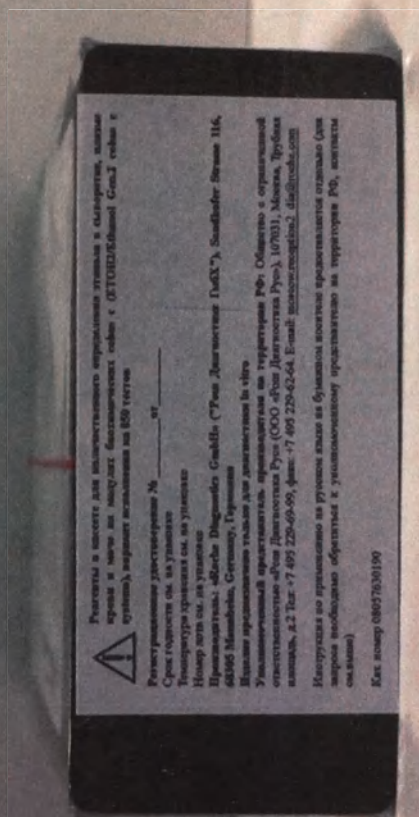


кассеты в кассете для количественного определения этанола в сыворотке, плазме крови и моче на модулях химических cobas c (ETOH2/Ethanol Gen.2 cobas c systems), вариант исполнения на 150 тестов

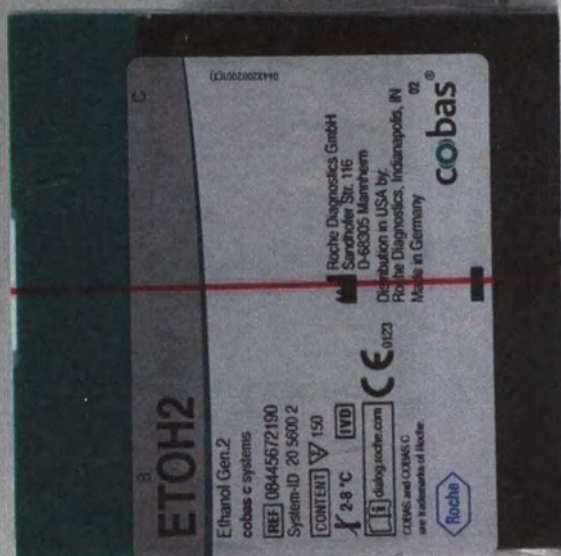

теты в кассете для количественного определения этанола в сыворотке, плазме крови и моче на модулях химических cobas c (ЕТОН2/Ethanol Gen.2 cobas c systems), вариант исполнения на 150 тестов

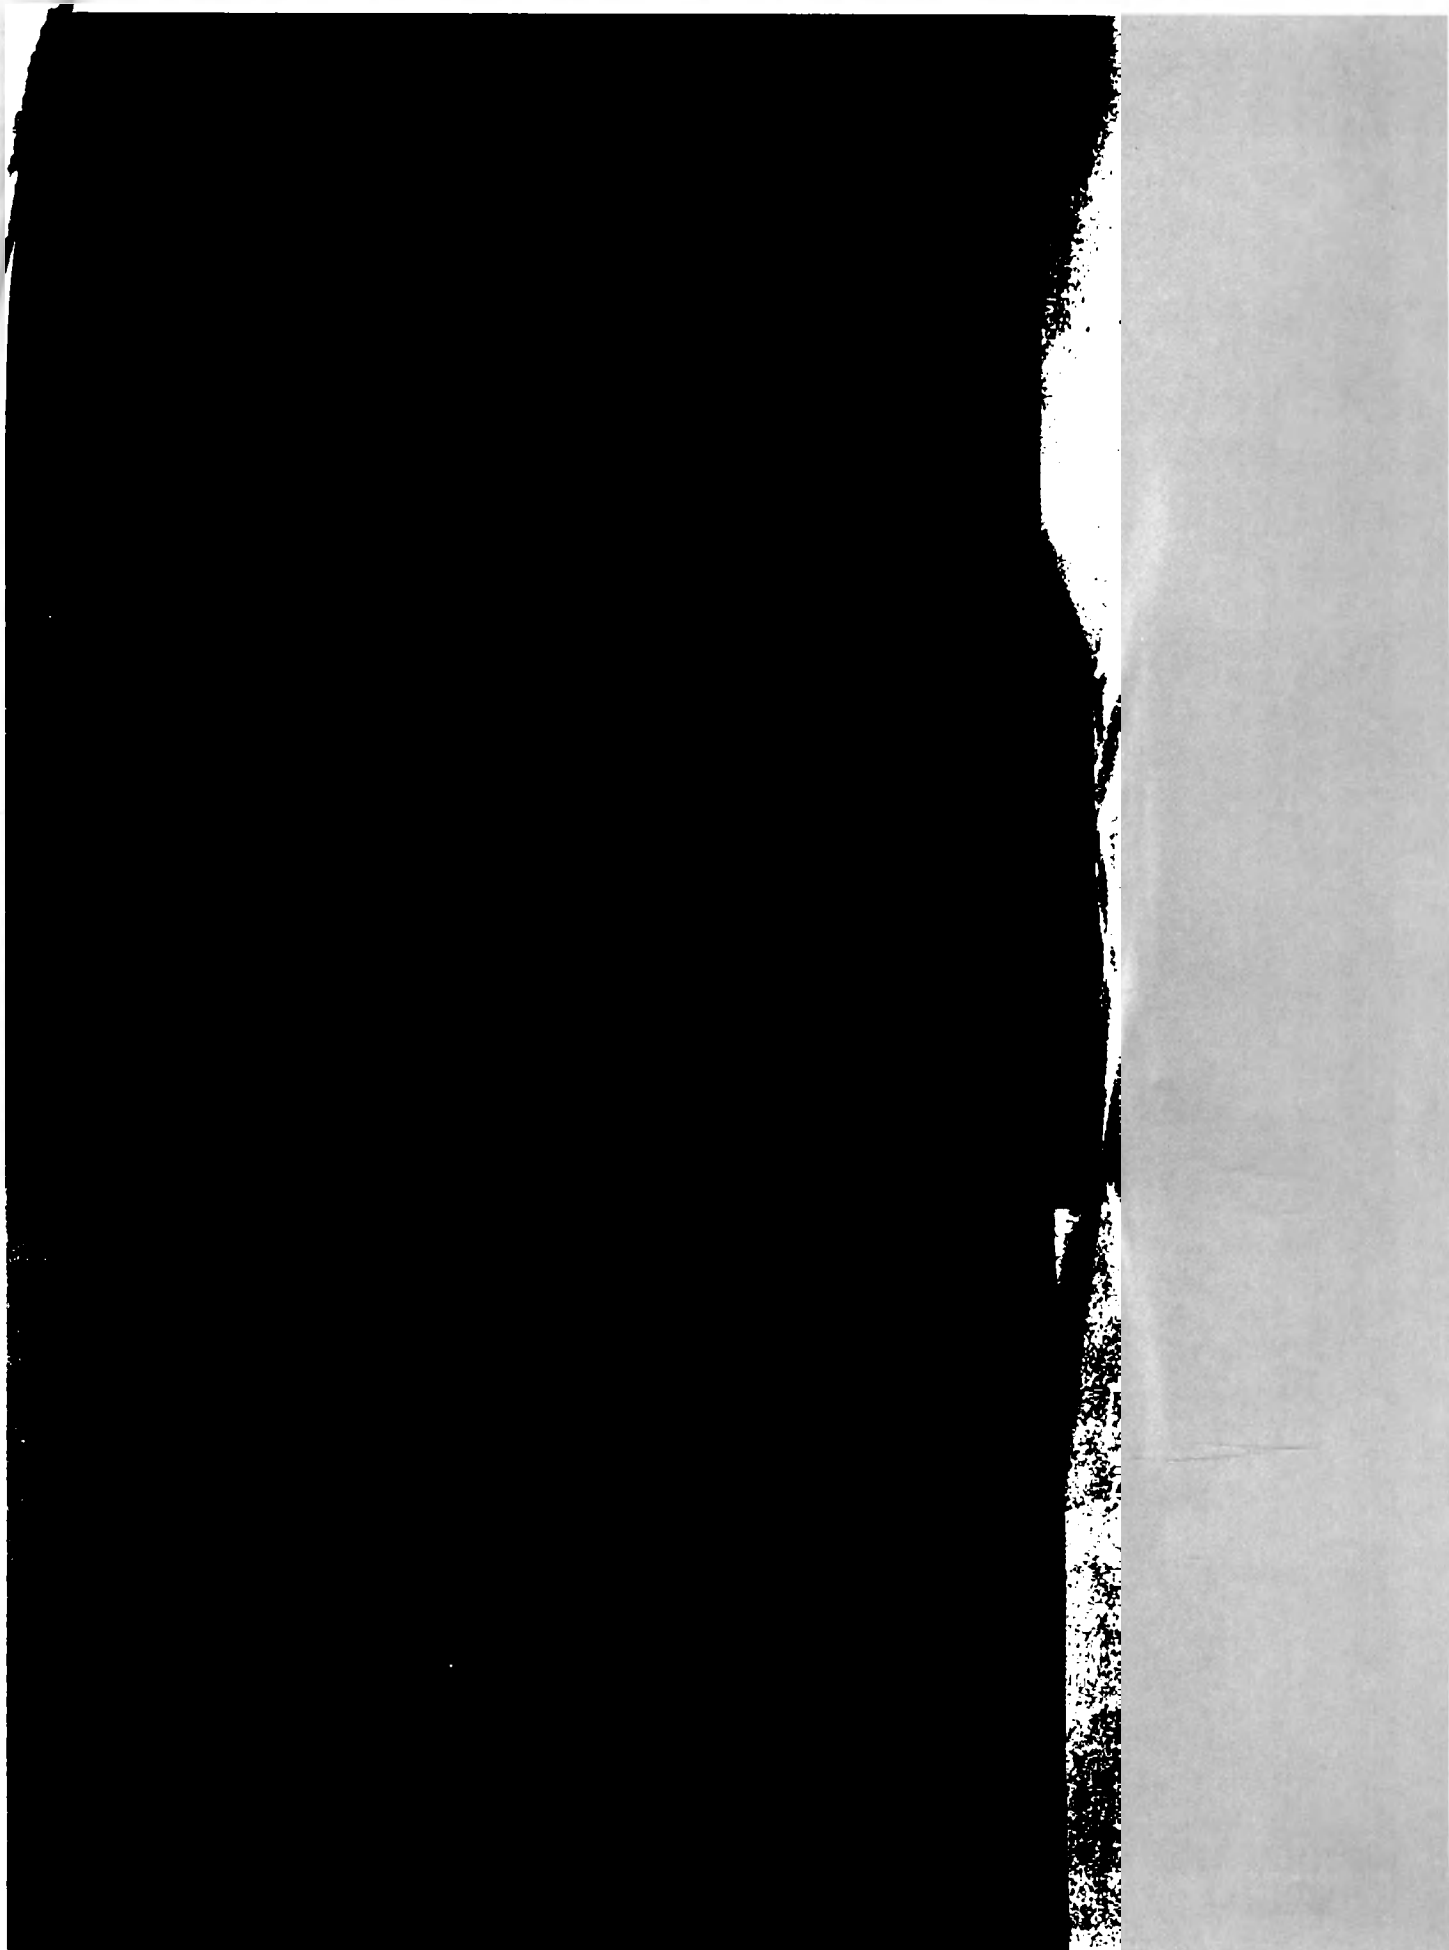


менты в кассете для количественного определения этанола в сыворотке, плазме крови и моче на модулях химических cobas c (ETOH2/Ethanol Gen.2 cobas c systems), вариант исполнения на 150 тестов

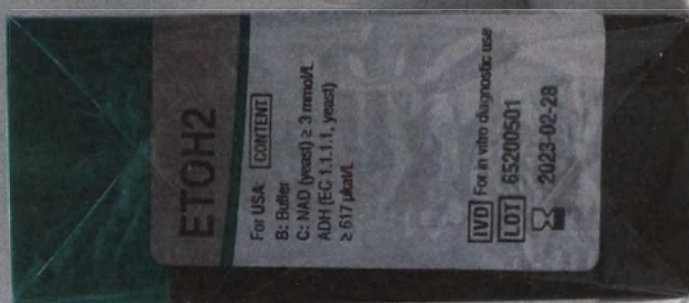

теты в кассете для количественного определения этанола в сыворотке, плазме крови и моче на модулях химических cobas c (ETOH2/Ethanol Gen.2 cobas c systems), вариант исполнения на 150 тестов



Результаты в кассете для количественного определения этанола в сыворотке, плазме крови и моче на модулях химических cobas c (ETOH2/Ethanol Gen.2 cobas c systems), вариант исполнения на 150 тестов

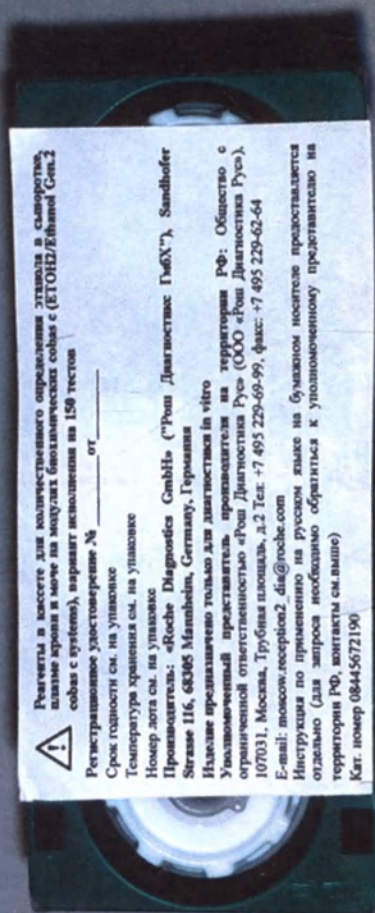

Результаты в кассете для количественного определения этанола в сыворотке, плазме крови и моче на модулях биохимических cobas c (ETOH2/Ethanol Gen.2 cobas c systems), вариант исполнения на 150 тестов

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Roche Diagnostik GmbH"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Издание предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубиня площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64

E-mail: moscow.rosch@roche.com

Инструкция по применению на русском языке на бумажном носителе предоставляется отдельно (для запроса необходимо обратиться к уполномоченному представителю на территории РФ, контакты см. выше)

Кат. номер 08445672190

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
21 листа (ов)



Мамеев А.С.

по доверенности
от 30.01.2023 г.