

УТВЕРЖДАЮ

Супервайзер по европейской
процедуре регистрации

ООО «Джонсон & Джонсон»

Рыбакова А.Н.



«10» июля 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

Линзы контактные ACUVUE® OASYS with HydraLuxe®

2024г.



Фото 1. Линзы контактные ACUVUE® OASYS with HydraLuxe®, 30 шт. в упаковке – потребительская упаковка

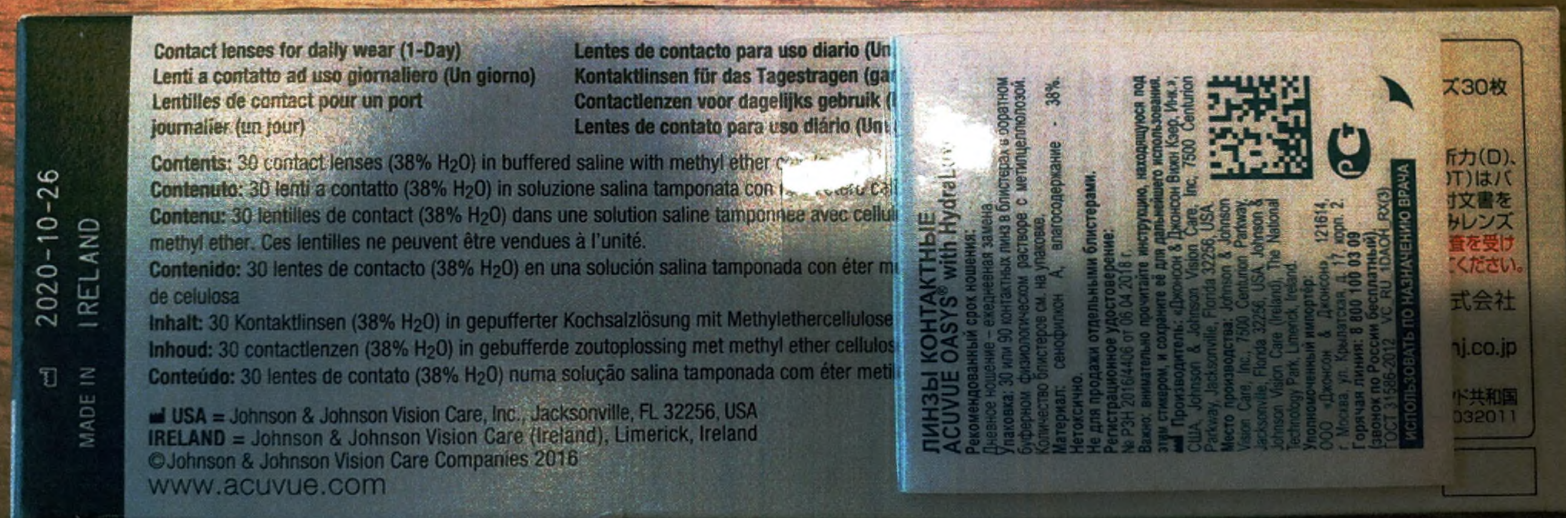


Фото 2. Линзы контактные ACUVUE® OASYS with HydraLuxe®, 30 шт. в упаковке – маркировка потребительской упаковки (оборотная сторона)

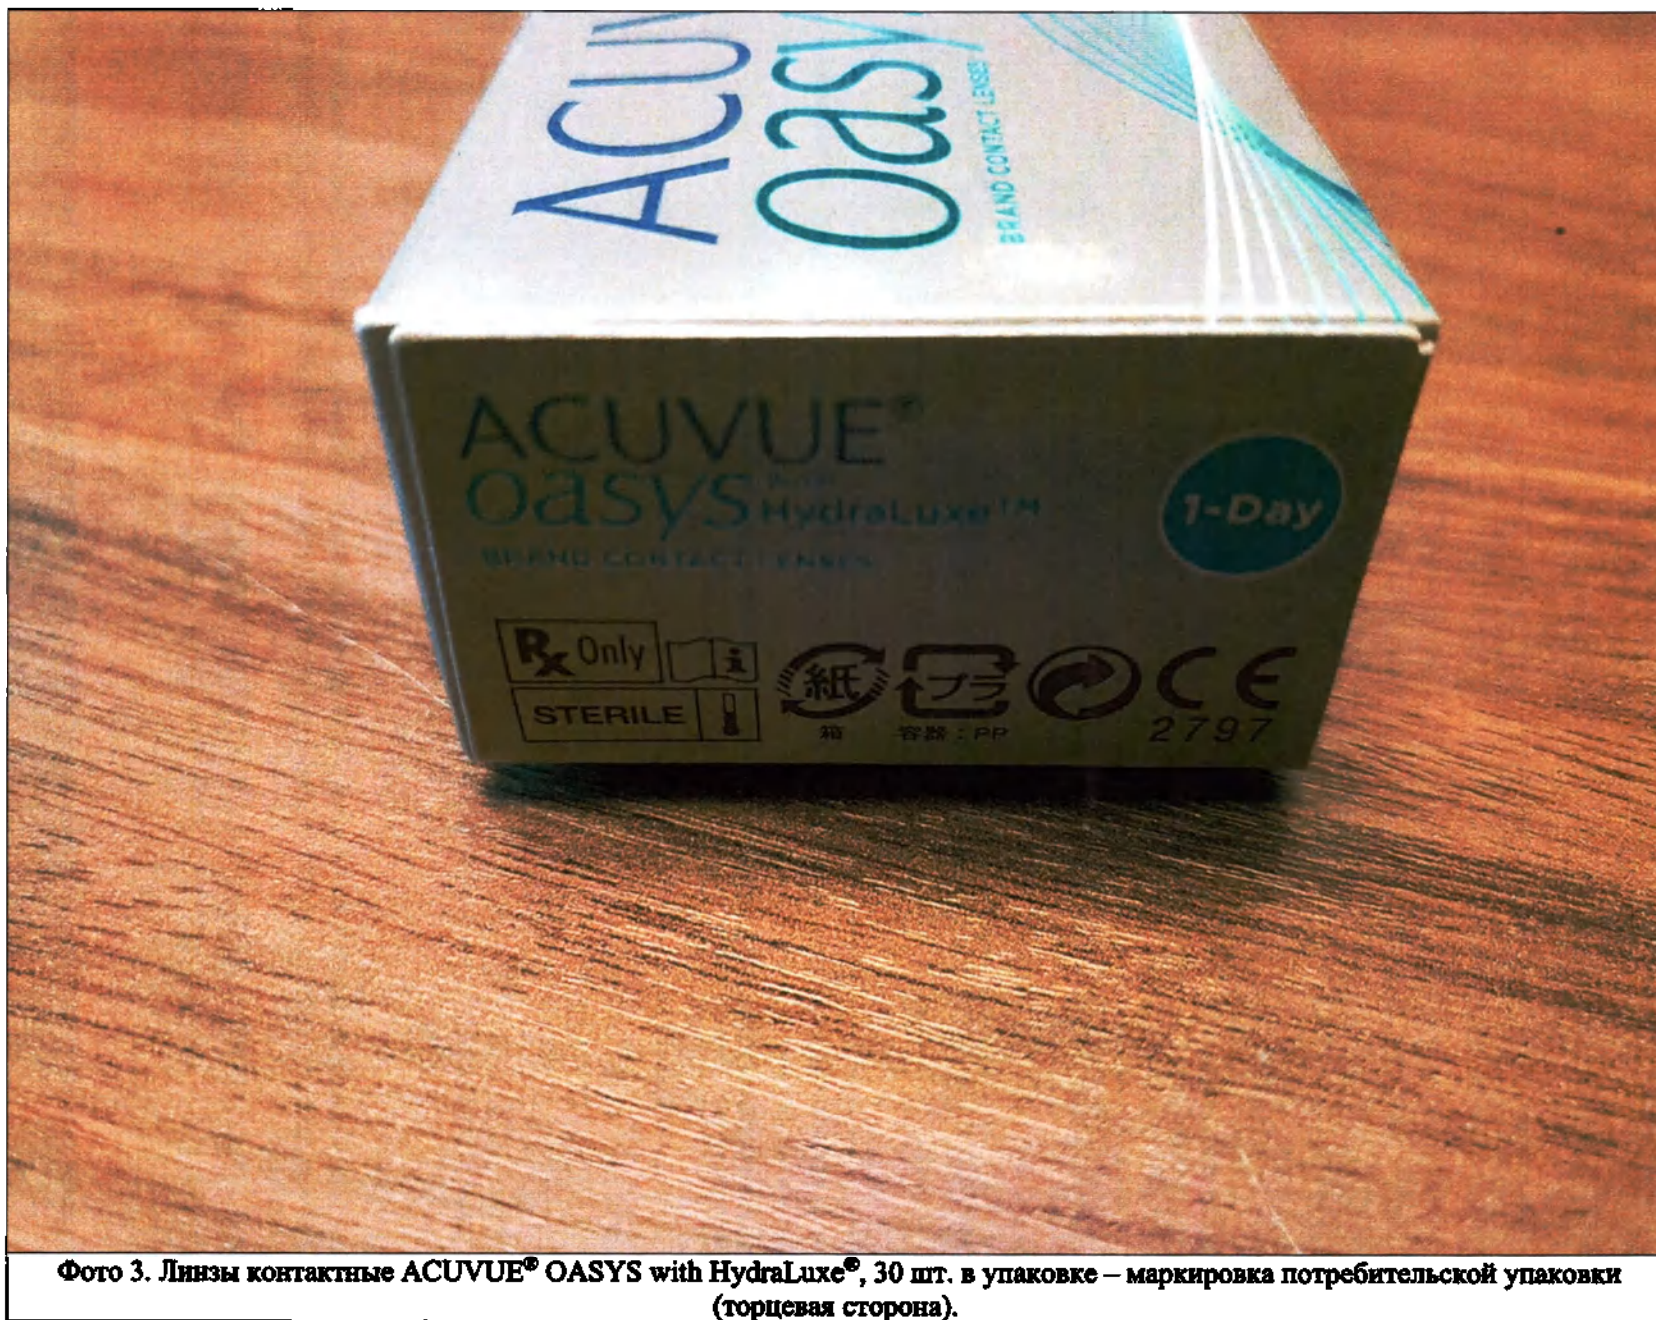


Фото 3. Линзы контактные ACUVUE[®] OASYS with HydraLuxe[®], 30 шт. в упаковке – маркировка потребительской упаковки (торцевая сторона).

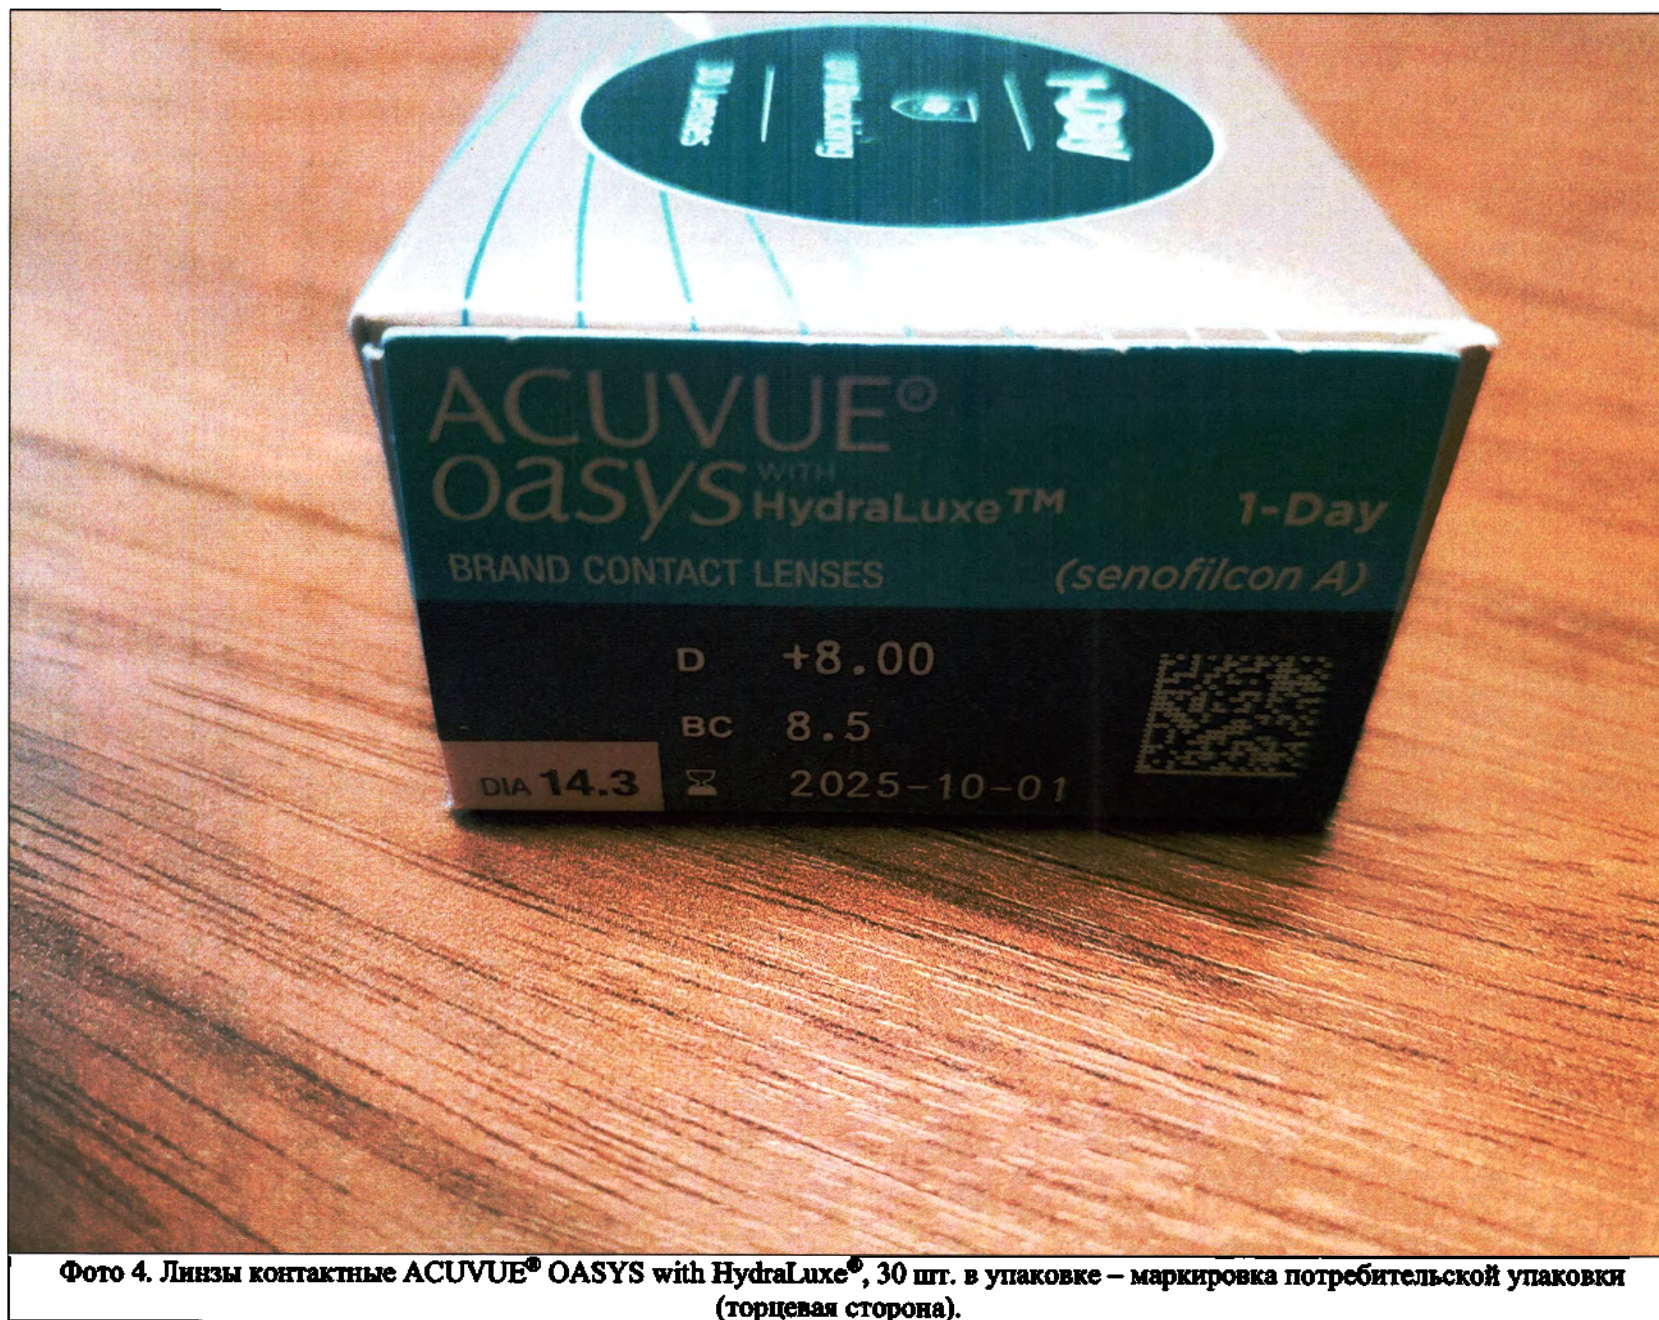


Фото 4. Линзы контактные ACUVUE® OASYS with HydraLuxe®, 30 шт. в упаковке – маркировка потребительской упаковки (торцевая сторона).




Фото 5. Линзы контактные ACUVUE® OASYS with HydraLuxe®, 30 шт. в упаковке – маркировка стерильной упаковки (блистеры с раствором)



Фото 6. Линзы контактные ACUVUE® OASYS with HydraLuxe®, 30 шт. в упаковке – изделие в стерильной упаковке (блистеры с раствором)




shown with etching

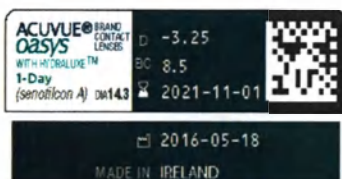

ИЛИ

Фото 7. Линзы контактные ACUVUE® OASYS with HydraLuxe®, 5 шт. в упаковке – макет потребительской упаковки для врача (версия 1)

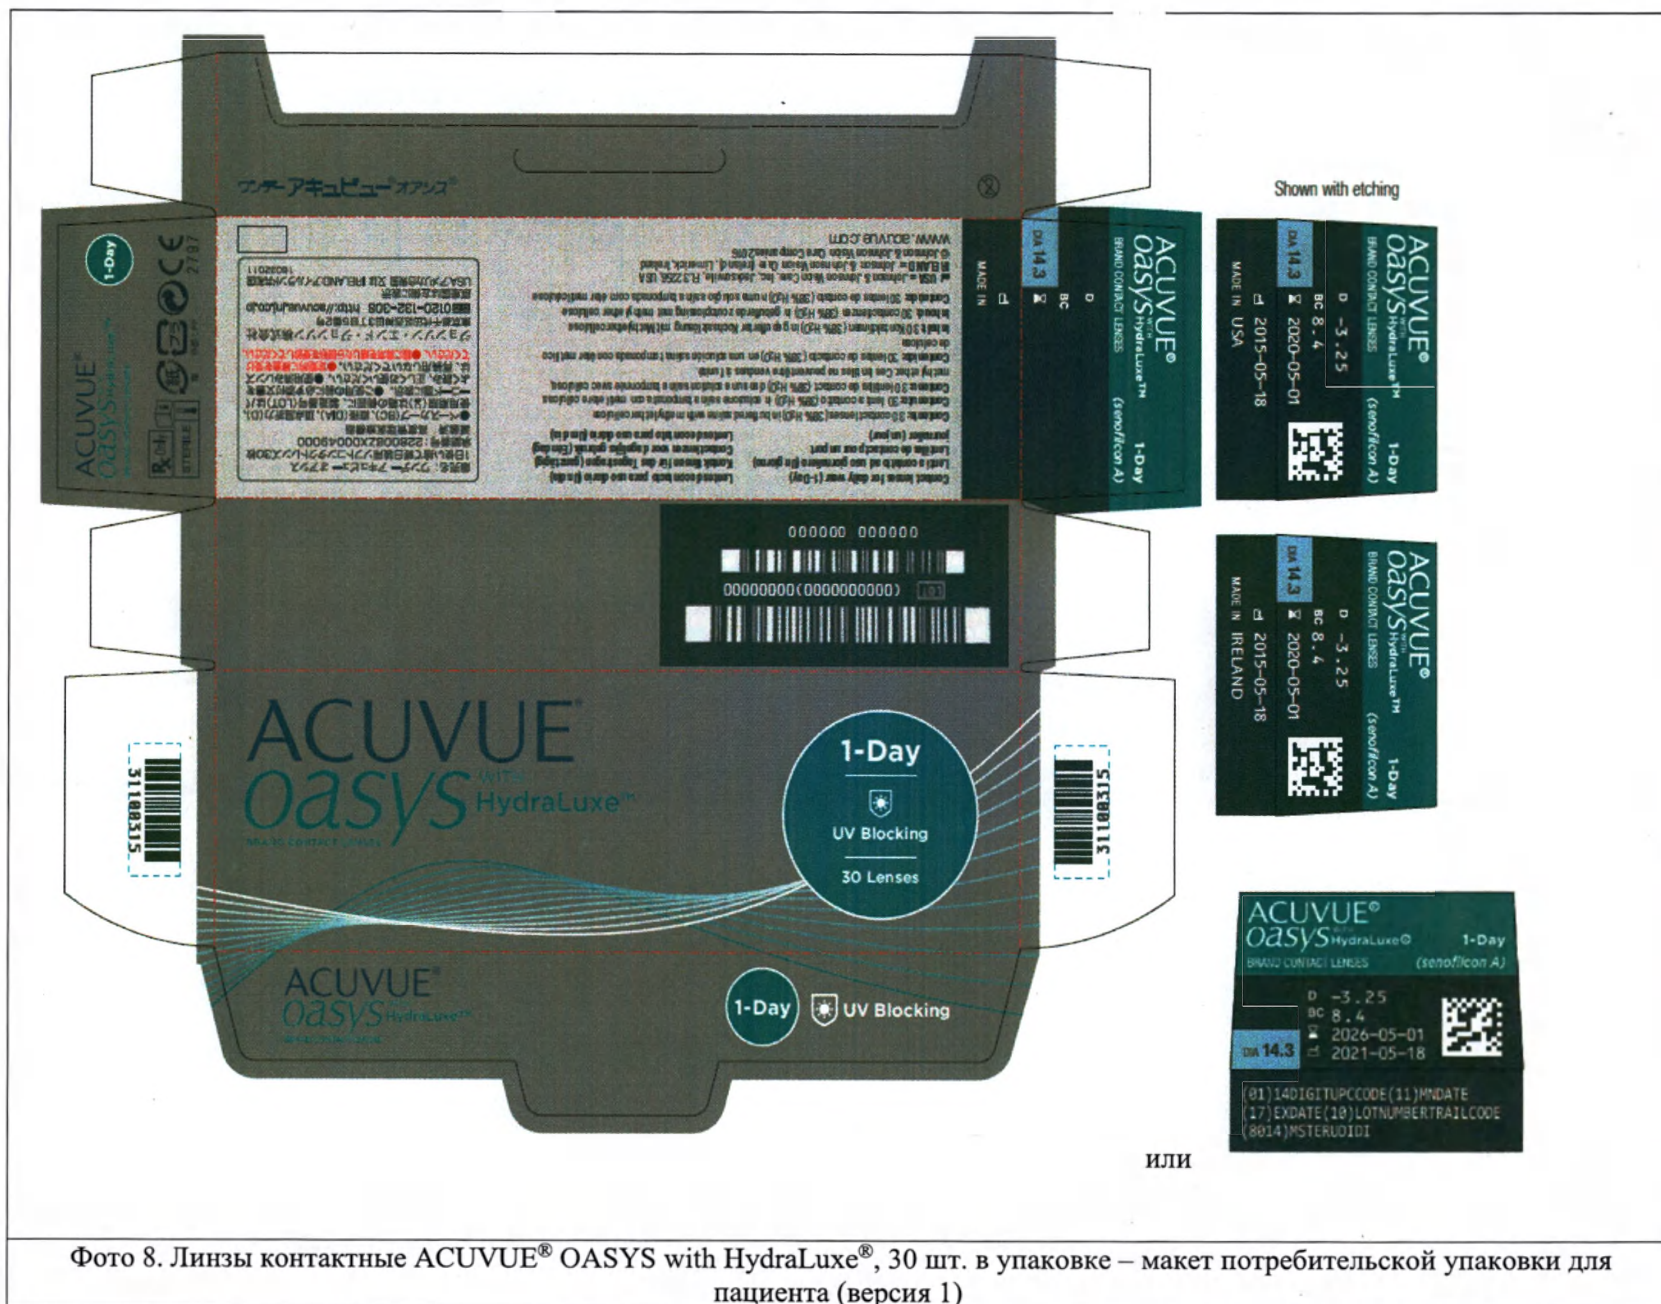


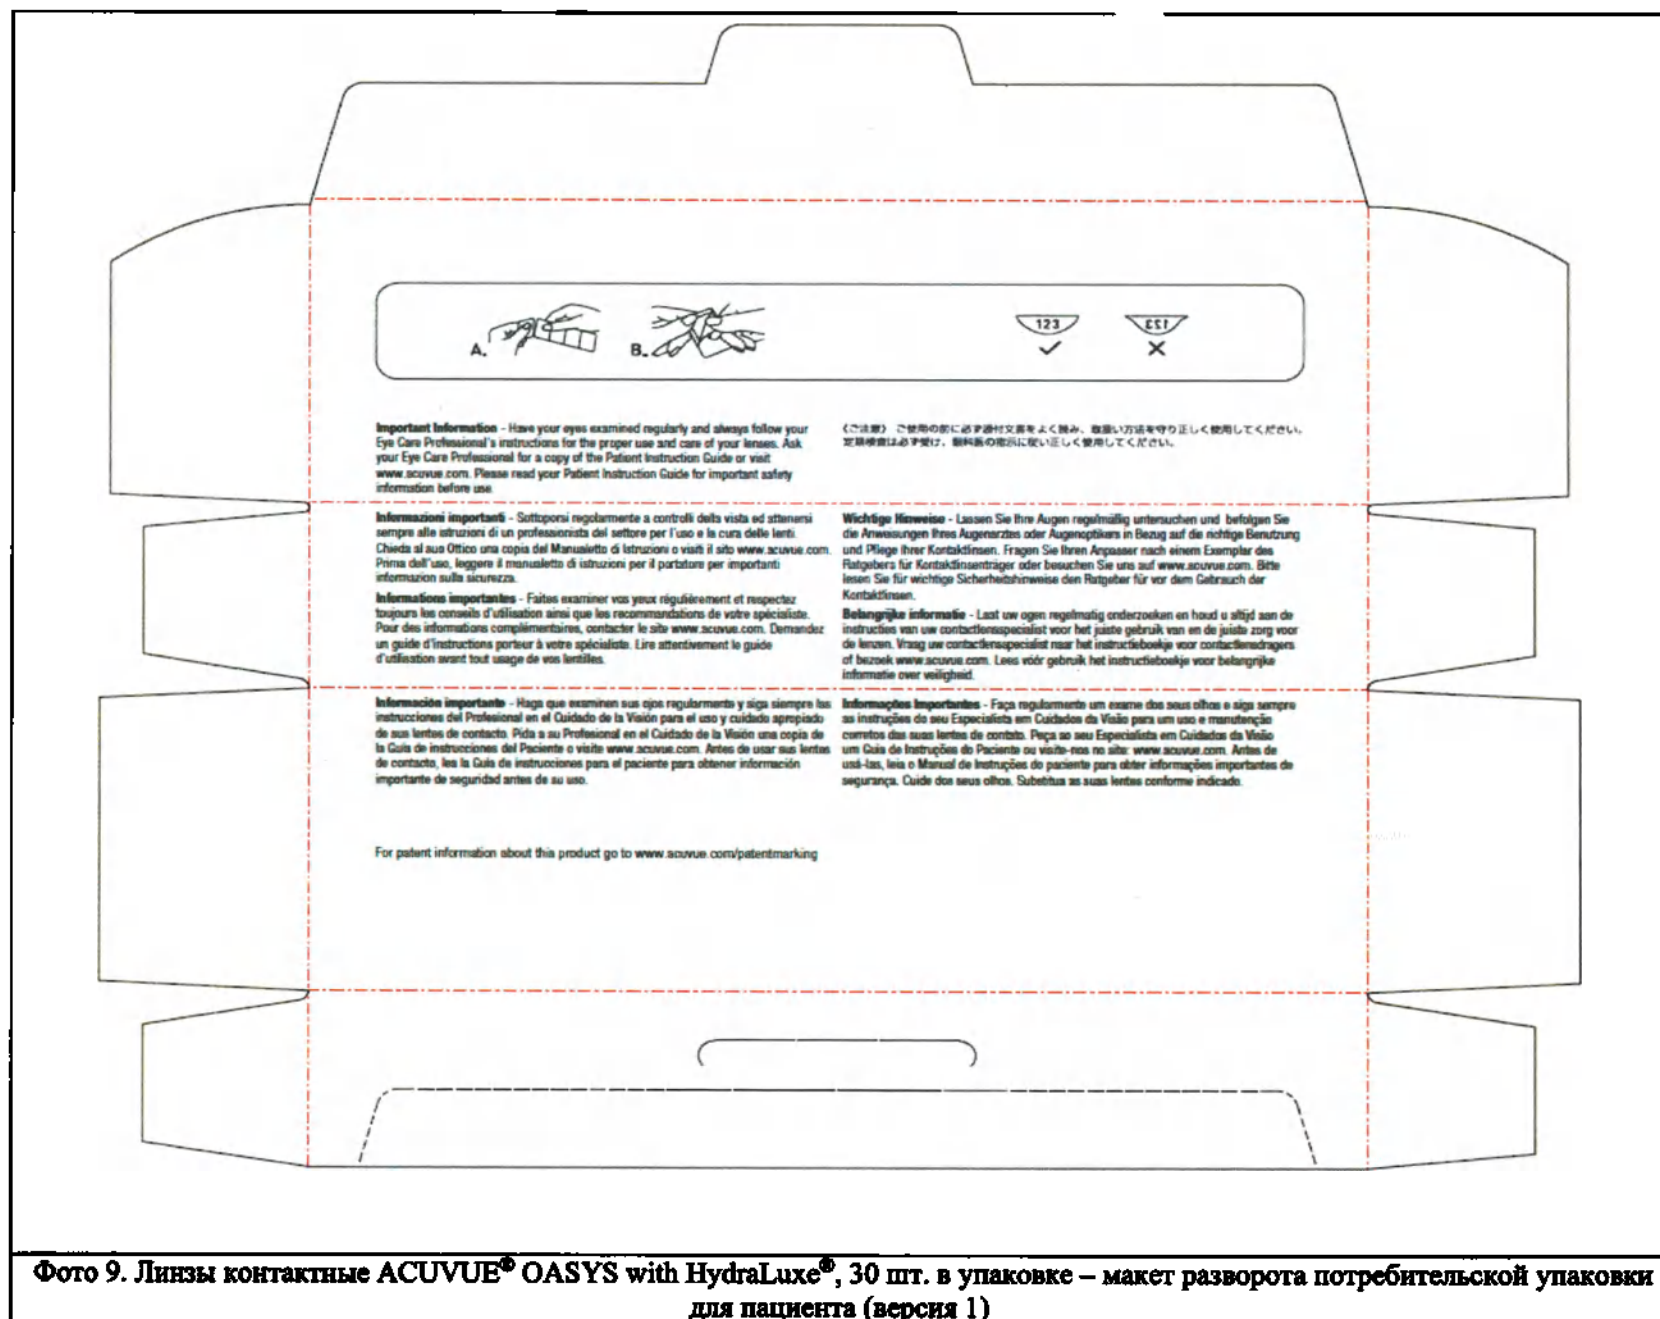


Фото 9. Линзы контактные ACUVUE® OASYS with HydraLuxe®, 30 шт. в упаковке – макет разворота потребительской упаковки для пациента (версия 1)

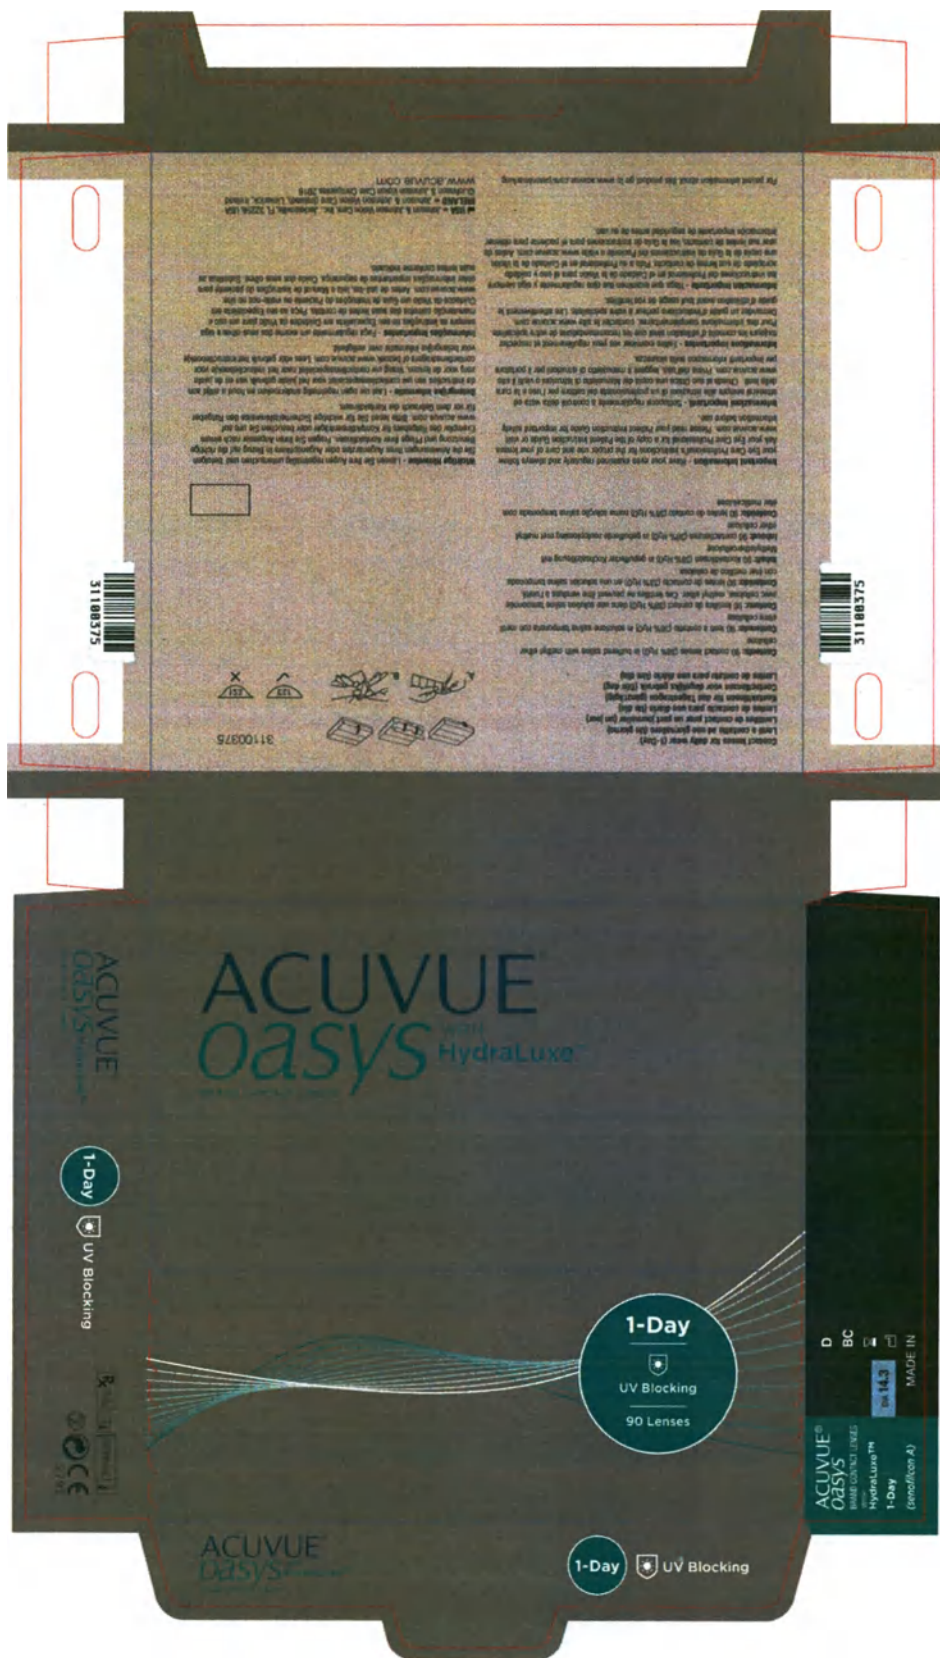

Shown with etching



Фото 10. Линзы контактные ACUVUE® OASYS with HydraLuxe®, 90 шт. в упаковке – макет потребительской упаковки для пациента (версия 1)



НЛИН

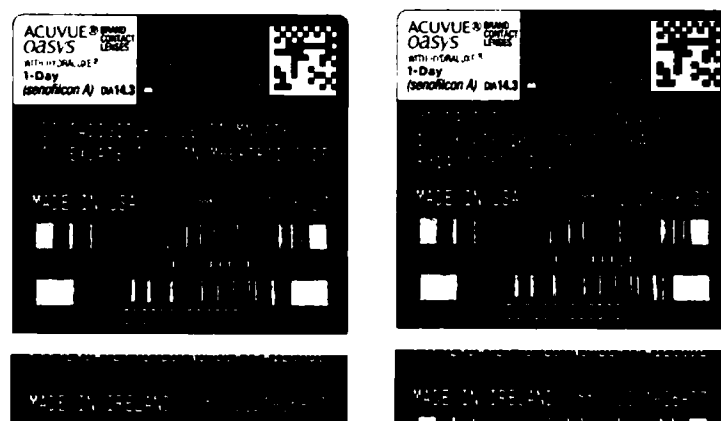


Фото 11. Линзы контактные ACUVUE® OASYS with HydraLux®, 5 шт. в упаковке – макет потребительской упаковки для врача (версия 2)

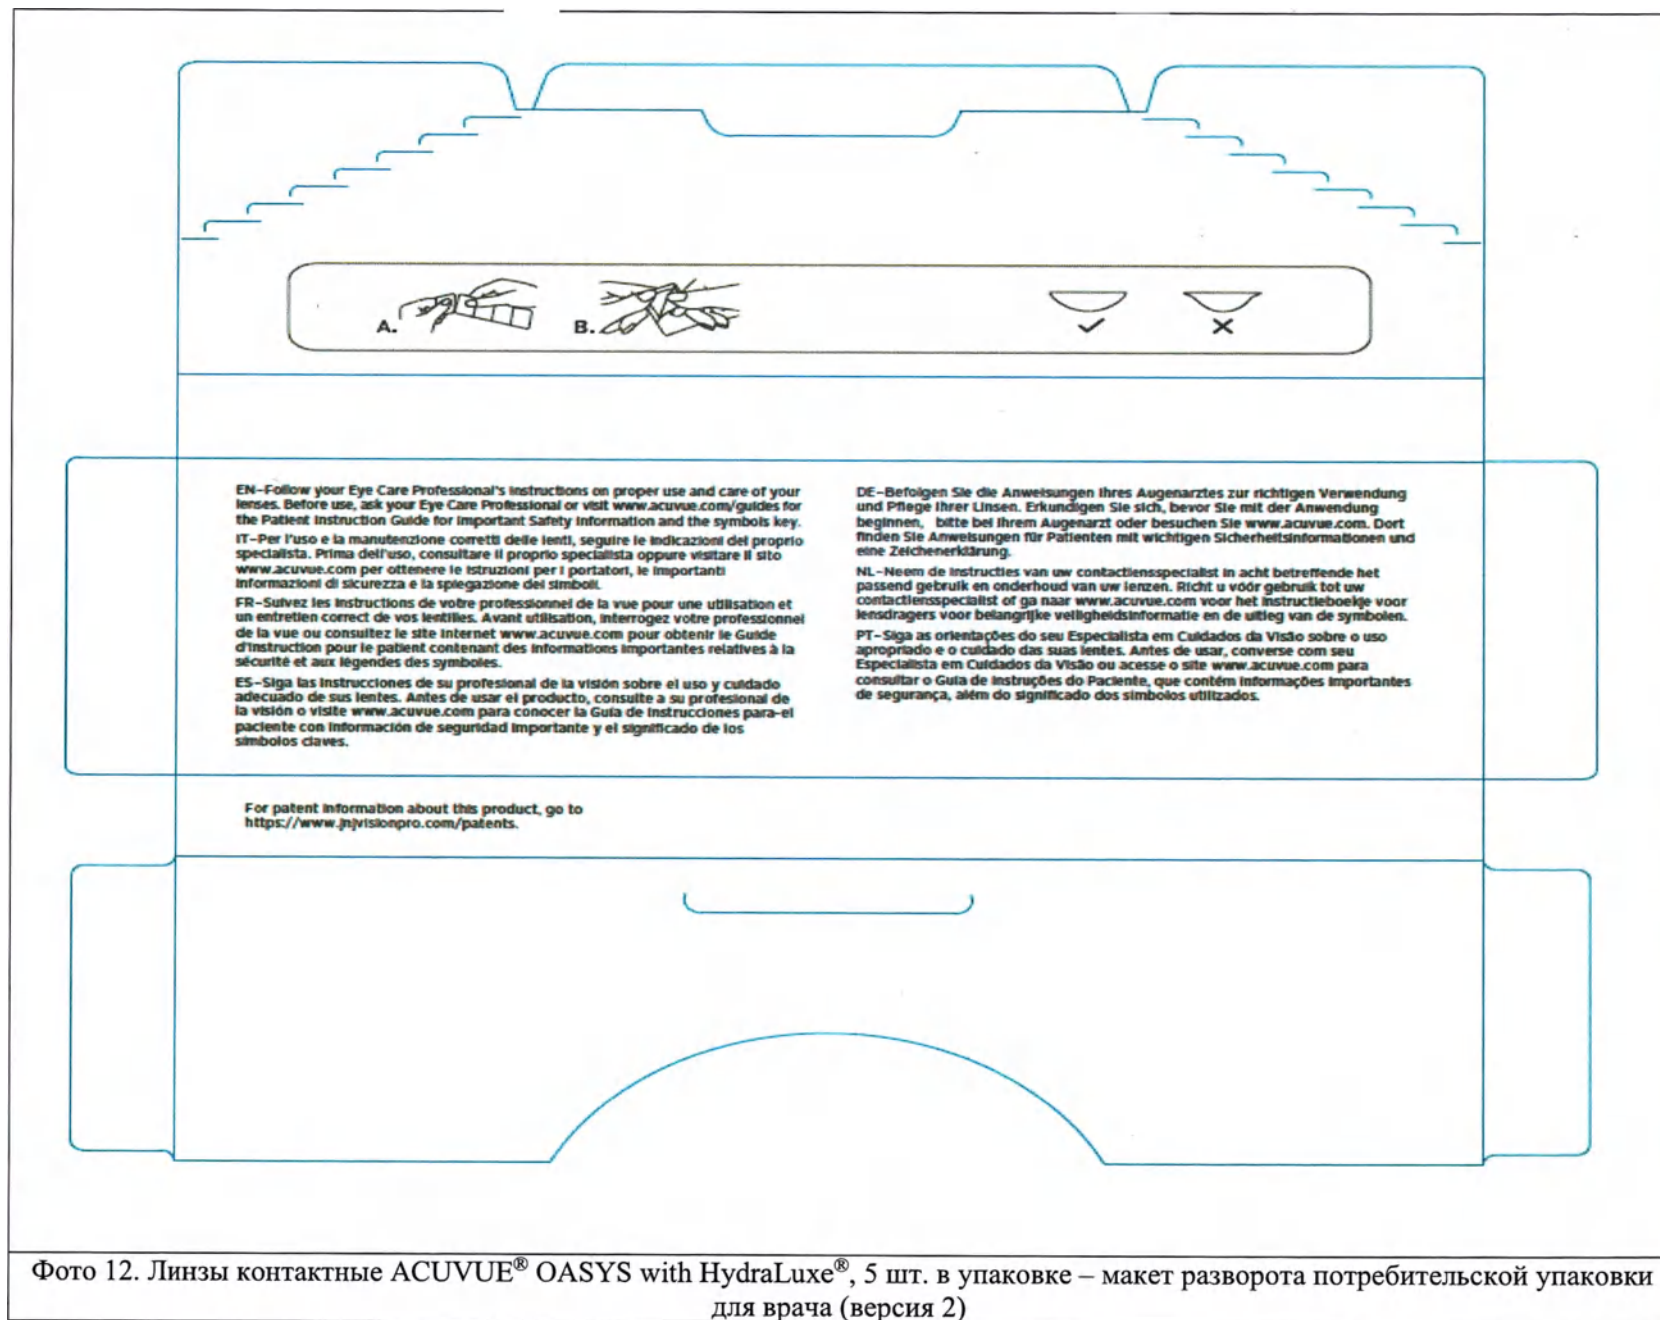


Фото 12. Линзы контактные ACUVUE® OASYS with HydraLuxe®, 5 шт. в упаковке – макет разворота потребительской упаковки для врача (версия 2)

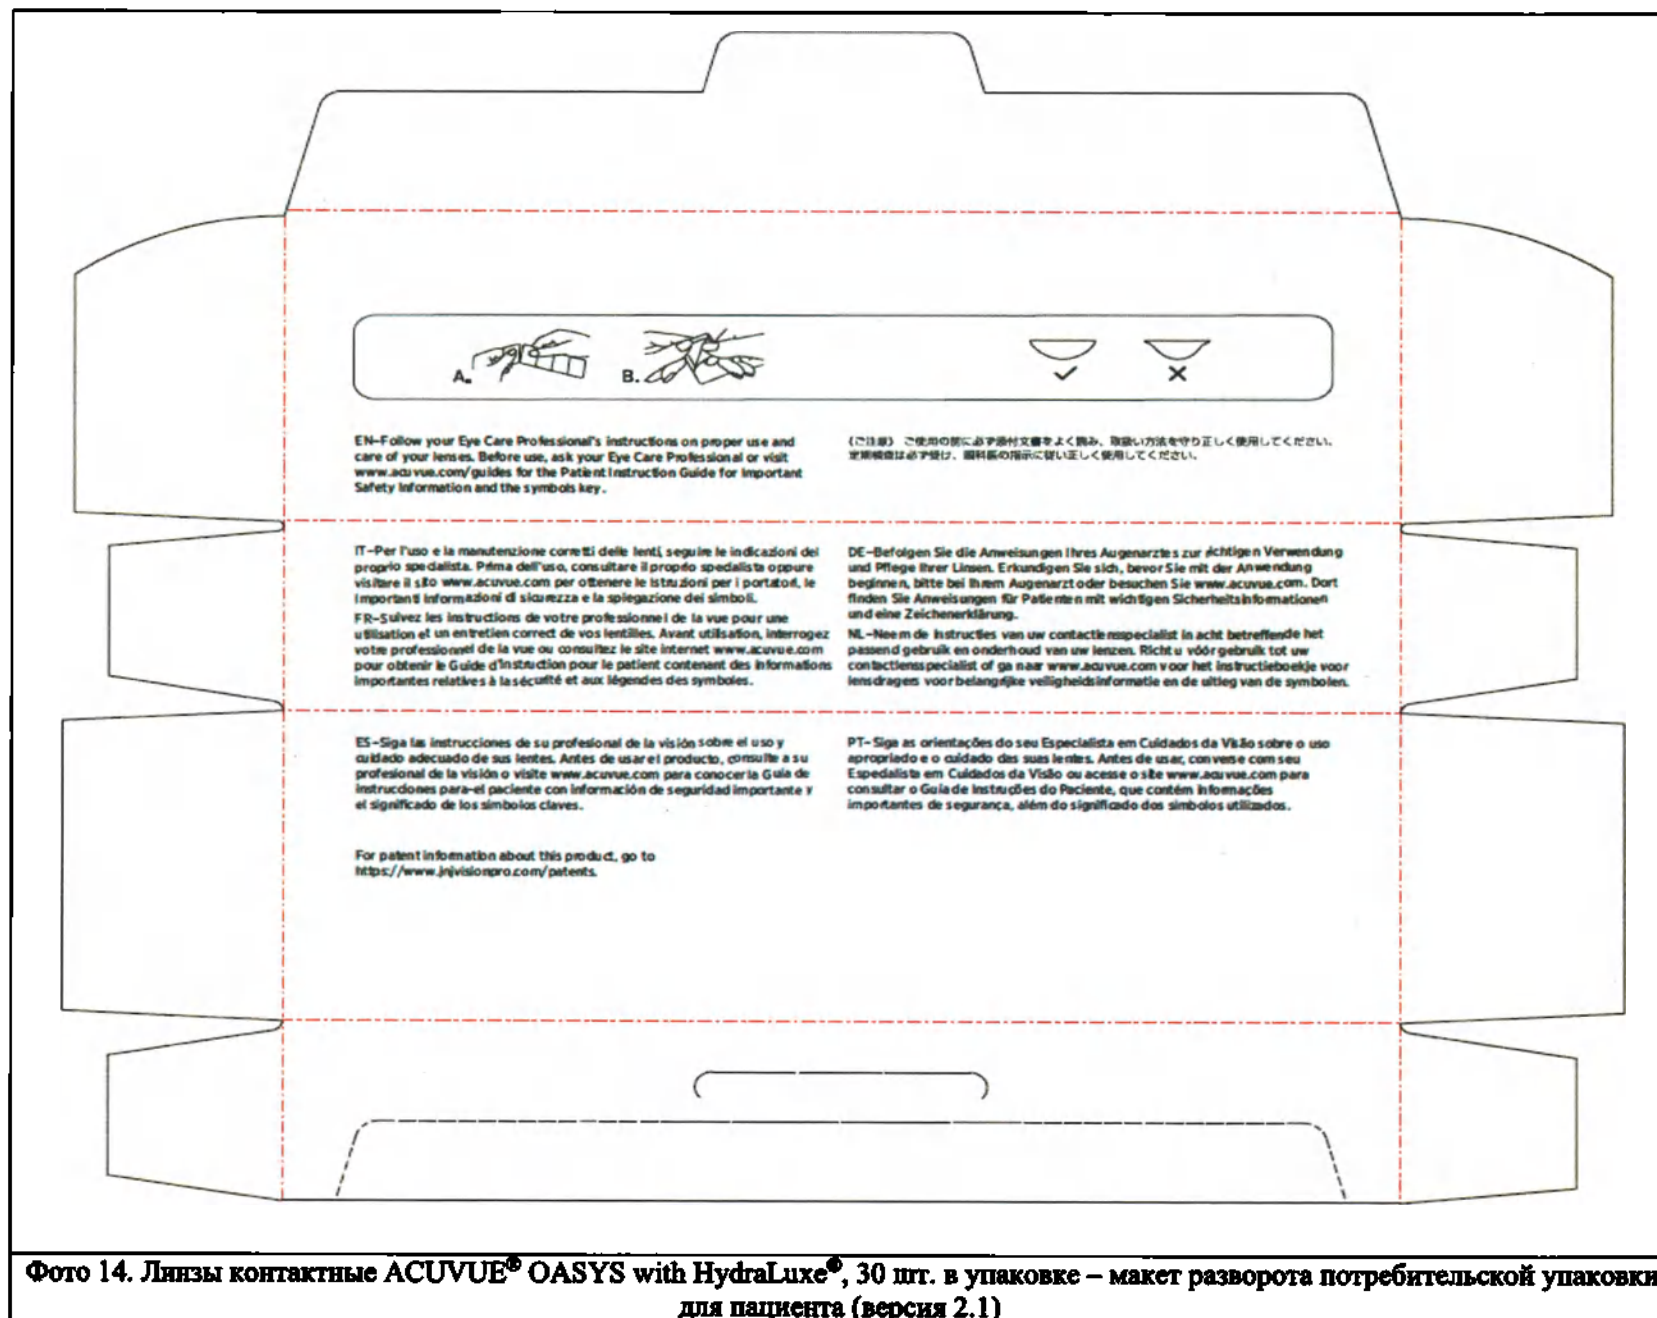
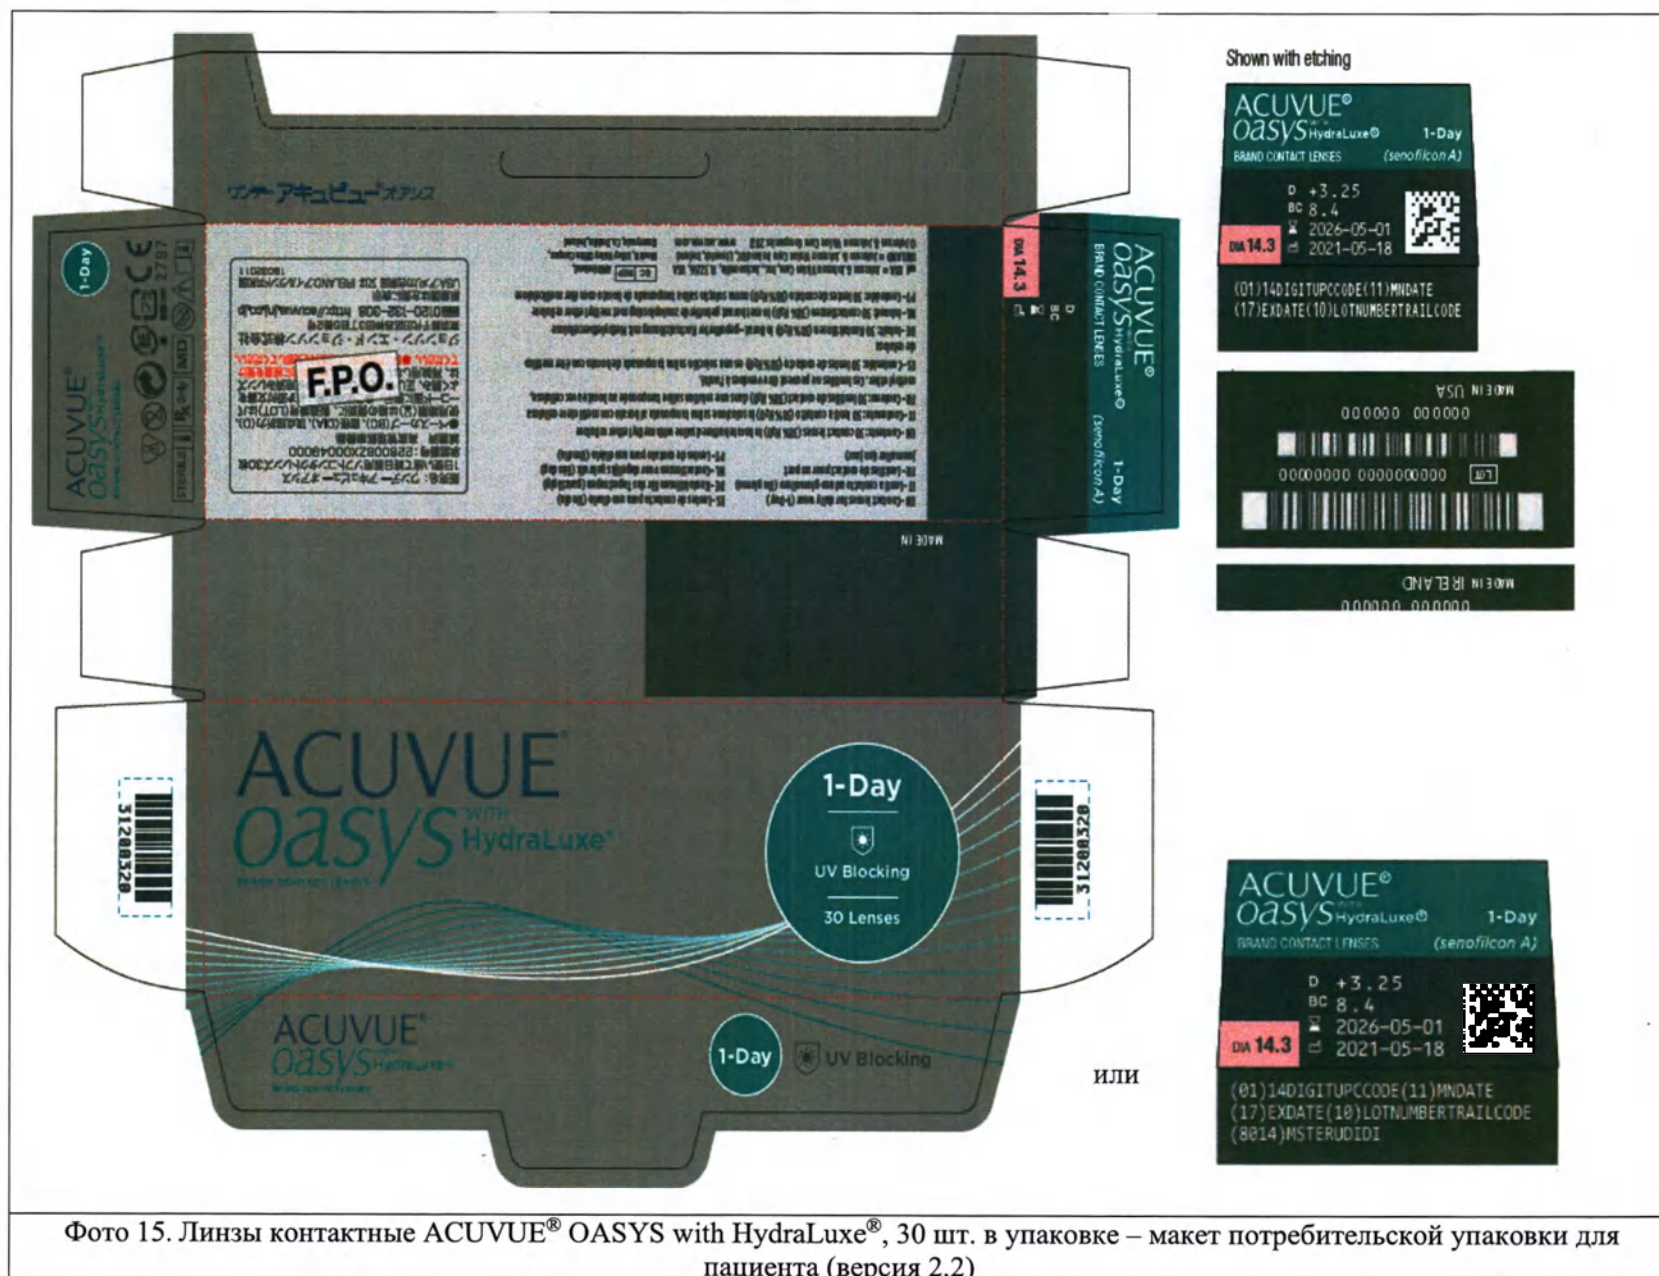


Фото 14. Линзы контактные ACUVUE® OASYS with HydraLuxe®, 30 шт. в упаковке – макет разворота потребительской упаковки для пациента (версия 2.1)




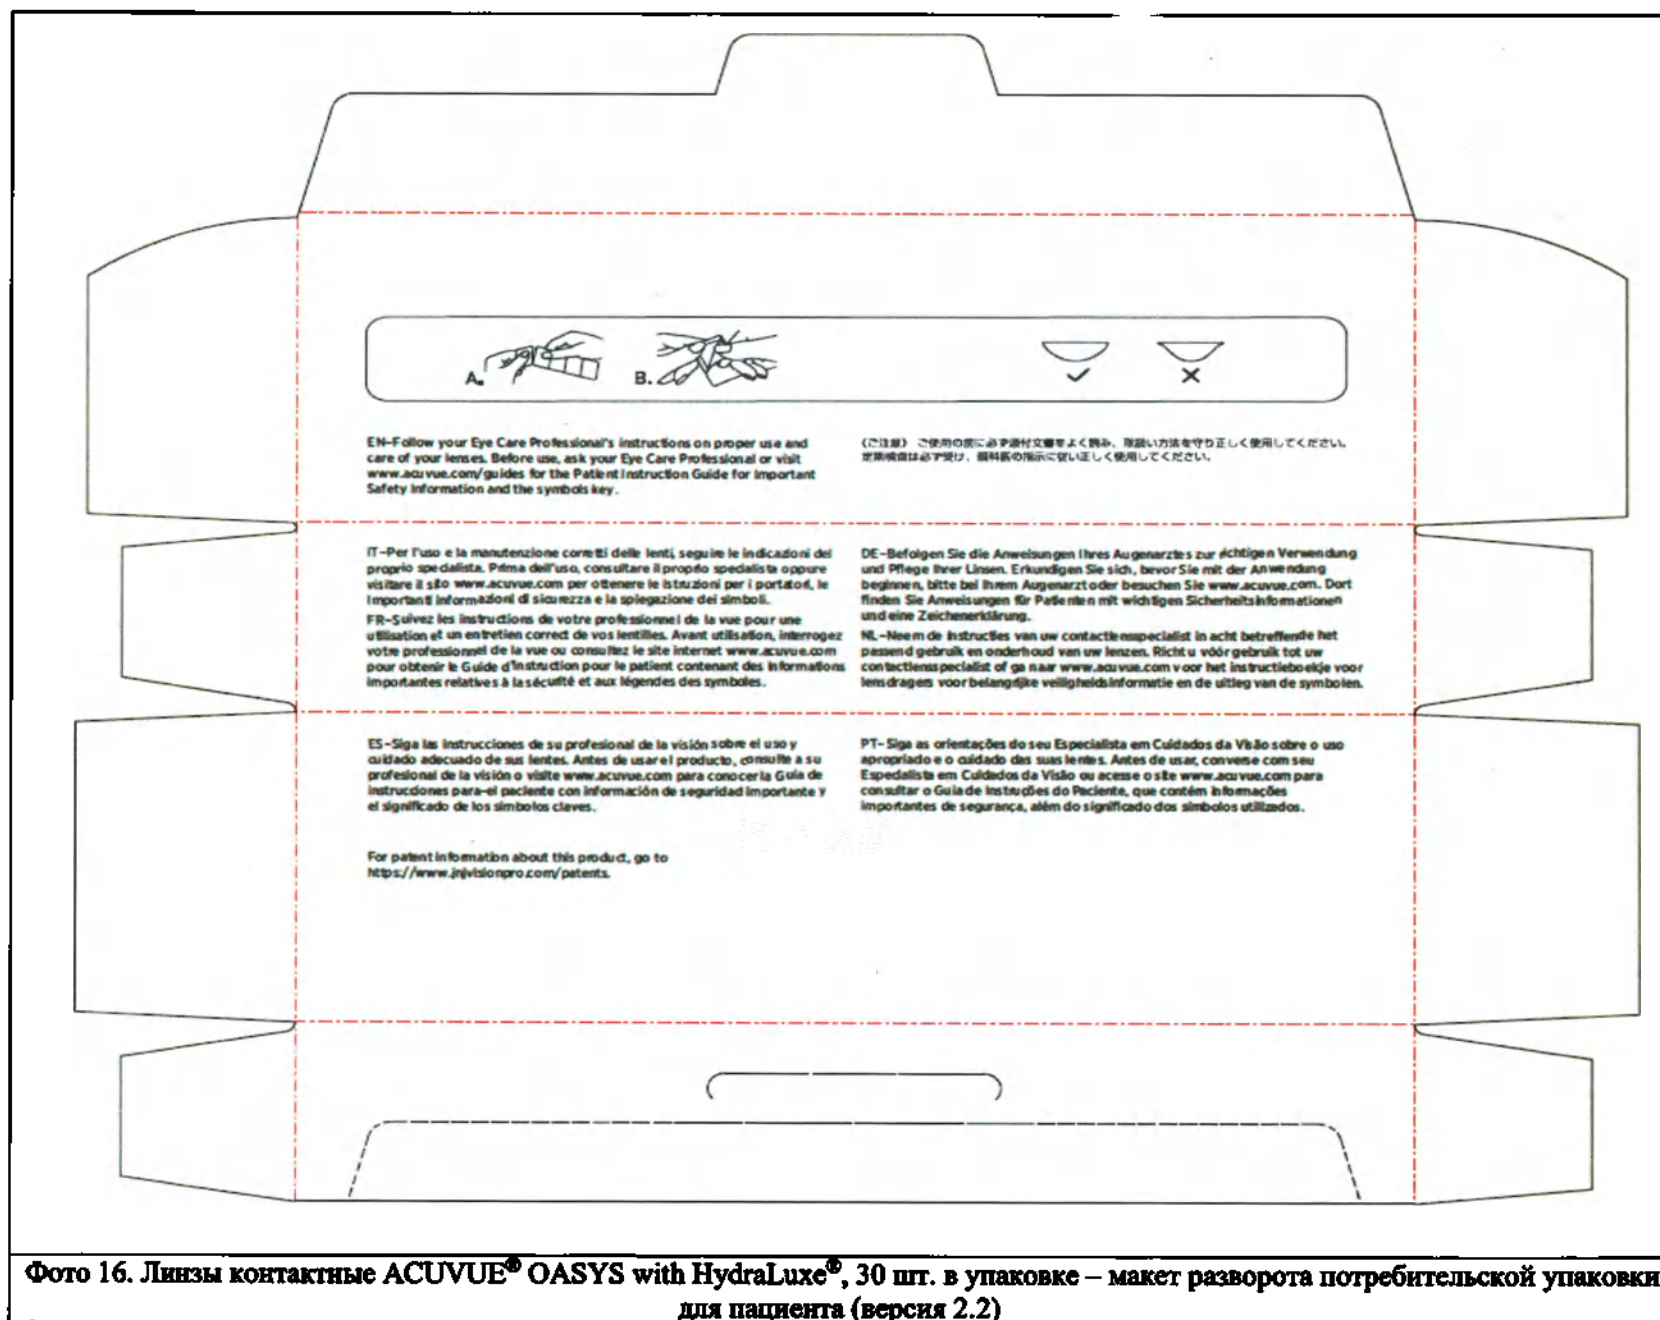


Фото 16. Линзы контактные ACUVUE® OASYS with HydraLuxe®, 30 шт. в упаковке – макет разворота потребительской упаковки для пациента (версия 2.2)

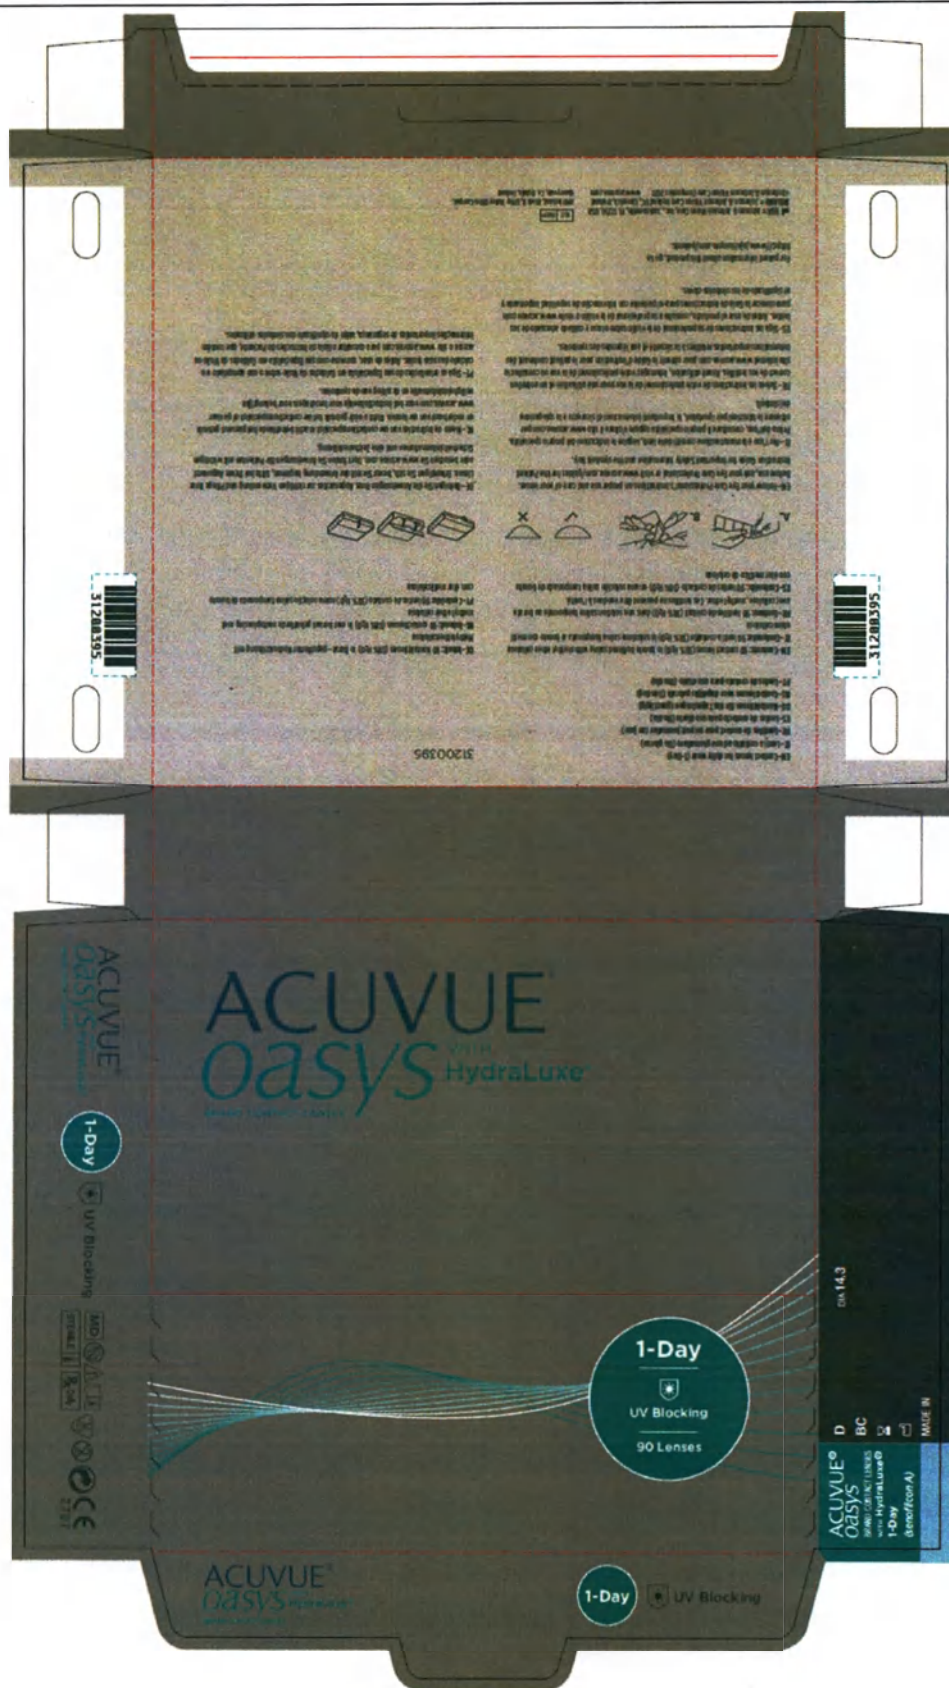


ИЛИ

Shown with etching



Фото 17. Линзы контактные ACUVUE® OASYS with HydraLuxe®, 90 шт. в упаковке – макет потребительской упаковки для пациента (версия 2.1)

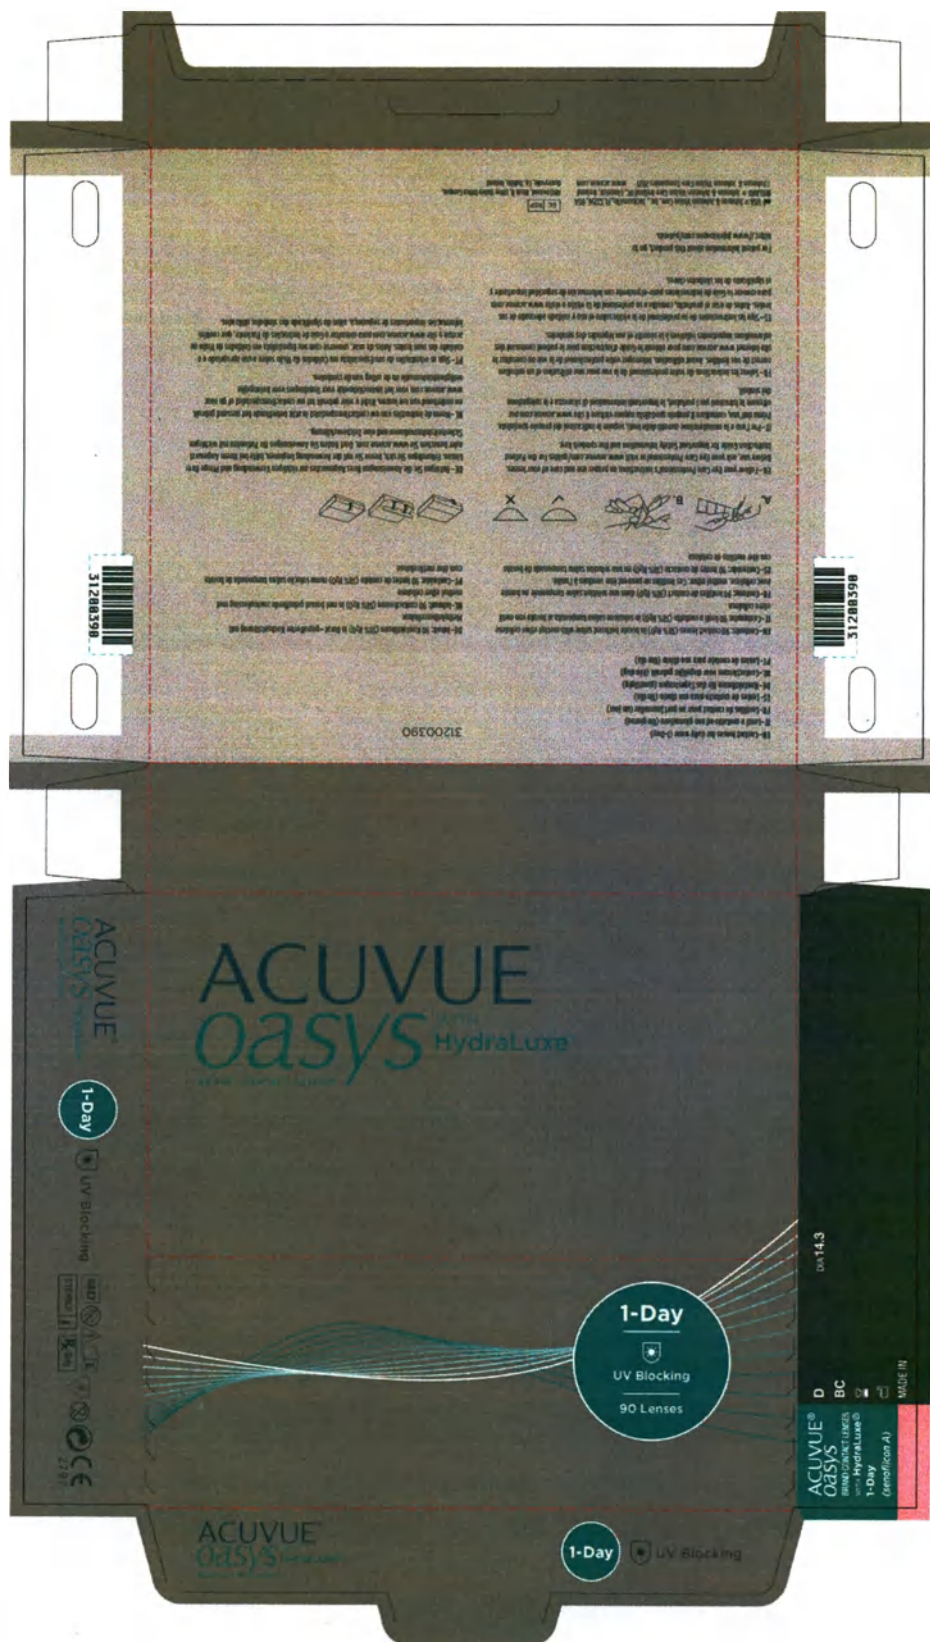


ИЛИ

Shown with etching



Фото 18. Линзы контактные ACUVUE® OASYS with HydraLuxe®, 90 шт. в упаковке – макет потребительской упаковки для пациента (версия 2.2)

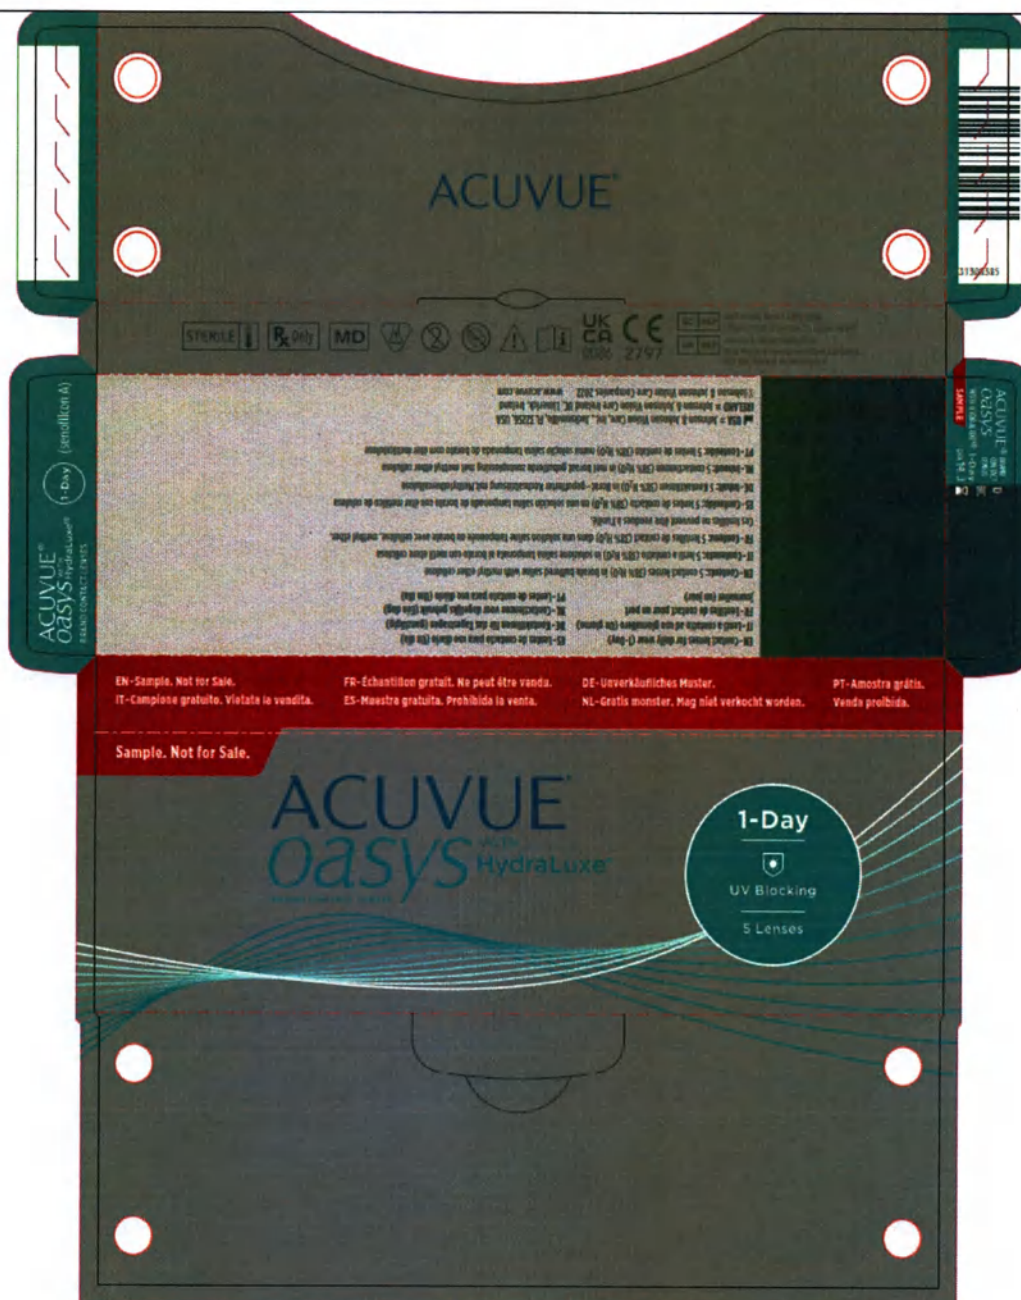

Shown with etching



ИЛИ

Фото 19. Линзы контактные ACUVUE® OASYS with HydraLuxe®, 5 шт. в упаковке – макет потребительской упаковки для врача (версия 3)

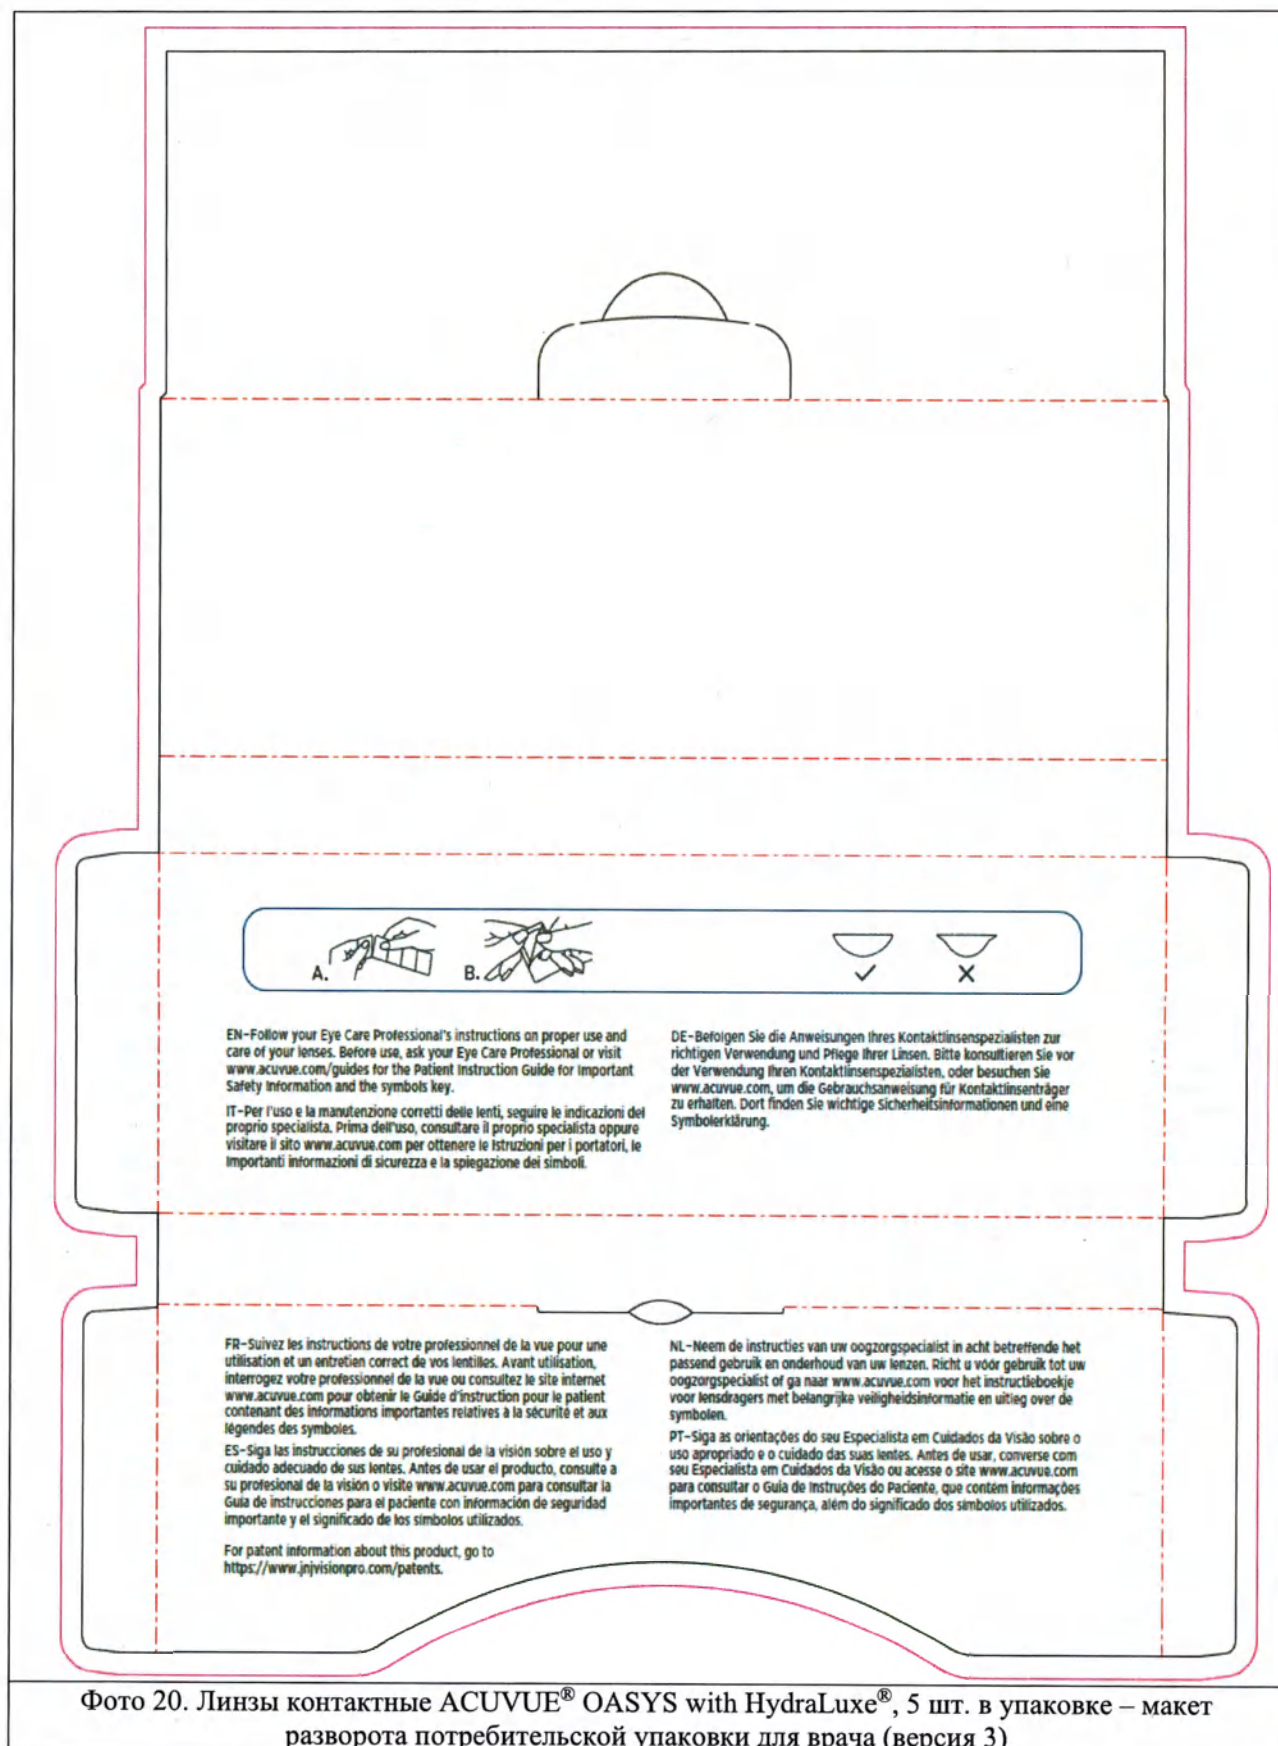
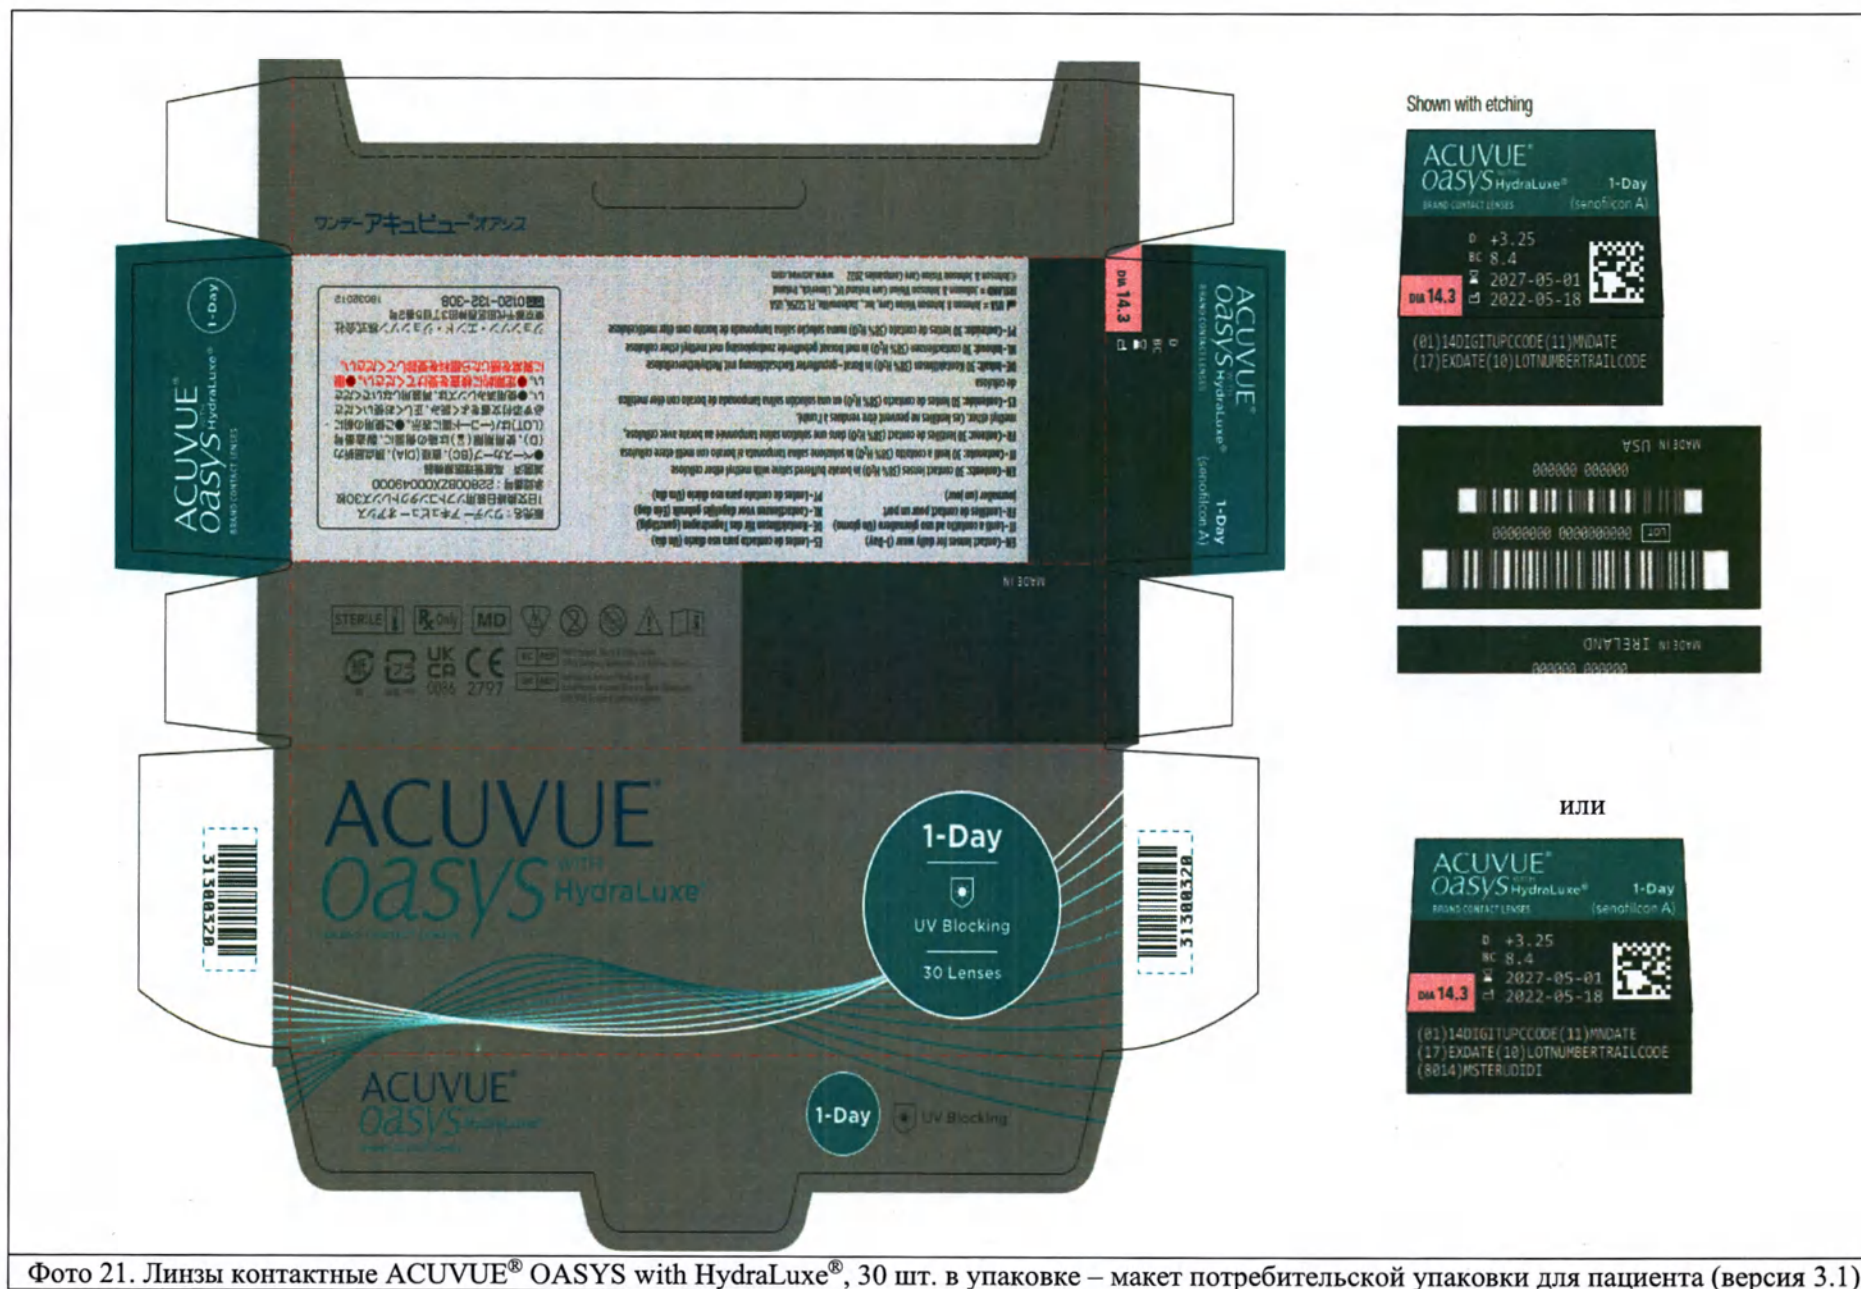


Фото 20. Линзы контактные ACUVUE® OASYS with HydraLuxe®, 5 шт. в упаковке – макет разворота потребительской упаковки для врача (версия 3)



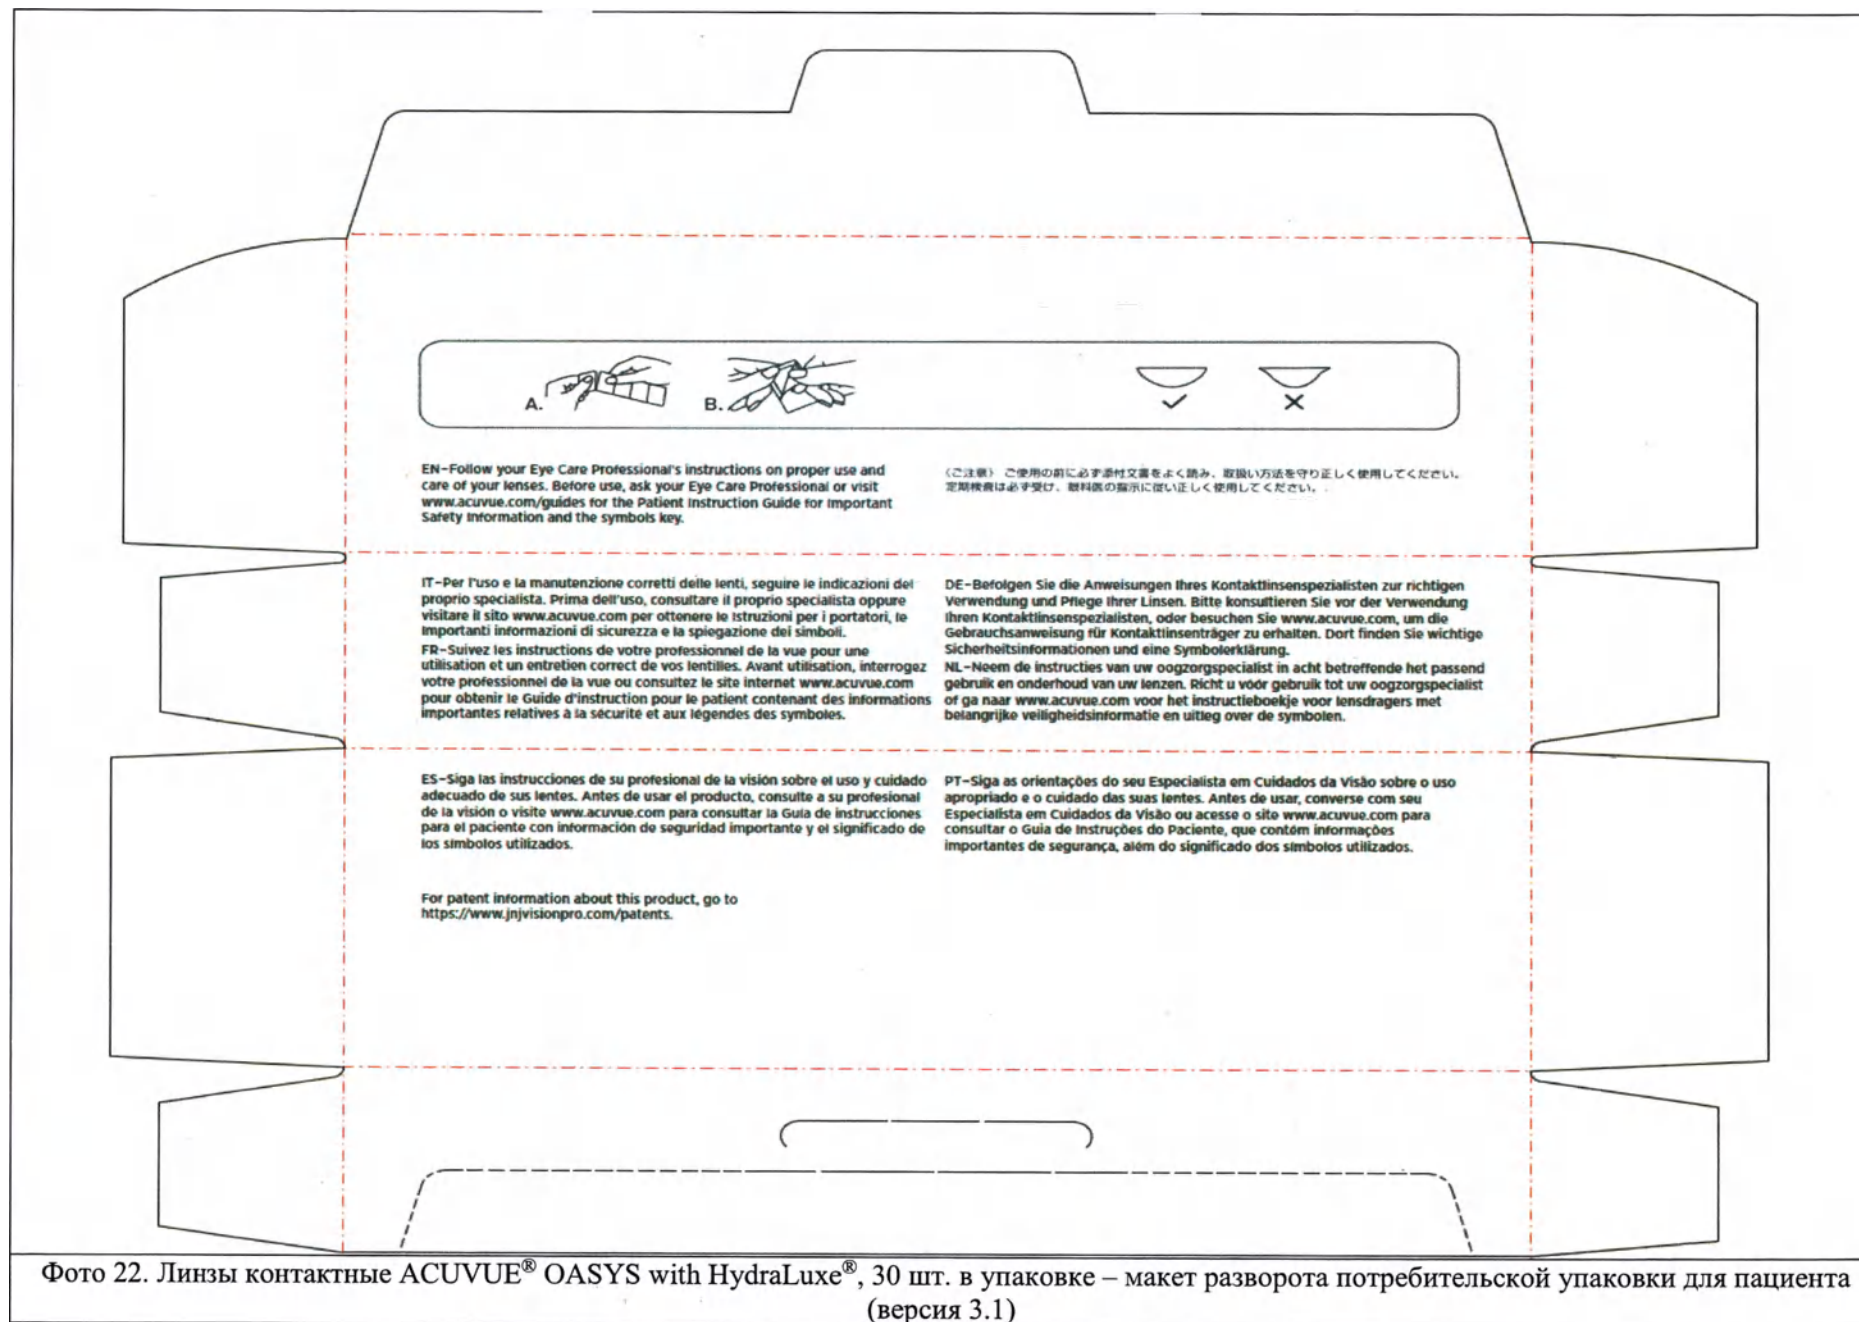
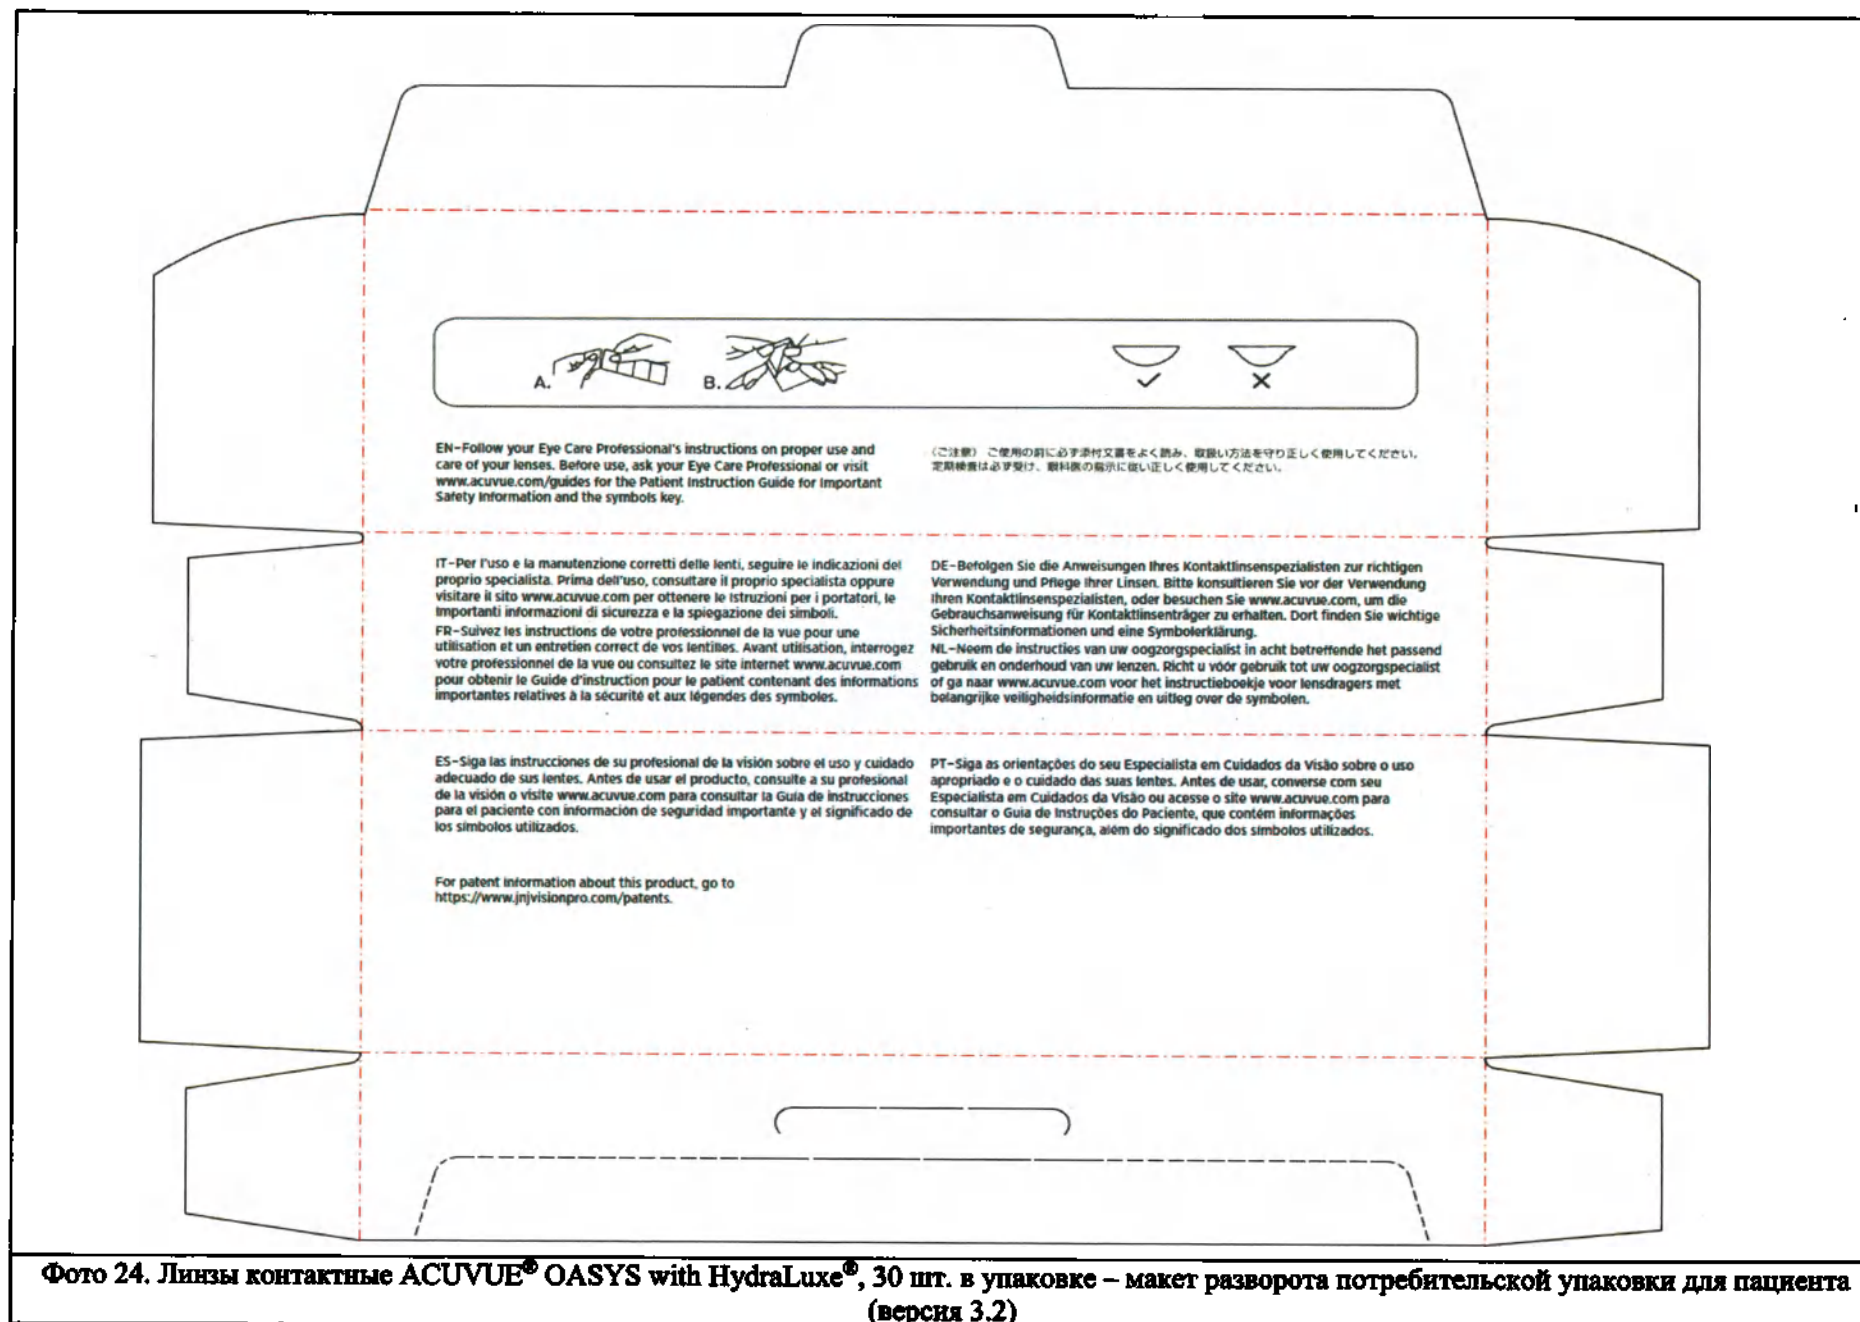


Фото 22. Линзы контактные ACUVUE® OASYS with HydraLuxe®, 30 шт. в упаковке – макет разворота потребительской упаковки для пациента (версия 3.1)



Фото 23. Линзы контактные ACUVUE® OASYS with HydraLuxe®, 30 шт. в упаковке – макет потребительской упаковки для пациента (версия 3.2)





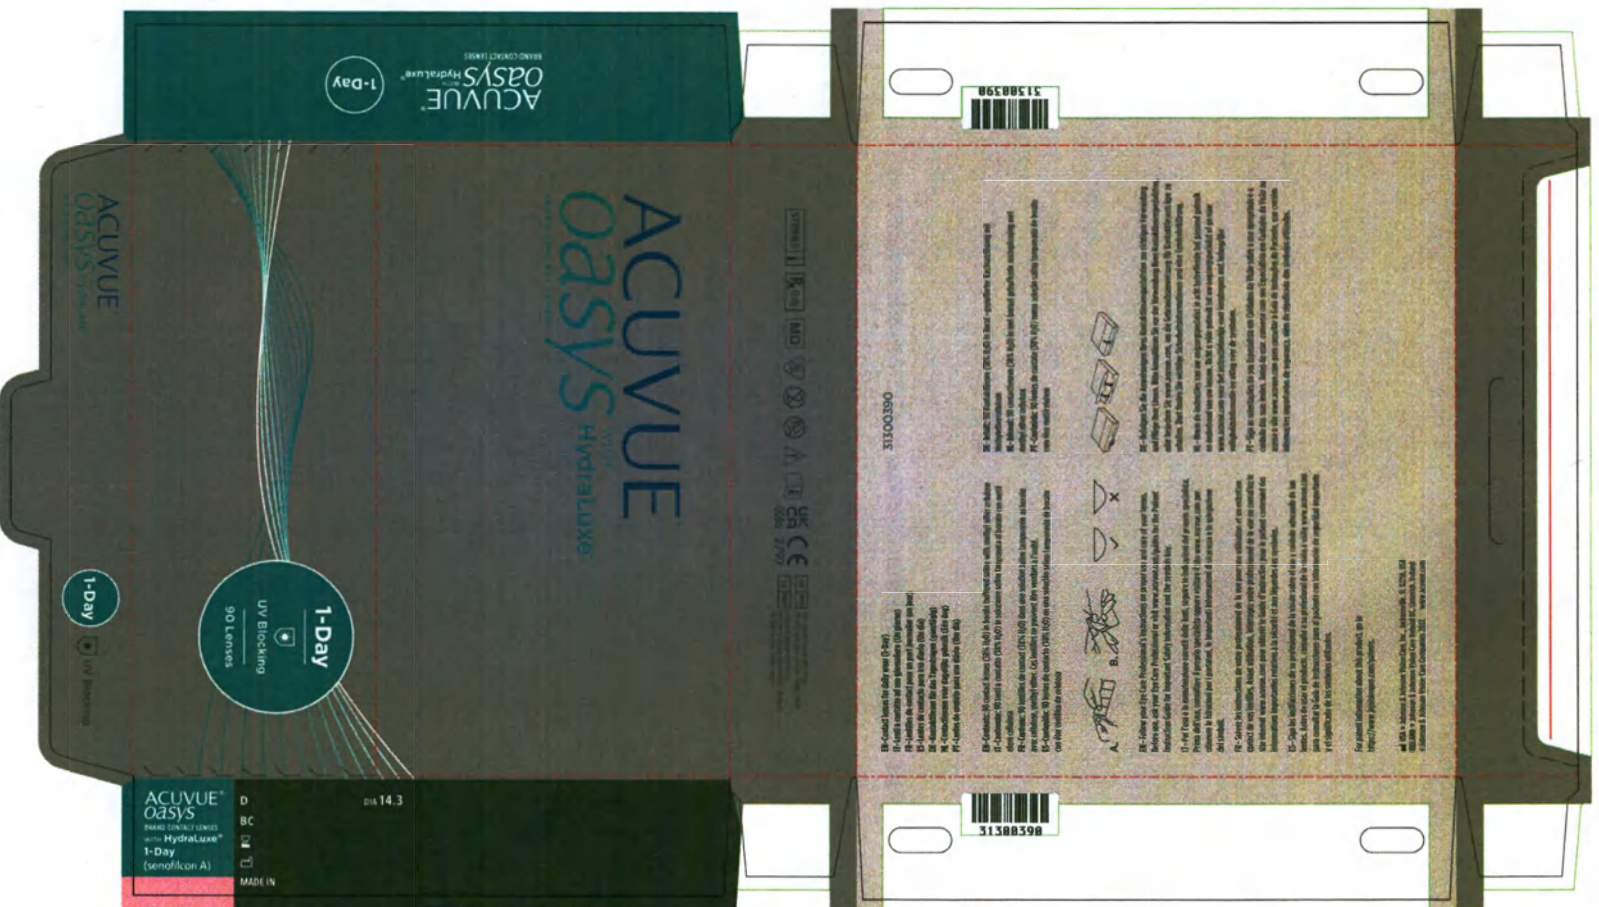


Фото 25. Линзы контактные ACUVUE® OASYS with HydraLuxe®, 90 шт. в упаковке – Макет потребительской упаковки (версия 3.1)

Shown with etching

ИДН

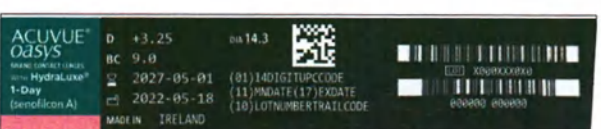

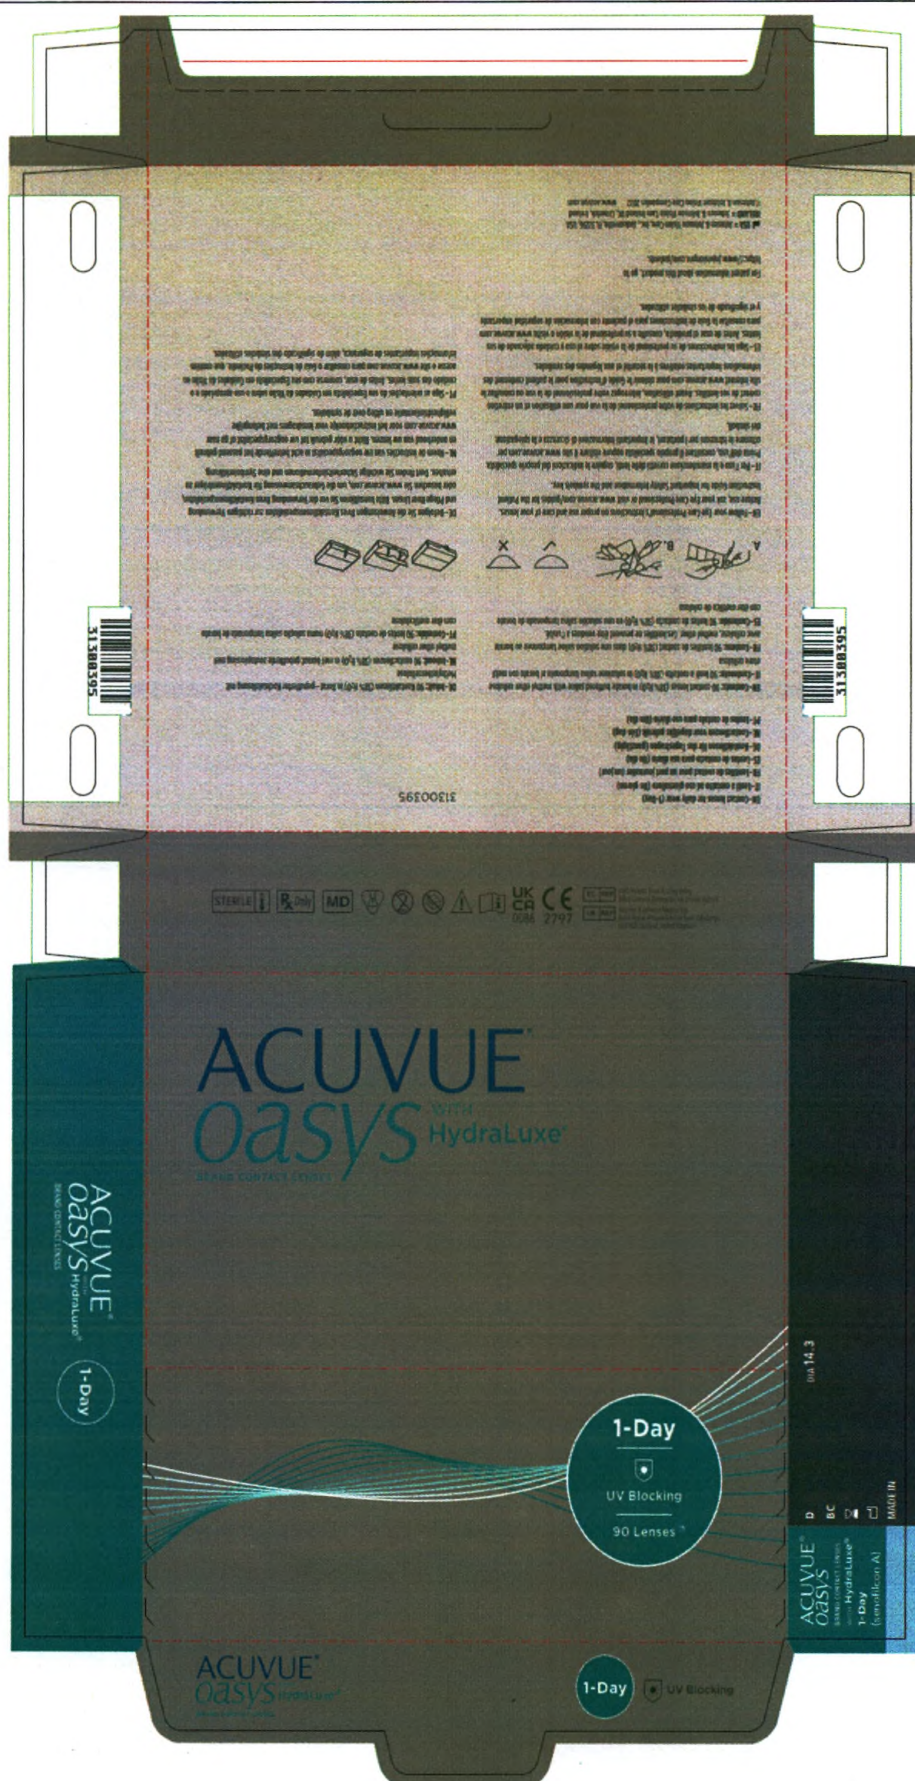

Shown with etching



ИЛИ



Фото 26. Линзы контактные ACUVUE® OASYS with HydraLuxe®, 90 шт. в упаковке – макет потребительской упаковки (версия 3.2)

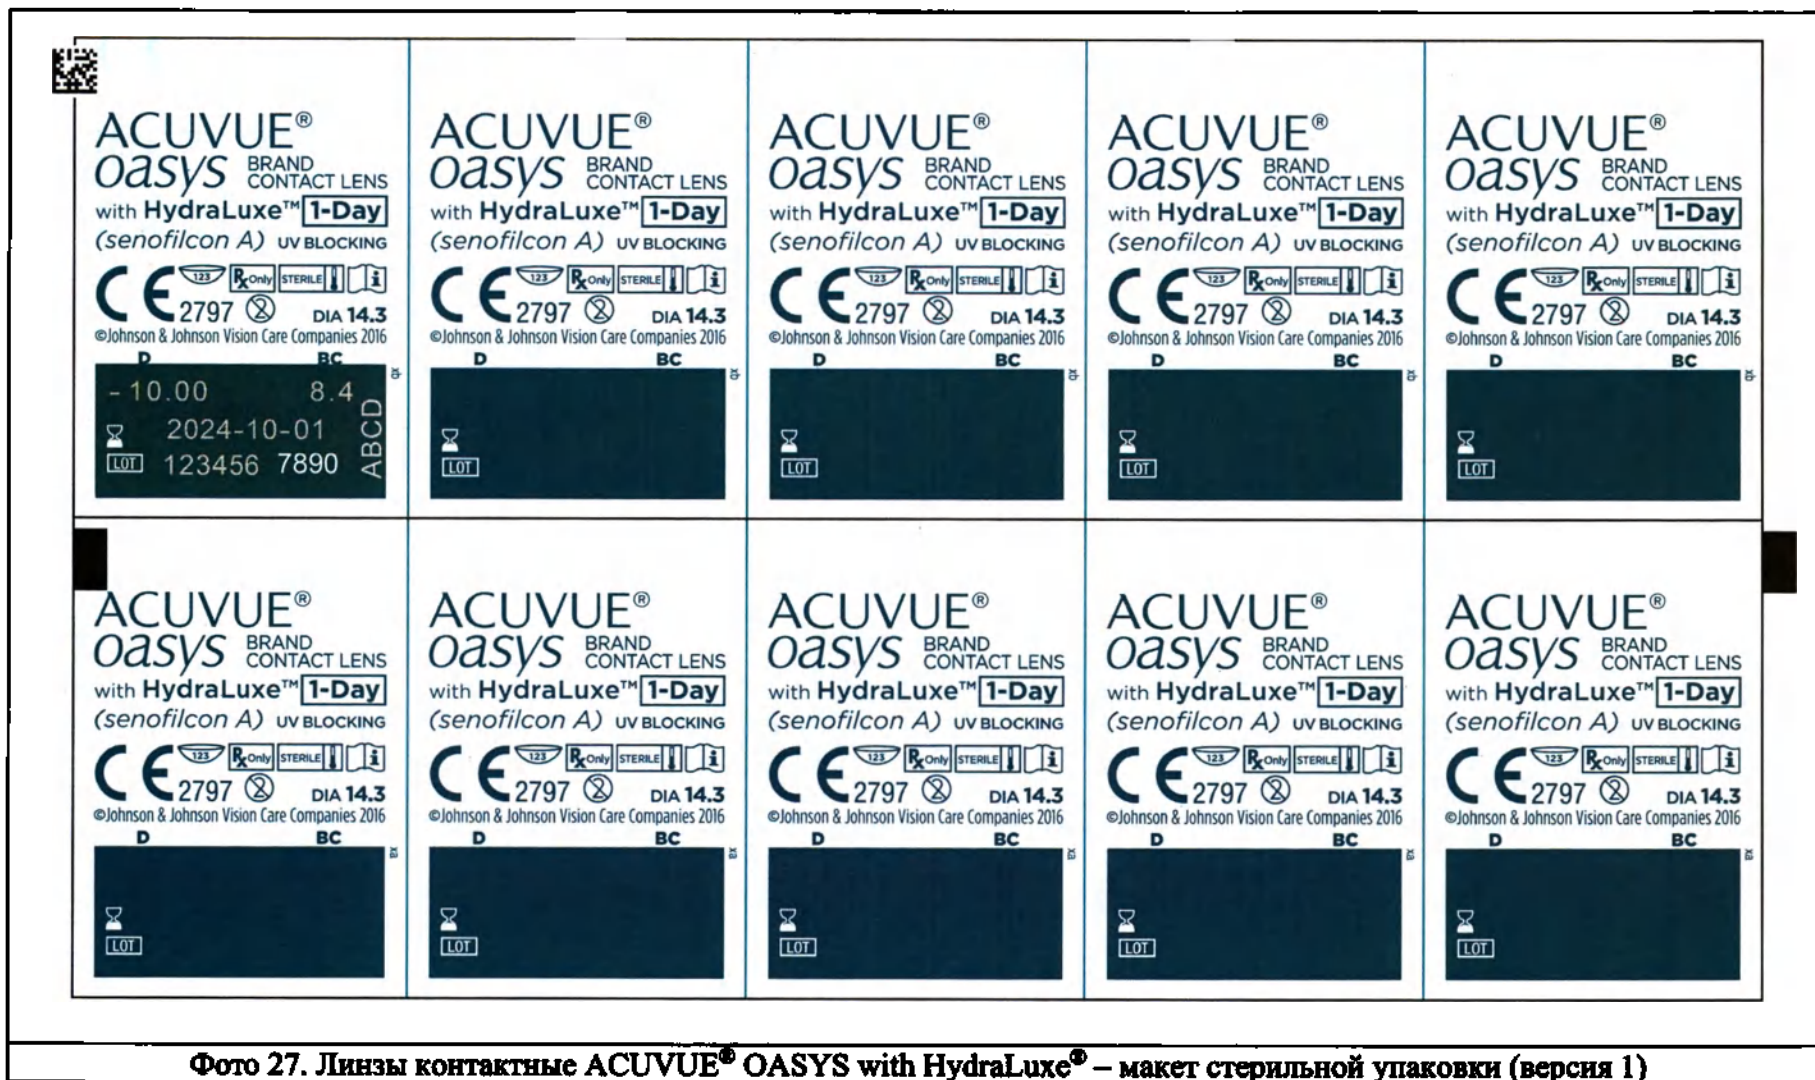




Фото 28. Линзы контактные ACUVUE® OASYS with HydraLuxe® – макет стерильной упаковки (версия 2)



Фото 29. Линзы контактные ACUVUE® OASYS with HydraLuxe® – макет стерильной упаковки (версия 3)

ЛИНЗЫ КОНТАКТНЫЕ ACUVUE® OASYS with HydraLuxe®

Рекомендованный срок ношения:

Дневное ношение – ежедневная замена.

Упаковка: 30 или 90 контактных линз в блистерах в боратном буферном физиологическом растворе с метилцеллюлозой. Количество блистеров см. на упаковке.

Материал: сенофилкон А, влагосодержание - 38 %. **Нетоксично.**

Не для продажи отдельными блистерами.

Регистрационное удостоверение: №РЗН 2016/4406 от xx.xx.xxxx г.

Важно: внимательно прочитайте инструкцию, находящуюся под этим стикером, и сохраните её для дальнейшего использования.

Производитель: «Джонсон & Джонсон Вижн Кэр, Инк.», США, Johnson & Johnson Vision Care, Inc, 7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida 32256, USA. **Место производства:** Johnson & Johnson Vision Care, Inc., 7500 Centurion Parkway, Jacksonville,

Florida 32256, USA. Johnson & Johnson Vision Care Ireland UC, ранее Johnson & Johnson Vision Care, (Ireland), The National Technology Park,

Limerick, V94 N732, Ireland. **Уполномоченный импортер:** ООО «Джонсон & Джонсон», 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2. **Горячая линия:** X XXX XXX XX XX (звонок по России бесплатный).

ГОСТ 31586-2012 XX_XX_XXX_XX(X)

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА

QR

Фото 30. Линзы контактные ACUVUE® OASYS with HydraLuxe® – макет русскоязычного стикера упаковки для пациента

ЛИНЗЫ КОНТАКТНЫЕ ACUVUE® OASYS with HydraLuxe®

Рекомендованный срок ношения:

Дневное ношение – ежедневная замена.

Упаковка: 5 контактных линз в блистерах в боратном буферном физиологическом растворе с метилцеллюлозой.

Материал: сенофилкон А, влагосодержание - 38 %. **Нетоксично.**

Регистрационное удостоверение: №РЗН 2016/4406 от xx.xx.xxxx г.

Важно: внимательно прочитайте инструкцию, находящуюся под этим стикером, и сохраните её для дальнейшего использования.

Производитель: «Джонсон & Джонсон Вижн Кэр, Инк.», США, Johnson & Johnson Vision Care, Inc, 7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida 32256, USA. **Место производства:** Johnson & Johnson Vision Care, Inc., 7500 Centurion Parkway, Jacksonville, Florida 32256, USA.

Johnson & Johnson Vision Care Ireland UC, ранее Johnson & Johnson Vision Care, (Ireland), The National Technology Park, Limerick, V94 N732, Ireland. **Уполномоченный импортер:**

ООО «Джонсон & Джонсон», 121614, г. Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2. **Горячая линия:**

X XXX XXX XX XX (звонок по России бесплатный).
ГОСТ 31586-2012 XX_XX_XXX_XX(X)

QR

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА


НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

Фото 31. Линзы контактные ACUVUE® OASYS with HydraLuxe® – макет русскоязычного стикера упаковки для врача

Информация рекламного характера.

Информация рекламного характера может быть размещена на вторичной упаковке (картонной упаковке), при этом не изменяя информацию для потребителя.

Пример:

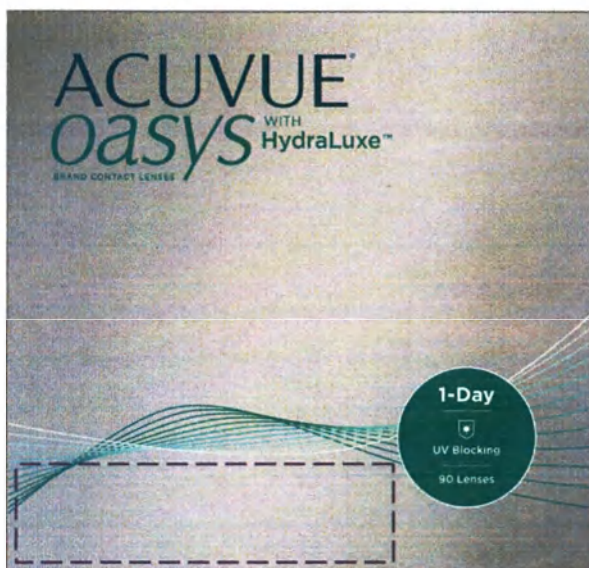


Применимо ко всем вариантам вторичной упаковки.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 33 листа (-ов).

Должность: Супервайзер по евразийской процедуре
регистрации

Ф.И.О.: Рыбакова Анастасия Николаевна

Подпись:  М.П.

«10» июля 2024 года

