

Руководитель направления по регистрации
продукции для in vitro диагностики,
иммунохимия, гематология и гемостаз
ООО «Сименс Здравоохранение»



Е.А. Чигринец

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

**«Набор реагентов для количественного определения раково-эмбрионального антигена
(РЭА)/СЕА на анализаторах иммунохемилюминисцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000
СЕА)»**



производства «Сименс Хелскэа Диагностикс Продактс Лимитед» (Siemens Healthcare Diagnostics
Products Limited), Великобритания
Glyn Rhonwy, Llanberis, Gwynedd LL55 4EL, United Kingdom

SIEMENS

IMMULITE® 2000 Systems

CEA

CEA



LOT 357

2022-01-31

REF L2KCE2

SMN 10380994

BEAD PACK 1 x L2CE12327

REAG WEDGE 1 x L2CEA2328

ADJUSTOR L 1 x LCEL139

ADJUSTOR H 1 x LCEH139

IVD



15

siemens.com/eifu

FOR USA


ENGLISH: For the quantitative measurement of CEA
Contains: murine monoclonal antibody, bovine alkaline phosphatase
rabbit polyclonal antibody, human serum

0318MP11052



(01)00630414961118
(10) 357
(17)220131
(240)10380994
(422)826

GTIN
LOT/BATCH
EXPIRY
SMN
ORIGIN GB



Siemens Healthcare Diagnostics Products Ltd.
Glyn Rhonwy
Llanberis, Gwynedd, LL55 4EL UK

siemens-healthineers.com

EC REP

Siemens Healthcare Diagnostics
Manufacturing Ltd
Chapel Lane
Swords, Co. Dublin, Ireland

Рисунок 1 Набор реагентов для количественного определения раково-эмбрионального антигена (РЭА)/CEA на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 CEA), маркировка вторичной упаковки

CEA

IMMULITE® 2000 Systems

REF L2KCE2

LOT 357

 2022-01-31

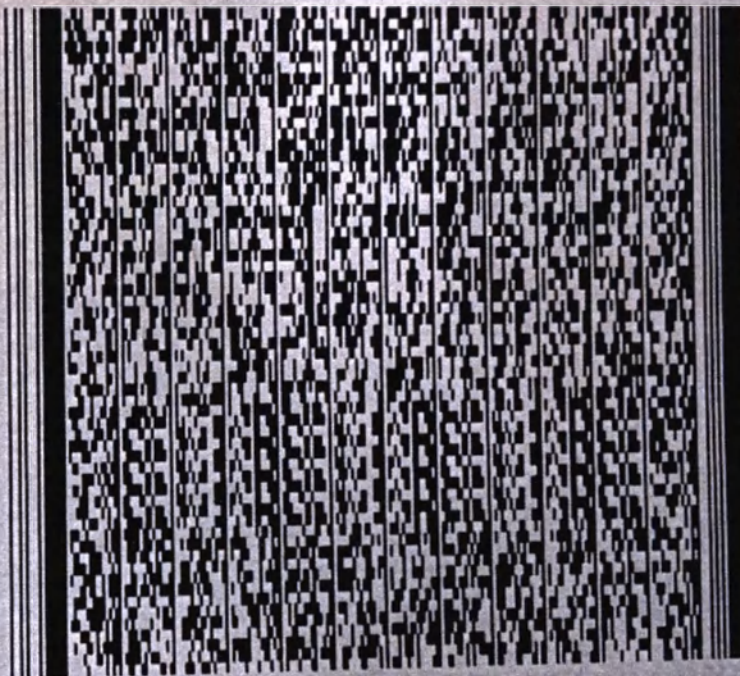


Рисунок 2. Набор реагентов для количественного определения раково-эмбрионального антигена (РЭА)/CEA на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 CEA), штрих-код

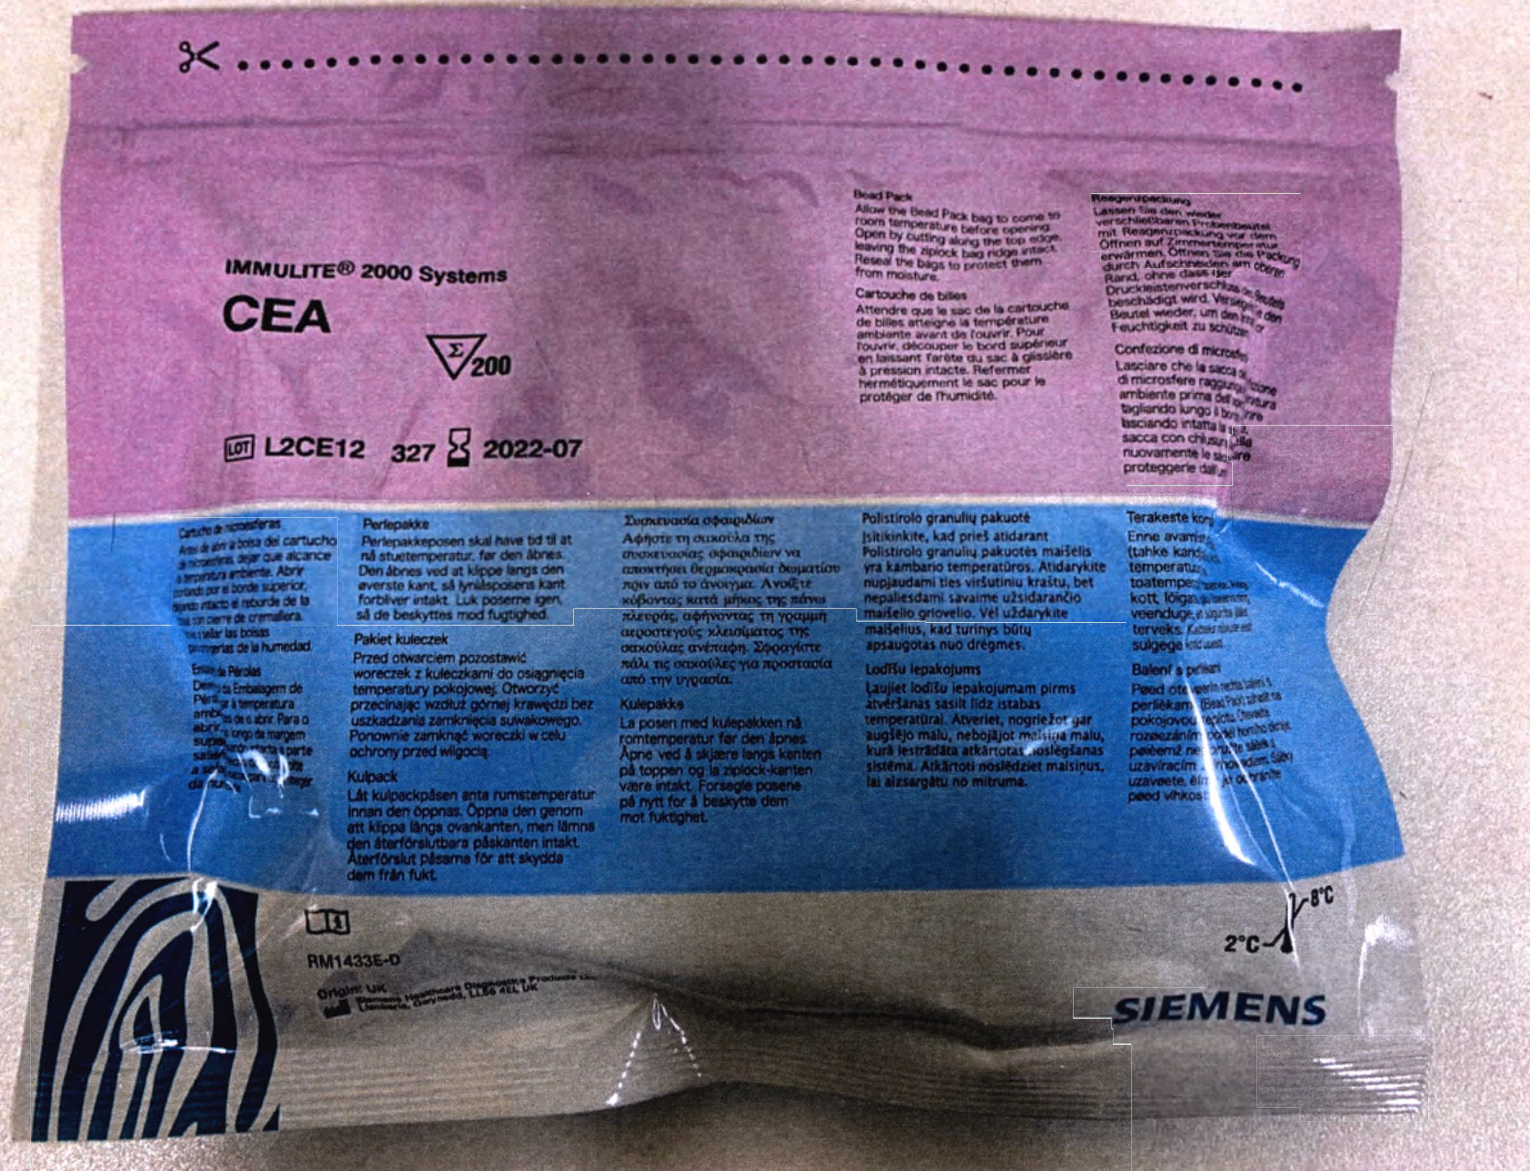


Рисунок 3. Набор реагентов для количественного определения раково-эмбрионального антигена (РЭА)/CEA на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 CEA), пакет с реагентом

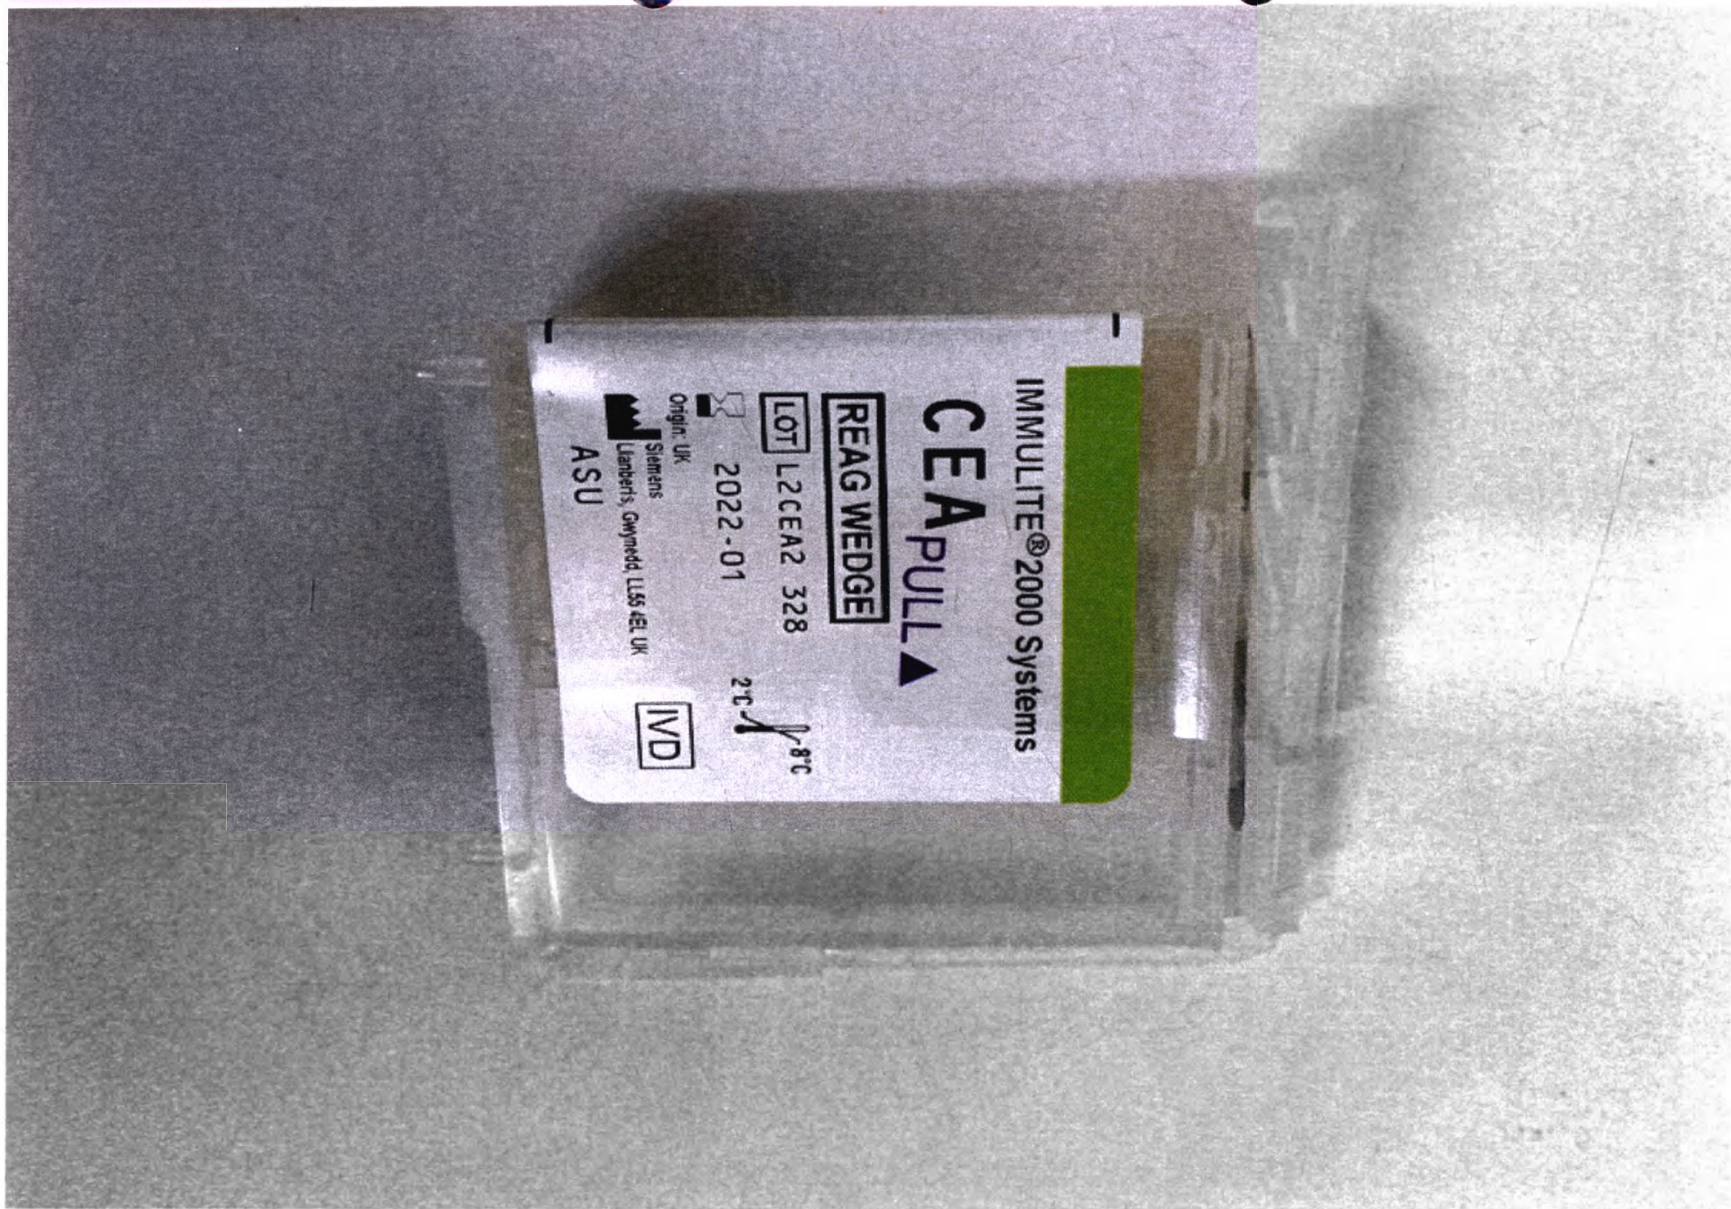


Рисунок 4 Набор реагентов для количественного определения раково-эмбрионального антигена (РЭА)/СЕА на анализаторах иммунохемилюминисцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 CEA), клин с реагентом (1)

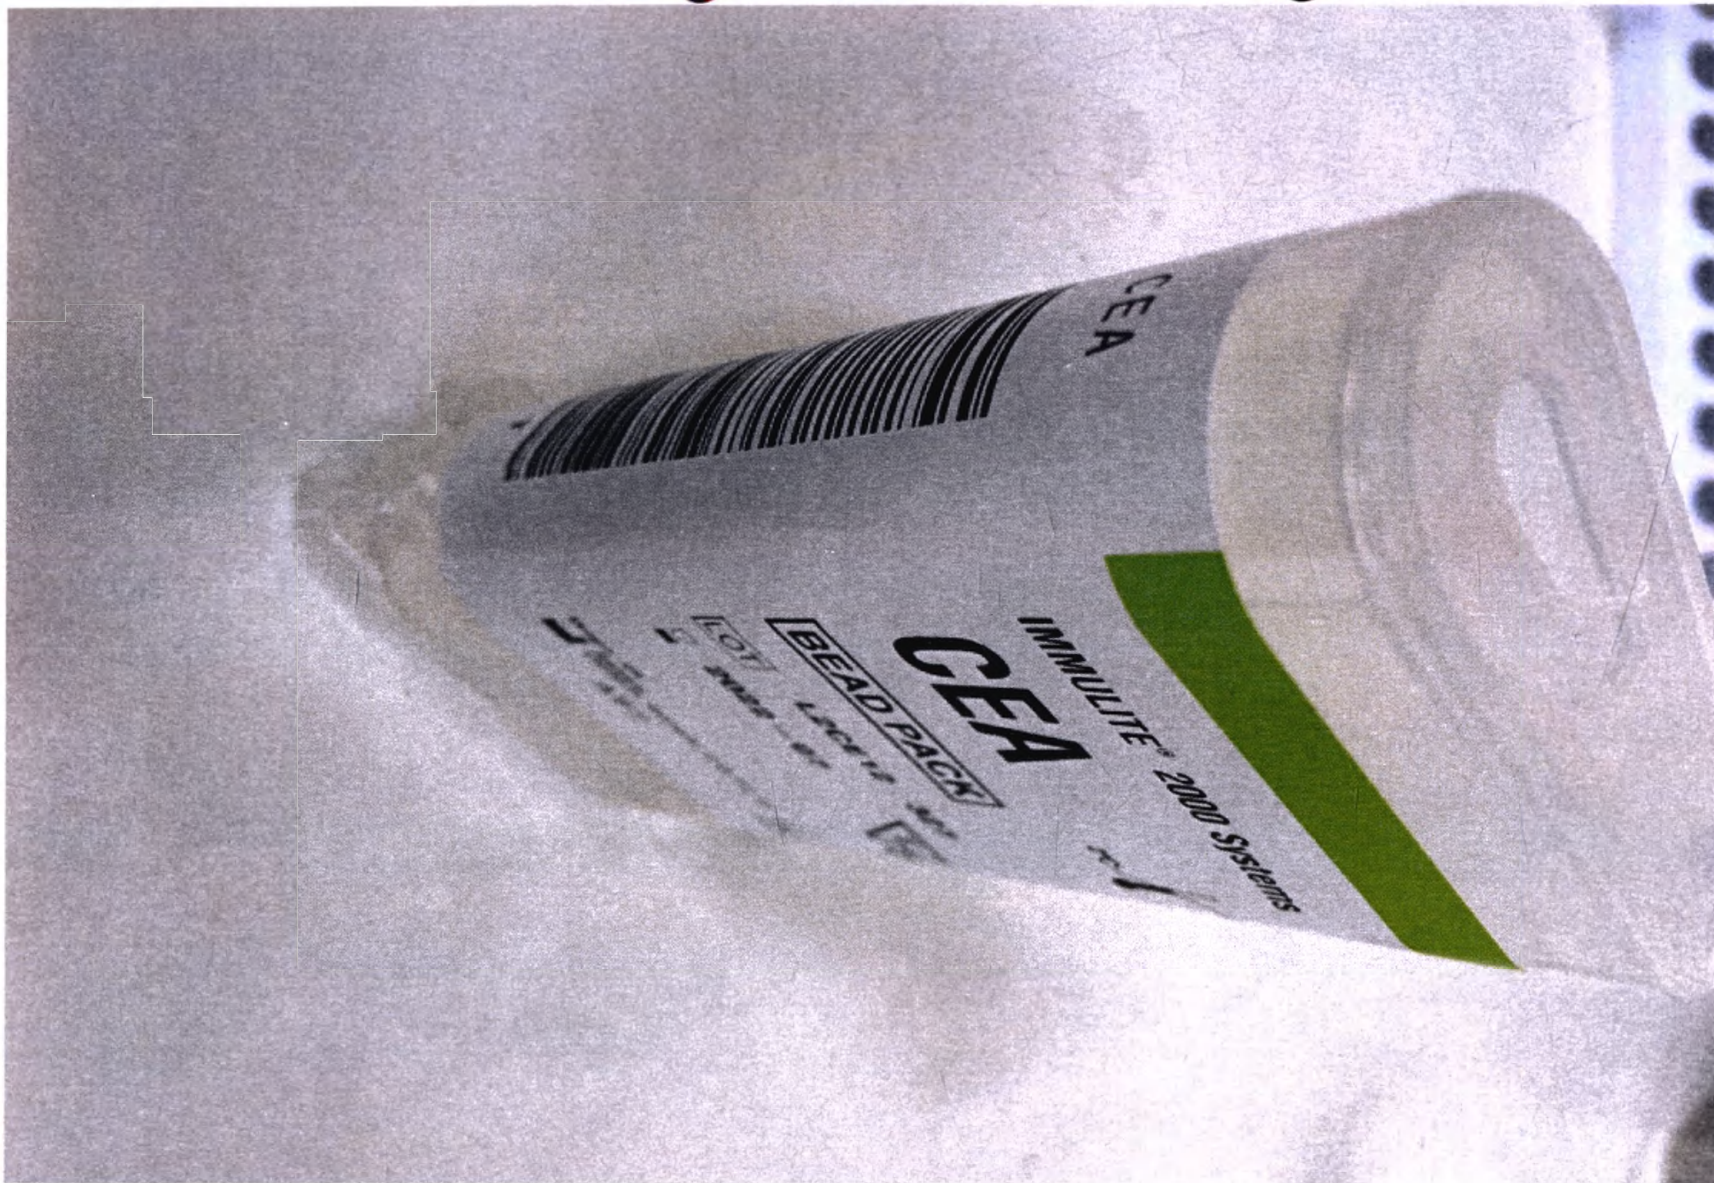


Рисунок 5. Набор реагентов для количественного определения раково-эмбрионального антигена (РЭА)/CEA на анализаторах иммунохемилуминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 CEA), клин с реагентом (2)



Рисунок 6. Набор реагентов для количественного определения раково-эмбрионального антигена (РЭА)/CEA на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 CEA Калибратор с низкой концентрацией CEA Adjustors (LCEL), (1)

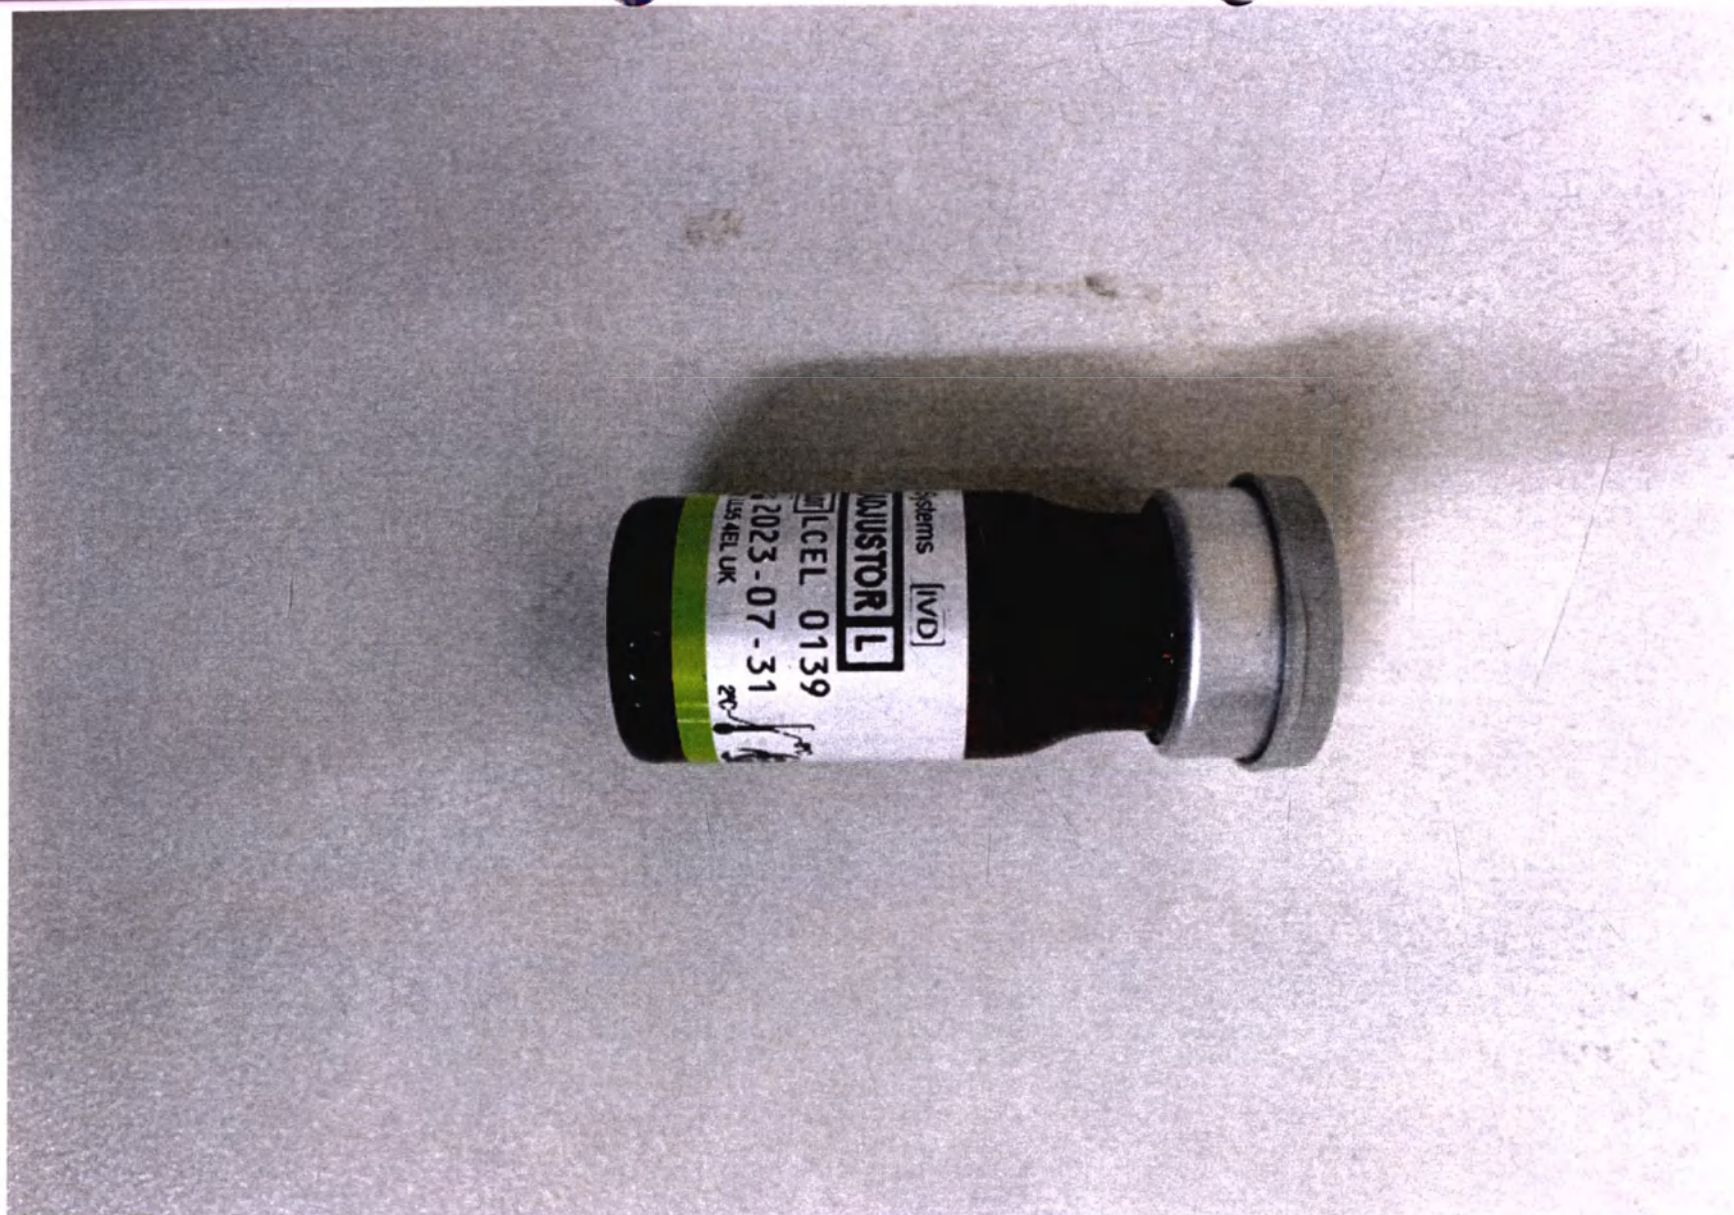


Рисунок 7. Набор реагентов для количественного определения раково-эмбрионального антигена (РЭА)/CEA на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 CEA Калибратор с низкой концентрацией CEA Adjustors (LCEL), (2)

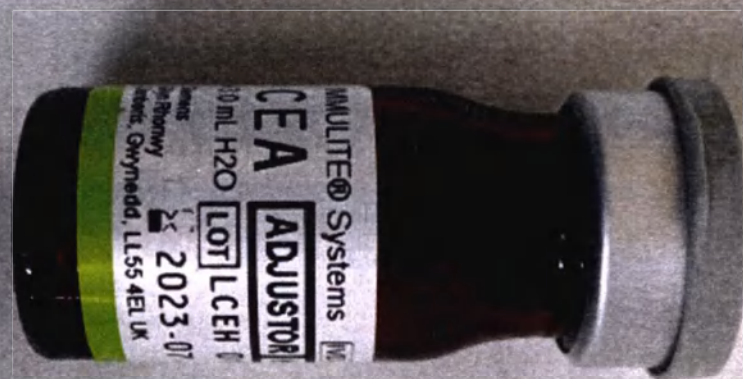


Рисунок 8. Набор реагентов для количественного определения раково-эмбрионального антигена (РЭА)/СЕА на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000. Калибратор с высокой концентрацией CEA Adjustors (LCEH), (1)

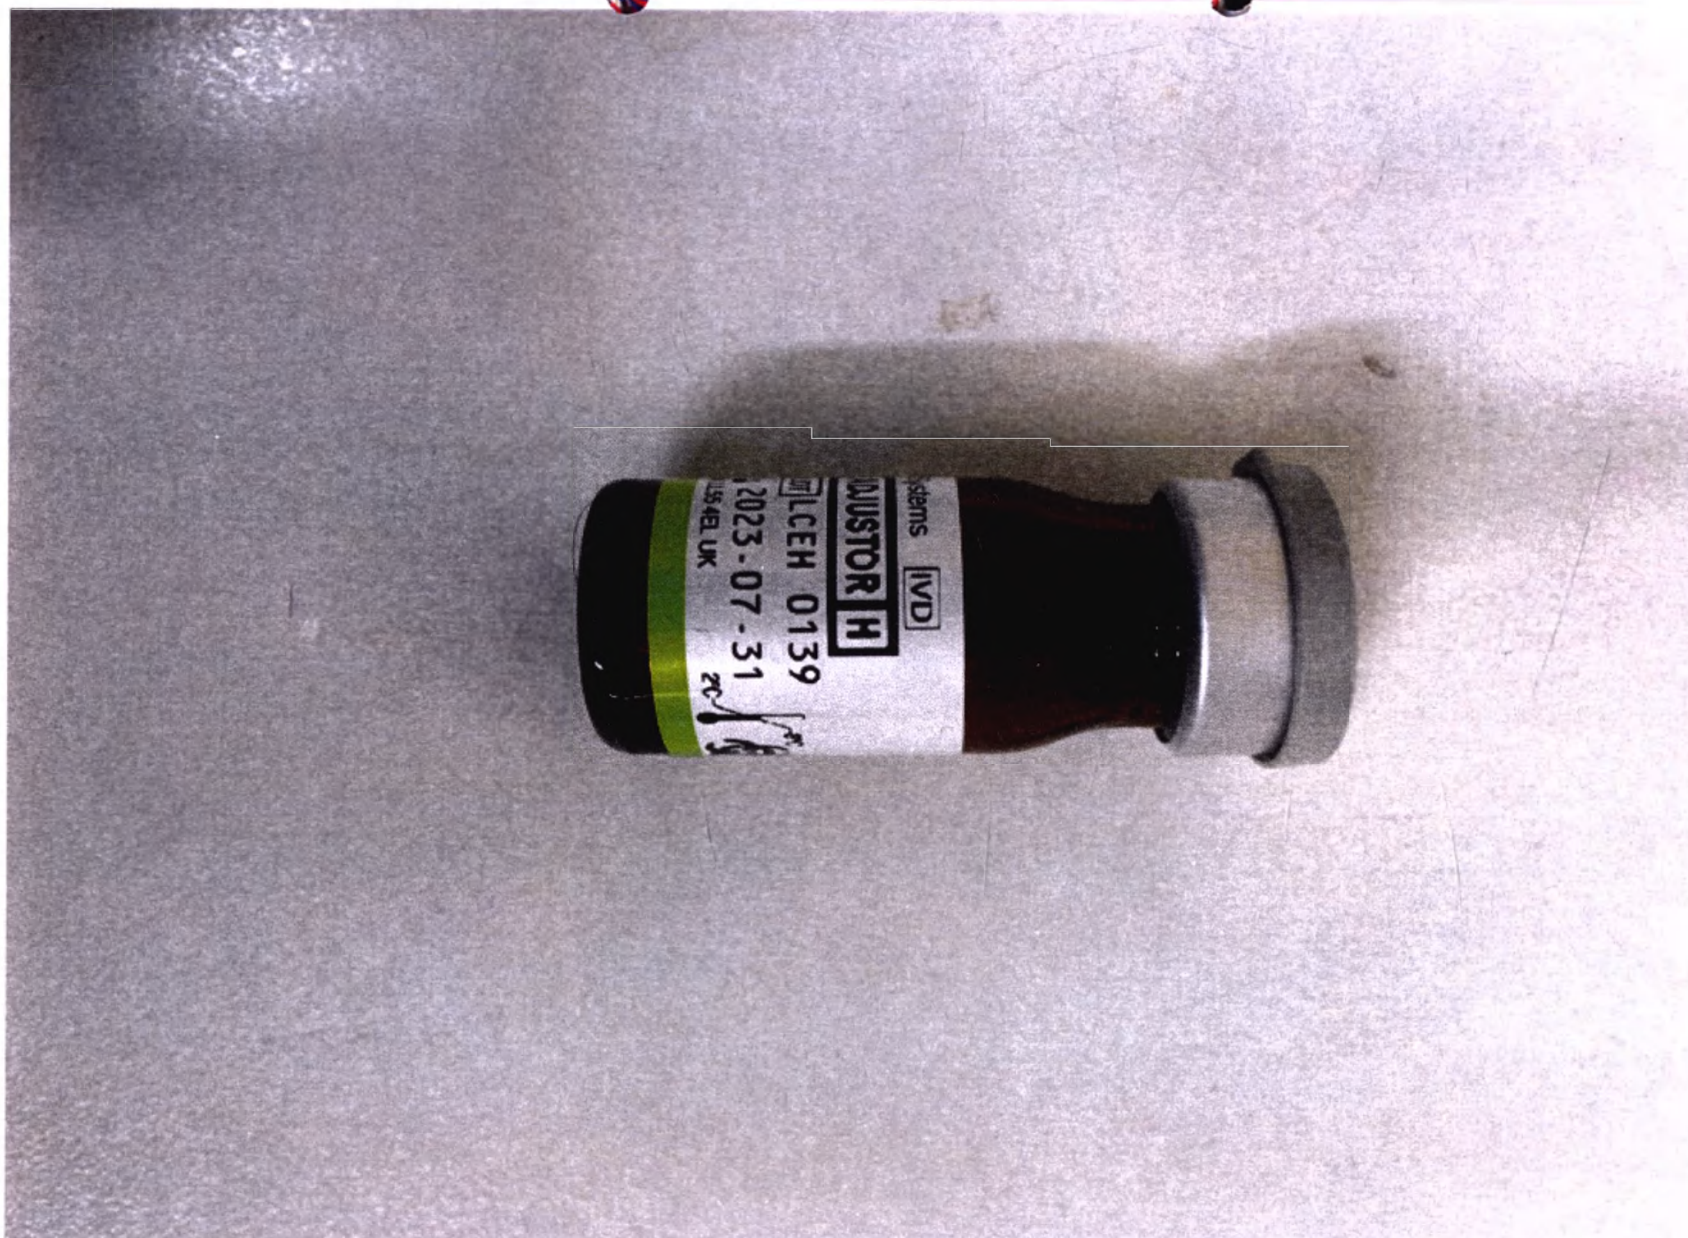


Рисунок 9. Набор реагентов для количественного определения раково-эмбрионального антигена (РЭА)/СЕА на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000. Калибратор с высокой концентрацией CEA Adjustors (LCEH), (2)



Рисунок 10 Набор реагентов для количественного определения раково-эмбрионального антигена (РЭА)/CEA на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000, стикеры

10380995

Набор реагентов для количественного определения раково-эмбрионального антигена (РЭА)/СЕА на анализаторах иммунохемилюминисцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 CEA)

Информация о производителе и стране производства:
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:

№ _____ от _____

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Рисунок 11. Пример макета русскоязычной маркировки Набор реагентов для количественного определения раково-эмбрионального антигена (РЭА)/СЕА на анализаторах иммунохемилюминисцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 CEA) (1)

10380994

Набор реагентов для количественного определения раково-эмбрионального антигена (РЭА)/СЕА на анализаторах иммунохемилюминисцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 СЕА)

Информация о производителе и стране производства: **Регистрационное удостоверение:**
см. на упаковке № _____ от _____

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Рисунок 12. Пример макета русскоязычной маркировки Набор реагентов для количественного определения раково-эмбрионального антигена (РЭА)/СЕА на анализаторах иммунохемилюминисцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 СЕА) (2)



Всего прошито и пронумеровано
листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»