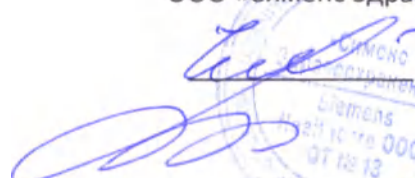


Руководитель направления по регистрации
продукции для in vitro диагностики,
иммунохимия, гематология и гемостаз
ООО «Сименс Здравоохранение»


Е.А. Чигринец


**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
для ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

**«Набор реагентов для количественного определения гастрина/Gastrin на анализаторах
иммунохемилюминисцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 Gastrin)»**


производства «Сименс Хелскэа Диагностикс Продактс Лимитед» (Siemens Healthcare Diagnostics
Products Limited), Великобритания
Glyn Rhonwy, Llanberis, Gwynedd LL55 4EL, United Kingdom

2022

SIEMENS

IMMULITE® 2000 Systems

GAS Gastrin



LOT 312

EXP 2022-03-31

REF L2KGA2

SMN 10380979

BEAD PACK 1 x L2GA12273

REAG WEDGE 1 x L2GAA2269

ADJUSTOR L 2 x LGAL140

ADJUSTOR H 2 x LGAH140

IVD



[siemens.com/eifu](https://www.siemens.com/eifu)

FOR USA

ENGLISH: For the quantitative measurement of Gastrin
Contains: murine monoclonal antibody, bovine alkaline
phosphatase rabbit polyclonal antibody



(01)00630414961521
(10) 312
(17)220331
(240)10380979
(422)826

GTIN
LOT/BATCH
EXPIRY
SMN
ORIGIN GB



Siemens Healthcare Diagnostics Products Ltd.
Glyn Rhonwy
Llanberis, Gwynedd, LL55 4EL UK

[siemens-healthineers.com](https://www.siemens-healthineers.com)

EC REP

Siemens Healthcare Diagnostics
Manufacturing Ltd.
Chapel Lane
Brentford, Middlesex, TW8 9JF, UK

Рисунок 1 Набор реагентов для количественного определения гастрина/Gastrin на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 Gastrin), маркировка вторичной упаковки

GAS

IMMULITE® 2000 Systems

REF

L2KGA2

LOT

312



2022-03-31


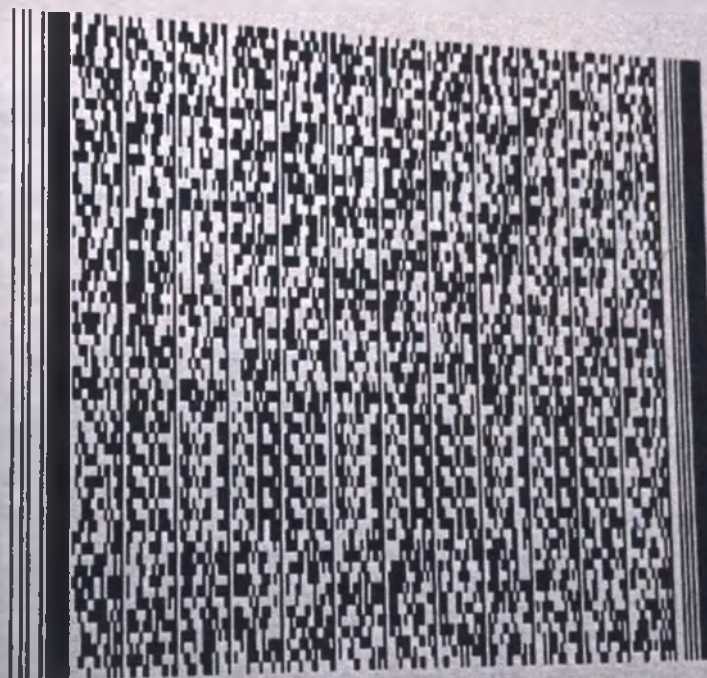


Рисунок 2. Набор реагентов для количественного определения гастрина/Gastrin на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 Gastrin), штрих-код

IMMULITE® 2000 Systems

GAS



LOT L2GA12 273 2024-03

Seed Pack

Adhere the Seed Pack to keep moisture at a constant temperature before use. Open by cutting along the top edge, leaving the ziplock closed to protect them from moisture.

Cartouche de billes

Attendez que le sac de la cartouche de billes intègre la température ambiante avant de l'ouvrir. Pour l'ouvrir, découpez le bord supérieur en laissant l'arête du sac à glissière à pression intacte. Refermez hermétiquement le sac pour le protéger de l'humidité.

Preparation Instructions

Remove the outer seal to keep moisture at a constant temperature before use. Open by cutting along the top edge, leaving the ziplock closed to protect them from moisture. After the outer seal is removed, the inner seal will be intact. Re-seal the bag by pressing the outer seal back into place.

Confezione di microsfere

Lasciare che la sacca delle microsfere raggiunga a temperatura ambiente prima dell'apertura. Per tagliare lungo il bordo superiore, lasciando intatto il coperchio a pressione. Richiudere la sacca con chiusura a zip. Riproteggere dalla luce.

Открыть пакет, не касаясь содержимого, держа его за верхнюю часть. Разрезать по верхнему краю, оставив intacto el rebordo de la cremallera. Evitar las bolsas expuestas de la humedad.

Antes de abrir, deixar a embalagem de microesferas à temperatura ambiente. Para abrir, cortar o longo da margem, deixando intacta a parte do zíper. Não expor as bolsas para se proteger.

Πακέτο σφαιρίων

Περιμένετε να η σακούλα της σφαίρας φτάσει στην θερμοκρασία του περιβάλλοντος πριν από το άνοιγμα. Ανοίξτε κόβοντας κατά μήκος της πάνω άκρας, αφήνοντας τη γραμμή αεροστεγούς αλυσίδας της σακούλας ανέπαφη. Σφραγίστε πάλι τις σακούλες για προστασία από την υγρασία.

Pakiet kuleczek

Przed otwarciem pozostawić woreczek z kuleczkami do osiągnięcia temperatury pokojowej. Otworzyć przecinając wzdłuż górnej krawędzi bez uszkodzenia zamknięcia suwakowego. Ponownie zamknąć woreczki w celu ochrony przed wilgocią.

Kuleček

Lēt kulečekpāsen ātrā telpas temperatūrā, pirms tās atvērt. Atvērt, griežot gar augšējo malu, nebojājot maisiņa malu, kurā iestrādāta atkārtotās noslēgšanas sistēma. Atkārtoti noslēdziet maisiņus, lai aizsargātu no mitruma.

Polistirolo granulų pakuotė išimkite, kad prieš atidarant polistirolo granulų pakuotės maišelis yra kambario temperatūros. Atidarykite nupjaudami ties viršutinio krašto, bet nepažeisdami savaiminio užsidarimo maišelio gnyvelio. Vėl uždarykite maišelius, kad turmų būtų apsaugotas nuo drėgmės.

Polistirolo granulų pakuotė išimkite, kad prieš atidarant polistirolo granulų pakuotės maišelis yra kambario temperatūros. Atidarykite nupjaudami ties viršutinio krašto, bet nepažeisdami savaiminio užsidarimo maišelio gnyvelio. Vėl uždarykite maišelius, kad turmų būtų apsaugotas nuo drėgmės.

Lođišu iepakojums

Ļaujiet lođišu iepakojumam pirms atvēršanas sasilt līdz istabas temperatūrai. Atveriet, nogriežot gar augšējo malu, nebojājot maisiņa malu, kurā iestrādāta atkārtotās noslēgšanas sistēma. Atkārtoti noslēdziet maisiņus, lai aizsargātu no mitruma.

Terakosta kőzet

Enne avaramis, neev (tahke kandamis) temperatúra. Toatemperatuuraga kott, lõgareidmis veanduge terakosta tervaks, kottu sulgege.

Baleri'sall

Poed ome, neev perikur, pakojuv rozeas, peibem, uzavir, uzavir, poed y.



RM1433E-D

www.siemens.com/diagnostics

SIEMENS

Рисунок 3. Набор реагентов для количественного определения гастрина/Gastrin на анализаторах иммунохемилуминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 Gastrin), пакет с реагентом



Рисунок 4 Набор реагентов для количественного определения гастрина/Gastrin на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 Gastrin), клин с реагентом (1)

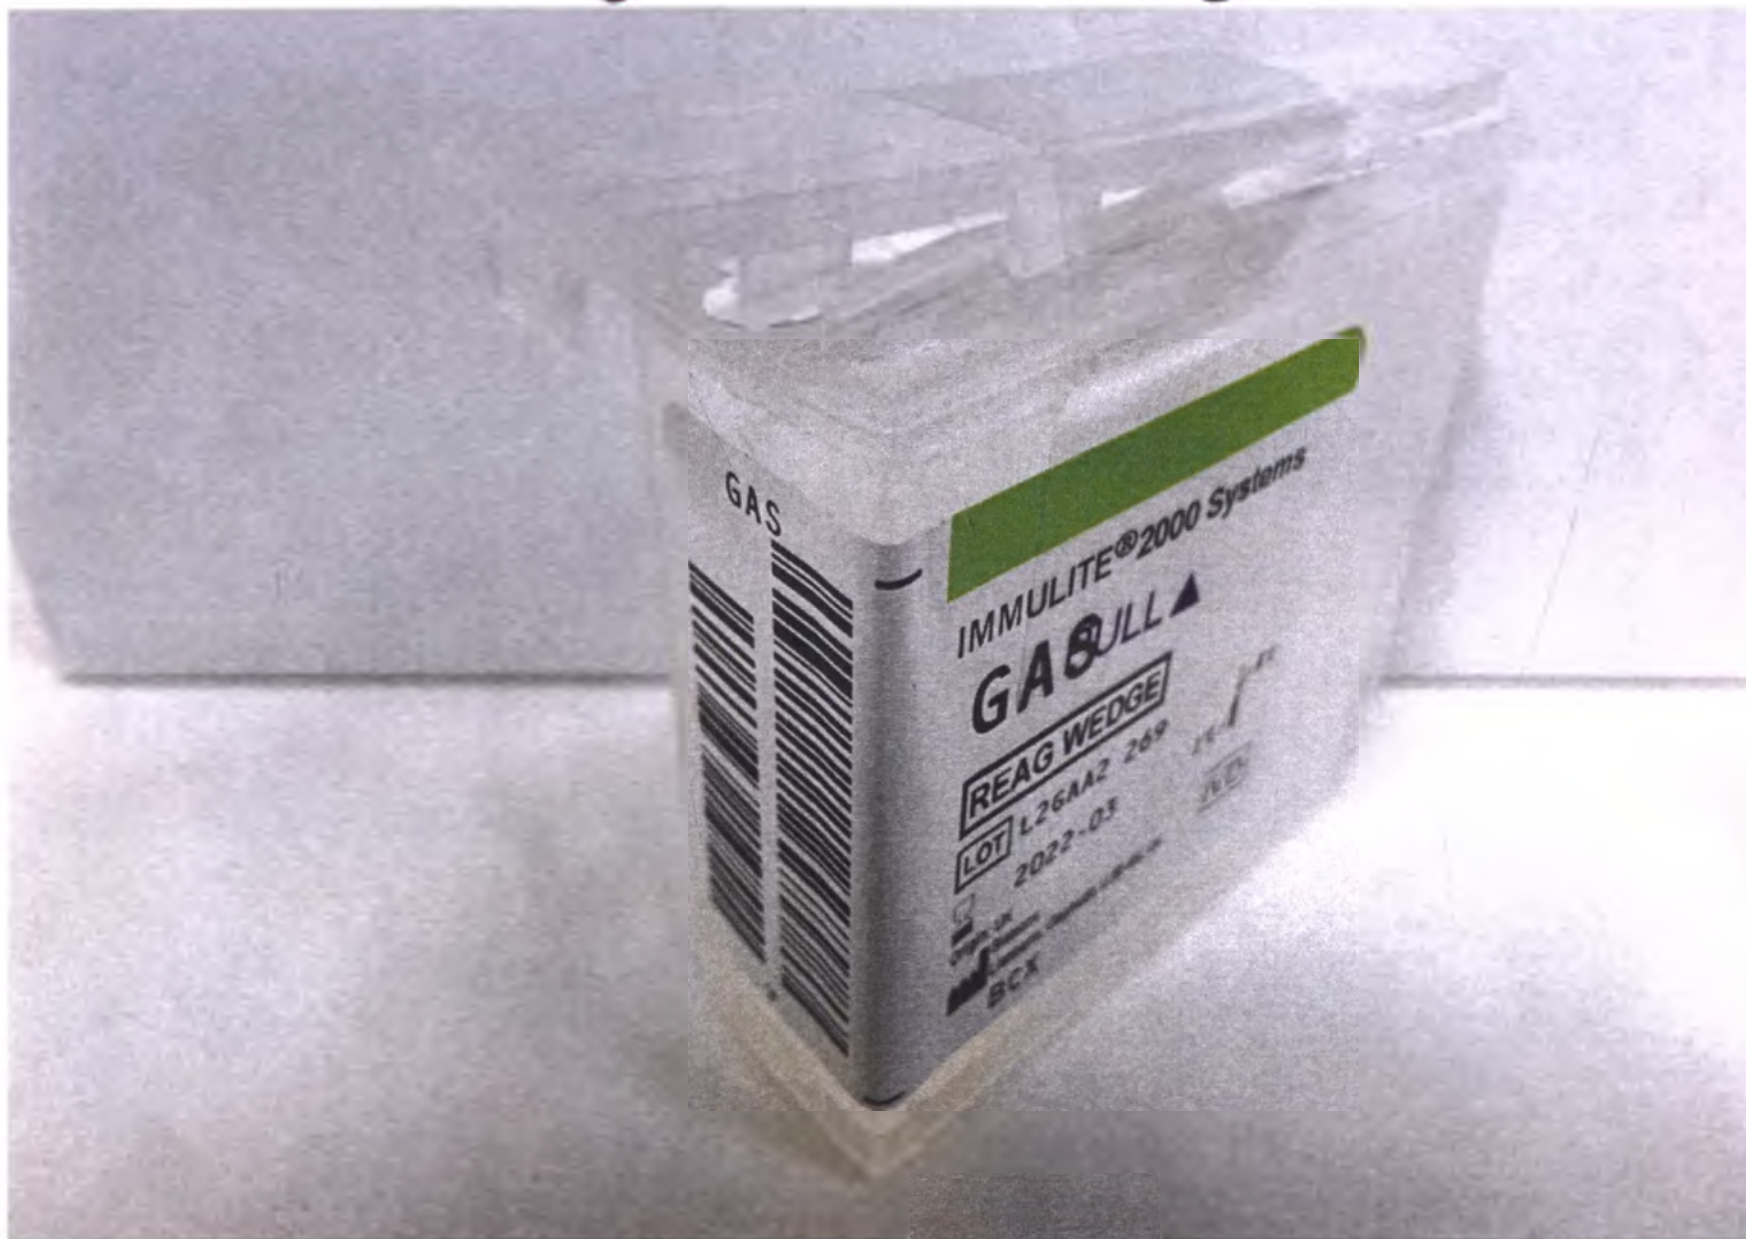


Рисунок 5. Набор реагентов для количественного определения гастрина/Gastrin на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 Gastrin), клин с реагентом (2)

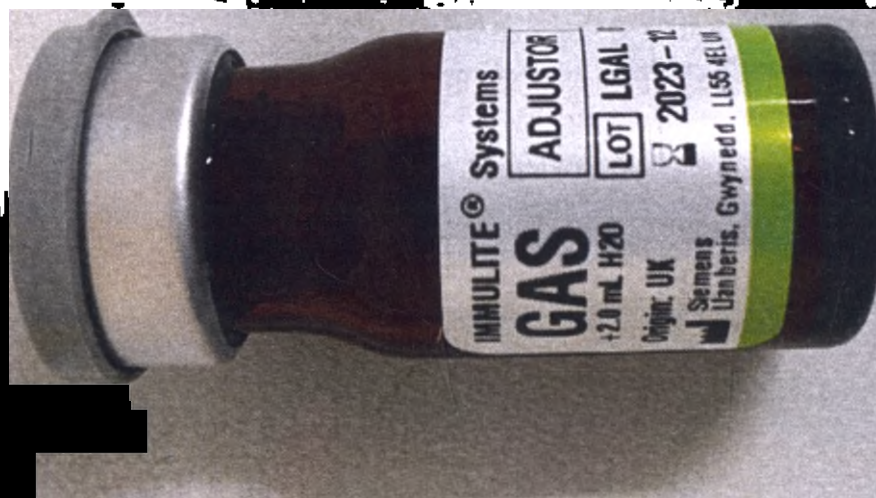


Рисунок 6. Набор реагентов для количественного определения гастрина/Gastrin на анализаторах иммунохемилюминисцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 Gastrin). Калибратор с низкой концентрацией Gastrin Adjustors (LGAL), (1)

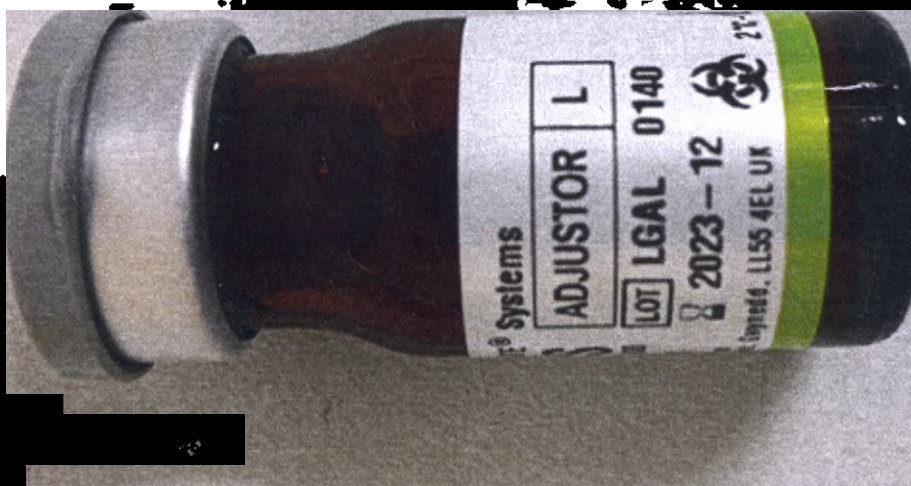


Рисунок 7. Набор реагентов для количественного определения гастрина/Gastrin на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 Gastrin) Калибратор с низкой концентрацией Gastrin Adjustors (LGAL), (2)



Рисунок 8. Набор реагентов для количественного определения гастрина/Gastrin на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 Gastrin). Калибратор с высокой концентрацией Gastrin Adjustors (LGAN), (1)

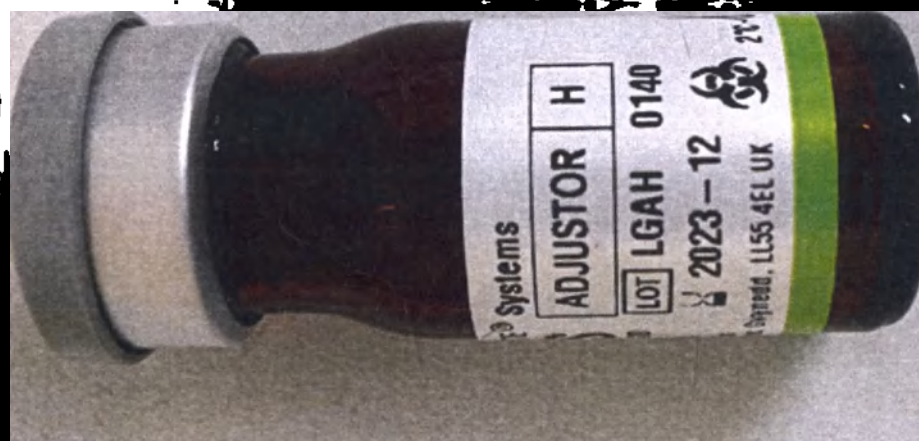


Рисунок 9. Набор реагентов для количественного определения гастрина/Gastrin на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 Gastrin). Калибратор с высокой концентрацией Gastrin Adjustors (LGAH), (2)



Рисунок 10 Набор реагентов для количественного определения гастрина/Gastrin на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 Gastrin), стикеры

10380979

Набор реагентов для количественного определения гастрина/Gastrin
на анализаторах иммунохемилюминисцентных серии Immulite 2000
(Immulite 2000 Gastrin)

Информация о производителе и стране производства:
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:

№ _____ от _____

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на
оригинальной упаковке

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Рисунок 11. Пример макета русскоязычной маркировки Набор реагентов для количественного определения гастрина/Gastrin на анализаторах иммунохемилюминисцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 Gastrin)



Всего прошито и пронумеровано
листа (ов).

ООО «Сименс Здравоохранение»