

Руководитель направления по регистрации
продукции для in vitro диагностики,
иммунохимия, гематология и гемостаз
ООО «Сименс Здравоохранение»

Б.А. Чигринец



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**

**«Набор реагентов для количественного определения ракового антигена СА 15–3 (BR-MA)/BR-MA
(CA 15–3) на анализаторах иммунохемилюминисцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 CA
15–3 (BR-MA))»**

производства «Сименс Хелскэа Диагностикс Продактс Лимитед» (Siemens Healthcare Diagnostics
Products Limited), Великобритания
Glyn Rhonwy, Llanberis, Gwynedd LL55 4EL, United Kingdom

SIEMENS

IMMULITE® 2000 Systems

BRM

BR-MA (CA15-3)



LOT 307

2021-11-30

REF L2KBR2

SMN 10380983

BEAD PACK 1 x L2BR12281

READ WEDGE 1 x L2BRA2282

ADJUSTOR L 1 x LBR1135

ADJUSTOR H 1 x LBRH135



siemens.com/eifu

FOR USA

ENGLISH: For the quantitative measurement of BR-MA (CA15-3)
Contains: murine monoclonal antibody, bovine alkaline phosphatase



(01)00630414961088
(10)307
(17)211130
(240)10380983
(422)828

GTIN
LOT/BATCH
EXPIRY
SMN
ORIGIN GB



Siemens Healthcare Diagnostics Products Ltd.
Glyn Rhonwy
Llanberis, Gwynedd, LL55 4EL UK

siemens-healthineers.com



Siemens Healthcare Diagnostics
Manufacturing Ltd.
Chapel Lane
Swords, Co. Dublin, Ireland

Рисунок 1. Набор реагентов для количественного определения ракового антигена CA 15-3 (BR-MA)/BR-MA (CA 15-3) на анализаторах иммунохемилюминисцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 CA 15-3 (BR-MA)), маркировка вторичной упаковки

BRM

IMMULITE® 2000 Systems

REF L2KBR2

LOT 307

 2021-11-30

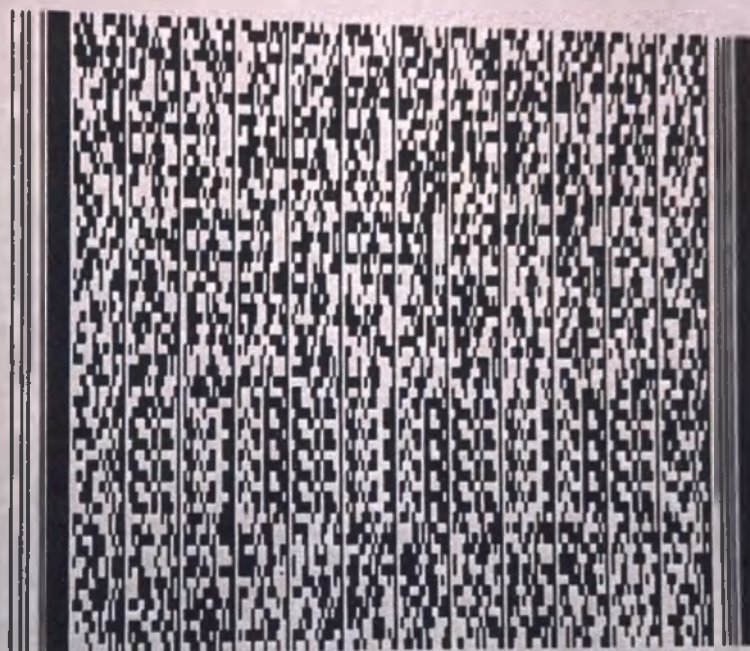


Рисунок 2. Набор реагентов для количественного определения ракового антигена СА 15–3 (BR-MA)/BR-MA (СА 15–3) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 CA 15–3 (BR-MA)), штрих-код



Рисунок 4. Набор реагентов для количественного определения ракового антигена CA 15-3 (BR-MA)/BR-MA (CA 15-3) на анализаторах иммунохемилюминисцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 CA 15-3 (BR-MA)), клин с реагентом (1)

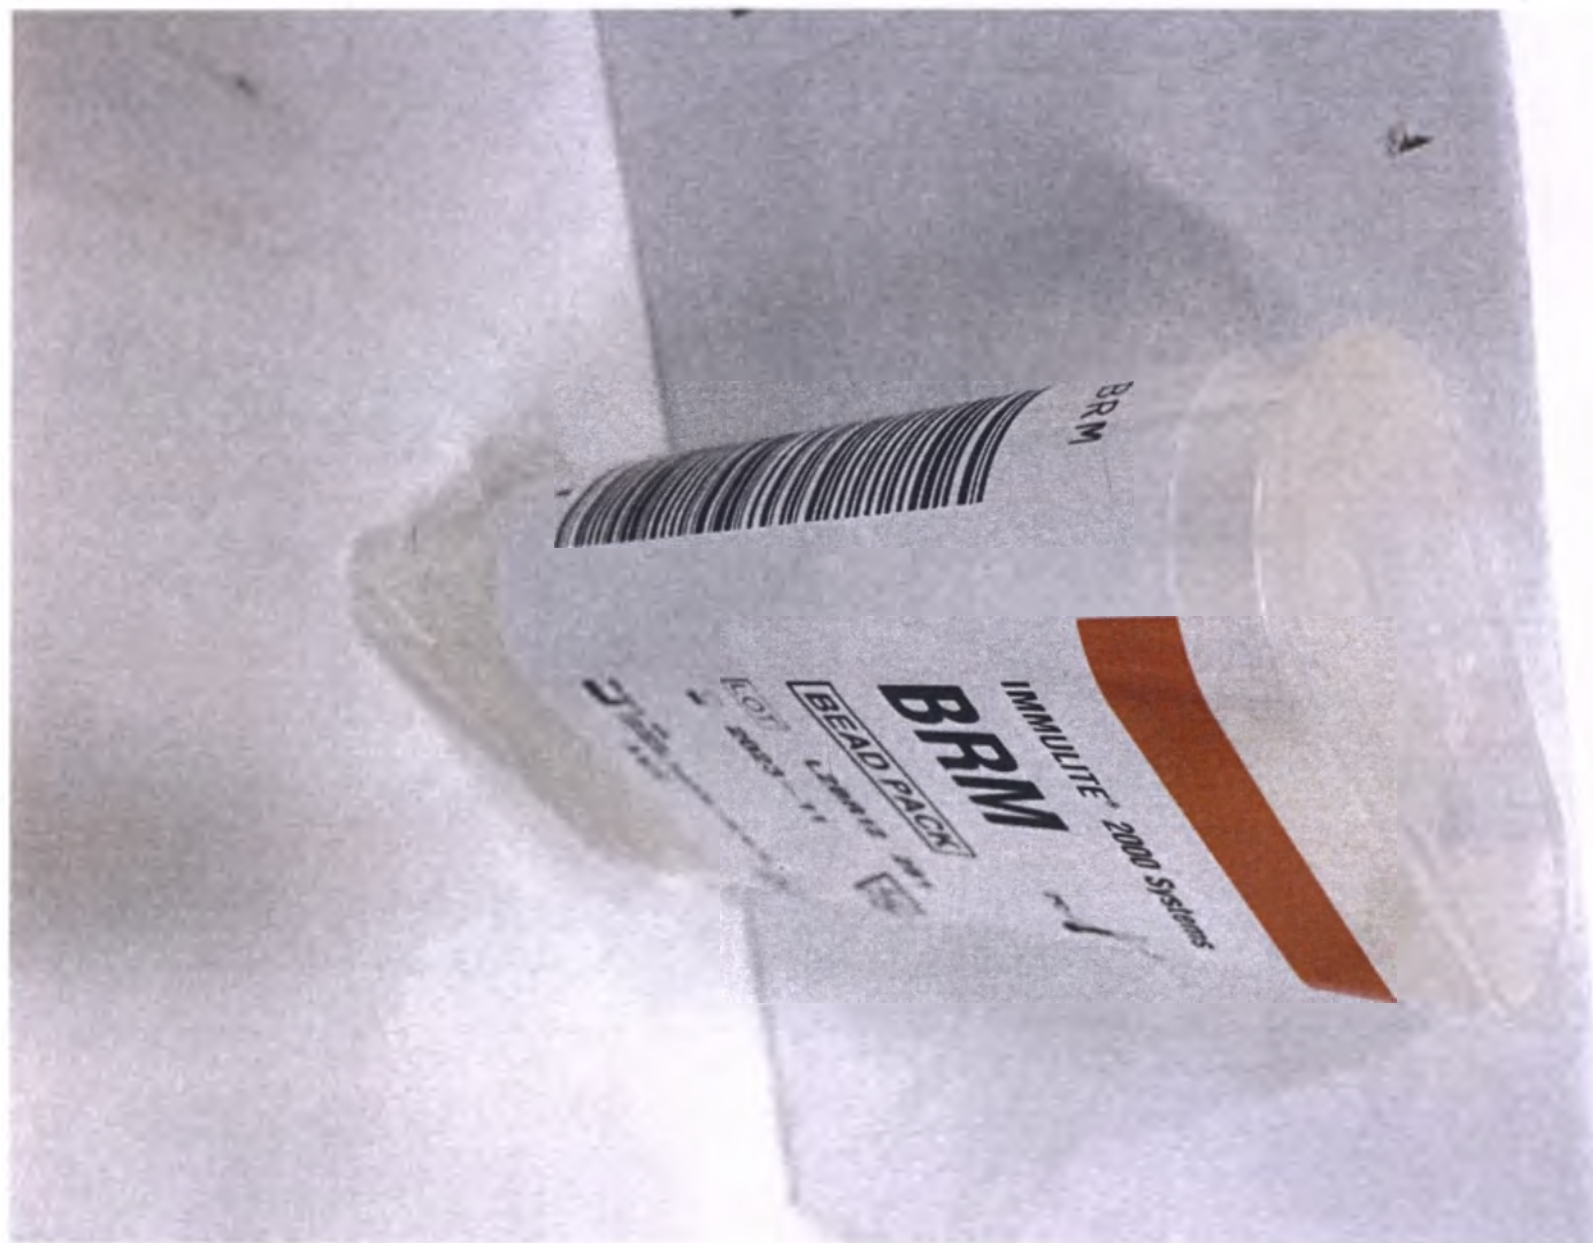


Рисунок 5. Набор реагентов для количественного определения ракового антигена СА 15-3 (BR-MA)/BR-MA (СА 15-3) на анализаторах иммунохемилюминисцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 СА 15-3 (BR-MA)), клин с реагентом (2)



Рисунок 6. Набор реагентов для количественного определения ракового антигена CA 15-3 (BR-MA)/BR-MA (CA 15-3) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 CA 15-3 (BR-MA)). Калибратор с низкой концентрацией BR-MA Adjustors (LBLR), (1)

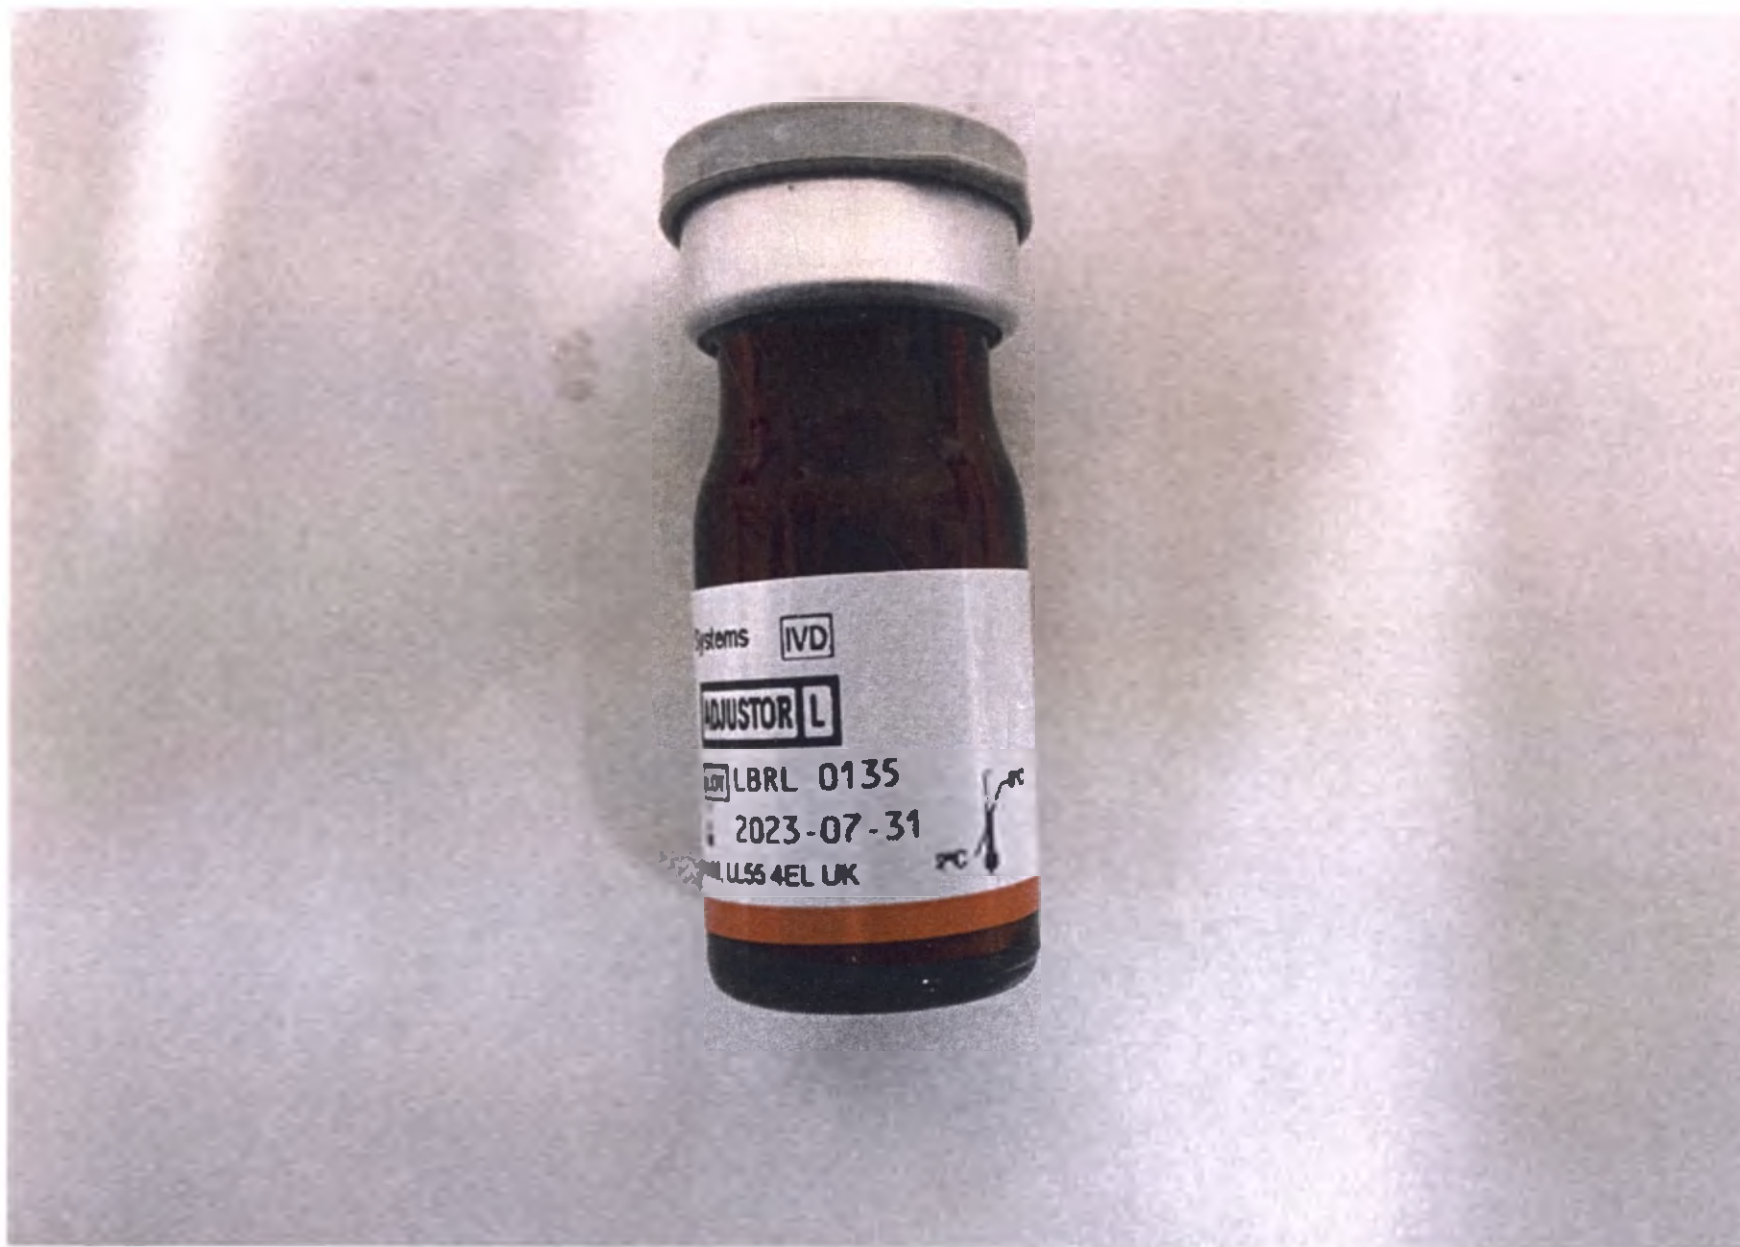


Рисунок 7. Набор реагентов для количественного определения ракового антигена СА 15-3 (BR-MA)/BR-MA (CA 15-3) на анализаторах иммунохемилюминисцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 CA 15-3 (BR-MA)). Калибратор с низкой концентрацией BR-MA Adjustors (LBRL), (2)



Рисунок 8. Набор реагентов для количественного определения ракового антигена CA 15-3 (BR-MA)/BR-MA (CA 15-3) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 CA 15-3 (BR-MA)). Калибратор с высокой концентрацией BR-MA Adjustors (LBRH), (1)

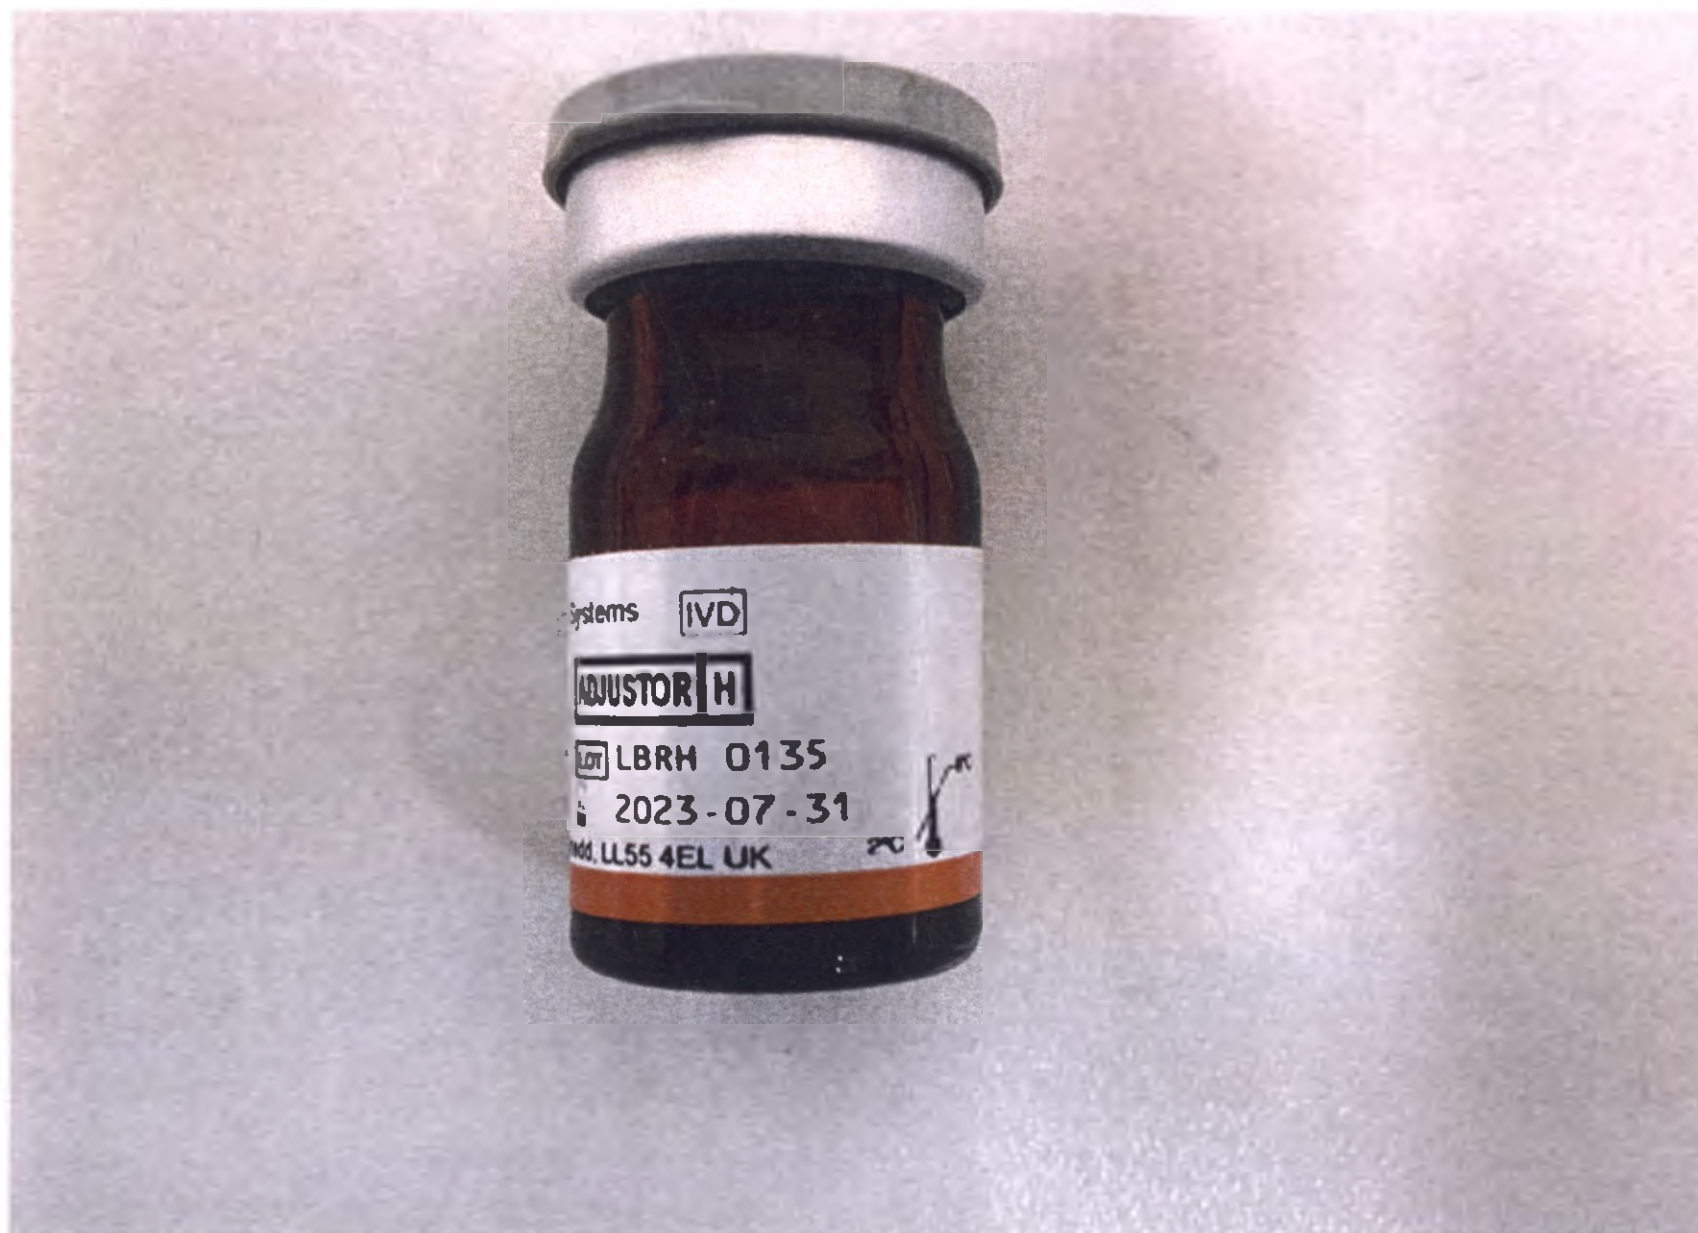


Рисунок 9. Набор реагентов для количественного определения ракового антигена CA 15-3 (BR-MA)/BR-MA (CA 15-3) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 CA 15-3 (BR-MA)). Калибратор с высокой концентрацией BR-MA Adjustors (LBRH), (2)



Рисунок 10. Набор реагентов для количественного определения ракового антигена CA 15-3 (BR-MA)/BR-MA (CA 15-3) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 CA 15-3 (BR-MA)), стикеры

10380983

Набор реагентов для количественного определения ракового антигена СА 15–3 (BR-MA)/BR-MA (СА 15–3) на анализаторах иммунохемилюминисцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 СА 15–3 (BR-MA))

Информация о производителе и стране производства: см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:

№ _____ от _____

ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Состав: указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

Рисунок 11. Пример макета русскоязычной маркировки Набора реагентов для количественного определения ракового антигена СА 15–3 (BR-MA)/BR-MA (СА 15–3) на анализаторах иммунохемилюминисцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 СА 15–3 (BR-MA))



Всего прошито и пронумеровано
2 листа (ов).

ООО «Сименс Здоровоохранение»