

Руководитель направления по регистрации  
продукции для in vitro диагностики,  
иммунохимия, гематология и гемостаз  
ООО «Сименс Здравоохранение»

  
Е.А. Чигринец



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ  
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO**


**«Набор реагентов для количественного определения инсулиноподобного фактора роста-1/IGF-1  
на анализаторах иммунохемилюминисцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 IGF-1)»**

производства «Сименс Хелскэа Диагностикс Продактс Лимитед» (Siemens Healthcare Diagnostics  
Products Limited), Великобритания  
Glyn Rhonwy, Llanberis, Gwynedd LL55 4EL, United Kingdom



Рисунок 1. Вторичная упаковка Набора реагентов для количественного определения инсулиноподобного фактора роста-1/IGF-1 на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 IGF-1)



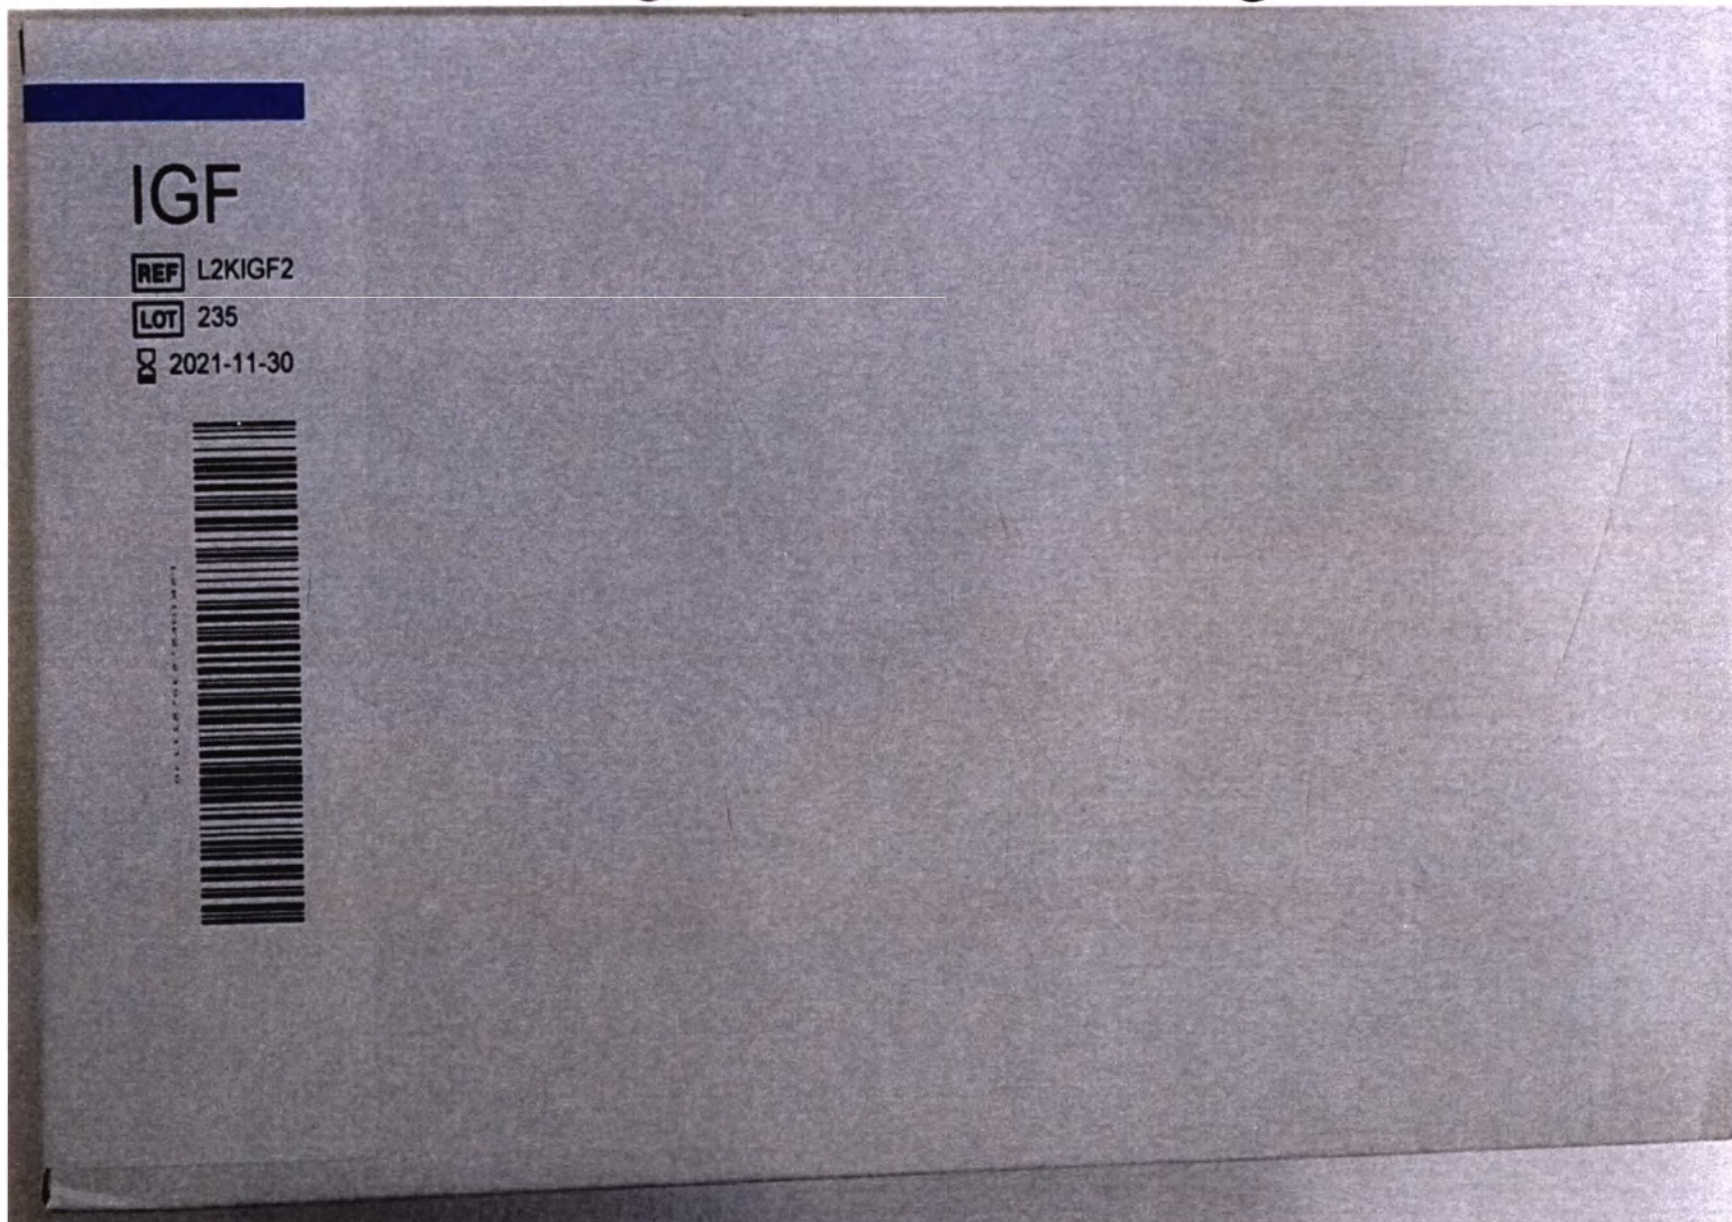

**Рисунок 2.** Вторичная упаковка Набора реагентов для количественного определения инсулиноподобного фактора роста-1/IGF-1 на анализаторах иммунохемилюминисцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 IGF-1), вид сбоку





Рисунок 3. Набора реагентов для количественного определения инсулиноподобного фактора роста-1/IGF-1 на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 IGF-1), общий вид



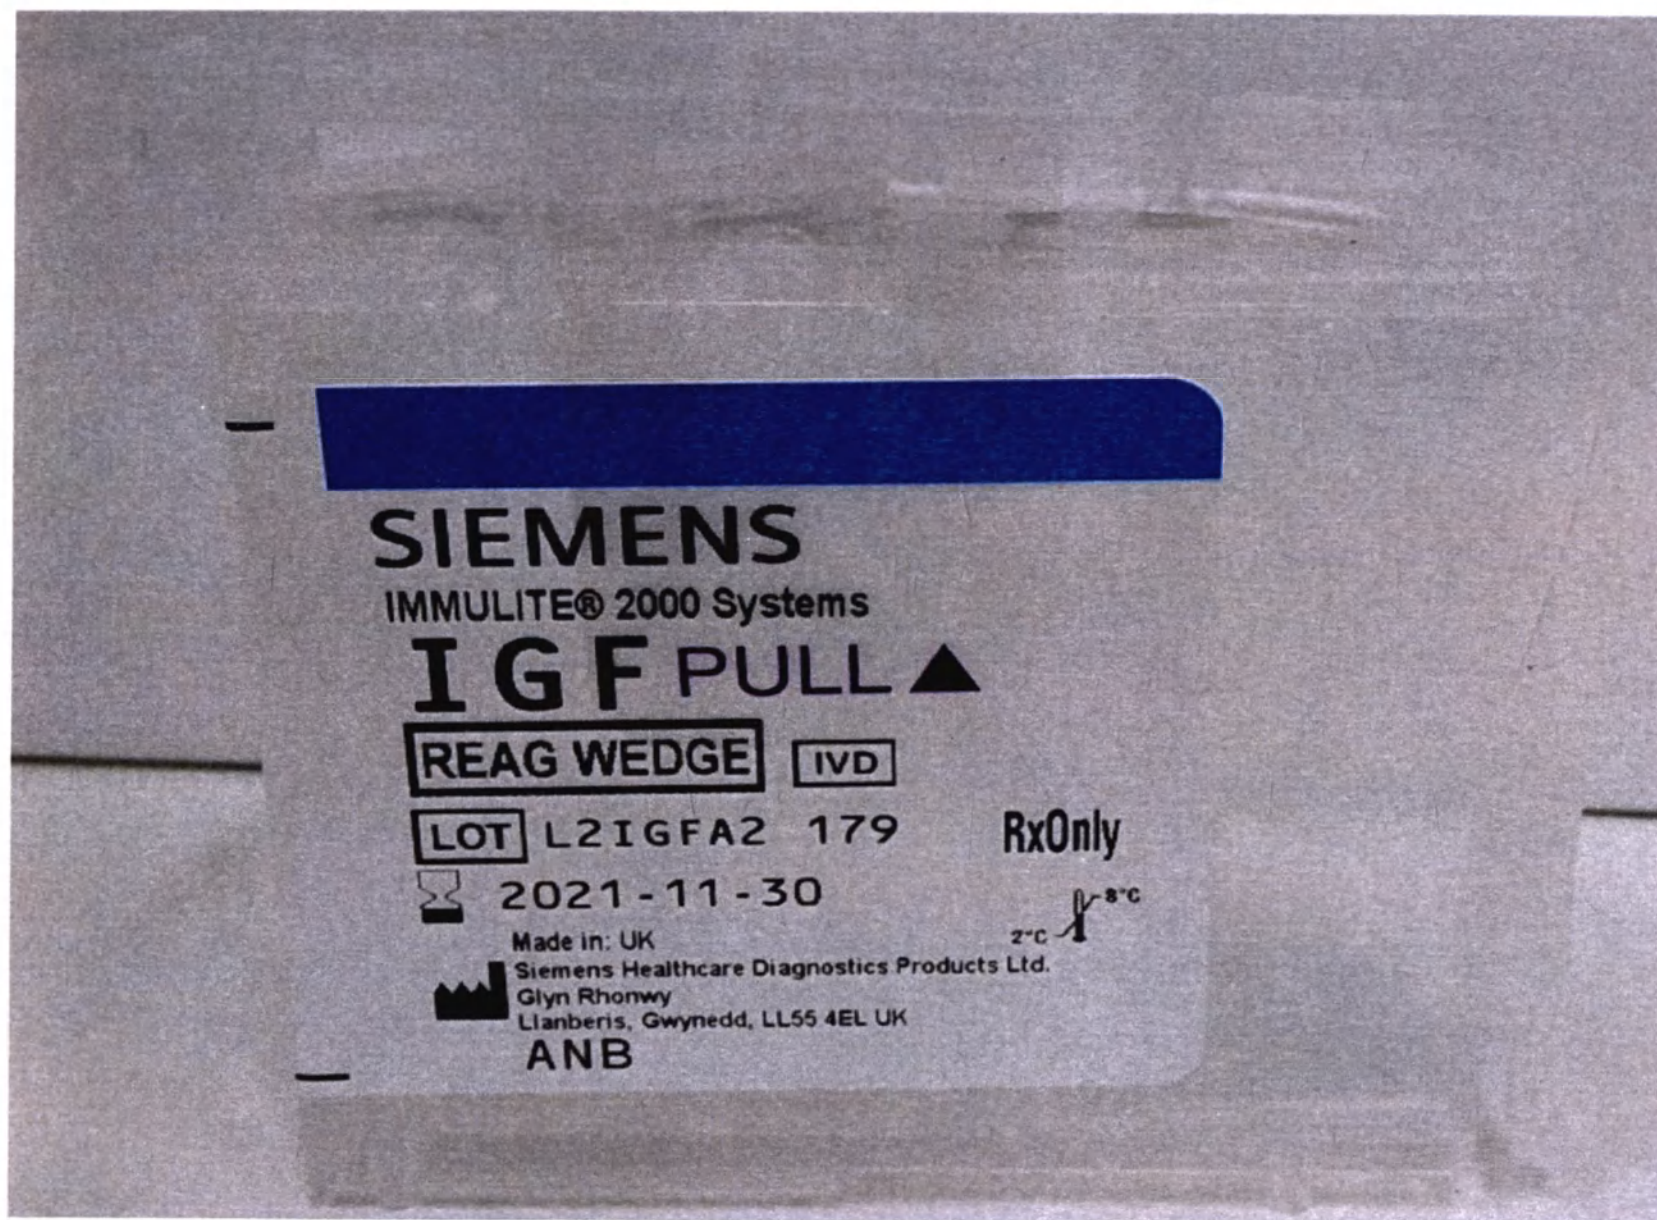


Рисунок 4. Клин с реагентом Набора реагентов для количественного определения инсулиноподобного фактора роста-1/IGF-1 на анализаторах иммунохемилюминисцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 IGF-1)



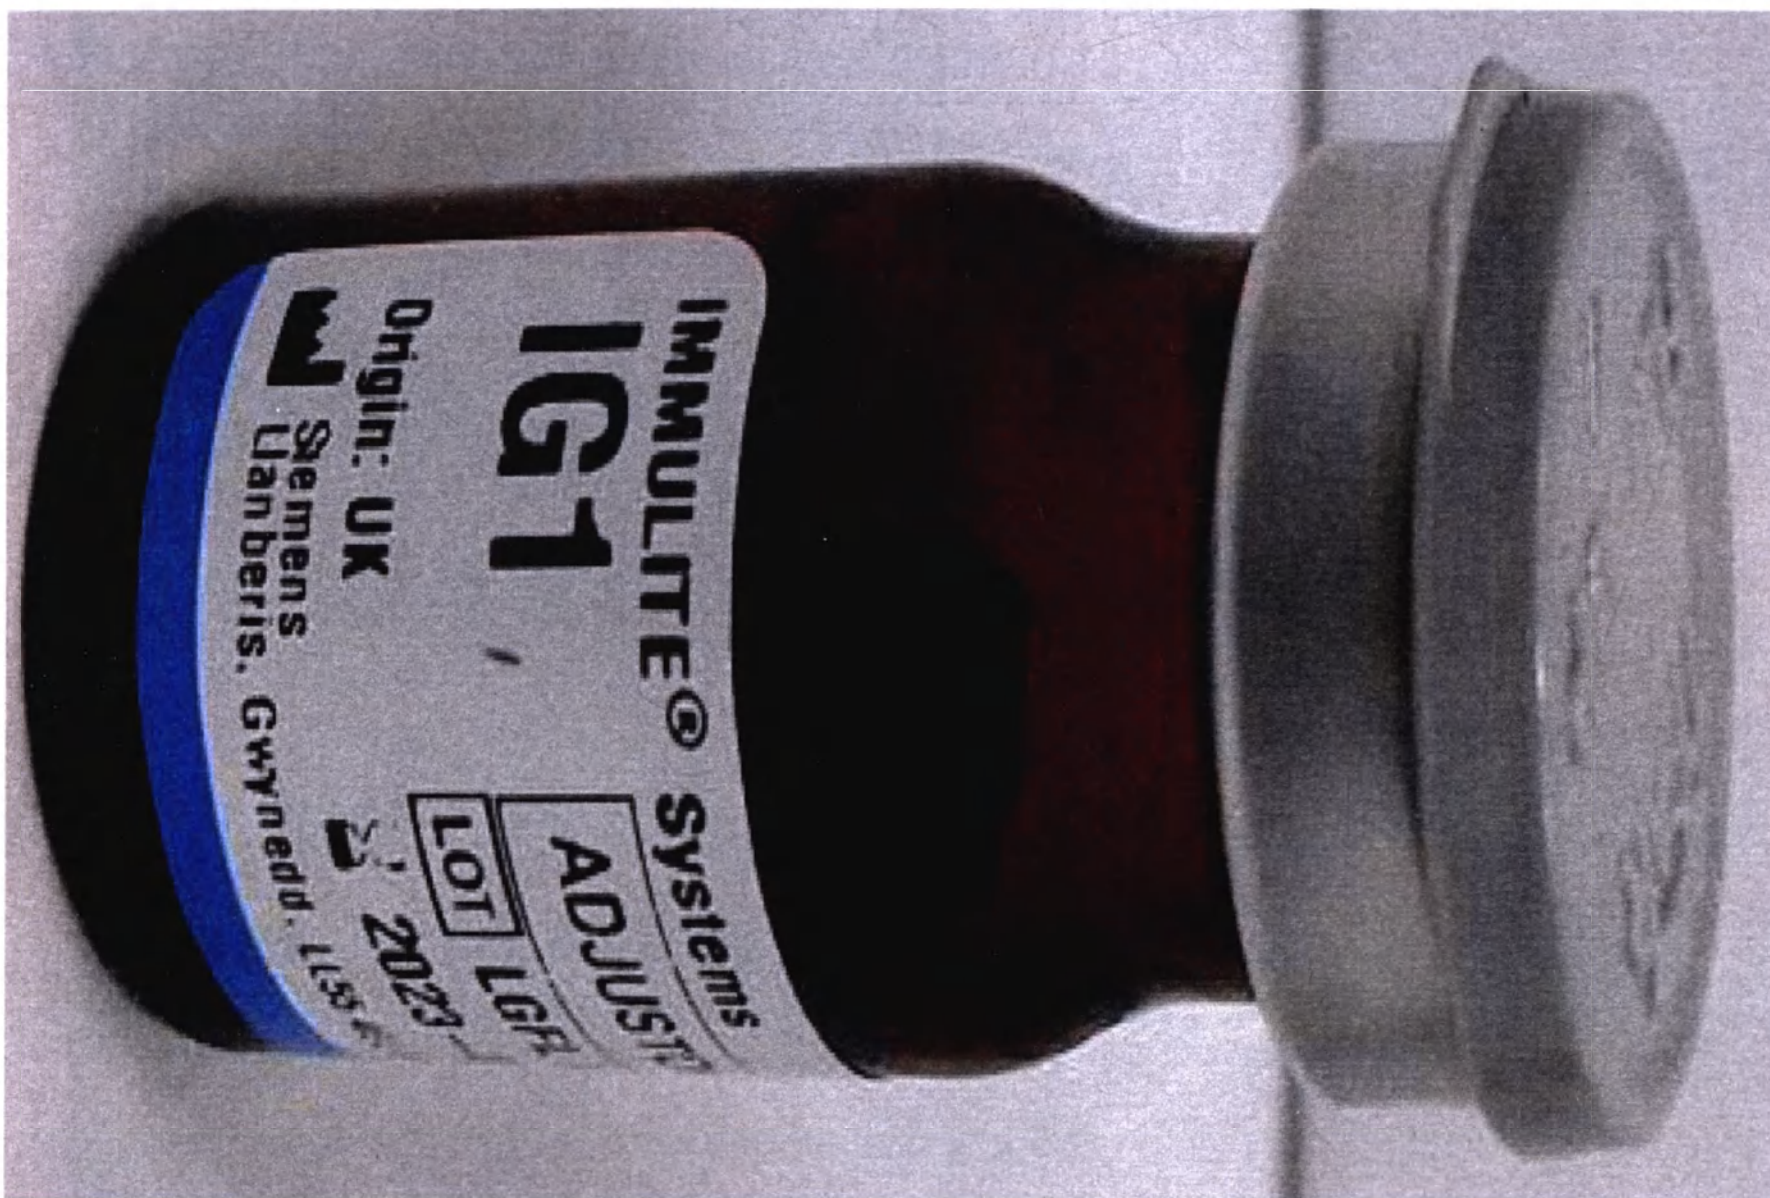


Рисунок 5. Калибратор с низкой концентрацией Набора реагентов для количественного определения инсулиноподобного фактора роста-1/IGF-1 на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 IGF-1), общий вид 1




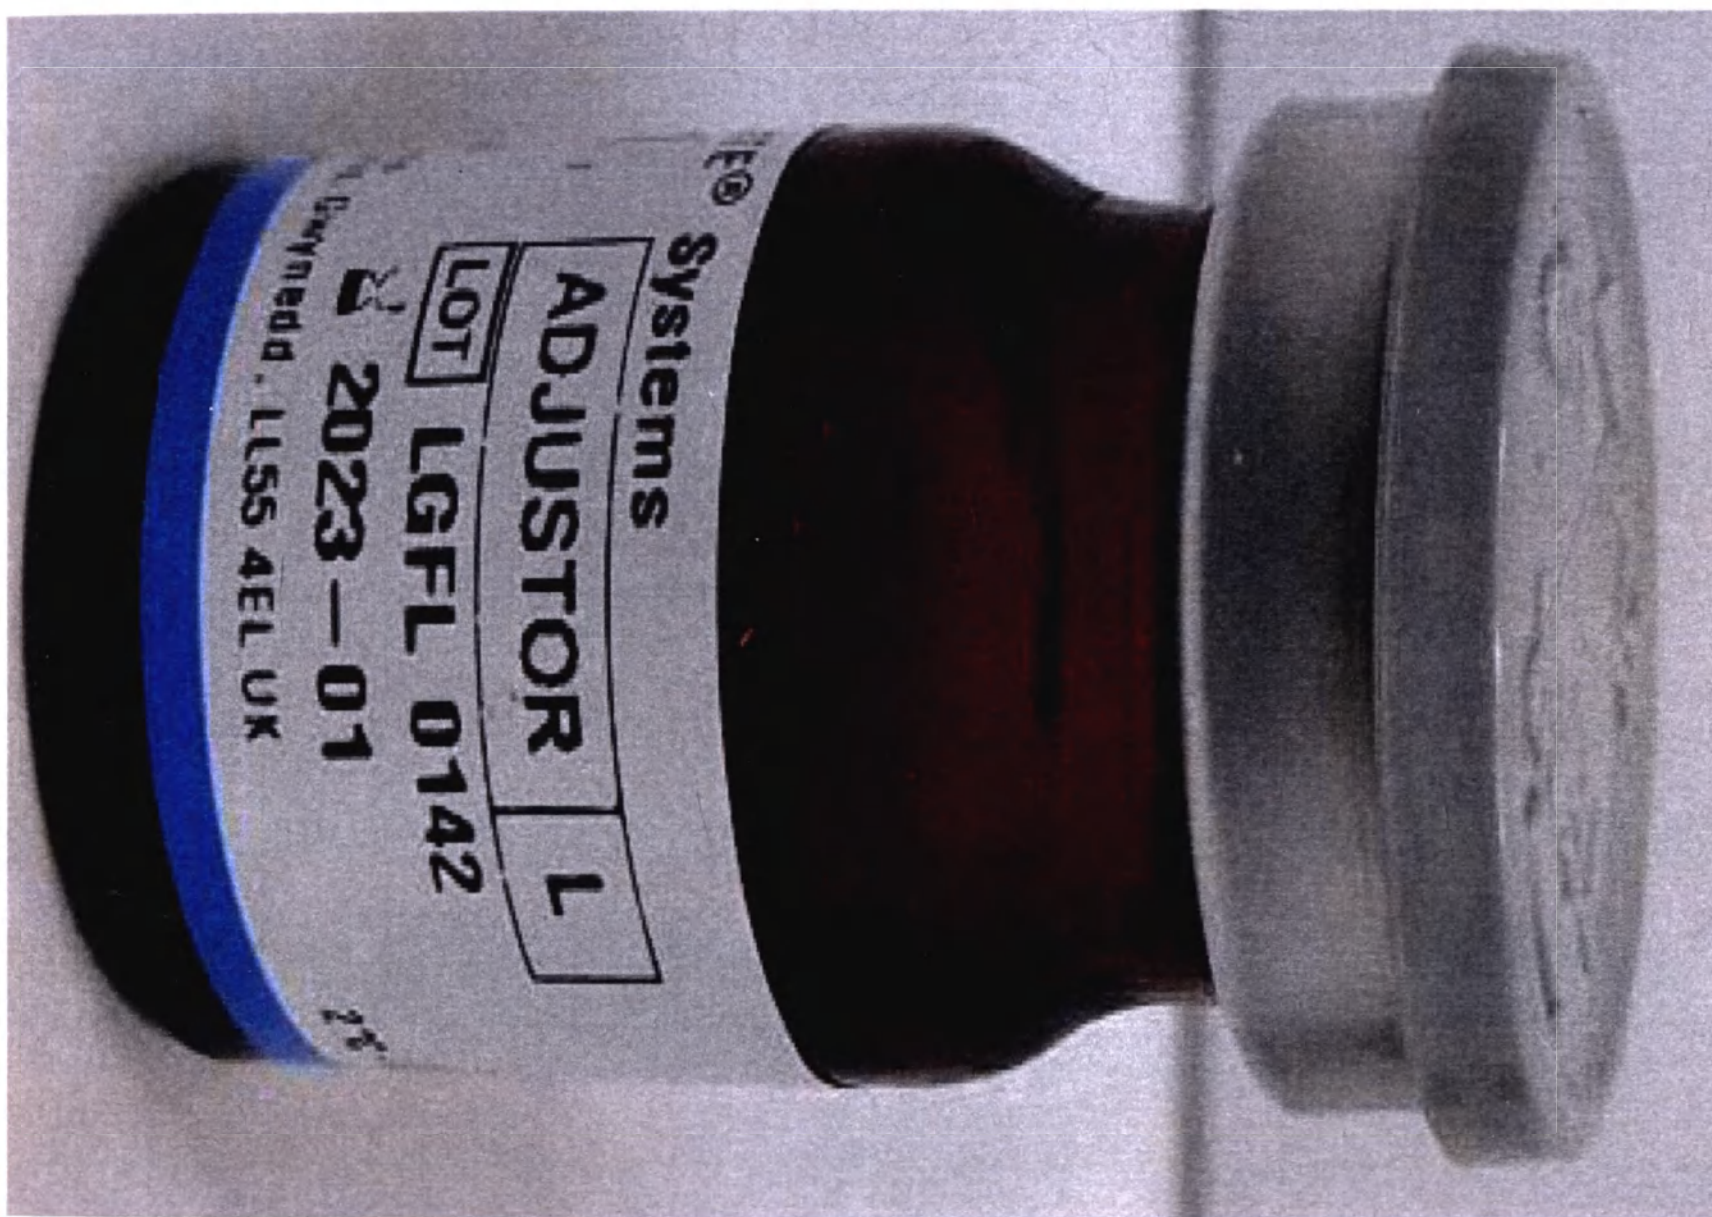



Рисунок 6. Калибратор с низкой концентрацией Набора реагентов для количественного определения инсулиноподобного фактора роста-1/IGF-1 на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 IGF-1), общий вид 2






**Рисунок 7.** Калибратор с низкой концентрацией Набора реагентов для количественного определения инсулиноподобного фактора роста-1/IGF-1 на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 IGF-1), общий вид 3

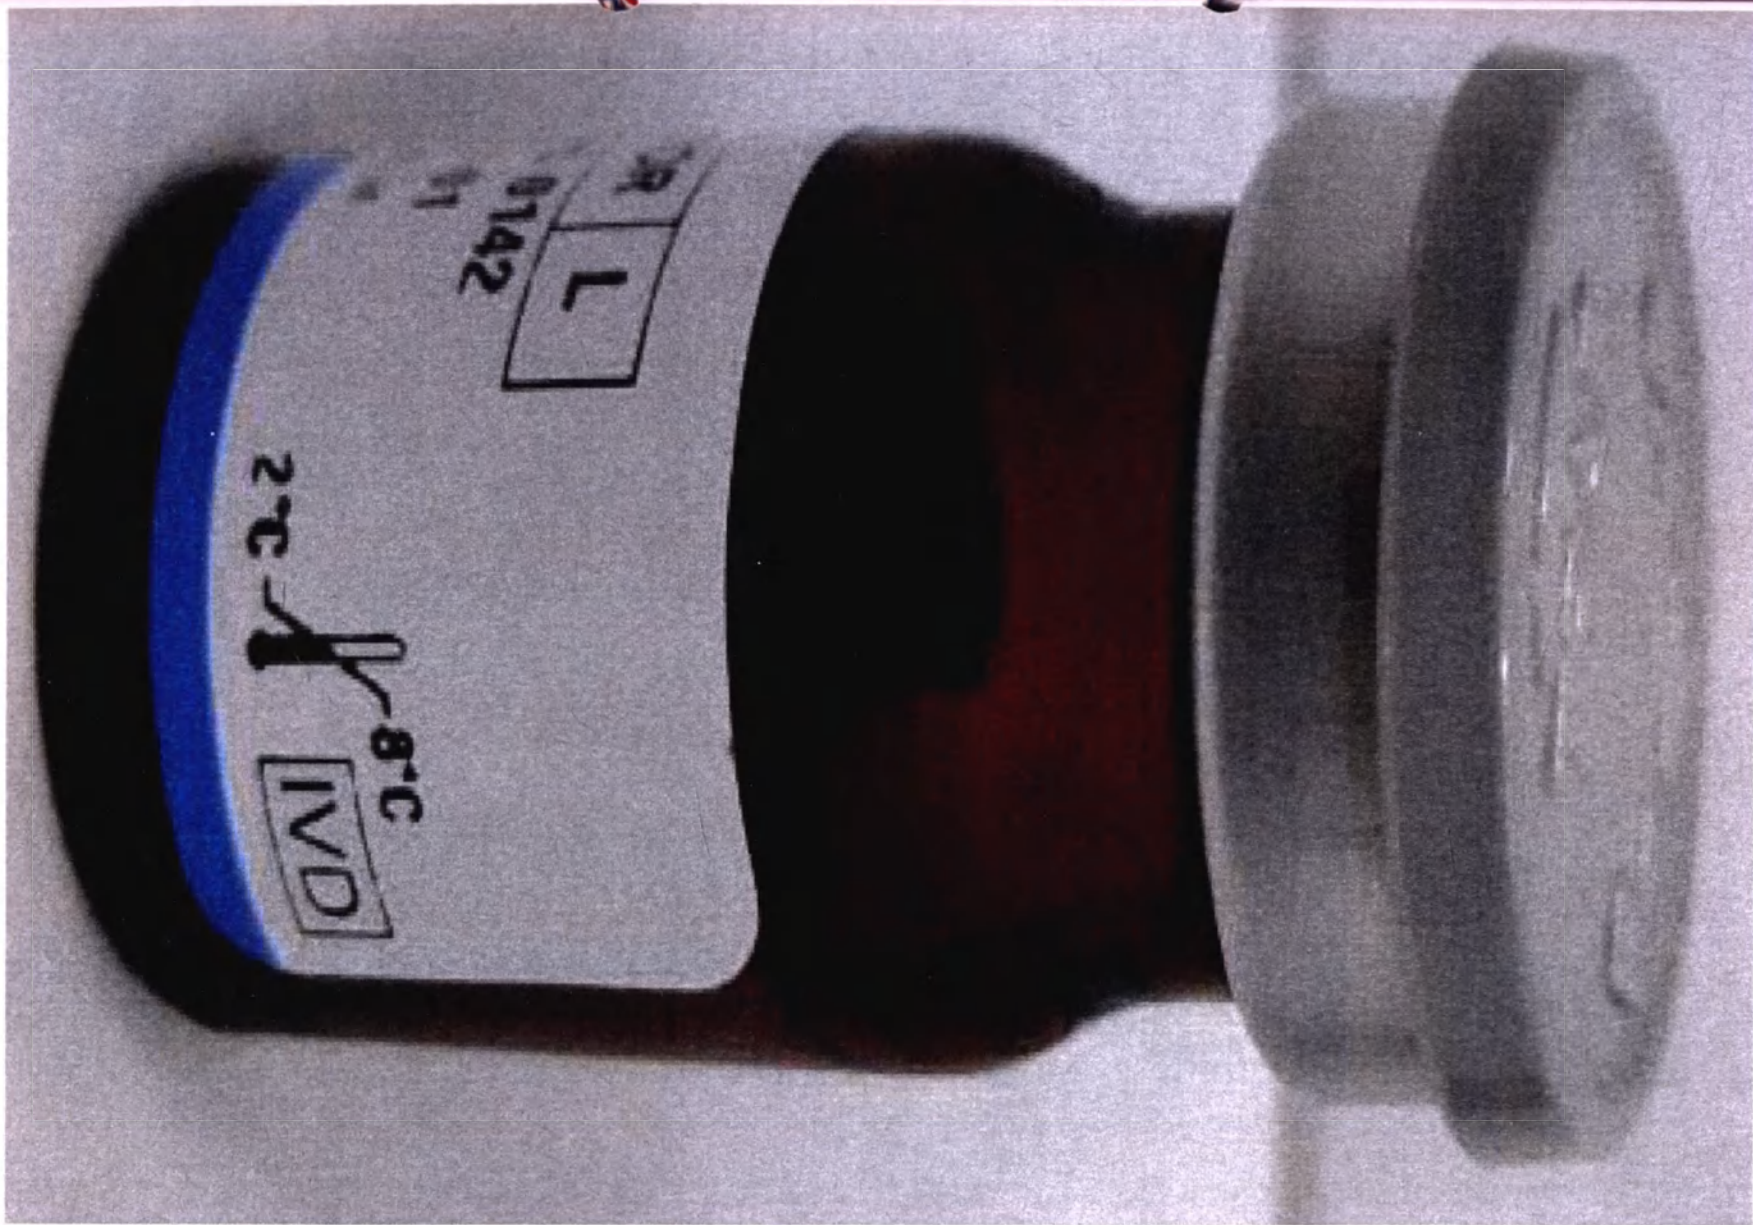

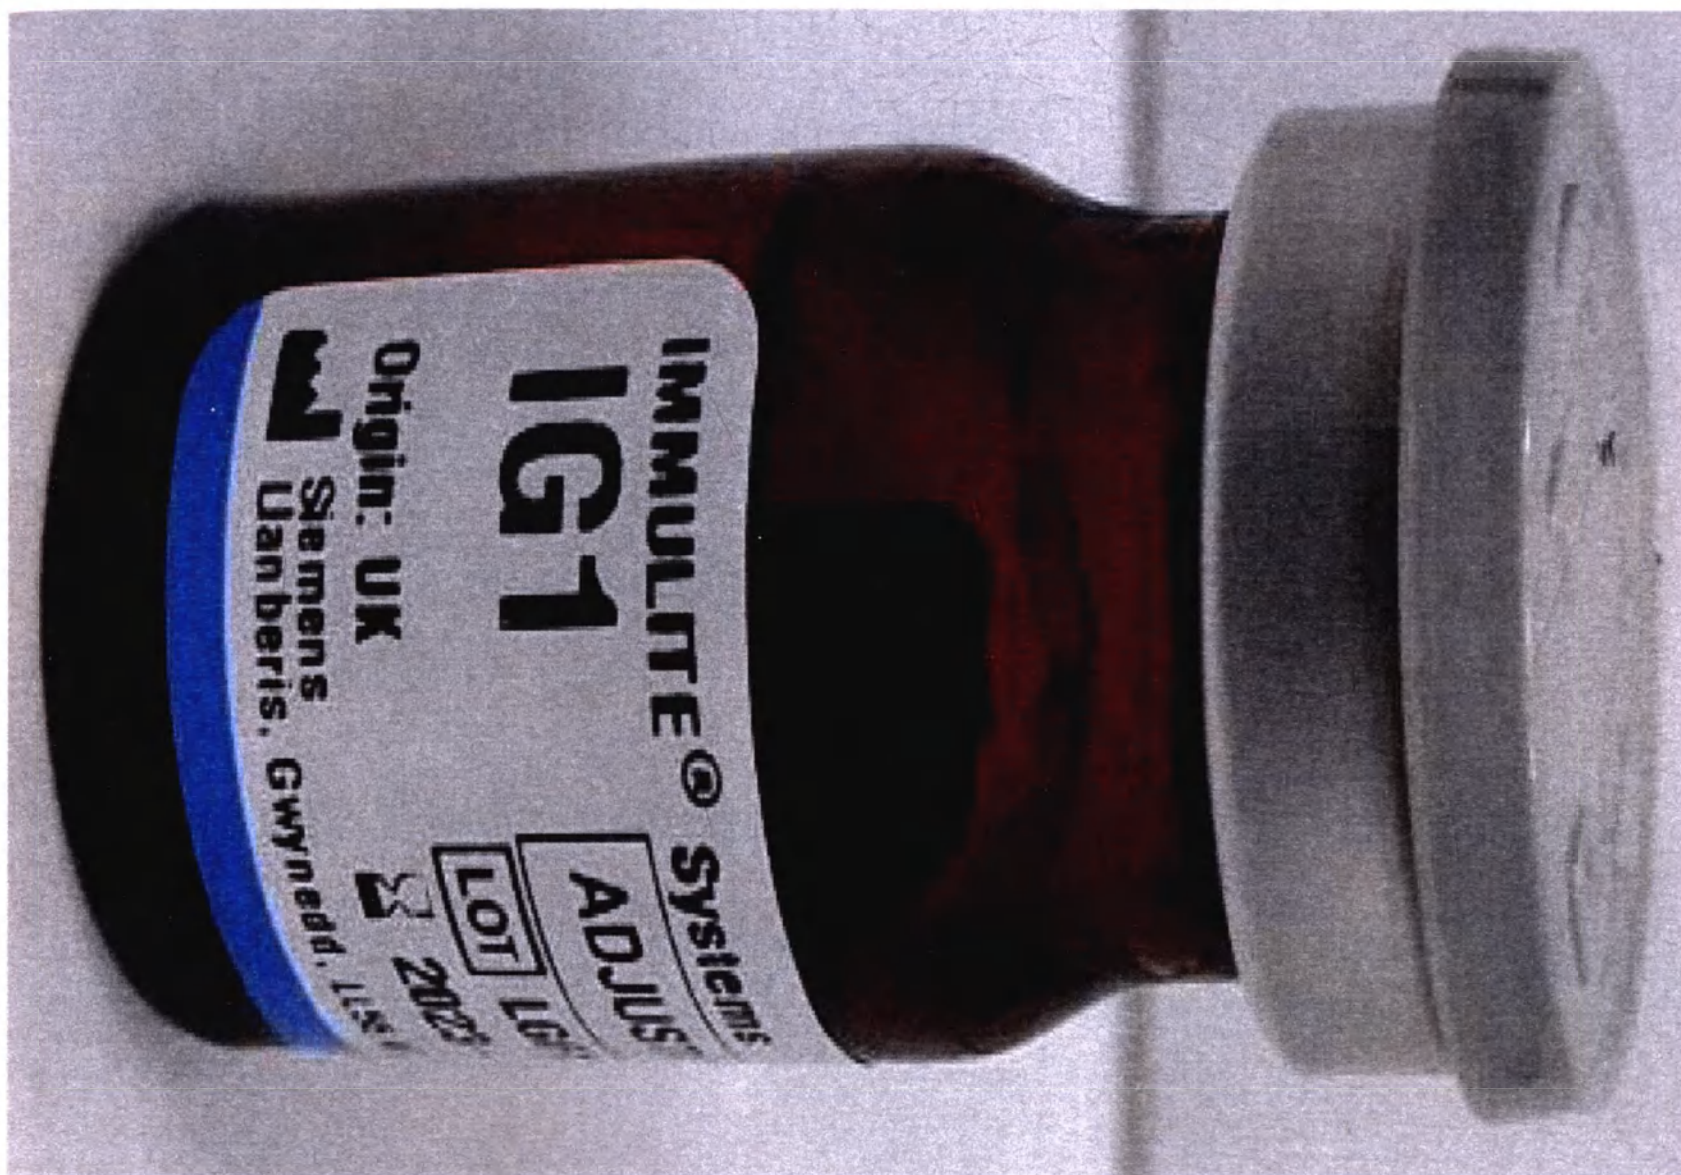

**Рисунок 8.** Калибратор с высокой концентрацией Набора реагентов для количественного определения инсулиноподобного фактора роста-1/IGF-1 на анализаторах иммунохемилюминисцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 IGF-1), общий вид 1



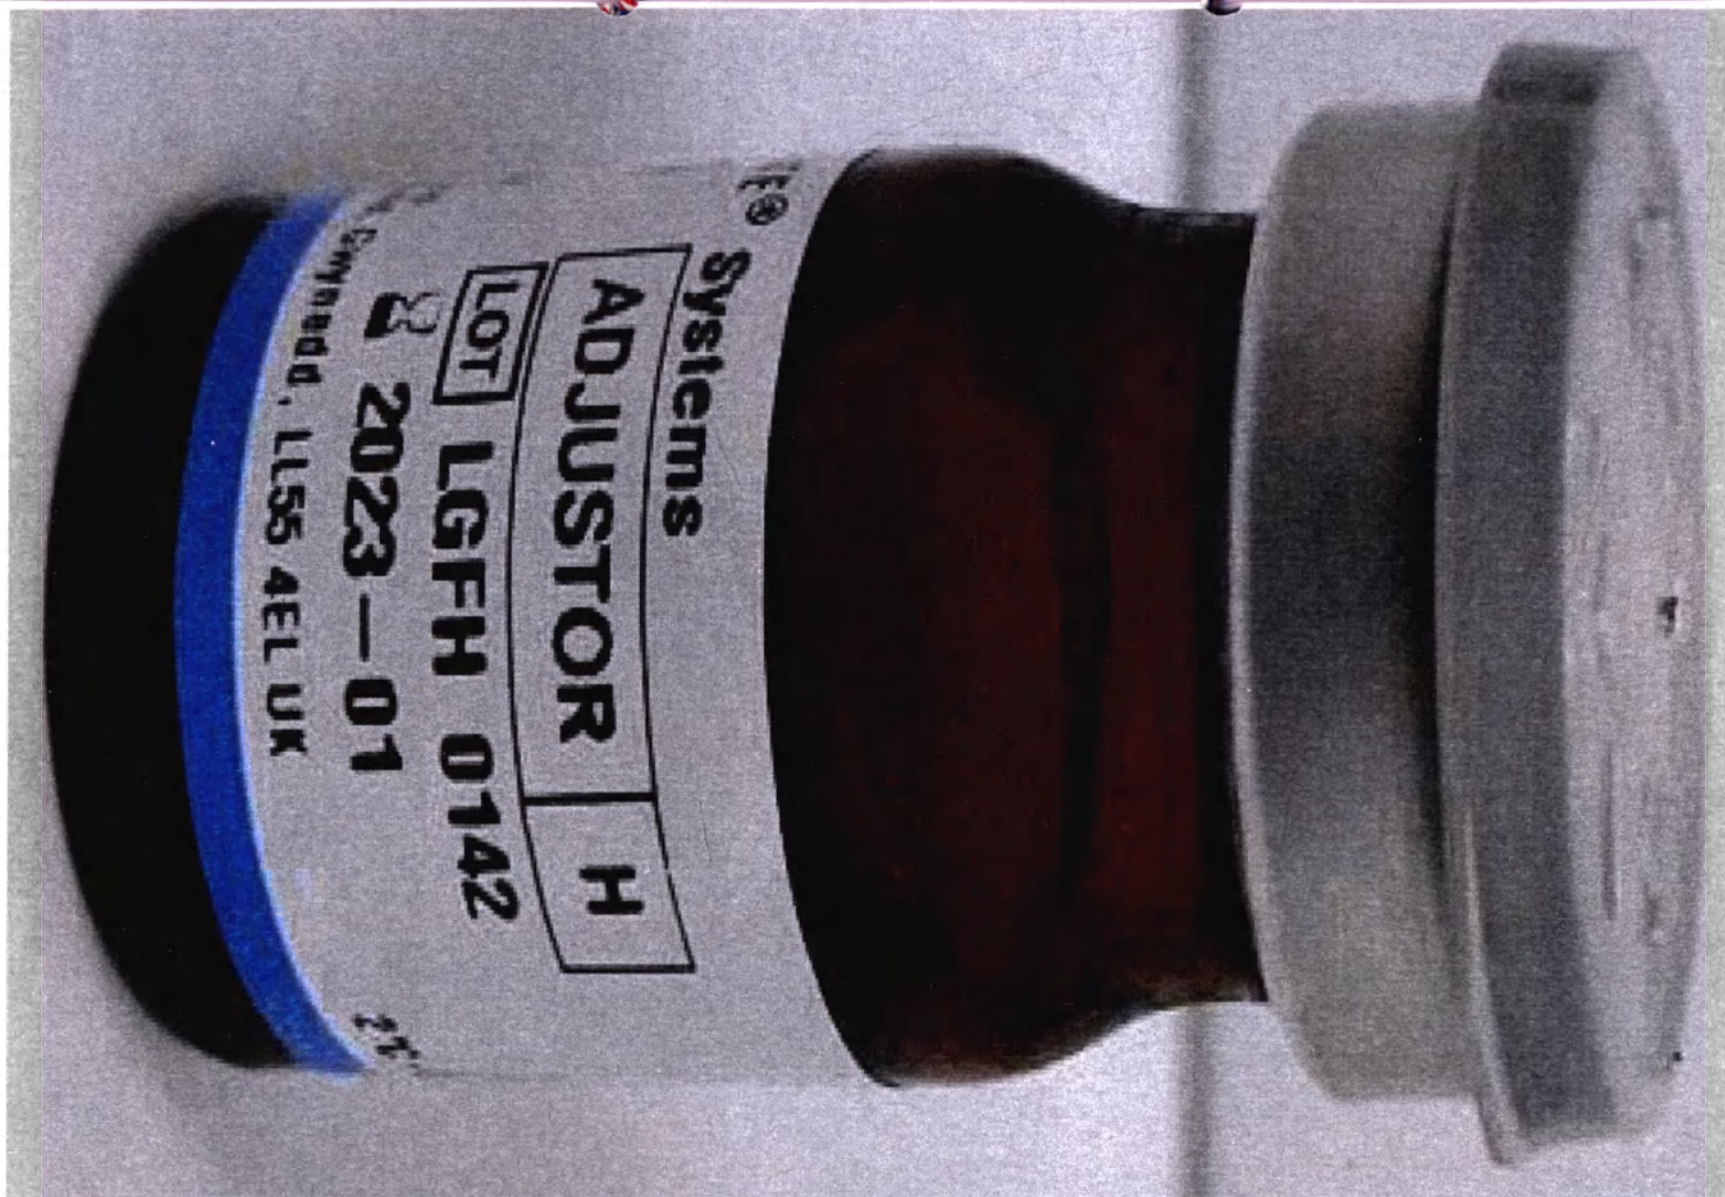

**Рисунок 9.** Калибратор с высокой концентрацией Набора реагентов для количественного определения инсулиноподобного фактора роста-1/IGF-1 на анализаторах иммунохемилюминисцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 IGF-1), общий вид 2



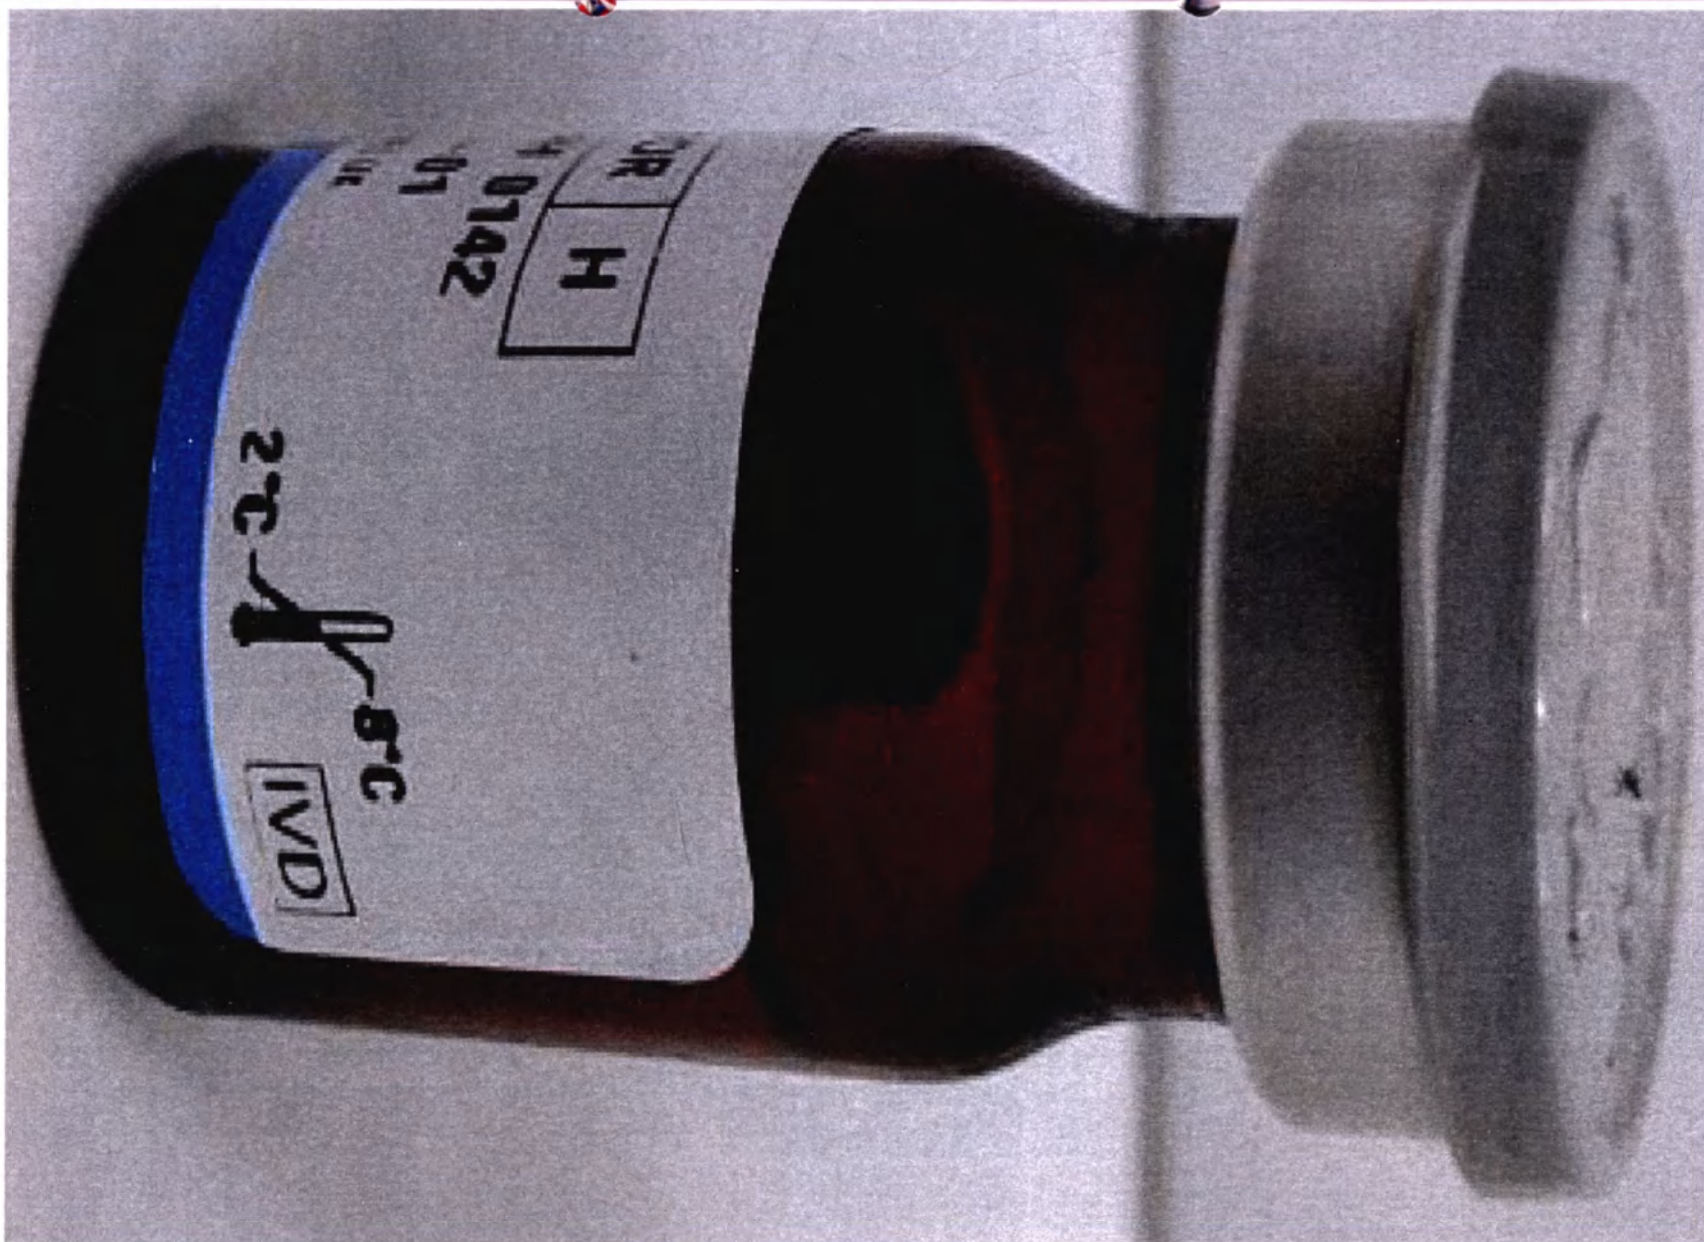


Рисунок 10. Калибратор с высокой концентрацией Набора реагентов для количественного определения инсулиноподобного фактора роста-1/IGF-1 на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 IGF-1), общий вид 3




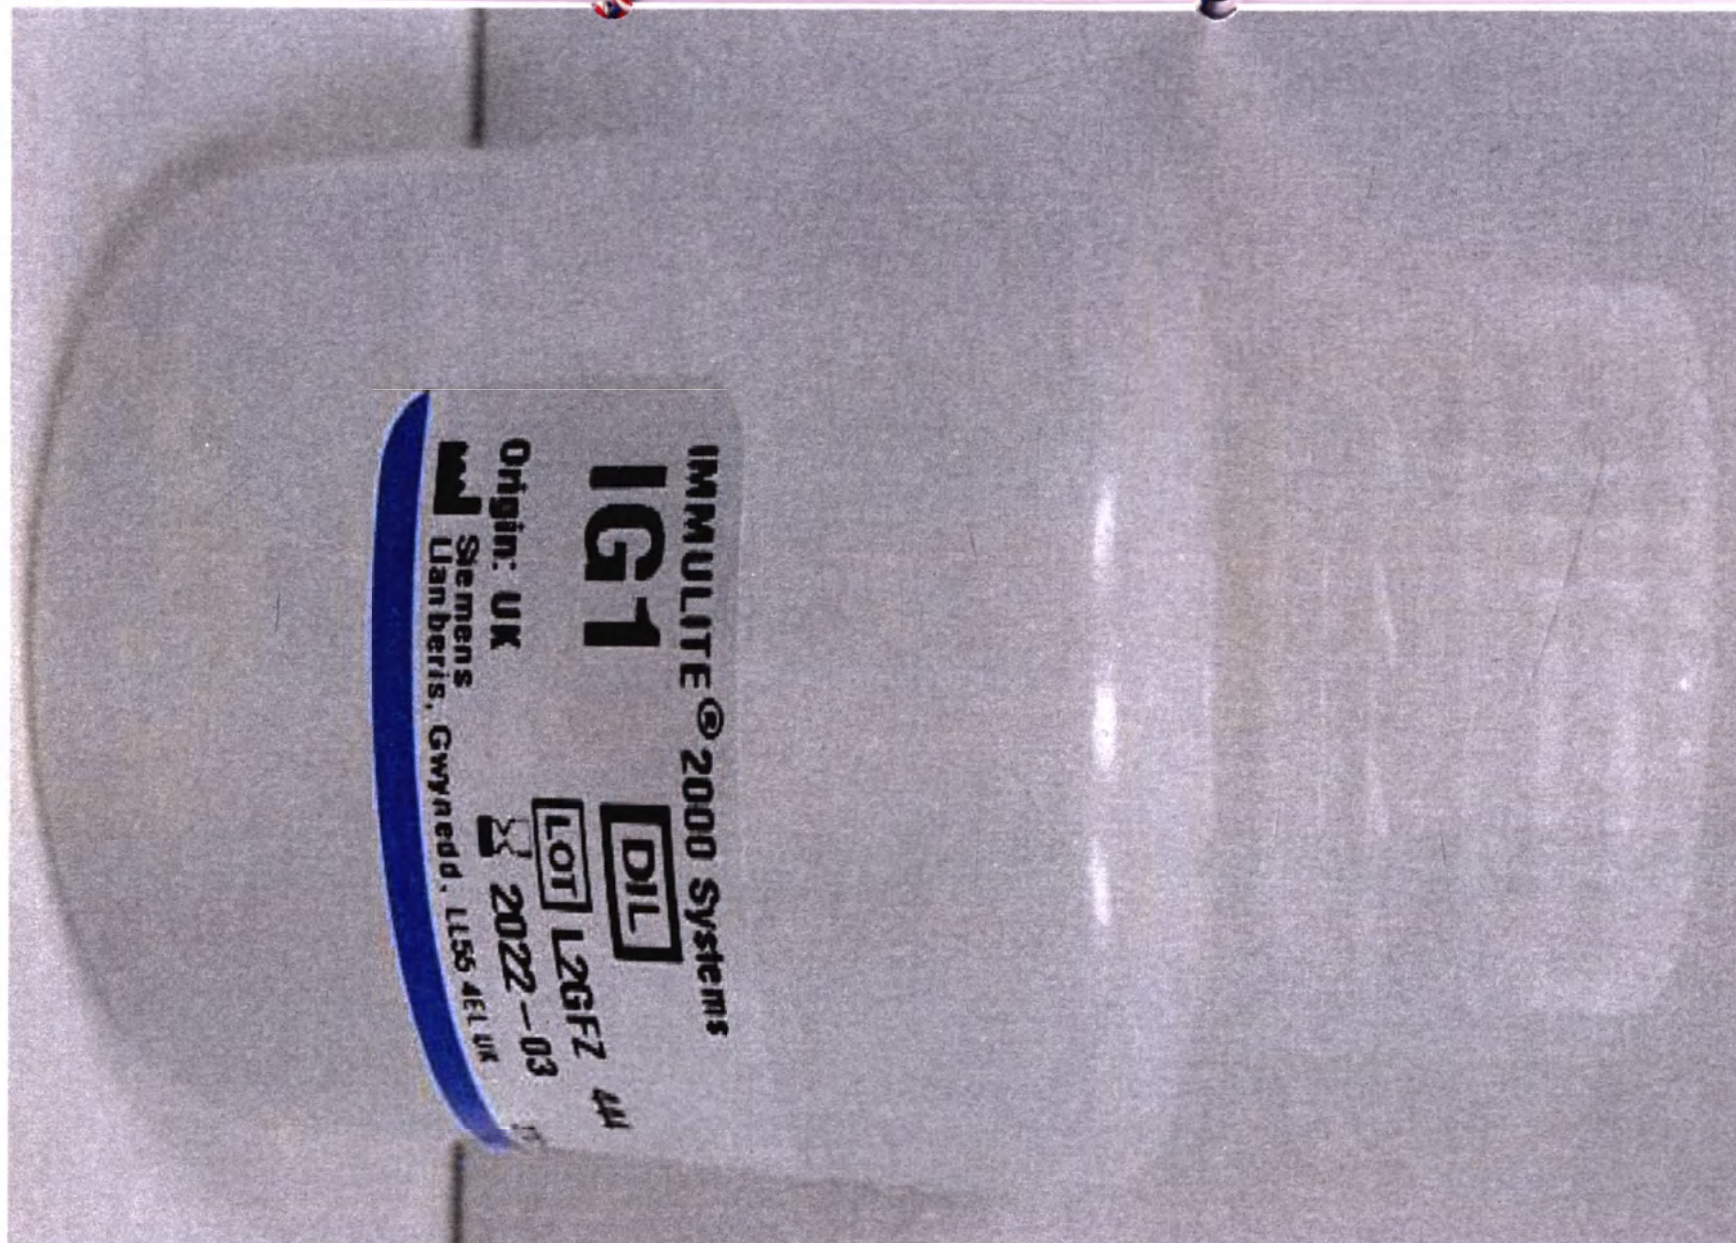


Рисунок 11. Разбавитель образца IGF-I Sample Diluent Набора реагентов для количественного определения инсулиноподобного фактора роста-1/IGF-1 на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 IGF-1), общий вид 1



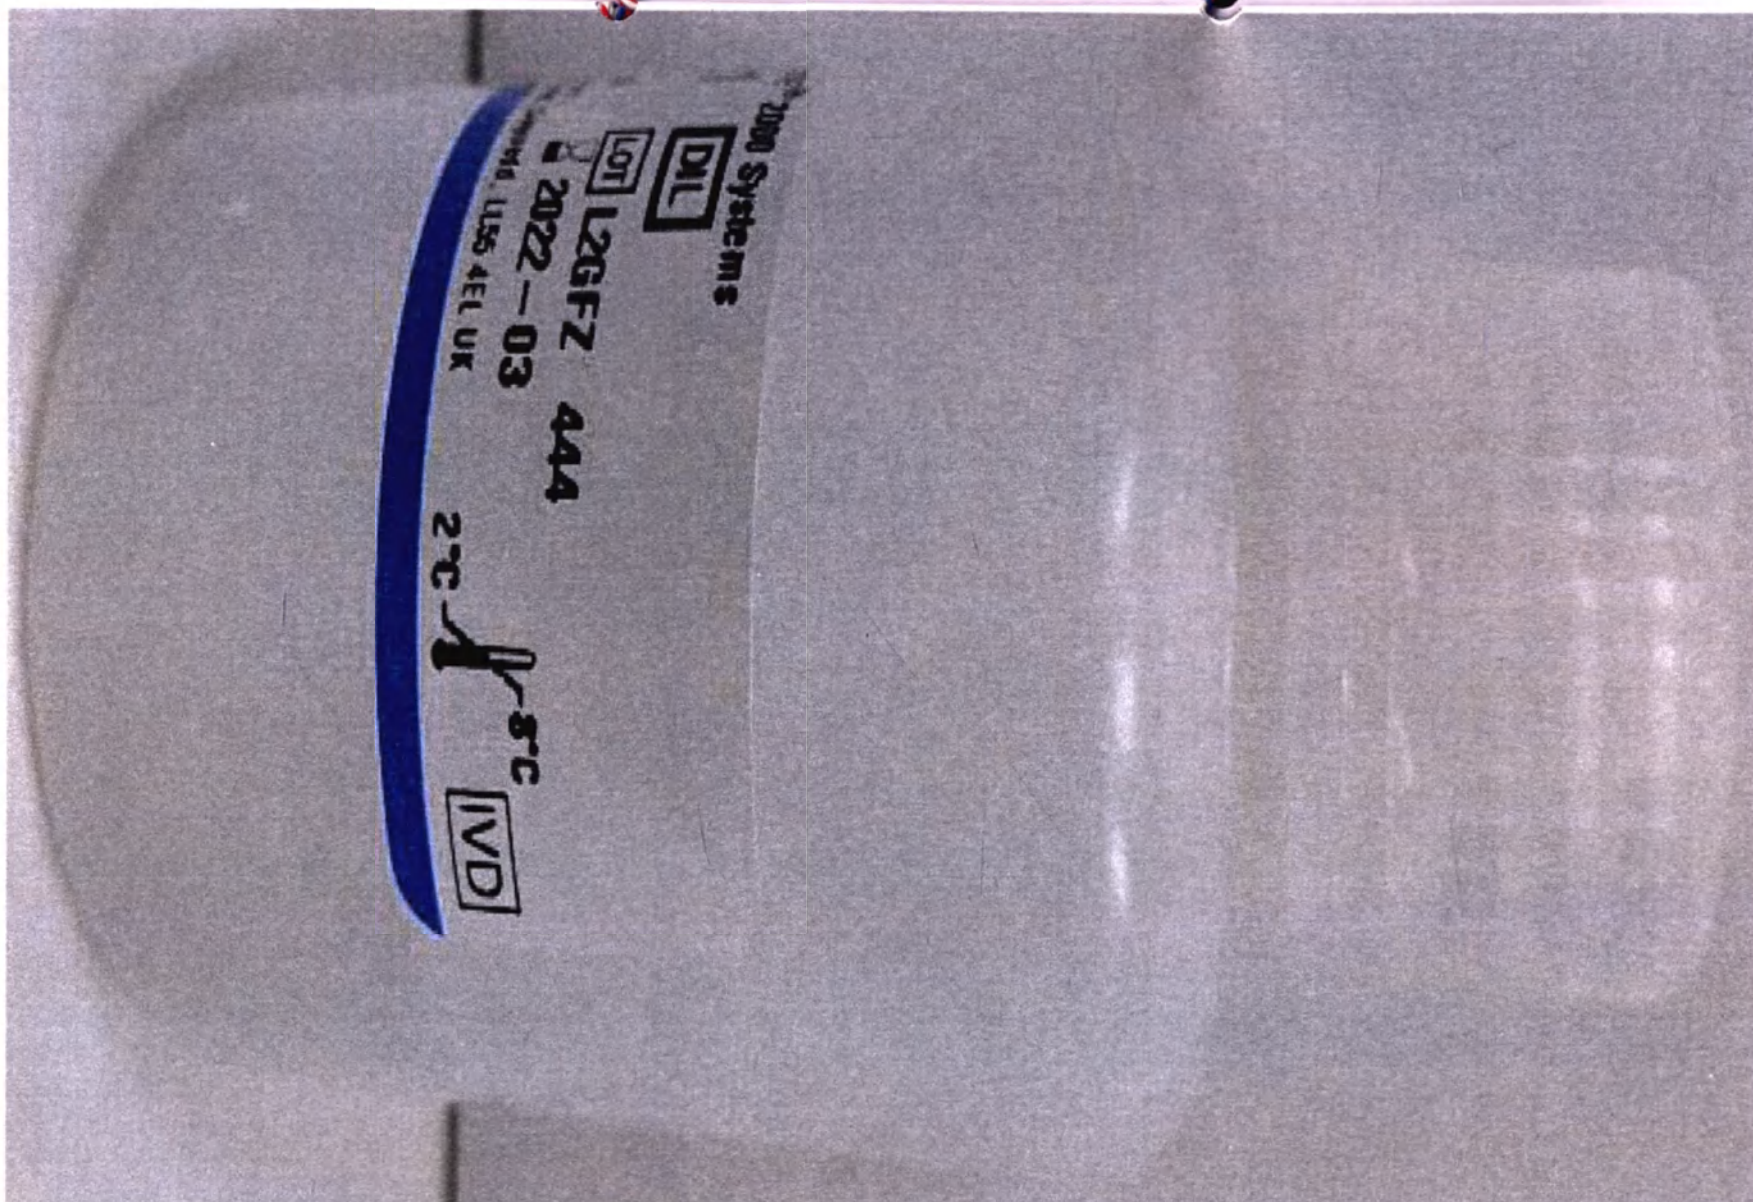

**Рисунок 12.** Разбавитель образца IGF-I Sample Diluent Набора реагентов для количественного определения инсулиноподобного фактора роста-1/IGF-1 на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 IGF-1), общий вид 2





Рисунок 13. Стикеры Набора реагентов для количественного определения инсулиноподобного фактора роста-1/IGF-1 на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии Immulite 2000 (Immulite 2000 IGF-1)



11128543

Набор реагентов для количественного определения инсулиноподобного фактора роста-1/IGF-1 на анализаторах иммунохемилюминисцентных серии Immulite 2000 (Immulinite 2000 IGF-1)

Информация о производителе и стране производства:  
см. на упаковке

Регистрационное удостоверение:

№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

## ТОЛЬКО ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Код партии, срок годности, условия хранения и др. символы указаны на оригинальной упаковке

Антитела к ВИЧ 1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

**Состав:** указан на оригинальной упаковке и в инструкции по применению

**Авторизованный представитель производителя на территории Российской Федерации:**

ООО «Сименс Здравоохранение», 115093, Москва, ул. Дубининская, 96

**Рисунок 14.** Пример макета русскоязычной маркировки Набора реагентов для количественного определения инсулиноподобного фактора роста-1/IGF-1 на анализаторах иммунохемилюминисцентных серии Immulinite 2000 (Immulinite 2000 IGF-1)





Всего прошито и пронумеровано  
15 листа (ов).

ООО «Сиенс Здравоохранение»