

A vertical red ribbon with black circular fasteners at the top and bottom, positioned on the left side of the page.

**Фотографические изображения
общего вида медицинского изделия**

**Анализатор для автоматизации
иммуногематологического тестирования
образцов крови человека**






1.2. Монитор с сенсорной панелью (Elo Touch Screen Monitor)



1.3. Сканер штрих-кодов запрограммированный (BarCode Scanner Programmed)




Т.4. Рычаг для установки контейнеров (Bottle loading lever)

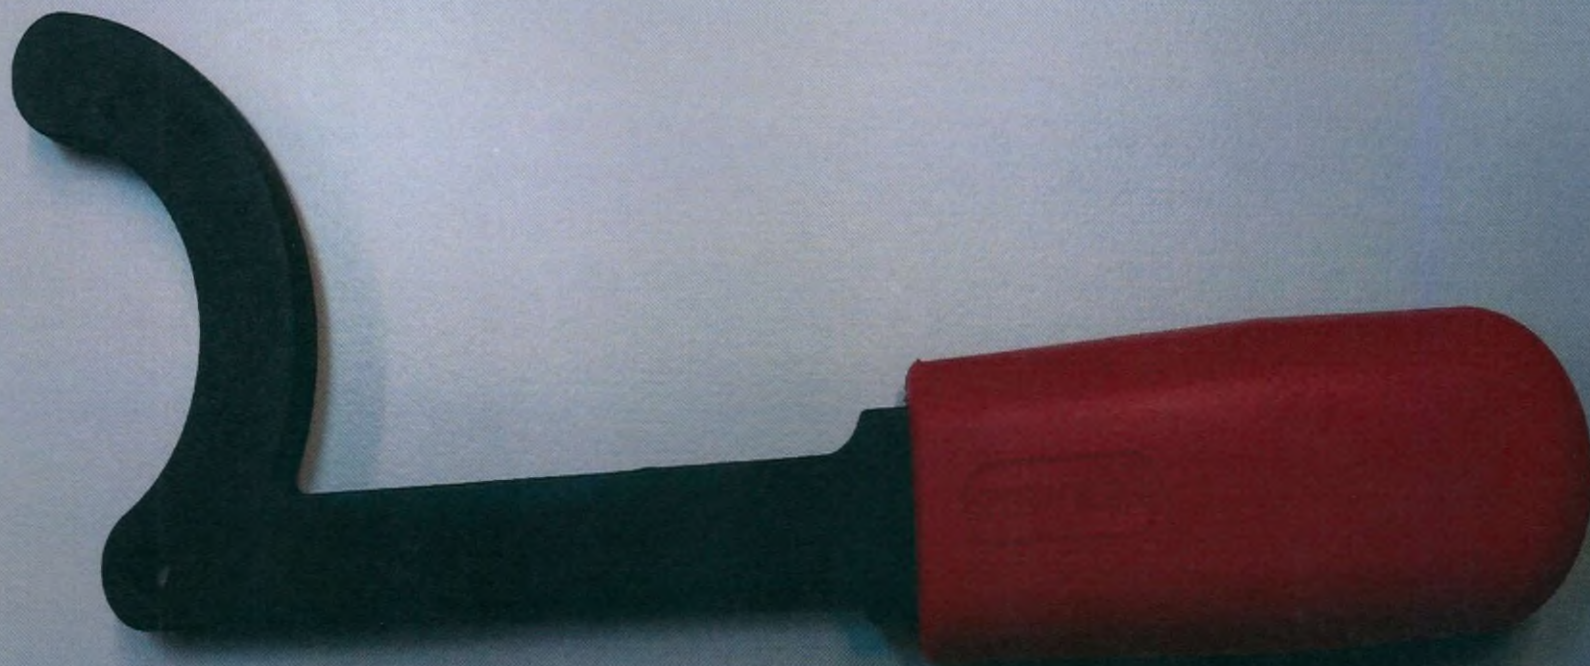


1.5. Документация пользователя на ORTHO VISION на USB (User Docs USB)



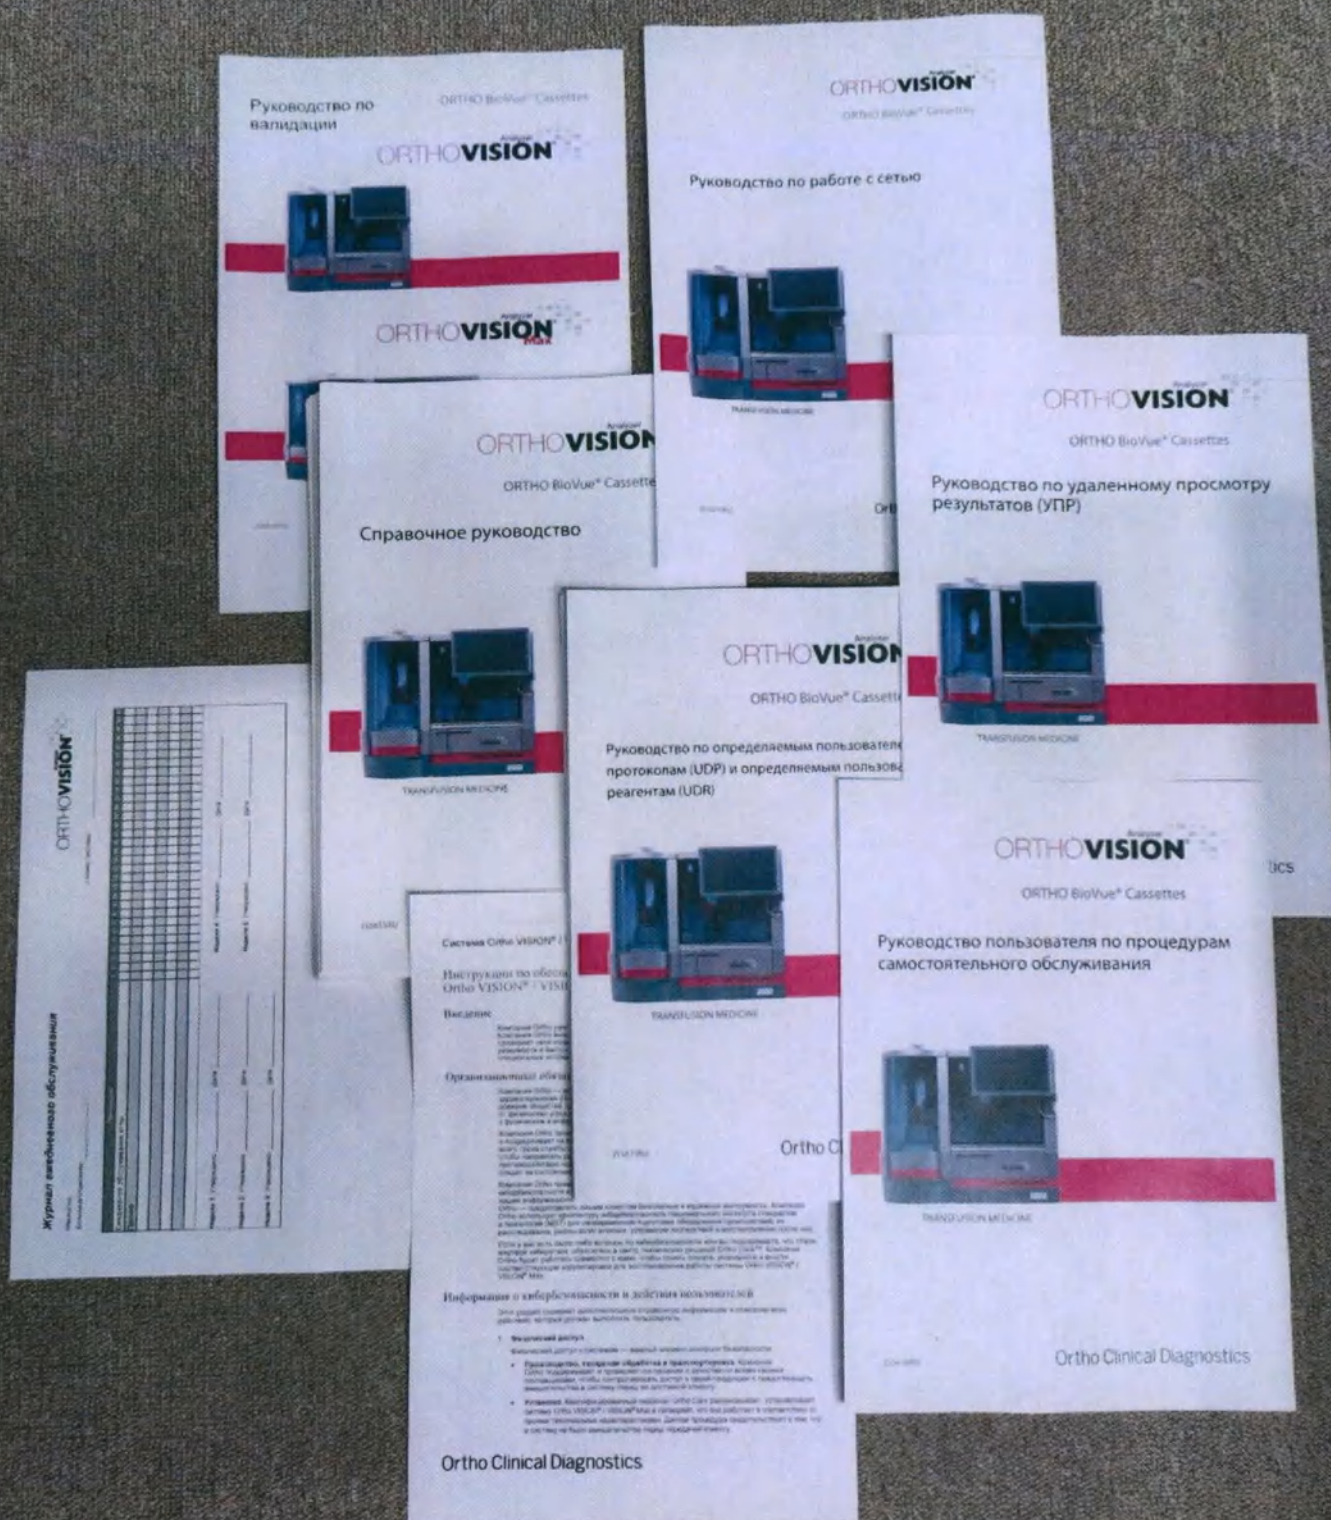

1.7. Кабель питания с европейским штепселем (Power Cable)

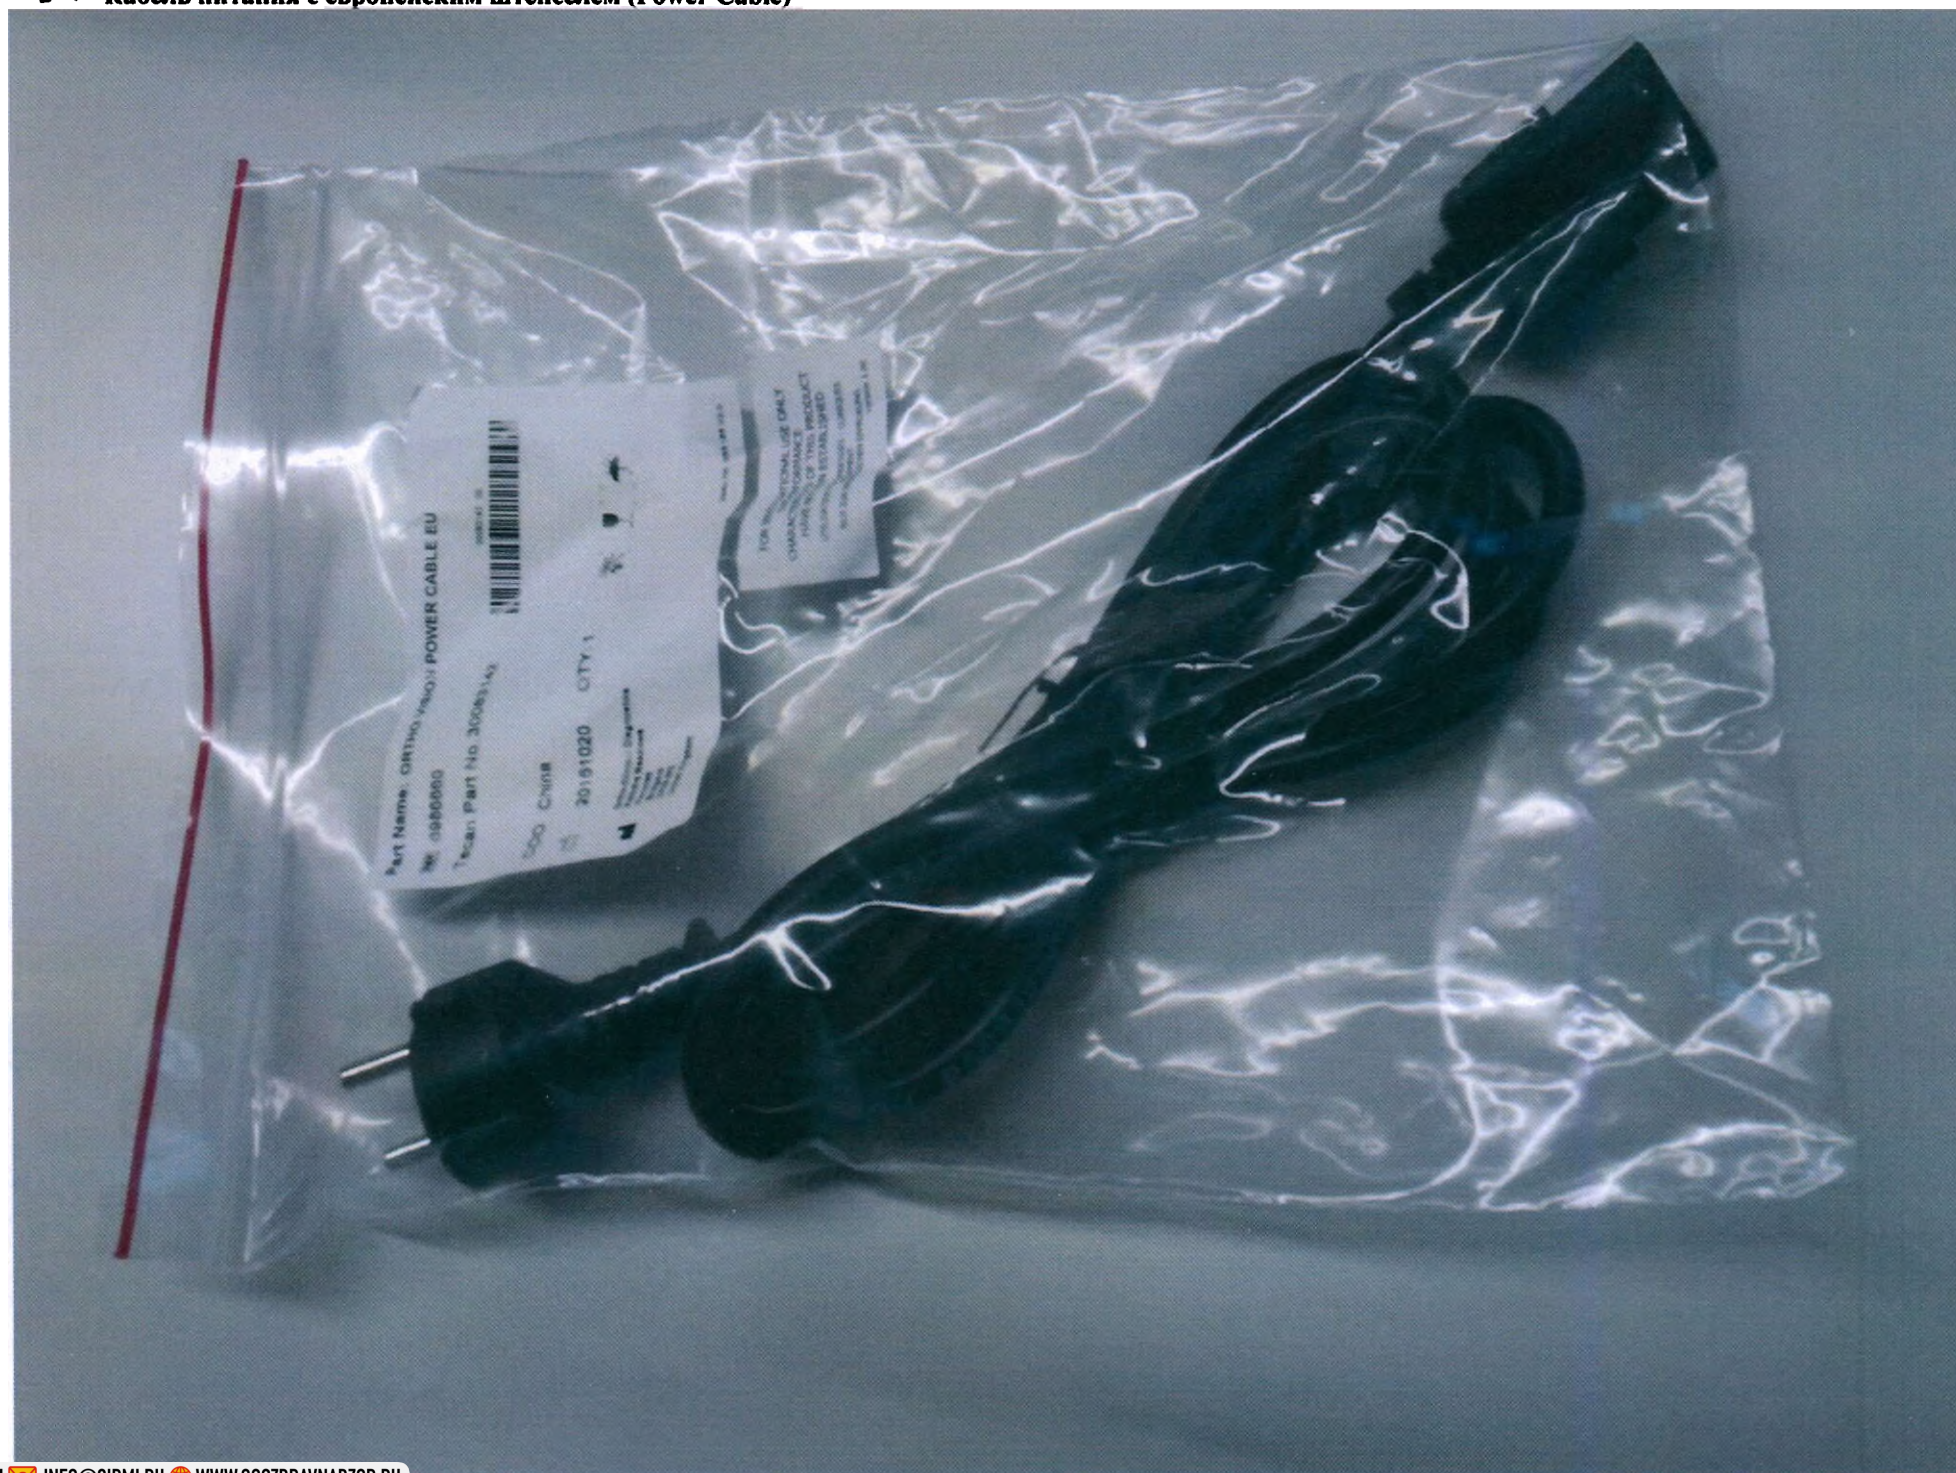



Т. 9. Дополнительный контейнер для физ.раствора (Saline Container IWAT)








Т.12. Контейнер для жидких отходов (Liquid Waste Container)




1.13. Контейнер для отходов (MTS/BioVue Disposal Container)




1.14. Контейнеры для системных жидкостей (Liquid Wash Container)

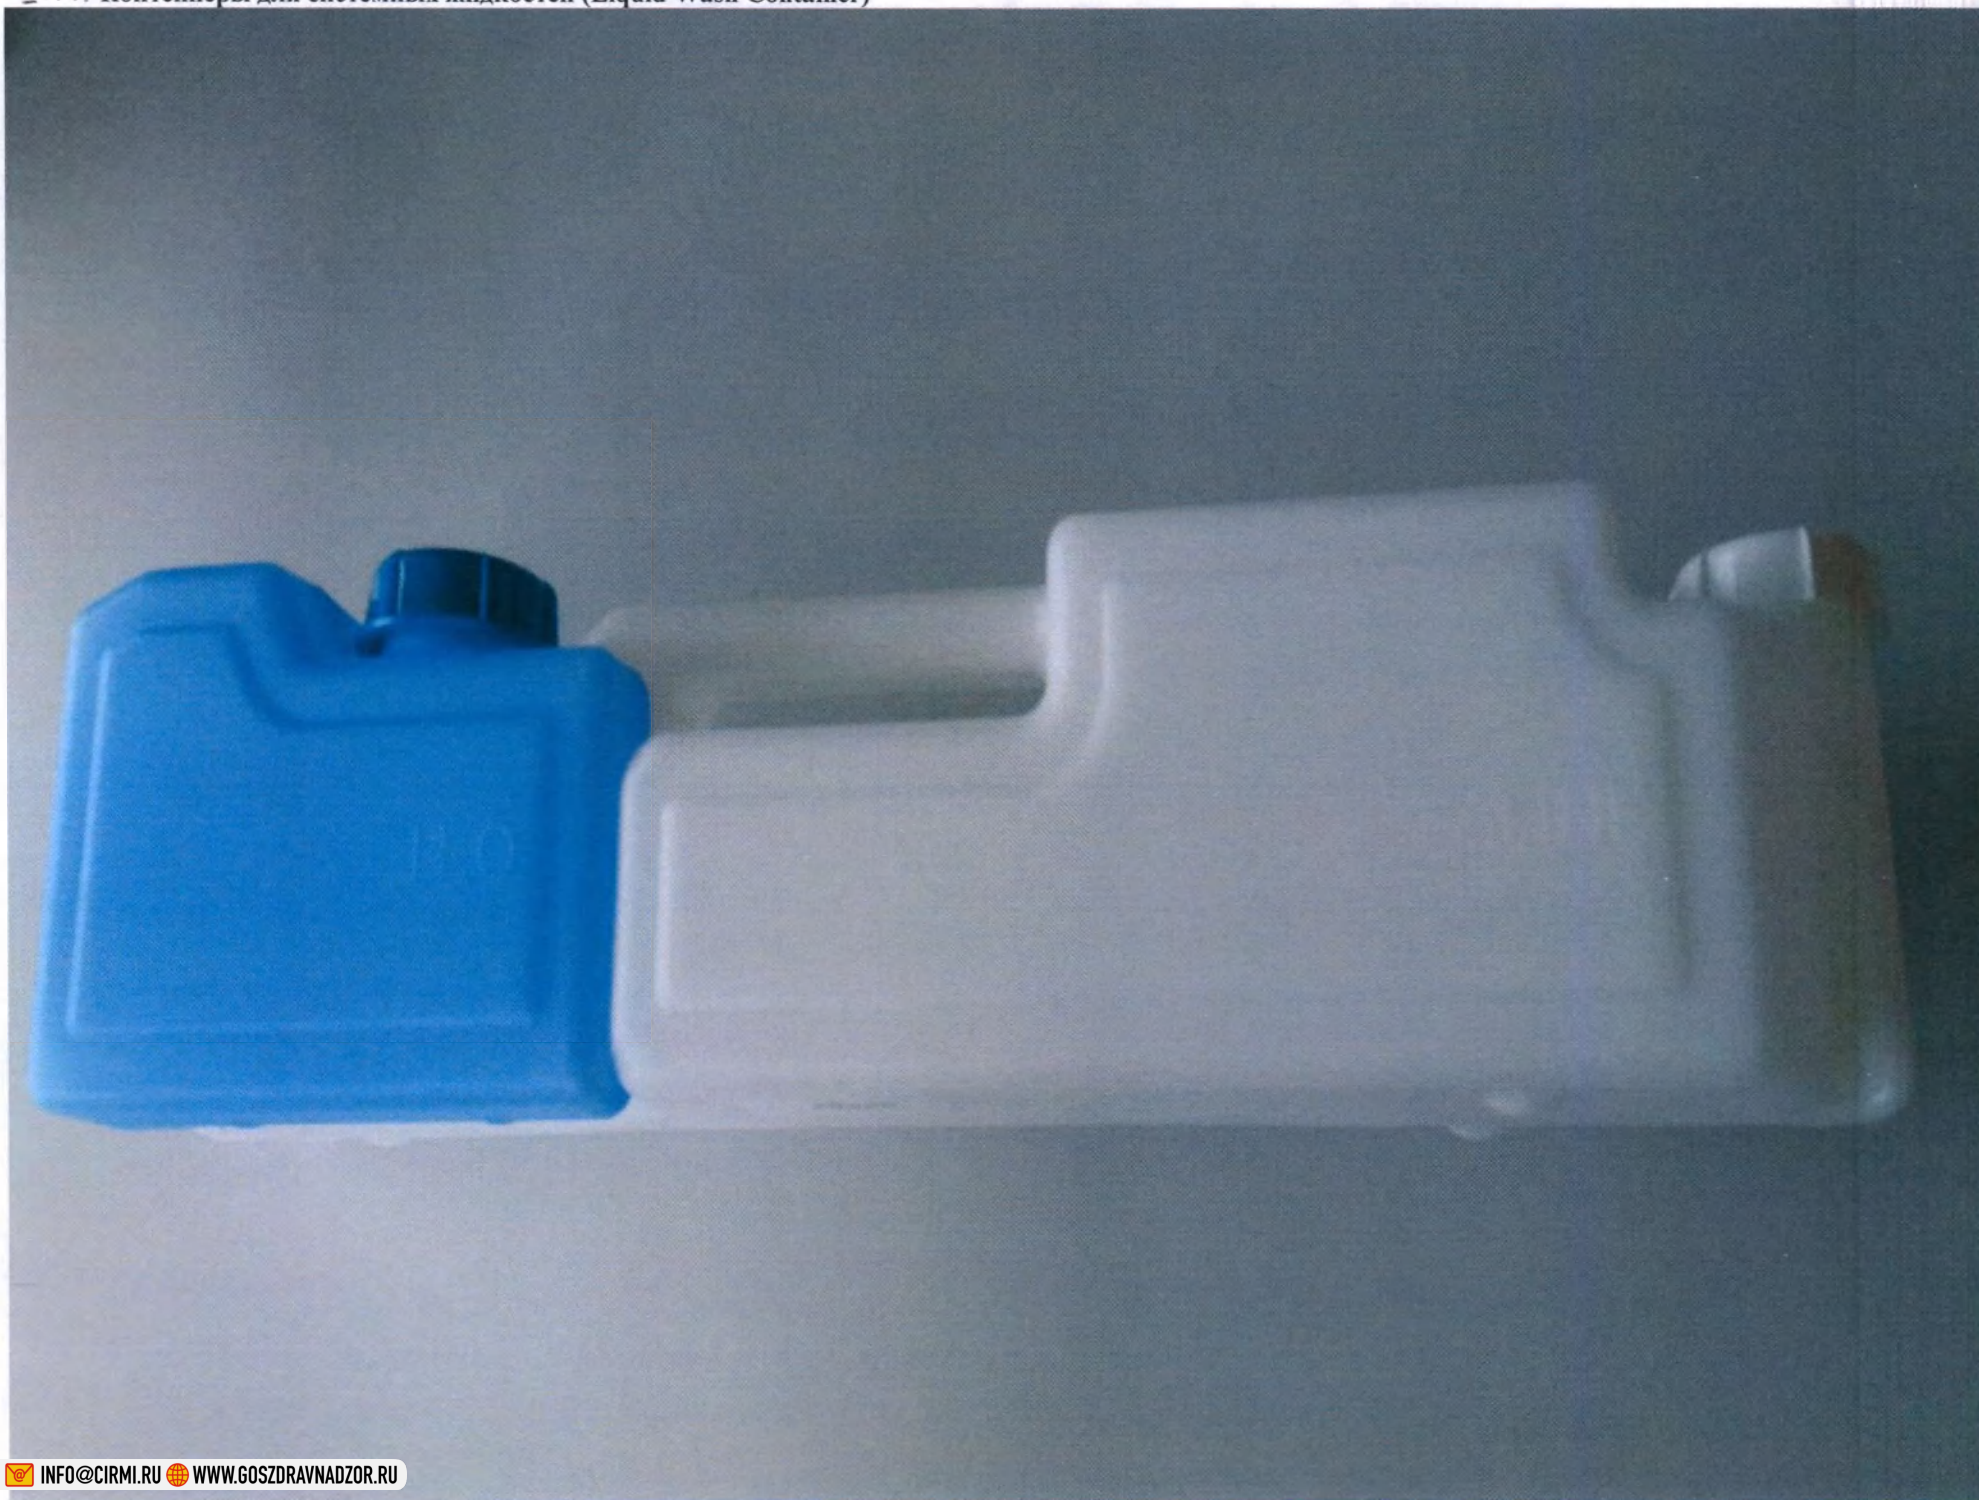



Г.16. Крышки для контейнера с водой (Lid bottle blue H2O – Blue)

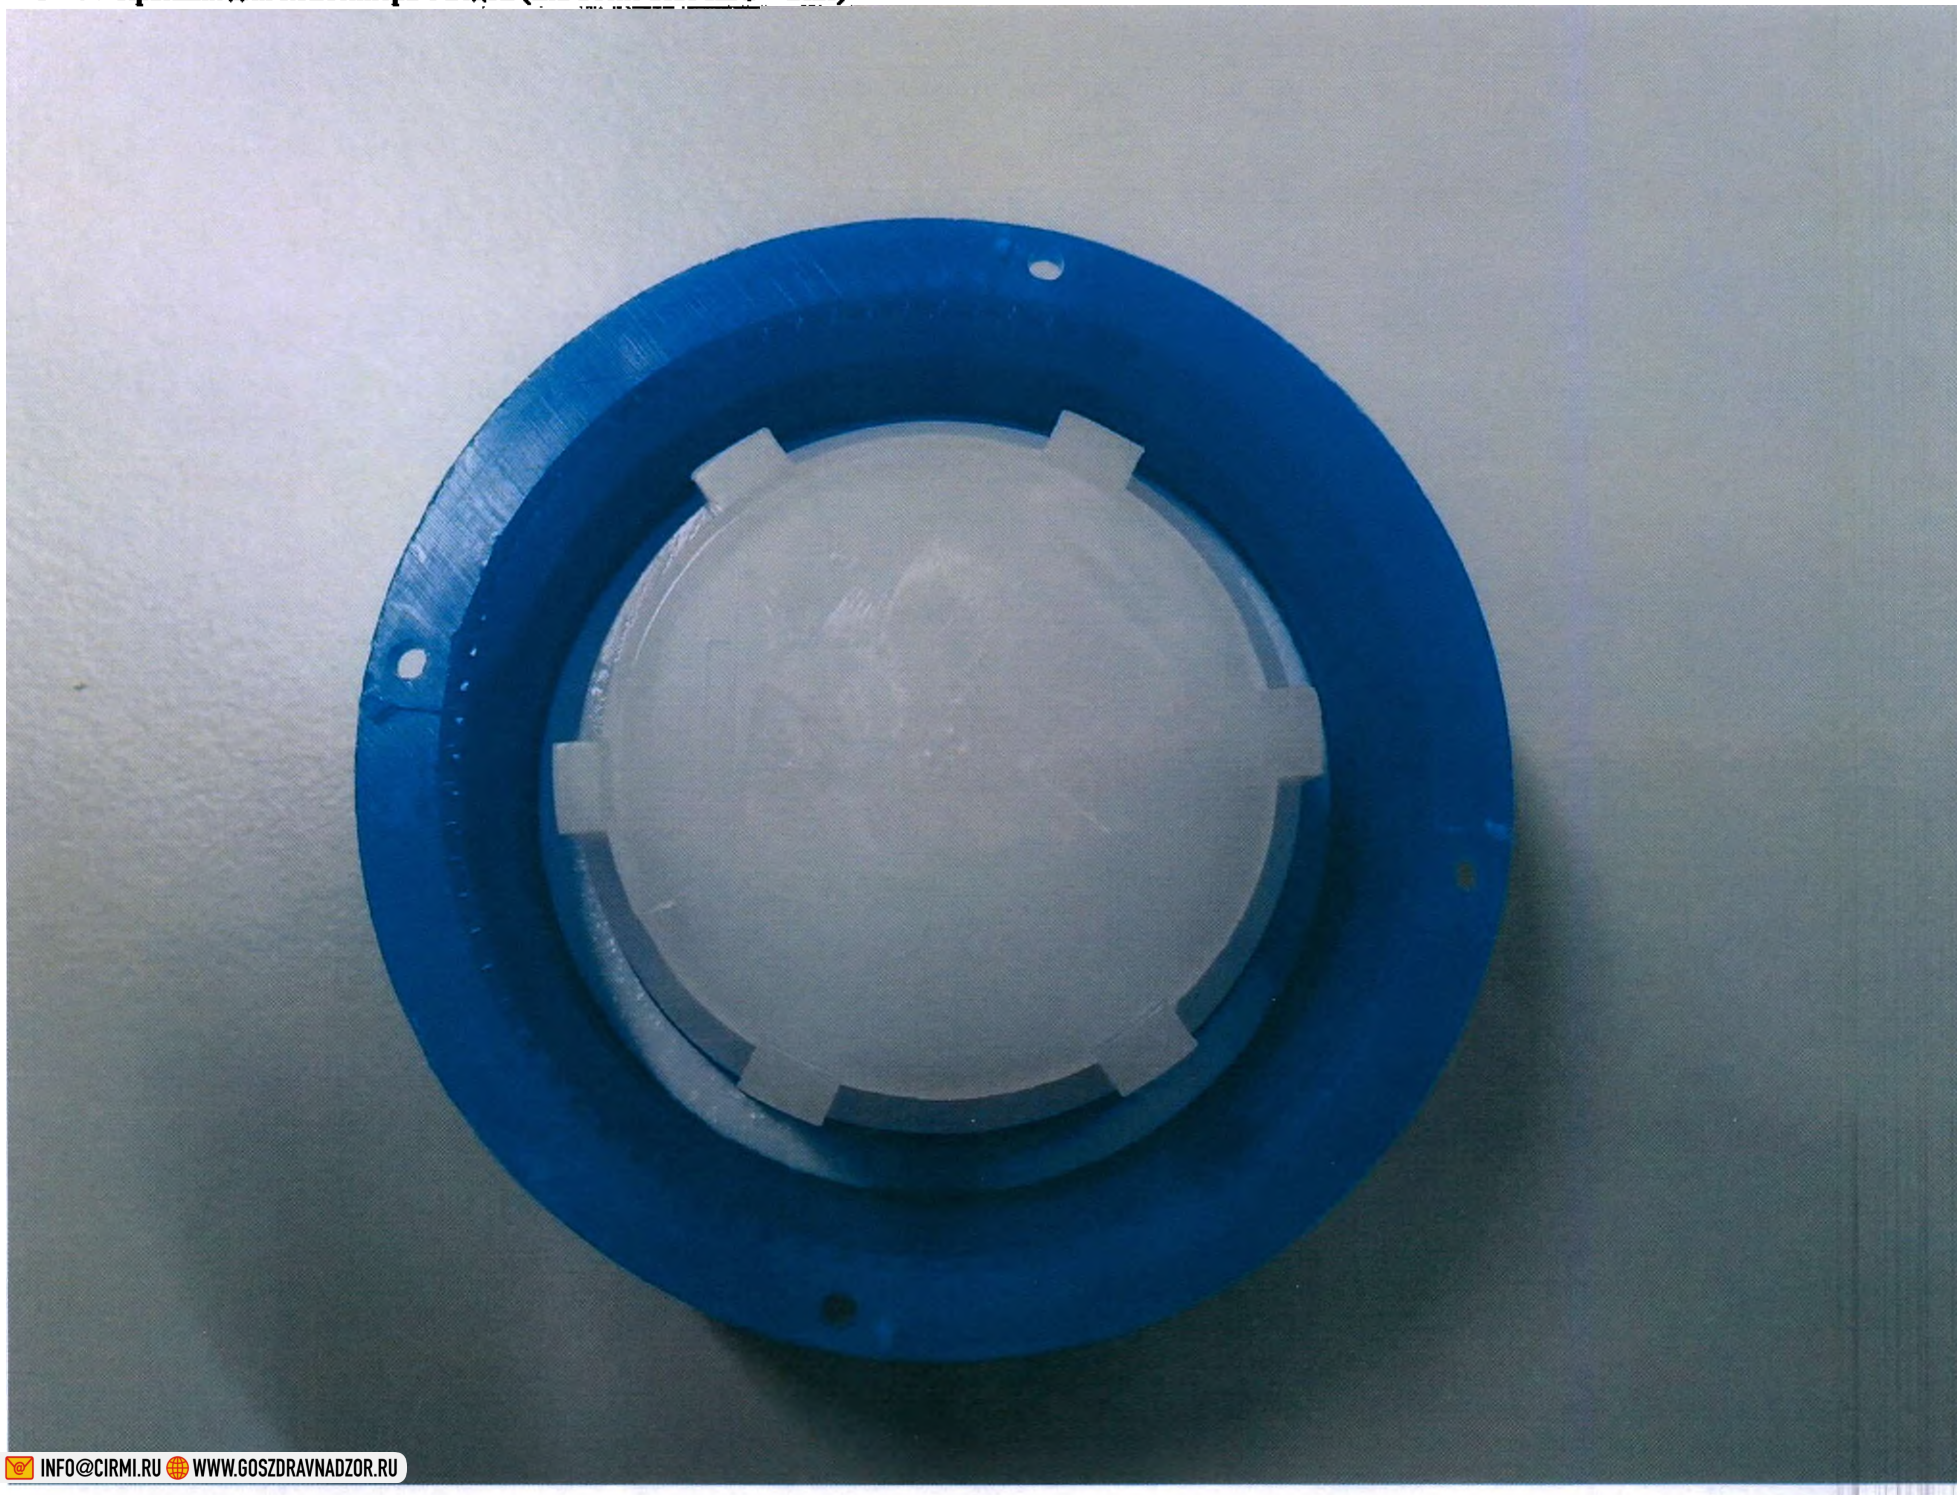

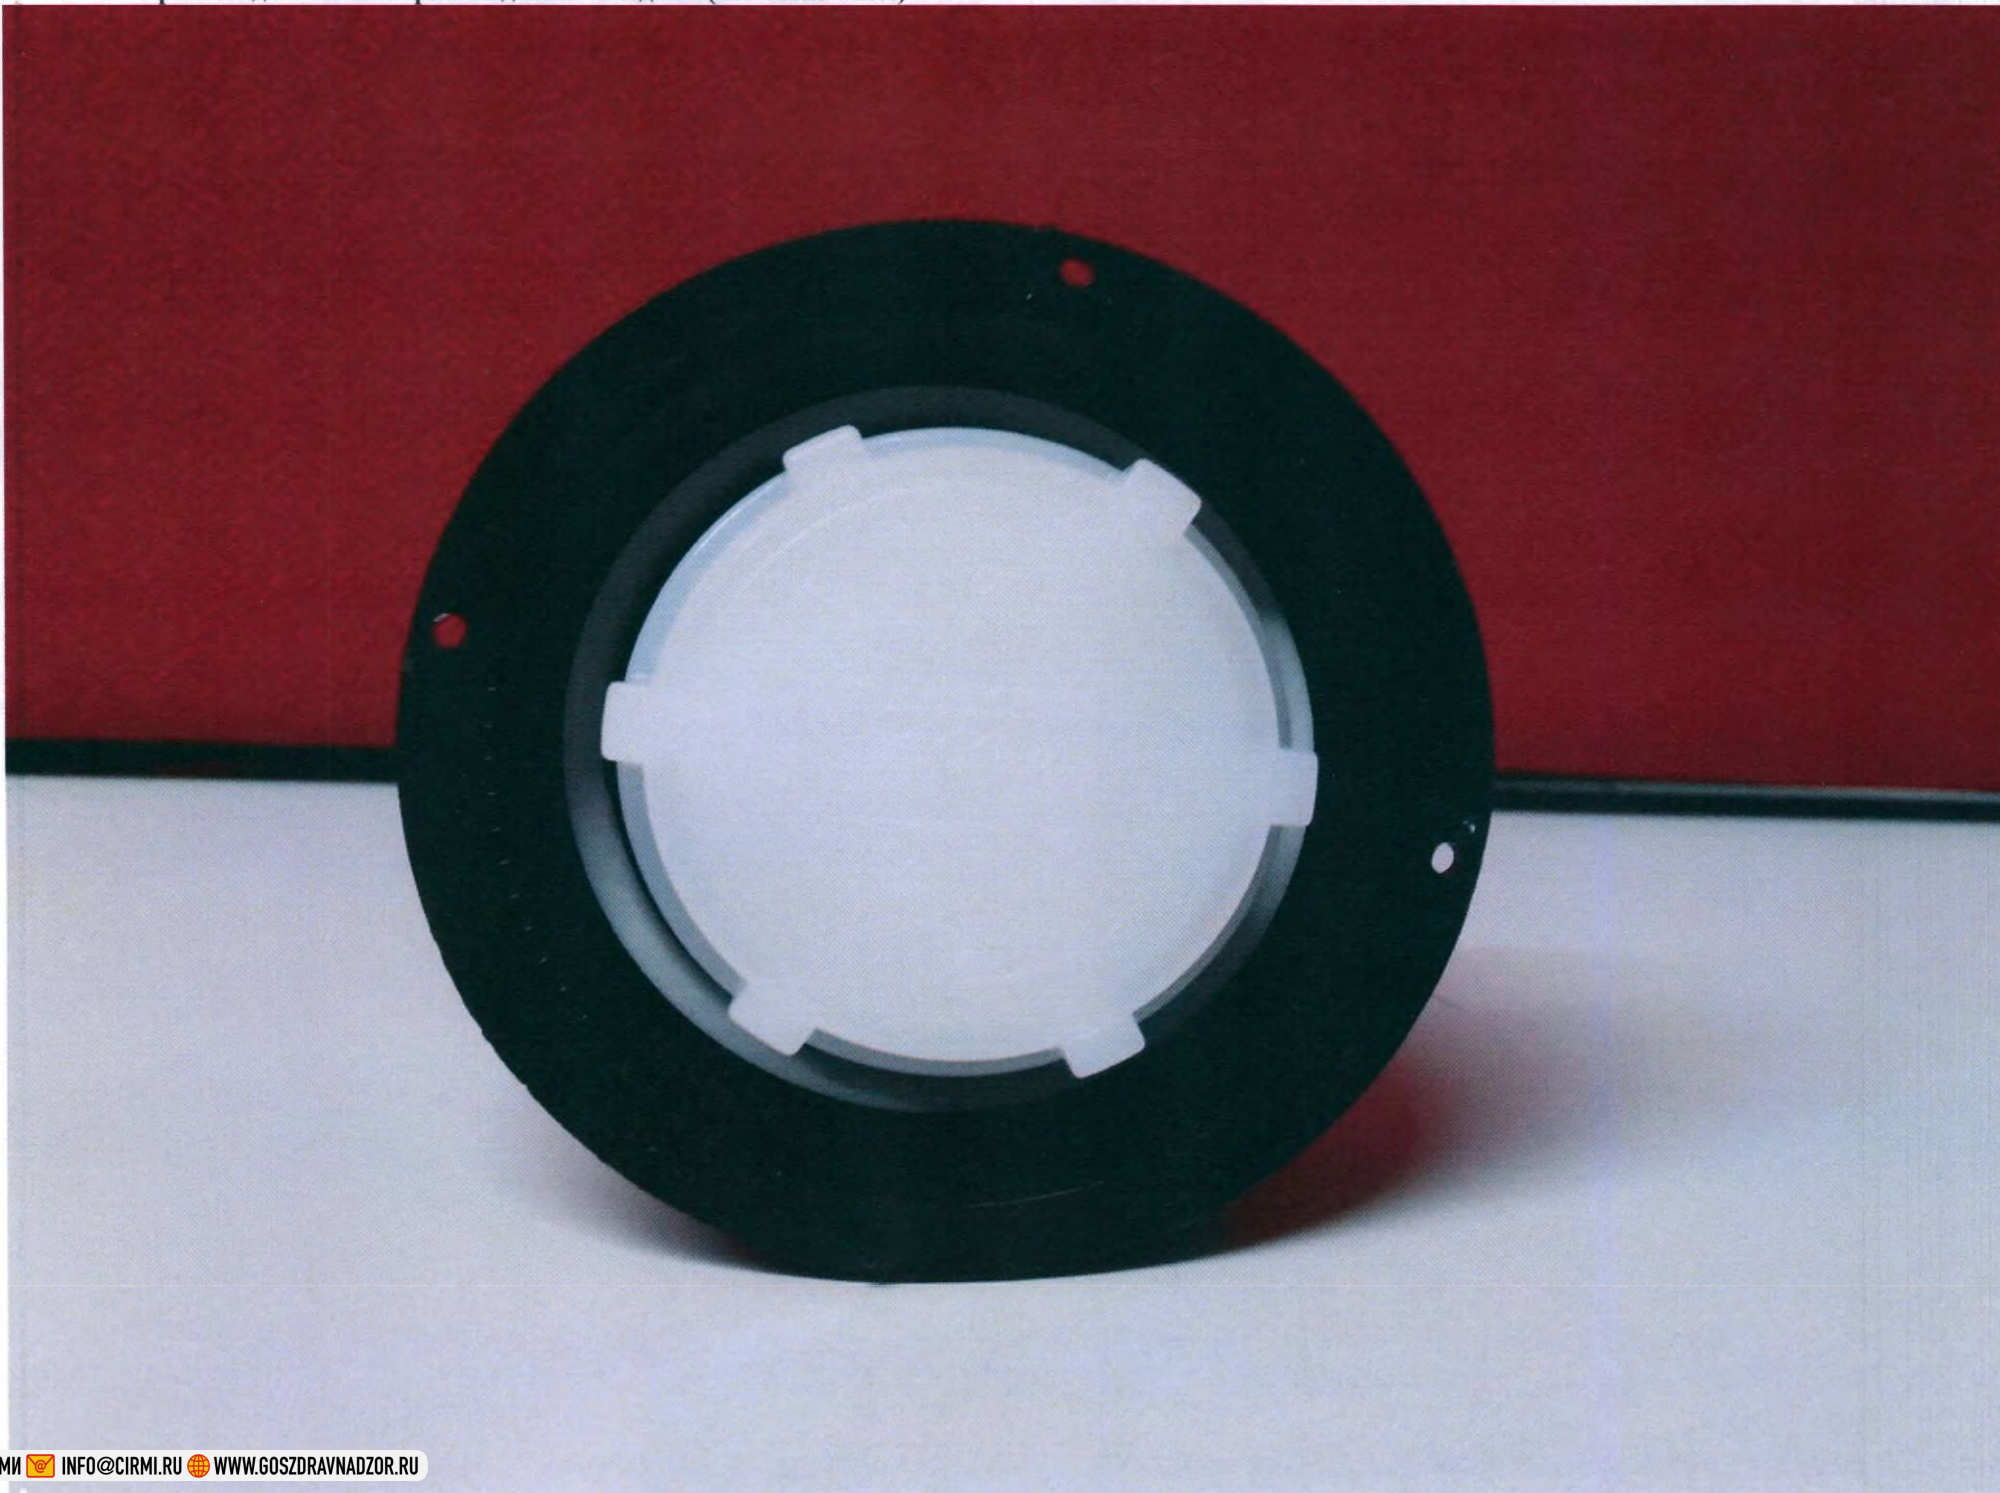


І.17. Крышки для контейнера с физ.раствором (Lid for saline bottle – White)

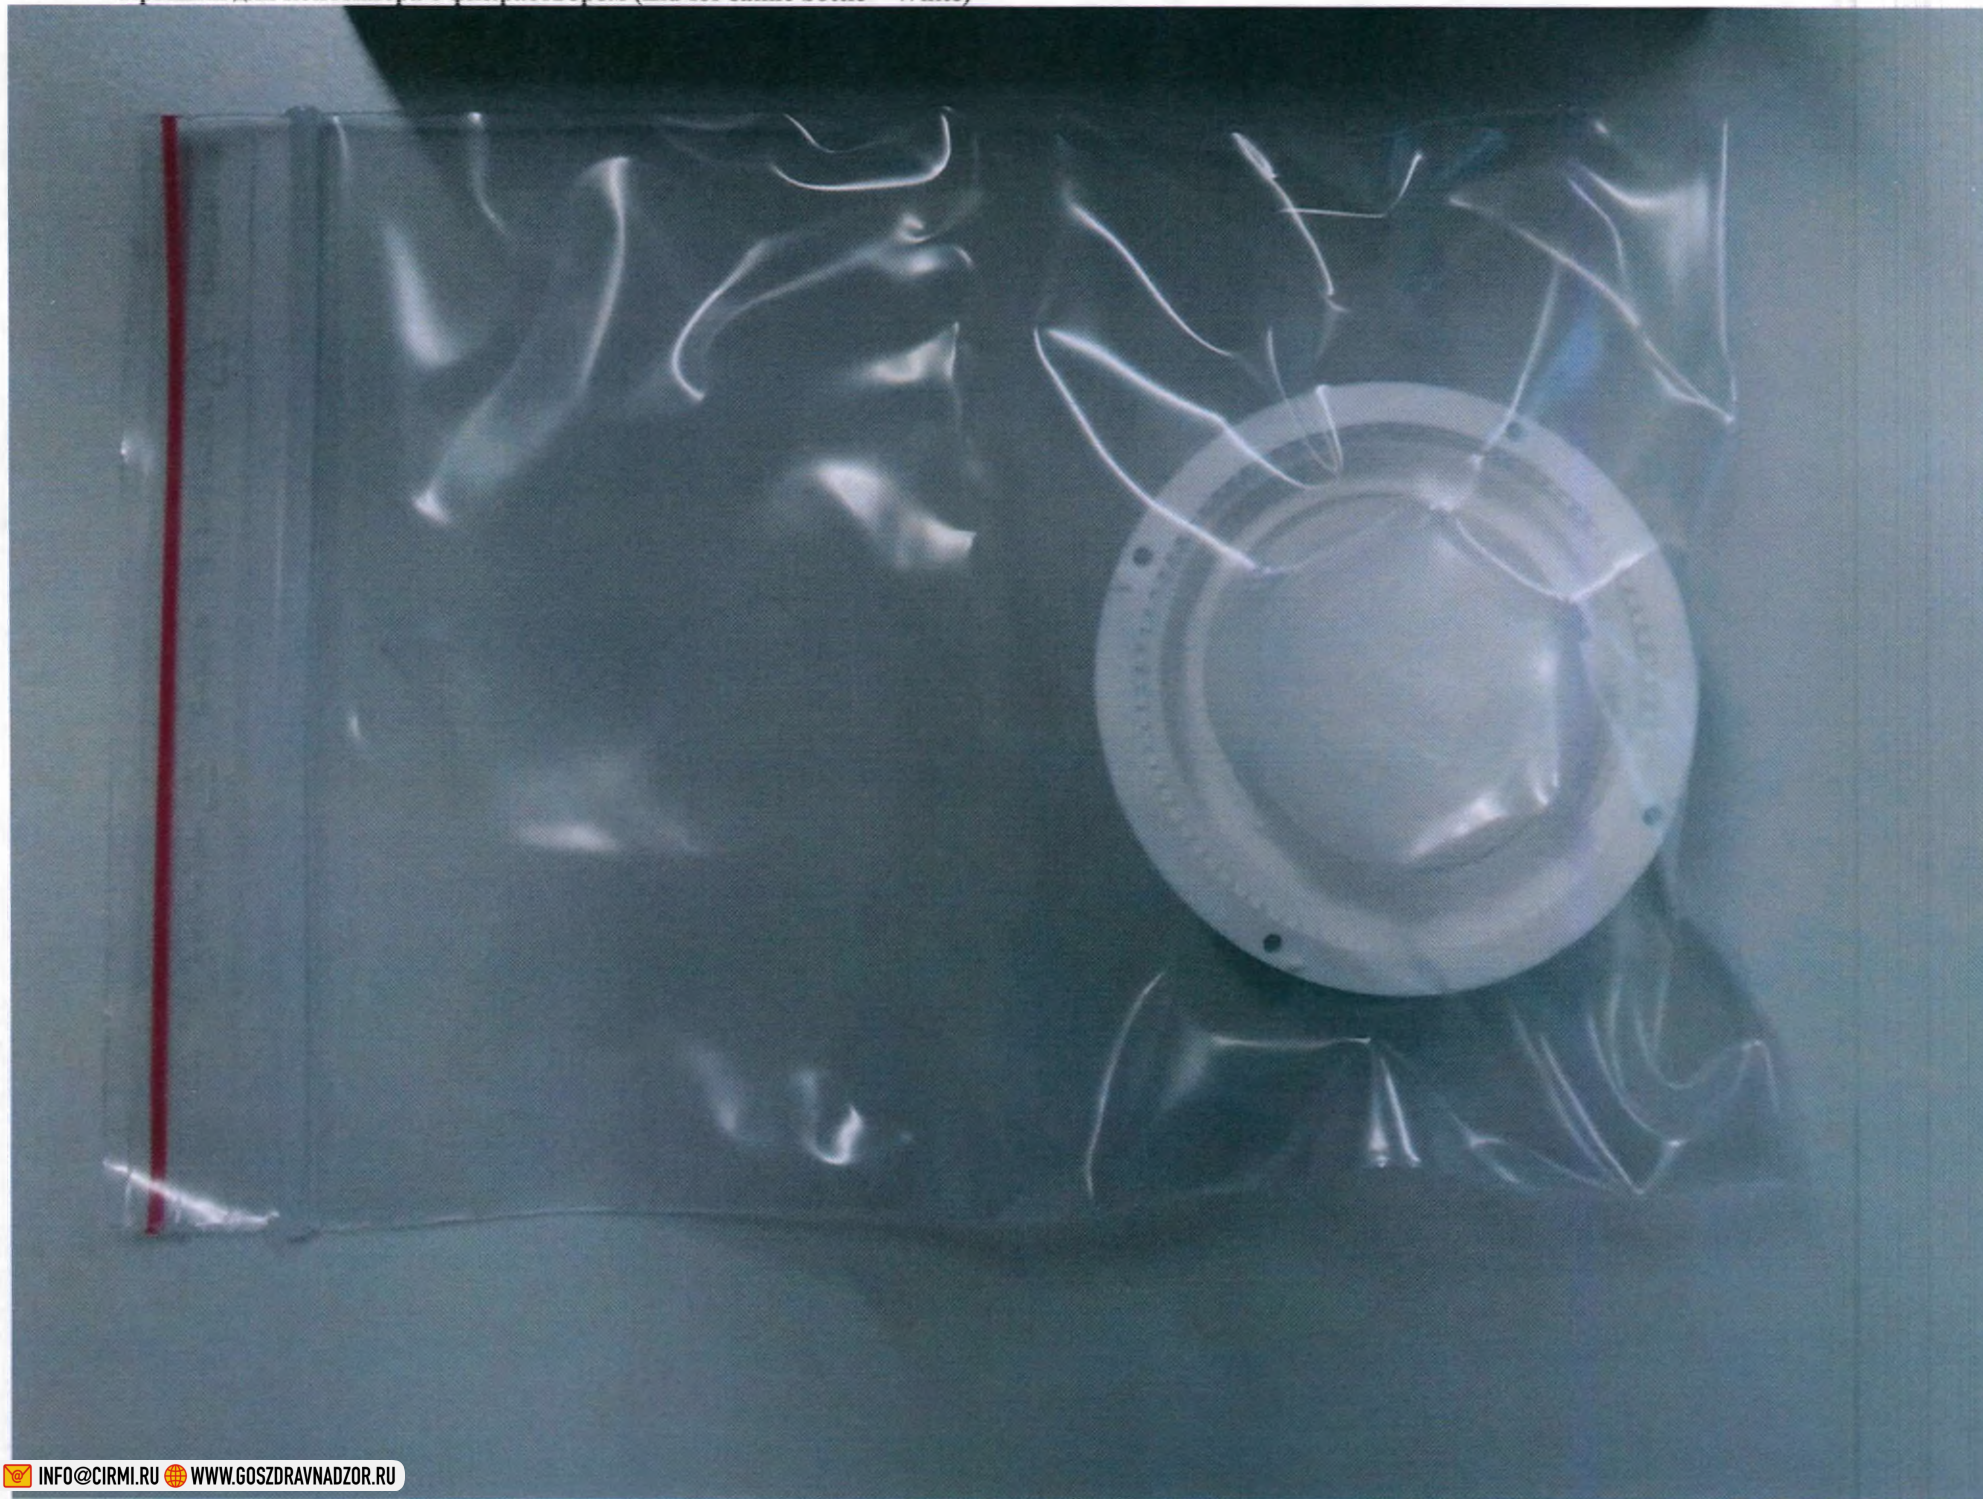

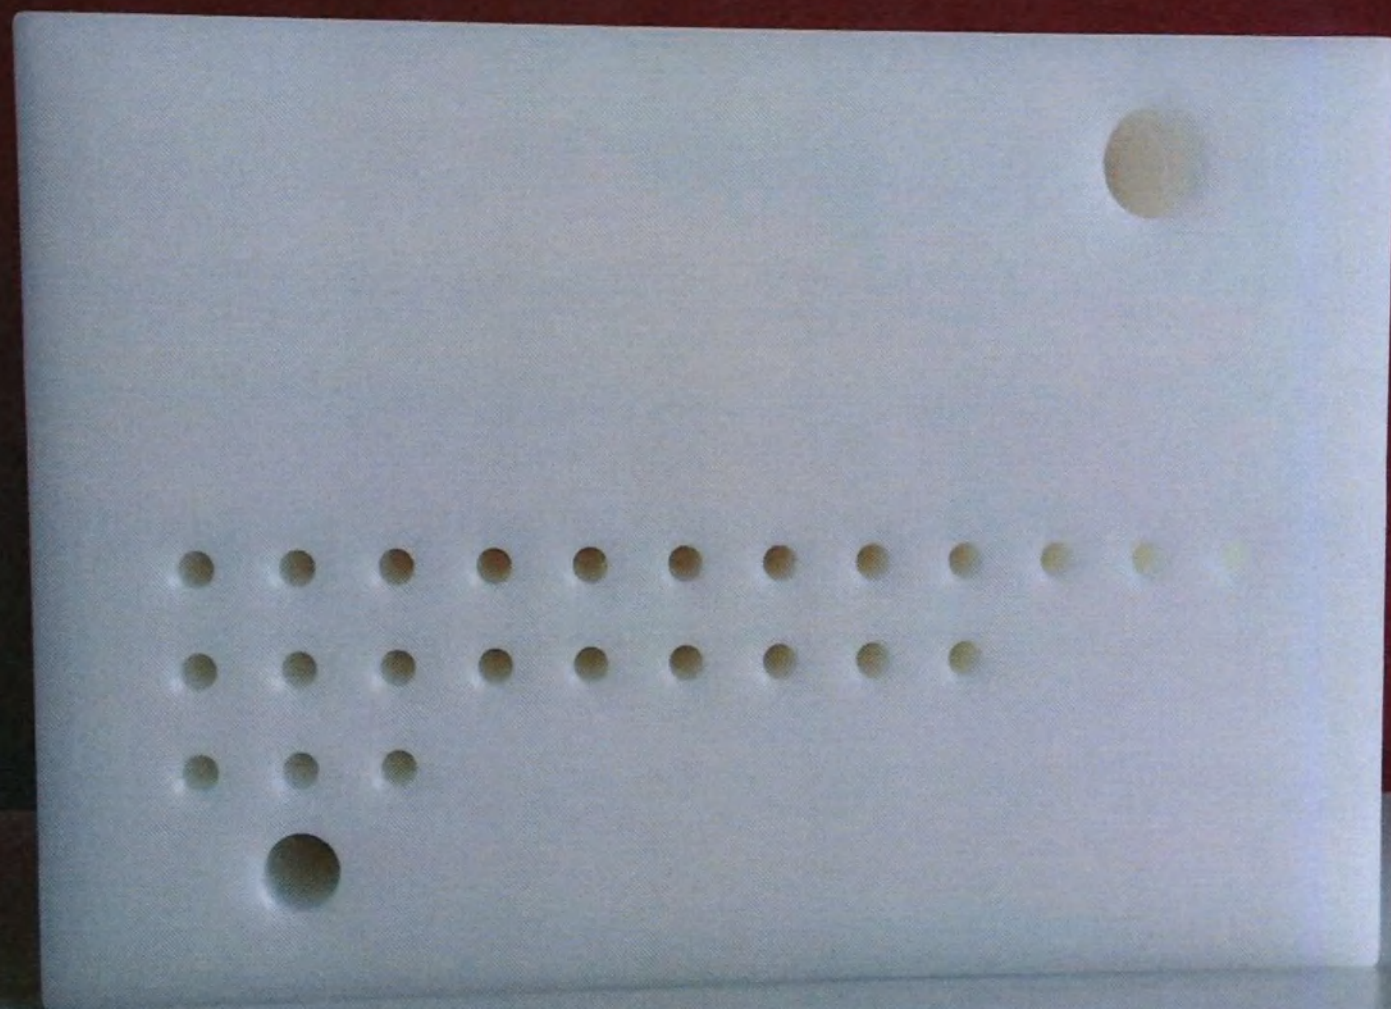



Т.21. Наборы для вскрытия BioVue кассет (Punch Tool Set BioVue)

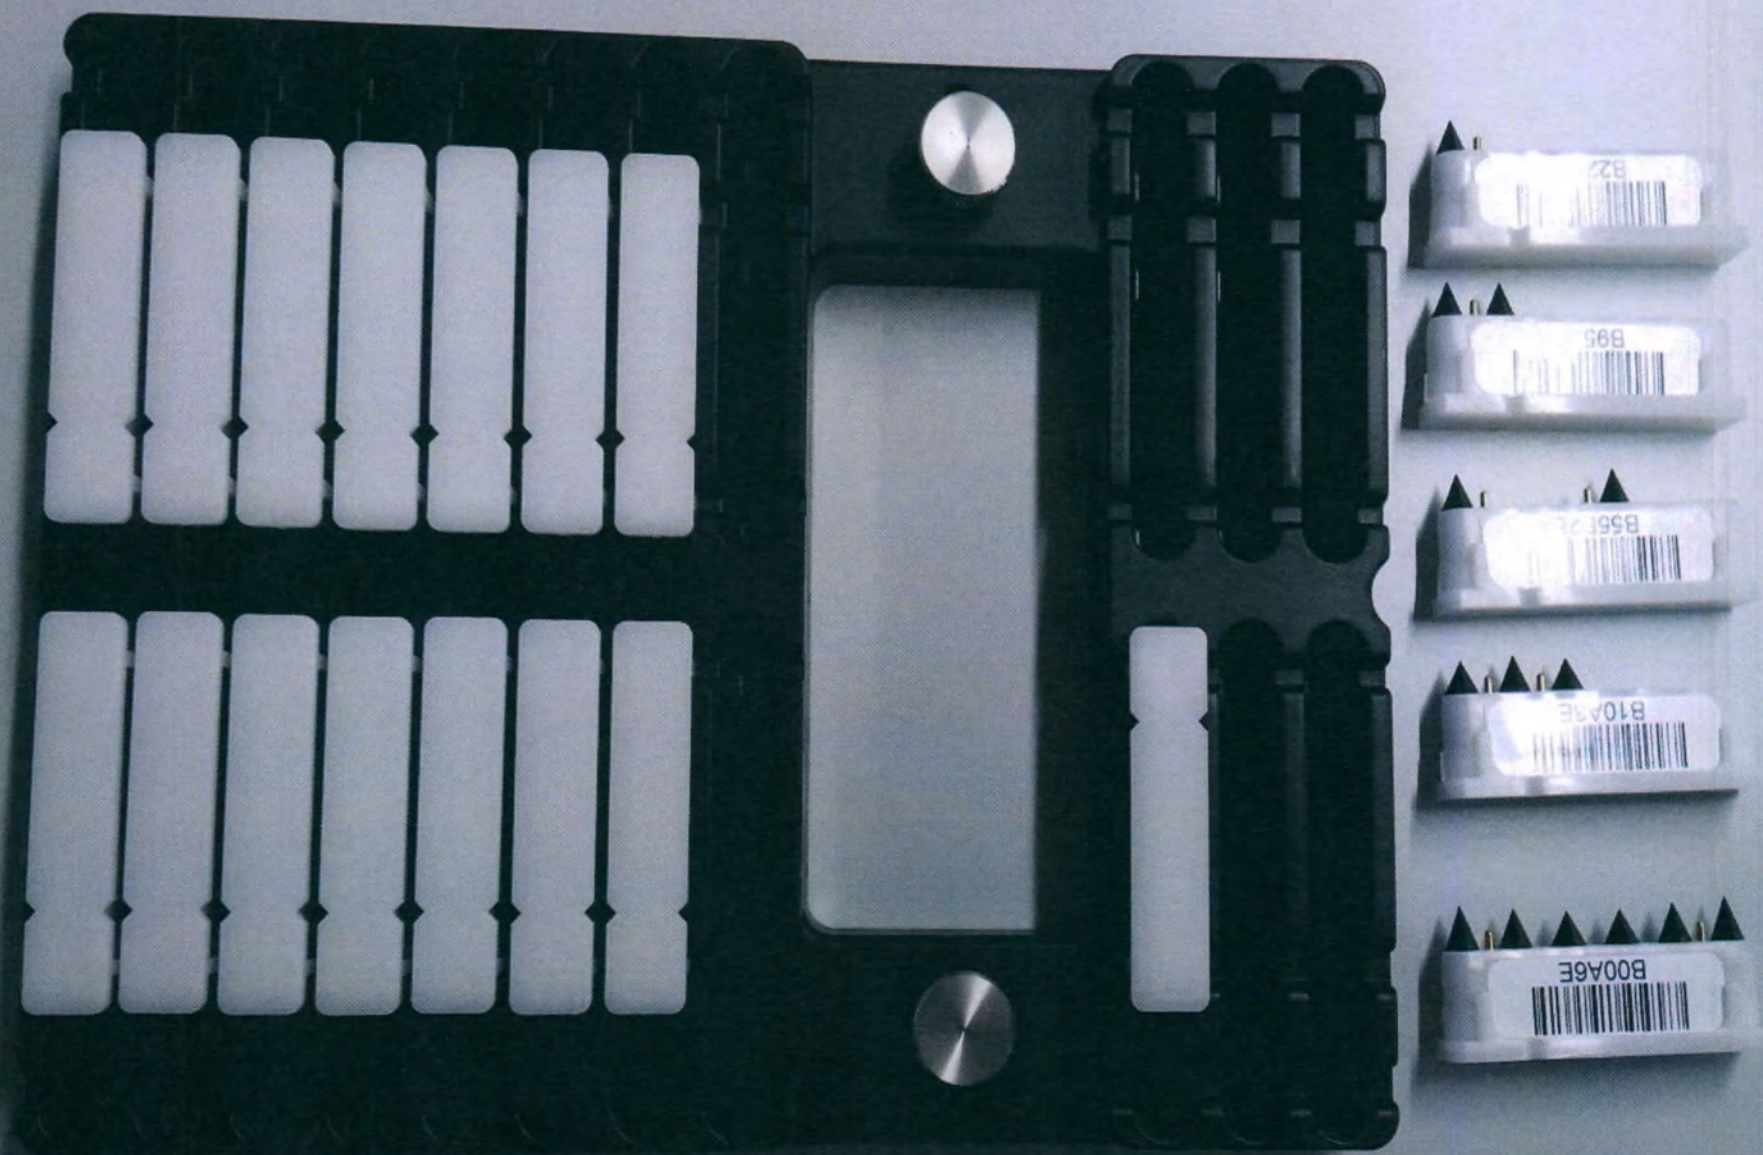

1.22. Наборы для подключения к дренажной линии ORTHO VISION (ORTHO VISION drain kit)



1.23. Наборы для проведения планового обслуживания анализатора ORTHO VISION (ORTHO VISION Operator Maintenance Kit)



I.24. Наборы для установки дополнительного контейнера с физ.раствором и для подключения к дренажной линии (4HR2nd Saline & Direct Drain)




1.25. Наборы для установки дополнительного контейнера с физ.раствором и контейнера для отходов (4HR 2nd Saline & Waste)



1.26. Наборы материалов и инструментов для обслуживания ORTHO VISION пользователем (ORTHO VISION Spare Parts and Tool Kit)



I.27 Наконечники стальные для отбора образцов (Pipettor Probe)

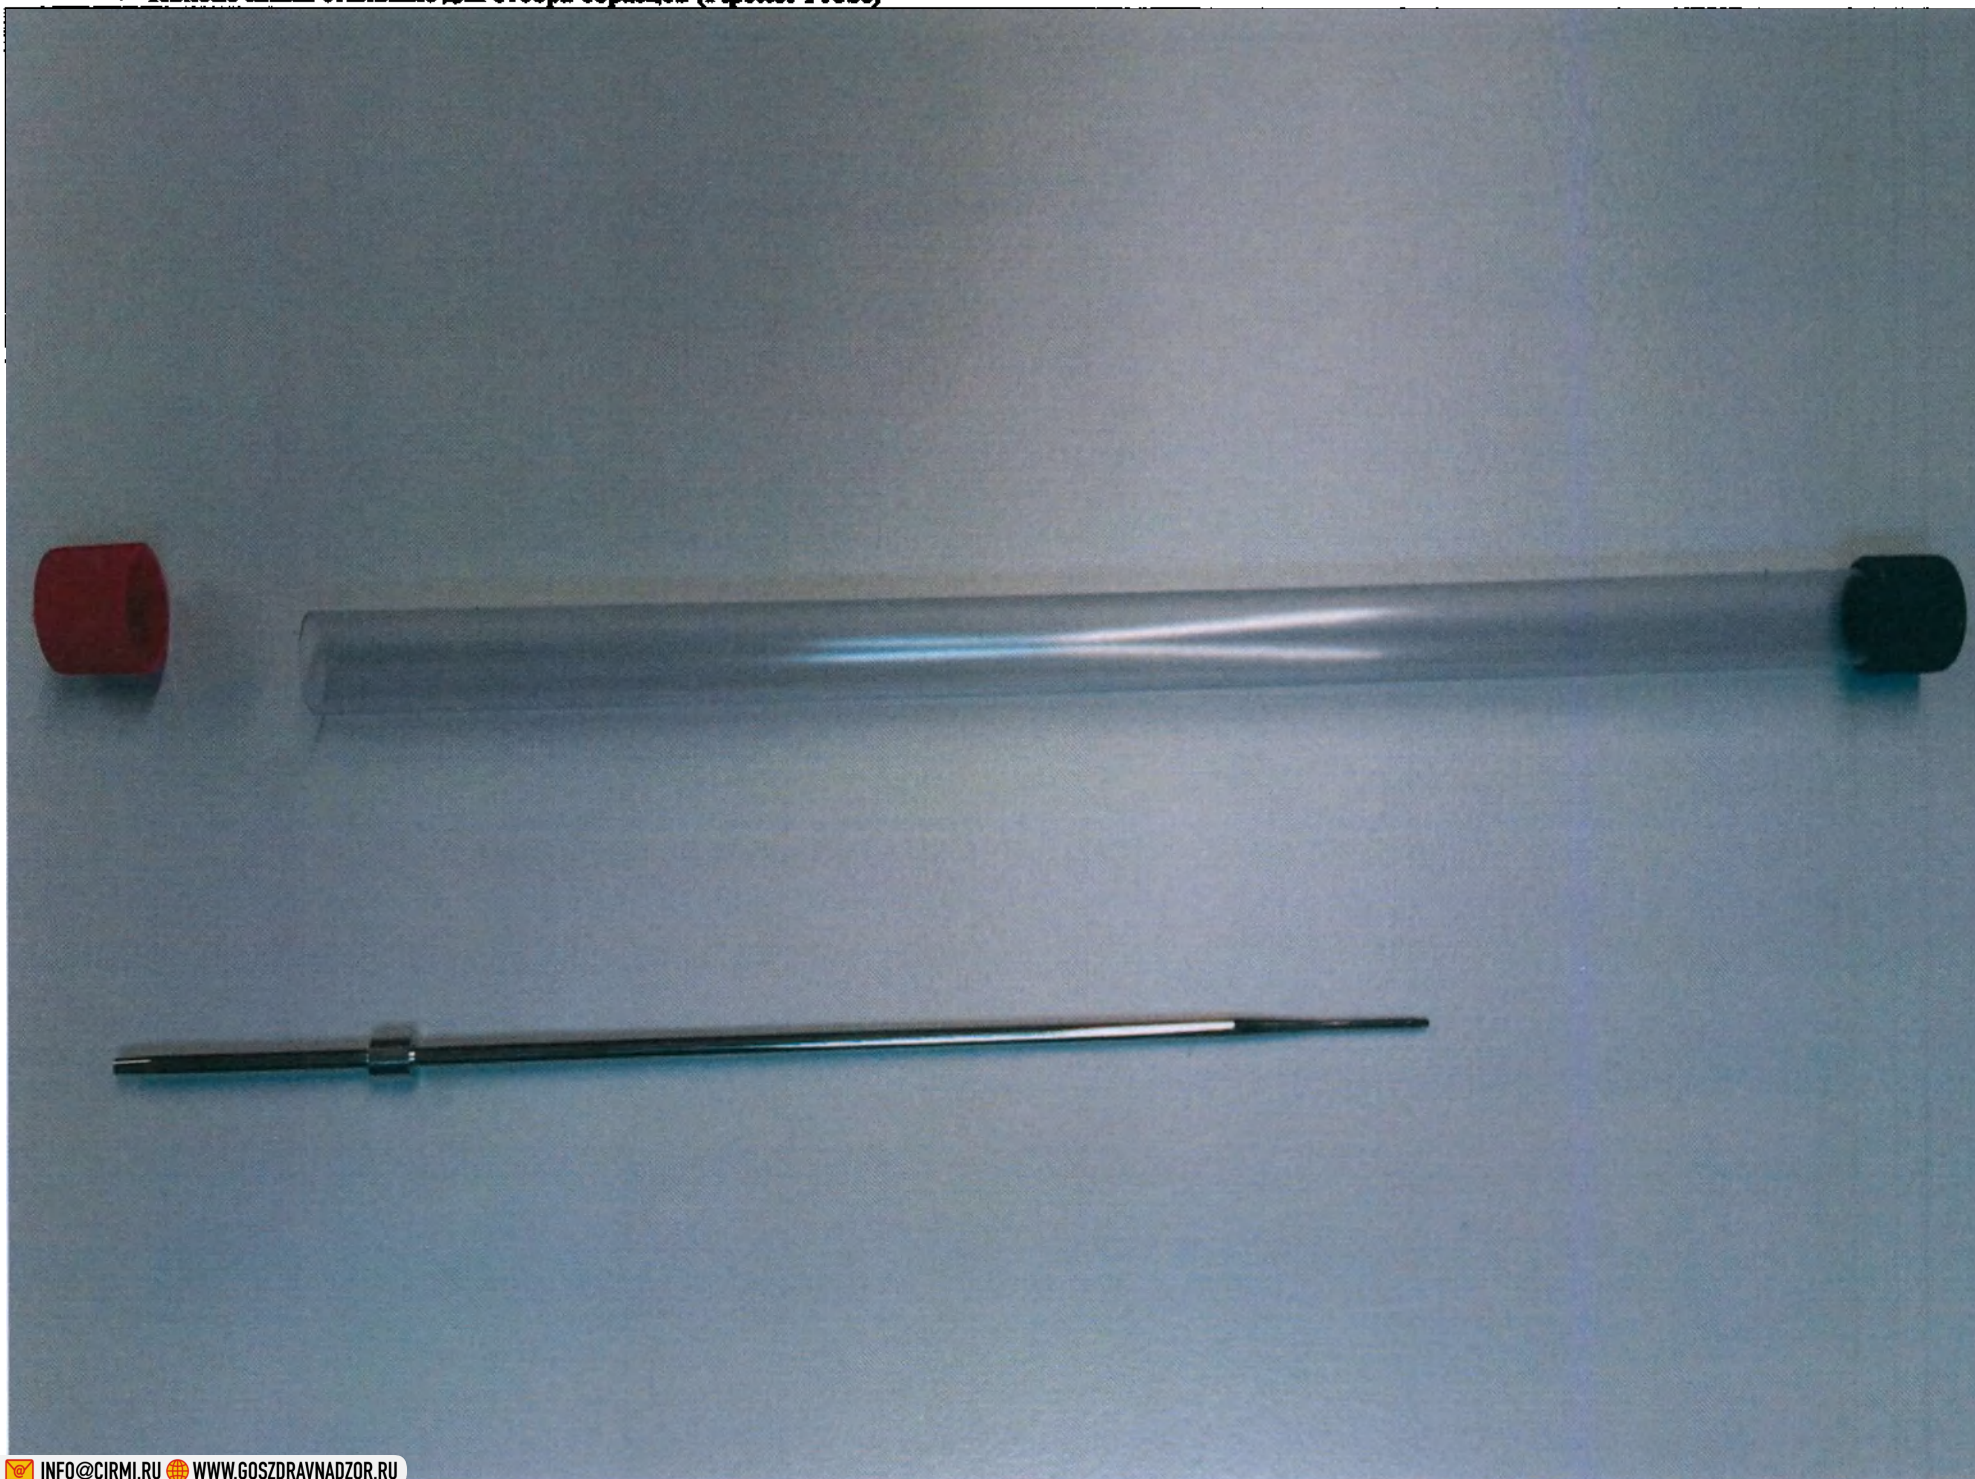






I.30. Стол для анализатора ORTHO VISION (ORTHO VISION Table)




I.31. Транспортировочные ручки (Transport Handles)

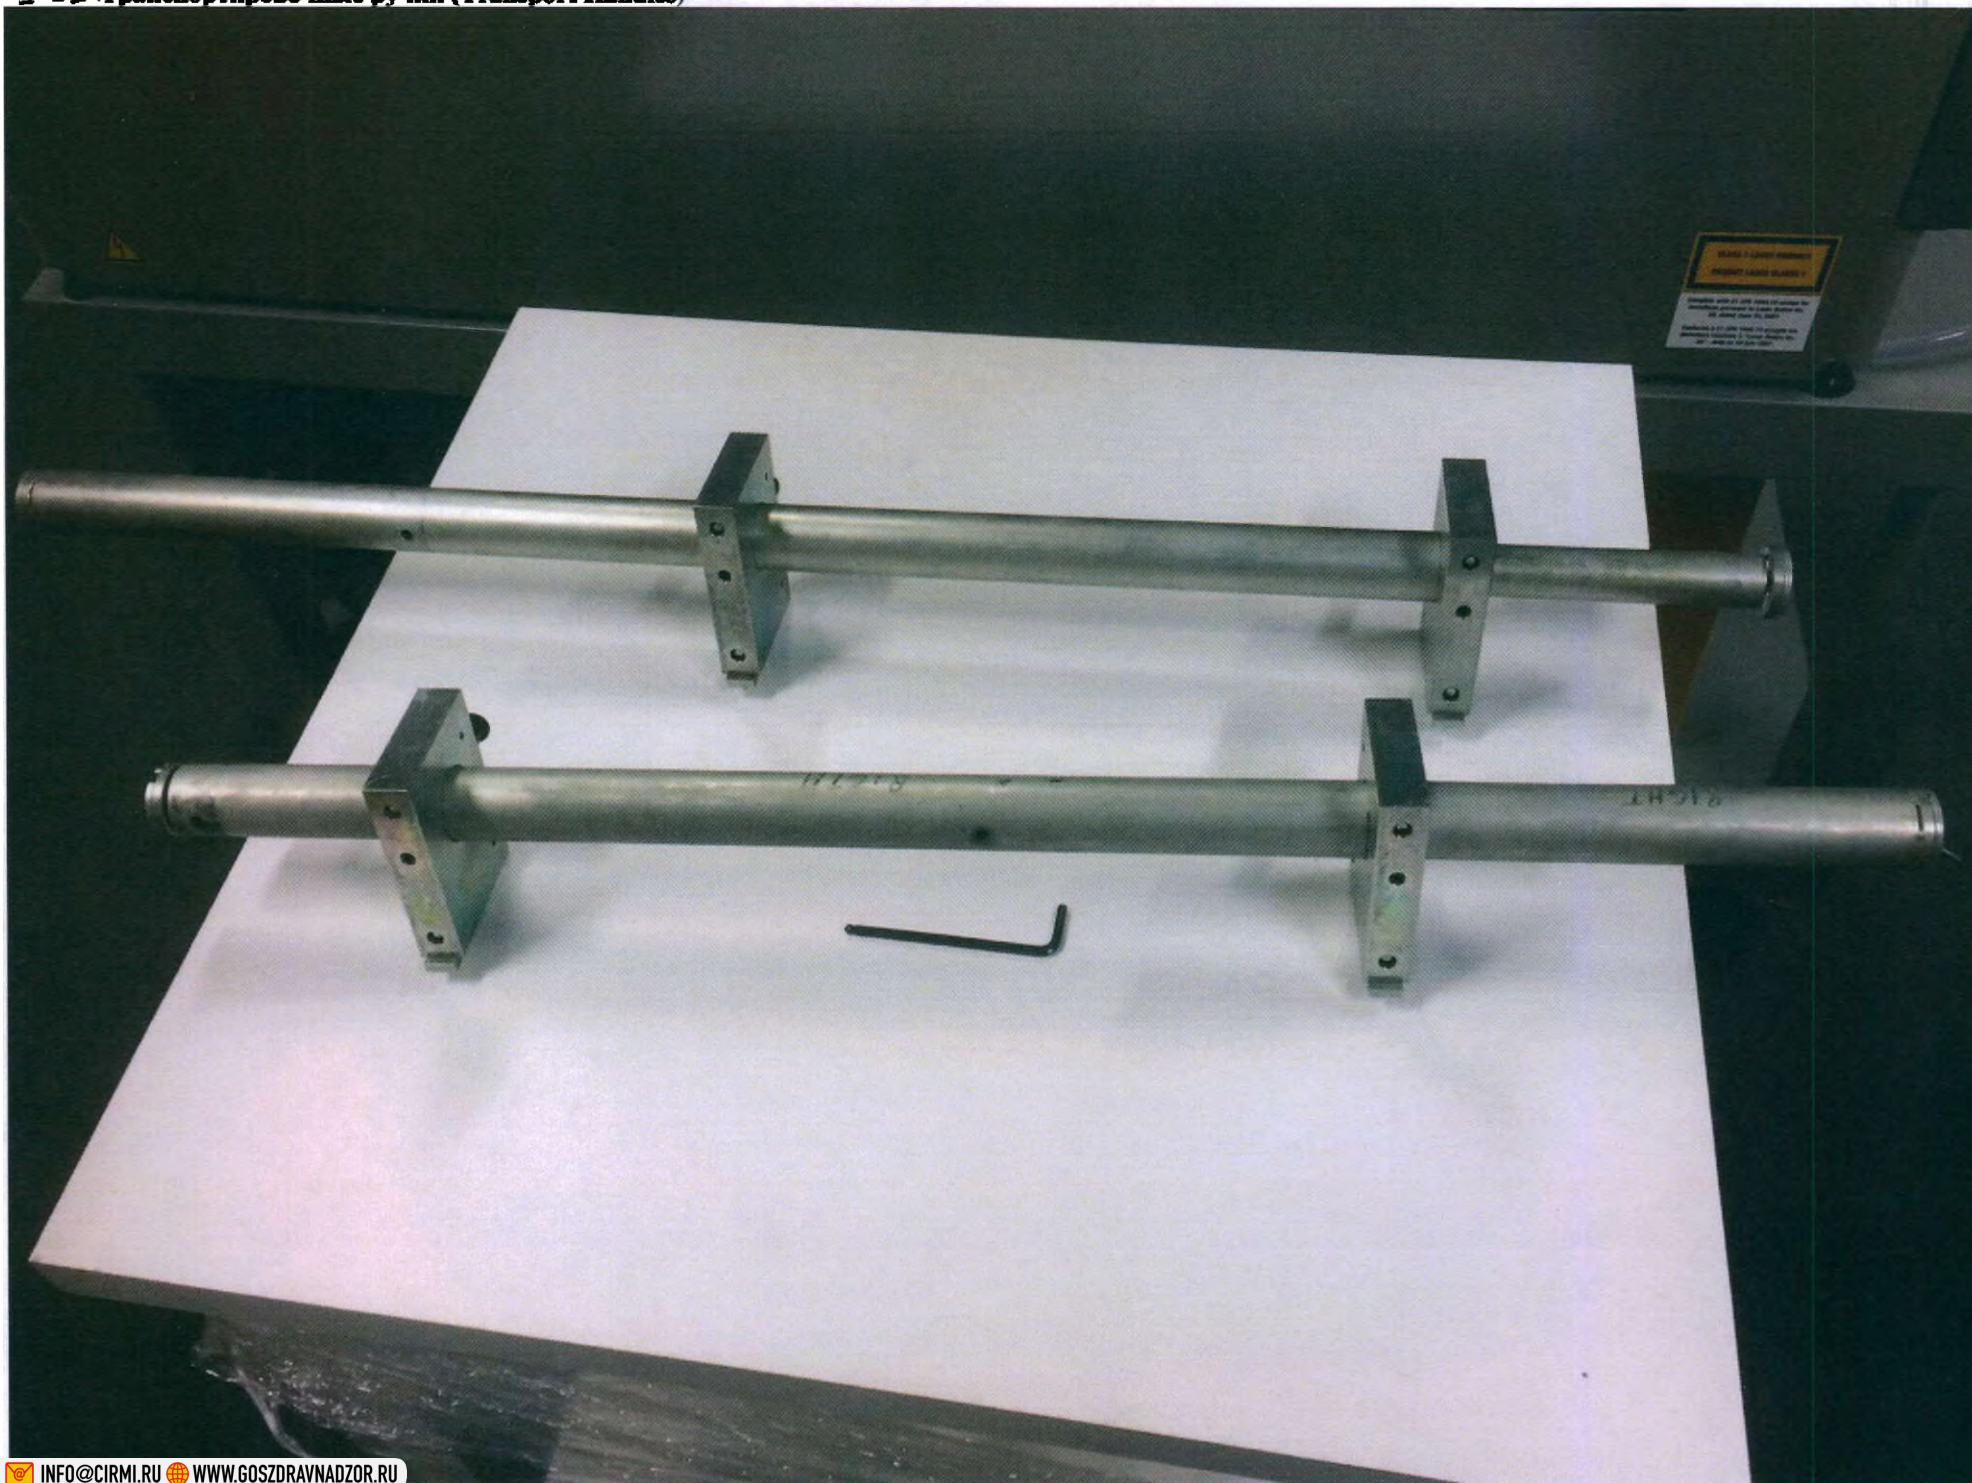





Т. 33. Штативы для 10 мл флаконов (RRBC Reagent Rack - 10 mL)

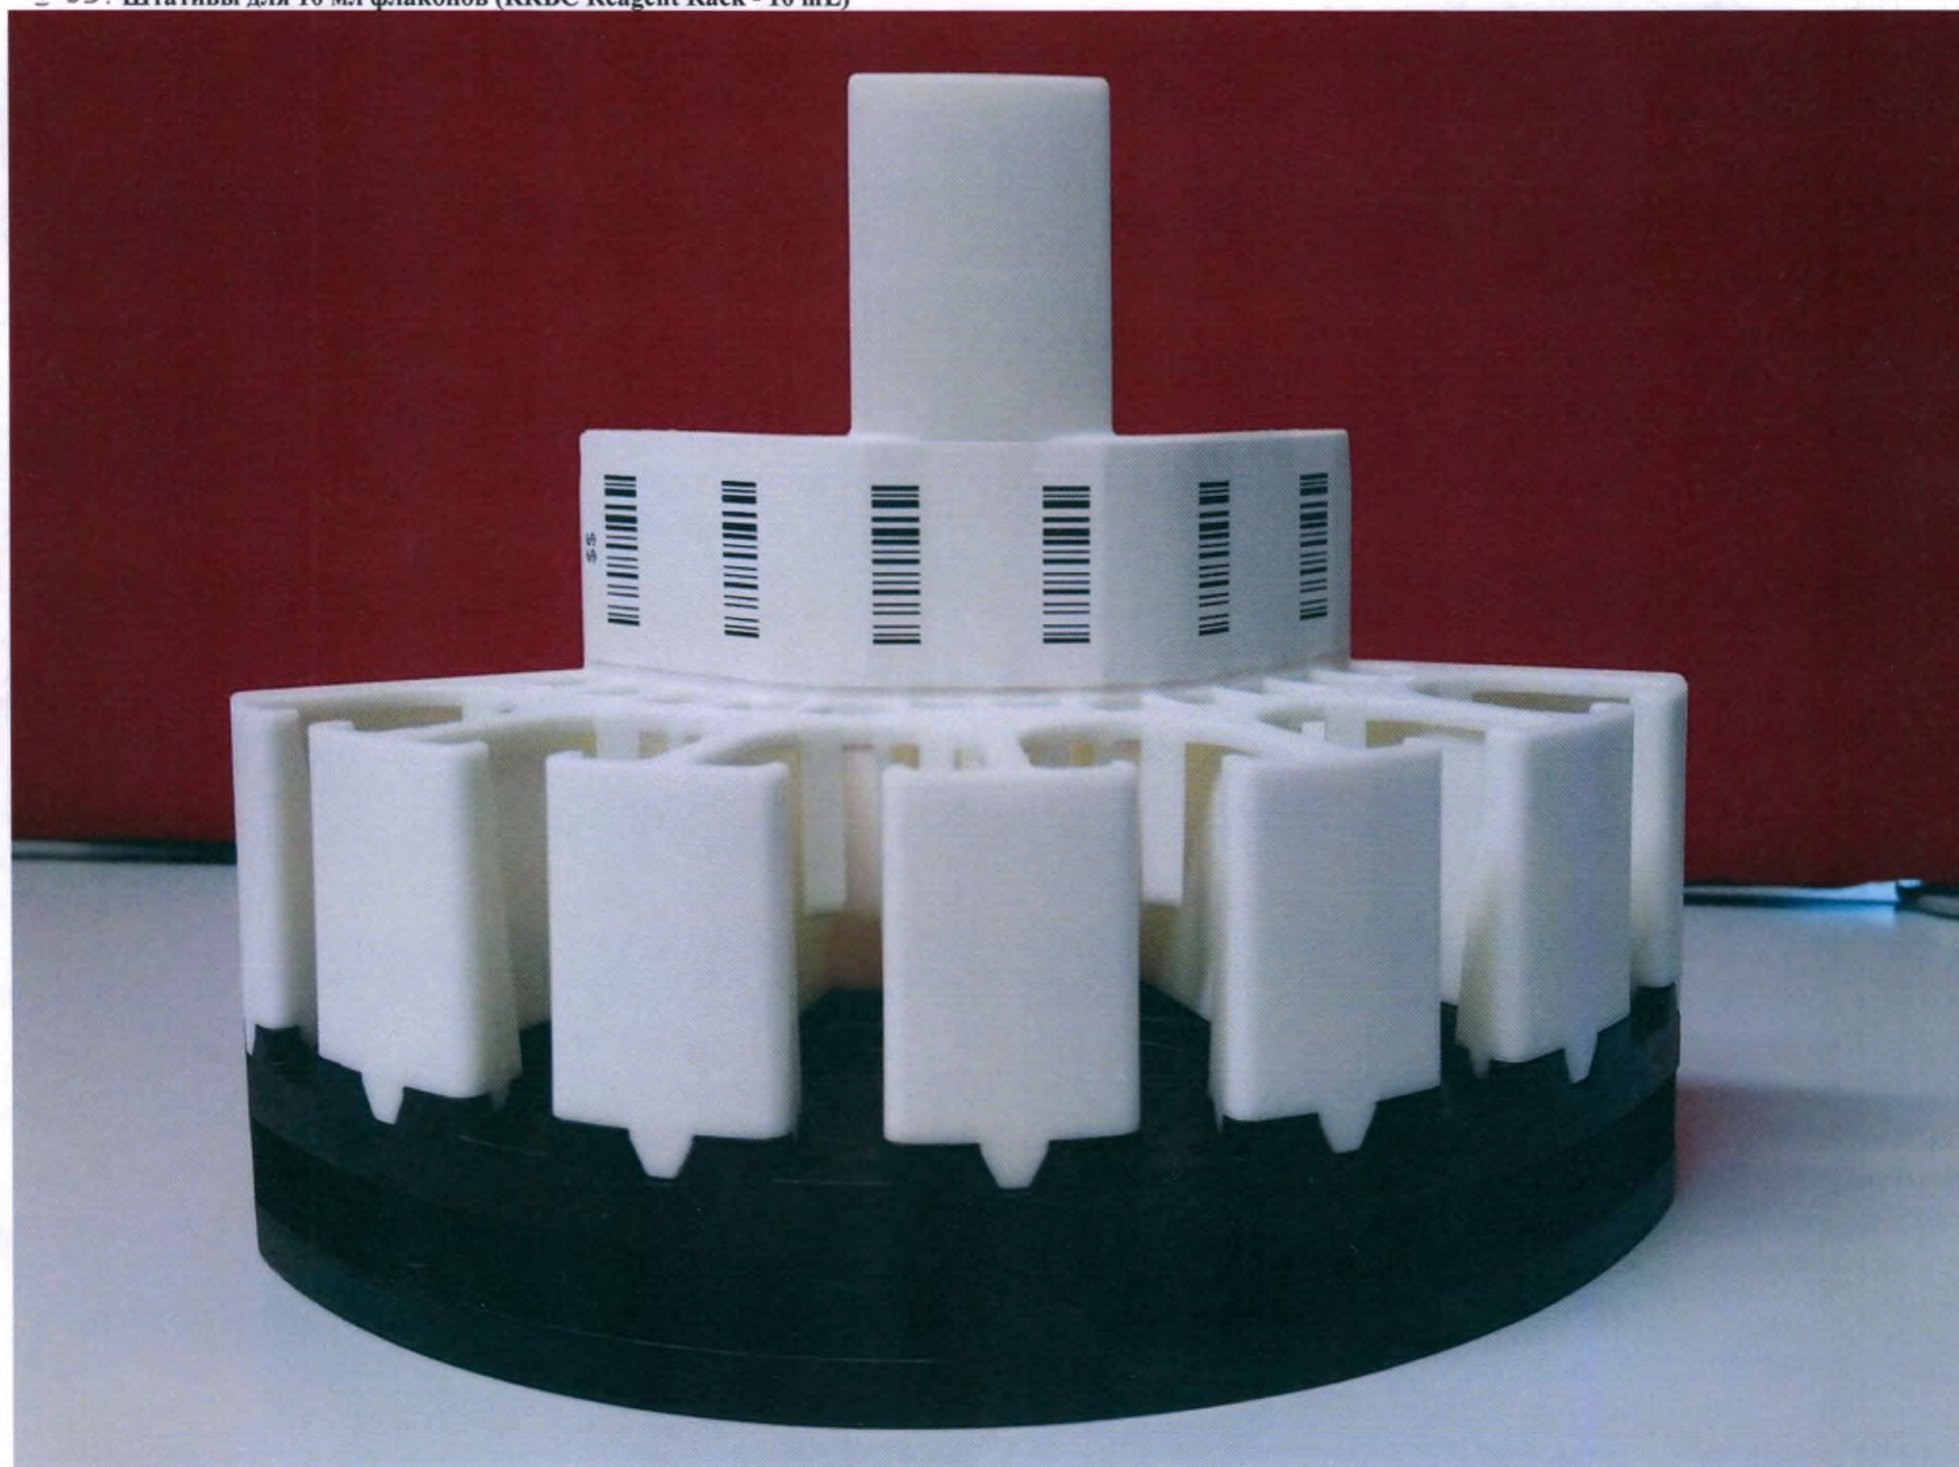

Т 34. Штативы для 3 мл флаконов (RRBC Reagent Rack - 3 mL)

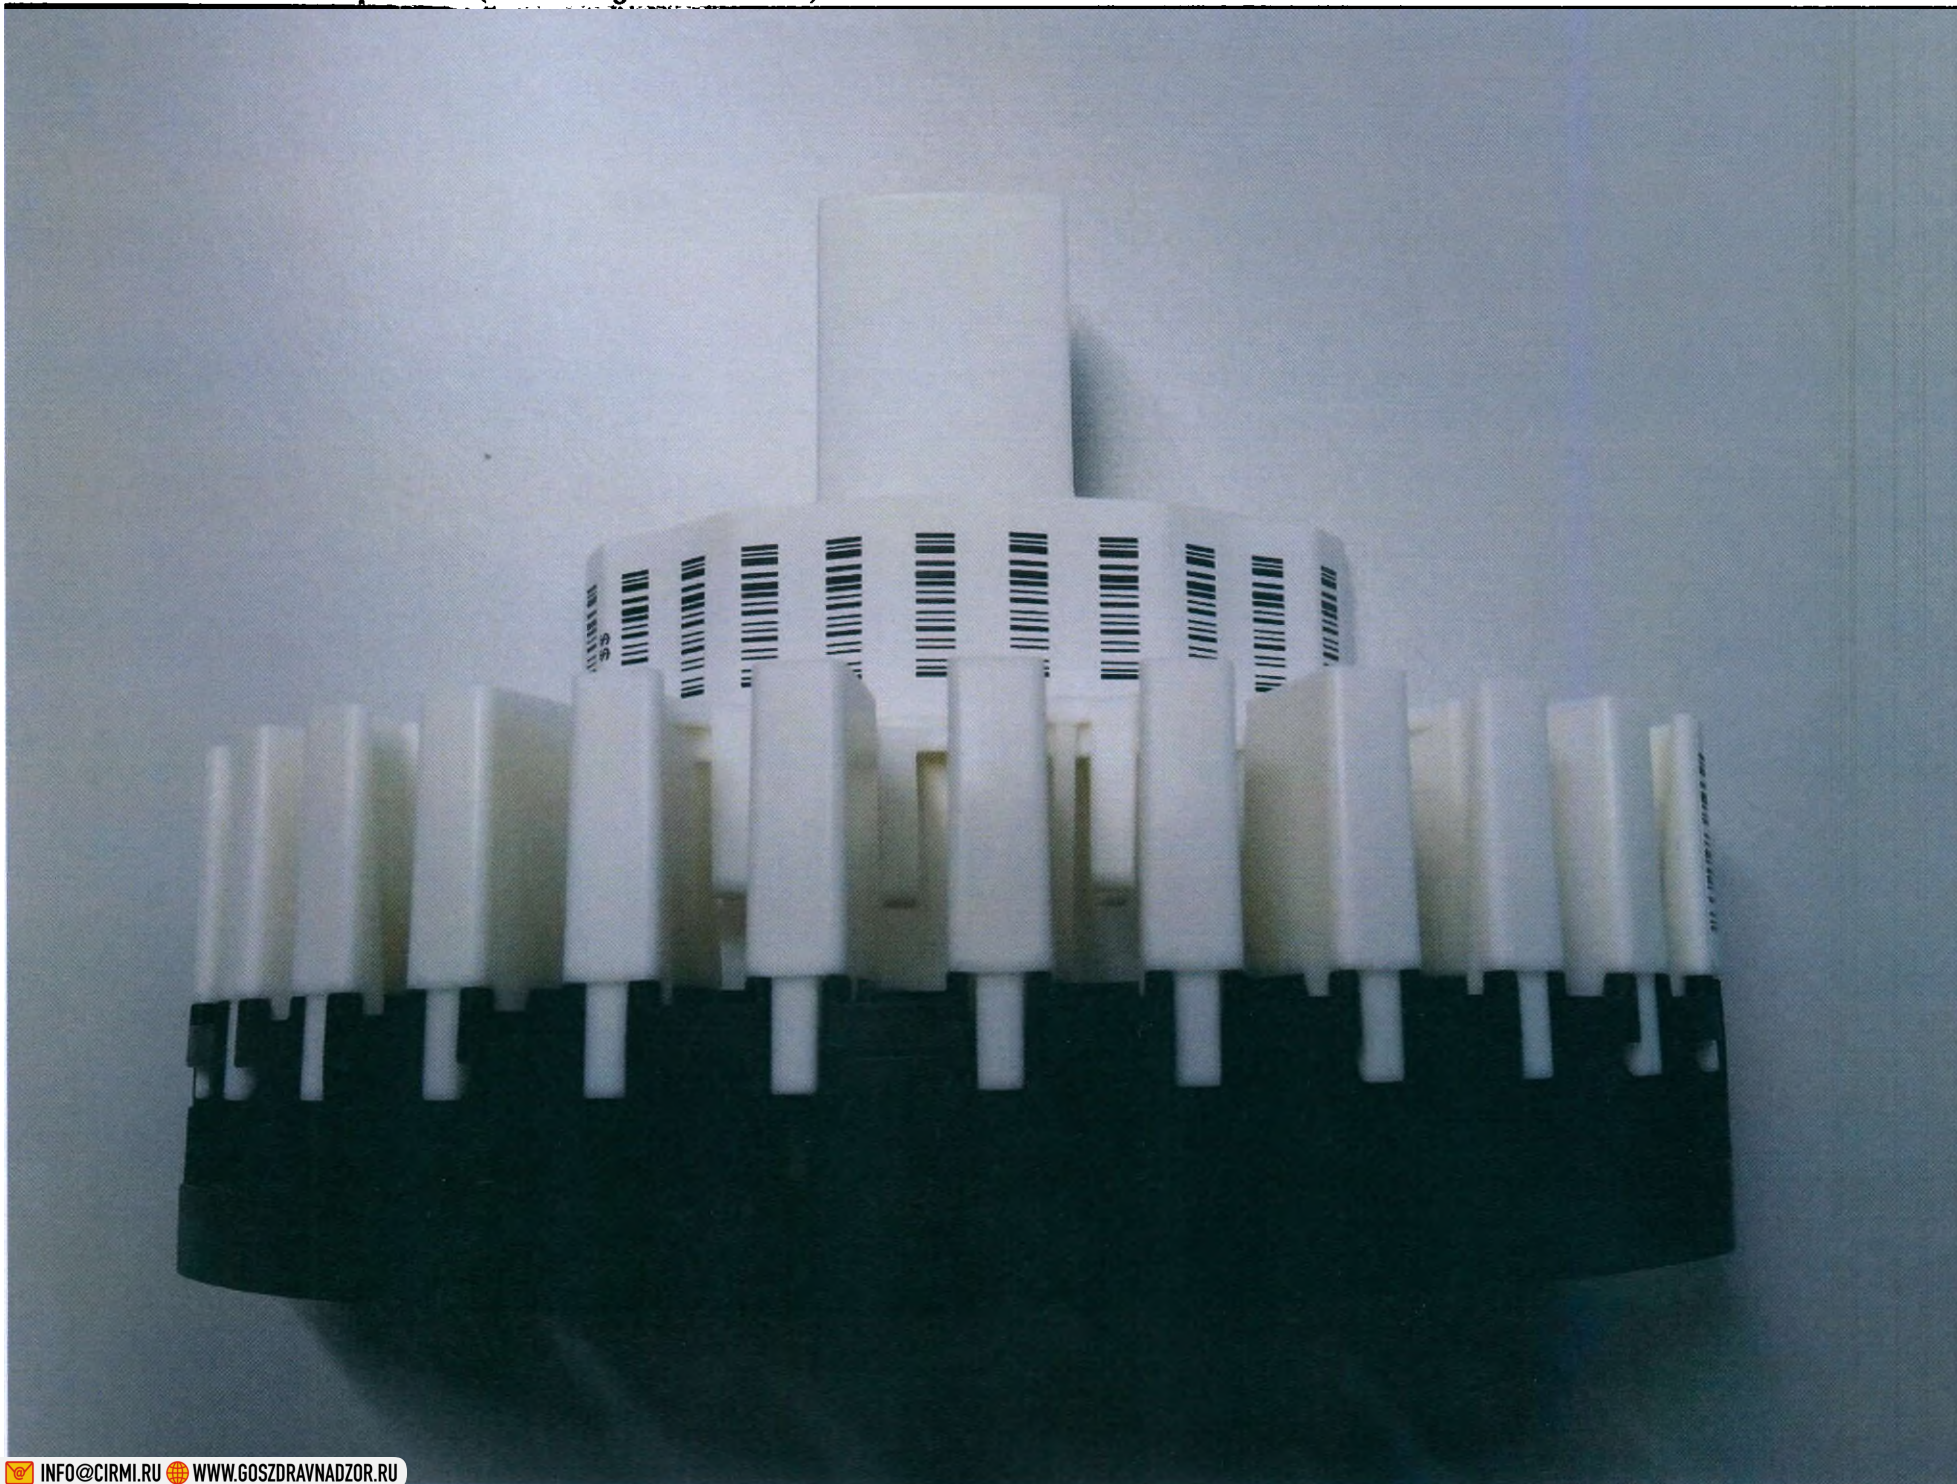


1.35. Штативы для педиатрических пробирок BD Microtainer

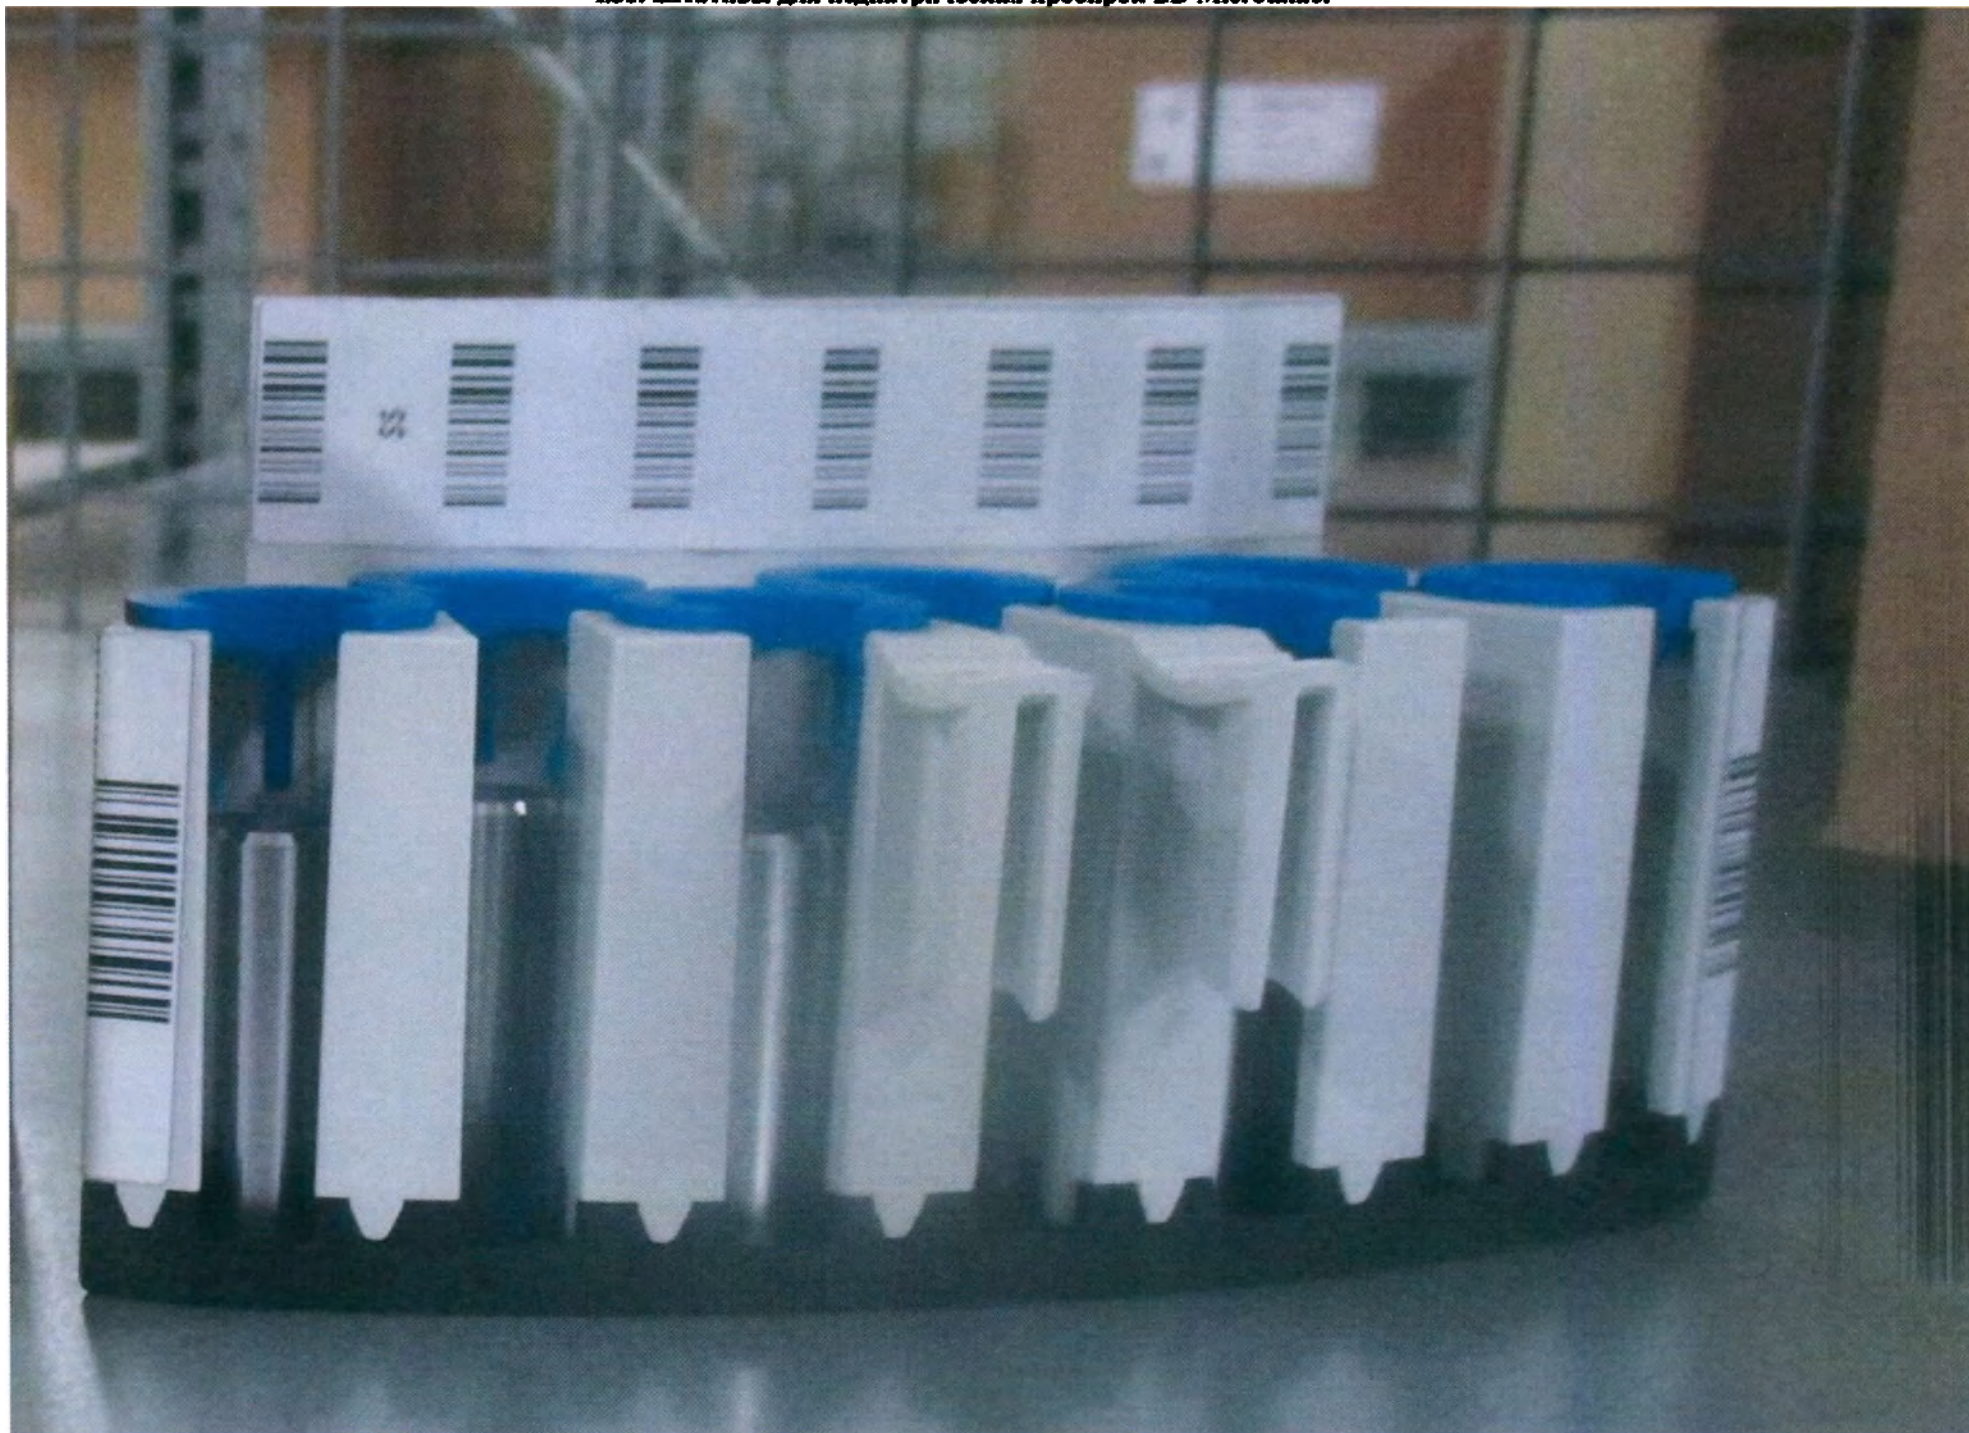

1.36. Штативы для педиатрических пробирок BD Microtainer Microgard



1.37. Штативы для педиатрических пробирок Eppendorf MTT для проб объемом 2,0 мл

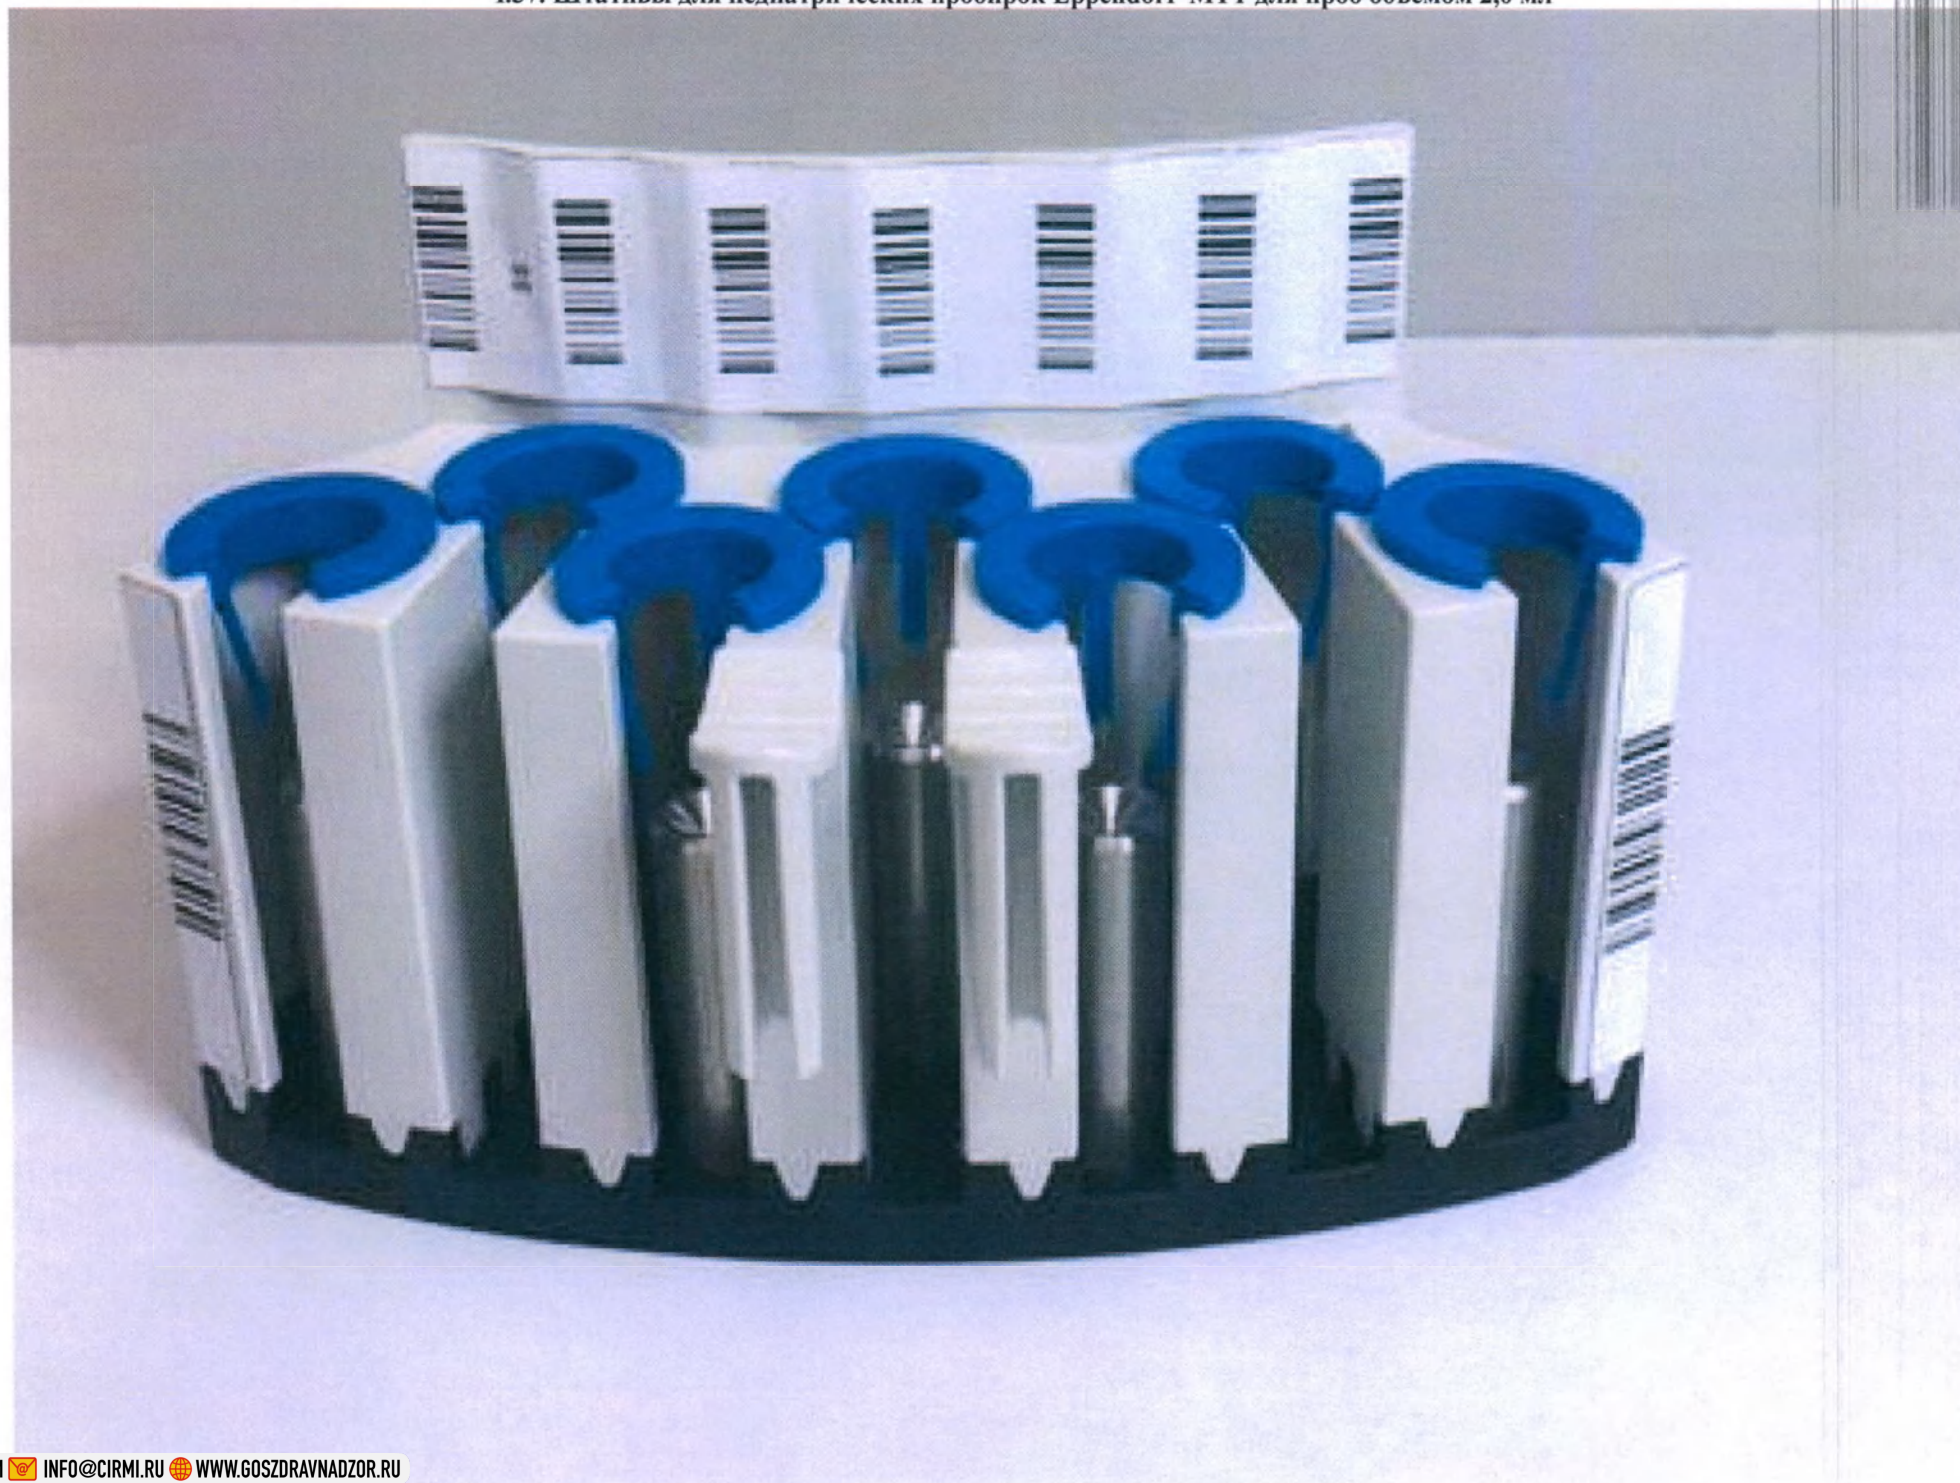

I.38. Штативы для педиатрических пробирок Eppendorf MTT для проб объемом 1,5 мл



L39. Штативы для педматрических пробирок Greiner MiniCollect



Part Name: ORTHO VISION PEDS27B GREINER MINICOLLECT

REF 6986646

Tecan Part No. 30083121



Tecan Purch. Part No. 30083727



COO Switzerland



20160811


QTY: 1




Ortho-Clinical Diagnostics
Fellindro Meadows
Pencoed
Bridgend
CF35 5PZ
United Kingdom

Doku No. 300186 V2.0


Л40. Штативы для педиатрических пробирок RAM Scientific SAFE-T-FILL

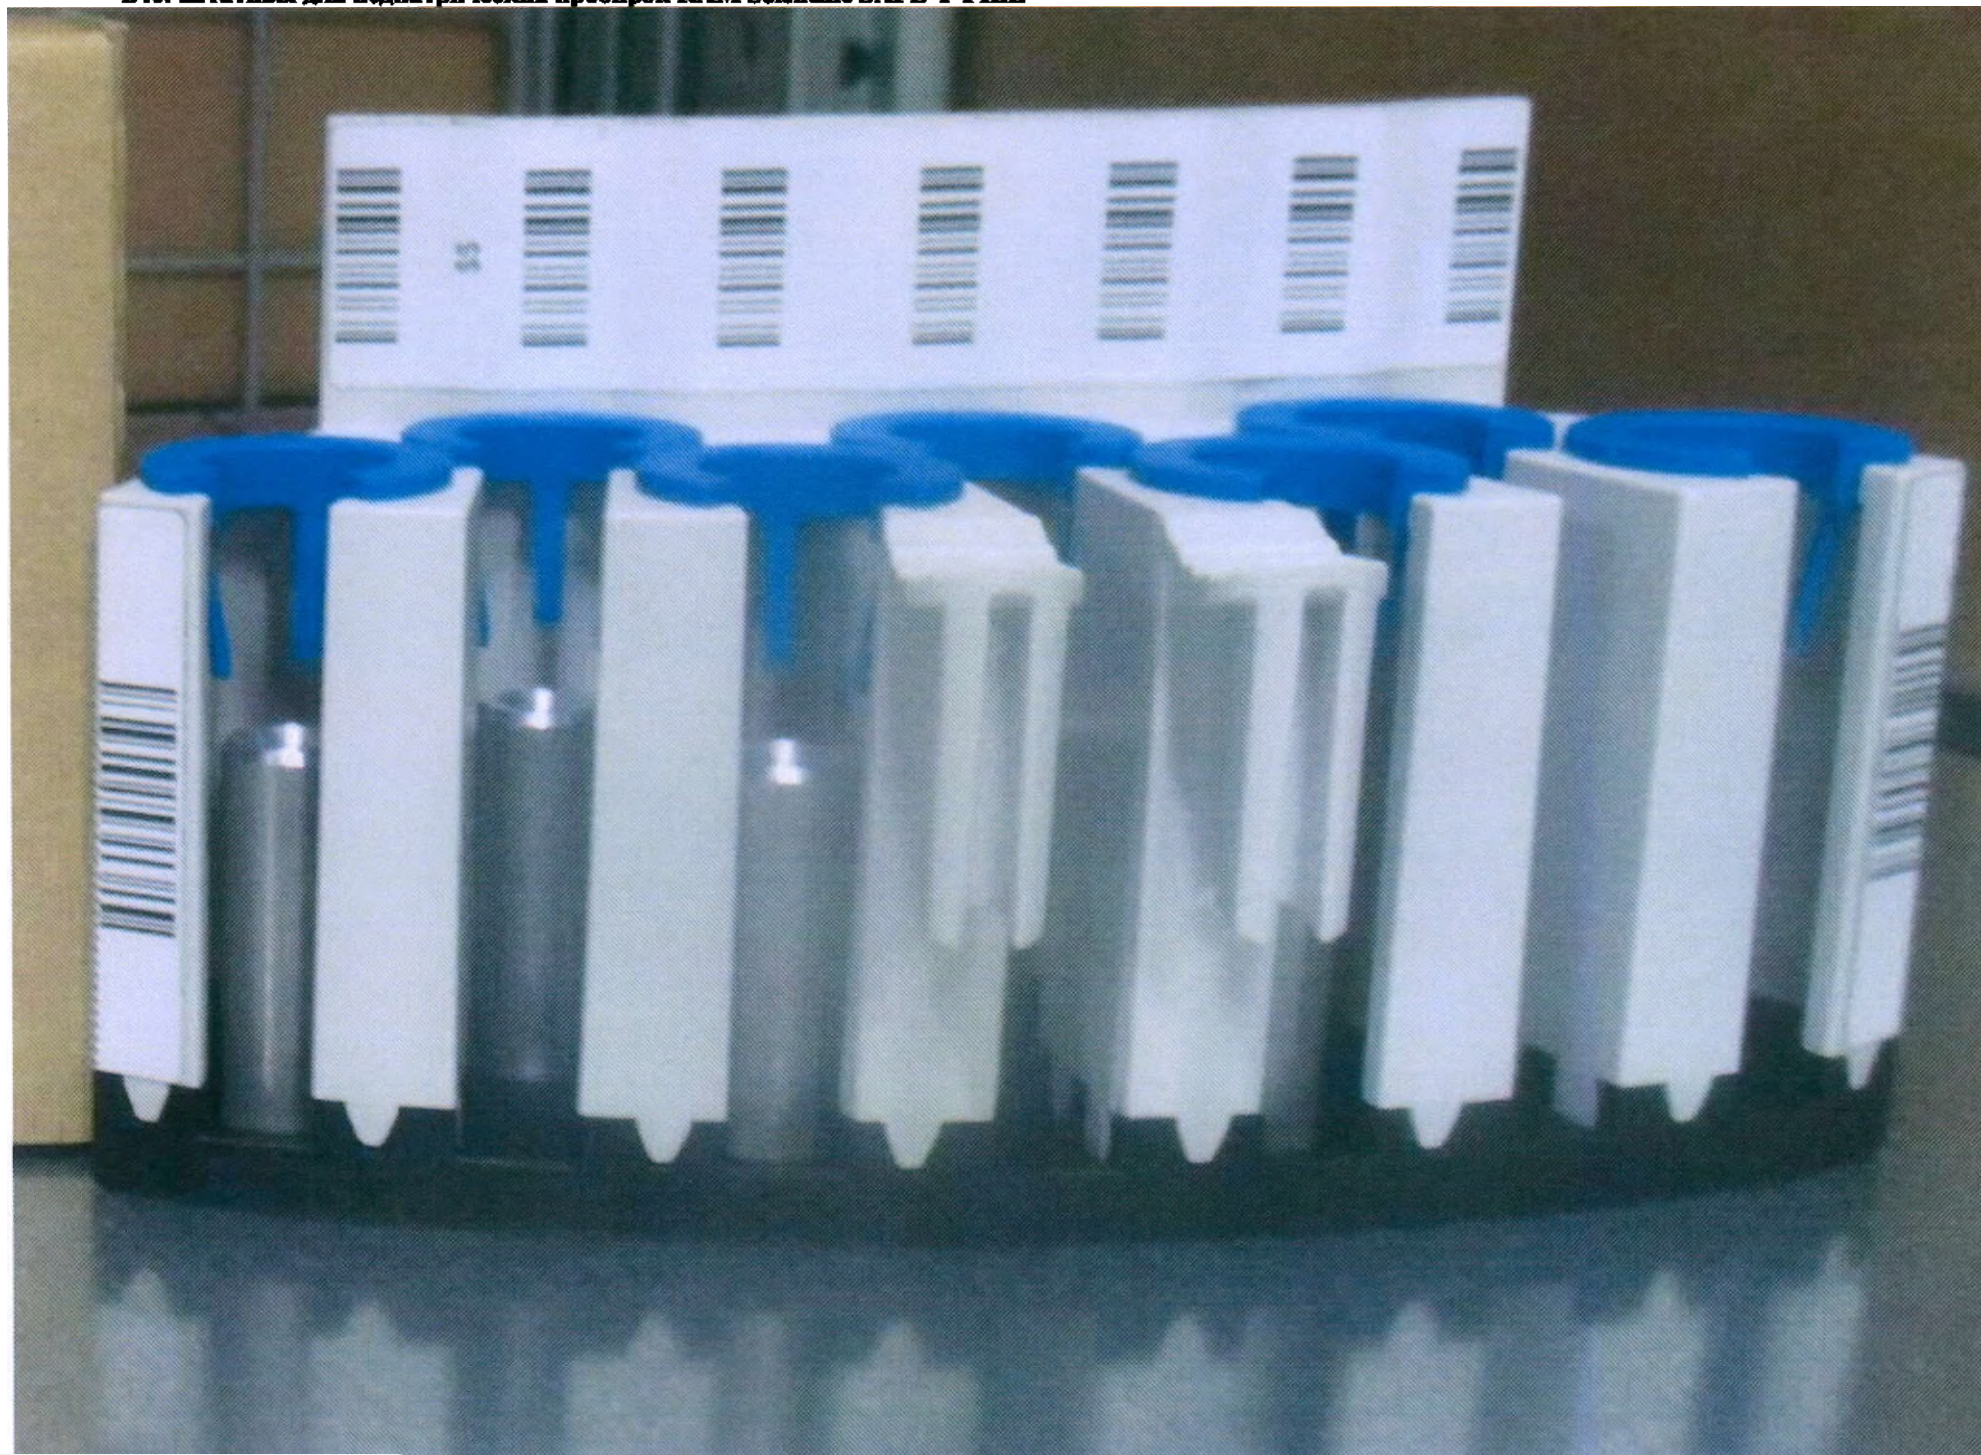

I.41. Штативы для педиатрических пробирок Sarstedt Microvette (Sample rack Sarstedt Microvette)

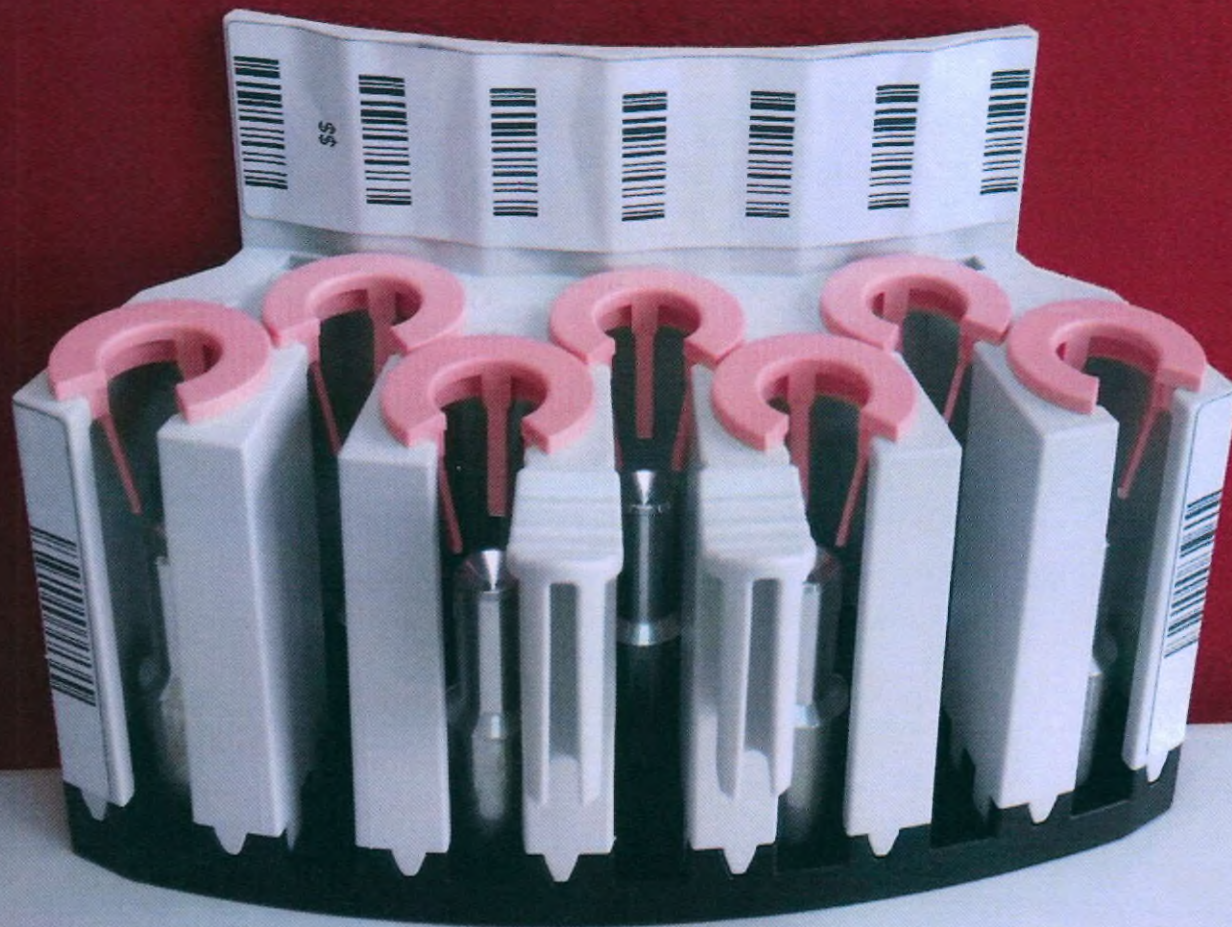

I.42. Штативы для педиатрических пробирок Sarstedt тип A (Sample rack Sarstedt Type A)

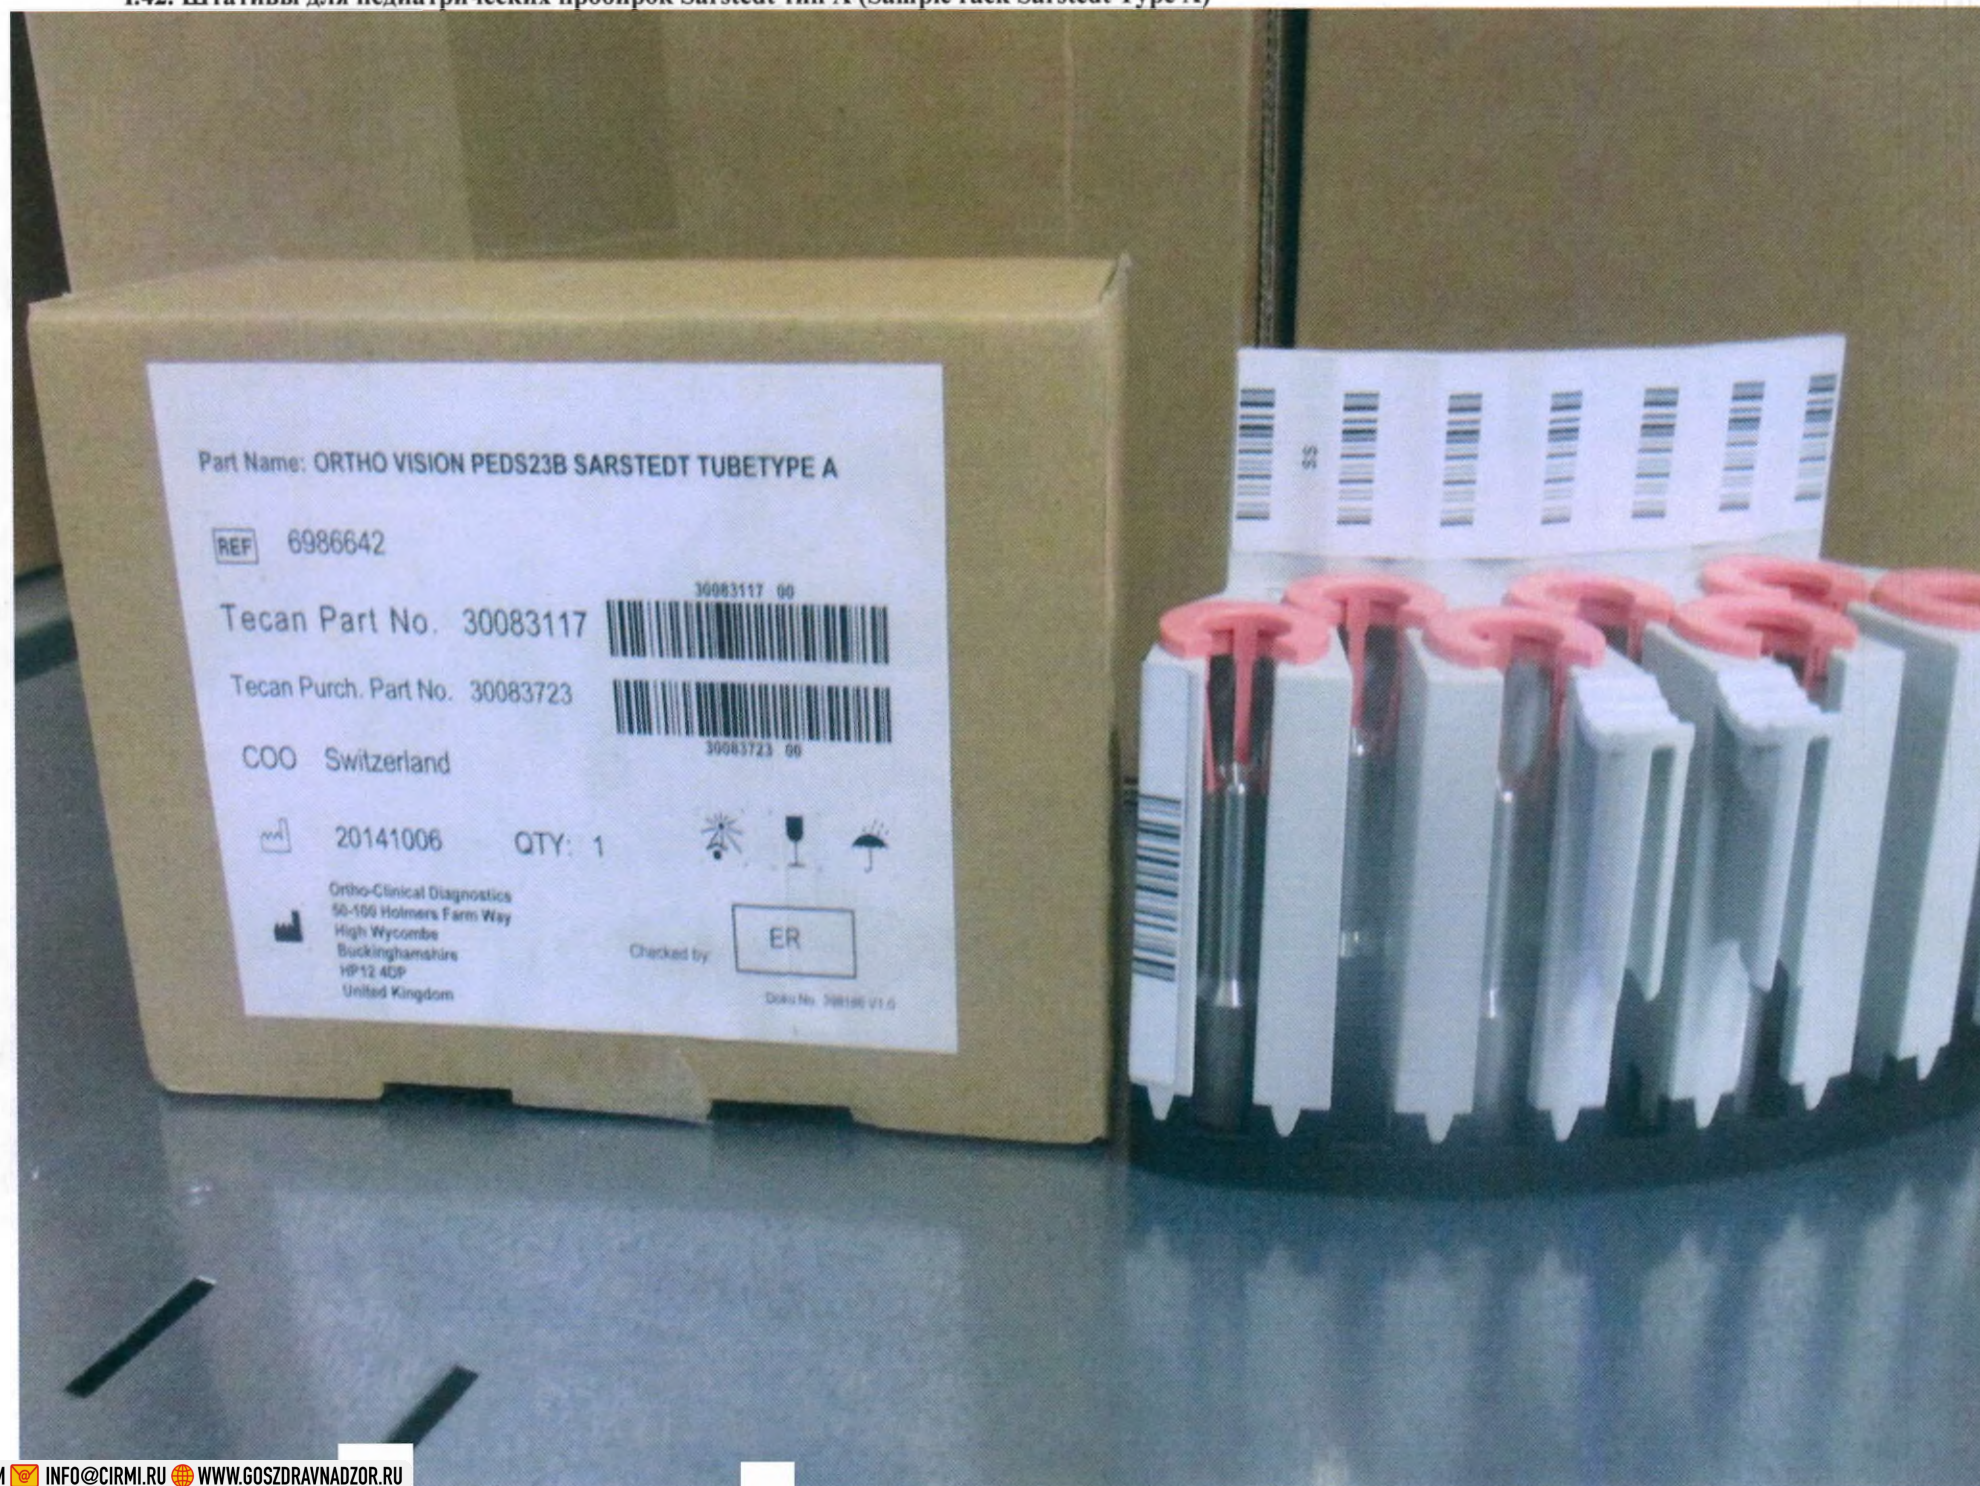

I.43. Штативы для педиатрических пробирок Sarstedt тип B (Sample rack Sarstedt Type B)



I.44. Штативы для педнатрических пробирок Sarstedt тип C (Sample rack Sarstedt Type C)



I.45. Штативы для педиатрических пробирок Sarstedt тип D (Sample rack Sarstedt Type D)



I.46. Штативы для педиатрических пробирок Sarstedt тип H (Sample rack Sarstedt Type H)



I.47. Штативы для педиатрических пробирок Sarstedt тип I (Sample rack Sarstedt Type I)




I.48. Штативы для педиатрических пробирок TEKLAB (Sample rack TEKLAB)



I.49. Штативы для педиатрических пробирок Terumo CAPJECT




I.50. Штативы для пробирок 10 мм, красный (Sample rack red 10 mm)

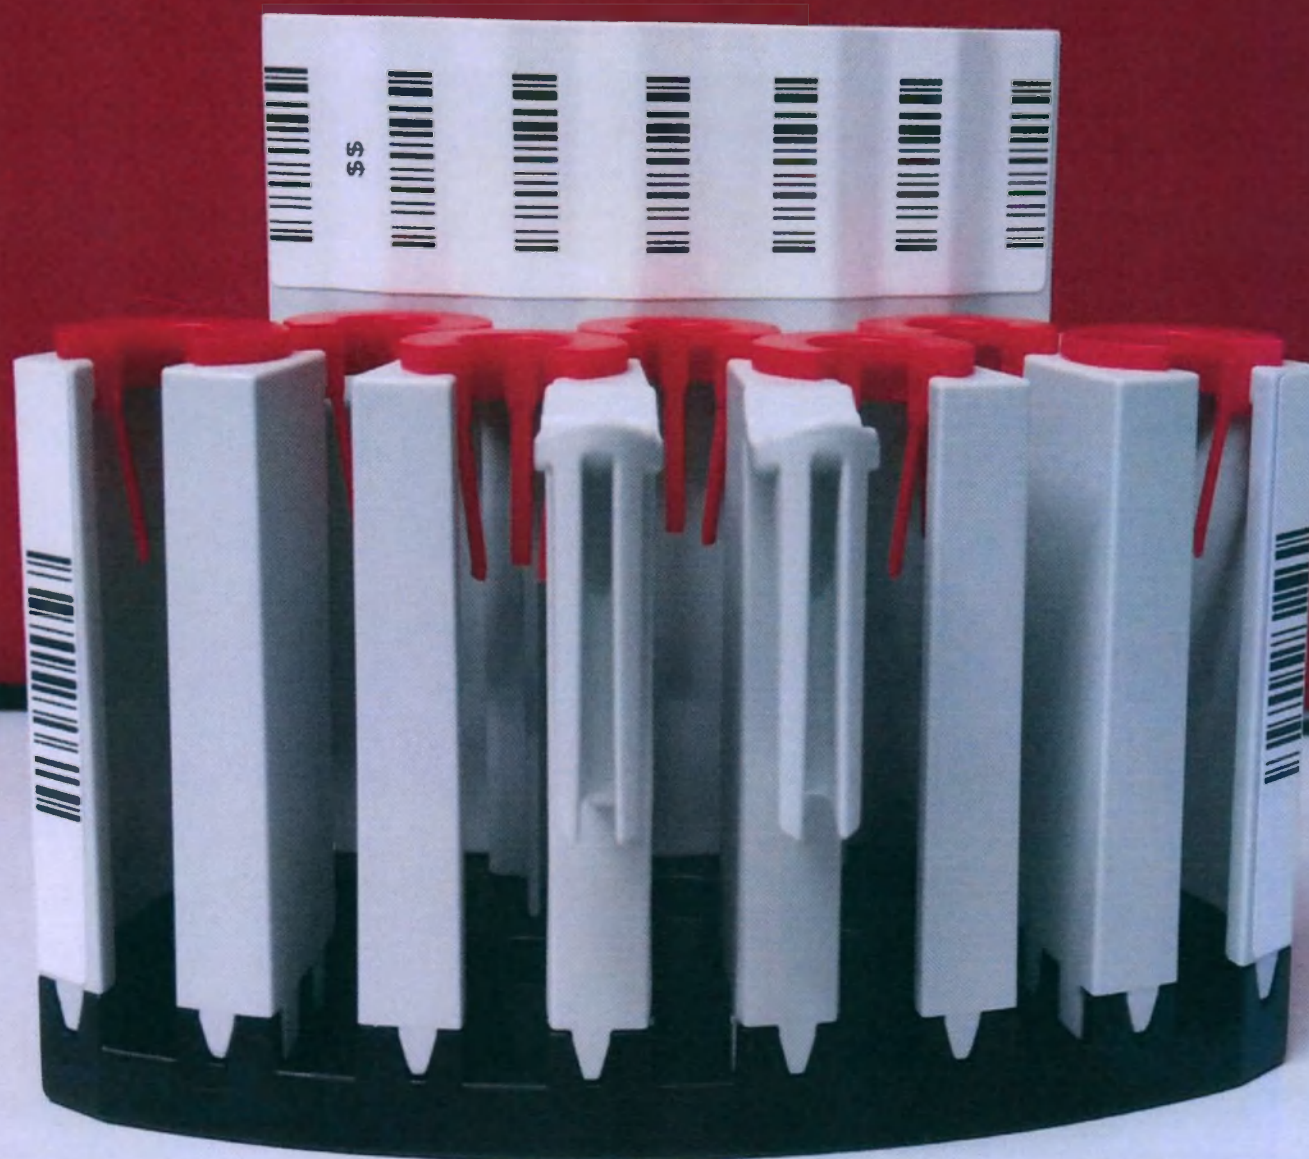


I.51. Штативы для пробирок 10.25x47 мм, красный (Sample rack red 10.25x47 mm)




1.52. Штативы для пробирок 13 мм, синий (Sample rack Blue 13 mm)

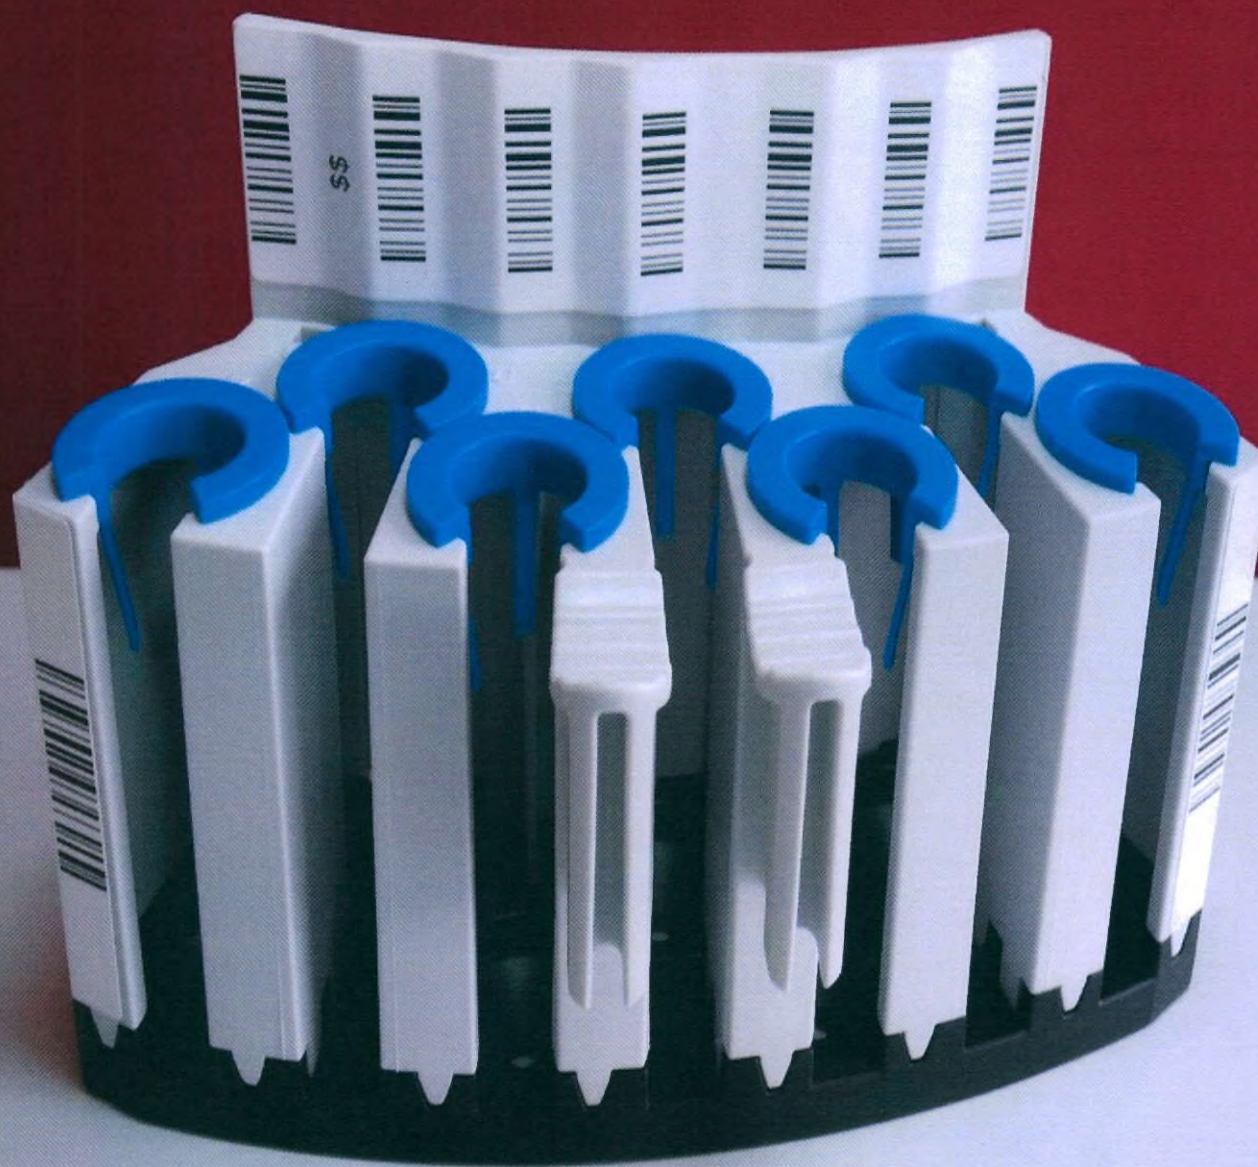

I.53. Штативы для пробирок 16 мм, зеленый (Sample rack Green 16 mm)

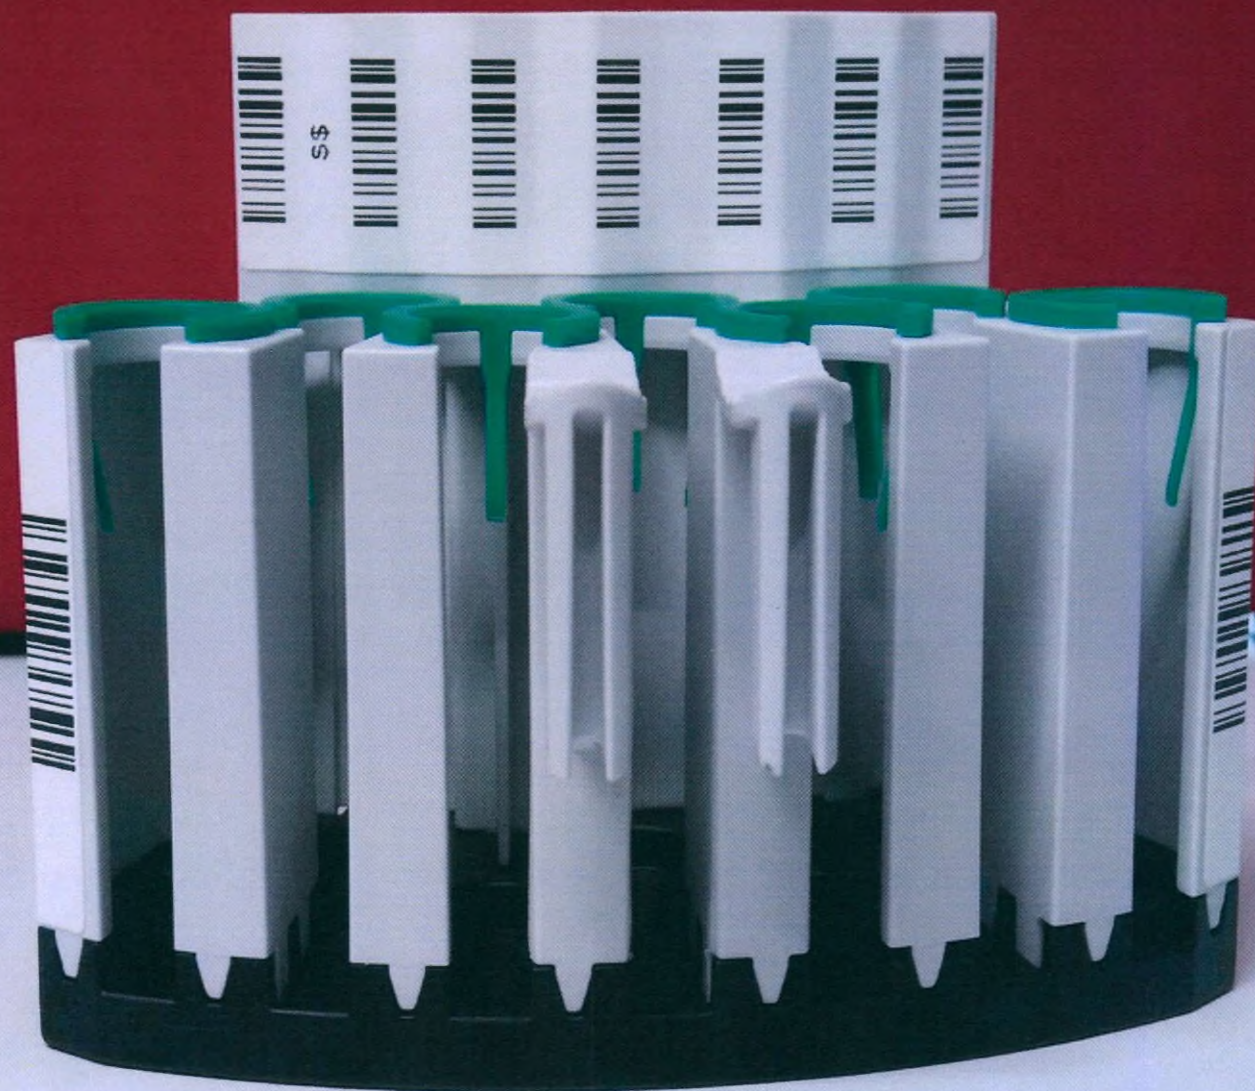


I.54. Штативы для пробирок Sarstedt Monovette объемом 4,9 мл (Sarstedt S-Mono 4.9 mL)

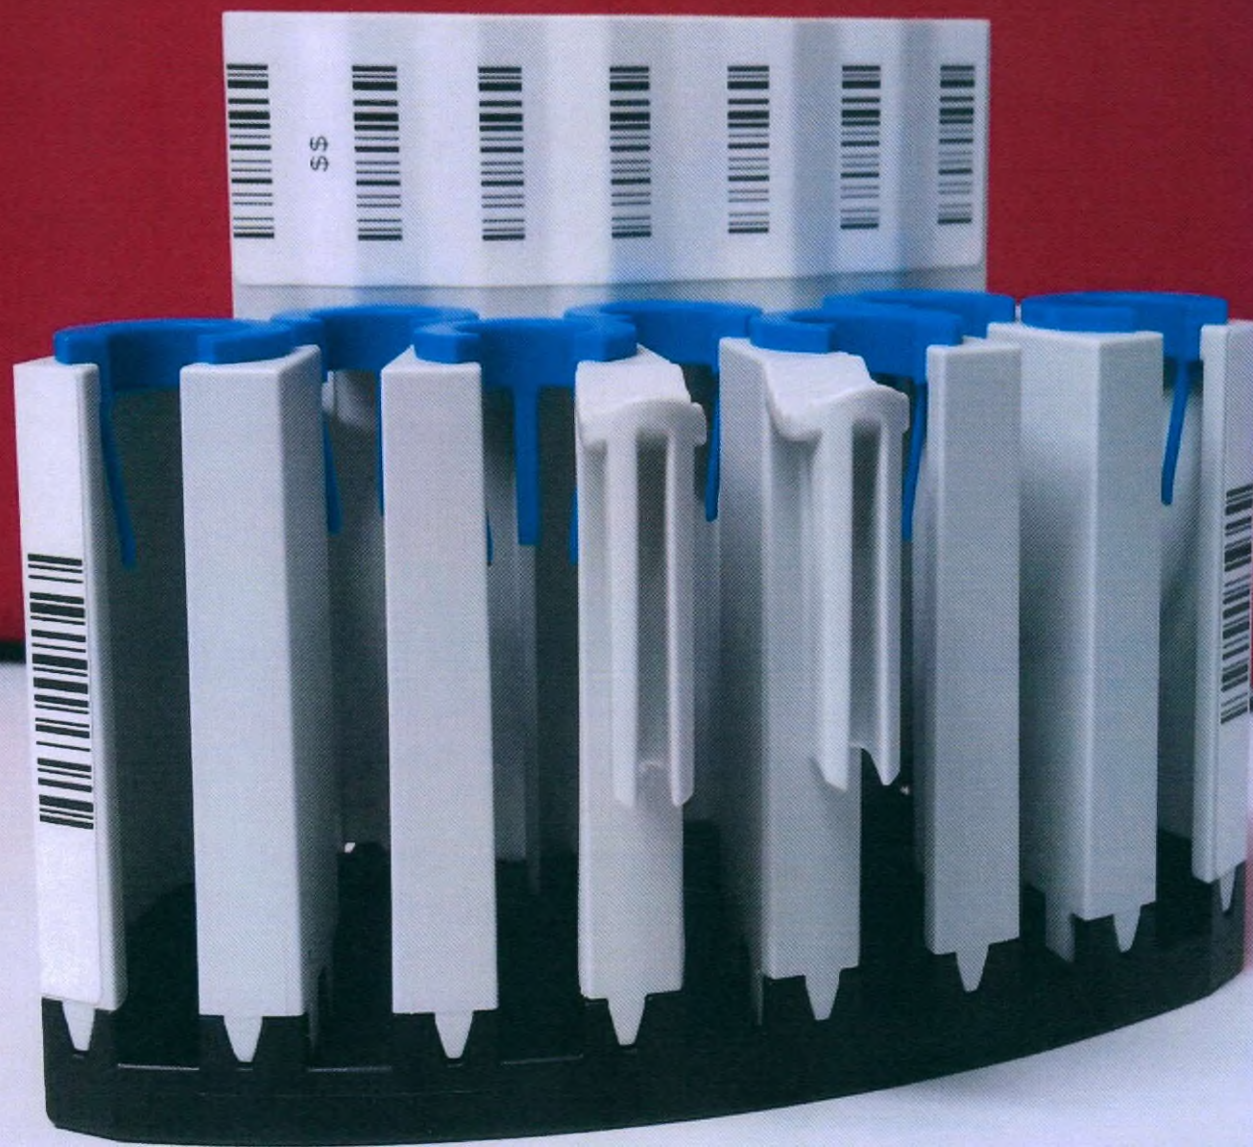


I.55. Штативы для пробирок Sarstedt Monovette объемом 7,5 мл (Sarstedt S-Mono 7.5 mL)



1.56. Штативы для разбавителей (Diluent Rack BioVue)

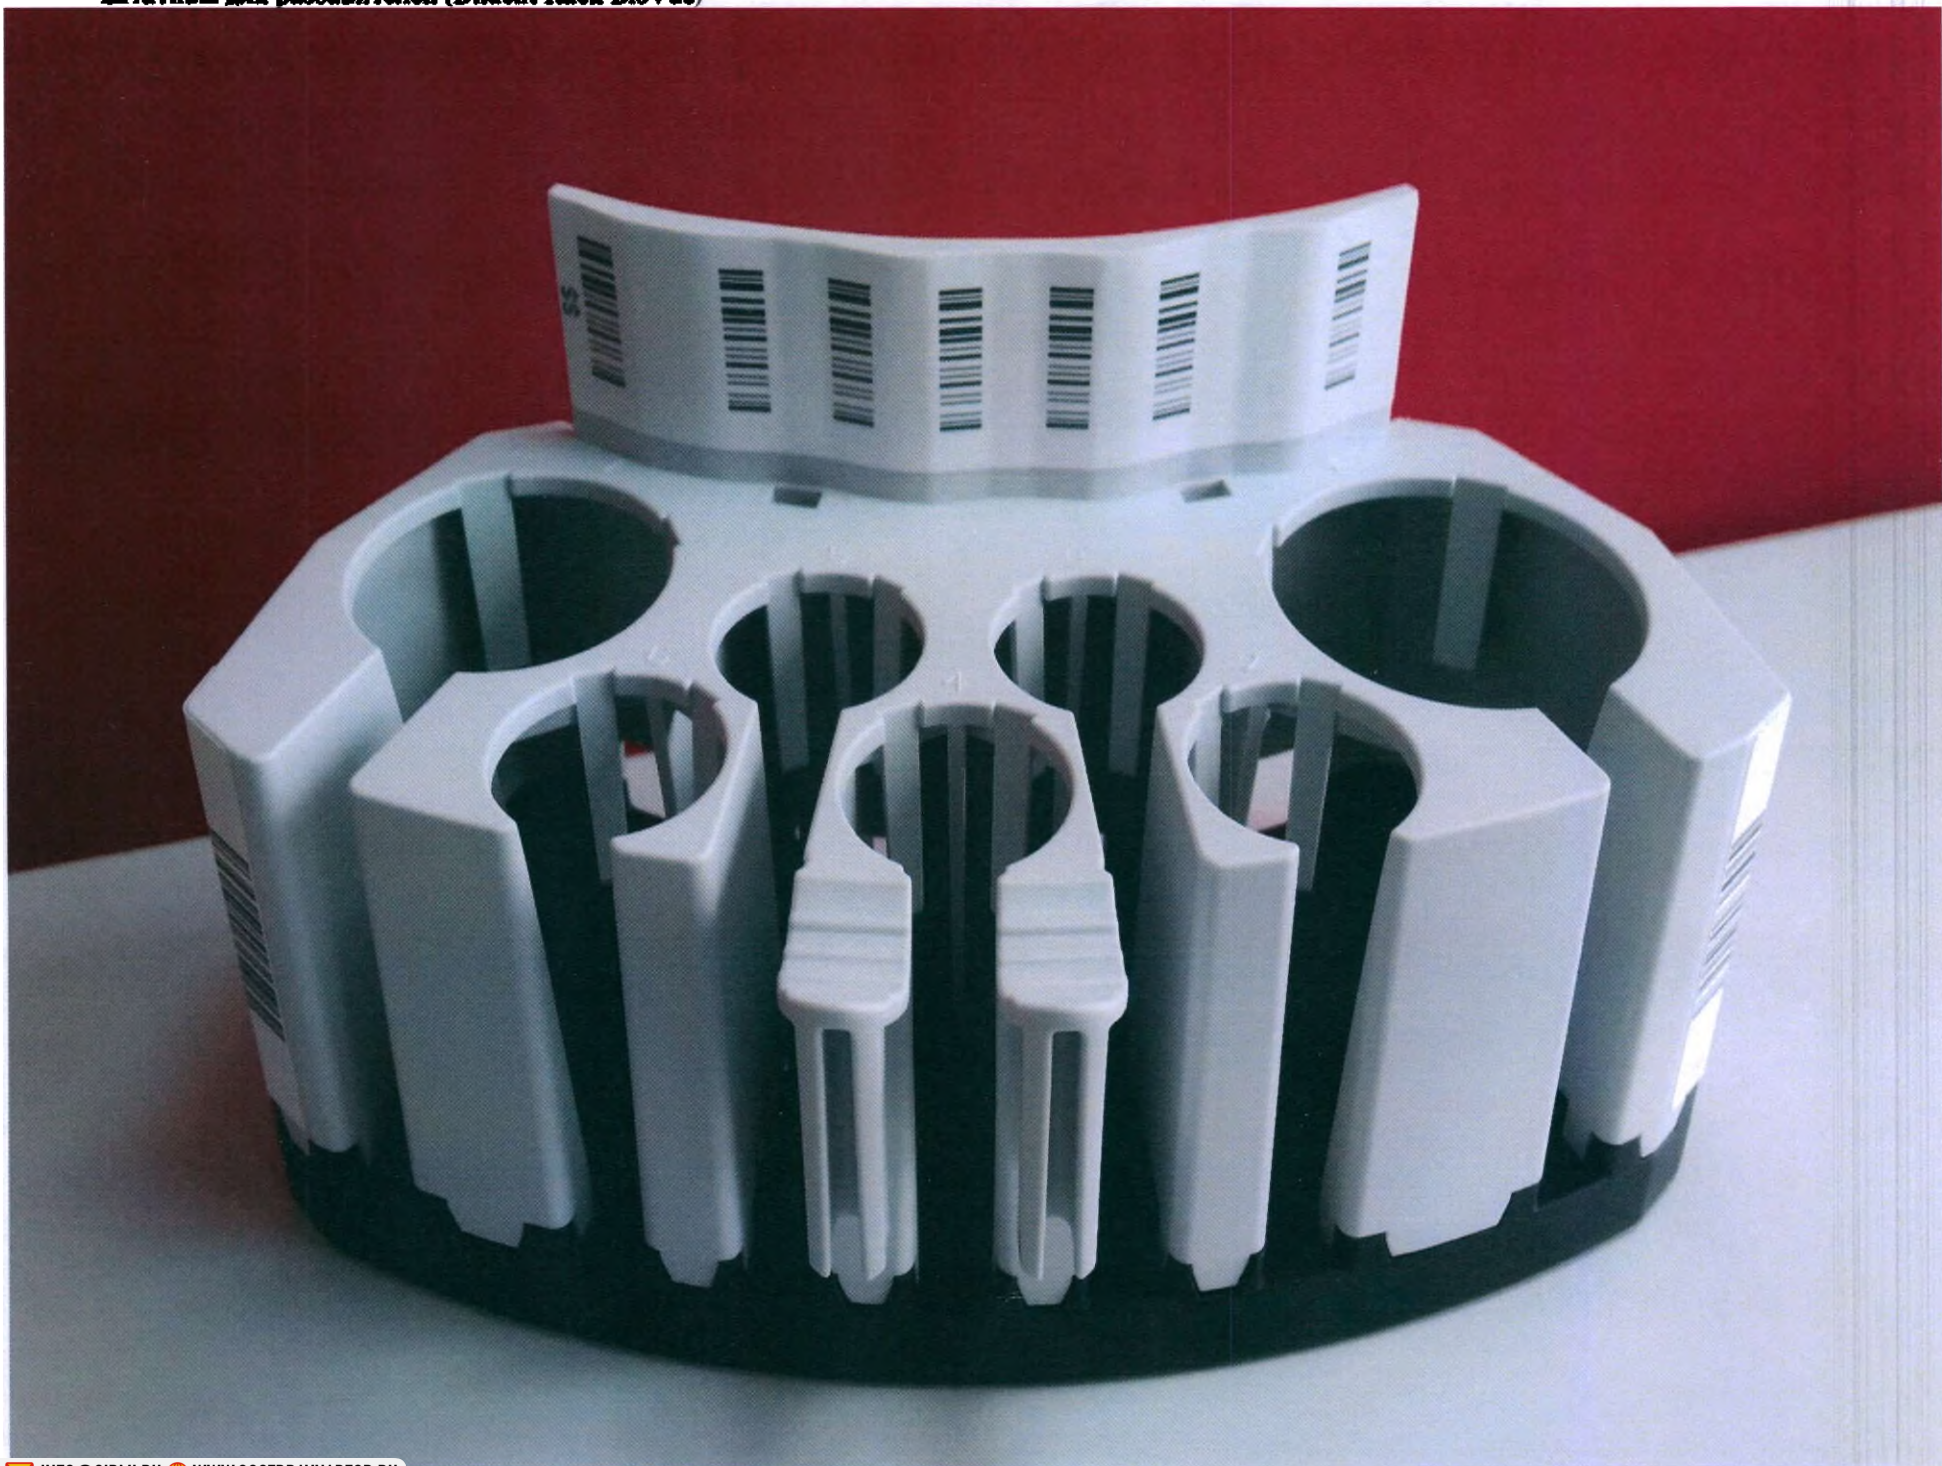

I.57. Штативы для реагентов ORTHO Sera

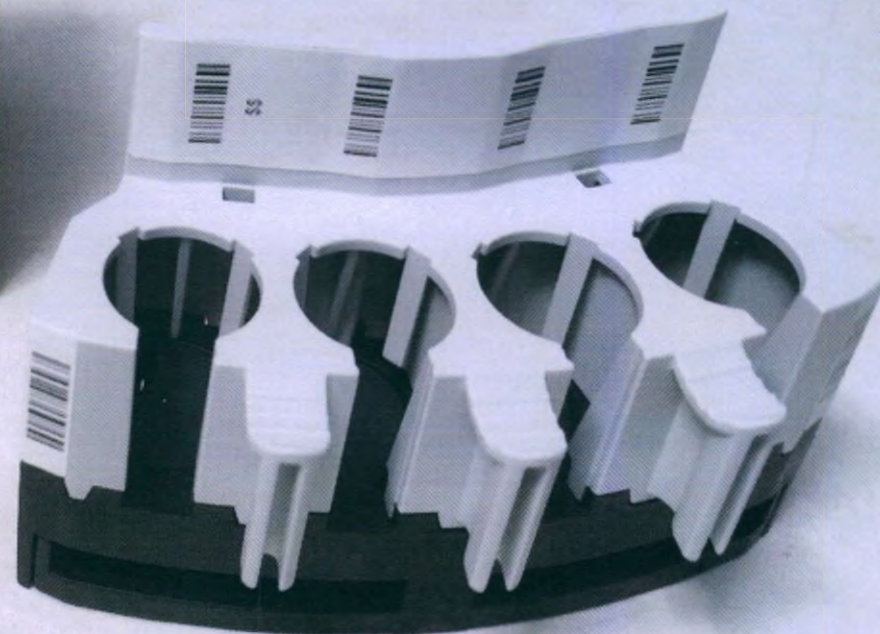






II.2. Монитор с сенсорной панелью (Elo Touch Screen Monitor)





II.3. Сканер штрих-кодов запрограммированный (BarCode Scanner Programmed)




II.4. Рычаг для установки контейнеров (Bottle loading lever)

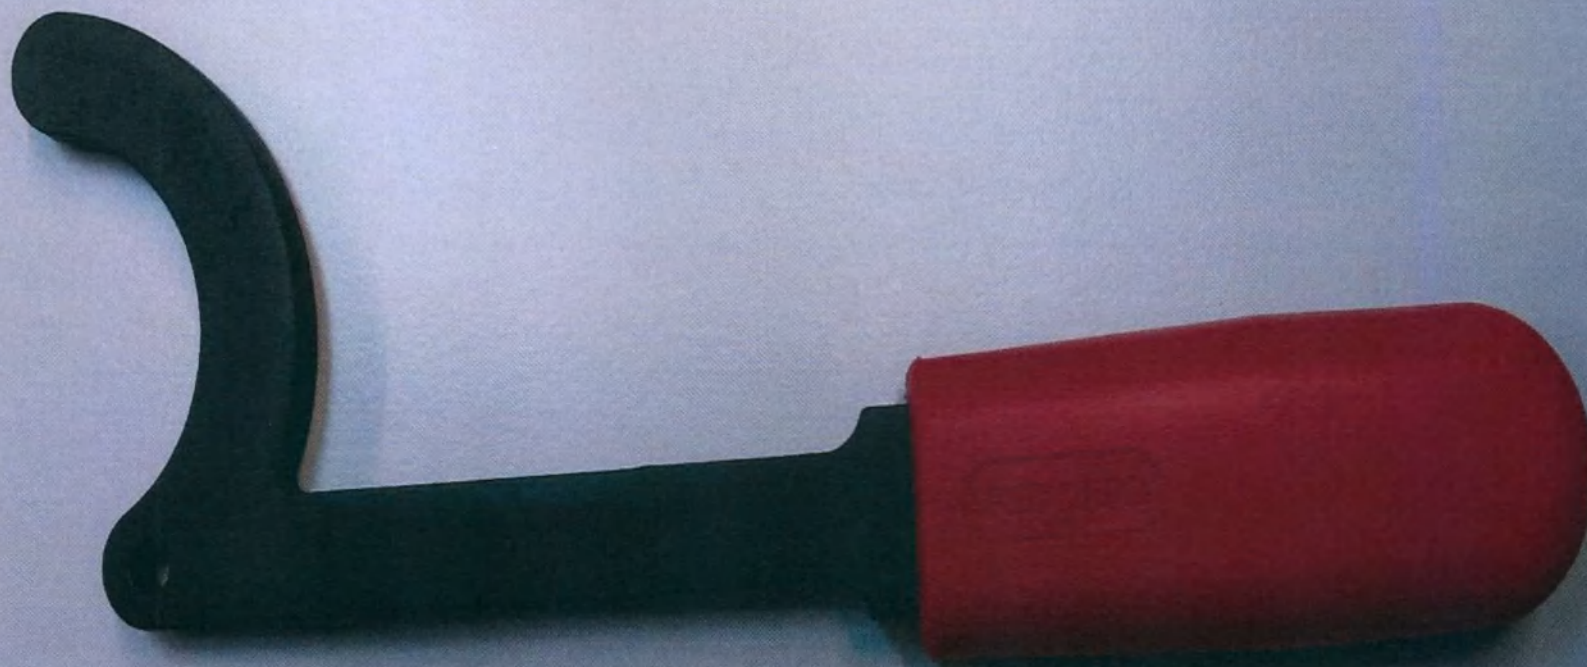

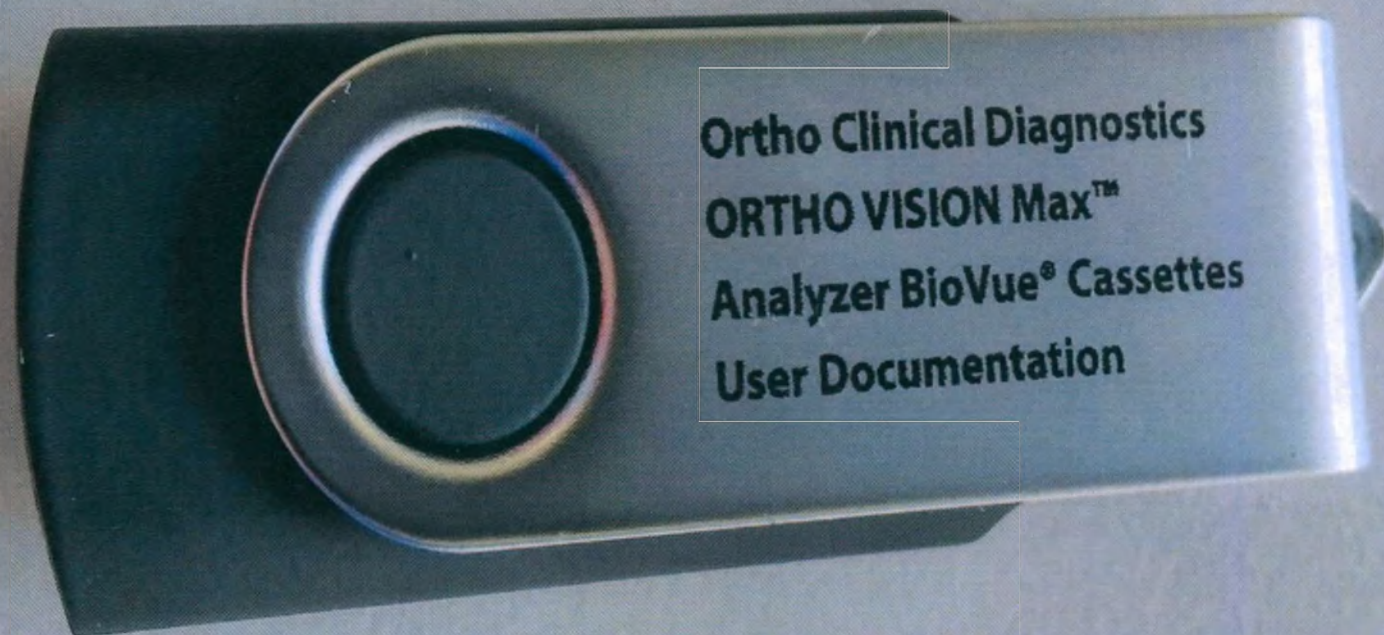

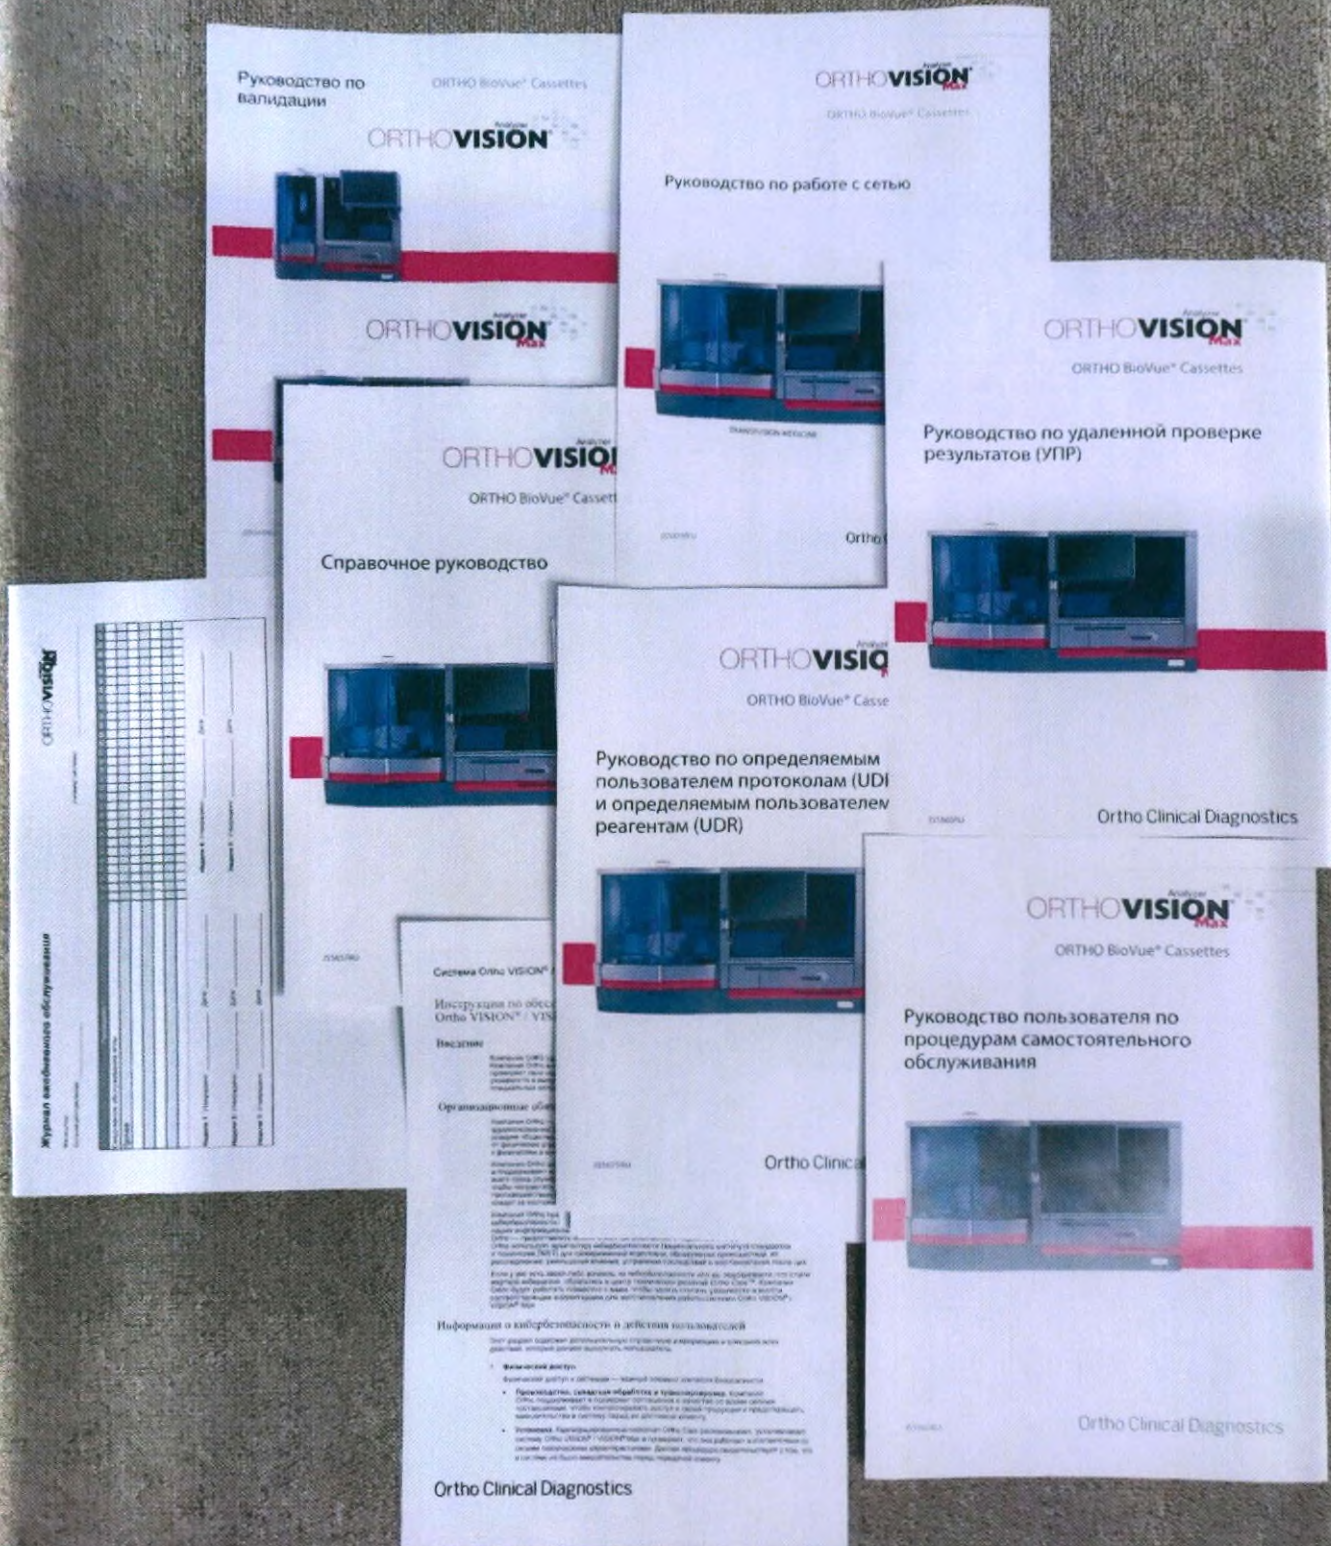

IL.7. Кабель питания с европейским штекером (Power Cable)

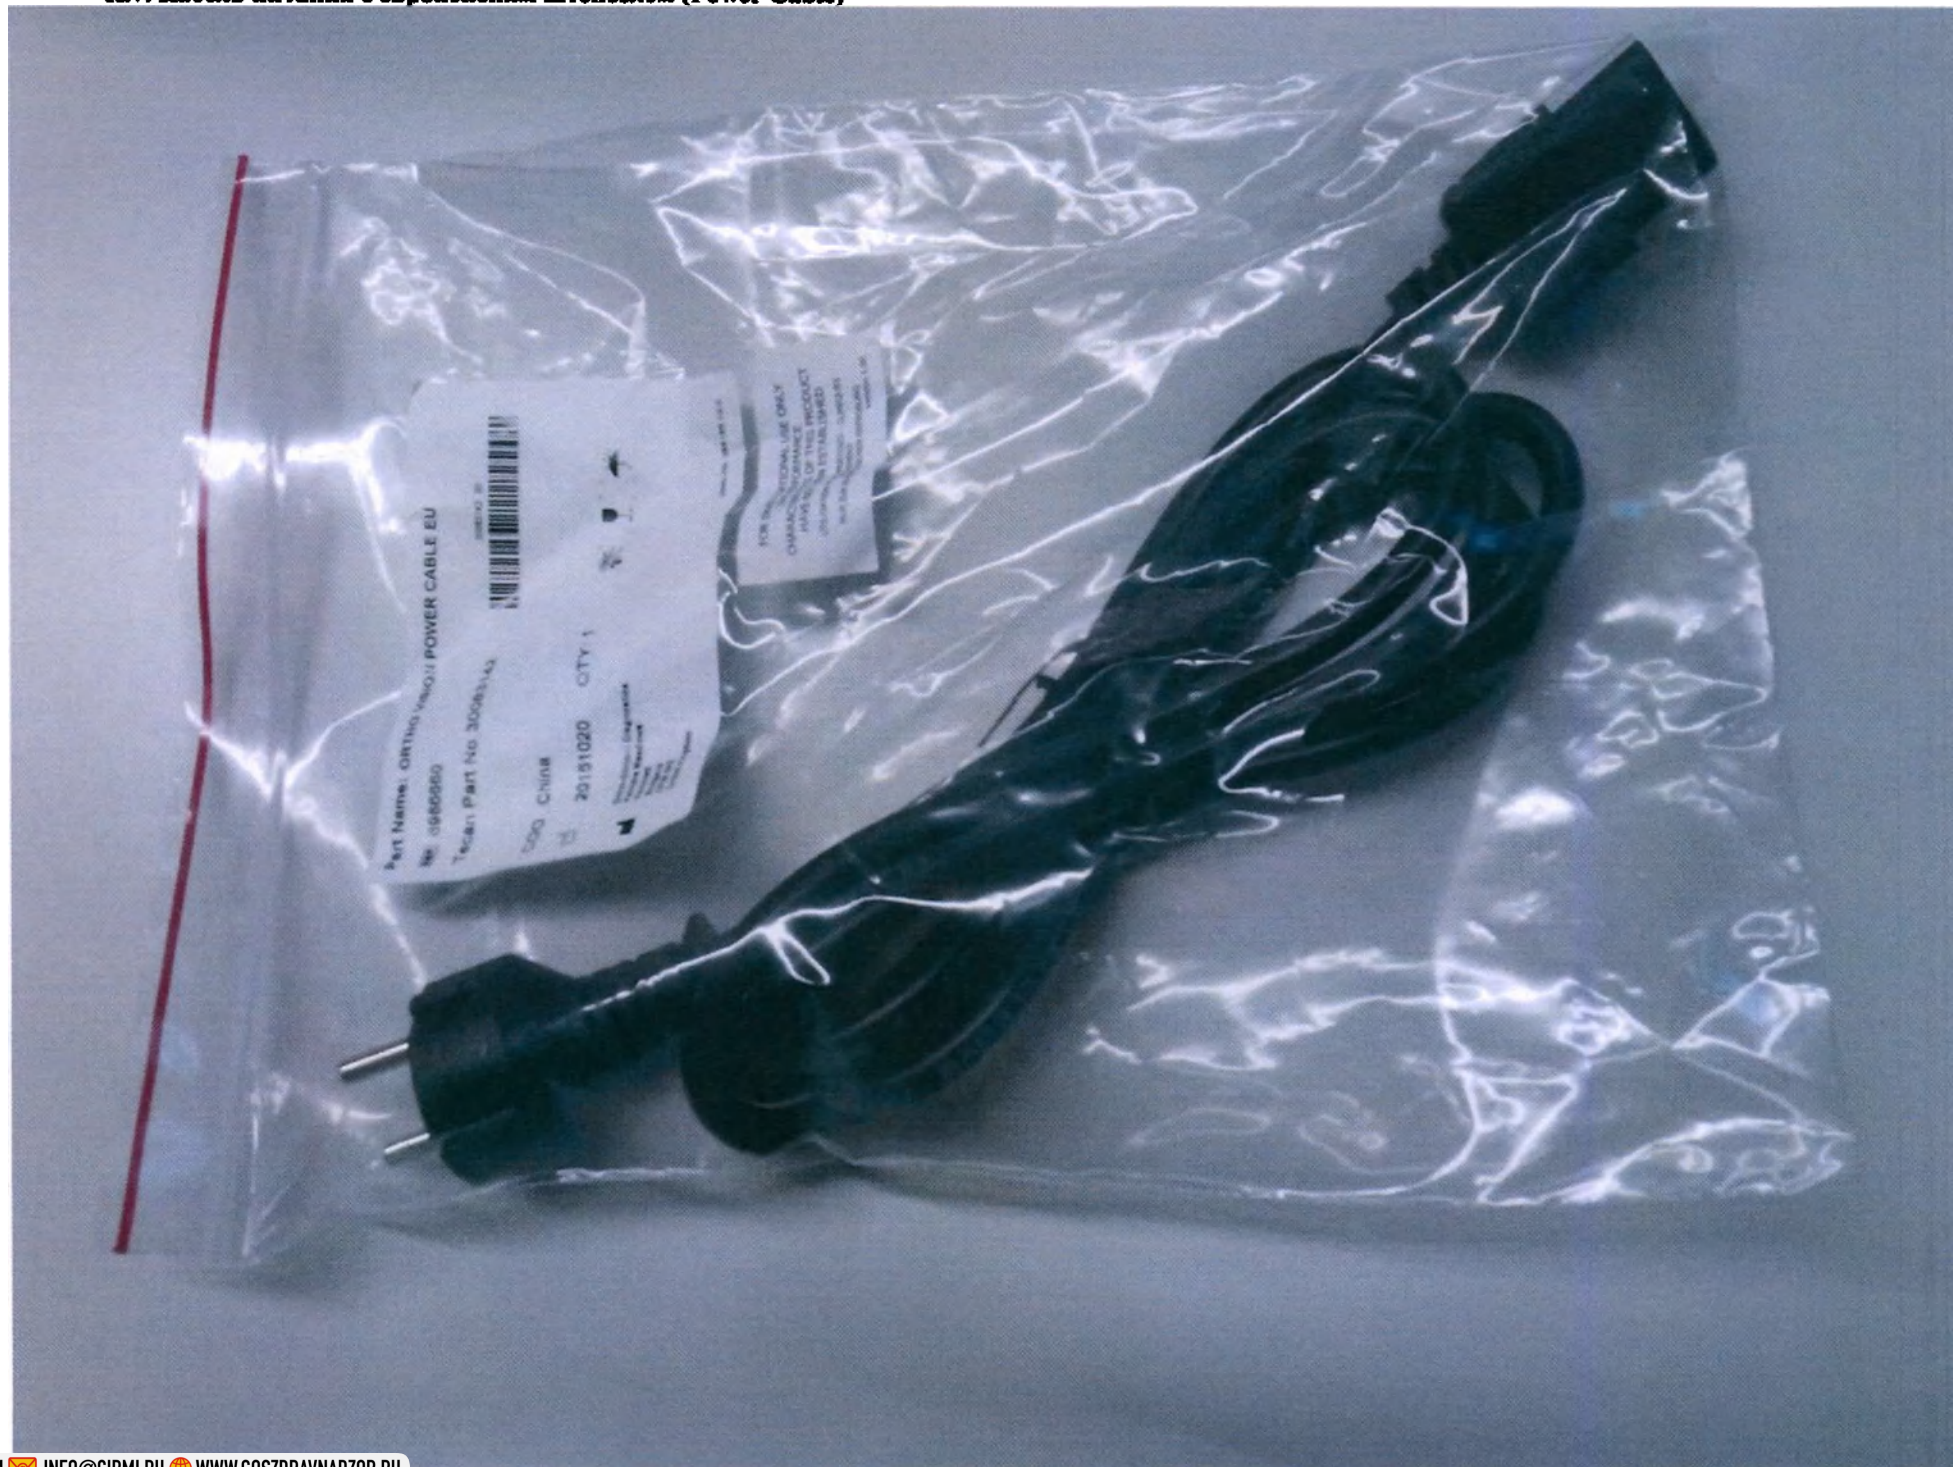

П.8. Внешний резервуар для жидких отходов 10 л (Bottle Waste 10L IWAT)



11.9. Дополнительный контейнер для физ.раствора (Saline Container IWAT)







3 mL

ORTHOVISION™

일회용 3 mL 증발 캡

3 mL fordampningshette til engangsbruk

Tek Kullanımlık 3 mL Buharlaştırma Kapağı

Одноразовый колпачок для защиты от испарения 3 мл

REF
6843004





II.13. Контейнеры для отходов (MTS/BioVue Disposal Container)




II.14. Контейнеры для отходов дополнительные широкие для ORTHO VISION Max (ORTHO VISION Max BioVue Disposal Container)




IMPORTANT
INSTALL THIS SIDE
FACING INSTRUMENTS FRONT


II.16. Контейнер для системных жидкостей (Liquid Wash Container)

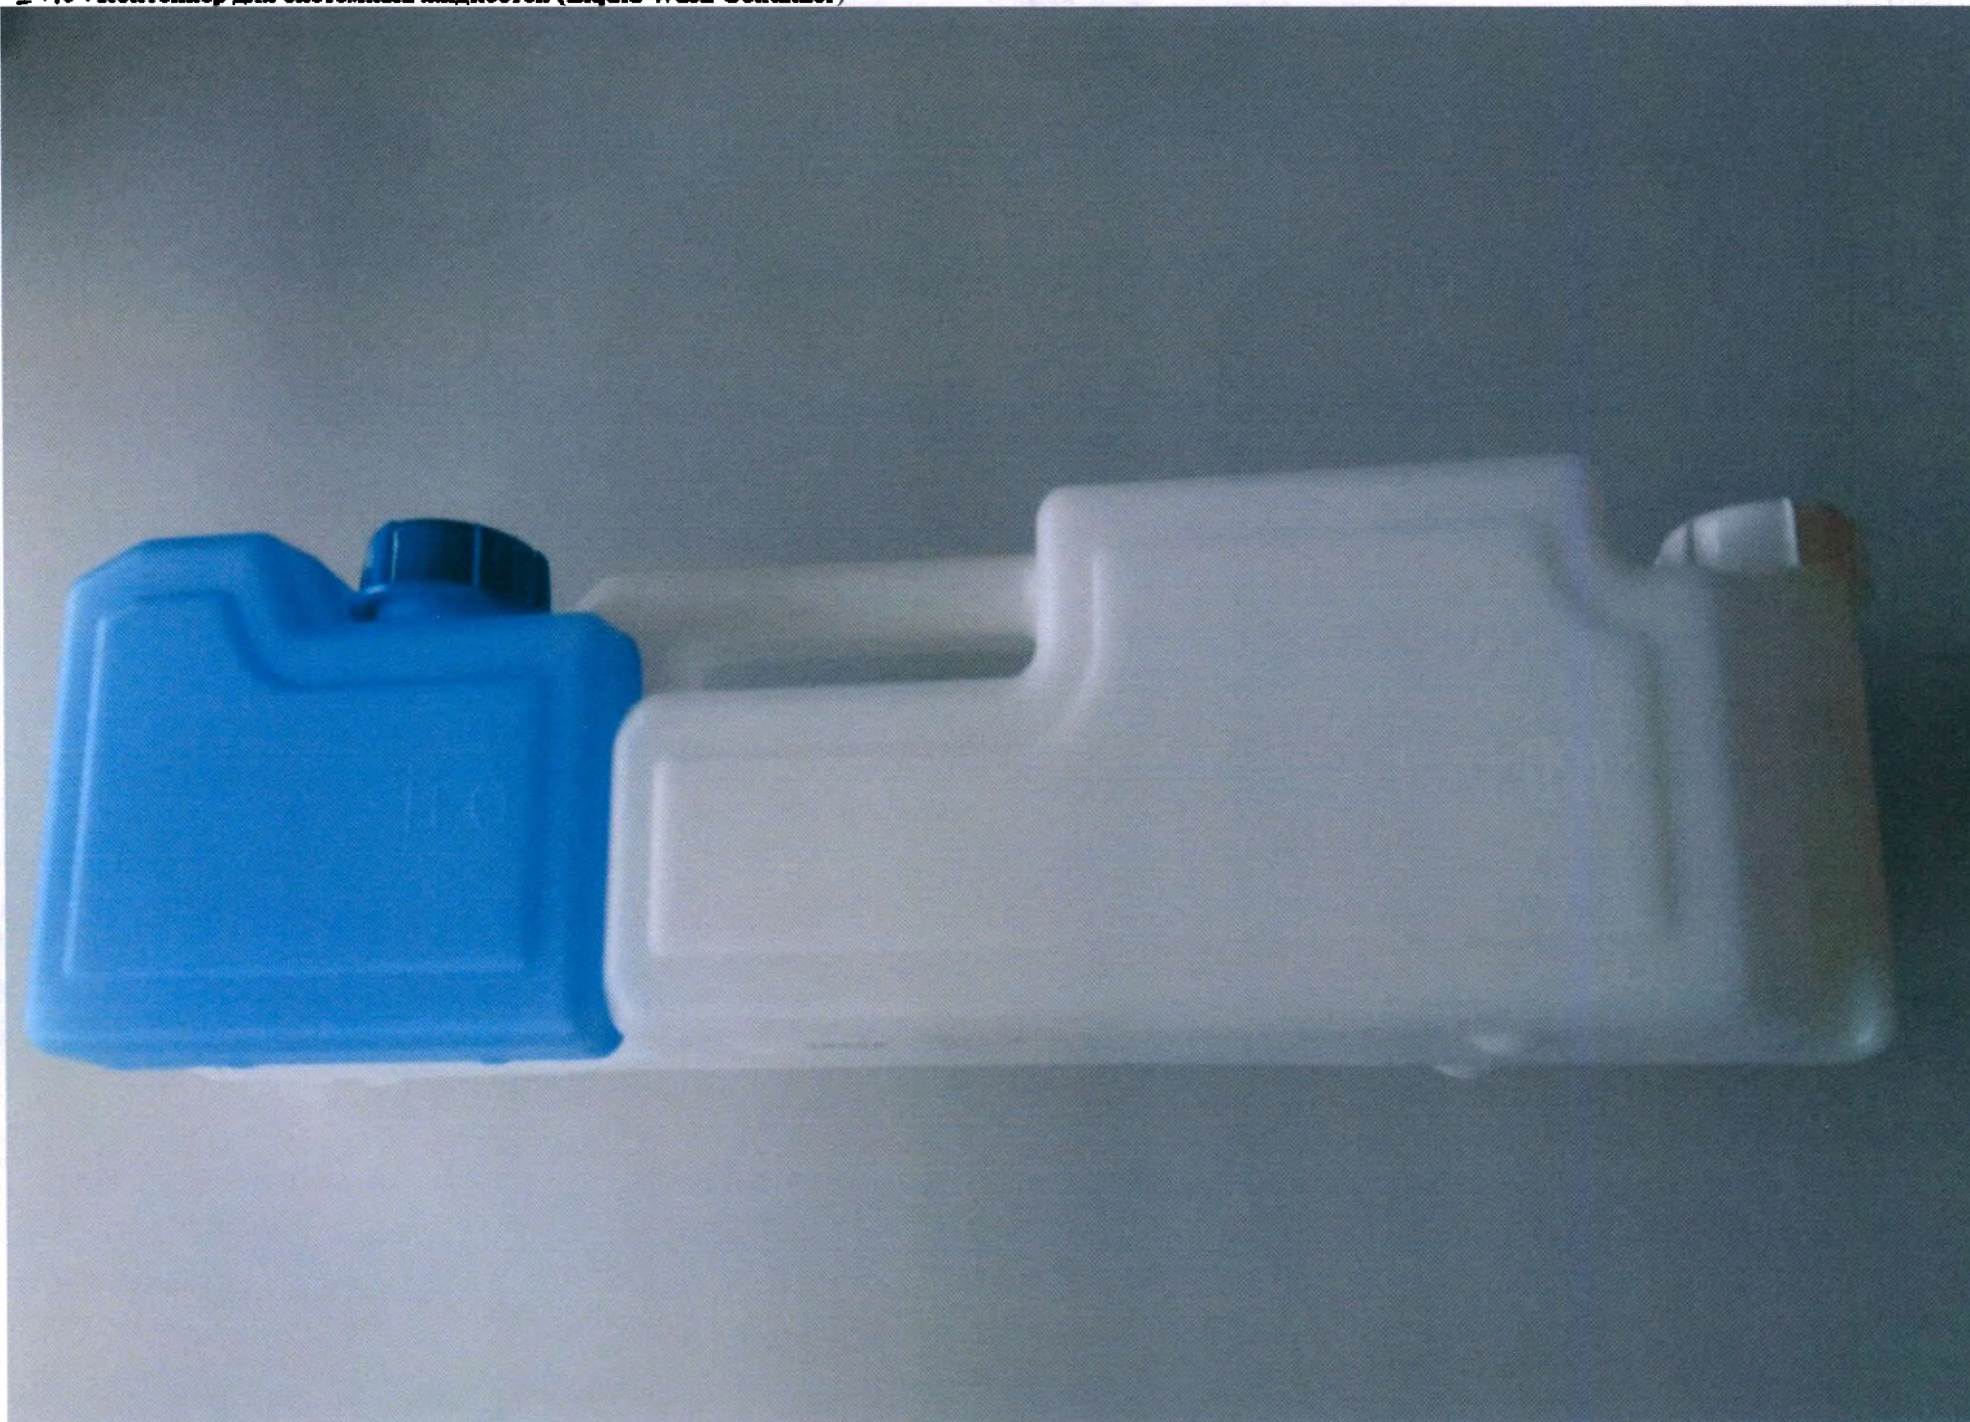

П.17. Крышки для контейнера с водой (Lid bottle blue H2O – Blue)

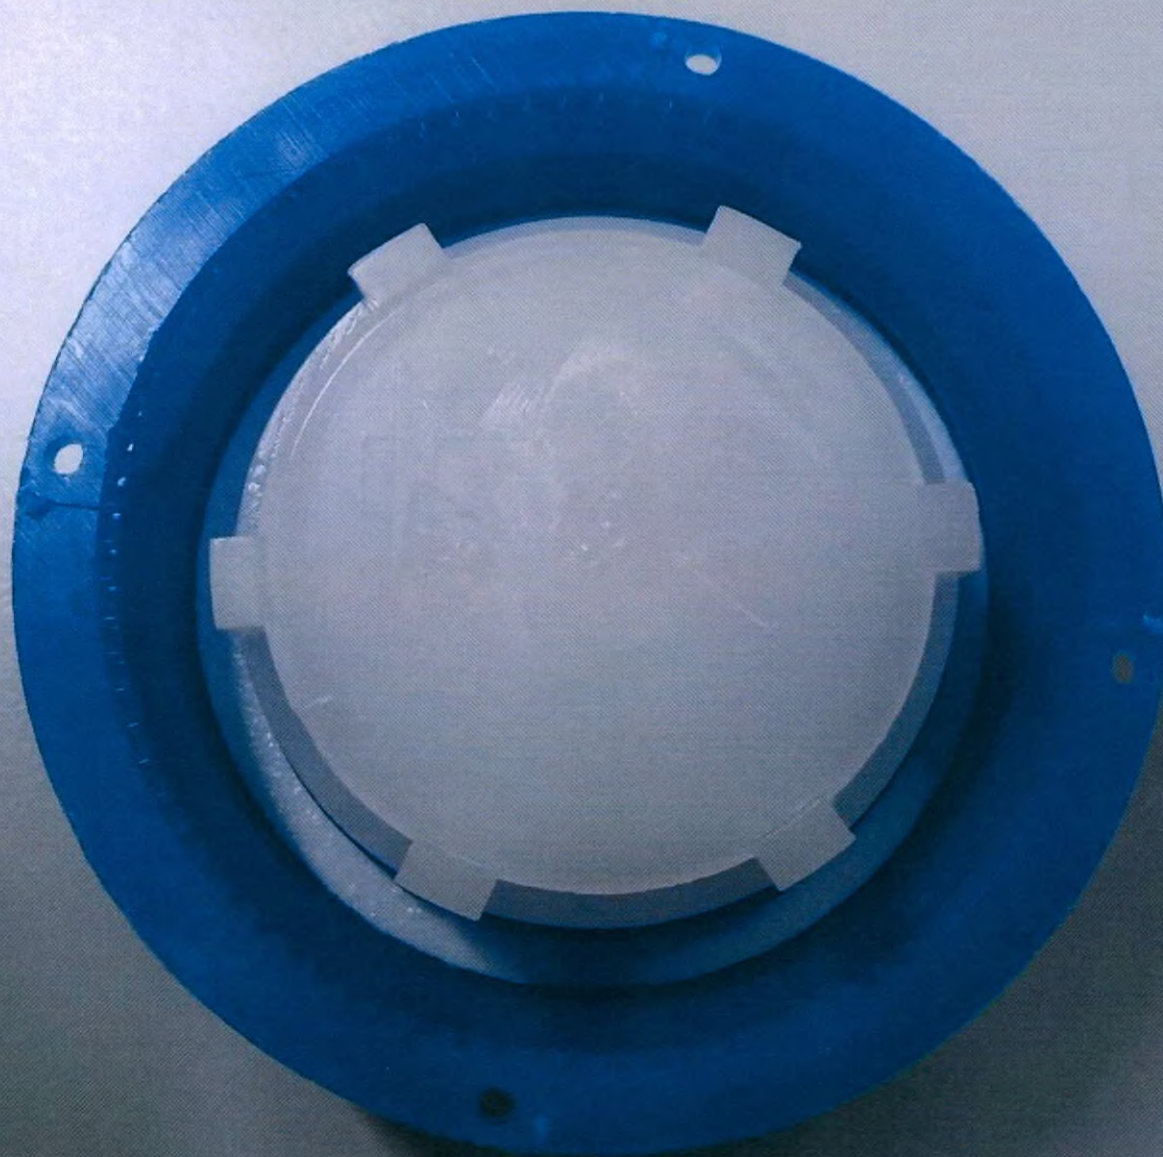

II.18. Крышки для контейнера с жидкими отходами (Lid bottle waste)

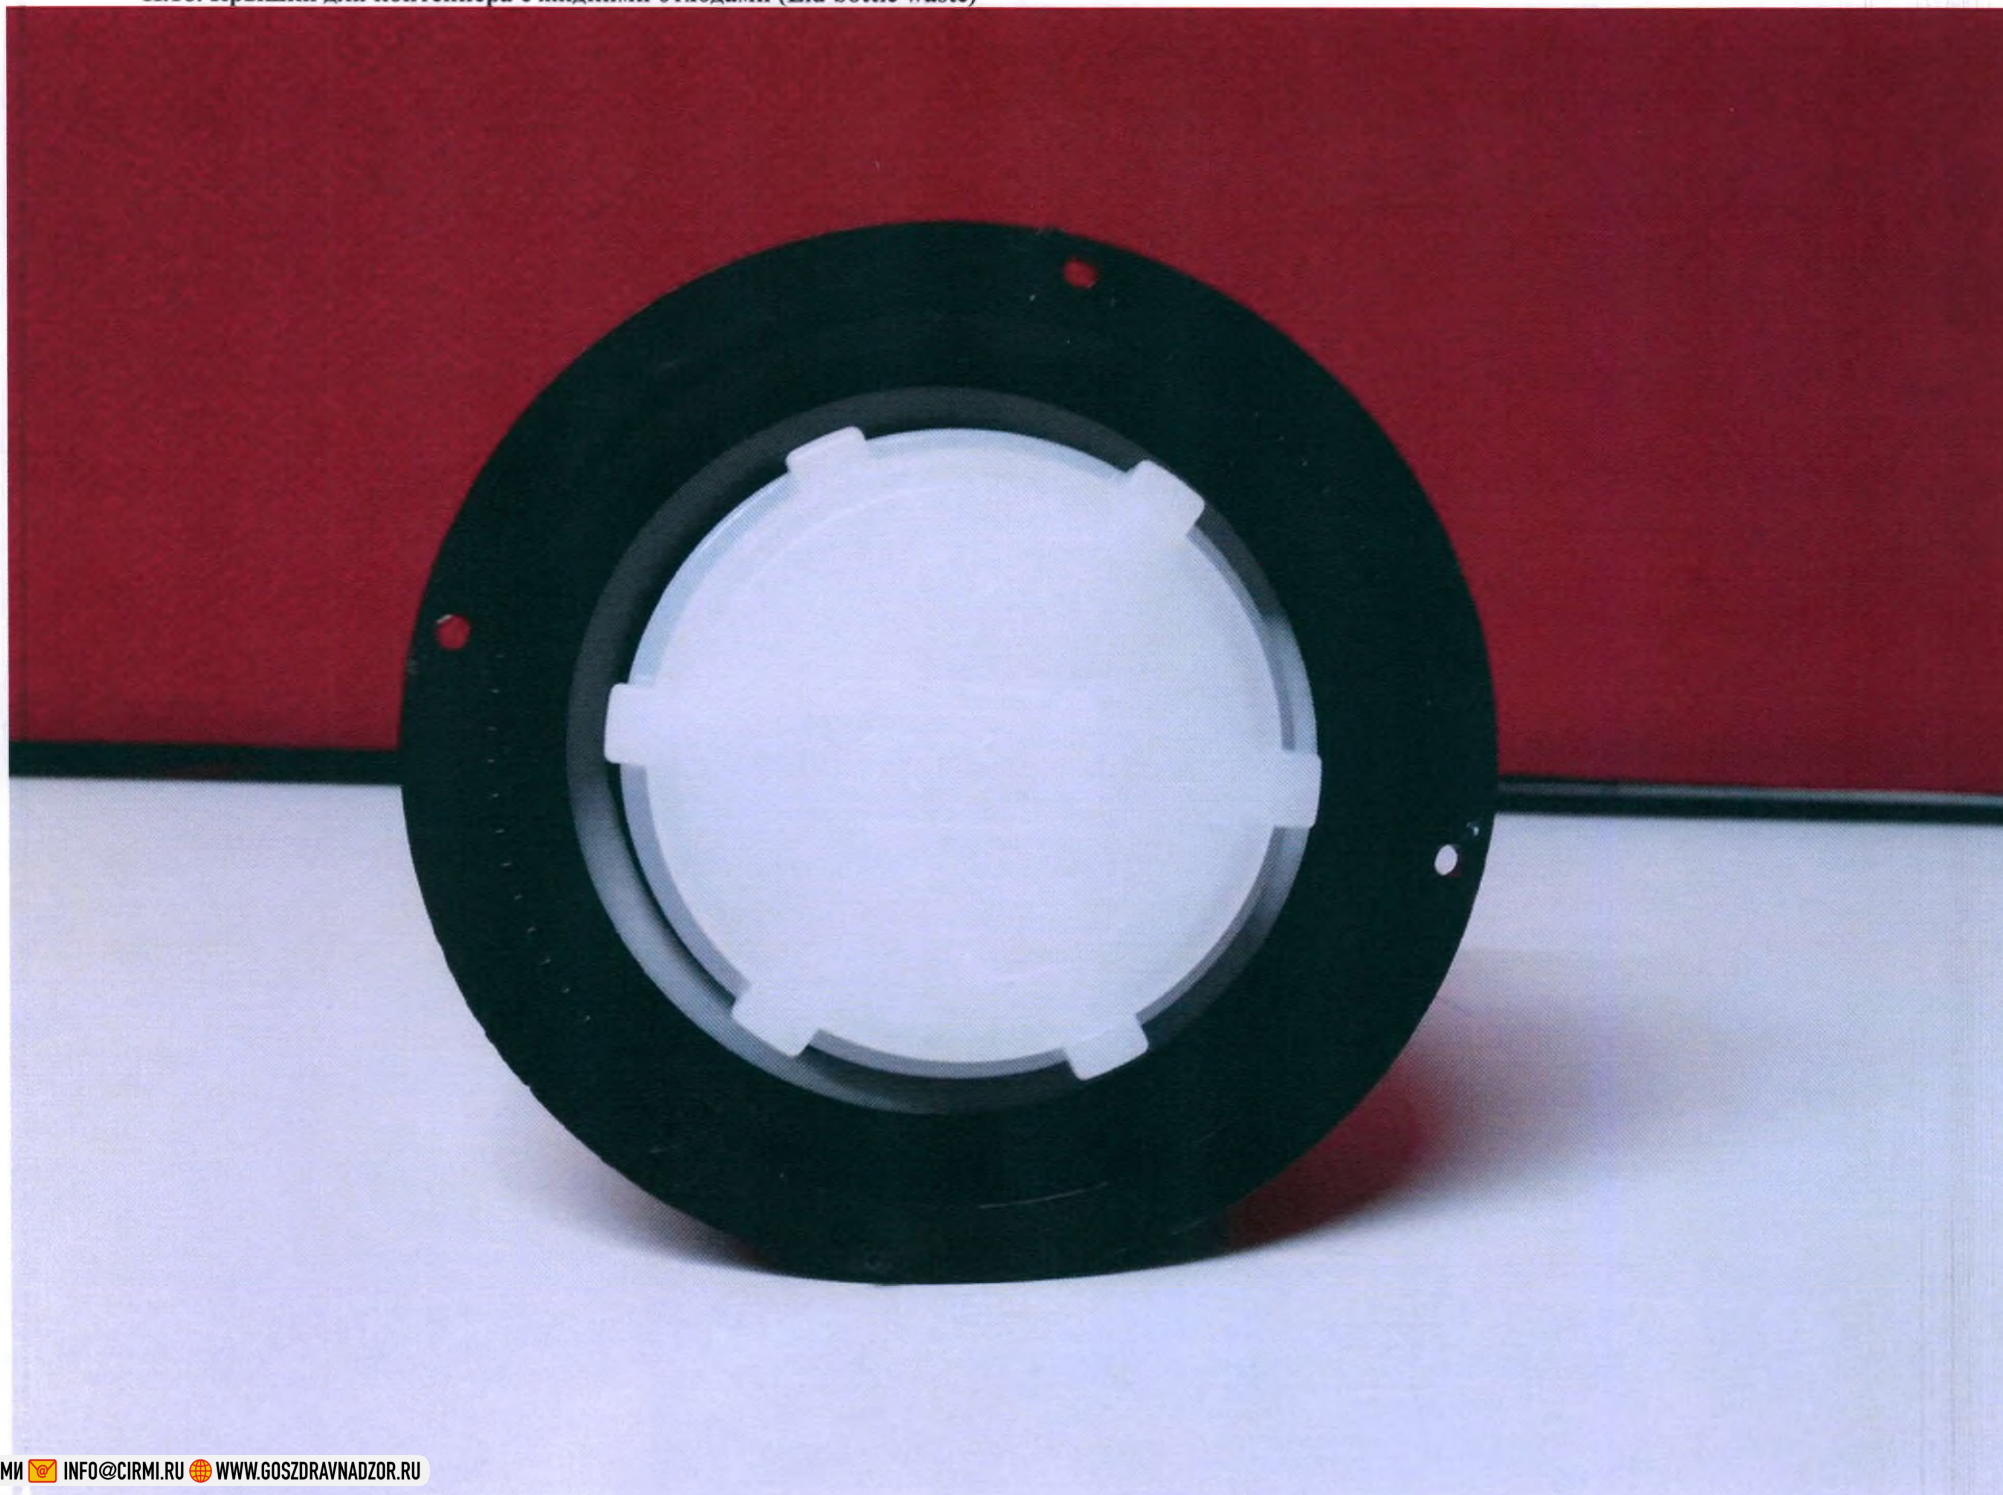


II.19. Крышки для контейнера с физ.раствором (Lid for saline bottle – White)




II.20. Лотки для разбавления одноразовые (Single-Use Dilution Tray)



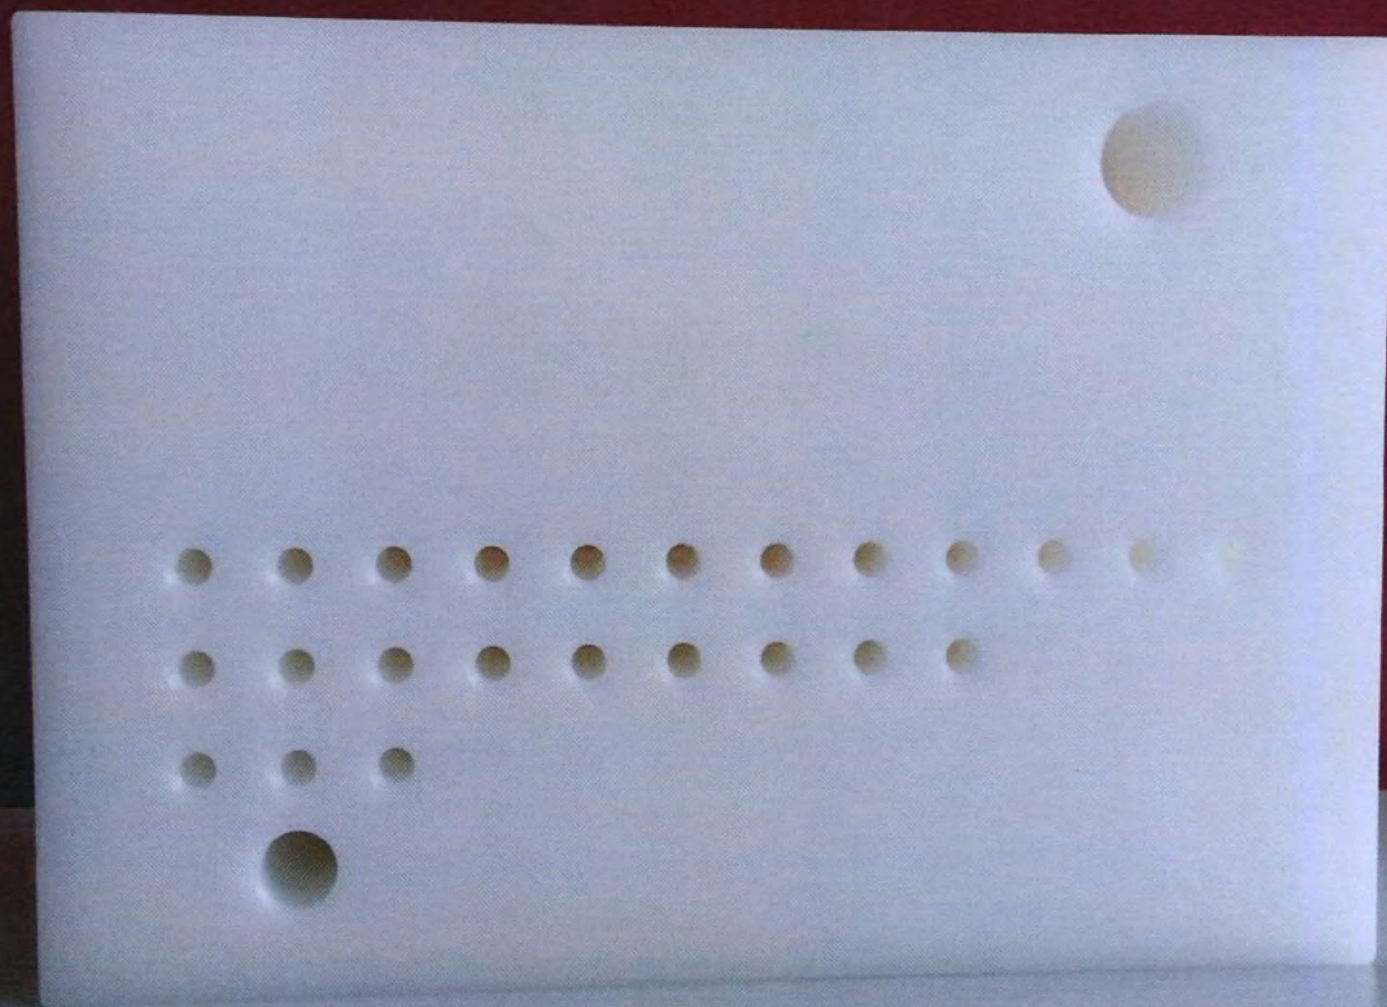



И. 23. Набор для вскрытия BioVue кассет (Punch Tool Set BioVue)

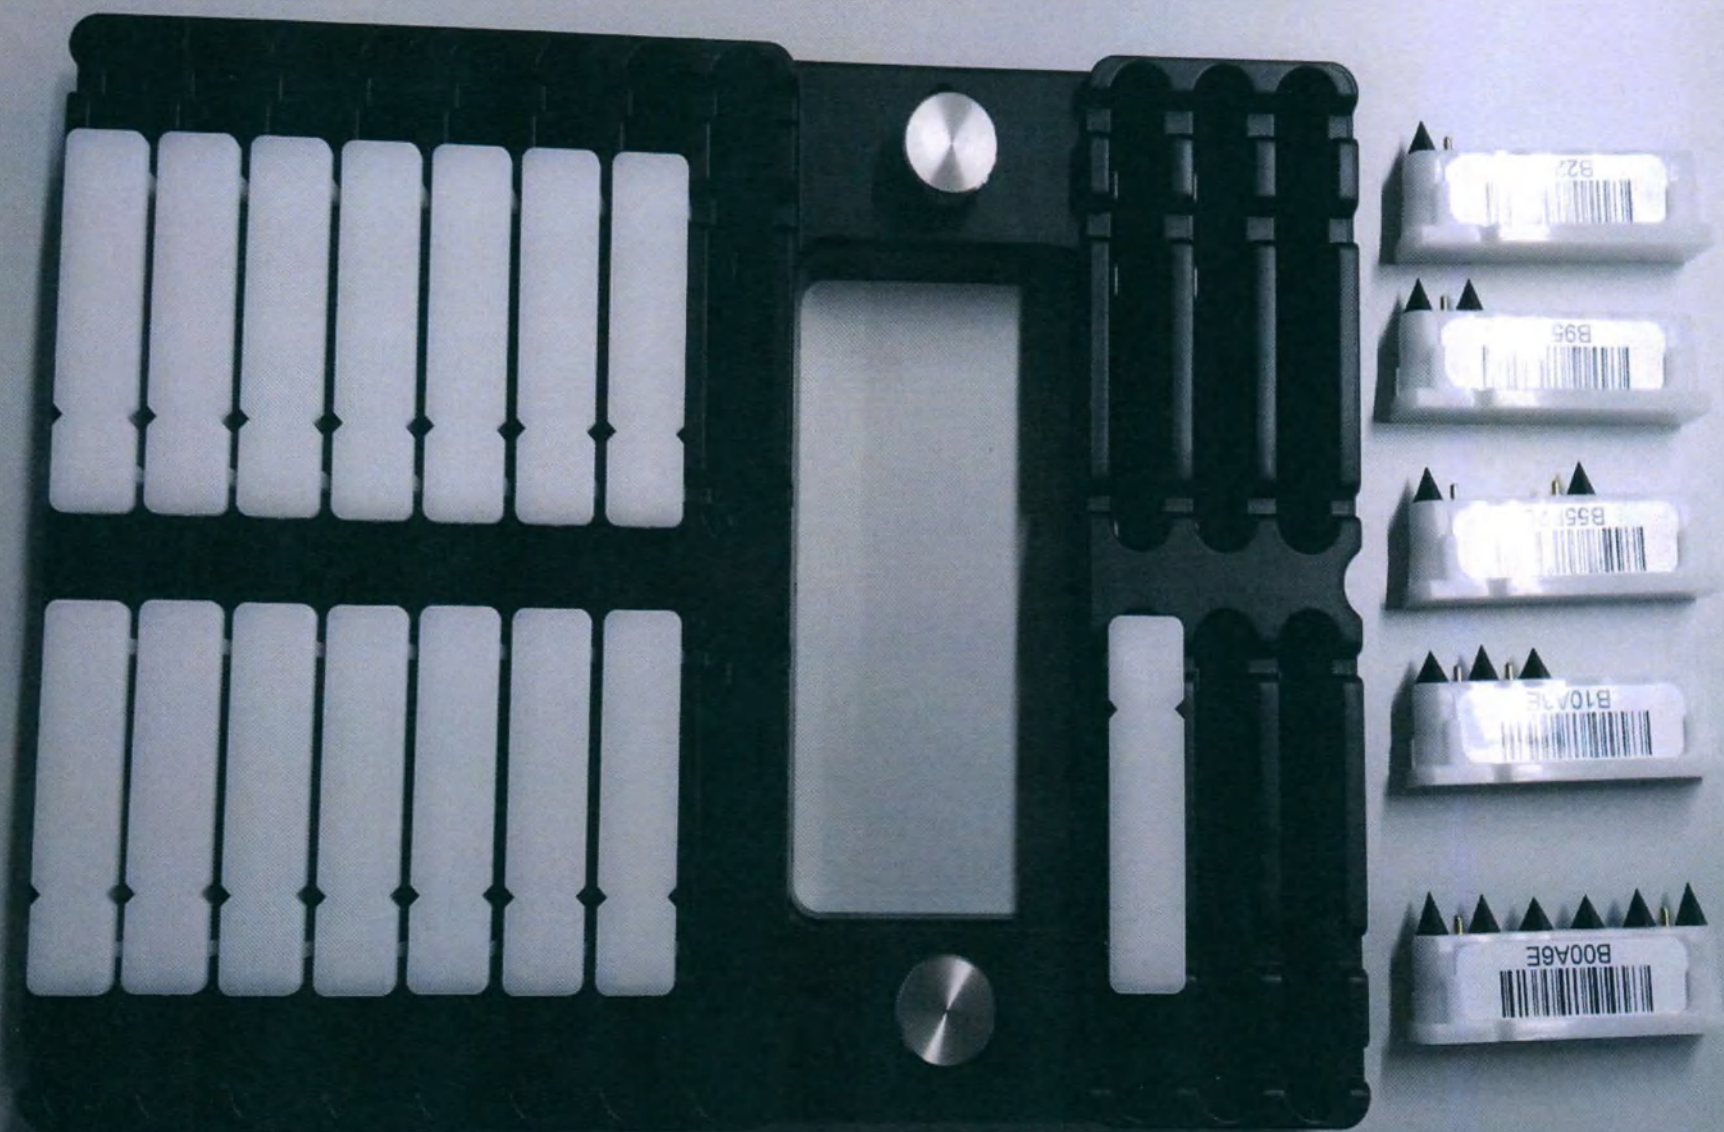

П.24. Наборы для подключения к дренажной линии ORTHO VISION Max (ORTHO VISION Max drain kit)



II.25. Наборы для проведения планового обслуживания анализатора ORTHO VISION Max (ORTHO VISION Max Operator Maintenance Kit)



П.26. Наборы для установки дополнительного контейнера с физ.раствором и для подключения к дренажной линии (4HR2nd Saline & Direct Drain)



II.27. Наборы для установки дополнительного контейнера с физ.раствором и контейнера для отходов (4HR 2nd Saline & Waste)



II.28. Наборы материалов и инструментов для обслуживания ORTHO VISION Max пользователем (ORTHO VISION Max Spare Parts and Tool Kit)








II.31. Программное обеспечение на USB для ORTHO VISION Max (ORTHO VISION Max Software USB)




П.32. Стол для анализатора ORTHO VISION Max (ORTHO VISION Max Table)





II.33. Транспортировочные ручки (Transport Handles)

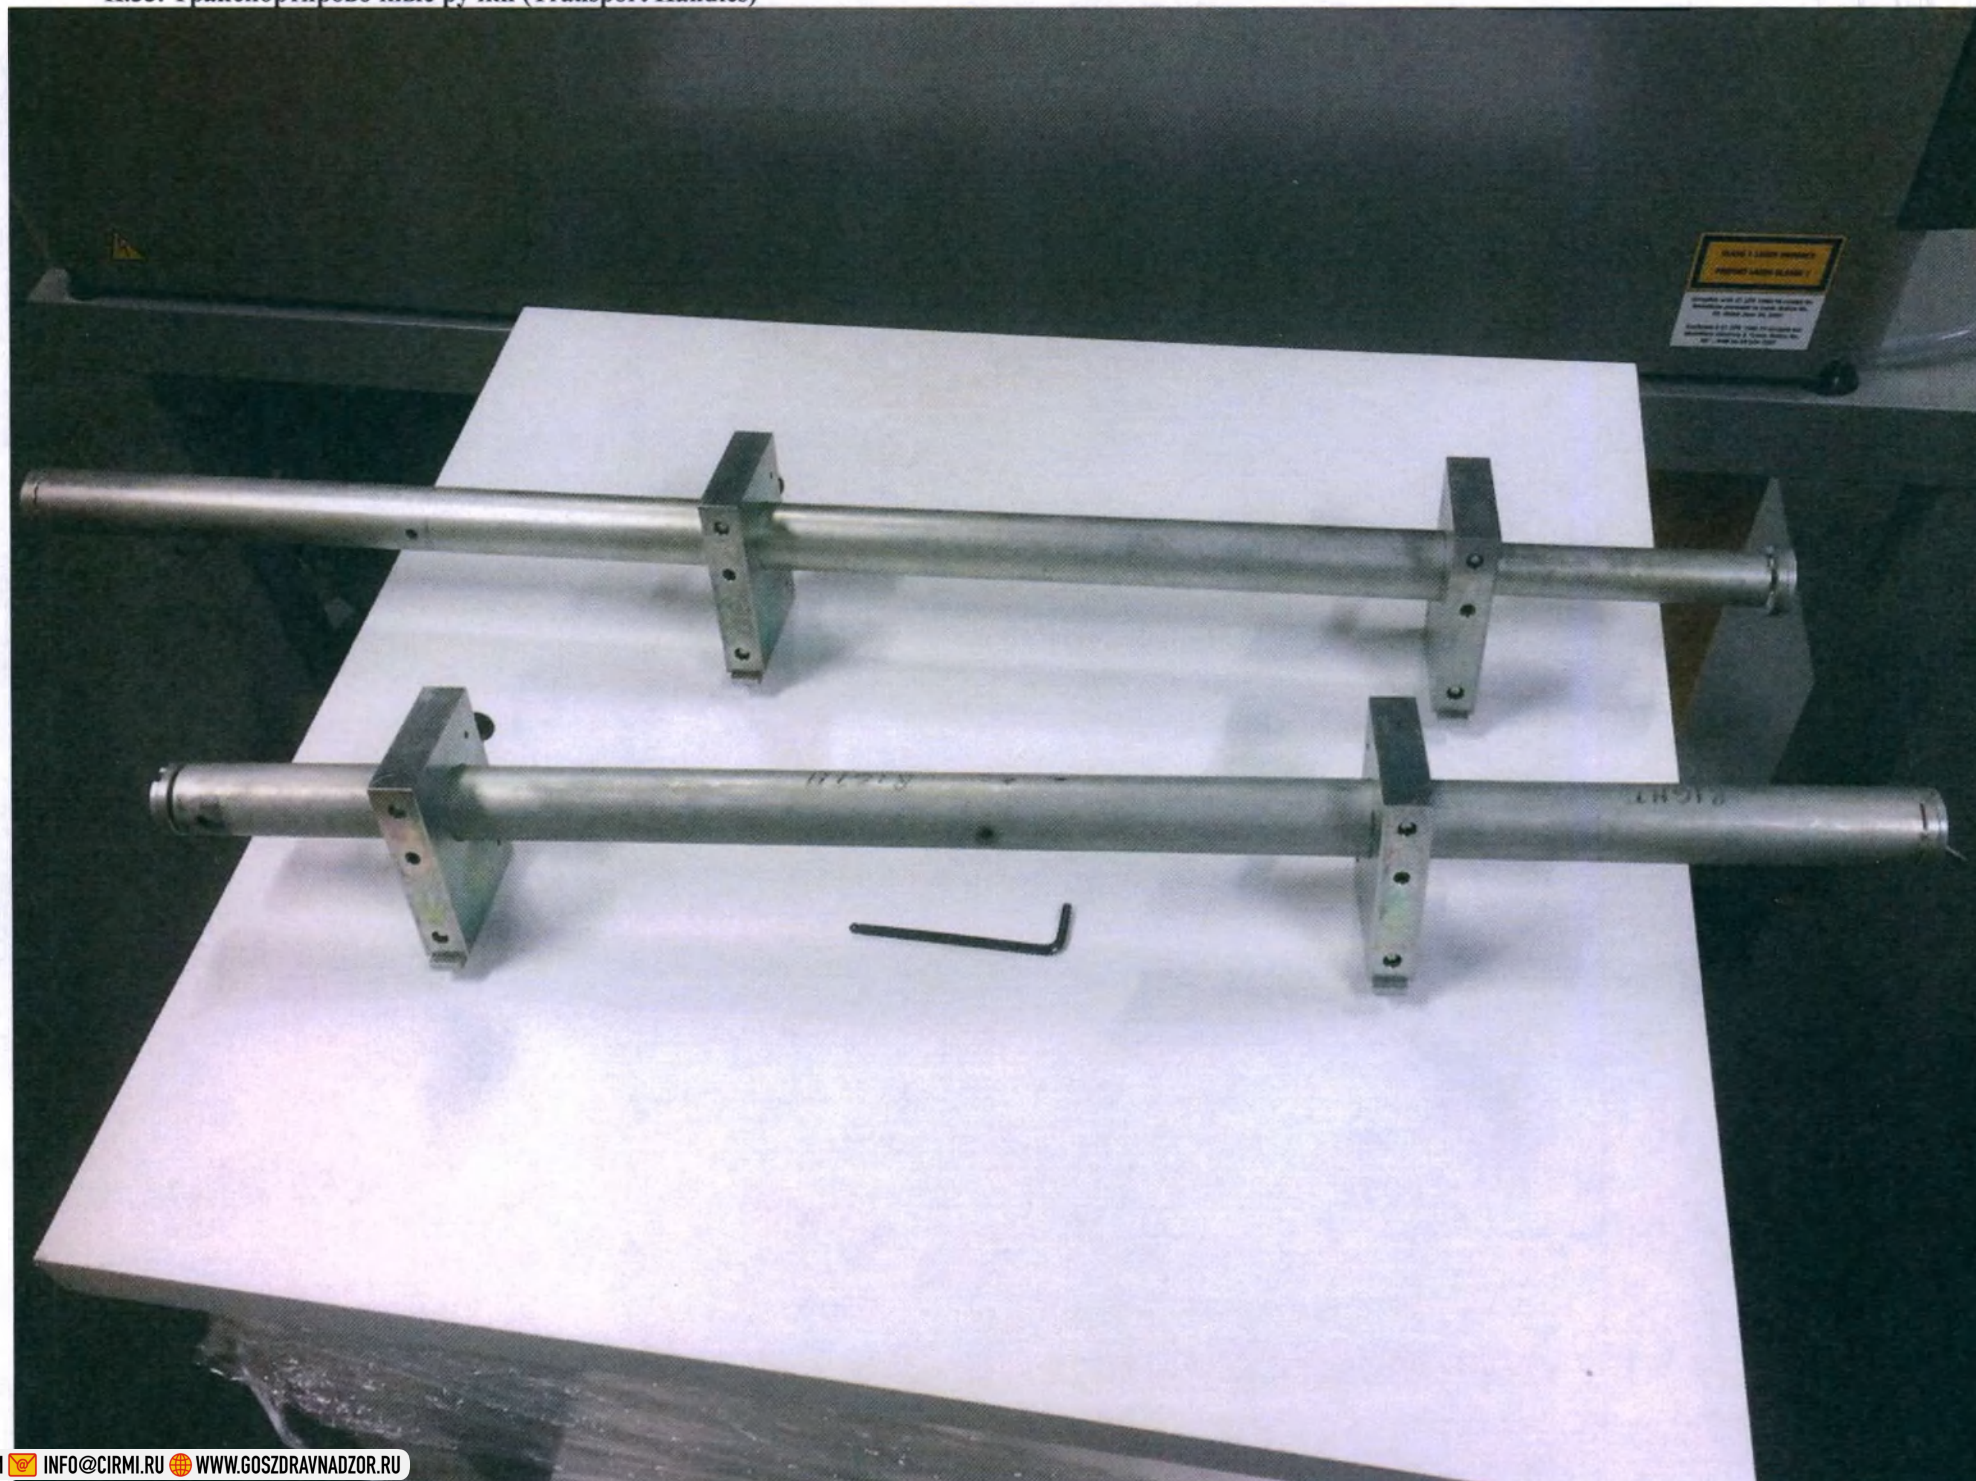

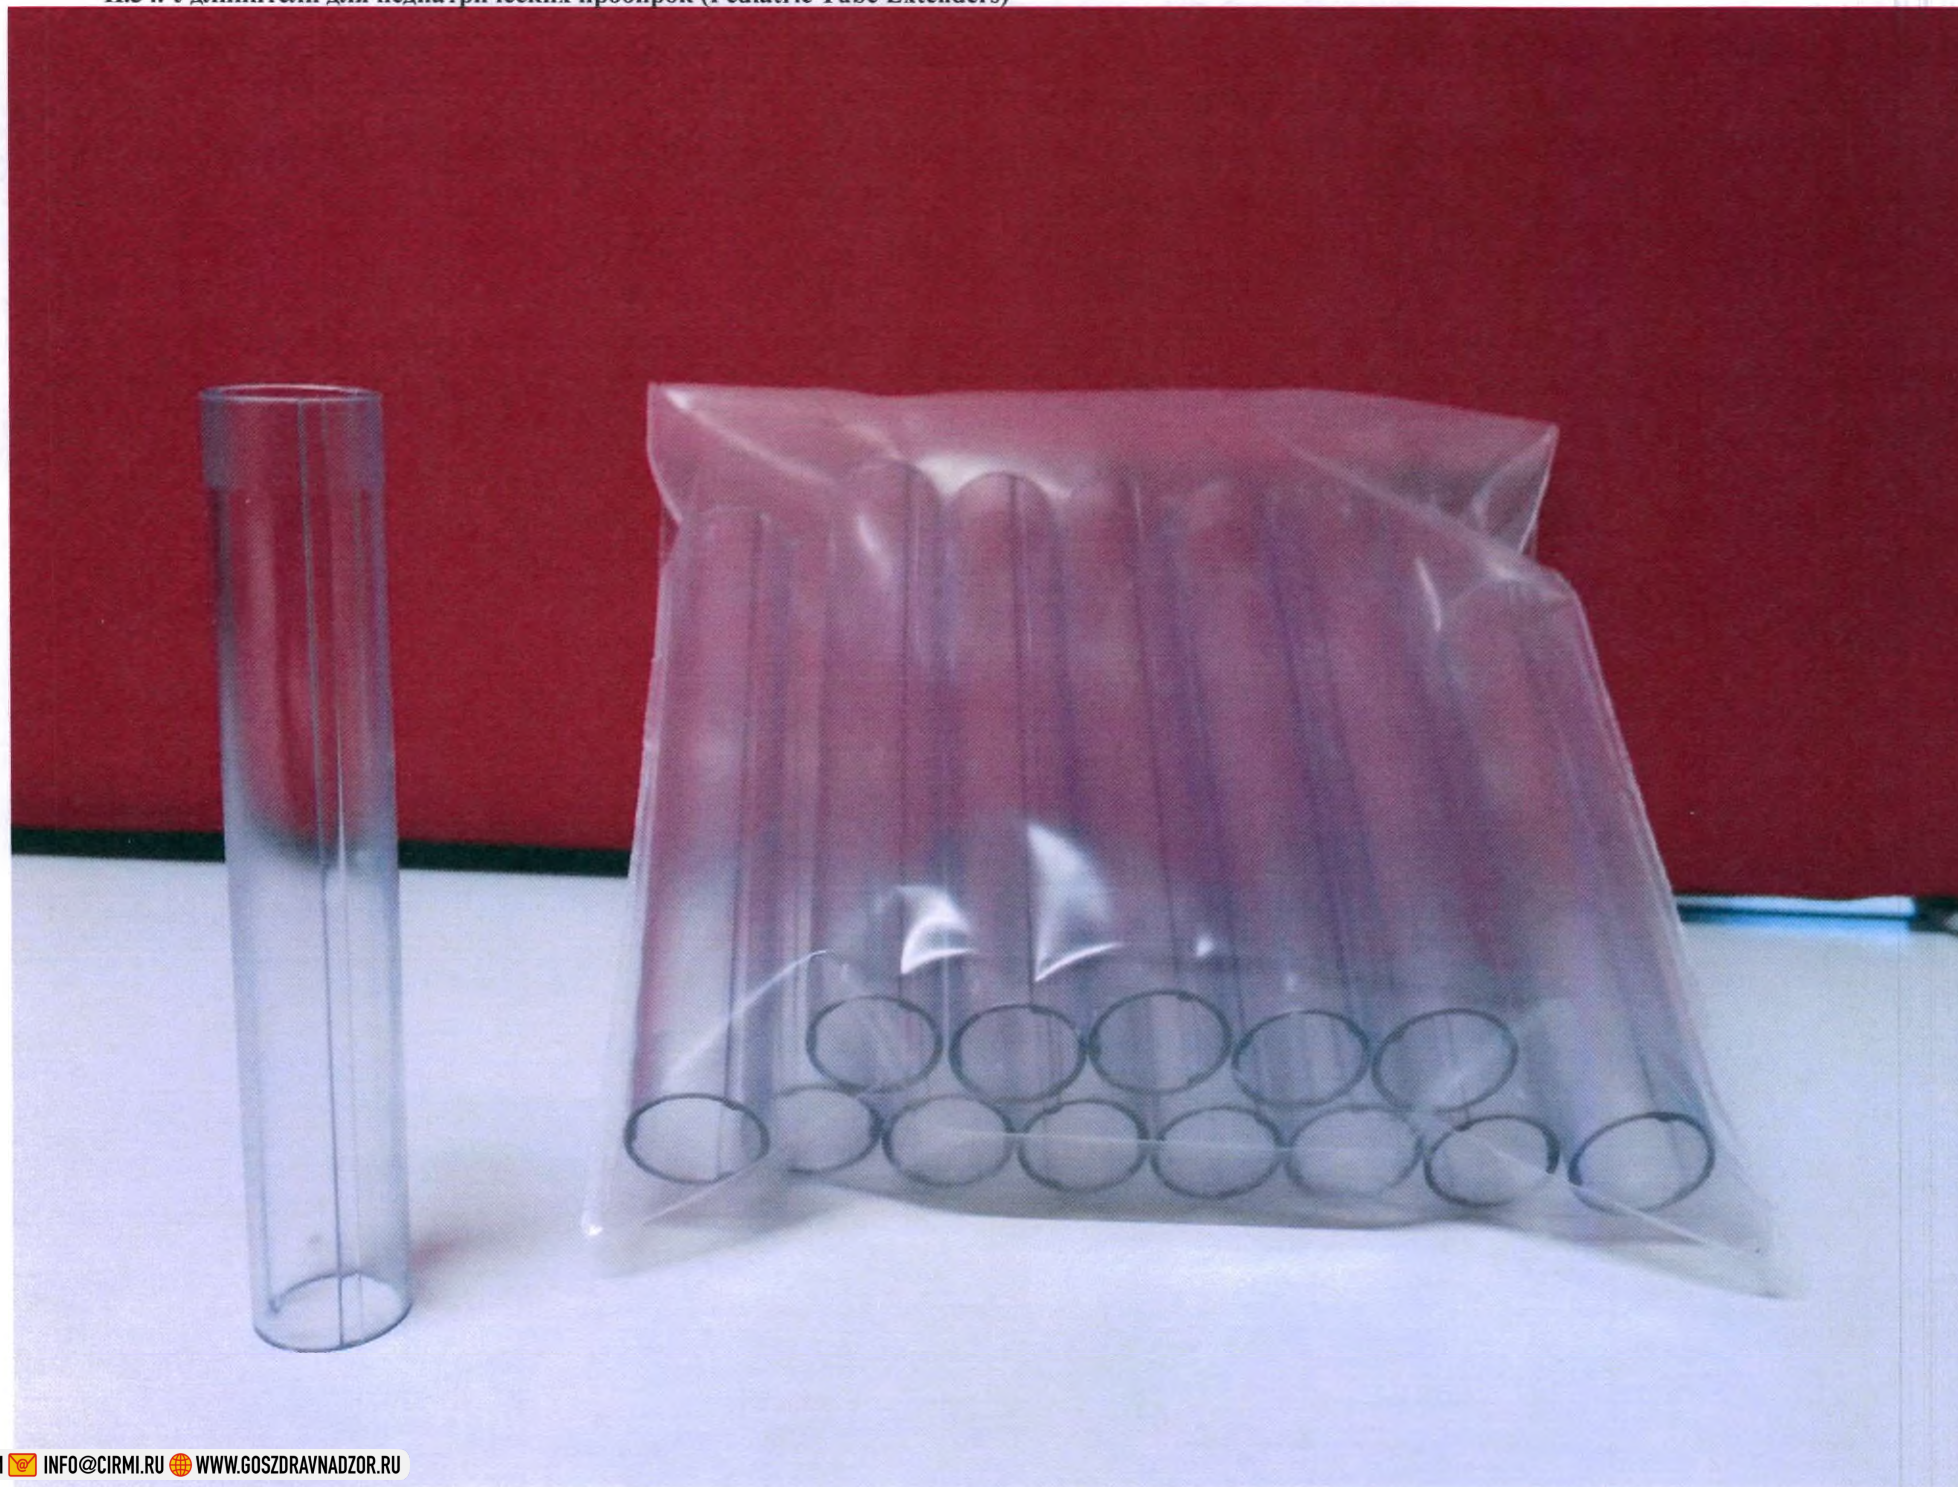

II.35. Штативы для 10 мл флаконов (RRBC Reagent Rack - 10 mL)

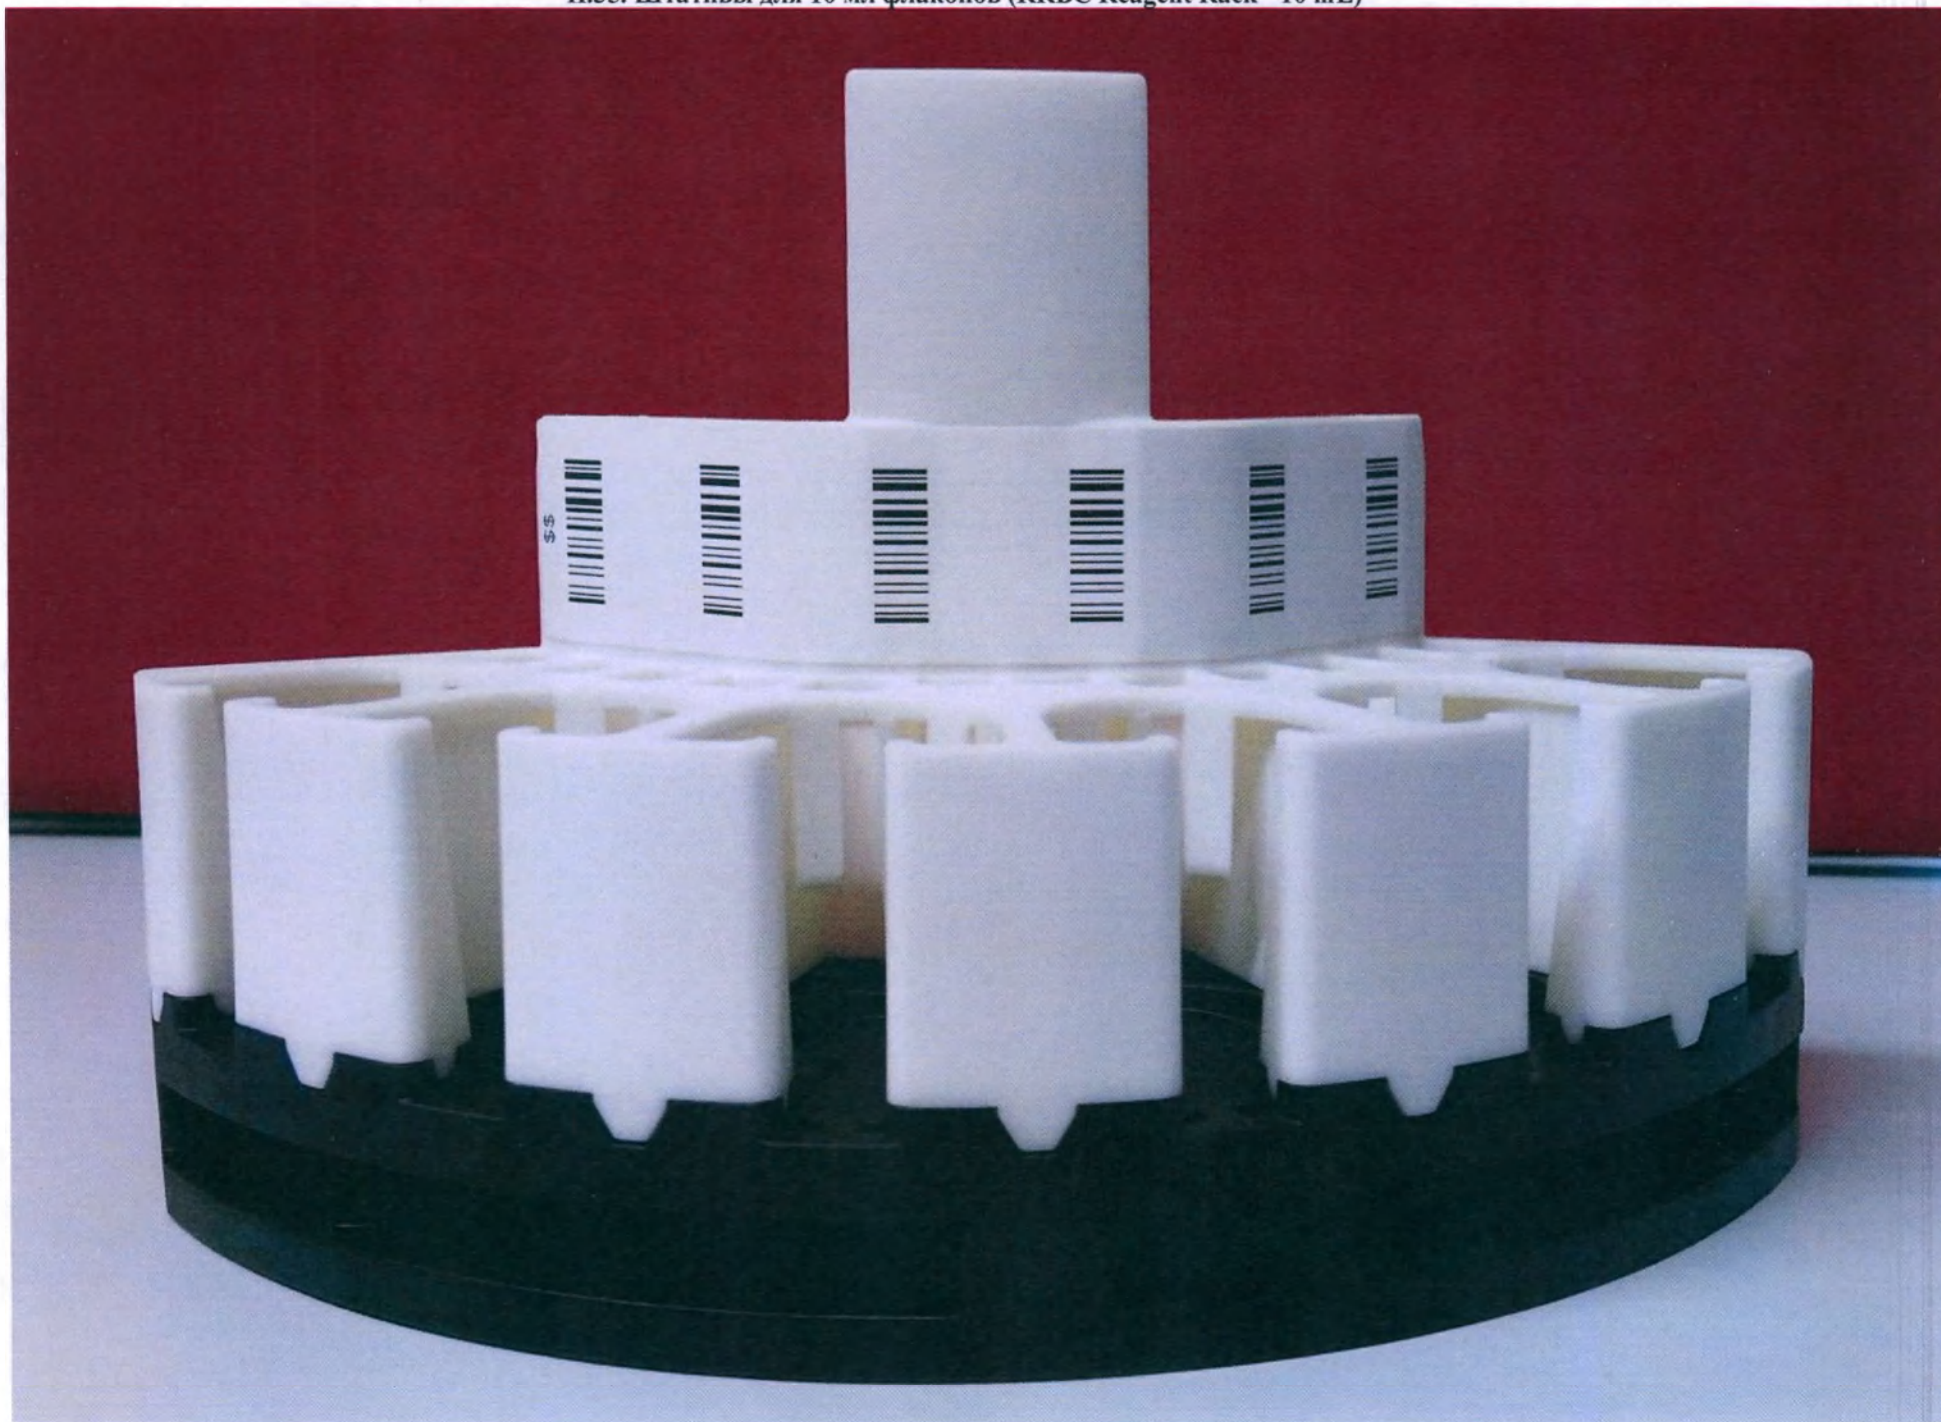

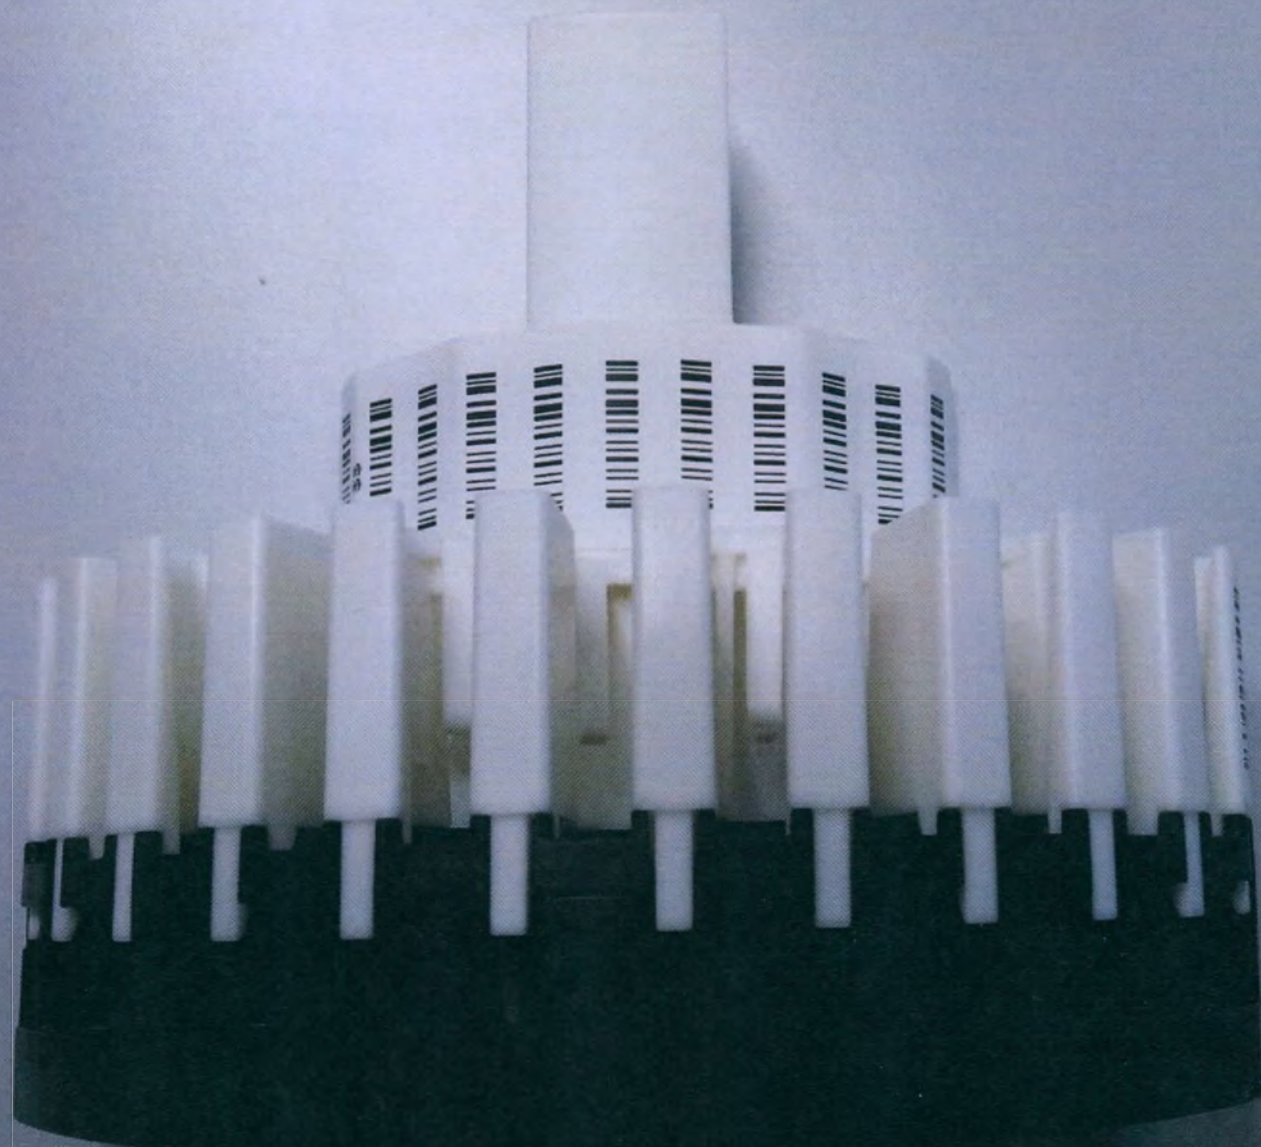


И.37. Штативы для педиатрических пробирок BD Microtainer





П.39. Штативы для педиатрических пробирок Eppendorf МТТ для проб объемом 2,0 мл

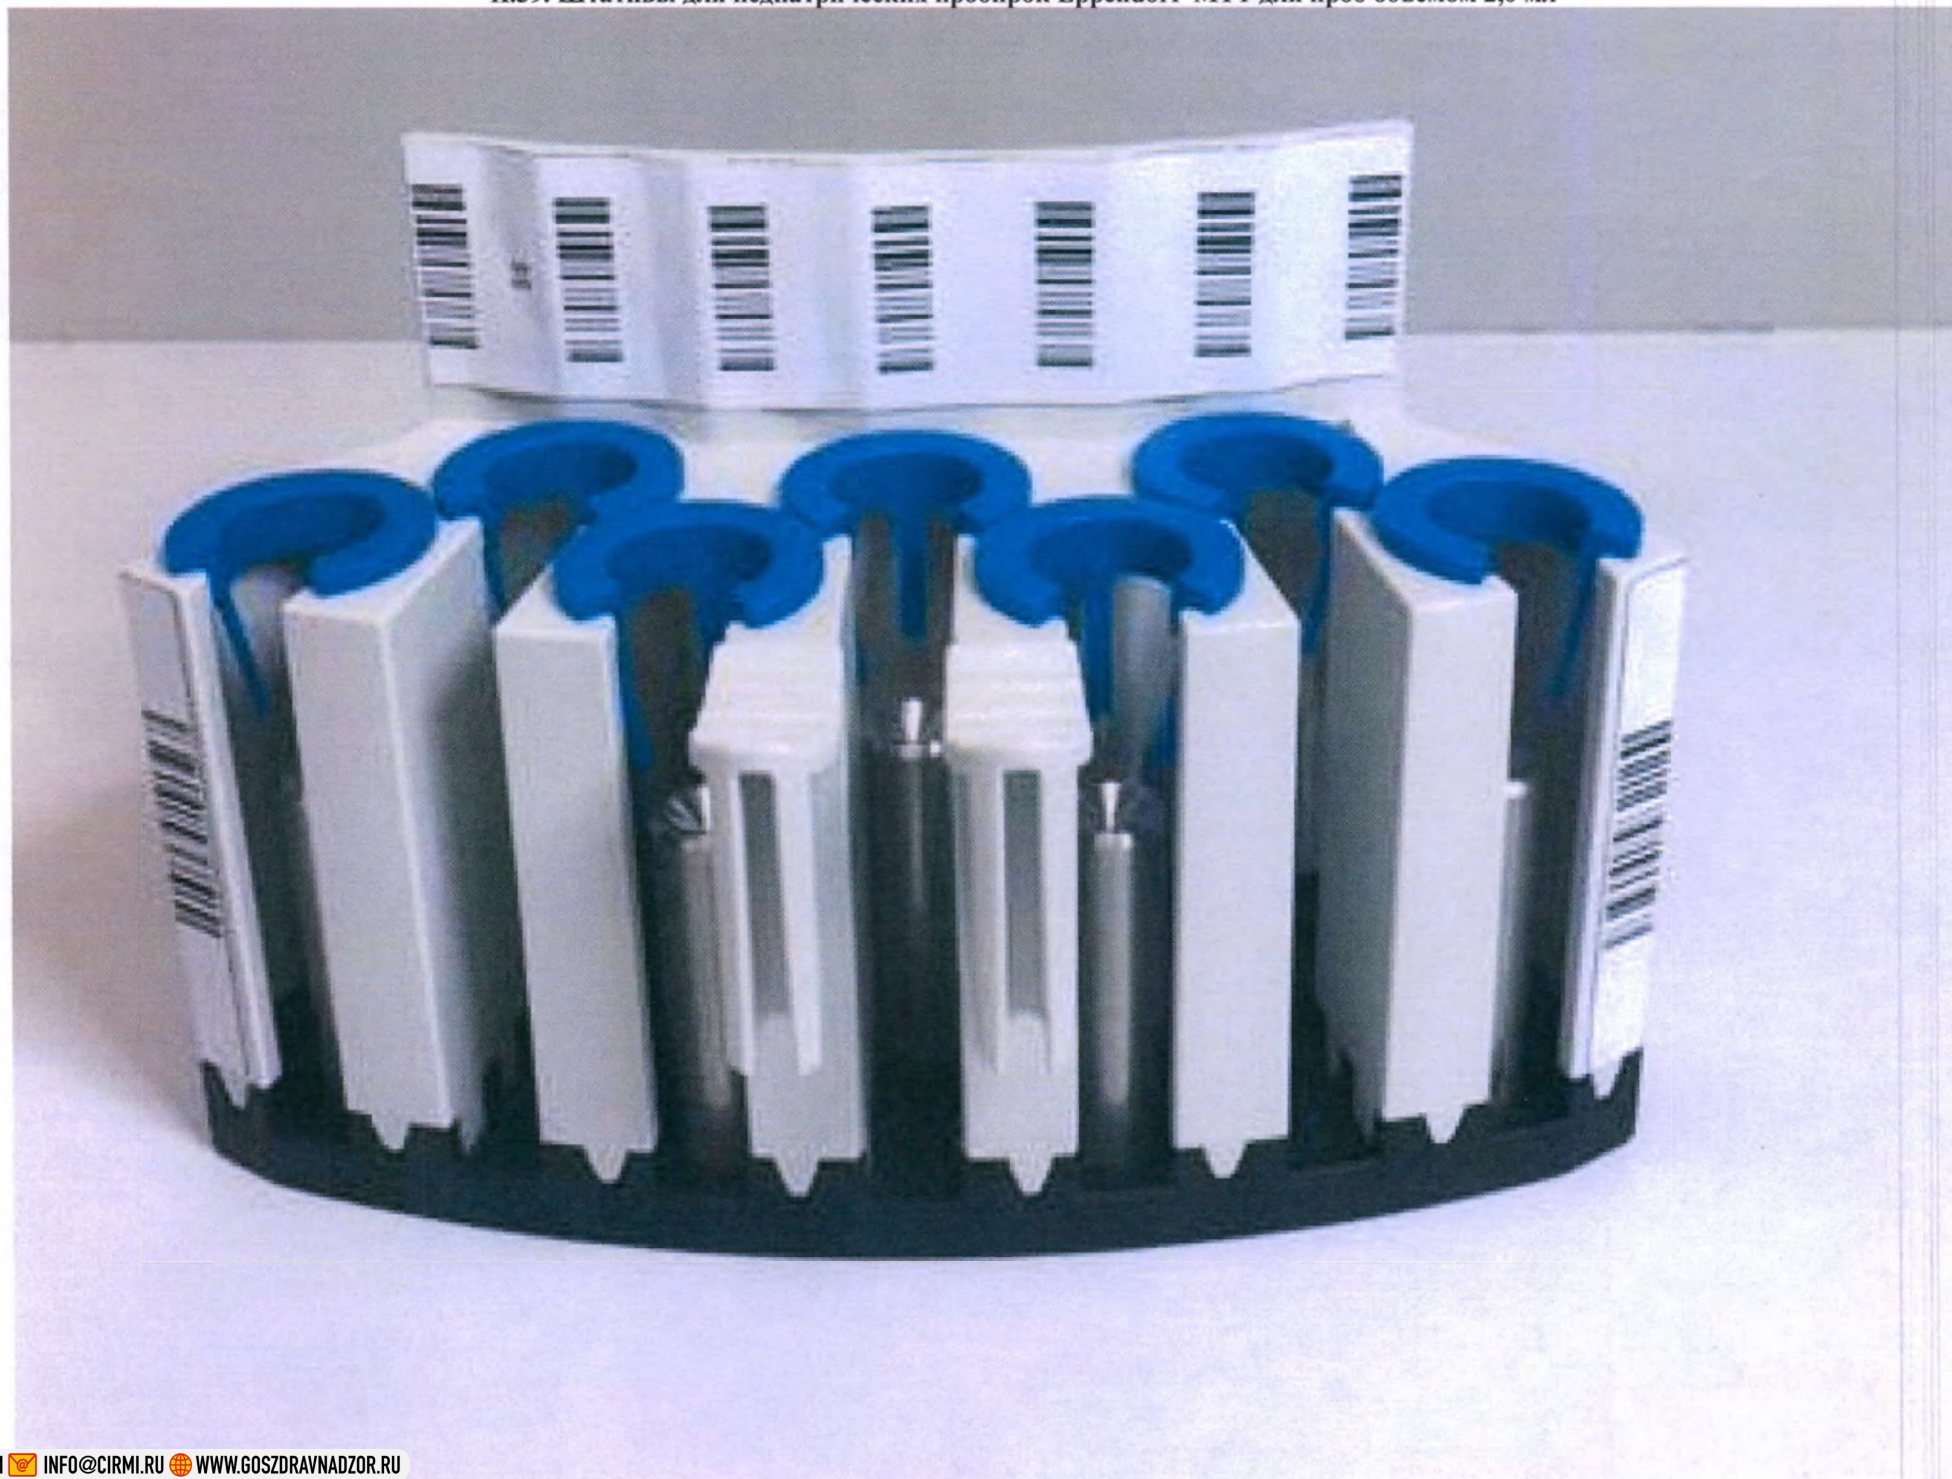





П.41. Штативы для педиатрических пробирок Greiner MiniCollect



II.42. Штативы для педиатрических пробирок RAM Scientific SAFE-T-FILL

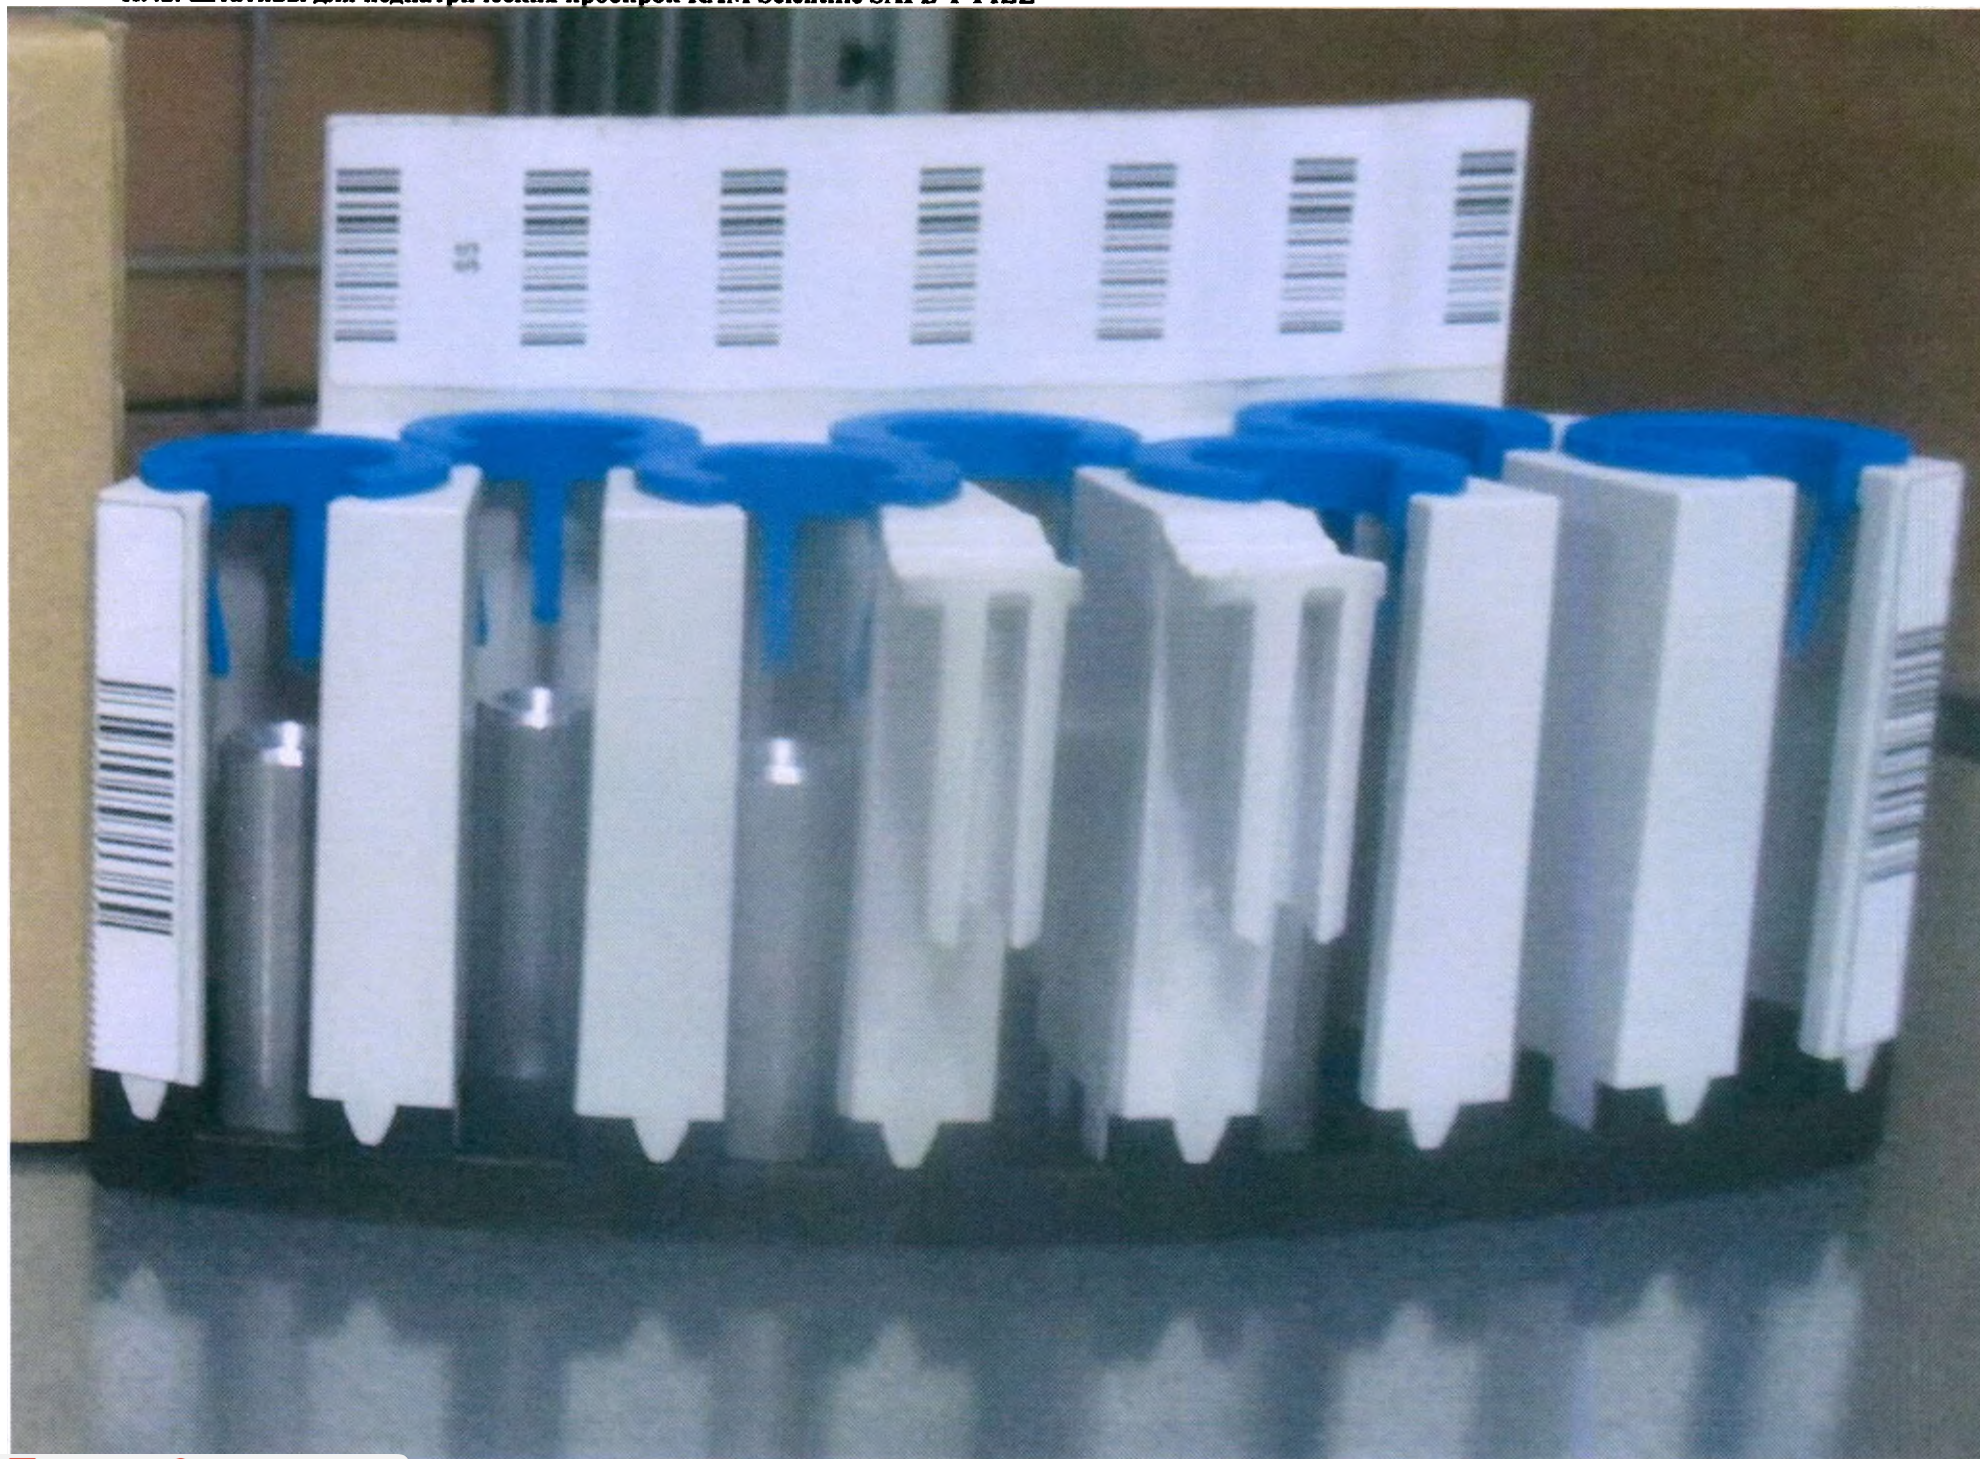

II.43. Штативы для педиатрических пробирок Sarstedt Microvette (Sample rack Sarstedt Microvette)

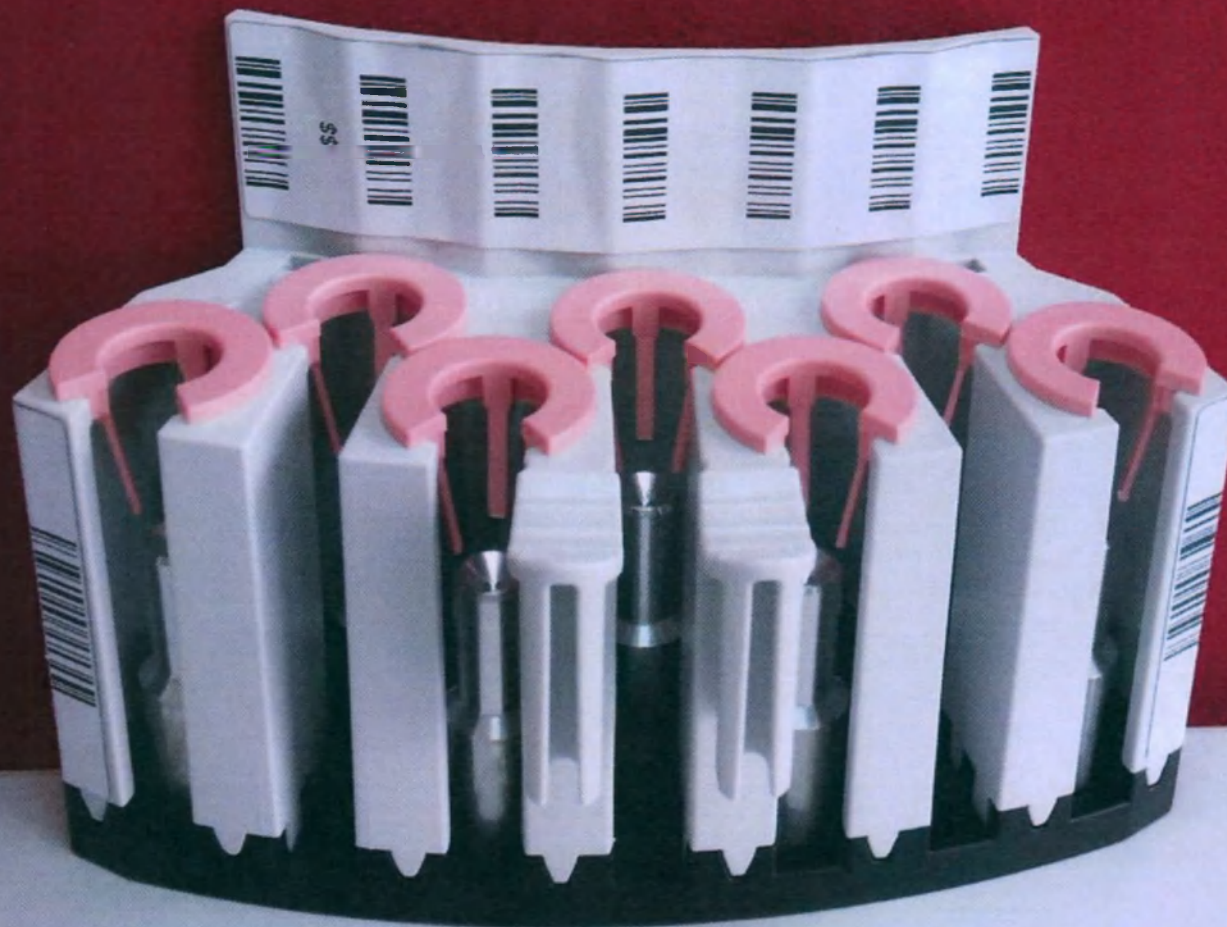

II.44. Штативы для педиатрических пробирок Sarstedt тип A (Sample rack Sarstedt Type A)



П.45. Штативы для педиатрических пробирок Sarstedt тип В (Sample rack Sarstedt Type B)



II.46. Штативы для педнатрических пробирок Sarstedt тип C (Sample rack Sarstedt Type C)



II.47. Штативы для педиатрических пробирок Sarstedt тип D (Sample rack Sarstedt Type D)



II.48. Штативы для педиатрических пробирок Sarstedt тип H (Sample rack Sarstedt Type H)



II.49. Штативы для педиатрических пробирок Sarstedt тип I (Sample rack Sarstedt Type I)




II.50. Штативы для педиатрических пробирок TEKLAB (Sample rack TEKLAB)



II.51. Штативы для педиатрических пробирок Terumo CAPJECT



II.52. Штативы для пробирок 10 мм, красный (Sample rack red 10 mm)

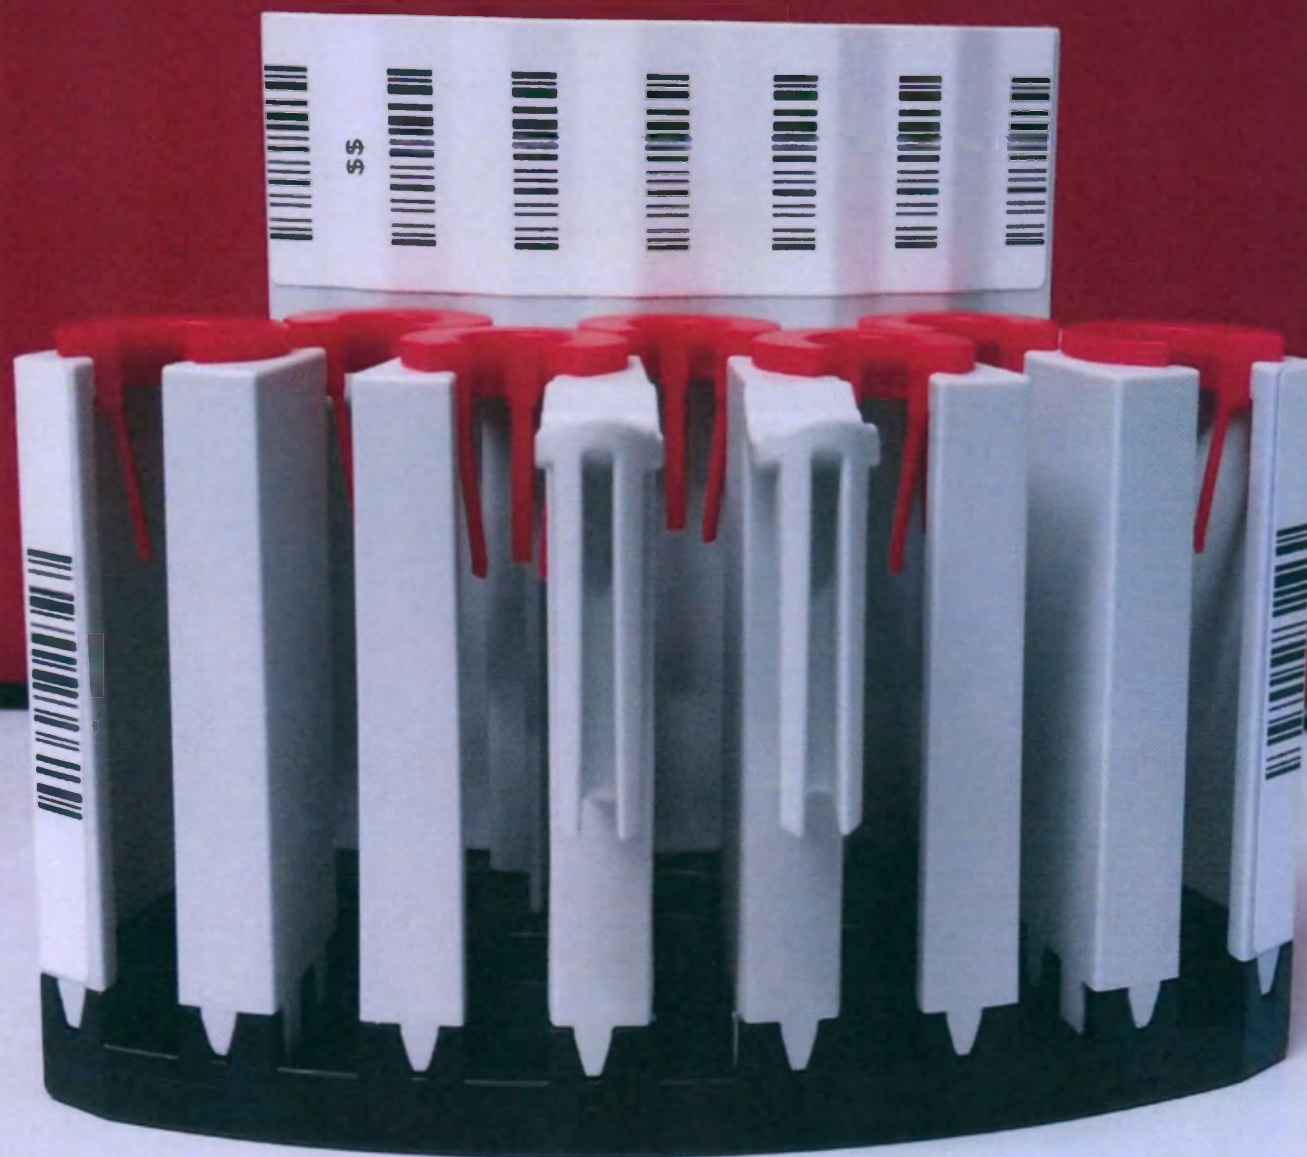


П.53. Штативы для пробирок 10.25x47 мм, красный (Sample rack red 10.25x47 mm)




II.54. Штативы для пробирок 13 мм, синий (Sample rack Blue 13 mm)



П.55. Штативы для пробирок 16 мм, зеленый (Sample rack Green 16 mm)

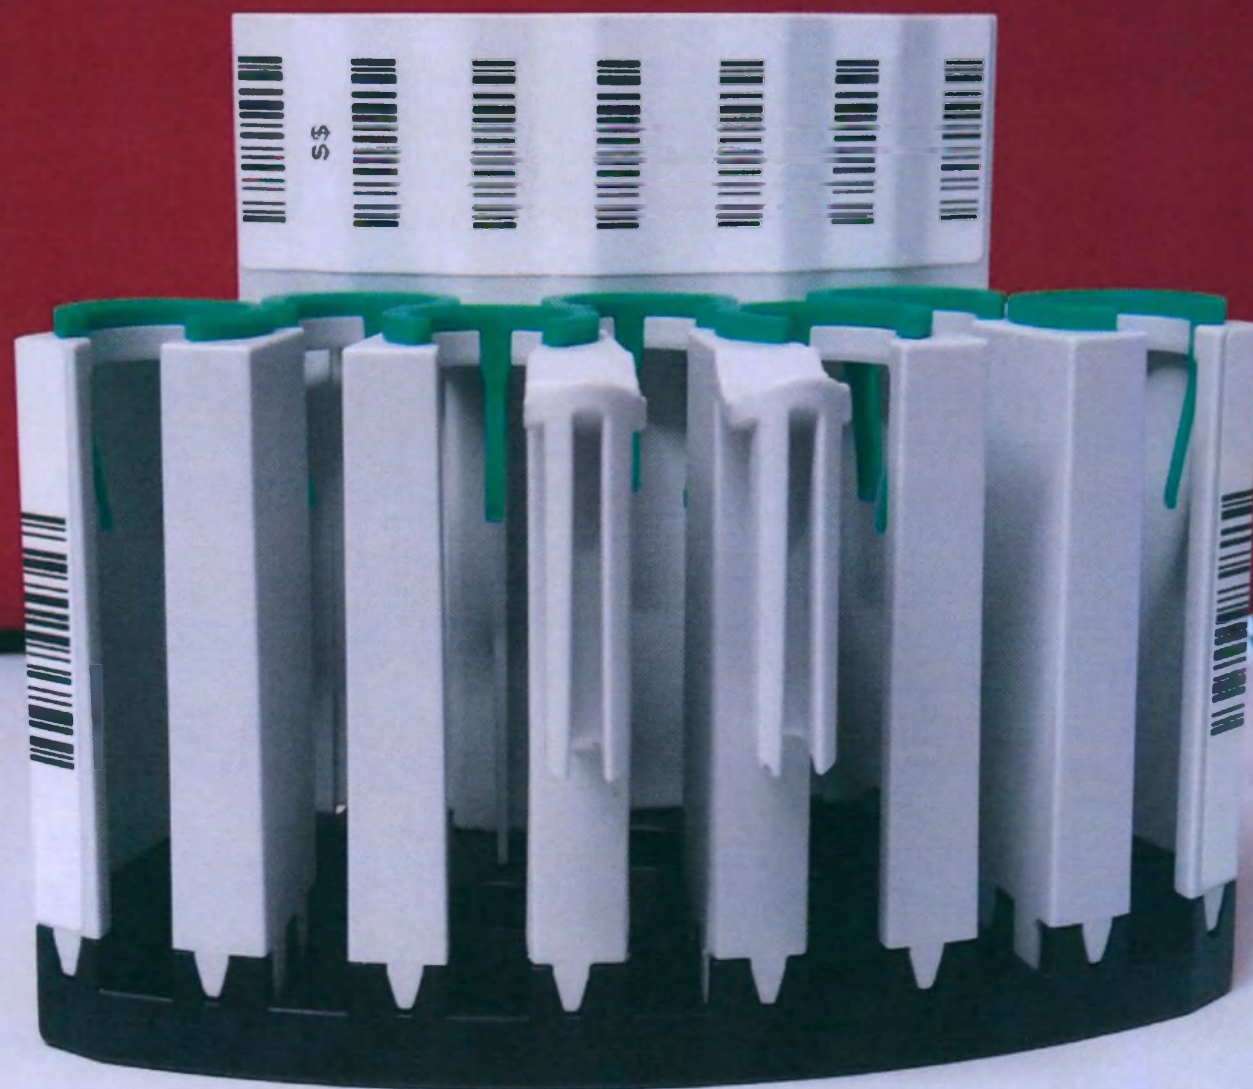


П.56. Штативы для пробирок Sarstedt Monovette объемом 4,9 мл (Sarstedt S-Mono 4.9 mL)

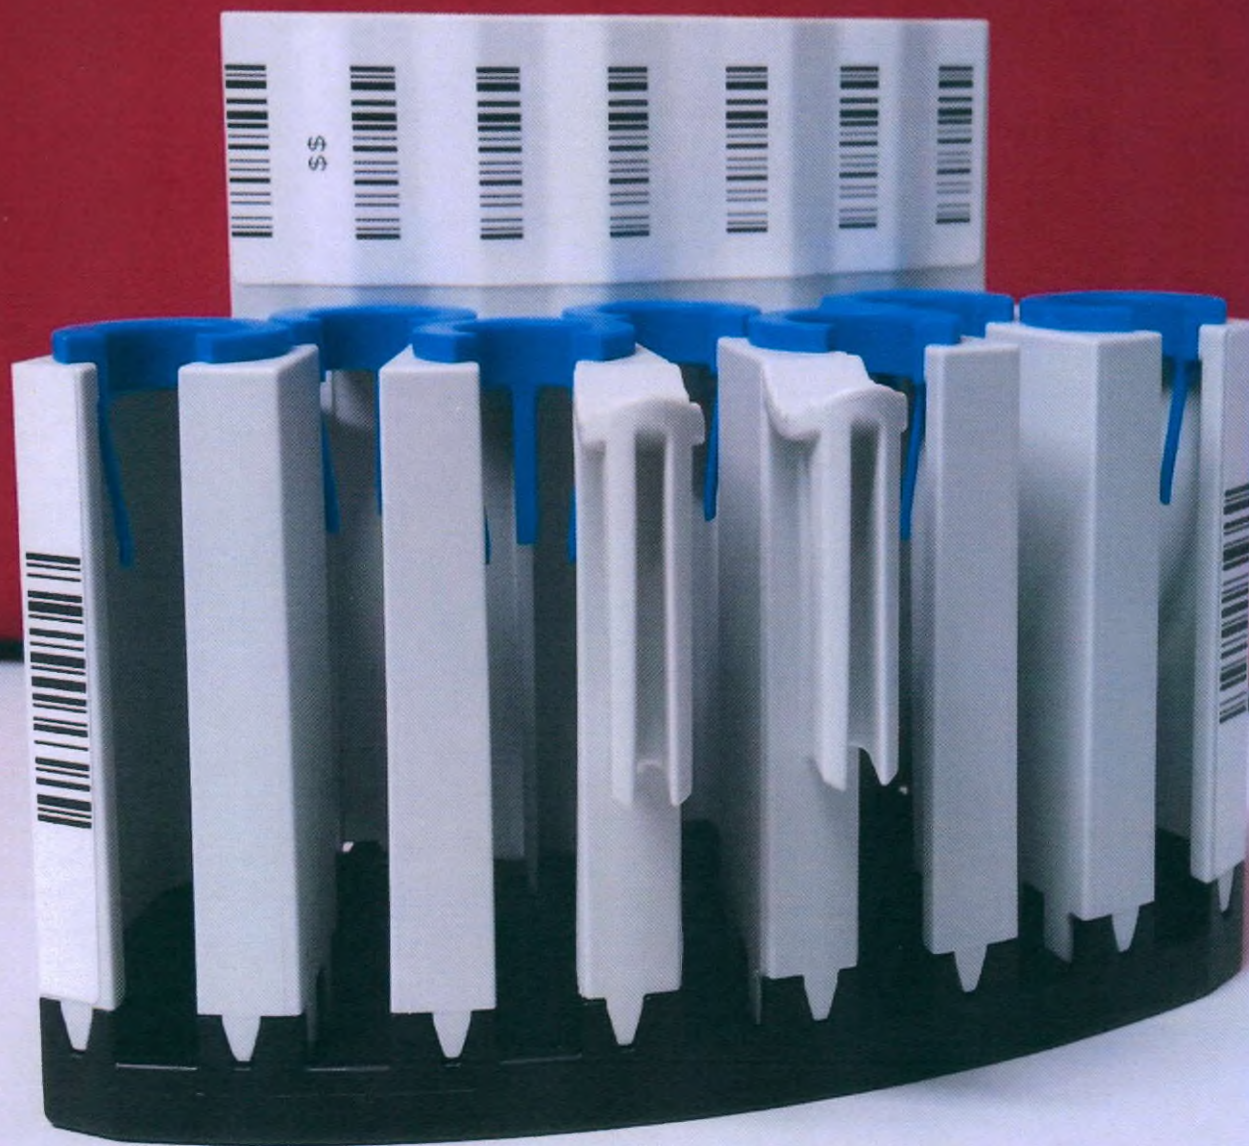


ИЛ.57. Штативы для пробирок Sarstedt Monovette объемом 7,5 мл (Sarstedt S-Mono 7.5 mL)



II.58. Штативы для разбавителей (Diluent Rack BioVue)

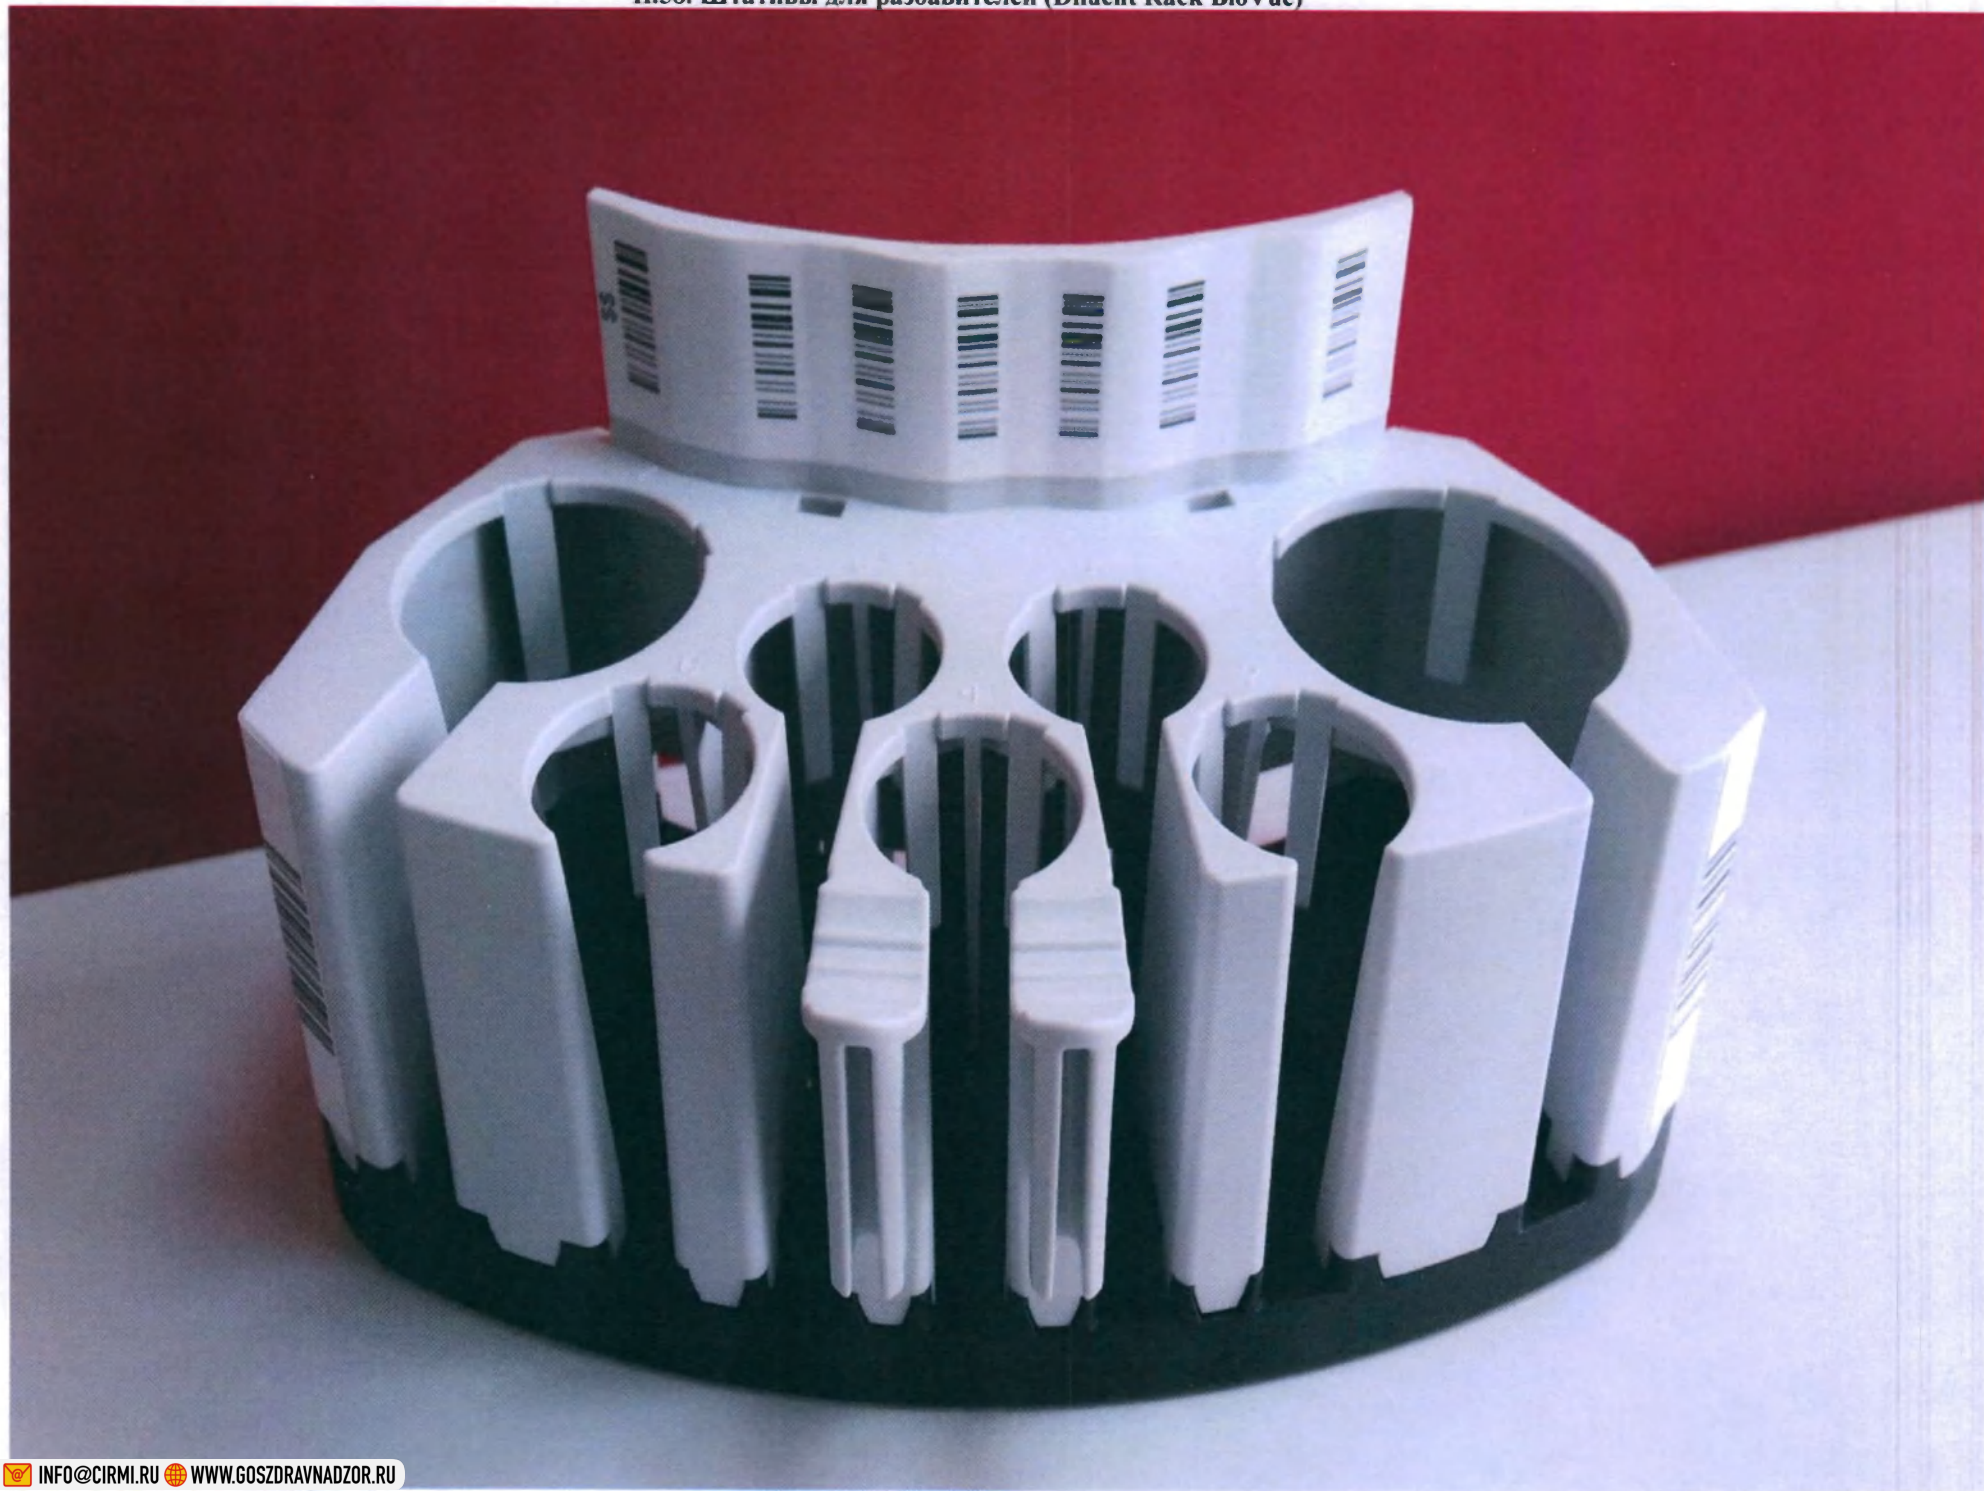

II.59. Штативы для реагентов ORTHO Sera

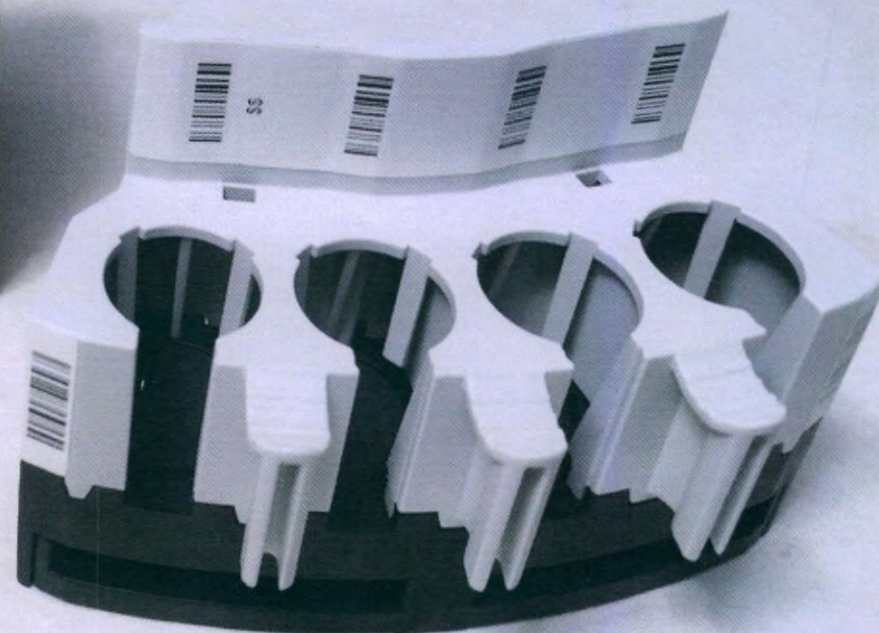

КОПИЯ ВЕРНА

Прошито, скреплено печатью

ВСЕГО 119 листов

«12» 05 2022 г.

Генеральный Директор

ООО «Орто-Клиникал Диагностикс»

Сергеенко В.К.

