


Фотографические изображения МИ:

«Реагенты в кассете для количественного определения N концевого фрагмента про-натрийуретического пептида типа В (NT proBNP) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys proBNP II cobas e analyzers/PBNPX), в вариантах исполнения»

I. Реагенты в кассете для количественного определения N-концевого фрагмента про-натрийуретического пептида типа В (NT-proBNP) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys proBNP II cobas e analyzers/PBNPX), вариант исполнения на 100 тестов




I. Реагенты в кассете для количественного определения N-концевого фрагмента про-натрийуретического пептида типа В (NT-proBNP) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys proBNP II cobas e analyzers/PBNPX), вариант исполнения на 100 тестов

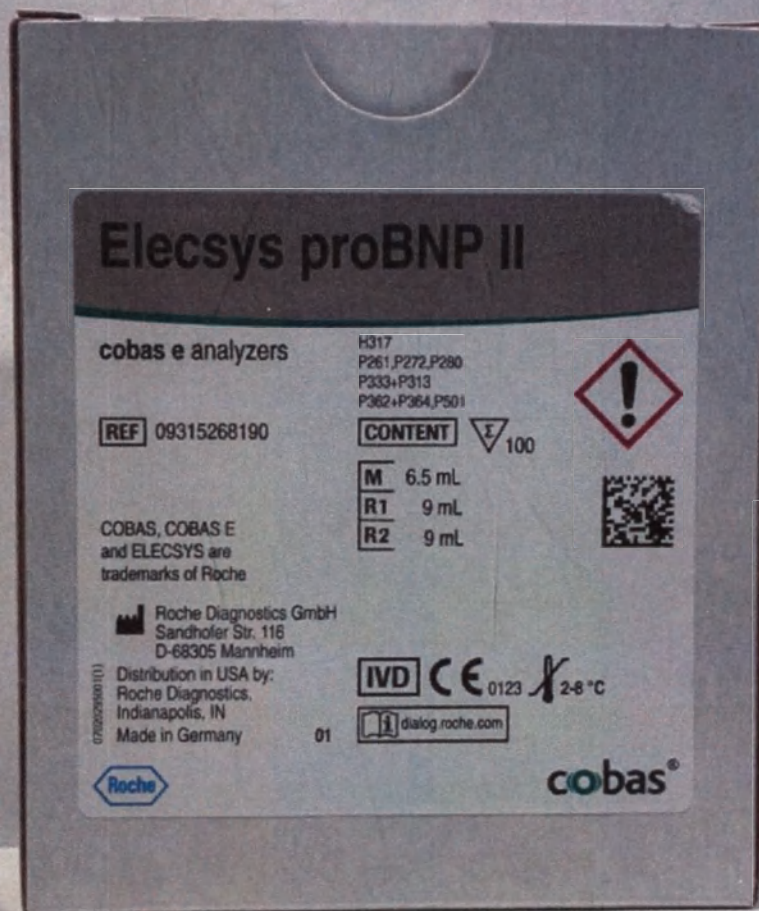


I. Реагенты в кассете для количественного определения N-концевого фрагмента про-натрийуретического пептида типа В (NT-proBNP) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys proBNP II cobas e analyzers/PBNPX), вариант исполнения на 100 тестов



- I. Реагенты в кассете для количественного определения N-концевого фрагмента про-натрийуретического пептида типа В (NT-proBNP) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys proBNP II cobas e analyzers/PBNPX), вариант исполнения на 100 тестов

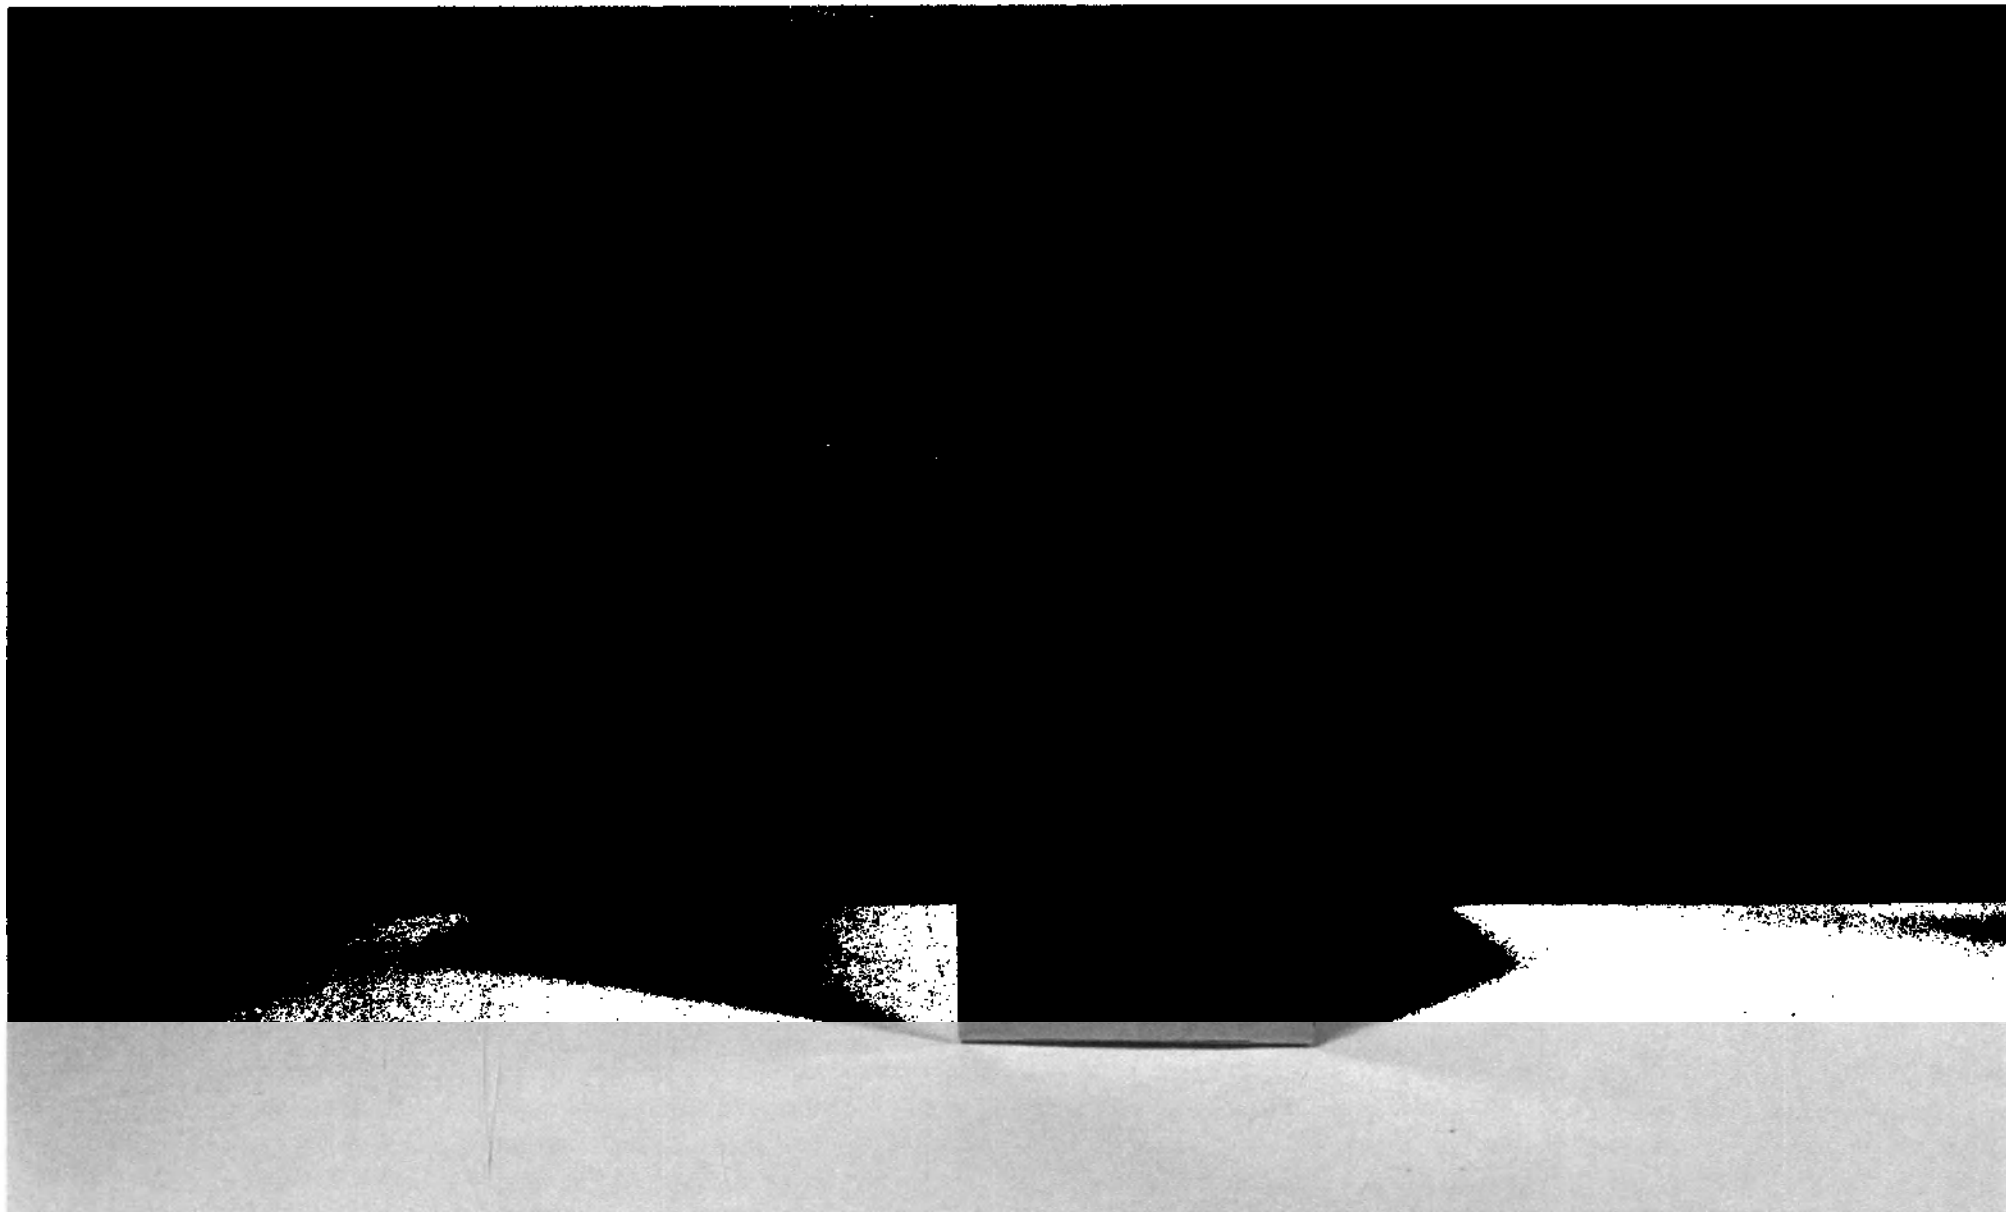


I. Реагенты в кассете для количественного определения N-концевого фрагмента про-натрийуретического пептида типа B (N-terminus pro-BNP) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys proBNP cobas e analyzers/PBNPX), вариант исполнения на 100 тестов

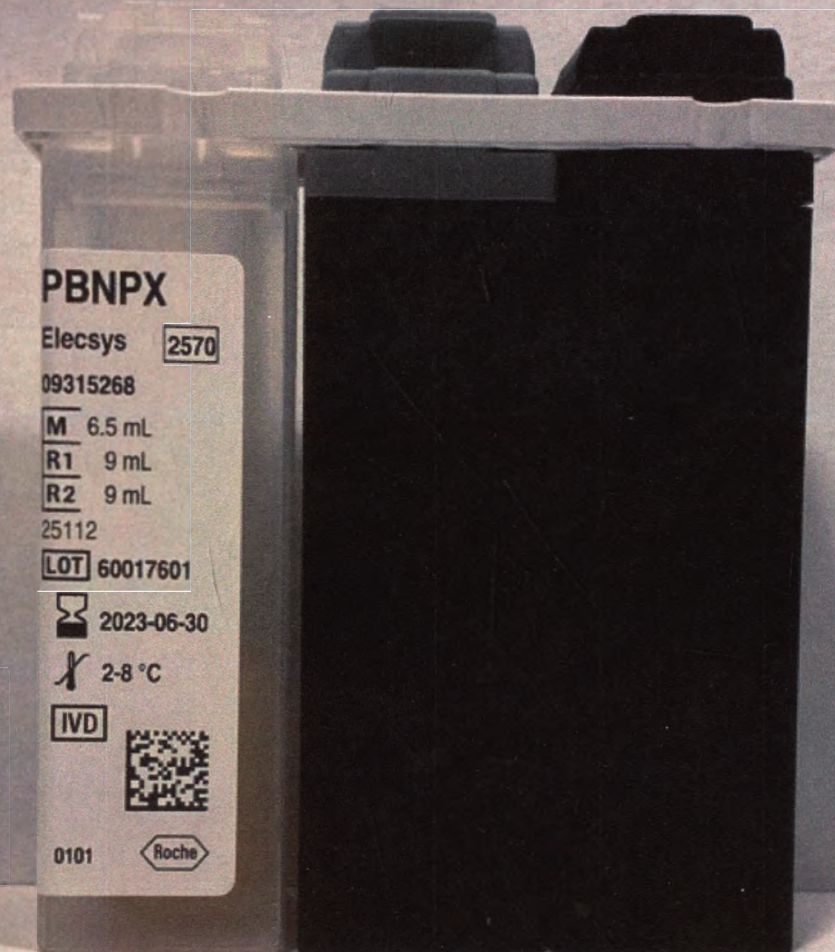

I. Реагенты в кассете для количественного определения N-концевого фрагмента про-натрийуретического пептида типа В (NT-проBNP) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys proBNP I, cobas e analyzers/PBNPX), вариант исполнения на 100 тестов



I. Реагенты в кассете для количественного определения N-концевого фрагмента про-натрийуретического пептида типа В (NT-proBNP) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys proBNP II, cobas e analyzers/PBNPX), вариант исполнения на 100 тестов

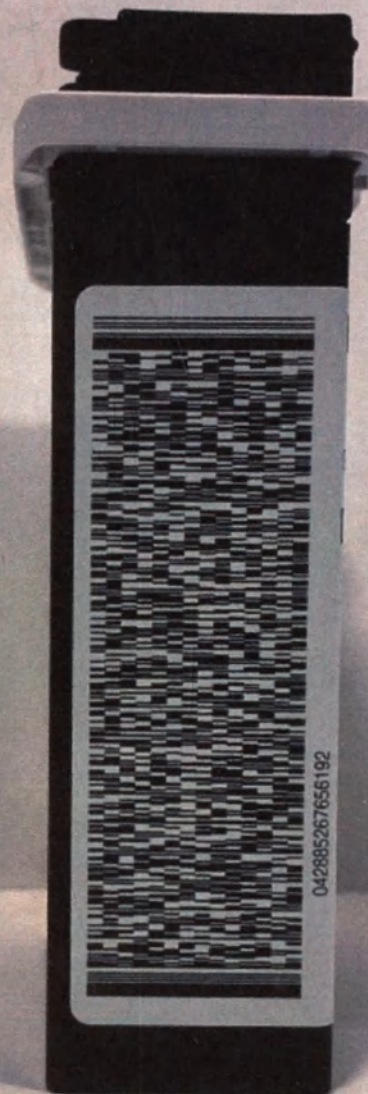

I. Реагенты в кассете для количественного определения N-концевого фрагмента про-натрийуретического пептида типа В (NT-proBNP) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys cobas e analyzers/PBNPX), вариант исполнения на 100 тестов

Реагенты в кассете для количественного определения N-концевого фрагмента про-натрийуретического пептида типа В (NT-proBNP) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (Elecsys cobas e analyzers/PBNPX), вариант исполнения на 100 тестов

Регистрационное удостоверение № ГИЗ 2012/14413 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Помощь см. на упаковке

Производитель: Roche Diagnostics GmbH ("Рош Диагностика ГмбХ", Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Германия)

Наличие сертификатов только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель, действующий на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107051, Москва, Чубовая площадь, д.2. Тел: +7 495 228-68-09, факс: +7 495 228-62-64. E-mail: marketing@ros2.ru, diag@ros2.ru


Инструкция по применению на русском языке на русском языке представлена отдельно (для заказа необходимо обратиться к уполномоченному представителю на территории РФ, контакты см. выше)

Кат. номер 0913268190

II. Реагенты в кассете для количественного определения N-концевого фрагмента про-натрийуретического пептида типа В (NT-proBNP) в сыворотке плазмы крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys proBNP II cobas e analyzers/PBNPX), вариант исполнения на 300 тестов



II. Реагенты в кассете для количественного определения N-концевого фрагмента про-натрийуретического пептида типа В (NT-proBNP) в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys proBNP II cobas e analyzers/PBNPX), вариант исполнения 300 тестов

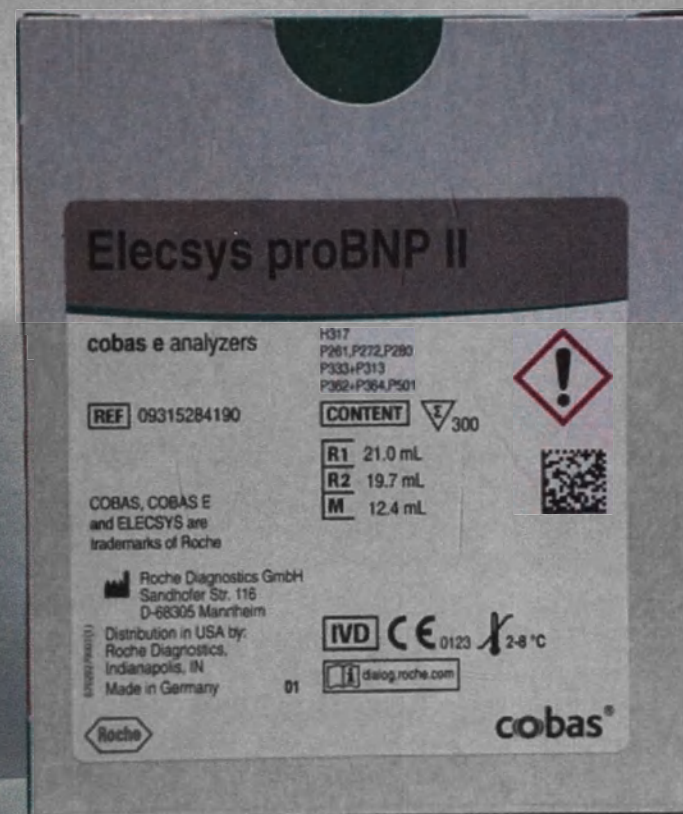


II. Реагенты в кассете для количественного определения N-концевого фрагмента про-натрийуретического пептида типа В (NT-proBNP) в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys proBNP II cobas e analyzers/PBNPX), вариант исполнения 300 тестов




01




II. Реагенты в кассете для количественного определения N-концевого фрагмента про-натрийуретического пептида типа В (NT-proBNP) в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys proBNP II cobas e analyzers/PBNPX), вариант исполнения 300 тестов

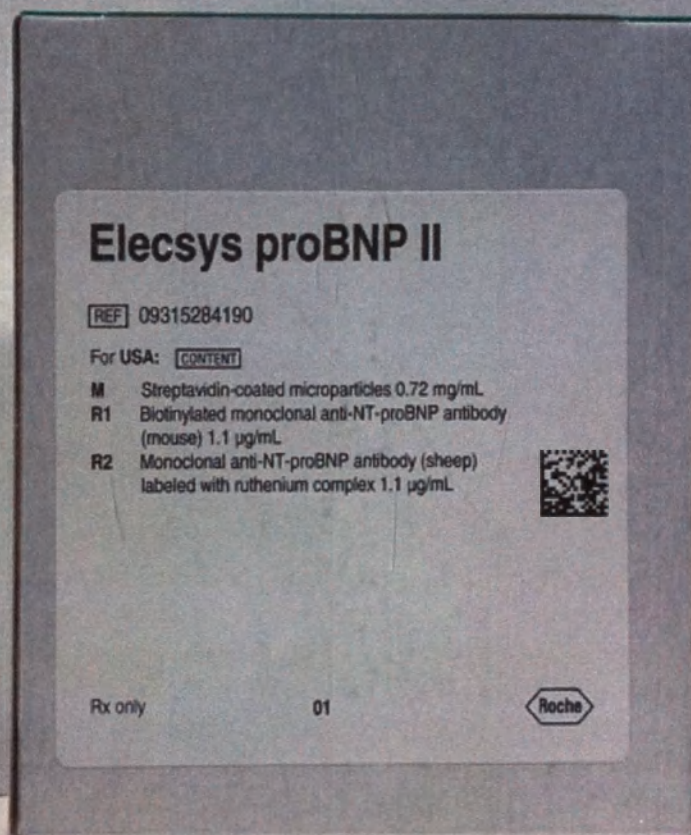

II. Реагенты в кассете для количественного определения N-концевого фрагмента про-натрийуретического пептида типа В (NT-proBNP) в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys proBNP II cobas e analyzers/PBNPX), вариант исполнения 300 тестов

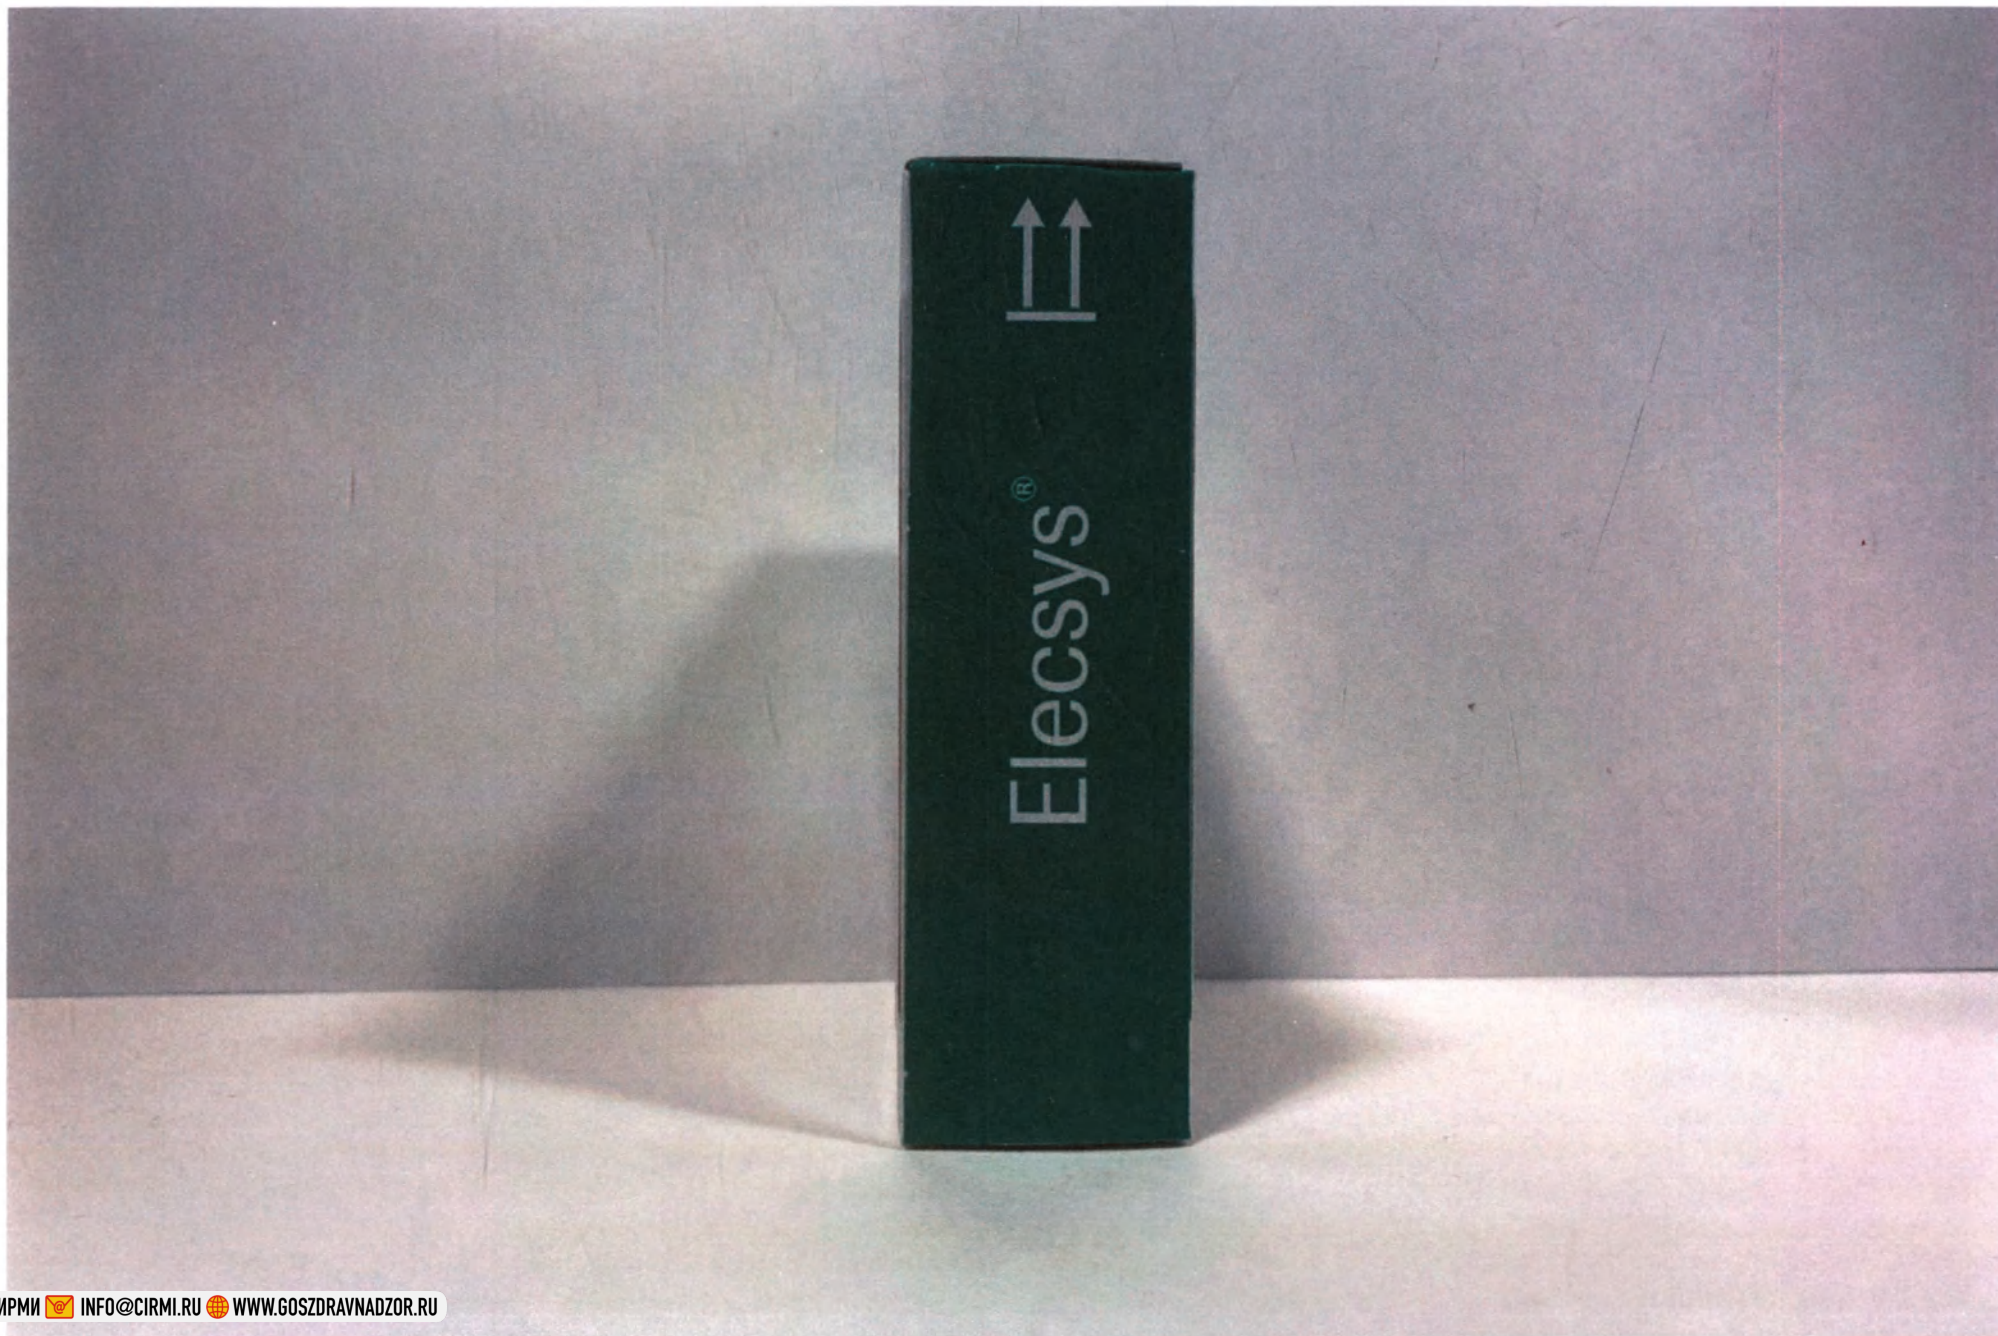


II. Реагенты в кассете для количественного определения N-концевого фрагмента про-натрийуретического пептида типа В (NT-proBNP) в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys proBNP II cobas e analyzers/PBNPX), вариант исполнения 300 тестов

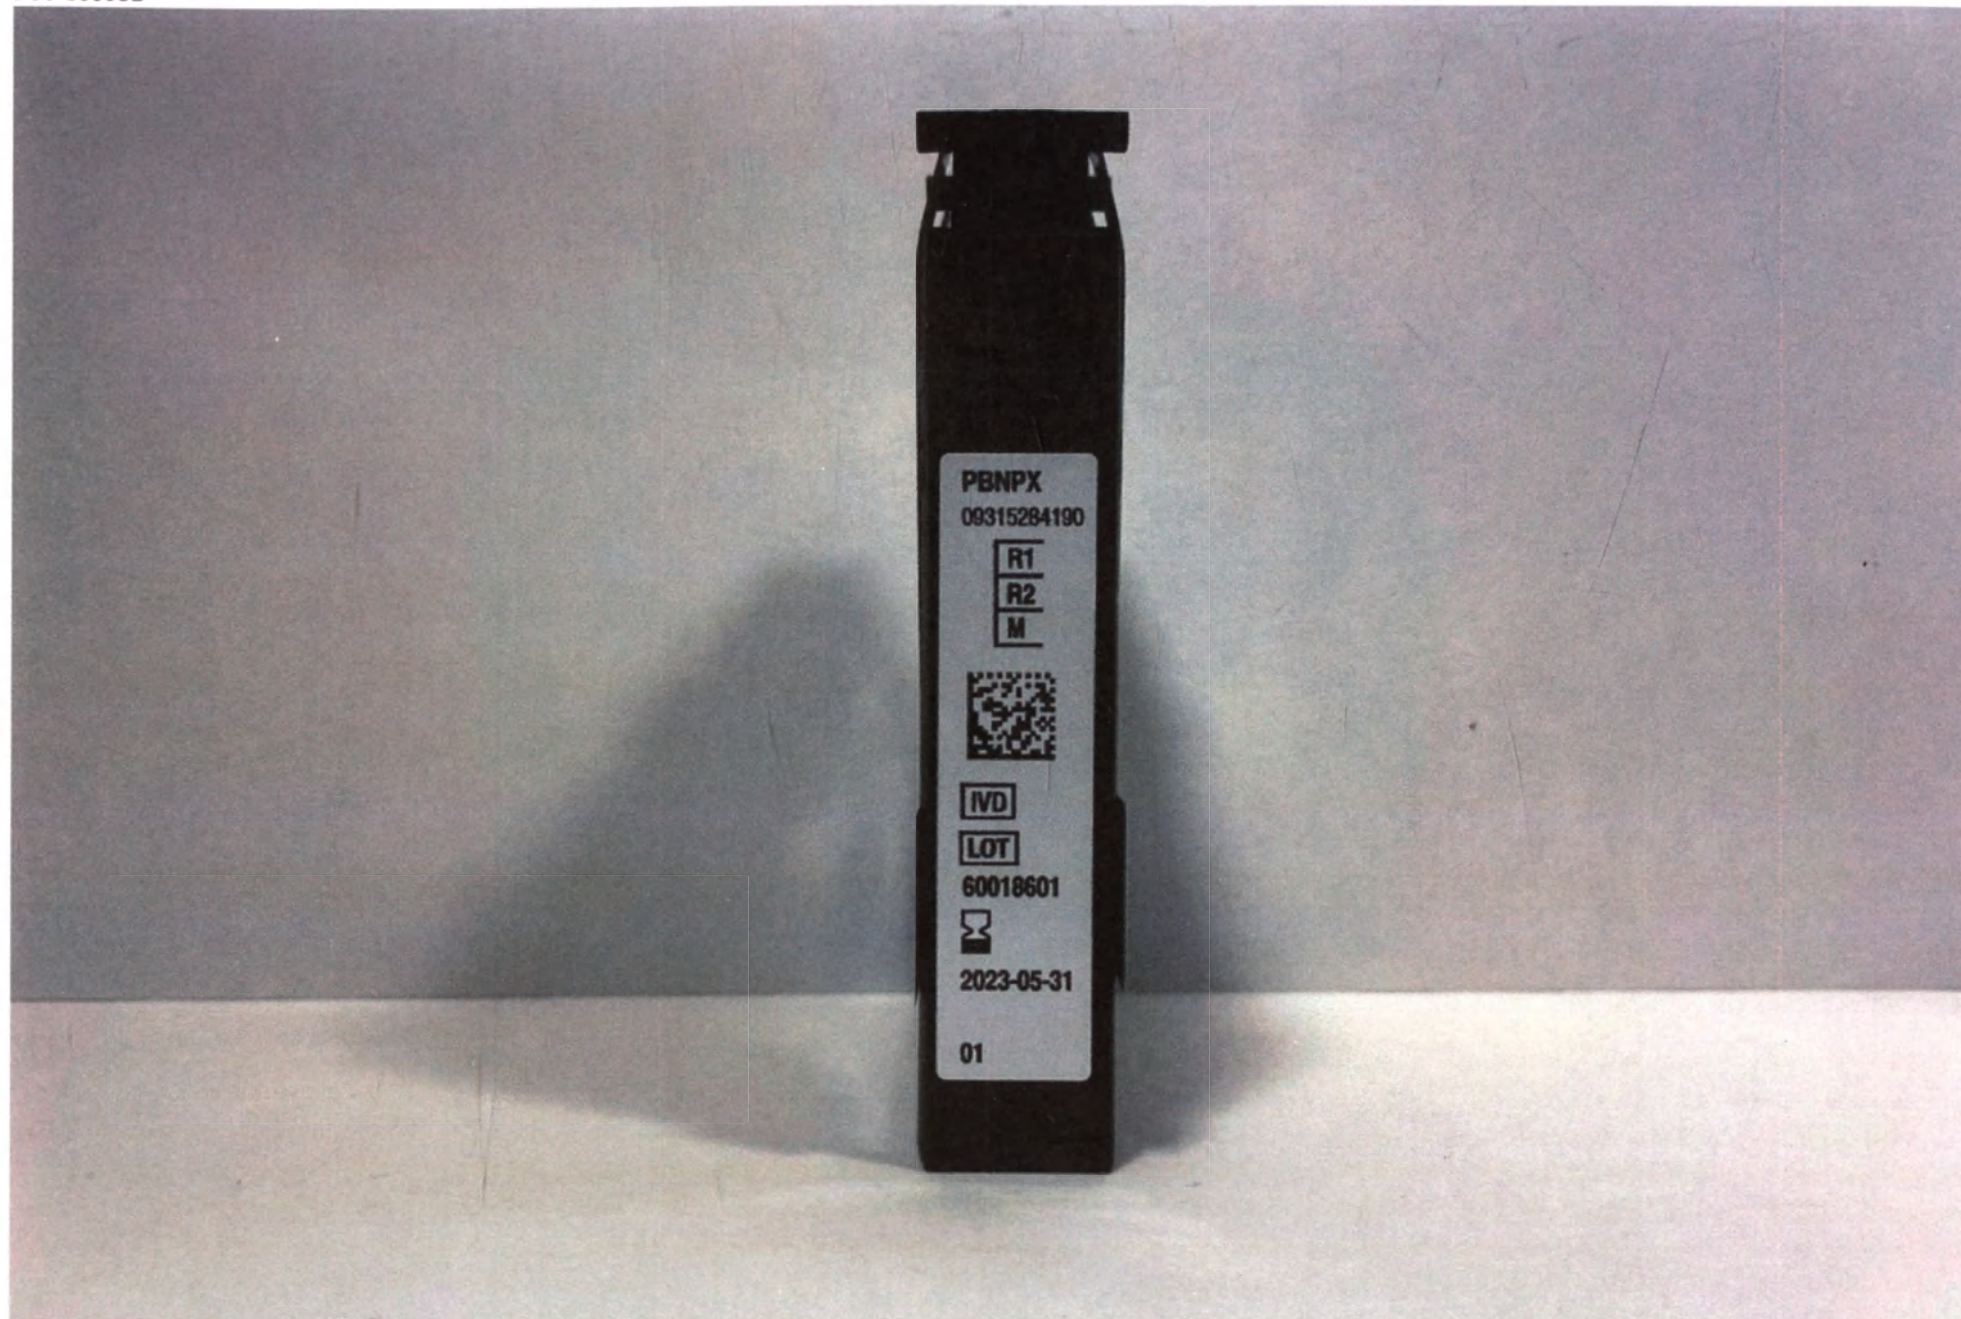

II. Реагенты в кассете для количественного определения N-концевого фрагмента про-натрийуретического пептида типа В (NT-proBNP) в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys proBNP II cobas e analyzers/PBNPX), вариант исполнения 300 тестов



II. Реагенты в кассете для количественного определения N-концевого фрагмента про-натрийуретического пептида типа В (NT-proBNP) в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys proBNP II cobas e analyzers/PBNPX), вариант исполнения 300 тестов

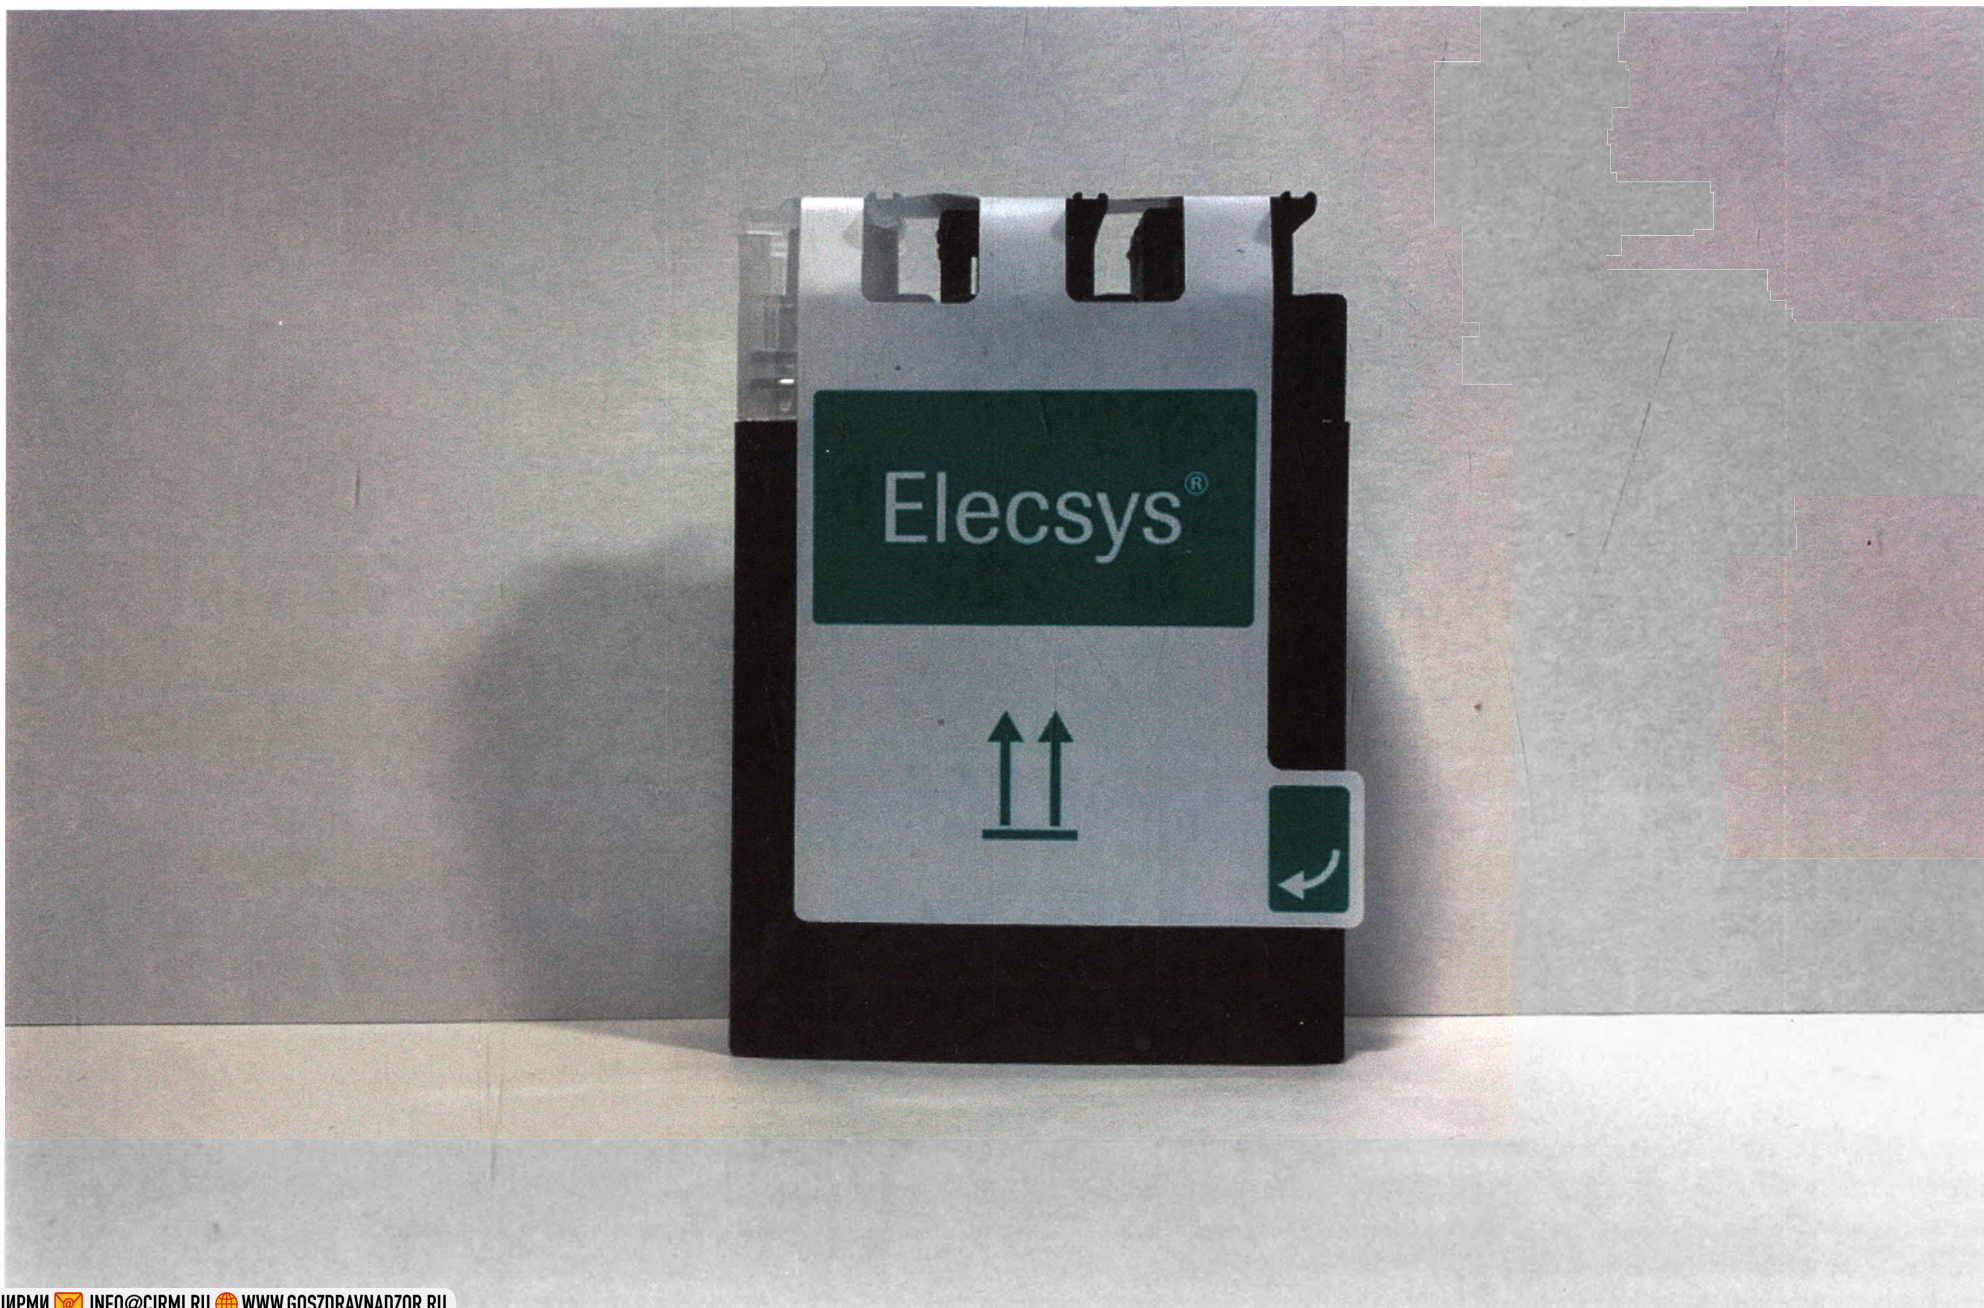

II. Реагенты в кассете для количественного определения N-концевого фрагмента про-натрийуретического пептида типа В (NT-proBNP) в сыворотке крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys proBNP II cobas e analyzers/PBNPX), вариант исполнения 300 тестов

Реагенты в кассете для количественного определения N-концевого фрагмента про-натрийуретического пептида типа В (NT-proBNP) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (Elecsys proBNP II cobas e analyzers/PBNPX), вариант исполнения на 300 тестов

Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/14423 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностика ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Издание предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception2_dia@roche.com

Инструкция по применению на русском языке на бумажном носителе предоставляется отдельно (для запроса необходимо обратиться к уполномоченному представителю на территории РФ, контакты см. выше).

Кат. номер 09315284190

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
18 листа (ов)



по доверенности
от 11.02.2022 г.