

«УТВЕРЖДЕНО»

Директор

ООО «Нейропроджект»

Д.М. Чебурашкин

«05» октября 2022 г.



МАКЕТЫ РУССКОЯЗЫЧНЫХ МАРКИРОВОК МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ:

Модуль DirectLink® для мониторинга внутричерепного давления, с
принадлежностями

Производства Интегра ЛайфСайнсиз Свитцерланд САРЛ

(Integra LifeSciences Switzerland SARL), Швейцария

2022

Основной блок модуля DirectLink®

РУ: № _____
Дата производства: _____
Артикул: 82-6828
Серийный номер: _____
Количество: 1 шт.

Не стерильно! Не совместим с МРТИ

Транспортировать и хранить при температуре от 0°С до +60°С, влажности от 16% до 86%, без конденсации
Производитель: «Интегра ЛаифСайнсиз Свйццрланд САРЛ», Швейцария
Страна изготовления: Швейцария
Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропродукт»,
Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,
Тел. +7 496 6808173



Удлинительный кабель

РУ: № _____
Дата производства: _____
Артикул: 82-6840
Номер партии: _____
Количество: 1 шт.

Не стерильно! Не совместим с МРТИ

Производитель: «Интегра ЛаифСайнсиз Свйццрланд САРЛ», Швейцария
Страна изготовления: Китай
Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропродукт»,
Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,
Тел. +7 496 6808173



Кабель для соединения с монитором DRAEGER/SIEMENS

РУ: № _____
Дата производства: _____
Артикул: 82-6860
Номер партии: _____
Количество: _____

Не стерильно! Не совместим с МРТИ

Производитель: «Интегра ЛаифСайнсиз Свйццрланд САРЛ», Швейцария
Страна изготовления: Китай
Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропродукт»,
Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,
Тел. +7 496 6808173



Кабель для соединения с монитором PHILIPS

РУ: № _____
Дата производства: _____
Артикул: 82-6881
Номер партии: _____
Количество: _____

Не стерильно! Не совместим с МРТИ

Производитель: «Интегра ЛаифСайнсиз Свйццрланд САРЛ», Швейцария
Страна изготовления: Китай
Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропродукт»,
Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,
Тел. +7 496 6808173



Кабель для соединения с монитором GE

РУ: № _____
Дата производства: _____
Артикул: 82-6882
Номер партии: _____
Количество: _____

Не стерильно! Не совместим с МРТИ

Производитель: «Интегра ЛаифСайнсиз Свйццрланд САРЛ», Швейцария
Страна изготовления: Китай
Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Нейропродукт»,
Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101,
Тел. +7 496 6808173



Кабель для соединения с монитором Spacelabs

РУ: № _____
Дата производства:
Артикул: 82-6883
Номер партии:
Количество:



RxOnly

Не стерильно! Не совместим с МРТИ

Производитель: «Интегра ЛанфСамсиз Сентцерланд САРЛ», Швейцария
Страна изготовления: США
Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Невропродвент»,
Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101.
Тел. +7 495 6608173

Кабель для соединения с монитором GE Datex-Ohmeda

РУ: № _____
Дата производства:
Артикул: 82-6884
Номер партии:
Количество:



RxOnly

Не стерильно! Не совместим с МРТИ

Производитель: «Интегра ЛанфСамсиз Сентцерланд САРЛ», Швейцария
Страна изготовления: США
Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Невропродвент»,
Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101.
Тел. +7 495 6608173

Кабель для соединения с монитором Nihon-Kohden

РУ: № _____
Дата производства:
Артикул: 82-6887
Номер партии:
Количество:



RxOnly

Не стерильно! Не совместим с МРТИ

Производитель: «Интегра ЛанфСамсиз Сентцерланд САРЛ», Швейцария
Страна изготовления: США
Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Невропродвент»,
Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101.
Тел. +7 495 6608173

Кабель для соединения с монитором Fukuda

РУ: № _____
Дата производства:
Артикул: 82-6889
Номер партии:
Количество:



RxOnly

Не стерильно! Не совместим с МРТИ

Производитель: «Интегра ЛанфСамсиз Сентцерланд САРЛ», Швейцария
Страна изготовления: США
Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ: ООО «Невропродвент»,
Россия, 127486, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, этаж 1, пом. 101.
Тел. +7 495 6608173

Всего пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

3) лист а

Директор (Небурашкин Д.М.)



«УТВЕРЖДЕНО»

Директор

ООО «Нейропроджект»

Д.М. Чебурашкин



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

«Модуль DirectLink® для мониторинга внутричерепного давления, с принадлежностями»

Производства Интегра ЛайфСайнсиз Свитцерланд САРЛ

(Integra LifeSciences Switzerland SARL), Швейцария

Модуль DirectLink® для мониторинга внутричерепного давления, с принадлежностями.
Вторичная упаковка.



REF 82-6828

SN 20DLK16124

CE
2797

DirectLink™
ICP Module

Module de PIC
ICP-Modul
ICP-module
Módulo ICP
Módulo para la medición de la
presión intracraneal (PIC)
Módulo de PIC
ICP-modul
ICP-modul
ICP-moduli
Modulo ICP
ICP modul
Modul ICP



Integra LifeSciences Switzerland Sarl
Rue Général 29 (2nd Floor)
Le Locle Neuchâtel CH-2600,
Switzerland

MADE IN Switzerland

U.S. Patent www.integralife.com/patentmarking



REV. 0

The image shows two boxes of Codman medical equipment, one for a DirectLink™ ICP Extension Cable and one for a Patient Monitor Interfax Cable. Both boxes are white with black text and a barcode. The top box is for the DirectLink™ ICP Extension Cable, which is a 10-foot cable with a 1/2 inch diameter. The bottom box is for the Patient Monitor Interfax Cable, which is a 10-foot cable with a 1/2 inch diameter. Both boxes are shown with their flaps open, revealing the product inside.

Top Box: DirectLink™ ICP Extension Cable

Codman

DirectLink™
ICP Extension Cable
10' (3.05m)
1/2" (12.7mm) dia.
CE

Part No. 10-1000-1000
Lot No. 10-1000-1000
Date of Manufacture: 10/10/00
Date of Expiry: 10/10/05

Caution: Do not use for any other purpose than intended.
Do not use for any other purpose than intended.
Do not use for any other purpose than intended.

U.S. Patent: 5,811,111
U.S. Patent: 5,811,111
U.S. Patent: 5,811,111

Bottom Box: Patient Monitor Interfax Cable

Codman


Patient Monitor Interfax Cable - Philips (12 pin)
10' (3.05m)
1/2" (12.7mm) dia.
CE

Part No. 10-1000-1000
Lot No. 10-1000-1000
Date of Manufacture: 10/10/00
Date of Expiry: 10/10/05


Caution: Do not use for any other purpose than intended.
Do not use for any other purpose than intended.
Do not use for any other purpose than intended.

U.S. Patent: 5,811,111
U.S. Patent: 5,811,111
U.S. Patent: 5,811,111

Модуль DirectLink® для мониторинга внутричерепного давления, с принадлежностями.
Изображение основного блока модуля во вторичной упаковке.

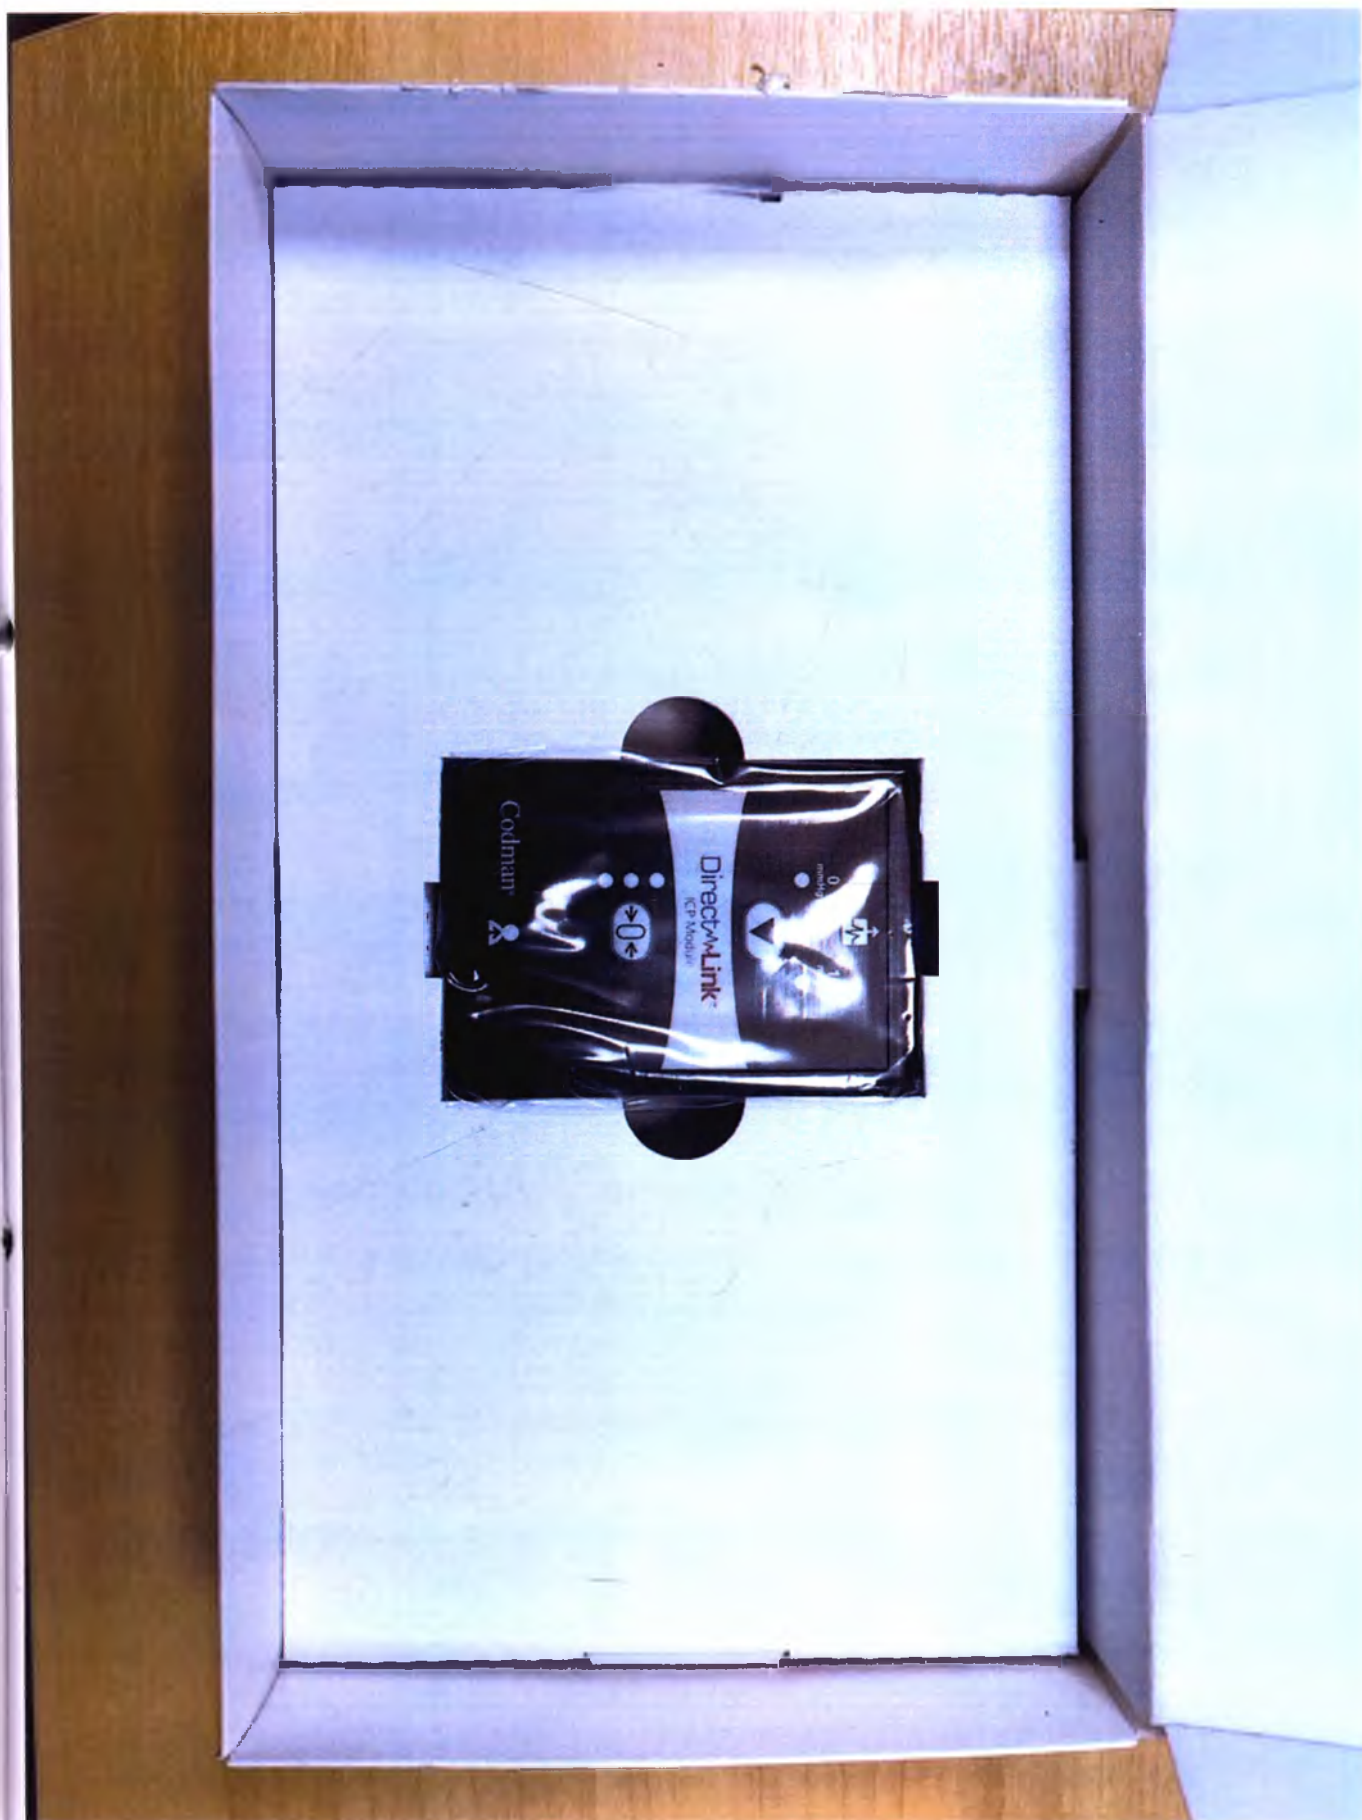



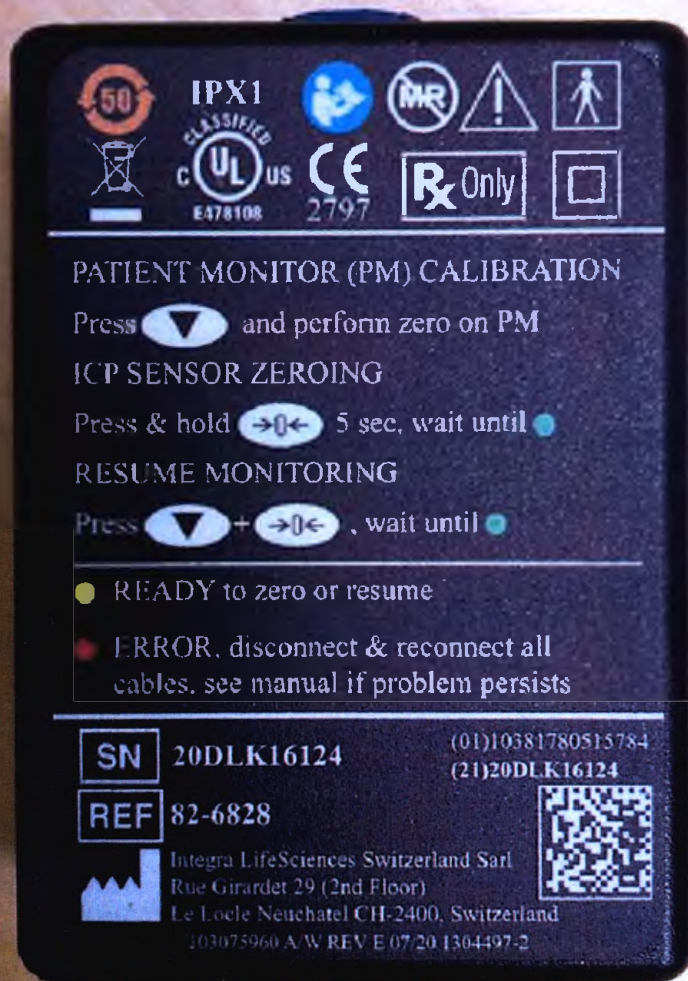

Основной блок модуля DirectLink®. Боковая сторона (низ)



Основной блок модуля DirectLink®. Боковая сторона (верх)



Удлинительный кабель из состава МИ Модуль DirectLink® для мониторинга внутричерепного давления, с принадлежностями, в первичной упаковке



Удлинительный кабель из состава МИ Модуль DirectLink® для мониторинга внутричерепного давления, с принадлежностями



Кабель для соединения с монитором DRAEGER/SIEMENS (принадлежность к МИ Модуль DirectLink® для мониторинга внутричерепного давления, с принадлежностями), в первичной упаковке



Кабель для соединения с монитором DRAEGER/SIEMENS (принадлежность к МИ Модуль DirectLink® для мониторинга внутричерепного давления, с принадлежностями)



Кабель для соединения с монитором PHILIPS (принадлежность к МИ Модуль DirectLink® для мониторинга внутричерепного давления, с принадлежностями), в первичной упаковке



Кабель для соединения с монитором PHILIPS (принадлежность к МИ Модуль DirectLink® для мониторинга внутричерепного давления, с принадлежностями)



Кабель для соединения с монитором GE (принадлежность к МИ Модуль DirectLink® для мониторинга внутричерепного давления, с принадлежностями), в первичной упаковке

Codman

©2019 Integra LifeSciences Corporation. All rights reserved.

REF 82-6882

2021-01-14

LOT 5211346

QTY 1

CE

Patient Monitor Interface Cable - GE (11 pin)

Câble d'interface pour Moniteur Patient - GE (11 broches)

Patientenmonitor-Schnittstellenkabel - GE (11 pin)

Patiëntmonitorinterfacekabel - GE (11-pins)

Cavo per interfaccia per monitor paziente - GE (11 pin)

Cable interfase de monitor - GE (11 patillas)

Cabo de interface de monitor de paciente - GE (11 p.)

Grænsefladekabel til patientmonitor - GE (11 ben)


Gränssnittskabel för patientmonitor - GE (11 stift)

Patient Monitor Interface -liitântäkaapeli - GE (11-nastainen)

Καλώδι διασύνδεσης παρακολούθησ ασθενούς - GE (11 επαφ)

Betegmonitor interfészakabel - GE (11 tűs)


Prepojovací kábel monitora pacienta - GE (11-kolíkový)



Integra LifeSciences Switzerland Sarl
Rue Girardet 29 (2nd Floor)
Le Locle Neuchâtel CH-2400, Switzerland

MADE IN China

U.S. Patent www.integralife.com/patentmarking




(01)10381780520733



(10)5211346

REV. D

Кабель для соединения с монитором GE (принадлежность к МИ Модуль DirectLink® для мониторинга внутричерепного давления, с принадлежностями)

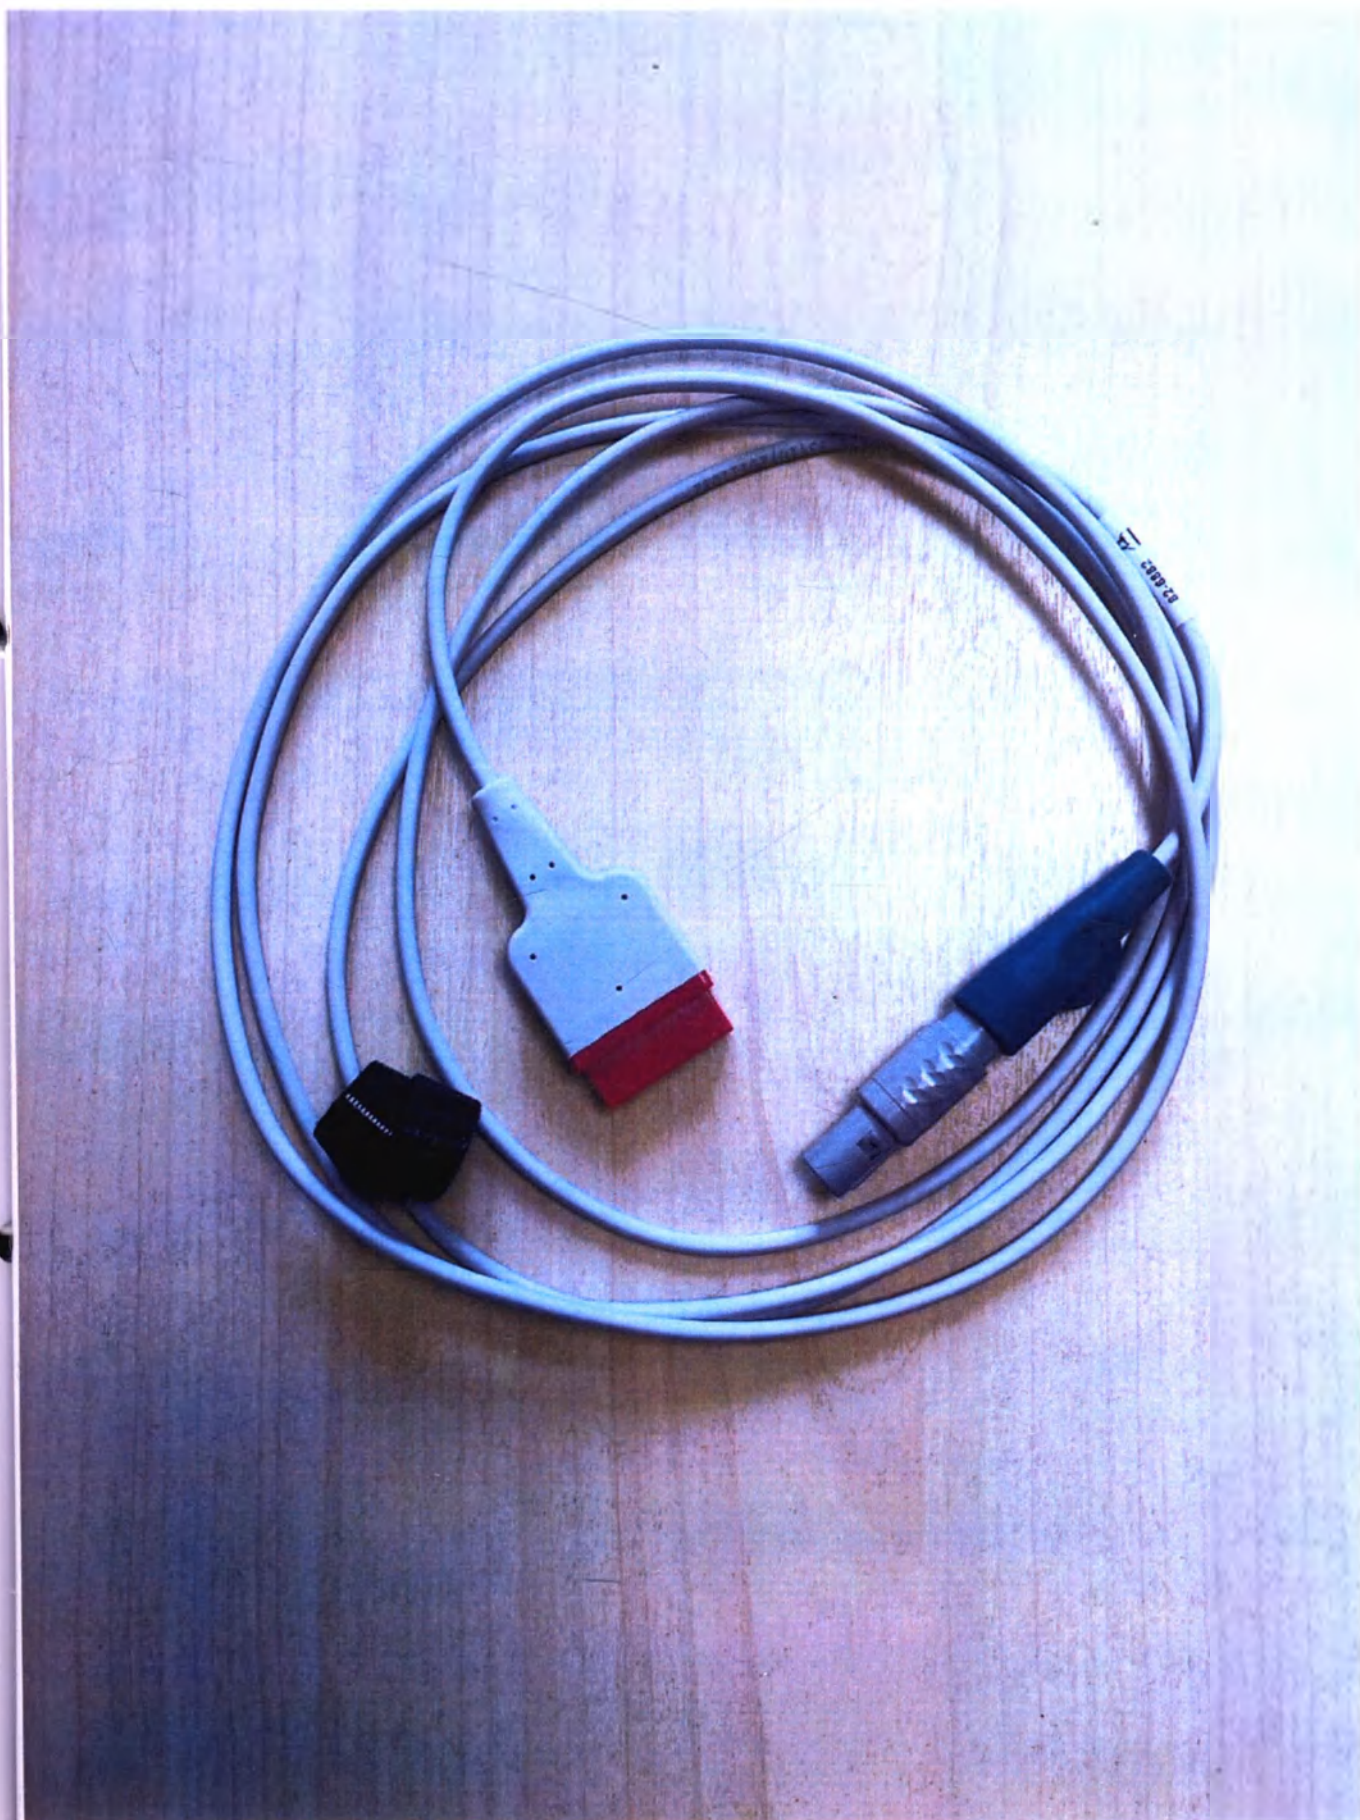


Кабель для соединения с монитором Spacelabs (принадлежность к МИ Модуль DirectLink® для мониторинга внутричерепного давления, с принадлежностями), в первичной упаковке



Кабель для соединения с монитором Spacelabs (принадлежность к МИ Модуль DirectLink® для мониторинга внутричерепного давления, с принадлежностями)



Кабель для соединения с монитором Nihon-Kohden (принадлежность к МИ Модуль DirectLink® для мониторинга внутричерепного давления, с принадлежностями), в первичной упаковке

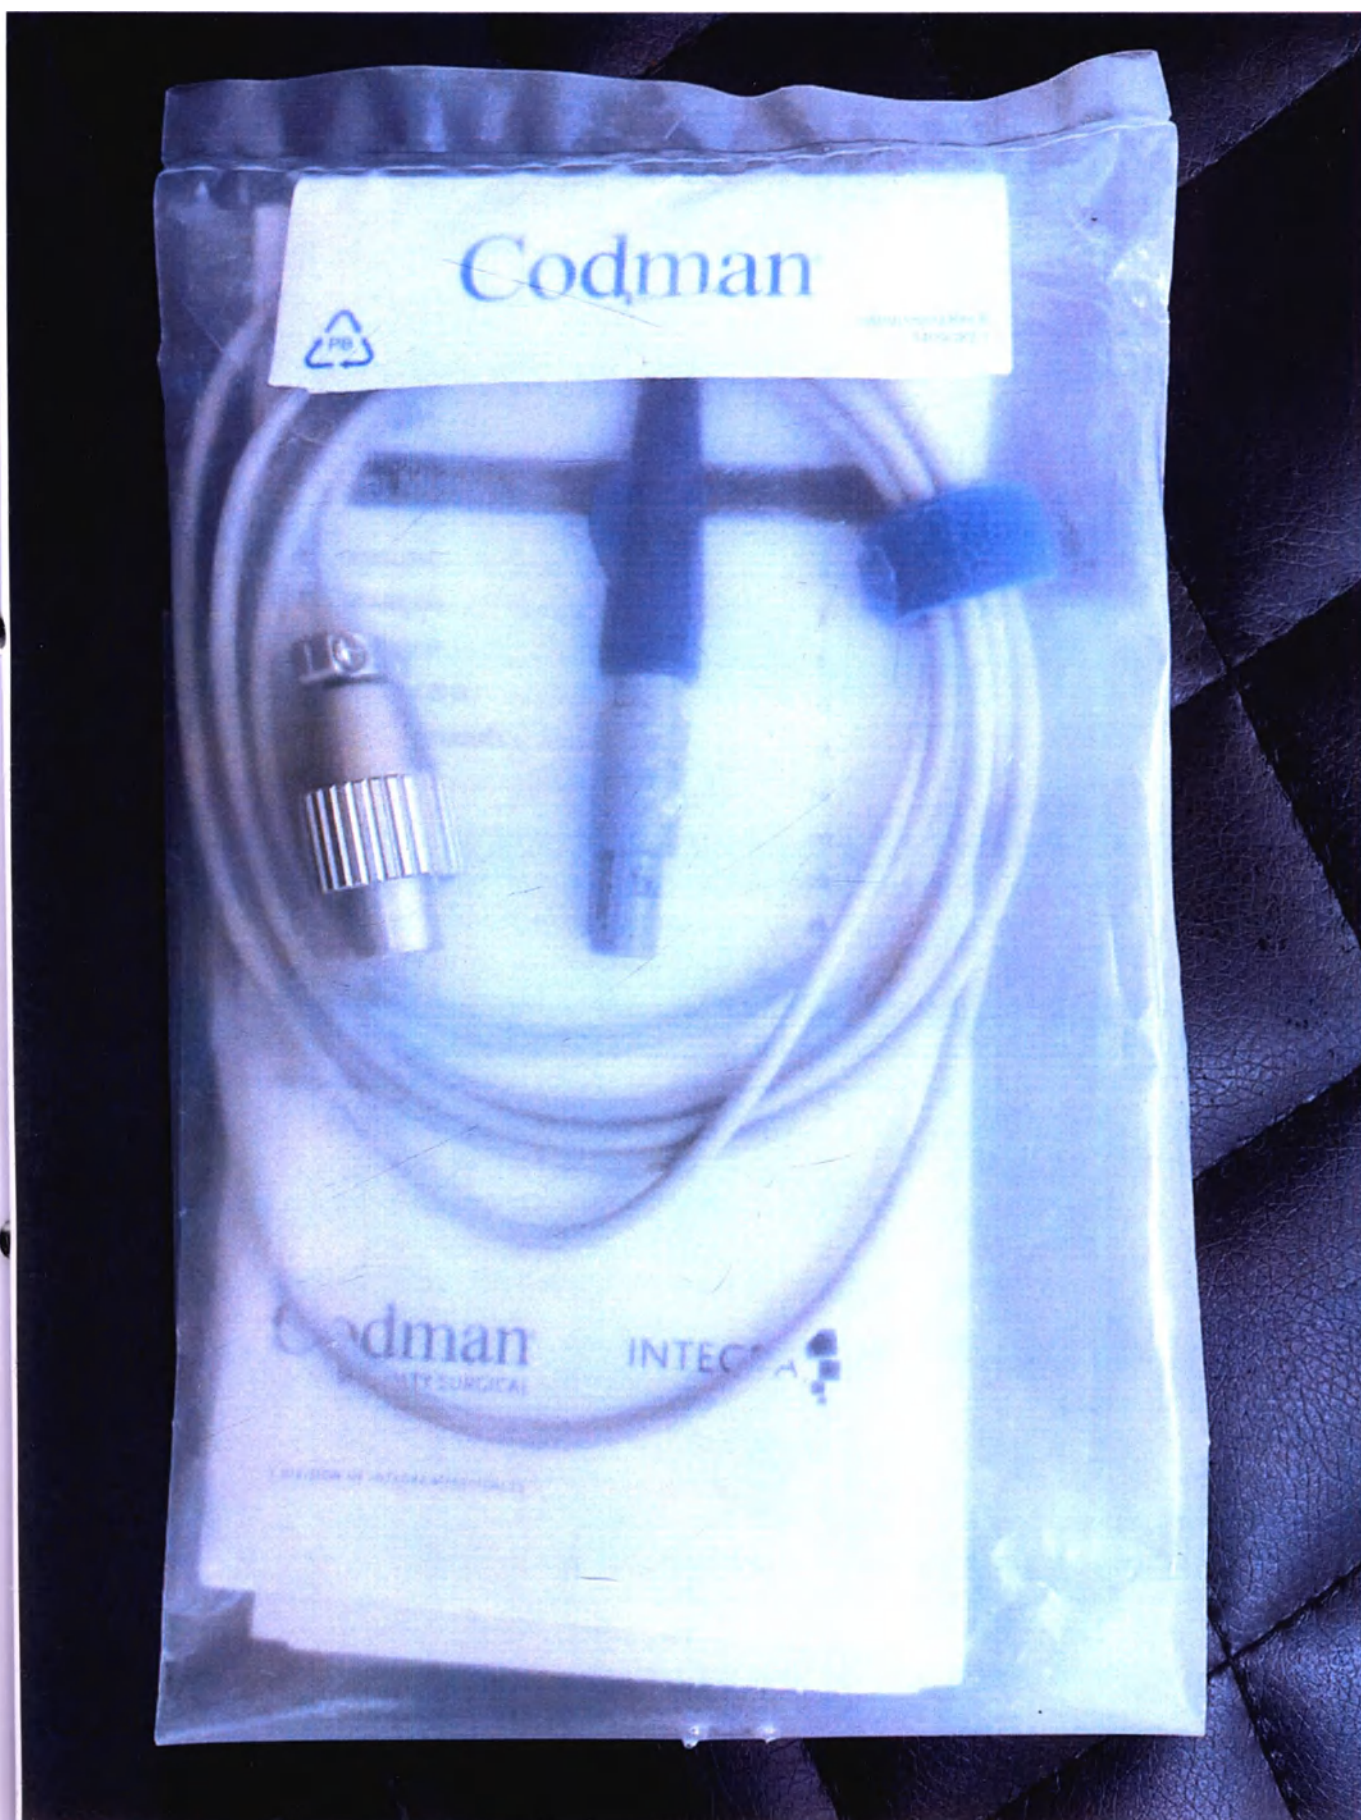

Кабель для соединения с монитором Nihon-Kohden (принадлежность к МИ Модуль DirectLink® для мониторинга внутричерепного давления, с принадлежностями)




Кабель для соединения с монитором Fukuda (принадлежность к МИ Модуль DirectLink® для мониторинга внутричерепного давления, с принадлежностями), в первичной упаковке



Кабель для соединения с монитором Fukuda (принадлежность к МИ Модуль DirectLink® для мониторинга внутричерепного давления, с принадлежностями)




Кабель для соединения с монитором GE Datex-Ohmeda (принадлежность к МИ Модуль DirectLink® для мониторинга внутричерепного давления, с принадлежностями), в первичной упаковке

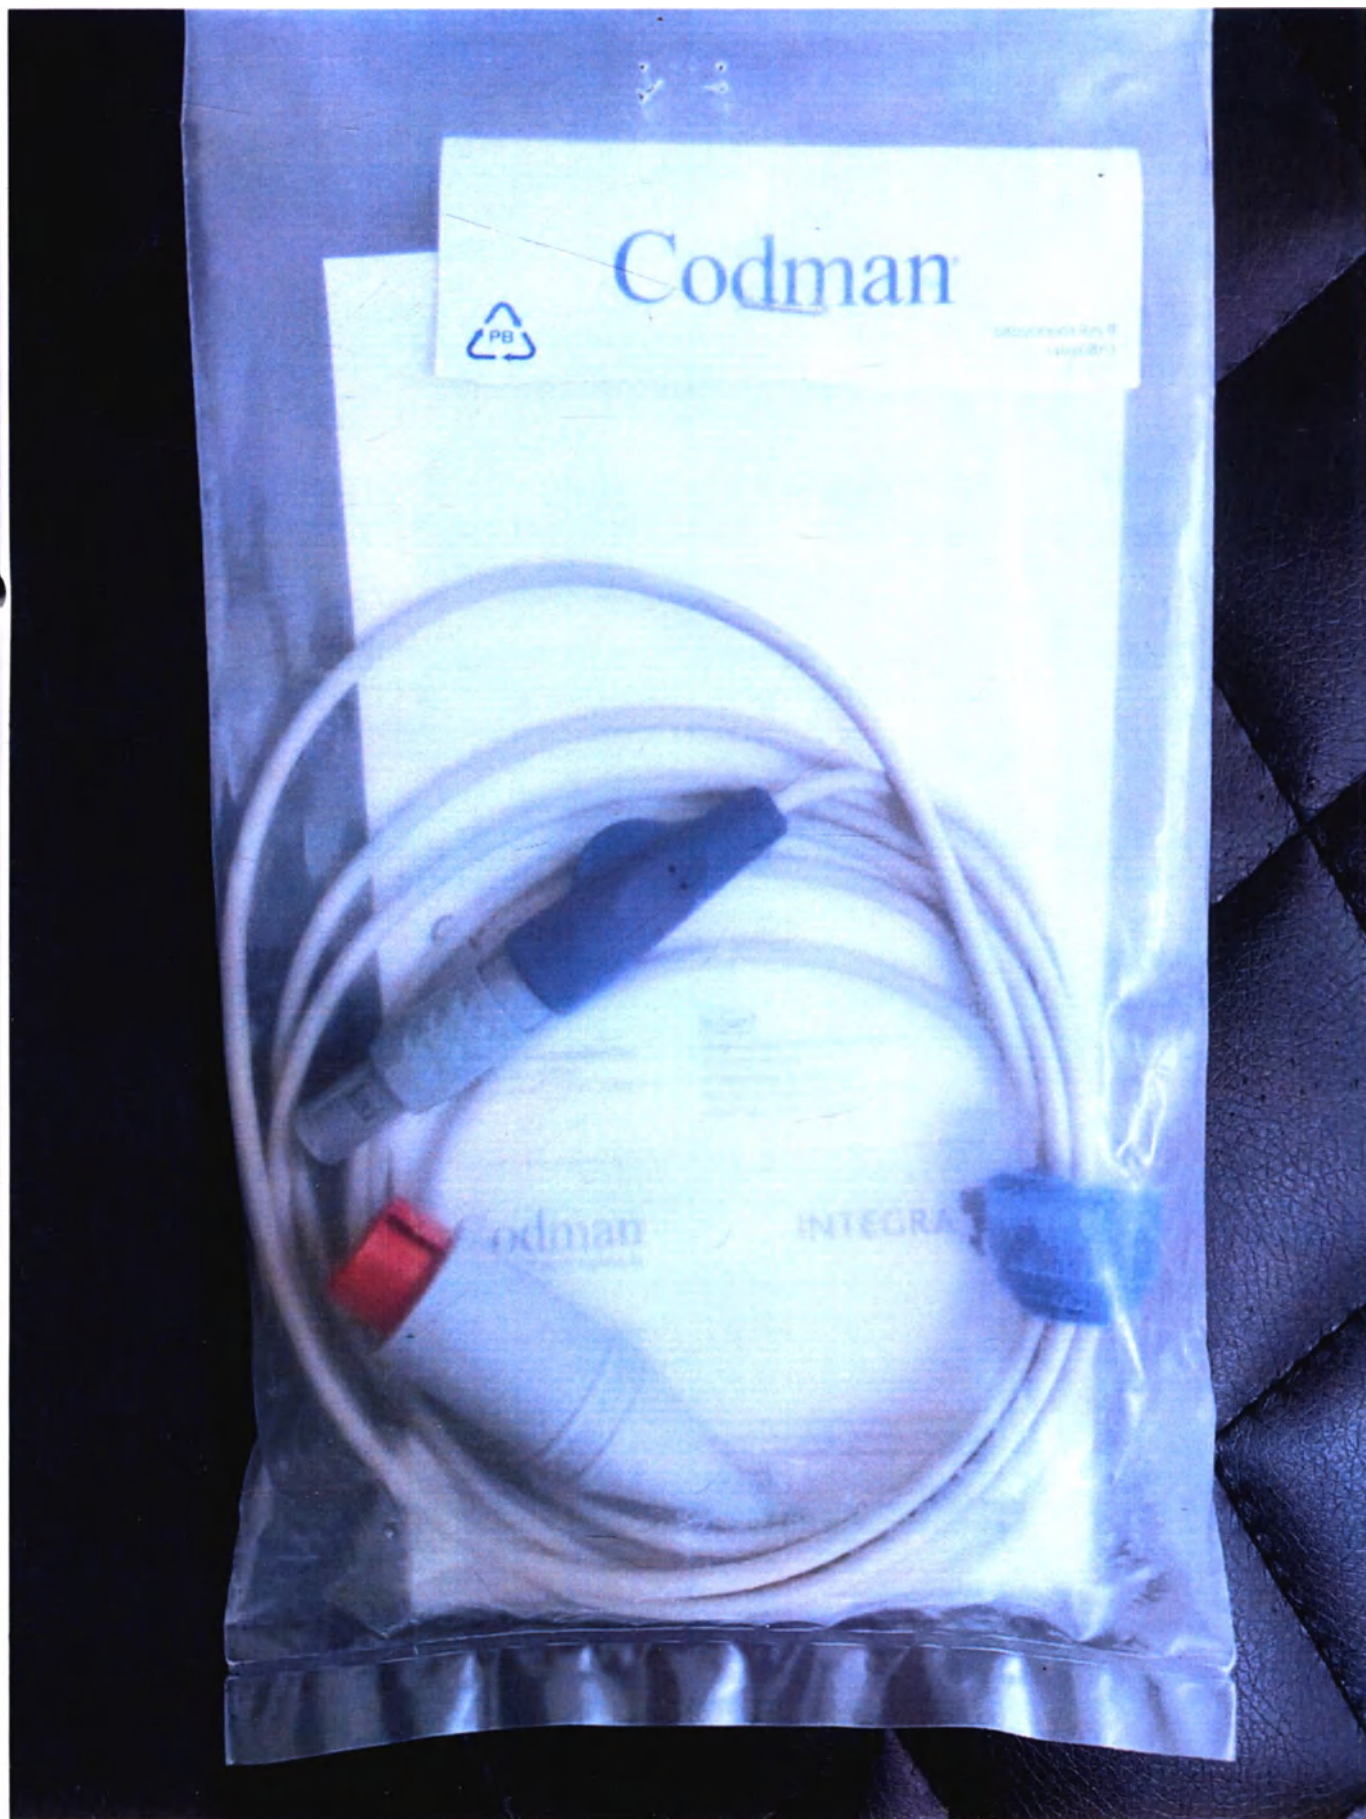

Кабель для соединения с монитором GE Datex-Ohmeda (принадлежность к МИ Модуль DirectLink® для мониторинга внутричерепного давления, с принадлежностями)



Всего пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

24 (двадцать четыре) лист а
Директор  (Чебурашкин Д.М.)

