

Фотографические изображения МИ:

«Набор калибраторов для количественного определения N конечного фрагмента про-натрийуретического пептида типа В (NT proBNP) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e, в вариантах исполнения»

I. Набор калибраторов для количественного определения N-концевого фрагмента про-натрийуретического пептида типа В (NT pro-BNP) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (ProBNP II CalSet cobas e analyzers), в составе



1. Набор калибраторов для количественного определения N концевого фрагмента про-натрийуретического пептида типа В в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (ProBNP II CalSet cobas e analyzers), в составе

cobas e analyzers

REF 09315292190

COBAS, COBAS E
and ELECSYS are
trademarks of Roche

 Roche GmbH
Sandhofer Str. 116
D-68305 Mannheim

 Distribution in USA by:
Roche Diagnostics,
Indianapolis, IN
Made in Germany

H317

P333+P313
P362+P364,P501

Cal1 → 2 x 1.0 mL

Cal2 → 2 x 1.0 mL




IVD

0123

2-8 °C

I. Набор калибраторов для количественного определения N-концевого фрагмента про-натрийуретического пептида типа В (NT-proBNP) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (ProBNP II CalSet cobas e analyzers), в составе

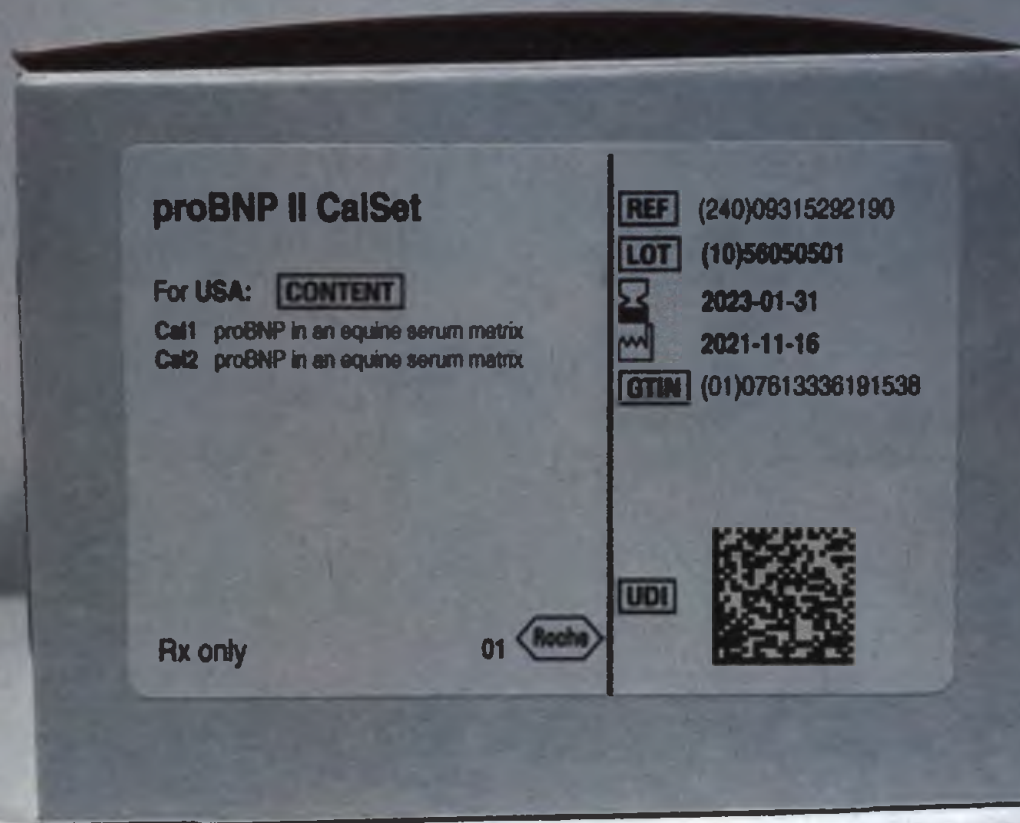

I. Набор калибраторов для количественного определения N-концевого фрагмента про-натрийуретического пептида типа В (NT-proBNP) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (ProBNP II CalSet cobas e analyzers), в составе

Набор калибраторов для количественного определения N-концевого фрагмента про-натрийуретического пептида типа В (NT-proBNP) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (ProBNP II CalSet cobas e analyzers), в составе:

1. Калибратор 1 (PBNPX Cal1), флакон, объем 1,0 мл – 2 шт.;
2. Калибратор 2 (PBNPX Cal2), флакон, объем 1,0 мл – 2 шт.;
3. Флакон нулевой – 4 шт.;
4. Карточка со стрипом – 1 шт.;
5. Этикетки для флаконов – 12 шт.;
6. Инструкция по применению.

Регистрационный удостоверение № РЗН 2011/14057 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рох Диагностикс ГмбХ"), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия

Изделие предназначено только для диагностики in vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рох Диагностикс Рус» (ООО «Рох Диагностикс Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception2_dia@roche.com

Кат. номер 09315292190

I. Набор калибраторов для количественного определения N-концевого фрагмента про-натрийуретического пептида типа В (NT-proBNP) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (ProBNP II, cobas e analyzers), в составе

Калибратор 1 (PBNPX Cal1), флакон, объем 1,0 мл




I. Набор калибраторов для количественного определения N-концевого фрагмента про-натрийуретического пептида типа В (NT-proBNP) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (ProBNP II CalSet cobas e analyzers), в составе Калибратор 2 (PBNPX Cal2), флакон, объем 1,0 мл




I. Набор калибраторов для количественного определения N-концевого фрагмента про-натрийуретического пептида типа B (NT-proBNP) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (ProBNP II cobas e analyzers), в составе
Флакон пустой



Л. Набор калибраторов для количественного определения N-концевого фрагмента про-натрийуретического пептида типа В (NT-proBNP) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (ProBNP II CalSet), в составе Флаконе пустой

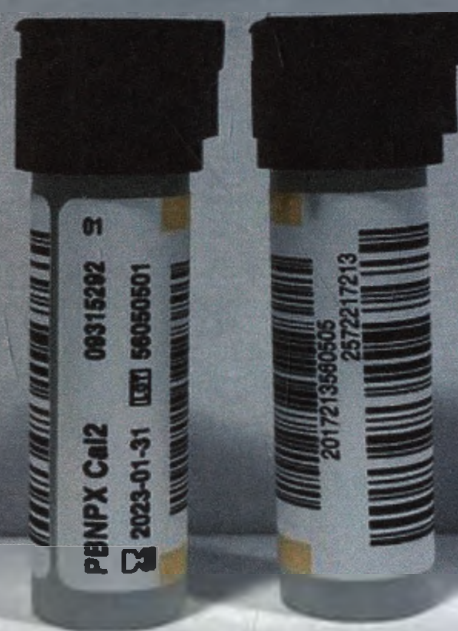


I. Набор калибраторов для количественного определения N-концевого фрагмента про-натрийуретического пептида типа В (NT-BNP) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (ProBNP II CalSet cobas e analyzers), в составе Карточка со штрихкодом

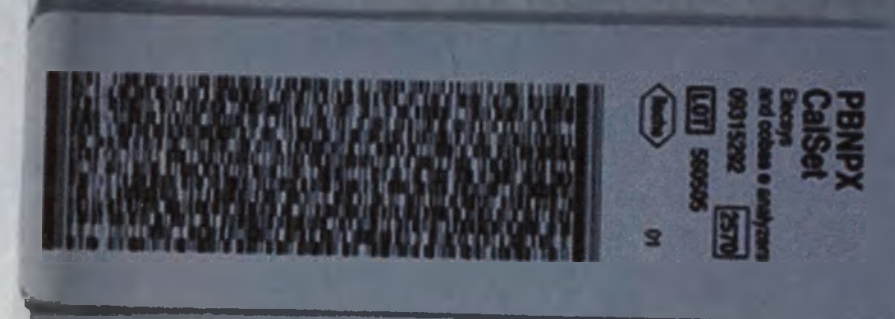

I. Набор калибраторов для количественного определения N-концевого фрагмента про-натрийуретического пептида типа В (NT-proBNP) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах и модулях иммунохимических cobas e (ProBNP II CalSet cobas e analyzers), в составе
 Этикетка для флакона




II. Набор калибраторов для количественного определения N конечного фрагмента про-натрийуретического пептида (NT-pro-BNP) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (CalSet ProBNP II) в составе

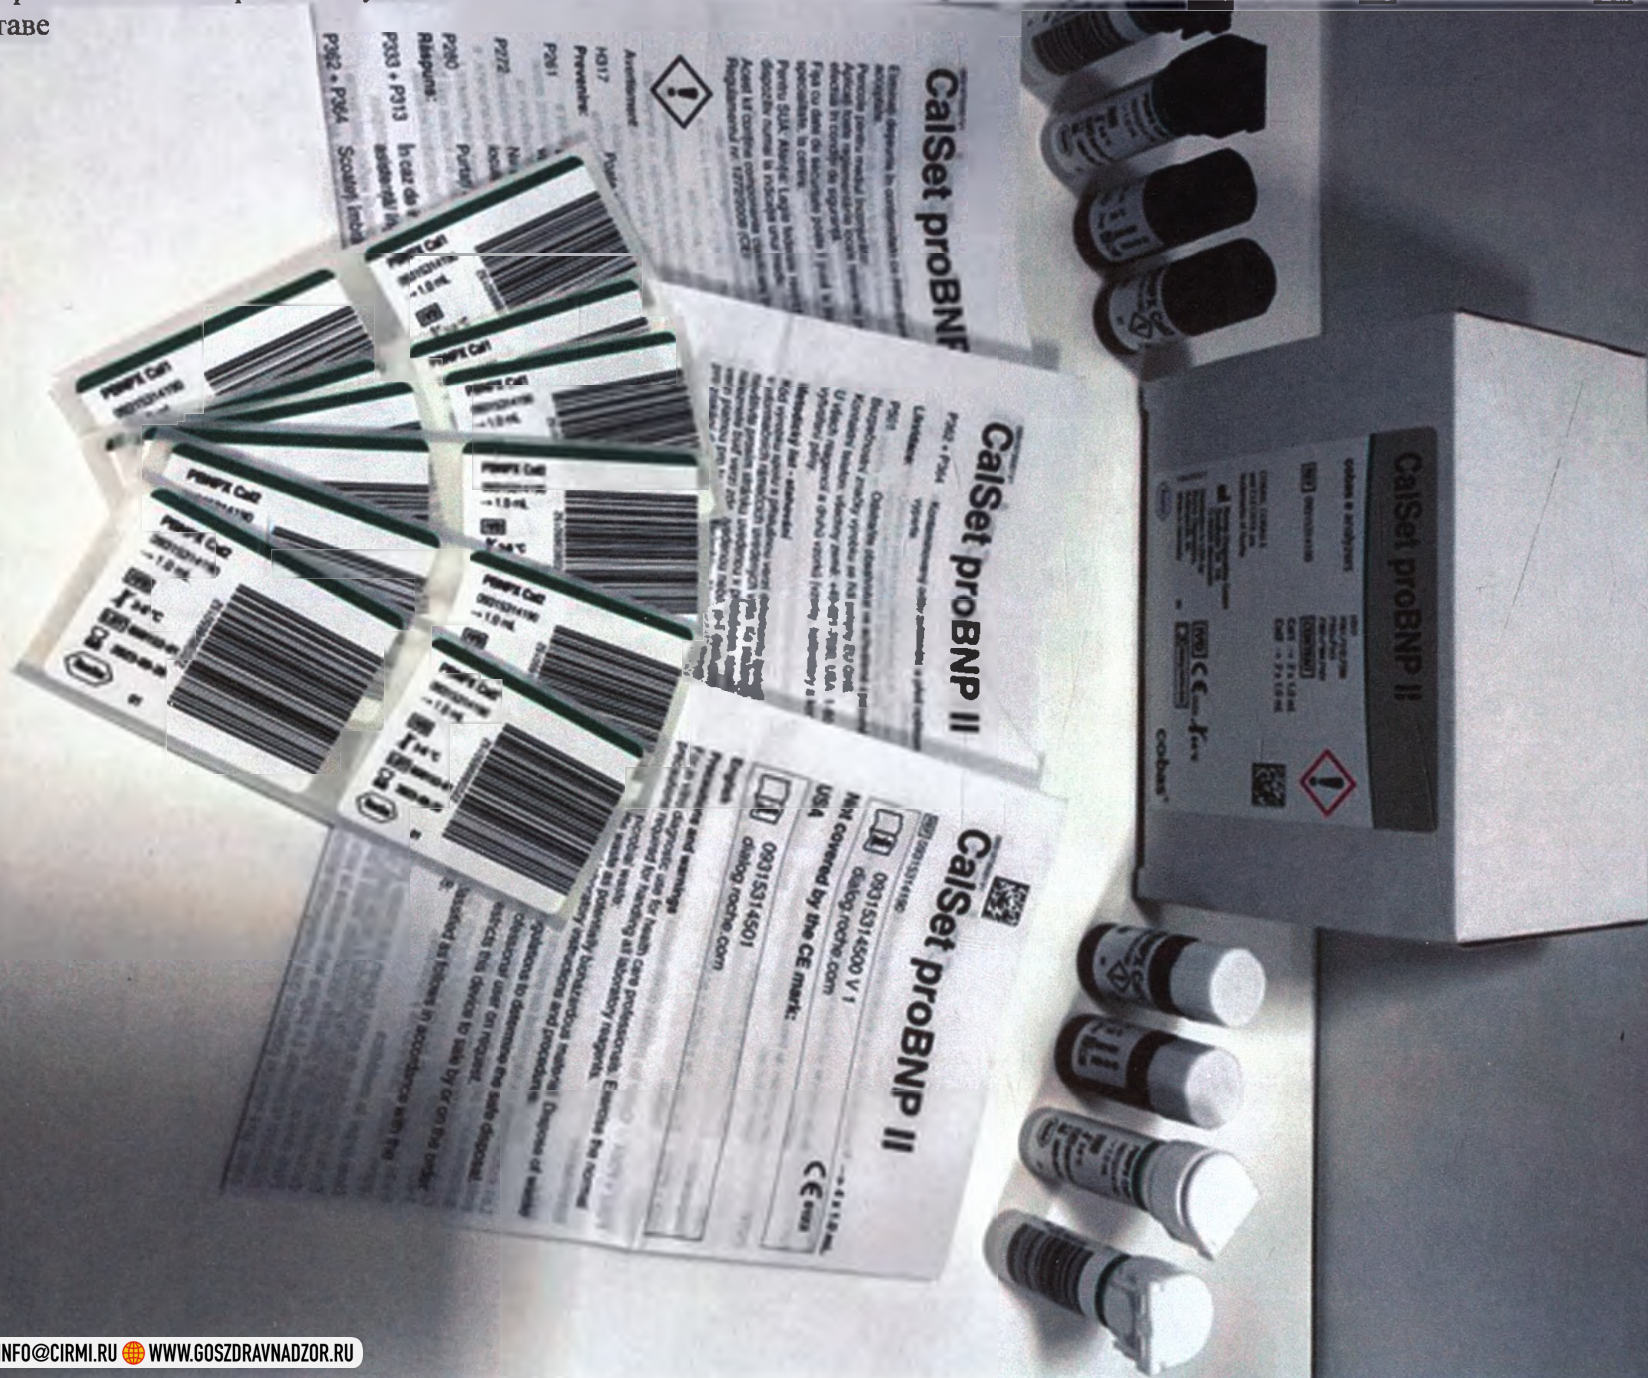

II. Набор калибраторов для количественного определения N-концевого фрагмента про-натрийуретического пептида типа B в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (CalSet ProBNP II cobas e) в составе



II. Набор калибраторов для количественного определения N-концевого фрагмента про-натрийуретического пептида типа B (CalSet ProBNP II) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (CalSet ProBNP II cobas e analyzer) в составе

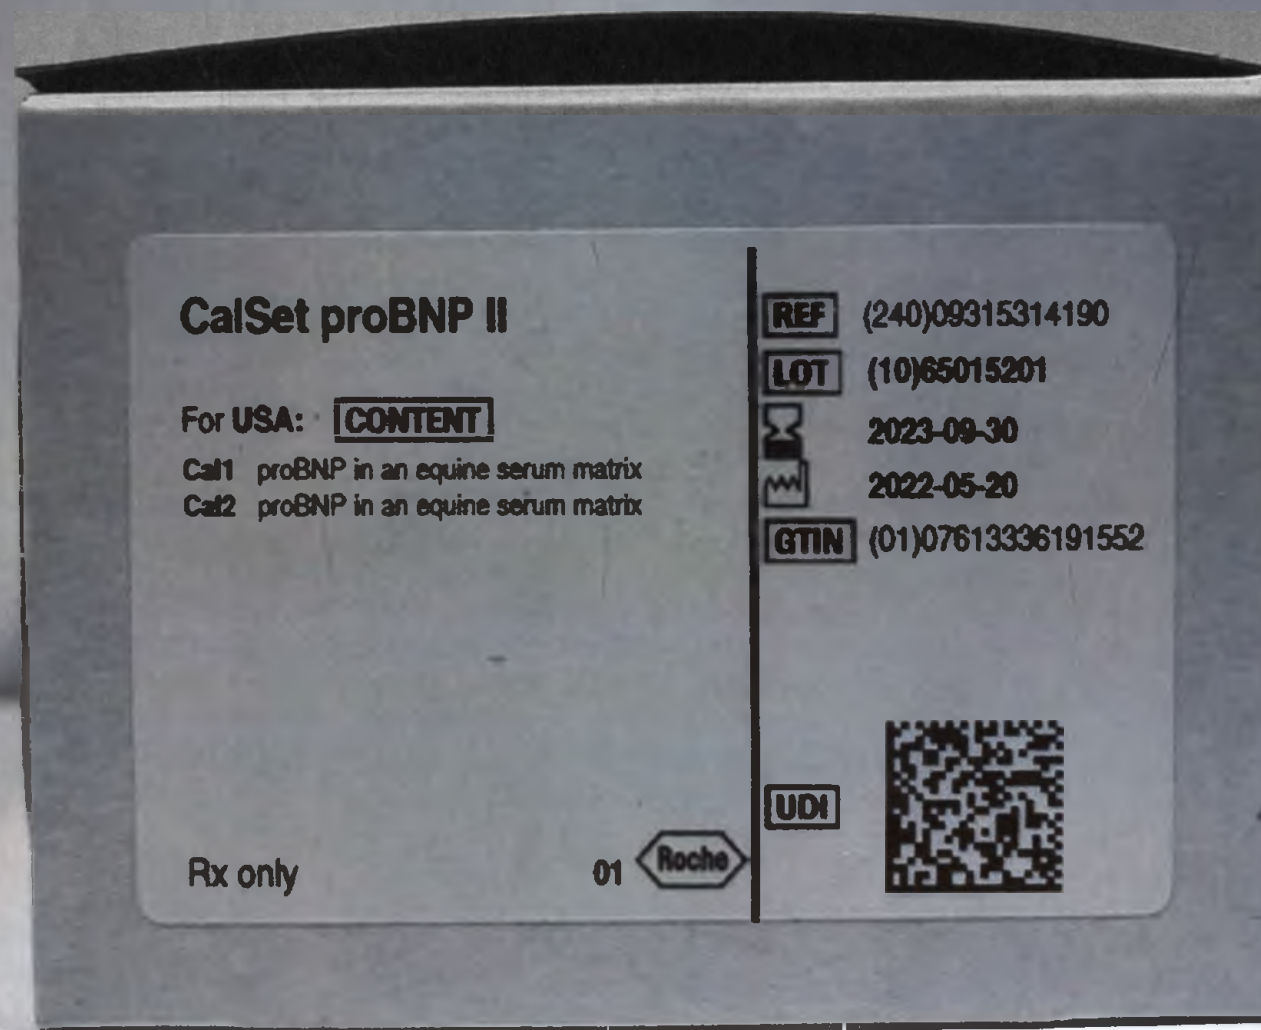

II. Набор калибраторов для количественного определения N-концевого фрагмента про-натрийуретического пептида типа В (NT-proBNP) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (CalSet ProBNP II cobas e analyzer), в составе

Набор калибраторов для количественного определения N-концевого фрагмента про-натрийуретического пептида типа В (NT-proBNP) в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (CalSet ProBNP II cobas e analyzer), в составе:

1. Калибратор 1 (PBNPX Cal1), флакон, объем 1,0 мл – 2 шт.;
2. Калибратор 2 (PBNPX Cal2), флакон, объем 1,0 мл – 2 шт.;
3. Флакон пустой – 4 шт.;
4. Этикетки для флаконов – 12 шт.;
5. Инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение № PZN 2021/14057 от _____

Срок годности см. на упаковке

Температура хранения см. на упаковке

Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» («Рох Диагностикс ГмбХ»), Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany, Германия


Изделие предназначено только для диагностики *in vitro*

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «Рох Диагностикс Рус» (ООО «Рох Диагностикс Рус»), 107031, Москва, Трудовая колония, д.2 Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.reception2_dia@roche.com

Кат. номер 09315314190

II. Набор калибраторов для количественного определения N-концевого фрагмента про-натрийуретического пептида типа B в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (CalSet ProBNP II cobas e analyt

Калибратор 1 (PBNPX Cal1), флакон, объем 1,0 мл

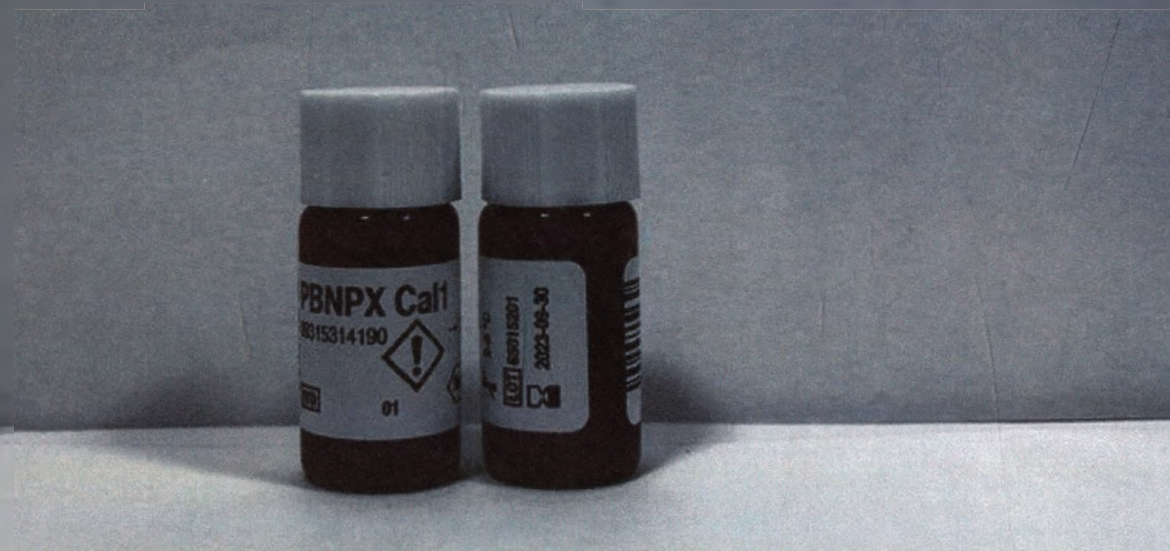


II Набор калибраторов для количественного определения N-концевого фрагмента про-натрийуретического пептида типа B в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (CalSet ProBNP II cobas e) в составе

Калибратор 2 (PBNPX Cal2), флакон, объем 1,0 мл




II. Набор калибраторов для количественного определения N-концевого фрагмента про-натрийуретического пептида типа BNP в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (CalSet ProBNP II cobas e-analy.
в составе
Флакон пустой

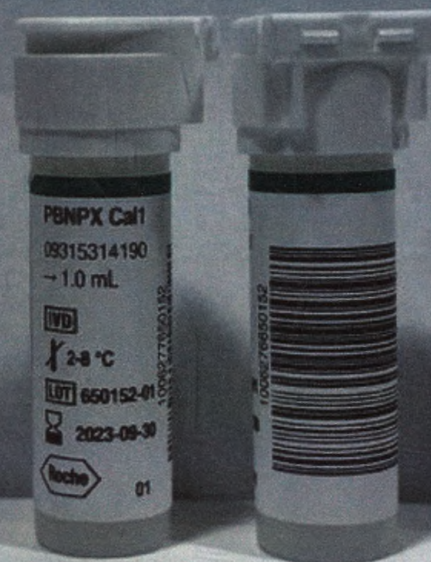

II. Набор калибраторов для количественного определения N-концевого фрагмента про-натрийуретического пептида типа B в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (CalSet ProBNP II cobas e analyzer) в составе

Флакон пустой

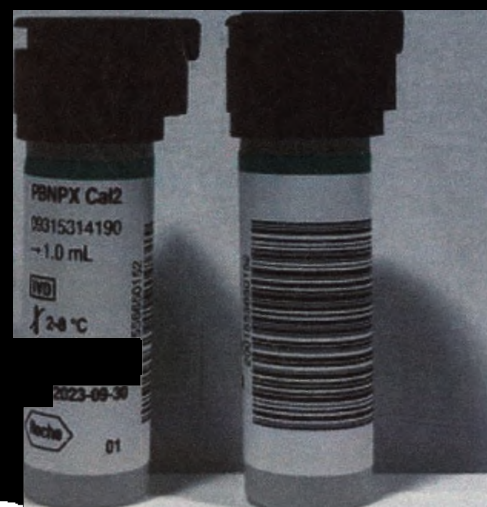

II. Набор калибраторов для количественного определения N-концевого фрагмента про-натрийуретического пептида типа B в сыворотке и плазме крови иммунохемилюминесцентным методом на модулях иммунохимических cobas e (CalSet ProBNP II cobas e analy

Этикетка для флакона



Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

22 листа (ов)



На доверенности

от 11.02.2022 г.