



Общество с ограниченной ответственностью МЛТ

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО МЛТ

 А.В. Безруков

«5» 07 2020 г.



Фотографические изображения медицинского изделия
«Автомат окраски препаратов на предметных стёклах по
ТУ 26.60.12-006-23475651-2020 в следующих исполнениях:
АФОМК-9-25, АФОМК-12-25 в составе»





**Автомат окраски препаратов на предметных стеклах
по ТУ 26.60.12-006-23475651-2020 АФОМК-12-25**

 Автомат окраски препаратов на предметных
стеклах по ТУ 26.60.12-006-23475651-2019
АФОМК-12-25

РУ № xxx xxx/xxx от XX xxxxx XXXX г.

 **540005**  **26.60.12.007.12**  **2019**

 **ООО МЛТ,**
141983, г. Дубна, ул. Программистов, д.4 к.3
+7 (495) 287 81 00, www.mlt.ru, mlt.lco@mail.ru

~220 В, 50 Гц, 300 ВА  **10 А**  **10 А**  

Автомат окраски препаратов на предметных стеклах
по ТУ 26.60.12-006-23475651-2020 АФОМК-12-25 (маркировка)



**Автомат окраски препаратов на предметных стеклах
по ТУ 26.60.12-006-23475651-2020 АФОМК-9-25**

IVD Автомат окраски препаратов на предметных
стеклах по ТУ 26.60.12-006-23475651-2019

АФОМК-9-25

РУ № xxx xxxx/xxxx от XX xxxxxx XXXX г.

SN 530003 **REF** 26.60.12.007.9  2019




ООО МЛТ,

141983, г. Дубна, ул. Программистов, д.4 к.3

+7 (495) 287 81 00, www.mlt.ru, mlt.llc@mail.ru


~220 В, 50 Гц, 300 ВА



Автомат окраски препаратов на предметных стеклах по
ТУ 26.60.12-006-23475651-2020 АФОМК-9-25(маркировка)



Штатив для предметных стекол-ШВ-25

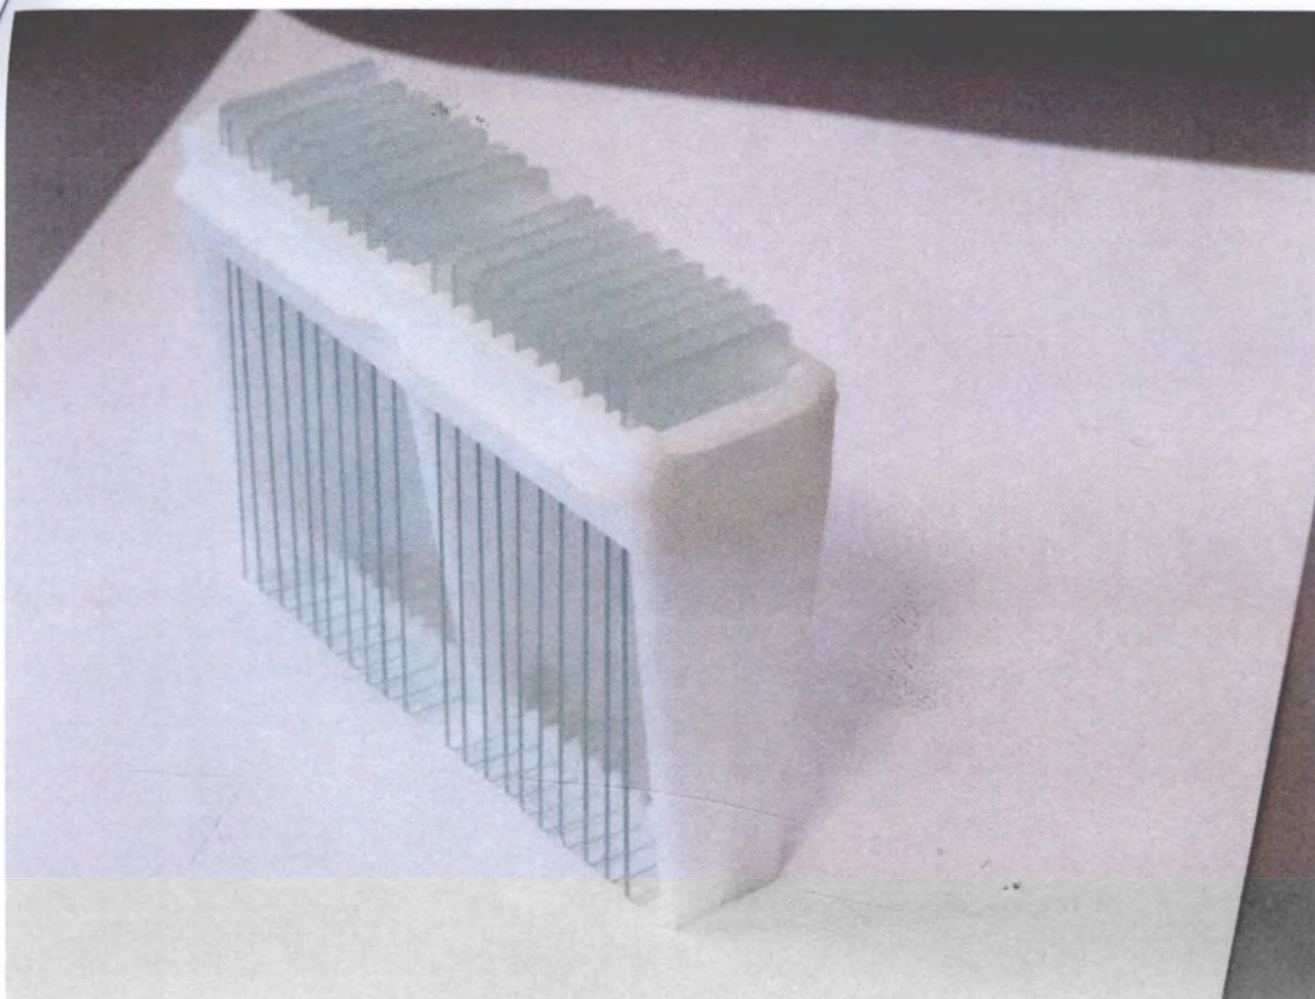


Вкладыш для предметных стекол



Штатив для вкладыша



Блоттер

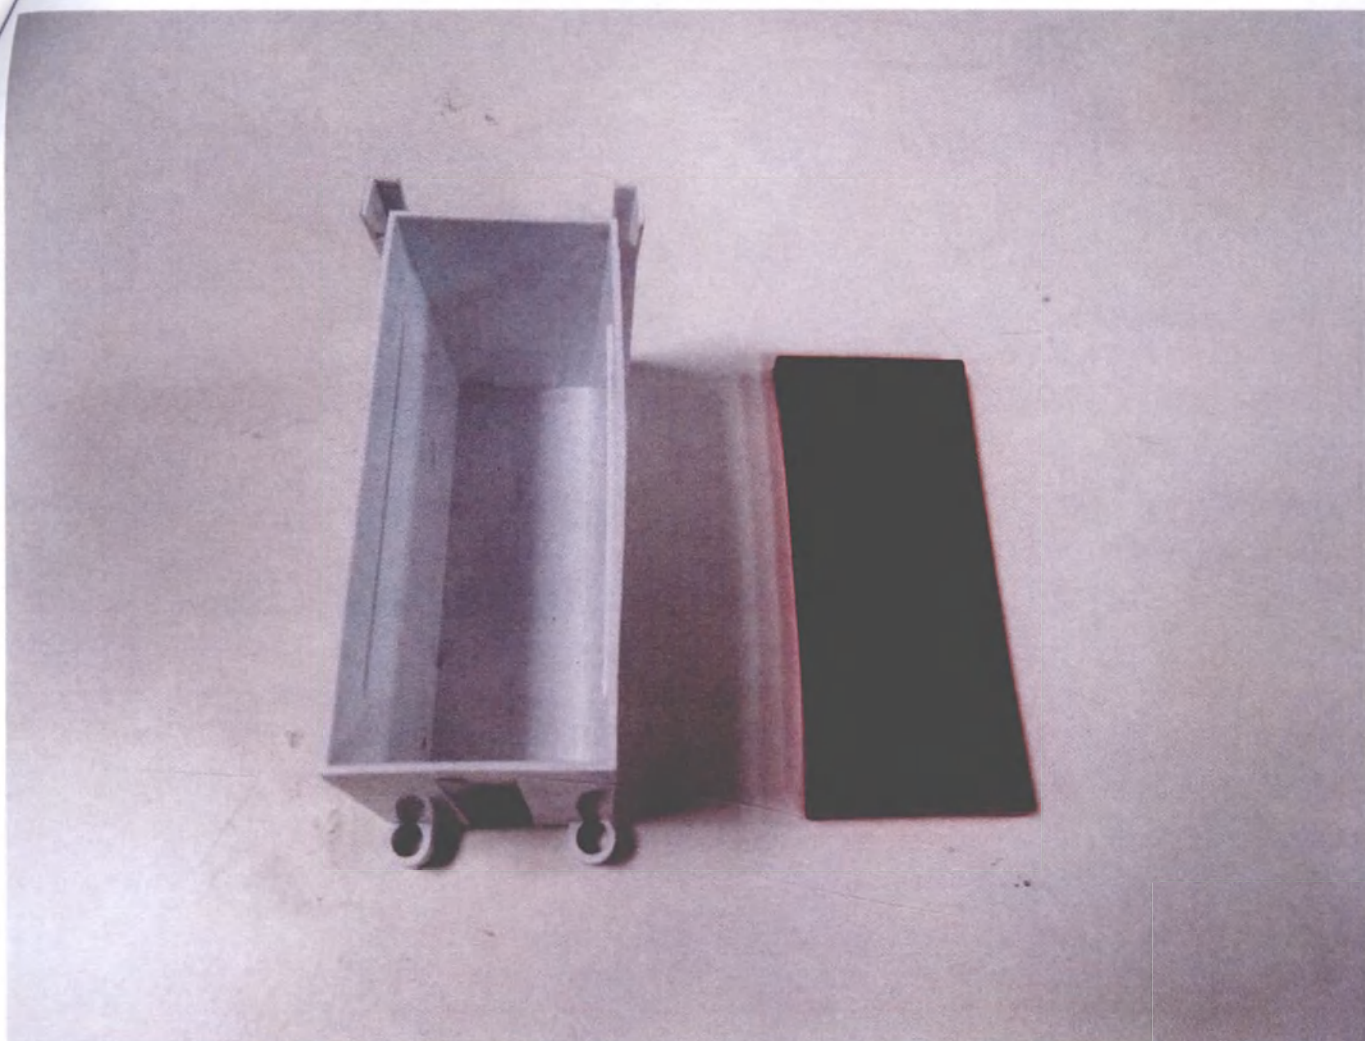


Ванна для реагентов ВВ-25 ПП с крышкой




Ванна для реагентов ВВ-25 ПОМ с крышкой



Комплект сантехнический для подключения к водопроводу

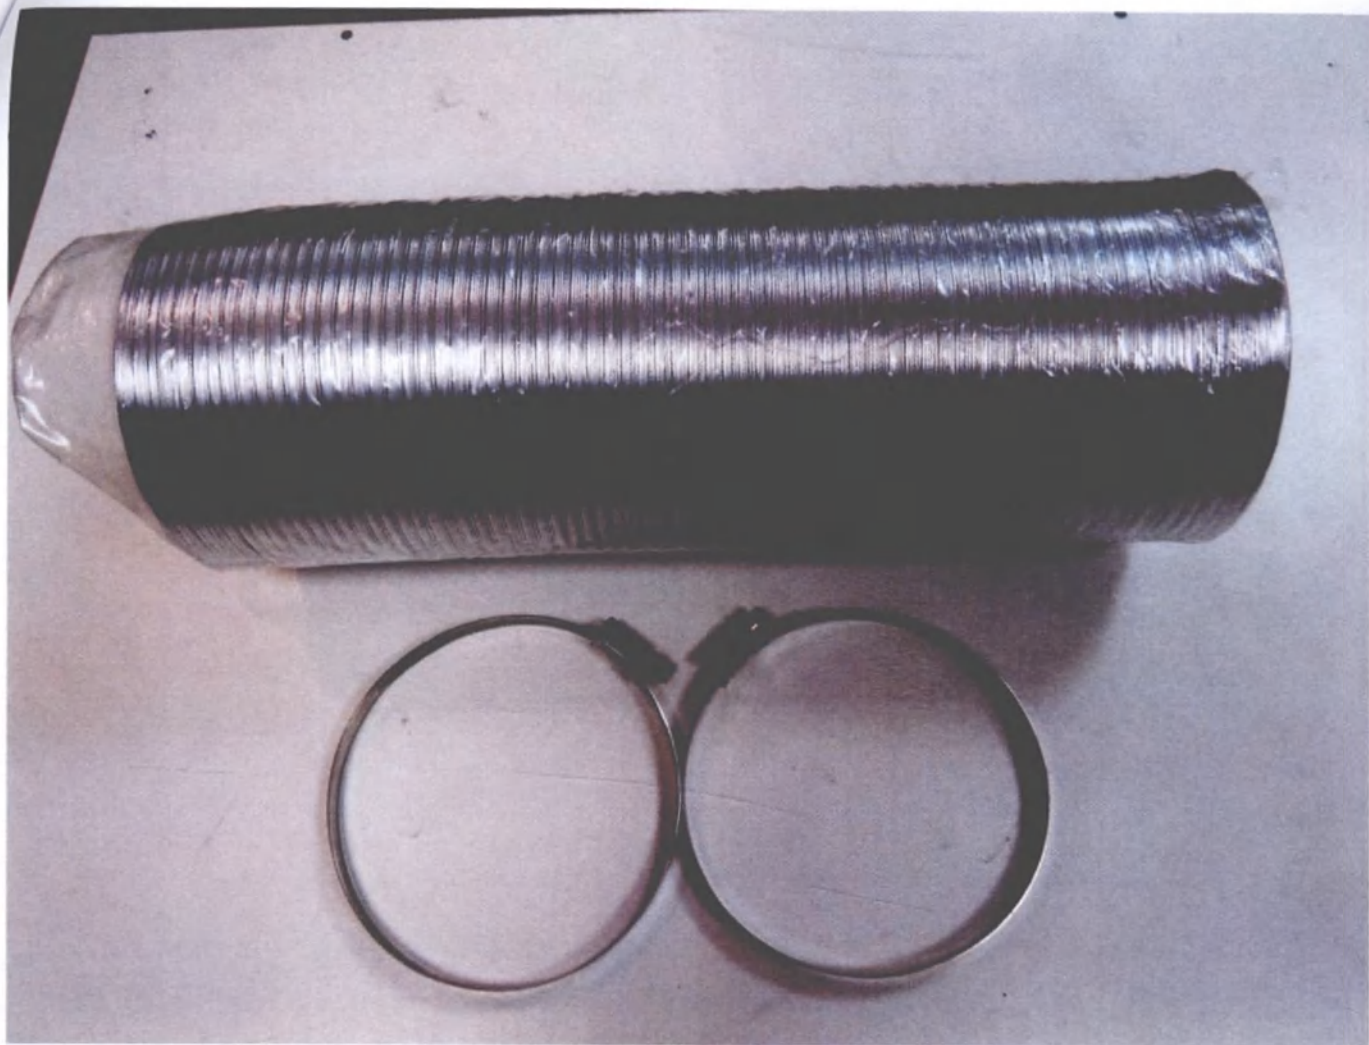

Комплект для подключения к вентиляции

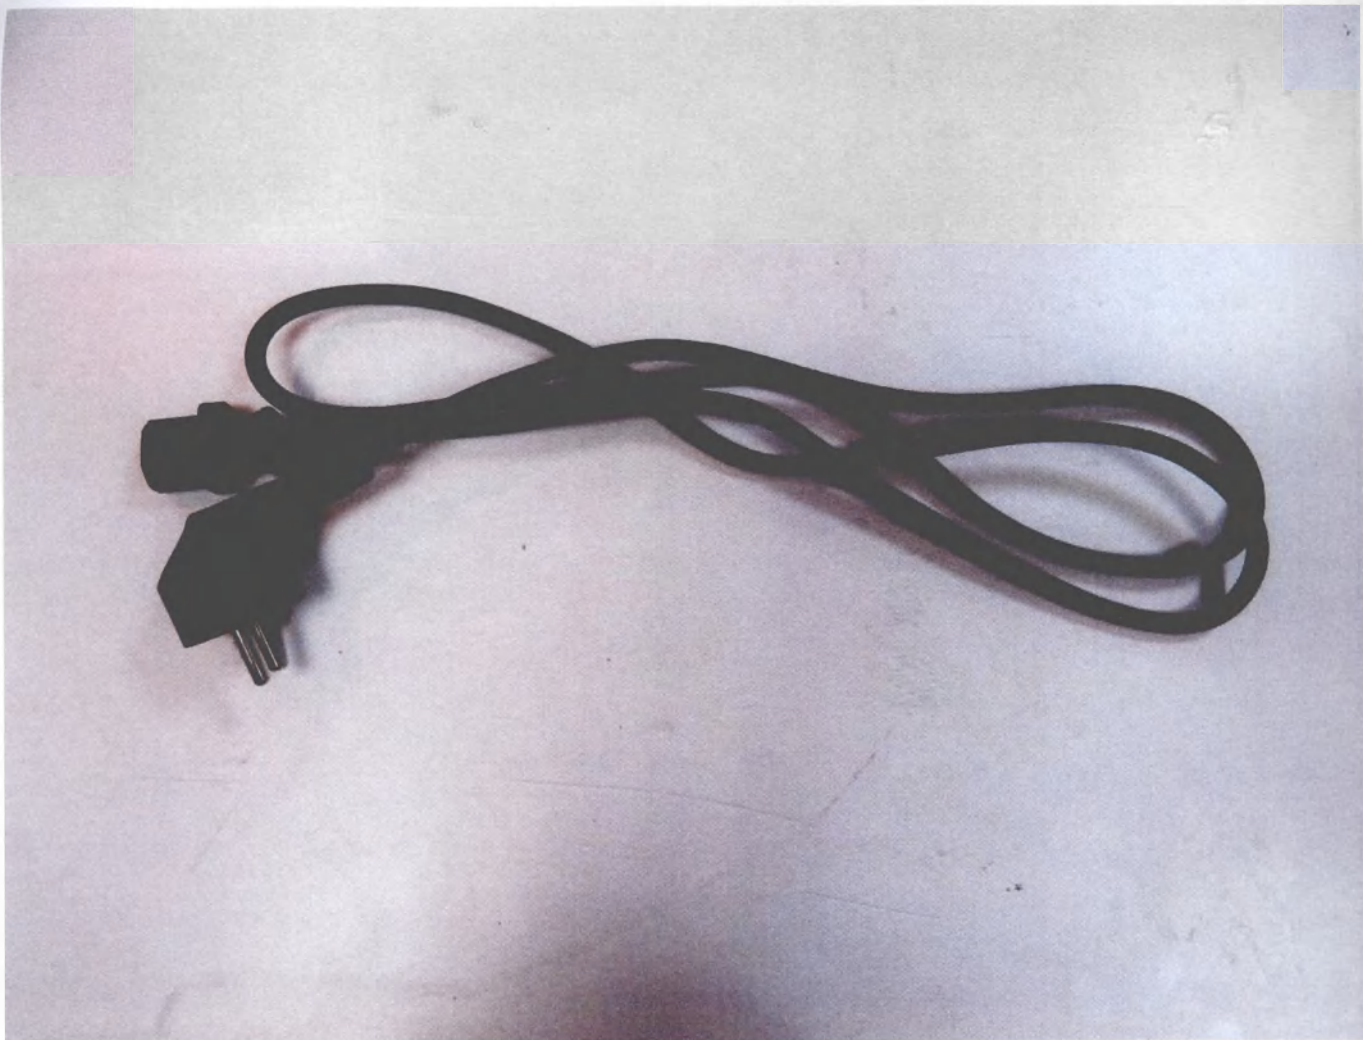

Сетевой кабель питания

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 14
(и Безруков) листов

Генеральный директор
ООО МЛТ

 А.В. Безруков





Общество с ограниченной ответственностью МЛТ

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО МЛТ

А.В. Безруков

«9» 02 2022 г.

Образцы маркировки медицинского изделия
«Автомат окраски препаратов на предметных стеклах по
ТУ 26.60.12-006-23475651-2020 в следующих исполнениях:
АФОМК-9-25, АФОМК-12-25 в составе»

Маркировка упаковки автомата окраски препаратов на предметных стеклах
АФОМК 9-25 (транспортная маркировка)

MLT	Автомат окраски препаратов на предметном стекле АФОМК-9-25	
	ТУ 26.60.12-006-23475651-2020	
Регистрационное удостоверение №XXX XXXX/XXXX		
	ООО МЛТ, 141983, г. Дубна, ул. Программистов, д.4 к.3	
		
		
		
REF 26.60.12.007.9	SN _____	
Упаковщик _____	Дата упаковки _____	
Количество мест / место _____	Штамп ОТК _____	

Символ	Описание
	Серийный номер
	Номер по каталогу
	Для in vitro диагностики
	Дата изготовления
	Изготовитель
	Номинал предохранителя
	Обратись к руководству по эксплуатации
	Хрупкое. Осторожно. Хрупкость груза. Осторожное обращение с грузом.
	Предел по количеству ярусов в штабеле.
	Беречь от влаги.
	Открывать здесь
	Температурный диапазон
	Диапазон влажности
	Логотип ООО МЛТ


Автомат фиксации и окраски мазков крови – АФОМК-9-25
(транспортная маркировка, дополнительная наклейка)



Символ	Описание
	Беречь от влаги.
	Хрупкое. Осторожно. Хрупкость груза. Осторожное обращение с грузом.
	Предел по количеству ярусов в штабеле.
	Верх.

Автомата окраски препаратов на предметных стеклах АФОМК 9-25

Габаритные размеры и масса

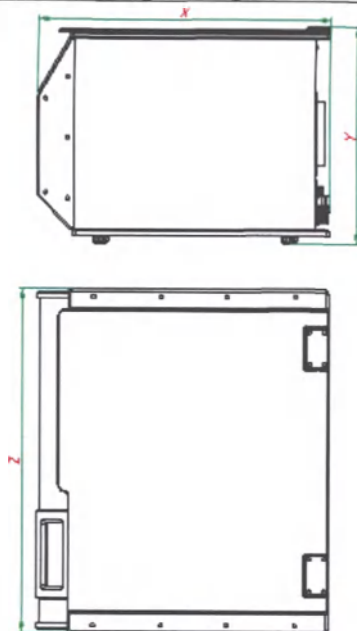

Габаритные
размеры не
более

X-460 мм
Y-330 мм
Z-530 мм

Масса не
более

18 кг

Заводская табличка

IVD Автомат окраски препаратов на предметных
стеклах по ТУ 26.60.12-006-23475651-2020

АФОМК-9-25

РУ № xxx xxxx/xxxx от XX xxxxxx XXXX г.

SN 530003 **REF** 26.60.12.007.9 **2019**

MLT ООО МЛТ,
141983, г. Дубна, ул. Программистов, д.4 к.3
+7 (495) 287 81 00, www.mlt.ru, mlt.llc@mail.ru

~220 В, 50 Гц, 300 ВА



Символ

Описание

SN

Серийный номер

REF

Номер по каталогу

IVD

Для in vitro диагностики



Дата изготовления



Изготовитель



Номинал предохранителя



Обратись к руководству по эксплуатации




Логотип ООО МЛТ

Маркировка упаковки автомата окраски препаратов на предметных стеклах
АФОМК 12-25 (транспортная маркировка)

MLT	Автомат окраски препаратов на предметном стекле АФОМК-12-25 ТУ 26.60.12-006-23475651-2020 Регистрационное удостоверение №XXX XXXX/XXXX	
	ООО МЛТ, 141983, г. Дубна, ул. Программистов, д.4 к.3	
		
		
	+50°C -40°C	
	80% 10%	
	26.60.12.007.12	 _____
Упаковщик _____		Дата упаковки _____
Количество мест / место _____		Штамп ОТК _____

Символ	Описание
	Серийный номер
	Номер по каталогу
	Для in vitro диагностики
	Дата изготовления
	Изготовитель
	Номинал предохранителя
	Обратись к руководству по эксплуатации
	Хрупкое. Осторожно. Хрупкость груза. Осторожное обращение с грузом.
	Предел по количеству ярусов в штабеле.
	Беречь от влаги.
	Открывать здесь
	Температурный диапазон
	Диапазон влажности
	Логотип ООО МЛТ


Автомат фиксации и окраски мазков крови – АФОМК-12-25
(транспортная маркировка, дополнительная наклейка)

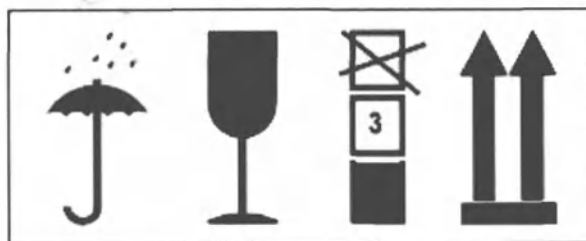

Символ	Описание
	Беречь от влаги.
	Хрупкое. Осторожно. Хрупкость груза. Осторожное обращение с грузом.
	Предел по количеству ярусов в штабеле.
	Верх.

Автомат фиксации и окраски мазков крови – АФОМК-12-25

Габаритные размеры и масса

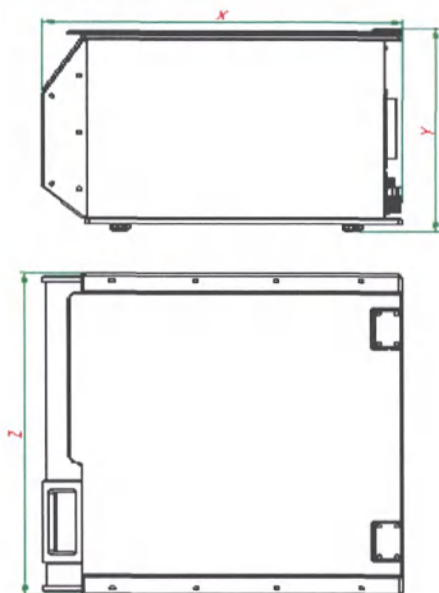

Габаритные
размеры не
более

X-580 мм
Y-330 мм
Z-530 мм

Масса не
более

22 кг

Заводская табличка

IVD Автомат окраски препаратов на предметных
стеклах по ТУ 26.60.12-006-23475651-2020

АФОМК-12-25

ПУ № xxx xxxx/xxxx от XX xxxxxx XXXX г.

SN 530003 **REF** 26.60.12.007.12 **2019**

MLT ООО МЛТ,
141983, г. Дубна, ул. Программистов, д.4 к.3
+7 (495) 287 81 00, www.mlt.ru, mlt.llc@mail.ru

~220 В, 50 Гц, 300 ВА



Символ

Описание

SN

Серийный номер

REF

Номер по каталогу

IVD

Для in vitro диагностики



Дата изготовления



Изготовитель



10 А

Номинал предохранителя




Обратись к руководству по эксплуатации



Логотип ООО МЛТ

Штатив для предметных стёкол ШВ-25

Общий вид

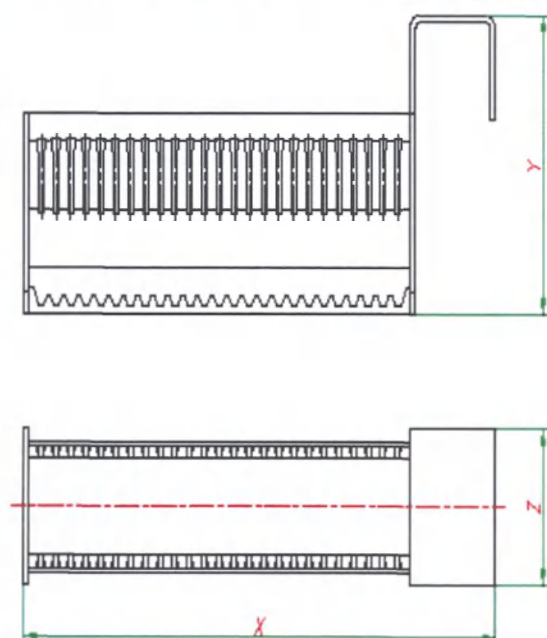

Маркировка



ШТАТИВ ДЛЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ ШВ-25

МЛБА.06.01.00

ТУ 26.60.12-006-23475651-2020

Рег. удостоверение №

REF 06.01.00

 28.06.2019

 2

LOT

 **ООО МЛТ**
141983, Московская обл., г. Дубна
ул. Программистов, д. 4, стр. 3
тел.: 8 (495) 287-81-00
E-mail: 2878100@mail.ru

Габаритные размеры и масса


Габаритные размеры не более	X-127 мм Y-68 мм Z-34мм
Масса не более	110 г

Маркировка

Символ	Описание
	Номер в каталоге
	Дата изготовления
	Код серии
	Количество изделий
	Изготовитель
	Логотип ООО МЛТ

Вкладыш для предметных стекол

Общий вид

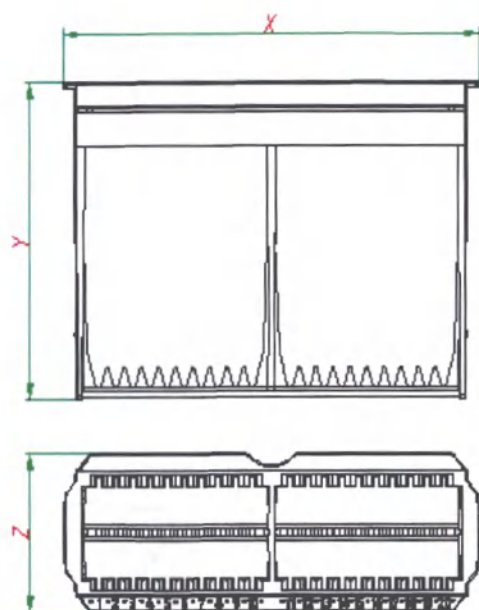

Маркировка



**ВКЛАДЫШ
ДЛЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ**
МЛБА.07.00.02

ТУ 26.60.12-006-23475651-2020

Рег. удостоверение №

REF 07.00.02

28.06.2019

Σ 2

LOT

ООО МЛТ
141983, Московская обл., г. Дубна
ул. Программистов, д. 4, стр. 3
тел.: 8 (495) 287-81-00
E-mail: 2878100@mail.ru

Габаритные размеры и масса

Габаритные
размеры не
более

X-110 мм
Y-75мм
Z-40мм

Масса не
более

40 г

Маркировка

Символ

Описание

REF

Номер в каталоге

28.06.2019

Дата изготовления

LOT

Код серии

Σ

Количество изделий

Изготовитель


Изготовитель

MLT

Логотип ООО МЛТ

Штатив для вкладыша

Общий вид

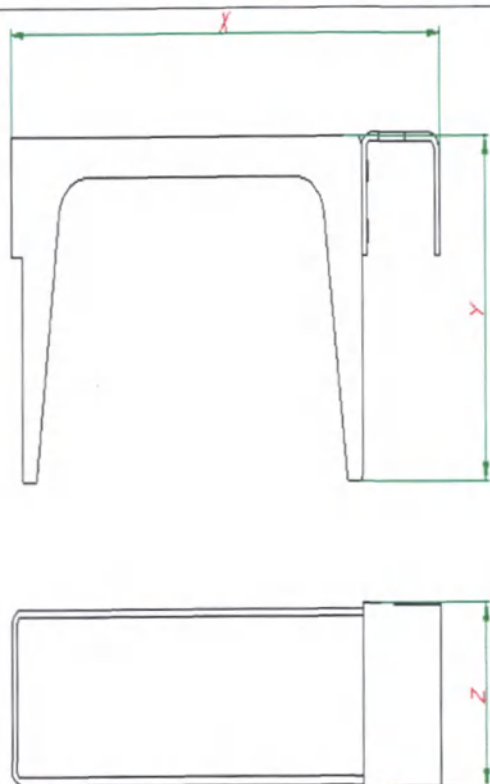

Маркировка



ШТАТИВ ДЛЯ ВКЛАДЫША

МЛБА.07.01.00

ТУ 26.60.12-006-23475651-2020

Рег. удостоверение №

REF 07.01.00

 28.06.2019

 2

LOT

 **ООО МЛТ**
141983, Московская обл., г. Дубна
ул. Программистов, д. 4, стр. 3
тел.: 8 (495) 287-81-00
E-mail: 2878100@mail.ru

Габаритные размеры и масса

Габаритные
размеры не
более
X-127 мм
Y-68 мм
Z-34мм

Масса не
более
110 г

Маркировка

Символ

Описание

REF

Номер в каталоге



Дата изготовления

LOT

Код серии



Количество изделий




Изготовитель



Логотип ООО МЛТ

Блоттер

Общий вид

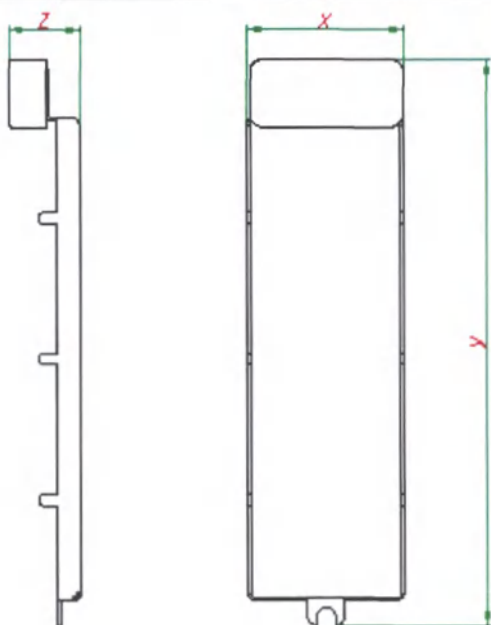

Маркировка



БЛОТТЕР

МЛБА.07.00.01

ТУ 26.60.12-006-23475651-2020

Рег. удостоверение №

REF 07.00.01

 28.06.2019

 1

LOT

 **ООО МЛТ**
141983, Московская обл., г. Дубна
ул. Программистов, д. 4, стр. 3
тел.: 8 (495) 287-81-00
E-mail: 2878100@mail.ru

Габаритные размеры и масса


Габаритные размеры не более	X-128 мм Y-45 мм Z-25 мм
Масса не более	60 г

Маркировка

Символ	Описание
REF	Номер в каталоге
	Дата изготовления
LOT	Код серии
	Количество изделий
	Изготовитель
MLT	Логотип ООО МЛТ

Ванна для реагентов ВВ-25 ПОМ с крышкой

Общий вид

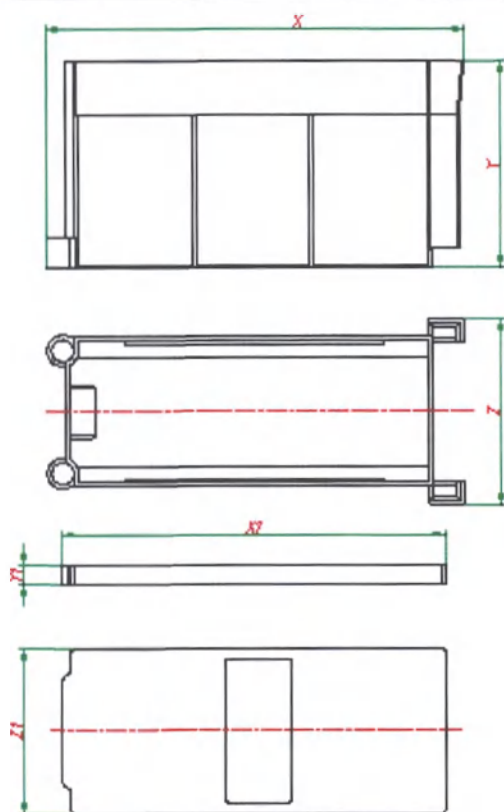

Маркировка



ВАННА ДЛЯ РЕАГЕНТОВ ВВ-25 ПОМ С КРЫШКОЙ

МЛБА.06.06.00-01

ТУ 26.60.12-006-23475651-2020

Рег. удостоверение №

REF 06.06.00-01

 28.06.2019

 10

LOT

 **ООО МЛТ**
141983, Московская обл., г. Дубна
ул. Программистов, д. 4, стр. 3
тел.: 8 (495) 287-81-00
E-mail: 2878100@mail.ru

Габаритные размеры и масса


Габаритные размеры не более	X-140 мм
	Y-75 мм
	Z-65 мм
	X1-126 мм
	Y2-7 мм
	Z3-55 мм
Масса не более	60 г

Маркировка

Символ	Описание
REF	Номер в каталоге
	Дата изготовления
LOT	Код серии
	Количество изделий
	Изготовитель
MLT	Логотип ООО МЛТ

Ванна для реагентов ВВ-25 ПП с крышкой

Общий вид

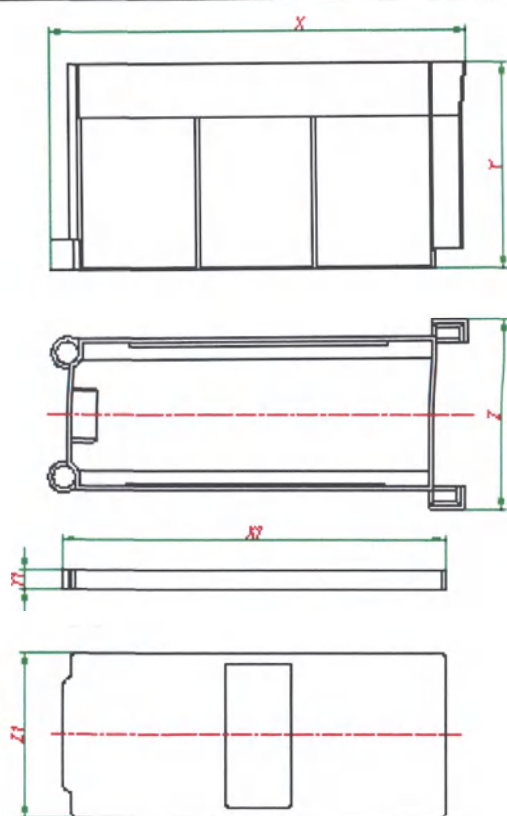

Маркировка



ВАННА ДЛЯ РЕАГЕНТОВ ВВ-25 ПП С КРЫШКОЙ

МЛБА.06.06.00

ТУ 26.60.12-006-23475651-2020

Рег. удостоверение №

REF 06.06.00

 28.06.2019

 10

LOT

 **ООО МЛТ**
141983, Московская обл., г. Дубна
ул. Программистов, д. 4, стр. 3
тел.: 8 (495) 287-81-00
E-mail: 2878100@mail.ru

Габаритные размеры и масса

Габаритные
размеры не
более

X-140 мм
Y-75 мм
Z-65 мм
X1-126 мм
Y2-7 мм
Z3-55 мм

Масса не
более


60 г

Маркировка

Символ	Описание
REF	Номер в каталоге
	Дата изготовления
LOT	Код серии
	Количество изделий
	Изготовитель
MLT	Логотип ООО МЛТ

Комплект сантехнический для подключения к водопроводу

Общий вид

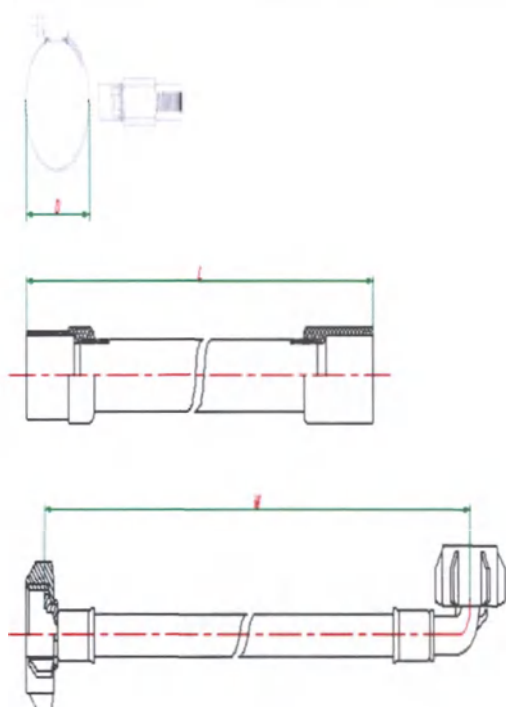

Маркировка



**КОМПЛЕКТ САНТЕХНИЧЕСКИЙ
ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
К ВОДОПРОВОДУ**

МЛБА.05.70.00

ТУ 26.60.12-006-23475651-2020

Рег. удостоверение №

REF 05.70.00

28.06.2019

1

LOT

ООО МЛТ
141983, Московская обл., г. Дубна
ул. Программистов, д. 4, стр. 3
тел.: 8 (495) 287-81-00
E-mail: 2878100@mail.ru


Габаритные размеры и масса

Габаритные размеры не более	D- Ø 20-32 мм L-1500 мм M-1500 мм
Масса не более	250 г

Маркировка

Символ	Описание
REF	Номер в каталоге
	Дата изготовления
LOT	Код серии
	Количество изделий
	Изготовитель
MLT	Логотип ООО МЛТ

Комплект для подключения к вентиляции

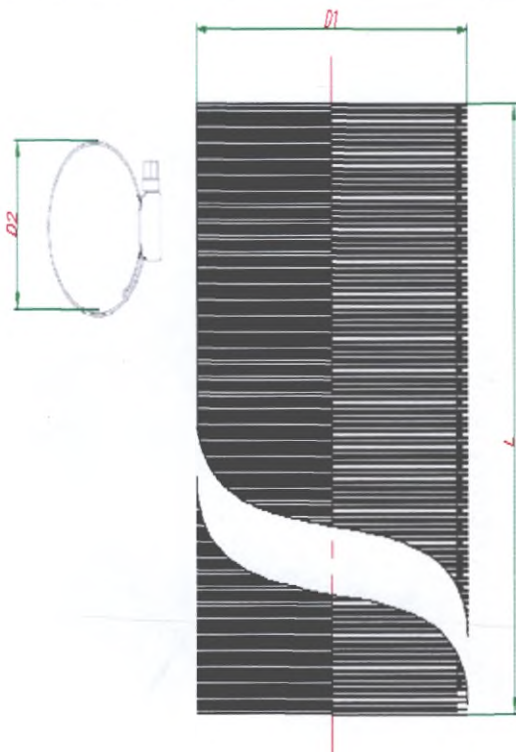Общий вид	Маркировка
	 КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ МЛБА.05.10.00 ТУ 26.60.12-006-23475651-2020 Рег. удостоверение № REF 05.10.00  28.06.2019  1 LOT  ООО МЛТ 141983, Московская обл., г. Дубна ул. Программистов, д. 4, стр. 3 тел.: 8 (495) 287-81-00 E-mail: 2878100@mail.ru

Габаритные размеры и масса

Габаритные размеры не более	L-400÷1000мм D1- Ø100 мм D2- Ø 90÷110 мм
Масса не более	350 г

Маркировка

Символ	Описание
REF	Номер в каталоге
	Дата изготовления
LOT	Код серии
	Количество изделий
	Изготовитель
MLT	Логотип ООО МЛТ

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 15

(Мутная бумага) листов

Генеральный директор
ООО МЛТ

 А.В. Безруков





Общество с ограниченной ответственностью МЛТ



«ПРЕДТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО МЛТ

А.В. Безруков

20 20 г.

Образцы маркировки медицинского изделия
«Автомат окраски и фиксации на предметных стеклах цитологических
препаратов и мазков крови по ТУ 26.60.12-006-23475651-2020 в следующих
исполнениях: АФОМК-9-25, АФОМК-12-25 в составе»

Маркировка упаковки автомата окраски и фиксации на предметных стеклах препаратов и мазков крови АФОМК-9-25 (транспортная маркировка)



Автомат окраски и фиксации на предметных стеклах препаратов и мазков крови
АФОМК-9-25
 ТУ 26.60.12-006-23475651-2020
 Регистрационное удостоверение РЗН XXXX/XXXXXX от XX.XX.20XX

 ООО МЛТ, 141983, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4 к. 3














REF 26.60.12.007.9 SN _____

Упаковщик _____ Дата упаковки _____

Количество мест / место _____ Штамп ОТК _____

Символ	Описание
	Серийный номер
	Номер по каталогу
	Для in vitro диагностики
	Дата изготовления
	Изготовитель
	Номинал предохранителя
	Обратись к руководству по эксплуатации
	Хрупкое. Осторожно. Хрупкость груза. Осторожное обращение с грузом.
	Предел по количеству ярусов в штабеле.
	Беречь от влаги.
	Температурный диапазон
	Диапазон влажности
	Логотип ООО МЛТ


Автомат фиксации и окраски мазков крови – АФОМК-9-25
 (транспортная маркировка, дополнительная наклейка)

Автомат фиксации и окраски мазков крови – АФОМК-9-25
(транспортная маркировка, дополнительная наклейка)



Символ	Описание
	Беречь от влаги.
	Хрупкое. Осторожно. Хрупкость груза. Осторожное обращение с грузом.
	Предел по количеству ярусов в штабеле.
	Верх.

**Маркировка упаковки автомата окраски и фиксации на предметных стеклах препаратов
и мазков крови АФОМК 9-25**

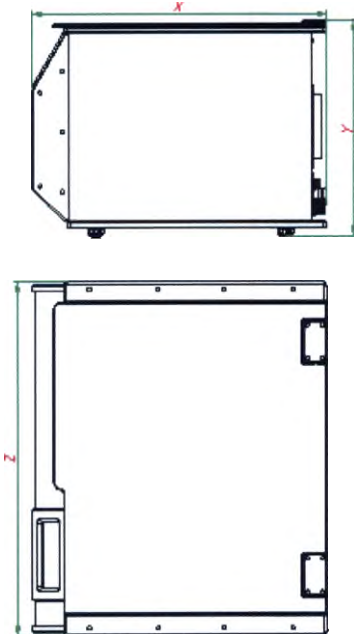Габаритные размеры и масса	
	
Габаритные размеры не более	X-460 мм Y-330 мм Z-530 мм
Масса не более	18 кг
Заводская табличка	
 Автомат окраски АФОМК-9-25 РУ № XXXXX/XXXX от XX XX 20XX  530003  26.60.12.007.9  2019  ООО МЛТ, 141983, г. Дубна, ул. Программистов, д.4 к.3 +7 (495) 287 81 00, www.mlt.ru, mlt.ltc@mail.ru ~220 В, 50 Гц, 300 ВА    	
Символ	Описание
	Серийный номер
	Номер по каталогу
	Для in vitro диагностики
	Дата изготовления
	Изготовитель
	Номинал предохранителя
	Обратись к руководству по эксплуатации
	Логотип ООО МЛТ

Маркировка упаковки автомата окраски и фиксации на предметных стеклах препаратов и мазков крови АФОМК 12-25 (транспортная маркировка)



Автомат окраски и фиксации на предметных стеклах препаратов и мазков крови
АФОМК-12-25
 ТУ 26.60.12-006-23475651-2020
 Регистрационное удостоверение РЗН ХХХХ/ХХХХХХ от ХХ.ХХ.20ХХ


 ООО МЛТ, 141983, г. Дубна, ул. Программистов, д.4 к.3



 **26.60.12.007.12**








 _____
 Упаковщик _____
 Количество мест / место _____

 Дата упаковки _____
 Штамп ОТК _____

Символ	Описание
	Серийный номер
	Номер по каталогу
	Для in vitro диагностики
	Дата изготовления
	Изготовитель
	Номинал предохранителя
	Обратись к руководству по эксплуатации
	Хрупкое. Осторожно. Хрупкость груза. Осторожное обращение с грузом.
	Предел по количеству ярусов в штабеле.
	Беречь от влаги.
	Температурный диапазон
	Диапазон влажности
	Логотип ООО МЛТ

Маркировка упаковки автомата окраски и фиксации на предметных стеклах препаратов и мазков крови АФОМК 12-25 (транспортная маркировка, дополнительная наклейка)


Маркировка упаковки автомата окраски и фиксации на предметных стеклах препаратов и мазков крови АФОМК 12-25 (транспортная маркировка, дополнительная наклейка)



Символ	Описание
	Беречь от влаги.
	Хрупкое. Осторожно. Хрупкость груза. Осторожное обращение с грузом.
	Предел по количеству ярусов в штабеле.
	Верх.

АФОМК 12-25

Габаритные размеры и масса

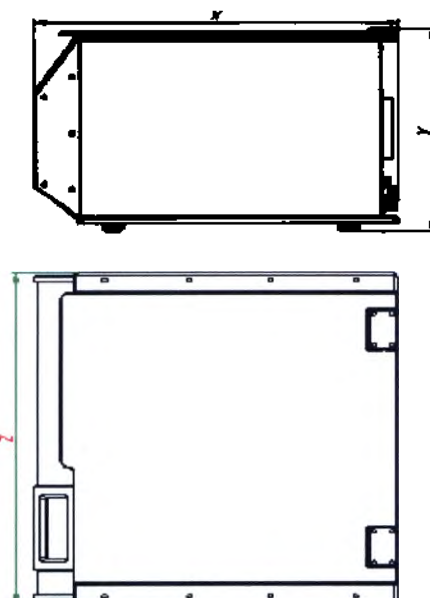

Габаритные
размеры не
более

X-580 мм
Y-330 мм
Z-530 мм

Масса не
более

22 кг

Заводская табличка

IVD Автомат окраски АФОМК-12-25

РУ № XXXXX/XXXX от XX XX 20XX

SN 540003 **REF** 26.60.12.007.12 **W** 2019

MLT ООО МЛТ,
141983, г. Дубна, ул. Программистов, д.4 к.3
+7 (495) 287 81 00, www.mlt.ru, mlt.lc@mail.ru

~220 В, 50 Гц, 300 ВА    

Символ

Описание

SN

Серийный номер

REF

Номер по каталогу

IVD

Для in vitro диагностики



Дата изготовления



Изготовитель



Номинал предохранителя




Обратись к руководству по эксплуатации

MLT

Логотип ООО МЛТ

Штатив для предметных стёкол ШВ-25

Общий вид

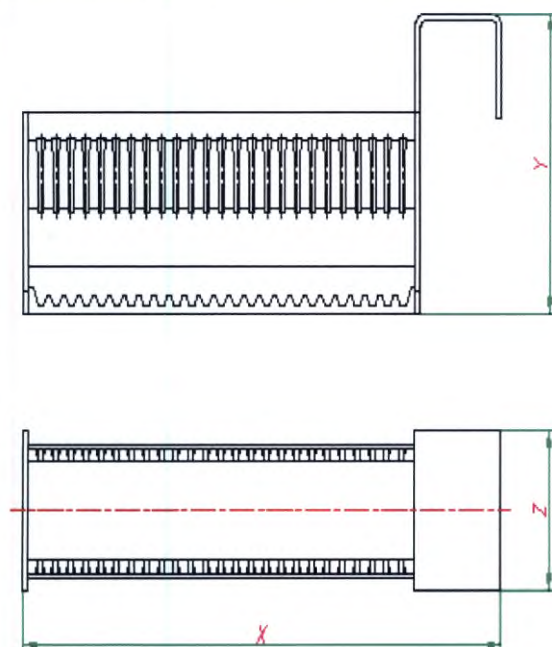

Маркировка



ШТАТИВ ДЛЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ ШВ-25

МЛБА.06.01.00

ТУ 26.60.12-006-23475651-2020

Рег. удостоверение №

REF 06.01.00

28.06.2019

2

LOT

ООО МЛТ
141983, Московская обл., г. Дубна
ул. Программистов, д. 4, стр. 3
тел.: 8 (495) 287-81-00
E-mail: 2878100@mail.ru

Габаритные размеры и масса

Габаритные
размеры не
более

X-127 мм
Y-68 мм
Z-34мм

Масса не
более

110 г

Маркировка

Символ

Описание

REF

Номер в каталоге



Дата изготовления

LOT

Код серии



Количество изделий




Изготовитель



Логотип ООО МЛТ

Вкладыш для предметных стекол

Общий вид

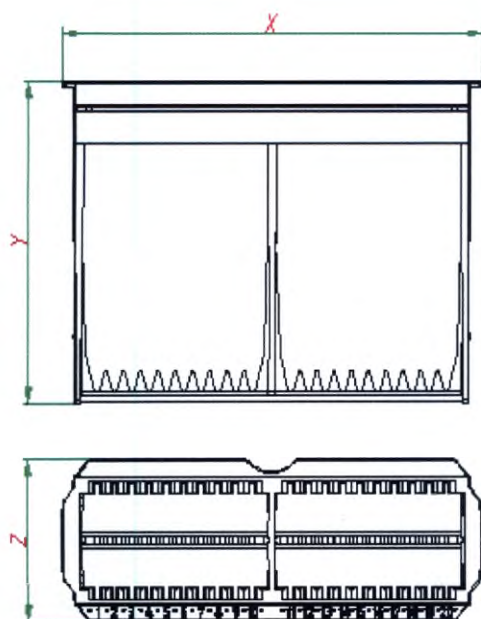

Маркировка



**ВКЛАДЫШ
ДЛЯ ПРЕДМЕТНЫХ СТЕКОЛ**

МЛБА.07.00.02

ТУ 26.60.12-006-23475651-2020

Рег. удостоверение №

REF 07.00.02

28.06.2019

2

LOT

ООО МЛТ
141983, Московская обл., г. Дубна
ул. Программистов, д. 4, стр. 3
тел.: 8 (495) 287-81-00
E-mail: 2878100@mail.ru

Габаритные размеры и масса

Габаритные
размеры не
более

X-110 мм
Y-75мм
Z-40мм

Масса не
более

40 г

Маркировка

Символ

Описание

REF

Номер в каталоге



Дата изготовления

LOT

Код серии




Количество изделий




Изготовитель



Логотип ООО МЛТ

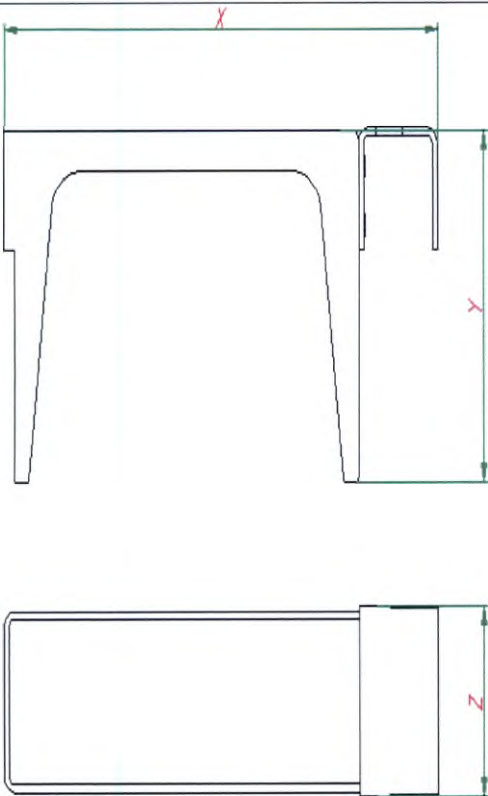
Штатив для вкладыша	
Общий вид	Маркировка
	 ШТАТИВ ДЛЯ ВКЛАДЫША МЛБА.07.01.00 ТУ 26.60.12-006-23475651-2020 Рег. удостоверение №  07.01.00  28.06.2019  2  LOT  ООО МЛТ 141983, Московская обл., г. Дубна ул. Программистов, д. 4, стр. 3 тел.: 8 (495) 287-81-00 E-mail: 2878100@mail.ru
Габаритные размеры и масса	
Габаритные размеры не более	X-127 мм Y-68 мм Z-34мм
Масса не более	110 г
Маркировка	
Символ	Описание
	Номер в каталоге
	Дата изготовления
	Код серии
	Количество изделий
	Изготовитель
	Логотип ООО МЛТ

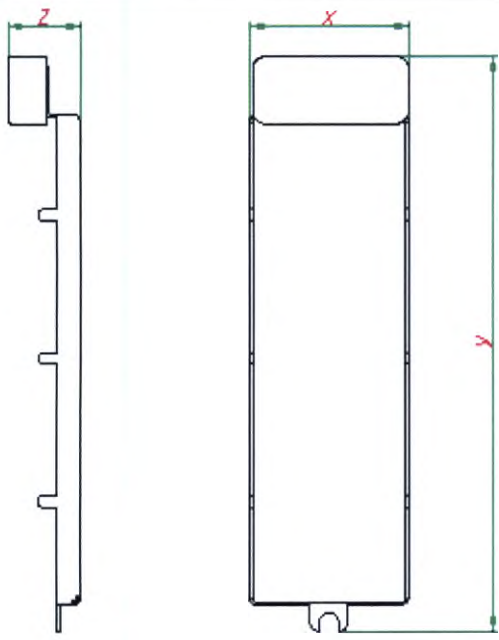Блоттер	
Общий вид	Маркировка
	 БЛОТТЕР МЛБА.07.00.01 ТУ 26.60.12-006-23475651-2020 Рег. удостоверение № REF 07.00.01  28.06.2019  1 LOT  ООО МЛТ 141983, Московская обл., г. Дубна ул. Программистов, д. 4, стр. 3 тел.: 8 (495) 287-81-00 E-mail: 2878100@mail.ru

Габаритные размеры и масса	
Габаритные размеры не более	X-128 мм Y-45 мм Z-25 мм
Масса не более	60 г
Маркировка	
Символ	Описание
	Номер в каталоге
	Дата изготовления
	Код серии
	Количество изделий
	Изготовитель
	Логотип ООО МЛТ

Ванна для реагентов ВВ-25 ПОМ с крышкой

Общий вид

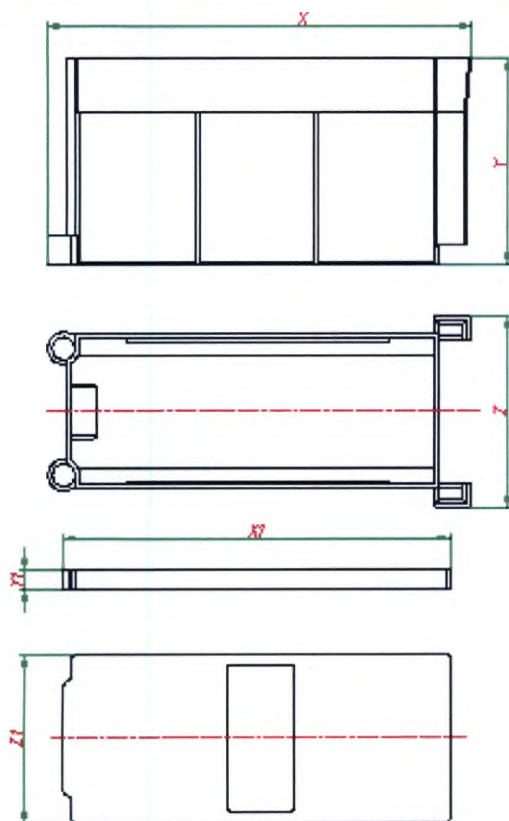

Маркировка



ВАННА ДЛЯ РЕАГЕНТОВ ВВ-25 ПОМ С КРЫШКОЙ

МЛБА.06.06.00-01

ТУ 26.60.12-006-23475651-2020

Рег. удостоверение №

REF 06.06.00-01

 28.06.2019

 10

LOT

 **ООО МЛТ**
141983, Московская обл., г. Дубна
ул. Программистов, д. 4, стр. 3
тел.: 8 (495) 287-81-00
E-mail: 2878100@mail.ru

Габаритные размеры и масса

Габаритные
размеры не
более

X-140 мм
Y-75 мм
Z-65 мм
X1-126 мм
Y2-7 мм
Z3-55 мм

Масса не
более

60 г

Маркировка

Символ

Описание

REF

Номер в каталоге



Дата изготовления

LOT

Код серии



Количество изделий




Изготовитель



Логотип ООО МЛТ

Ванна для реагентов ВВ-25 ПП с крышкой

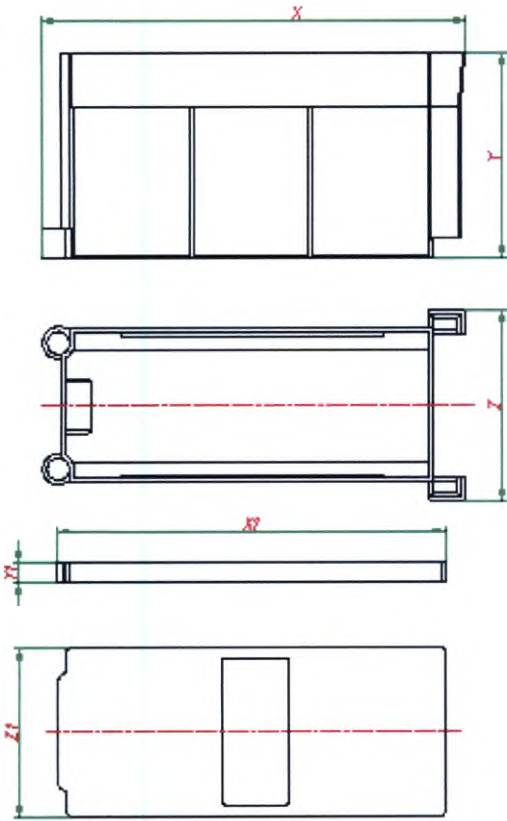Общий вид	Маркировка
	 ВАННА ДЛЯ РЕАГЕНТОВ ВВ-25 ПП С КРЫШКОЙ МЛБА.06.06.00 ТУ 26.60.12-006-23475651-2020 Рег. удостоверение № REF 06.06.00  28.06.2019  10 LOT  ООО МЛТ 141983, Московская обл., г. Дубна ул. Программистов, д. 4, стр. 3 тел.: 8 (495) 287-81-00 E-mail: 2878100@mail.ru

Габаритные размеры и масса


Габаритные размеры не более	X-140 мм Y-75 мм Z-65 мм X1-126 мм Y2-7 мм Z3-55 мм
Масса не более	60 г

Маркировка

Символ	Описание
REF	Номер в каталоге
	Дата изготовления
LOT	Код серии
	Количество изделий
	Изготовитель
MLT	Логотип ООО МЛТ

Комплект сантехнический для подключения к водопроводу

Общий вид

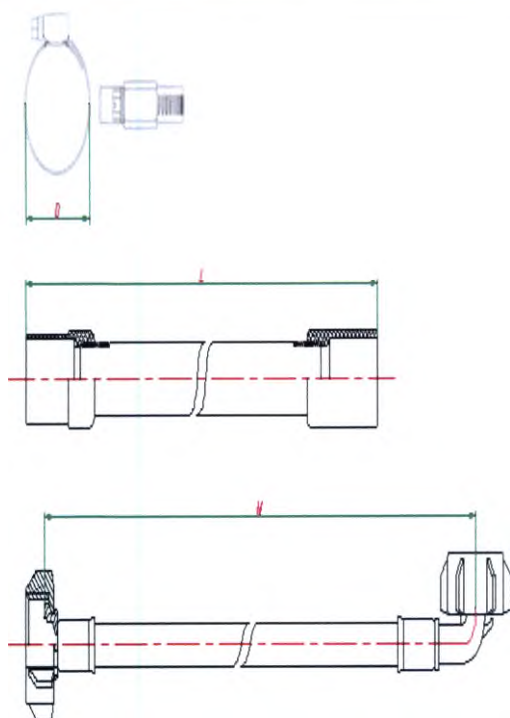

Маркировка



КОМПЛЕКТ САНТЕХНИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВОДОПРОВОДУ

МЛБА.05.70.00

ТУ 26.60.12-006-23475651-2020

Рег. удостоверение №

REF 05.70.00

28.06.2019

1

LOT



ООО МЛТ

141983, Московская обл., г. Дубна

ул. Программистов, д. 4, стр. 3

тел.: 8 (495) 287-81-00

E-mail: 2878100@mail.ru

Габаритные размеры и масса

Габаритные
размеры не
более

D- Ø 20-32 мм

L-1500 мм

M-1500 мм

Масса не
более

250 г

Маркировка

Символ

Описание

REF

Номер в каталоге



Дата изготовления

LOT

Код серии



Количество изделий




Изготовитель



Логотип ООО МЛТ

Комплект для подключения к вентиляции

Общий вид

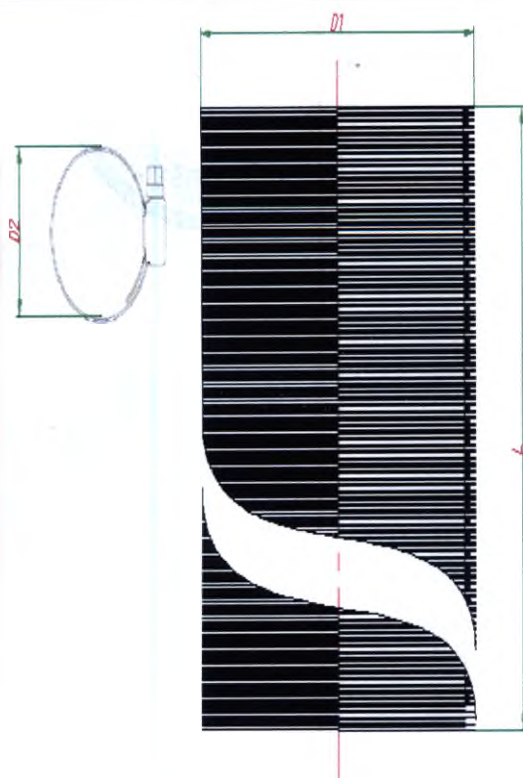

Маркировка



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ

МЛБА.05.10.00

ТУ 26.60.12-006-23475651-2020

Рег. удостоверение №



05.10.00



28.06.2019



1



ООО МЛТ

141983, Московская обл., г. Дубна
ул. Программистов, д. 4, стр. 3
тел.: 8 (495) 287-81-00
E-mail: 2878100@mail.ru

Габаритные размеры и масса

Габаритные
размеры не
более
L-400÷1000мм
D1- Ø100 мм
D2- Ø 90÷110 мм

Масса не
более
350 г

Маркировка

Символ

Описание



Номер в каталоге



Дата изготовления



Код серии



Количество изделий



Изготовитель



Логотип ООО МЛТ

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 11
(20.10.2020) листов



Генеральный директор
ООО МПТ

А.В. Безруков




Общество с ограниченной ответственностью МЛТ

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО МЛТ

А.В. Безруков

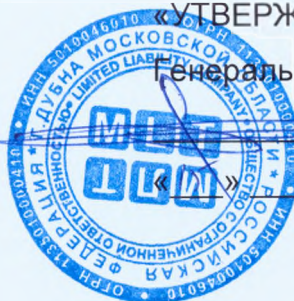

10

20 20 г.

Фотографические изображения медицинского изделия
«Автомат окраски и фиксации на предметных стеклах цитологических
препаратов и мазков крови по ТУ 26.60.12-006-23475651-2020 в следующих
исполнениях: АФОМК-9-25, АФОМК-12-25 в составе»



Автомат окраски и фиксации на предметных стеклах цитологических препаратов и мазков крови по ТУ 26.60.12-006-23475651-2020 в исполнении АФОМК-12-25 в составе

IVD Автомат окраски **АФОМК-12-25**

РУ № XXXXX/XXXX от XX XX 20XX

SN 540003 **REF** 26.60.12.007.12  2019




ООО МЛТ,

141983, г. Дубна, ул. Программистов, д.4 к.3

+7 (495) 287 81 00, www.mlt.ru, mlt.llc@mail.ru

~220 В, 50 Гц, 300 ВА



Автомат окраски и фиксации на предметных стеклах цитологических препаратов и мазков крови по ТУ 26.60.12-006-23475651-2020 в исполнении АФОМК-12-25 (маркировка)



Автомат окраски и фиксации на предметных стеклах цитологических препаратов и мазков крови по ТУ 26.60.12-006-23475651-2020 в исполнении АФОМК-9-25



Автомат окраски АФОМК-9-25

РУ № XXXXX/XXXX от XX XX 20XX



530003



26.60.12.007.9



2019




ООО МЛТ,

141983, г. Дубна, ул. Программистов, д.4 к.3

+7 (495) 287 81 00, www.mlt.ru, mlt.llc@mail.ru


~220 В, 50 Гц, 300 ВА



Автомат окраски и фиксации на предметных стеклах цитологических препаратов и мазков крови по ТУ 26.60.12-006-23475651-2020 в исполнении АФОМК-9-25 (маркировка)



Штатив для предметных стекол-ШВ-25

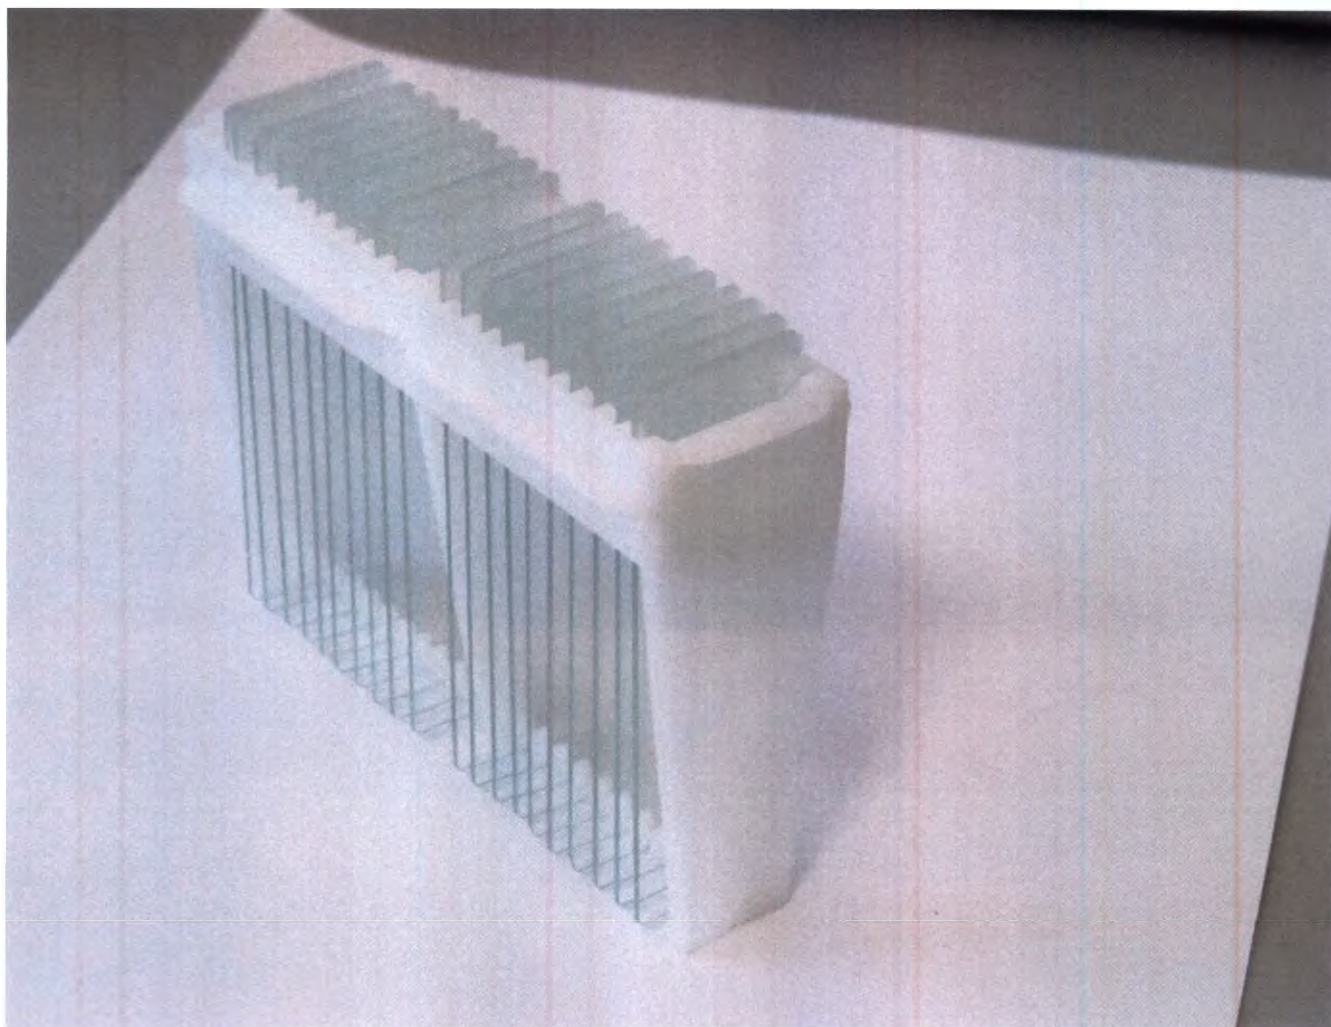


Вкладыш для предметных стекол




Штатив для вкладыша



Блоттер

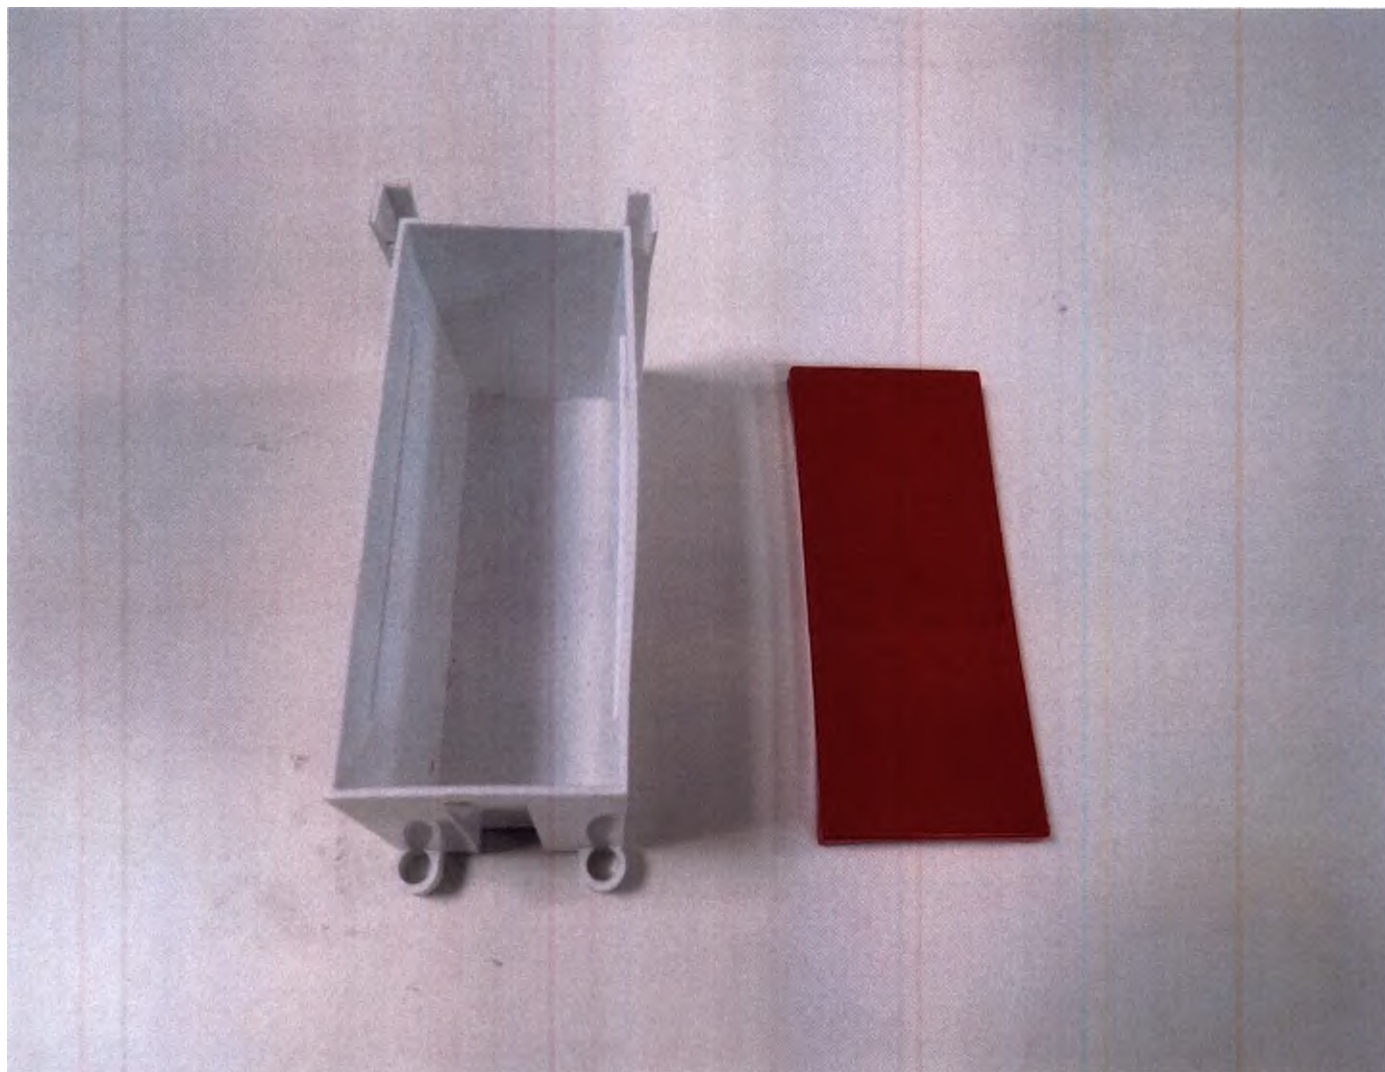


Ванна для реагентов ВВ-25 ПП с крышкой

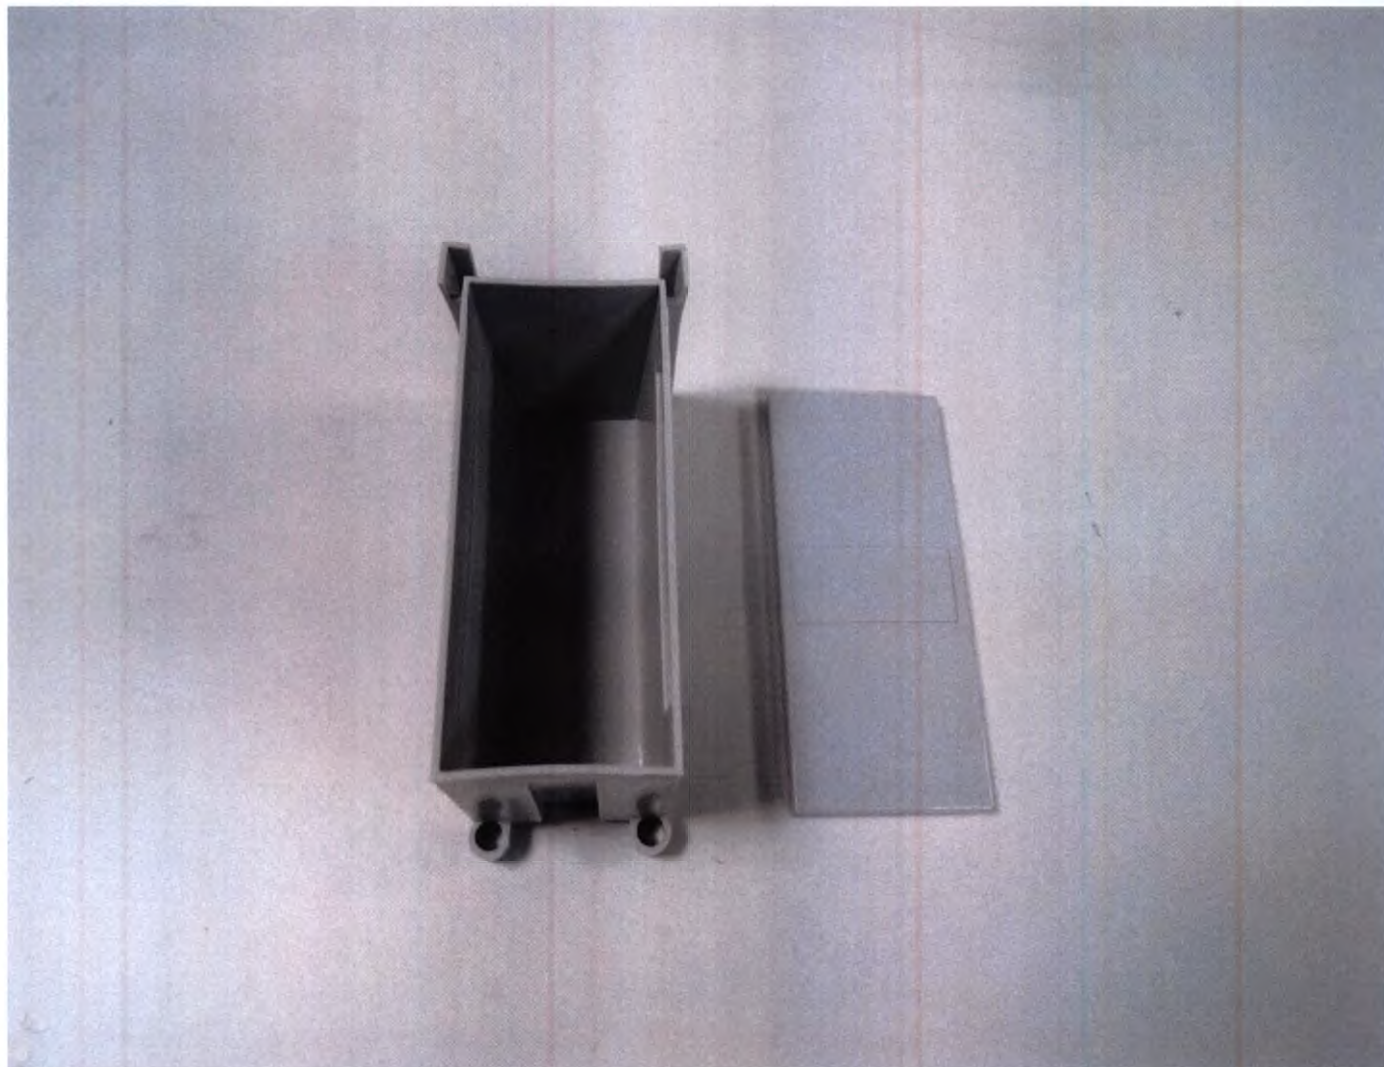

Ванна для реагентов ВВ-25 ПОМ с крышкой



Комплект сантехнический для подключения к водопроводу

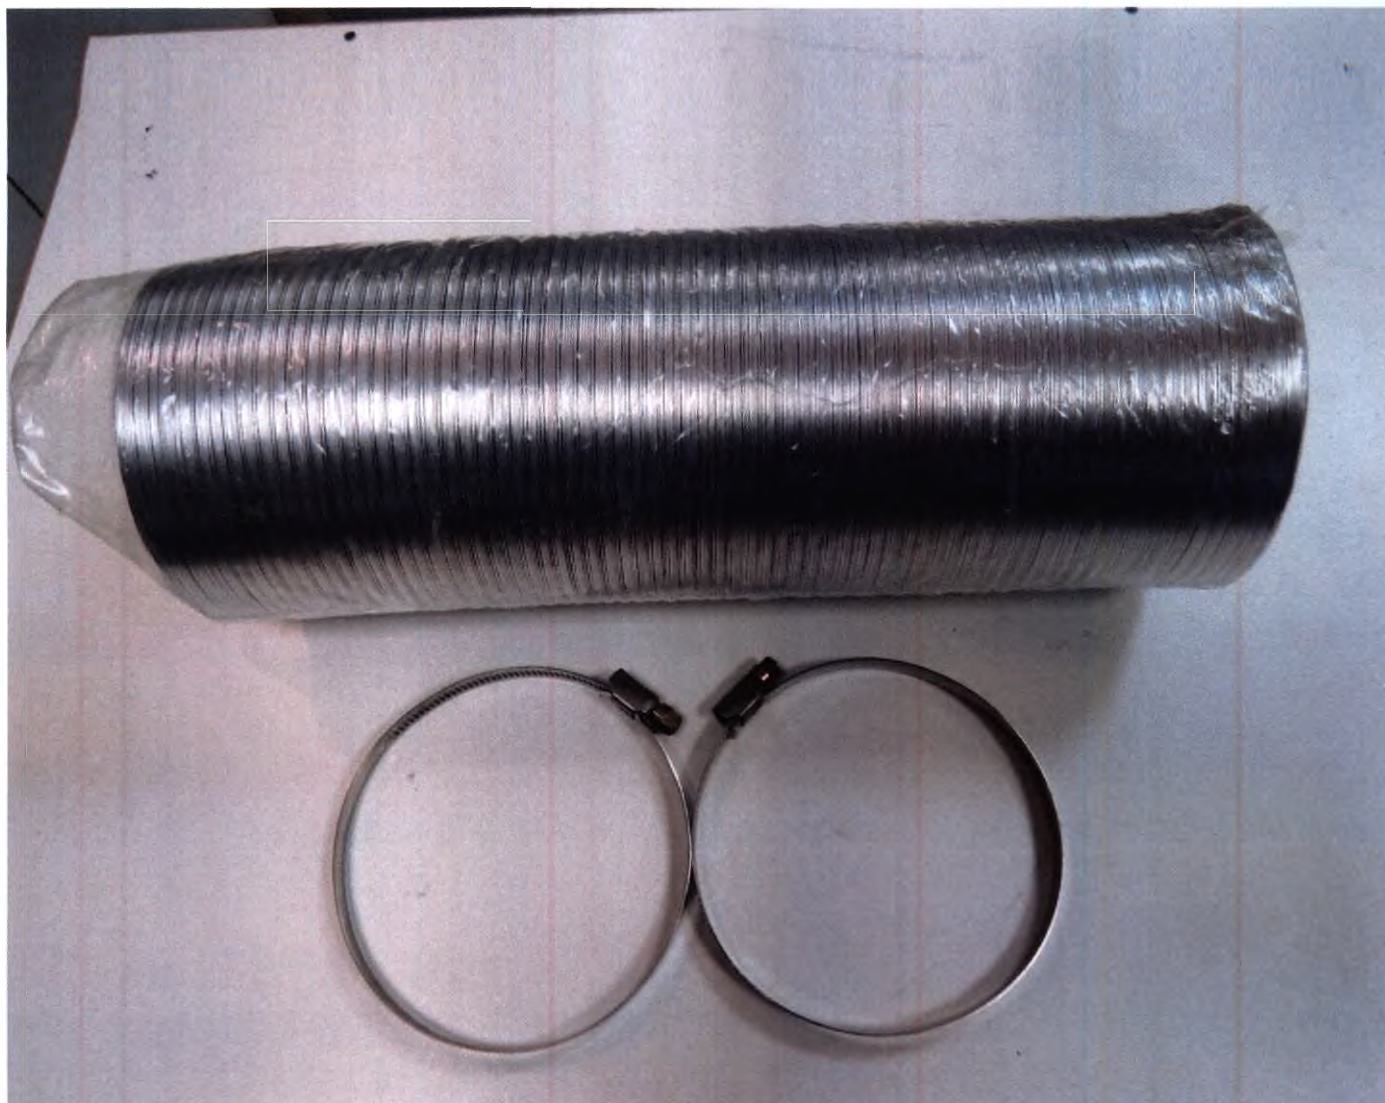


Комплект для подключения к вентиляции




Сетевой кабель питания

Пример окрашивания образцов мазков крови по Романовскому на автомате АФОМК-9-25 по методике окраски Л5-Г10, поставляемой с АФОМК-9-25 и АФОМК-12-25.

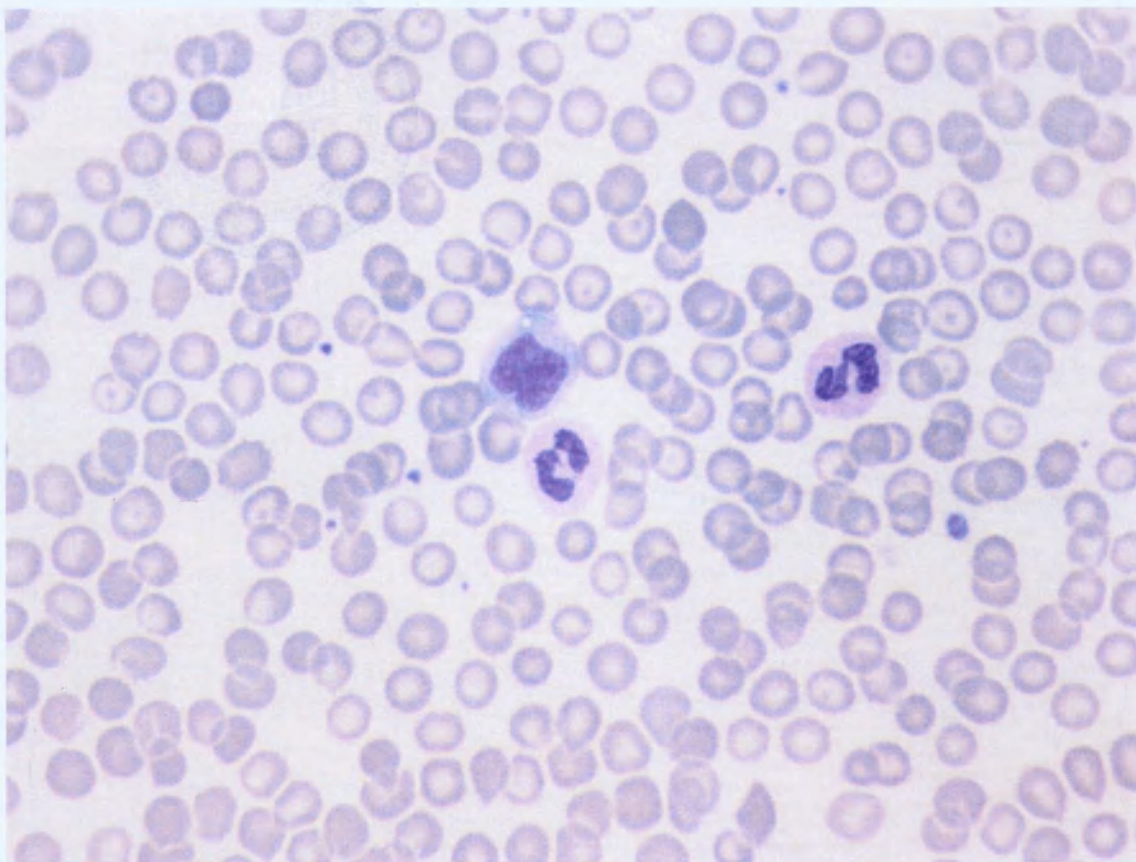

Пример окрашивания образцов цитологических препаратов по Папаниколау на автомате АФОМК-12-25 по методике окраски ПАП ДИФ, поставляемой с АФОМК-12-25.

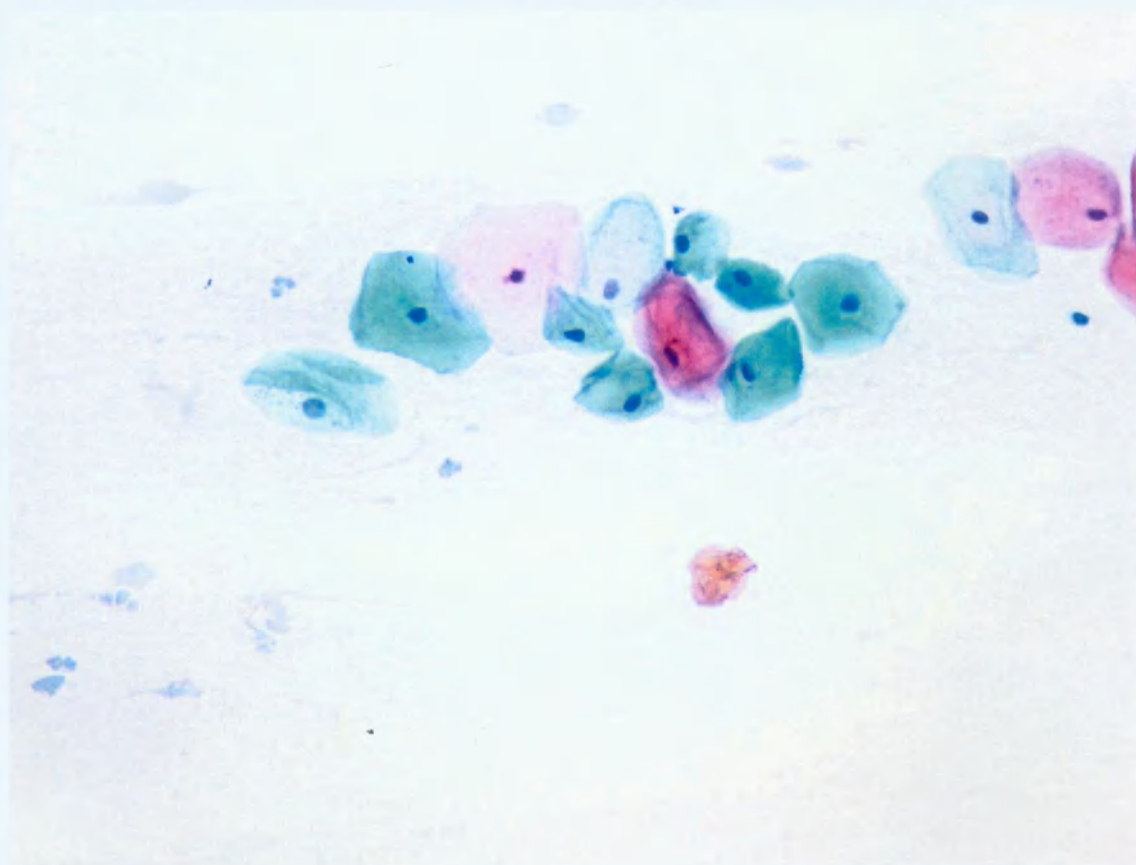

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 15
(Мониторинг) листов

Генеральный директор
ООО ЦПМИ
_____ А.В. Безруков

