


Фотографические изображения общего вида

«Набор реагентов для качественного выявления ДНК *Chlamydia trachomatis* методом ПЦР in vitro в препаратах нуклеиновых кислот, полученных из клинических образцов в режиме реального времени «Хламидия-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-116-41390295-2021»

Комплект 1:

ПЦР-смесь

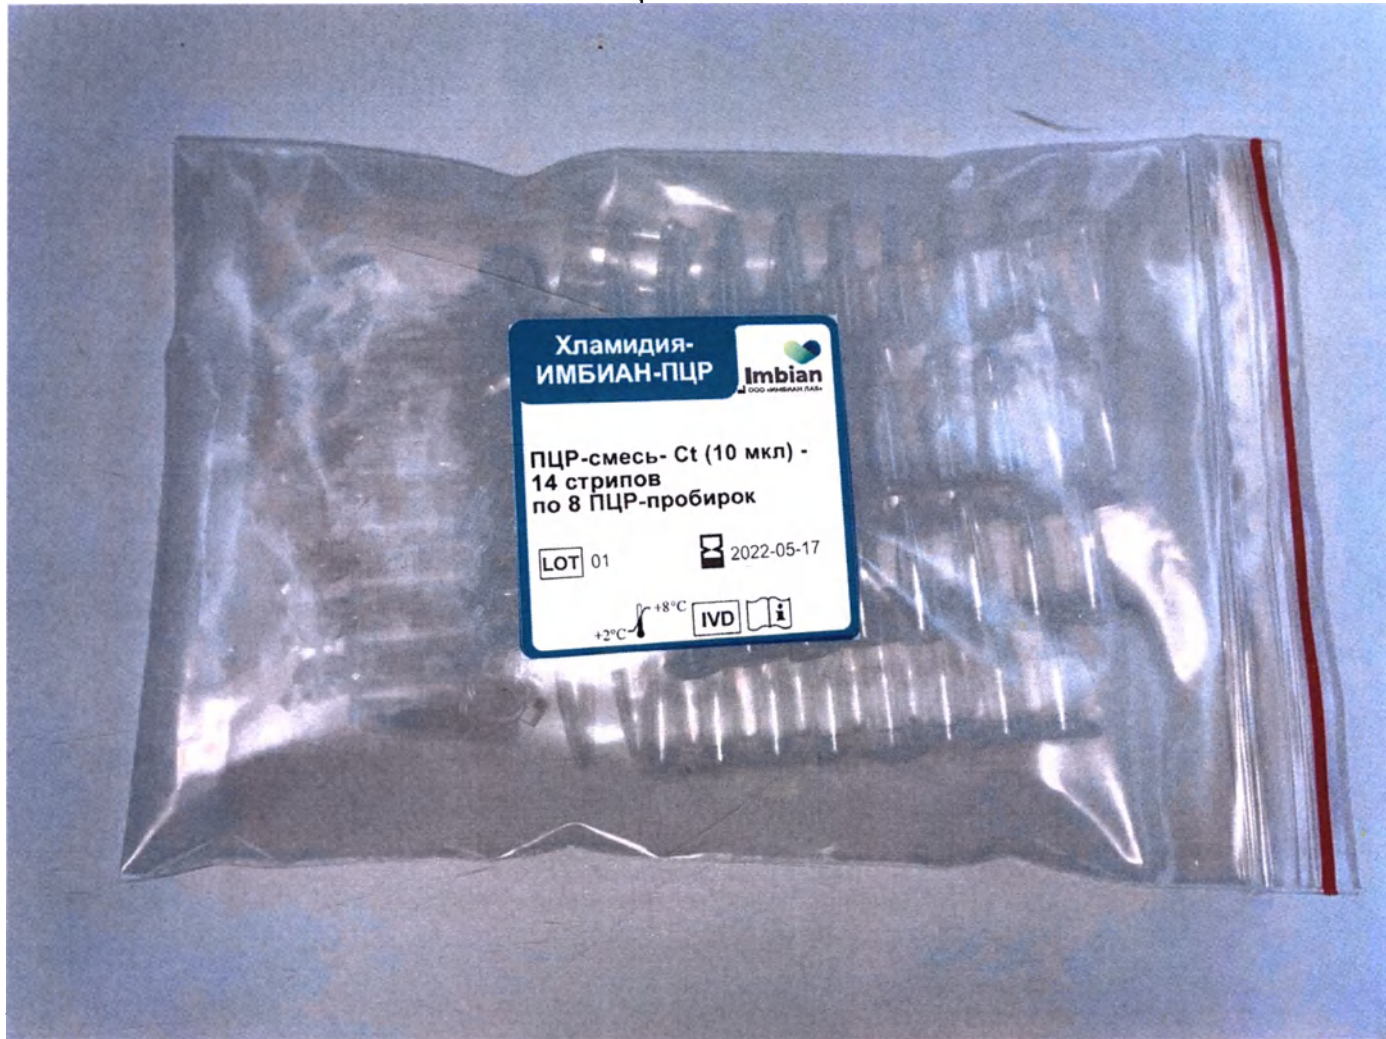

Таг - ДНК-полимераза



Положительный контрольный образец



Внутренний контрольный образец



Отрицательный контрольный образец



Хламидия-ИМБИАН-ПЦР



Комплект 2

Набор реагентов для качественного выявления ДНК *Chlamydia trachomatis* методом ПЦР in vitro в препаратах нуклеиновых кислот, полученных из клинических образцов в режиме реального времени «Хламидия-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-116-41390295-2021

1 ПЦР-смесь- Ct (10 мкл)	112 отдельных ПЦР пробирок	ПУ № XXX XXXX/XXXXX
2 Taq-ДНК-полимераза, 1120 мкл	1 пробирка	LOT 01
3 Положительный контрольный образец, 250 мкл	1 пробирка	REF 01
4 Внутренний контрольный образец, 1120 мкл	1 пробирка	2021-05-17
5 Отрицательный контрольный образец, 1500 мкл	1 пробирка	2022-05-17
6 Инструкция по применению	1 шт	
7 Паспорт	1 шт	

Замораживать не допускается
Только для диагностики in vitro.
ТУ 21.20.23-116-41390295-2021
Для профессионального применения

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл., Г.О. Рабочий поселок: Кольцово, РП Кольцово, ул. Саломая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
Тел.: 8 (383) 209-34-54, info@imbian.ru

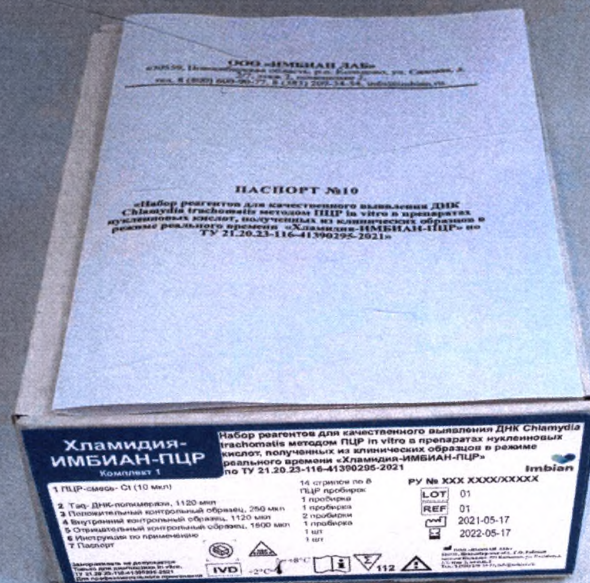

Инструкция по применению
 Набор реагентов для качественного выявления ДНК Chlamydia trachomatis методом ПЦР in vitro в препаратах нуклеиновых кислот, полученных из клинических образцов в режиме реального времени «Хламидия-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-116-41390295-2021

Комплект 2:

ПЦР-смесь



Таг - ДНК-полимераза



Положительный контрольный образец





Внутренний контрольный образец



Отрицательный контрольный образец



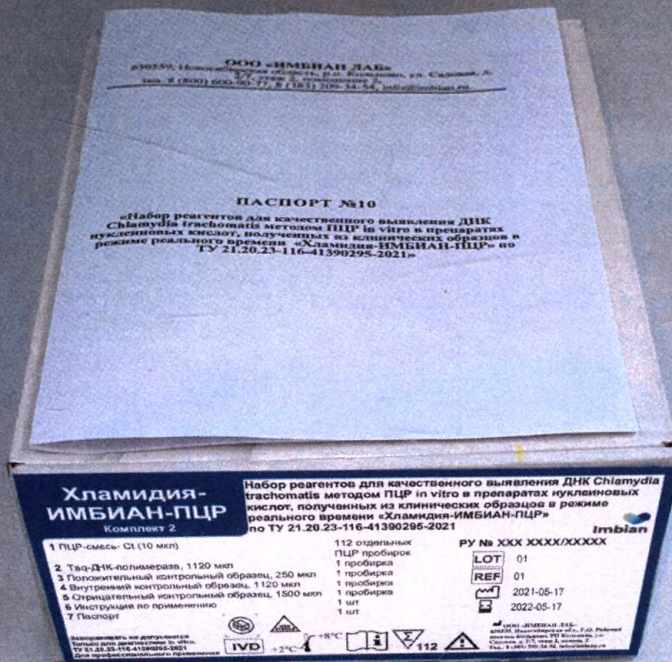

Инструкция по применению
 Набор реагентов для качественного выявления ДНК *Chlamydia trachomatis* методом ПЦР in vitro в препаратах нуклеиновых кислот, полученных из клинических образцов в режиме реального времени «Хламидия-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-116-41390295-2021

Хламидия-ИМБИАН-ПЦР

Набор реагентов для качественного выявления ДНК Chlamydia trachomatis методом ПЦР in vitro в препаратах нуклеиновых кислот, полученных из клинических образцов в режиме реального времени «Хламидия-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-116-41390295-2021

РУ № XXX XXXX/XXXXX

ТУ 21.20.23-116-41390295-2021

Количество наборов

LOT 01

REF 01

ШТ

 2021-05-17

 2022-05-17

Масса нетто кг

Масса брутто кг

Масса нетто потребительской упаковки кг

Imbian

Допускается краткосрочная +2°C (до 7 суток) транспортировка при температуре не выше плюс 25°C
Замораживать не допускается
Только для in vitro диагностики



IVD



ООО «ИМБИАН ЛАБ»

630559, Новосибирская обл., Г.О. Рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
Тел.: 8 (383) 209-34-54 info@imbiana.ru

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова



Сшито и заверено печатю 10
(100000) лист 06


Генеральный директор ООО «Имбиан лаб»
Осипова В.В.



Фотографические изображения общего вида

«Набор реагентов для качественного выявления ДНК *Chlamydia trachomatis* методом ПЦР in vitro в препаратах нуклеиновых кислот, полученных из клинических образцов в режиме реального времени. «Хламидия-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-116-41390295-2021»

Комплект 1:
ПЦР-смесь

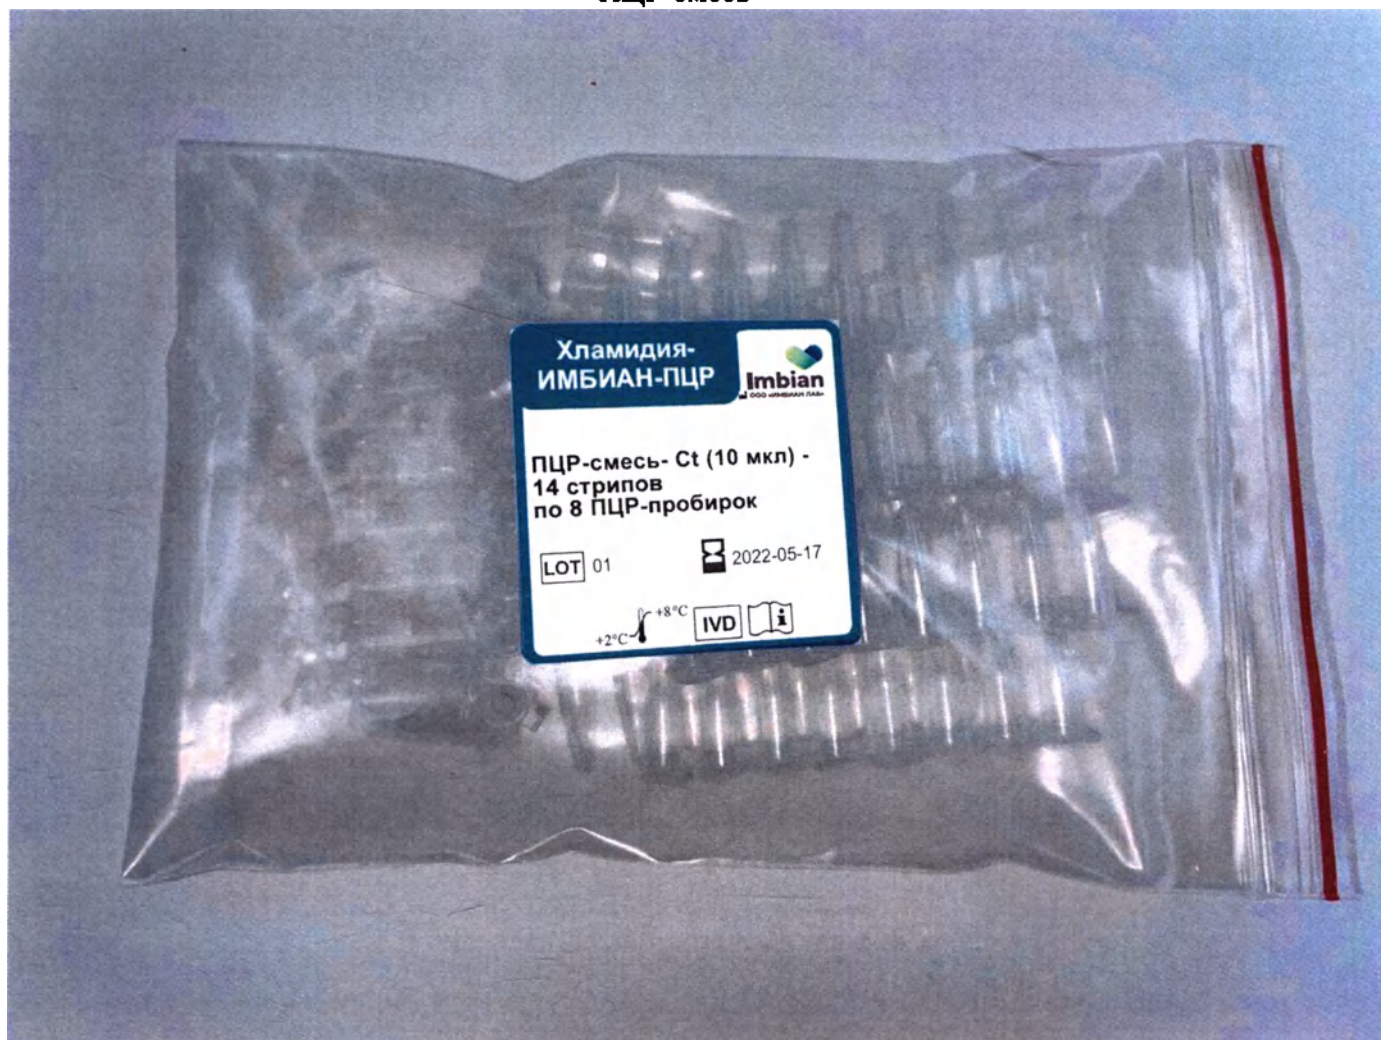

Тaq - ДНК-полимераза



Положительный контрольный образец





Внутренний контрольный образец



Отрицательный контрольный образец



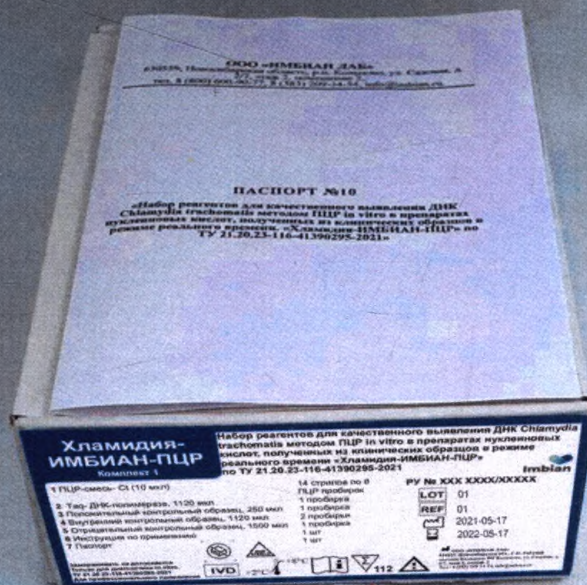


Инструкция по применению

Набор реагентов для качественного выявления ДНК *Chlamydia trachomatis* методом ПЦР in vitro в препаратах нуклеиновых кислот, полученных из клинических образцов в режиме реального времени.

«Хламидия-ИМБИАН-ПЦР»
по ТУ 21.20.23-116-41390295-2021

Комплект 2:
ПЦР-смесь

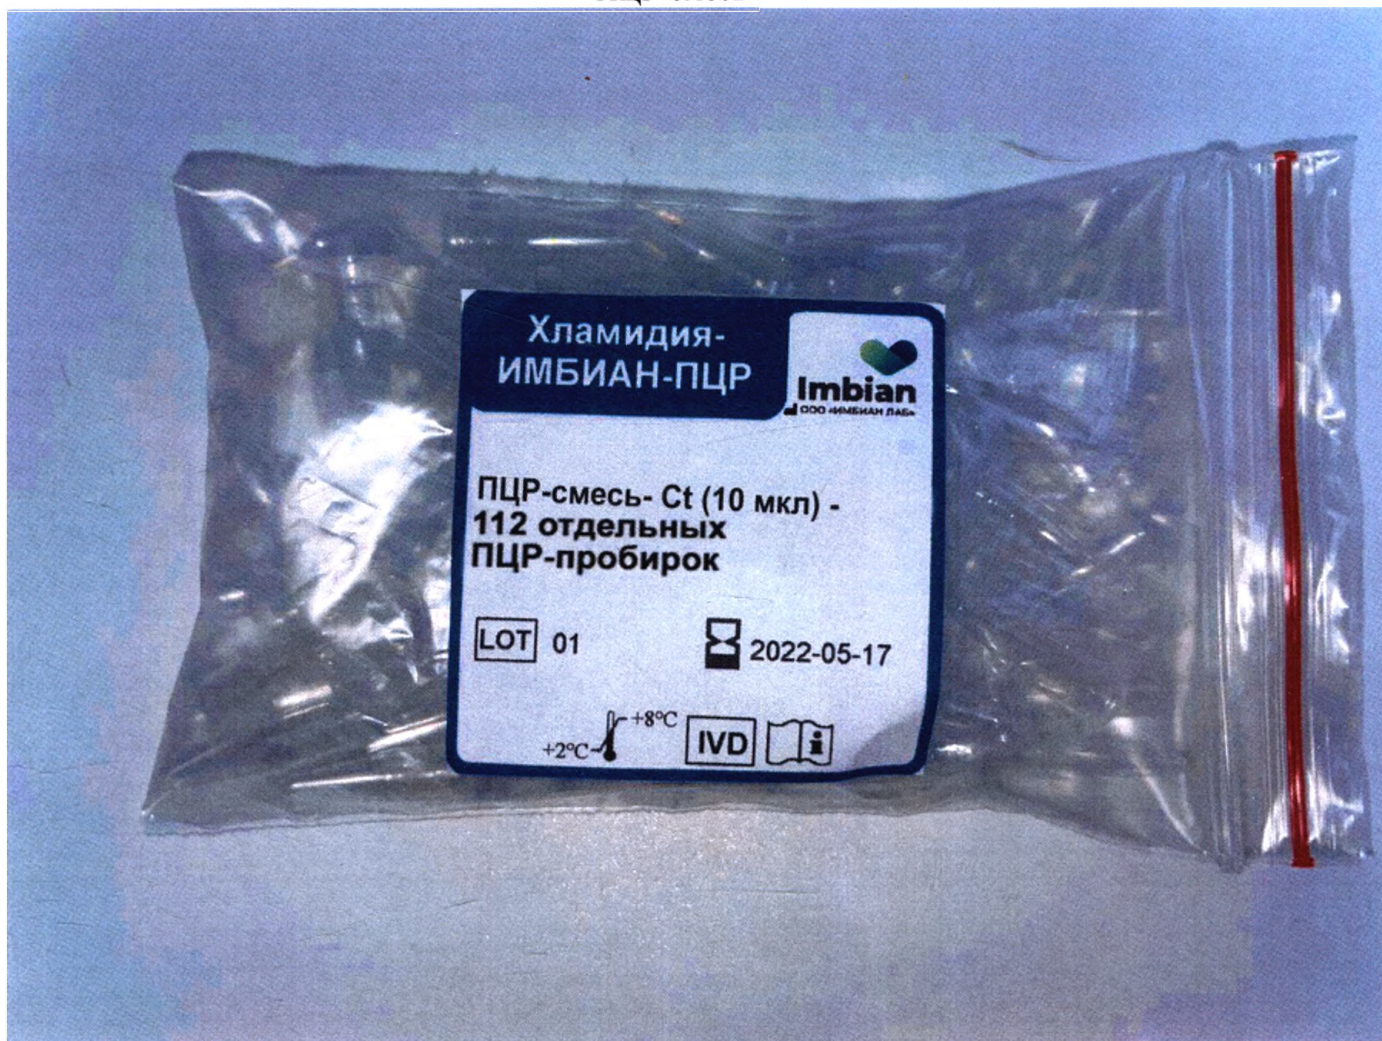

Таг - ДНК-полимераза



Положительный контрольный образец



Внутренний контрольный образец



Отрицательный контрольный образец



Хламидия-ИМБИАН-ПЦР

Набор реагентов для качественного выявления ДНК *Chlamydia trachomatis* методом ПЦР in vitro в препаратах нуклеиновых кислот, полученных из клинических образцов в режиме реального времени «Хламидия-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-116-41390295-2021

РУ № XXX XXXX/XXXXXX

ТУ 21.20.23-116-41390295-2021

Количество наборов

LOT 01

ШТ
2021-05-17

REF 01

2022-05-17

Масса нетто кг

Масса брутто кг

Масса нетто потребительской упаковки кг

Допускается краткосрочная +2°C (до 7 суток) транспортировка при температуре не выше плюс 25°C
Замораживать не допускается
Только для in vitro диагностики



IVD



Imbian

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

630559, Новосибирская обл., Г.О.
Рабочий поселок Кольцово, РП
Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
Тел.: 8 (383) 209-34-54 info@imbiana.ru

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова



Сшито и заверено печатью 10
(десять) лист 06

Генеральный директор ООО «ИМБИАН
ЛАБ» Осипова В.В.



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»
Осипова В.В.



**«Набор реагентов для качественного выявления ДНК Chlamydia trachomatis
методом ПЦР in vitro в препаратах нуклеиновых кислот, полученных из
клинических образцов в режиме реального времени «Хламидия-ИМБИАН-ПЦР» по
ТУ 21.20.23-116-41390295-2021»**

Макет маркировки


1. Маркировка компонентов

Хламидия- ИМБИАН-ПЦР



ПЦР-смесь- Ct (10 мкл) -
112 отдельных
ПЦР-пробирок

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД



IVD




Хламидия- ИМБИАН-ПЦР



ПЦР-смесь- Ct (10 мкл) -
14 стрипов
по 8 ПЦР-пробирок

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД



IVD




Хламидия-ИМБИАН-ПЦР

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Таг-ДНК-полимераза - 1120 мкл

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX




IVD

Хламидия-ИМБИАН-ПЦР

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Положительный контрольный
образец - 250 мкл

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX




IVD

Хламидия-ИМБИАН-ПЦР

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Внутренний контрольный
образец - 1120 мкл

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX



IVD

Хламидия-ИМБИАН-ПЦР


ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Отрицательный контрольный образец - 1500 мкл

ГГГГ-ММ-ДД

LOT

XXXXXX



2. Маркировка потребительской упаковки

Хламидия-ИМБИАН-ПЦР

Комплект 1

Набор реагентов для качественного выявления ДНК Chlamydia trachomatis методом ПЦР in vitro в препаратах нуклеиновых кислот, полученных из клинических образцов в режиме реального времени «Хламидия-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-116-41390295-2021



1 ПЦР-смесь- Ct (10 мкл)

14 стрипов по 8

ПУ № XXX XXXX/XXXXX

2 Taq- ДНК-полимераза, 1120 мкл

ПЦР пробирок

LOT

XXXXXX

3 Положительный контрольный образец, 250 мкл

1 пробирка

REF

XX-XXX/X

4 Внутренний контрольный образец, 1120 мкл

1 пробирка



ГГГГ-ММ-ДД

5 Отрицательный контрольный образец, 1500 мкл

2 пробирки



ГГГГ-ММ-ДД

6 Инструкция по применению

1 пробирка

7 Паспорт

1 шт



Замораживать не допускается
Только для диагностики in vitro.
ТУ 21.20.23-116-41390295-2021
Для профессионального применения

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл., Г.О. Рабочий
поселок Кольцово, РП Кольцово, ул. Садовая, д.
2/7, этаж 2, помещ. 2
Тел.: 8 (383) 209-34-54, info@imbian.ru

Хламидия-ИМБИАН-ПЦР

Комплект 2

Набор реагентов для качественного выявления ДНК Chlamydia trachomatis методом ПЦР in vitro в препаратах нуклеиновых кислот, полученных из клинических образцов в режиме реального времени «Хламидия-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-116-41390295-2021



1 ПЦР-смесь- Ct (10 мкл)

112 отдельных

ПУ № XXX XXXX/XXXXX

2 Taq-ДНК-полимераза, 1120 мкл

ПЦР пробирок

LOT

XXXXXX

3 Положительный контрольный образец, 250 мкл

1 пробирка

REF

XX-XXX/X

4 Внутренний контрольный образец, 1120 мкл

1 пробирка



ГГГГ-ММ-ДД

5 Отрицательный контрольный образец, 1500 мкл

2 пробирки



ГГГГ-ММ-ДД

6 Инструкция по применению

1 пробирка

7 Паспорт

1 шт



Замораживать не допускается
Только для диагностики in vitro.
ТУ 21.20.23-116-41390295-2021
Для профессионального применения

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл., Г.О. Рабочий
поселок Кольцово, РП Кольцово, ул.
Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
Тел.: 8 (383) 209-34-54, info@imbian.ru

Хламидия- ИМБИАН-ПЦР

Набор реагентов для качественного выявления ДНК *Chlamydia trachomatis* методом ПЦР in vitro в препаратах нуклеиновых кислот, полученных из клинических образцов в режиме реального времени «Хламидия-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-116-41390295-2021

РУ № XXX XXXX/XXXXX

ТУ 21.20.23-116-41390295-2021

Количество
наборов

LOT XXXXXX  **шт** ГГГГ-ММ-ДД

REF XX-XXX/X  ГГГГ-ММ-ДД

Масса нетто кг

Масса брутто кг

Масса нетто
потребительской
упаковки кг

Imbian

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Допускается краткосрочная +2°C
(до 7 суток) транспортировка
при температуре не выше плюс 25°C
Замораживать не допускается
Только для in vitro диагностики




IVD



630559, Новосибирская обл., Г.О.
Рабочий поселок Кольцово, РП
Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
Тел.: 8 (383) 209-34-54 info@imbian.ru

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

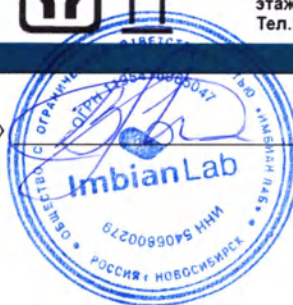

Сшито и заверено печатью 4

(22.07.19) лист 2



генеральный директор ООО «ИМБИАН
ЛАБ» Селепова В.В.