


Фотографические изображения общего вида

**Набор реагентов для качественного выявления методом ПЦР in vitro
ДНК *Neisseria gonorrhoeae* в препаратах нуклеиновых кислот,
полученных из клинических образцов в режиме реального времени
«Гонорея-ИМБИАН-ПЦР»
по ТУ 21.20.23-081-41390295-2021**

Комплект 1:
ПЦР-смесь-Ng

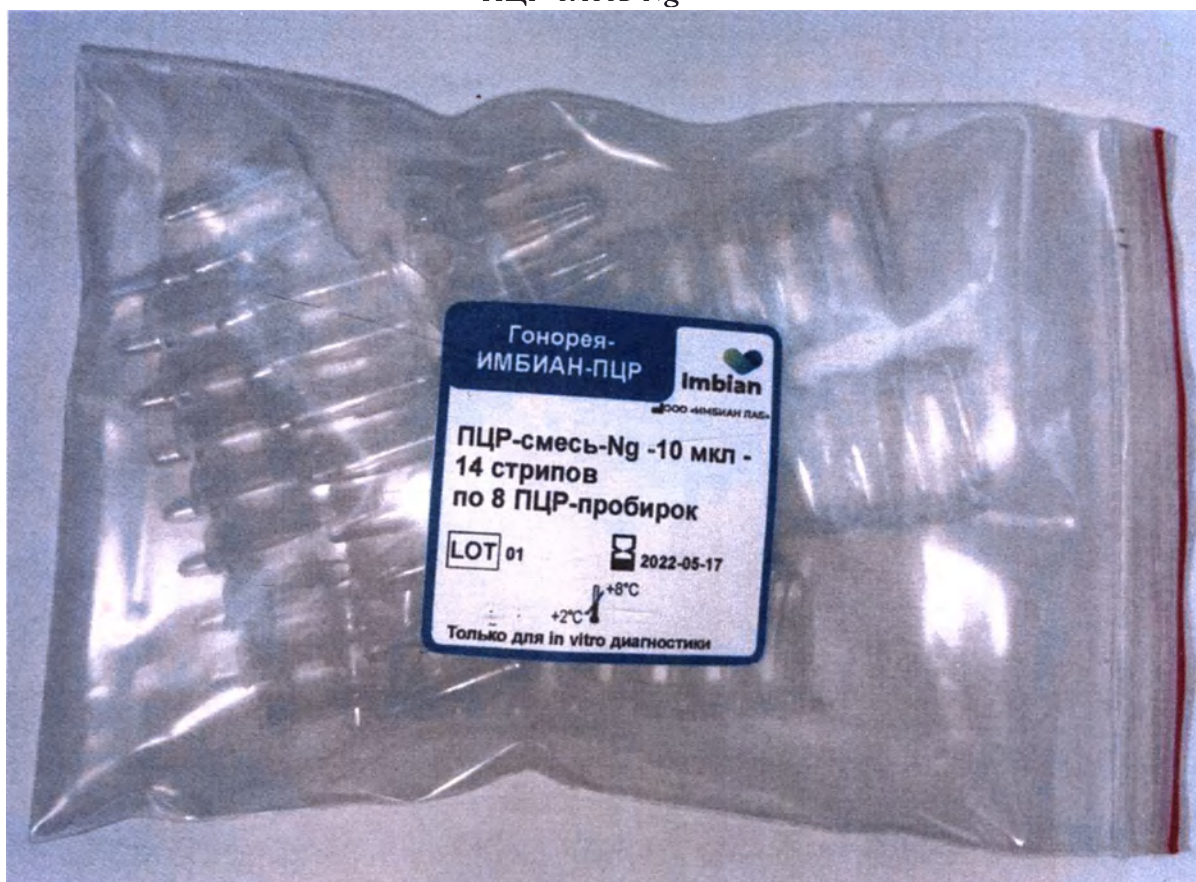

Тaq - ДНК-полимераза



Комплексный положительный контрольный образец



Внутренний контрольный образец.



Отрицательный контрольный образец



ИСПОЛНИ С ЛАМИНЫ
КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ

Инструкция по применению
Набор реагентов для качественного
выявления антител к вирусу ДНК
Нейссерии гонорральной в препаратах
мочевых, слюнных и из влагалища
образцов
в режиме реального времени
«Гонорей-ИМП/ИВН-ПЦР»
по ТУ 21.20.23-091-41390295-2021

Гонорей-
ИМП/ИВН-ПЦР

Набор реагентов для качественного выявления антител к вирусу ДНК
Нейссерии гонорральной в препаратах мочевых, слюнных и из
влагалища образцов в режиме реального времени «Гонорей-ИМП/ИВН-ПЦР» по
ТУ 21.20.23-091-41390295-2021

Состав набора:

1. ПЦР-состав (10 шт)
2. Буферная смесь (10 шт)
3. Прогризованный раствор (10 шт)
4. Буферная смесь (10 шт)
5. Буферная смесь (10 шт)
6. Буферная смесь (10 шт)
7. Буферная смесь (10 шт)
8. Буферная смесь (10 шт)
9. Буферная смесь (10 шт)
10. Буферная смесь (10 шт)

1. ПЦР-состав (10 шт)
2. Буферная смесь (10 шт)
3. Прогризованный раствор (10 шт)
4. Буферная смесь (10 шт)
5. Буферная смесь (10 шт)
6. Буферная смесь (10 шт)
7. Буферная смесь (10 шт)
8. Буферная смесь (10 шт)
9. Буферная смесь (10 шт)
10. Буферная смесь (10 шт)

Гонорей-ИМП/ИВН-ПЦР
ИМП/ИВН-ПЦР
ИМП/ИВН-ПЦР
ИМП/ИВН-ПЦР
ИМП/ИВН-ПЦР
ИМП/ИВН-ПЦР
ИМП/ИВН-ПЦР
ИМП/ИВН-ПЦР
ИМП/ИВН-ПЦР
ИМП/ИВН-ПЦР

Гонорей-
ИМП/ИВН-ПЦР
ИМП/ИВН-ПЦР
ИМП/ИВН-ПЦР
ИМП/ИВН-ПЦР
ИМП/ИВН-ПЦР
ИМП/ИВН-ПЦР
ИМП/ИВН-ПЦР
ИМП/ИВН-ПЦР
ИМП/ИВН-ПЦР
ИМП/ИВН-ПЦР

Гонорей-ИМП/ИВН-ПЦР
ИМП/ИВН-ПЦР
ИМП/ИВН-ПЦР
ИМП/ИВН-ПЦР
ИМП/ИВН-ПЦР
ИМП/ИВН-ПЦР
ИМП/ИВН-ПЦР
ИМП/ИВН-ПЦР
ИМП/ИВН-ПЦР
ИМП/ИВН-ПЦР

Гонорей-ИМП/ИВН-ПЦР
ИМП/ИВН-ПЦР
ИМП/ИВН-ПЦР
ИМП/ИВН-ПЦР
ИМП/ИВН-ПЦР
ИМП/ИВН-ПЦР
ИМП/ИВН-ПЦР
ИМП/ИВН-ПЦР
ИМП/ИВН-ПЦР
ИМП/ИВН-ПЦР

Комплект 2:
ПЦР-смесь-*Ng*



Тaq - ДНК-полимераза



Комплексный положительный контрольный образец



Внутренний контрольный образец



Отрицательный контрольный образец



Гонорея-ИМБИАН-ПЦР

Набор реагентов для качественного выявления методом ПЦР in vitro ДНК *Neisseria gonorrhoeae* в препаратах нуклеиновых кислот, полученных из клинических образцов в режиме реального времени «Гонорея-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-081-41390295-2021

РУ № XXX XXXX/XXXXX
ТУ 21.20.23-081-41390295-2021

Комплект 1 /Комплект 2 - нужное подчеркнуть

Количество наборов

LOT 01

REF 01

шт

2021-05-17

2022-05-17

Масса нетто

кг

Масса брутто

кг

Масса нетто потребительской упаковки

кг

Imbian

Допустима транспортировка при температуре от +2 до +8°C в течение 5 дней (не более) и хранения (+2...+8°C)

Только для in vitro диагностики



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская область,
г. Новосибирск, рп. Кольцово,
ул. Садовая 2/7, помещение 2, этаж 2
8-800-600-90-77; 8(383)209-34-54,
info@imbian.ru

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова



Сшито и заверено печатью 10
1000) лист 06

Генеральный директор ООО «Имбиан лаб»
Осипова В.В.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В.Осипова

2021 г.



Набор реагентов для качественного выявления методом ПЦР in vitro ДНК Neisseria gonorrhoeae в препаратах нуклеиновых кислот, полученных из клинических образцов в режиме реального времени «Гонорея-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-081-41390295-2021

Макет маркировки

2021

МАРКИРОВКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ УПАКОВОК

Гонорея-ИМБИАН-ПЦР  ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ПЦР-смесь-Ng -10 мкл -
14 стрипов
по 8 ПЦР-пробирок

LOT XXXXXX  ГГГГ-ММ-ДД

IVD  +2°C +8°C

Гонорея-ИМБИАН-ПЦР  ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ПЦР смесь- Ng- 10мкл-
112 отдельных ПЦР
пробирок

LOT XXXXXX  ГГГГ-ММ-ДД

IVD  +2°C +8°C

Гонорея-ИМБИАН-ПЦР  ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тaq-ДНК-полимераза - 1120 мкл

 ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX  +2°C +8°C

Гонорея-ИМБИАН-ПЦР  ООО «ИМБИАН ЛАБ»


Комплексный положительный контрольный
образец - 250 мкл

 ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX IVD  +2°C +8°C

Гонорея-ИМБИАН-ПЦР  ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Внутренний контрольный
образец - 1120 мкл

 ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX IVD  +2°C +8°C

Гонорея-ИМБИАН-ПЦР  ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Отрицательный контрольный
образец - 1500 мкл

 ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX IVD  +2°C +8°C

МАРКИРОВКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ

Гонорея- ИМБИАН-ПЦР

Комплект 1

Набор реагентов для качественного выявления методом ПЦР in vitro ДНК *Neisseria gonorrhoeae* в препаратах нуклеиновых кислот, полученных из клинических образцов в режиме реального времени «Гонорея-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-081-41390295-2021



Состав набора:

1 ПЦР-смесь-Ng-10 мкл

2 Taq-ДНК-полимераза (1120 мкл)

3 Комплексный положительный контрольный образец (250 мкл)

4 Внутренний контрольный образец, (1120 мкл)

5 Отрицательный контрольный образец, (1500 мкл)

6 Вкладыш с данными контрольного образцов

7 Инструкция по применению

14 стрипов

по 8 ПЦР-пробирок

1 пробирка

1 пробирка

2 пробирки

1 пробирка

1 шт

1 шт

РУ № XXX XXXX/XXXXX

LOT XXXXXX


REF XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД


ГГГГ-ММ-ДД

ТУ 21.20.23-081-41390295-2021

Для профессионального применения



+2°C



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл., Г.О. Рабочий
поселок Кольцово, РП Кольцово, ул.
Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

Гонорея- ИМБИАН-ПЦР

Комплект 2

Набор реагентов для качественного выявления методом ПЦР in vitro ДНК *Neisseria gonorrhoeae* в препаратах нуклеиновых кислот, полученных из клинических образцов в режиме реального времени «Гонорея-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-081-41390295-2021



Imbian

Состав набора:

1 ПЦР-смесь-Ng-10 мкл.

112 отдельных
ПЦР-пробирок

РУ № XXX XXXX/XXXXX

2 Taq-ДНК-полимераза (1120 мкл)

1 пробирка

LOT XXXXXX

3 Комплексный положительный контрольный образец, (250 мкл)

1 пробирка

REF XXXXXX

4 Внутренний контрольный образец, (1120 мкл)

2 пробирки



ГГГГ-ММ-ДД

5 Отрицательный контрольный образец, (1500 мкл)

1 пробирка



ГГГГ-ММ-ДД

6 Вкладыш с данными контрольного образцов


1 шт

7 Инструкция по применению

1 шт


ТУ 21.20.23-081-41390295-2021

Для профессионального применения



112

+2°C



+8°C



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл., Г.О. Рабочий
поселок Кольцово, РП Кольцово, ул.
Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
8 (383) 209-34-54
info@imbian.ru

МАРКИРОВКА ГРУППОВОЙ УПАКОВКИ

Гонорея- ИМБИАН-ПЦР

Набор реагентов для качественного выявления методом ПЦР in vitro ДНК *Neisseria gonorrhoeae* в препаратах нуклеиновых кислот, полученных из клинических образцов в режиме реального времени «Гонорея-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-081-41390295-2021

РУ № XXX XXXX/XXXXX
ТУ 21.20.23-081-41390295-2021

Количество
наборов

LOT XXXXXX  ГГГГ-ММ-ДД

REF XX-XXX/X  ГГГГ-ММ-ДД

Допустима
транспортировка при
температуре до +25 С
в течение 7 дней (не более)
и хранения (+2...+8°C)



Масса нетто кг

Масса брутто кг

Масса нетто
потребительской
упаковки кг

Imbian

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

630559, Новосибирская обл., Г.О. Рабо-
чий поселок Кольцово, РП Кольцово, ул.
Садовая, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
8(383)209-34-54.
info@imbian.ru

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»



В.В. Осипова

Счито и заверено печатью 5
(мех) лист 06

Генеральный директор ООО «Имблан д.о.о»
Осипова В.В.

