



Вариант 1



Набор калибраторов для определения антистрептолизина-О
(КАЛИБРАТОР АСЛ(О) ДДС) по ТУ 21.20.23.110-050-48813770-2022

2

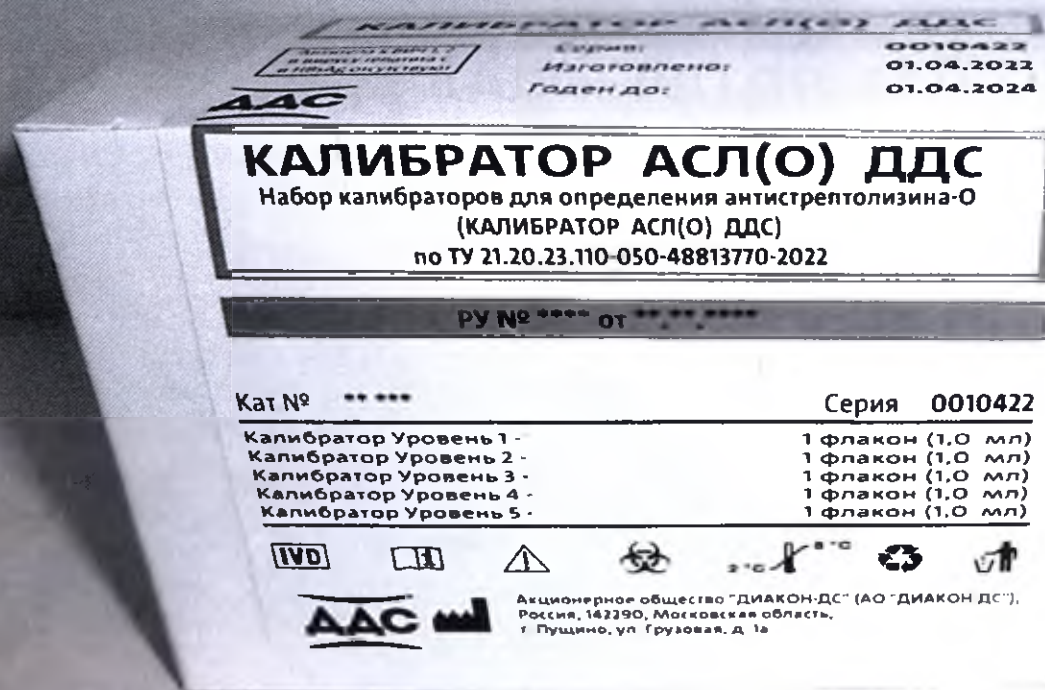

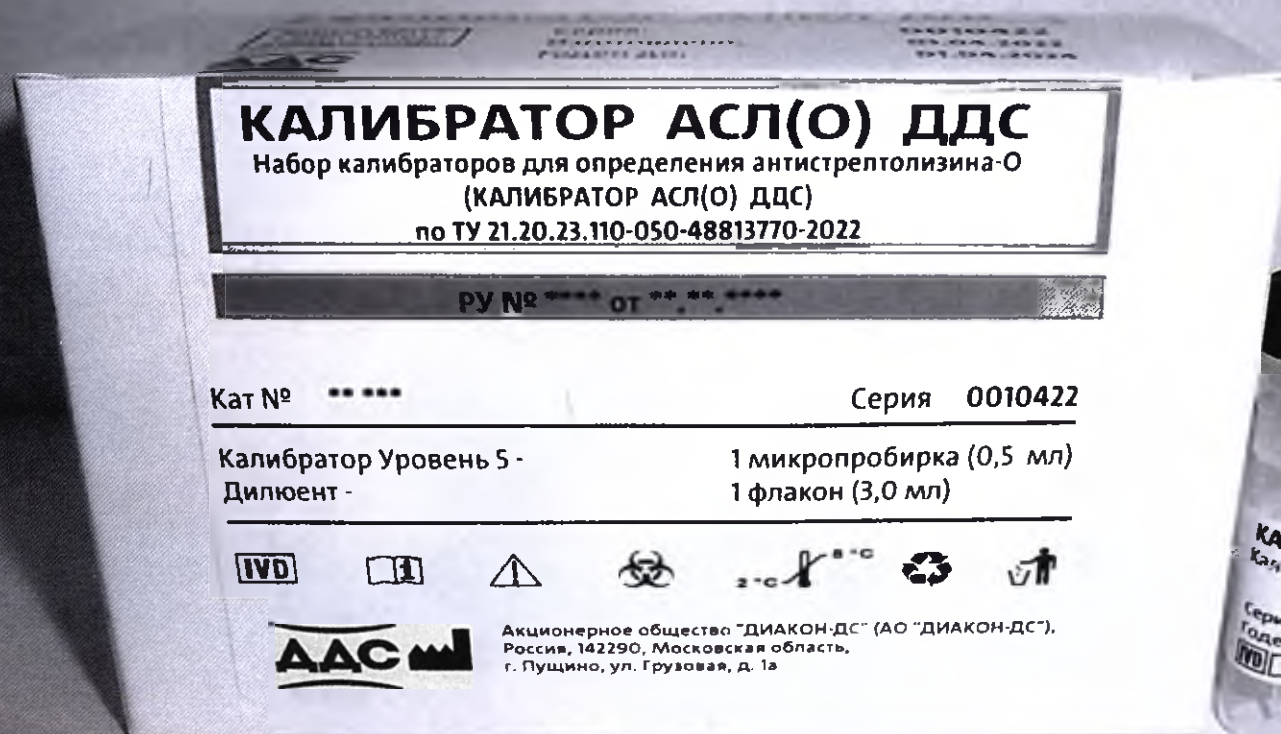

Набор калибраторов для определения антистрептолизина-О
(КАЛИБРАТОР АСЛ(О) ДДС) по ТУ 21.20.23.110-050-48813770-2022

КАЛИБРАТОР АСЛ(О) ДДС

Набор калибраторов для определения антистрептолизина-О
(КАЛИБРАТОР АСЛ(О) ДДС)
по ТУ 21.20.23.110-050-48813770-2022

РУ № **** ОТ ** ** *

Кат № ****

Серия 0010422

Калибратор Уровень 5 -

1 флакон (1,0 мл)


Дилуэнт -

1 флакон (3,0 мл)



Акционерное общество "ДИАКОН-ДС" (АО "ДИАКОН-ДС").
Россия, 142290 Московская область,
г. Пущино, ул. Луговая, д. 1а



Прочито, пронумеровано и
скреплено печатью 4
Генеральный директор
АО «ДИАКОН-ДС»  Т.Ю. Корзун

