

Фотографические изображения общего вида

Набор реагентов для качественного выявления методом ОТ-ПЦР *in vitro* РНК вируса краснухи в пробах нуклеиновых кислот, полученные из клинического материала, в режиме реального времени «Краснуха-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-110-41390295-2021

Комплект 1:
Положительный контрольный образец (ПКО)

Готовая реакционная смесь для ОТ-ПЦР (ГРС для ОТ-ПЦР), лиофилизированная - 6 стрипов по 8 пробирок.



Готовая реакционная смесь для ОТ-ПЦР (ГРС для ОТ-ПЦР), лиофилизированная – 6 стрипов по 8 пробирок по 50 мкл.





Оптическая плёнка - 2 листа.




ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл., Г.О. Рабочий посёлок Калынов, РП Калынов,
ул. Салтыков, д. 2/7, этаж 2, помест. 2
Тел.: 8 (383) 209-34-54, www.imbian.ru, e-mail: info@imbiana.ru

Паспорт №20

Набор реагентов для качественного выявления
методом ОТ-ПЦР in vitro РНК вируса
краснухи в пробах нуклеиновых кислот,
полученных из клинического
материала, в режиме реального времени
«Краснуха-ИМБИАН-ПЦР»
по ТУ 21.20.23-110-41390295-2021

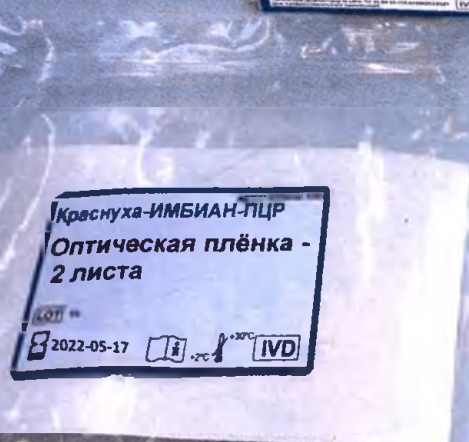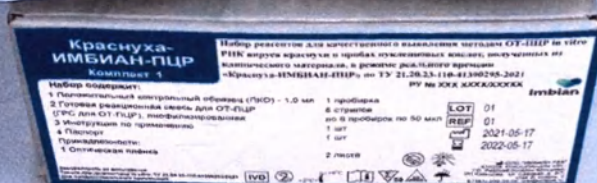


Инструкция по применению
Набор реагентов для качественного
выявления методом ОТ-ПЦР
in vitro РНК вируса краснухи в пробах
нуклеиновых кислот,
полученных из клинического
материала, в режиме реального времени
«Краснуха-ИМБИАН-ПЦР»
по ТУ 21.20.23-110-41390295-2021

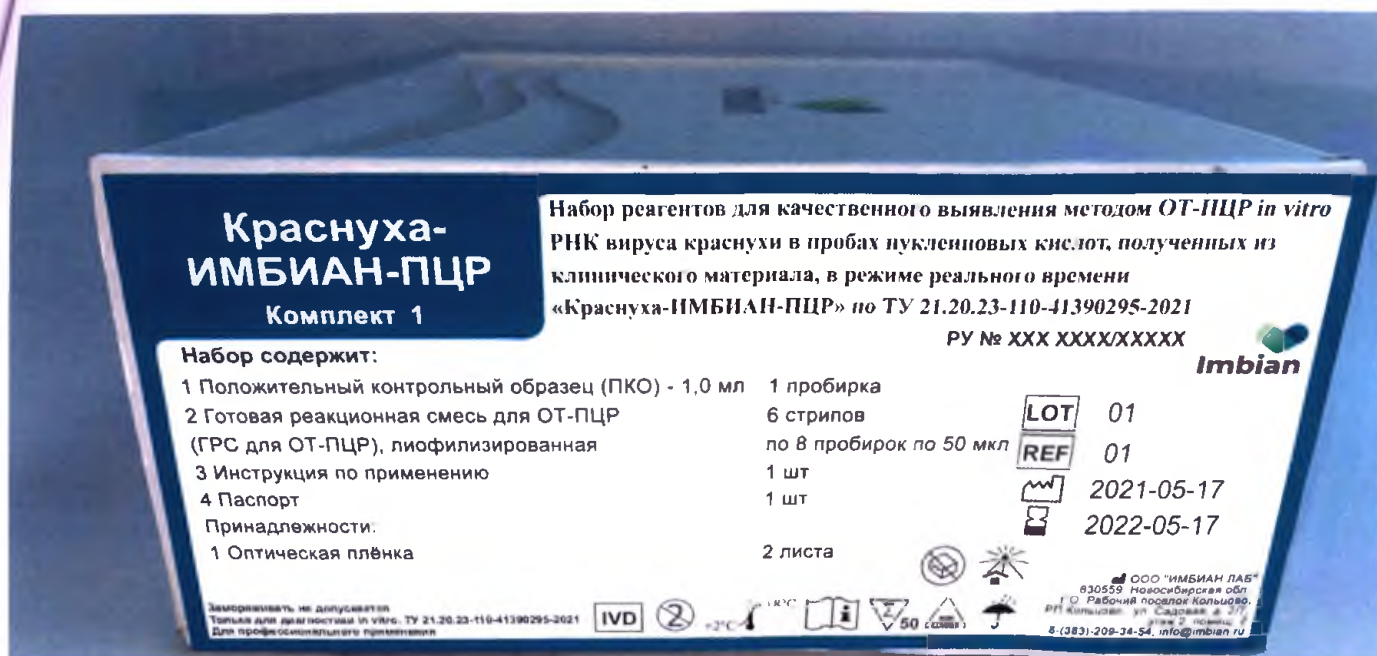

Комплект 2:
Положительный контрольный образец (ПКО) - 1 пробирка;



Готовая реакционная смесь для ОТ-ПЦР (ГРС для ОТ-ПЦР), лиофилизированная - 5 пробирок, каждая на 10 определений.


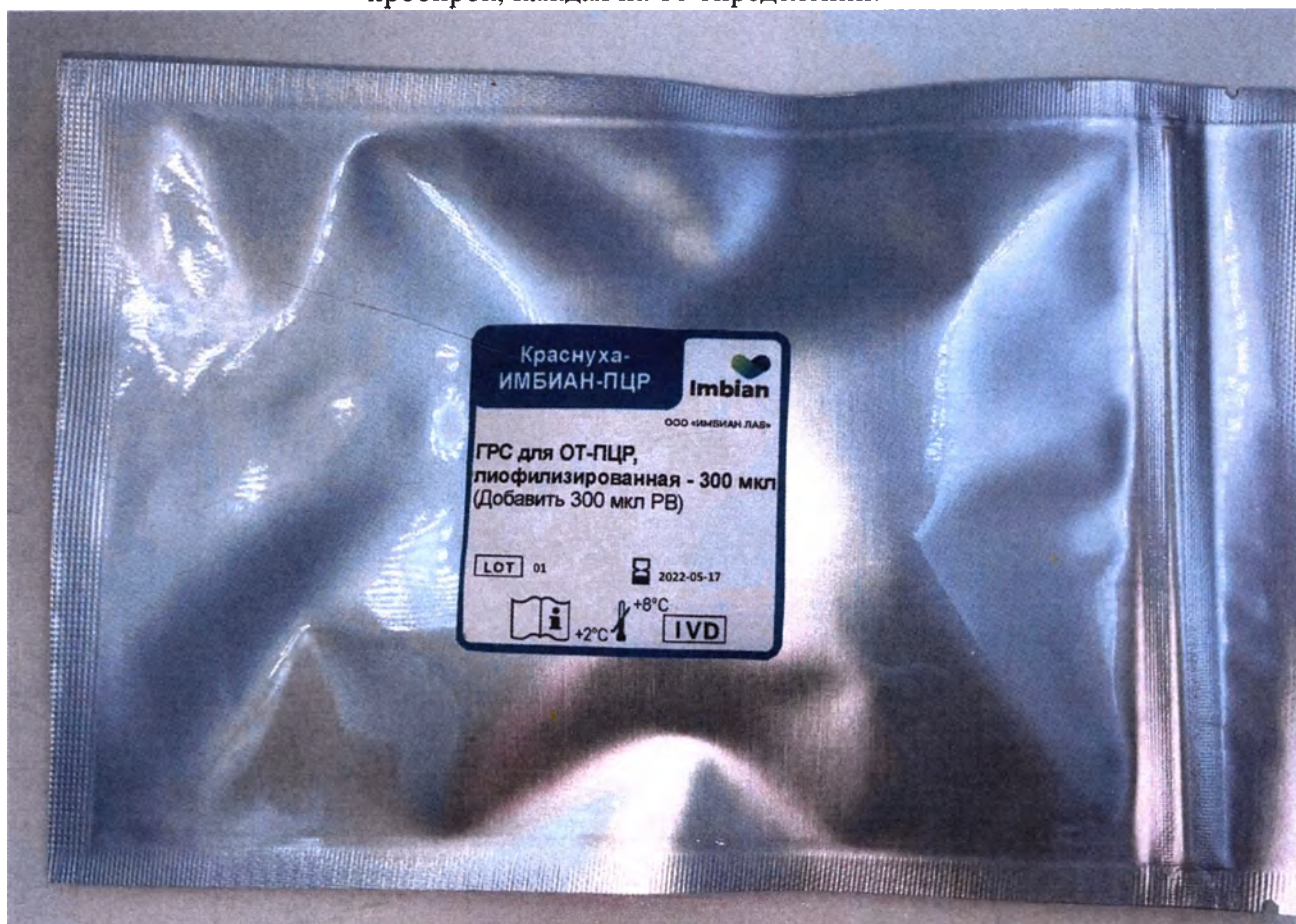


Раствор для восстановления (РВ) - 1 флакон.




ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл., Г.О. Рабочий поселок Кольцово, РП Кольцово,
ул. Сазонова, д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
Тел.: 8 (383) 289-34-54, www.imbian.ru, e-mail: info@imbian.ru

Паспорт №20
Набор реагентов для качественного выявления
методом ОТ-ПЦР in vitro РНК вируса
краснухи в пробах нуклеиновых кислот,
полученных из клинического
материала, в режиме реального времени
«Краснуха-ИМБИАН-ПЦР»
по ТУ 21.20.23-110-41390295-2021

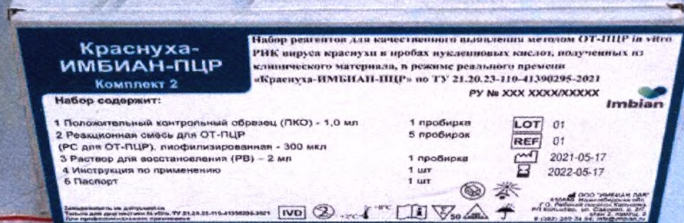

Инструкция по применению
Набор реагентов для качественного
выявления методом ОТ-ПЦР
in vitro РНК вируса краснухи в пробах
нуклеиновых кислот,
полученных из клинического
материала, в режиме реального времени
«Краснуха-ИМБИАН-ПЦР»
по ТУ 21.20.23-110-41390295-2021

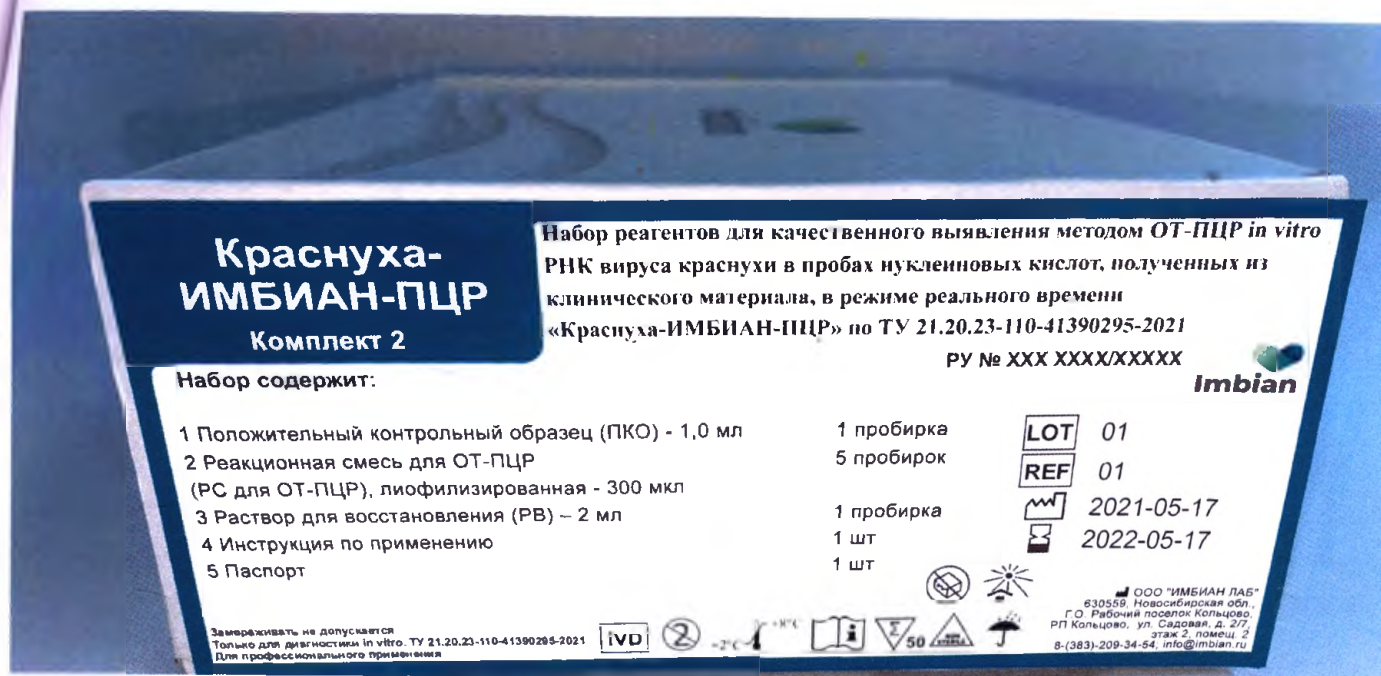

Транспортная упаковка



Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова



Сшито и заверено печатью

Валентина лист 06

7

Генеральный директор ООО «Имбиан Лаб»
Осипова В.В.



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»



В.В.Осипова

21 «апреля» 2021 г.

**Набор реагентов для качественного выявления методом ОТ-ПЦР in vitro РНК
вируса краснухи в пробах нуклеиновых кислот, полученных из клинического
материала, в режиме реального времени «Краснуха-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-
110-41390295-2021**

Макет маркировки

Краснуха-ИМБИАН-ПЦР ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ПКО - 1 мл

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД +2°C +8°C IVD

Краснуха-ИМБИАН-ПЦР ООО «ИМБИАН ЛАБ»

ГРС для ОТ-ПЦР, лиофилизированная - 6 стрипов по 8 пробирок по 50 мкл (Добавить 50 мкл анализата)

LOT XXXXXX ГГГГ-ММ-ДД

+2°C +8°C IVD

Краснуха-ИМБИАН-ПЦР ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Оптическая плёнка - 2 листа

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД +2°C +30°C IVD

Краснуха-ИМБИАН-ПЦР
Комплект 1

Набор реагентов для качественного выявления методом ОТ-ПЦР in vitro РНК вируса краснухи в пробах нуклеиновых кислот, полученных из клинического материала, в режиме реального времени «Краснуха-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-110-41390295-2021
РУ № XXX XXXX/XXXXX

Набор содержит:

1 Положительный контрольный образец (ПКО) - 1,0 мл	1 пробирка	XXXXXX XX-XXX/X ГГГГ-ММ-ДД ГГГГ-ММ-ДД
2 Готовая реакционная смесь для ОТ-ПЦР (ГРС для ОТ-ПЦР), лиофилизированная	6 стрипов по 8 пробирок по 50 мкл	
3 Инструкция по применению	1 шт	
4 Паспорт	1 шт	
Принадлежности:		
1 Оптическая плёнка	2 листа	

Замораживать не допускается
Только для диагностики in vitro. ТУ 21.20.23-110-41390295-2021
Для профессионального применения

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630558 Новосибирская обл.
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 277,
этаж 2, помещ. 2
8-(383)-209-34-54; info@imbian.ru

Краснуха-ИМБИАН-ПЦР 

ПКО - 1 мл

LOT XXXXXX  ГГГГ-ММ-ДД  +2°C  +8°C IVD

Краснуха-ИМБИАН-ПЦР 

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Реакционная смесь для ОТ-ПЦР (РС для ОТ-ПЦР), лиофилизированная - 300 мкл- 5 пробирок
(Добавить 300 мкл РВ)

LOT XXXXXX  ГГГГ-ММ-ДД

 +2°C  +8°C IVD

Краснуха-ИМБИАН-ПЦР 

РВ - 2 мл

LOT XXXXXX  ГГГГ-ММ-ДД  +2°C  +8°C IVD

Краснуха-ИМБИАН-ПЦР
Комплект 2

Набор реантентов для качественного выявления методом ОТ-ПЦР in vitro РНК вируса краснухи в пробах нуклеиновых кислот, полученных из клинического материала, в режиме реального времени «Краснуха-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-110-41390295-2021

РУ № XXX XXXX/XXXXX 

Набор содержит:

1 Положительный контрольный образец (ПКО) - 1,0 мл	1 пробирка	LOT XXXXXX
2 Реакционная смесь для ОТ-ПЦР (РС для ОТ-ПЦР), лиофилизированная - 300 мкл	5 пробирок	REF XX-XXX/X
3 Раствор для восстановления (РВ) – 2 мл	1 пробирка	 ГГГГ-ММ-ДД
4 Инструкция по применению	1 шт	 ГГГГ-ММ-ДД
5 Паспорт	1 шт	


Замораживать не допускается
Только для диагностики in vitro. ТУ 21.20.23-110-41390295-2021
Для профессионального применения

IVD  +2°C  +8°C     

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцова, ул. Садовая д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
t-(383)-209-34-54; info@imbian.ru

Краснуха-ИМБИАН-ПЦР		Набор реагентов для качественного выявления методом ОТ-ПЦР in vitro РНК вируса краснухи в пробах нуклеиновых кислот, полученных из клинического материала, в режиме реального времени «Краснуха-ИМБИАН-ПЦР»	
		по ТУ 21.20.23-110-41390295-2021 комплект 1/комплект 2 (нужное подчеркнуть)	
РУ № XXX XXXX/XXXXX ТУ 21.20.23-110-41390295-2021		Масса нетто кг Масса брутто кг Масса нетто потребительской упаковки кг	
Количество наборов	ШТ	Имбиан	
LOT XXXXXX	ГГГГ-ММ-ДД	Имбиан	
REF XX-XXX/X	ГГГГ-ММ-ДД	Имбиан	
Замораживать не допускается Допустима транспортировка при температуре от +2 до +8°C		Имбиан	

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

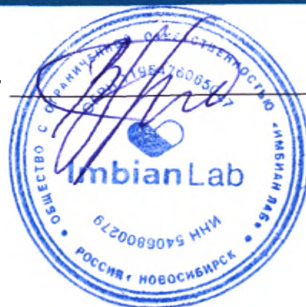

В.В. Осипова

Сшито и заверено печатью
Метаре) лист *а*

4

Генеральный директор ООО «Имблан лаб»
Осипова В.В.

