

УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Диагностика-М»

В.Е. Усачев



20.12.2022 г.

Макет маркировки медицинского изделия

«Система рентгеновская диагностическая для преобразования цифровых изображений «ДИАГНОСТ-МЕД» по ТУ 26.60.11-002-17942806-2021»

Производитель/разработчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Диагностика-М»

(ООО «Диагностика-М»)

Юридический адрес:

109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 42, этаж 13, комната 12

2022

Макет маркировки компонента Системы:

Система рентгеновская диагностическая для преобразования
цифровых изображений «Диагност-Мед»
ТУ 26.60.11-002-17942806-2021



ДПРС 2430 WiFi

ДЕТЕКТОР ПЛОСКОПАНЕЛЬНЫЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ СТАТИЧЕСКИЙ

Класс защиты от поражения электрическим током - III

Электропитание DC 12 В, 45 ВА

Степень защиты IP54

Максимальная нагрузка 150 кг

Рабочая температура от +10 °C до +40 °C



Сделано в России: ООО «Диагностика-М»,
sale@tsnk.ru, www.tsnk.ru, +7(495)228-18-28

Пример маркировки упаковки Системы:

Система рентгеновская диагностическая для преобразования цифровых изображений «Диагност-Мед» по ТУ 26.60.11-002-17942806-2021 в составе:		TSNK ООО Диагностика-М	
Детектор ДПРС 2430WiFi		1	
Зарядное устройство для аккумулятора		1	
Аккумулятор для детектора ДПРС 2430WiFi		1	
Кабель Ethernet 1м		1	
СПО для сбора и хранения данных на флэш-носителе		1	
Артикул: ЕКНОФ Дата производства: 19 июня 2021			
		Сделано в России: ООО «Диагностика-М», sale@tsnk.ru, www.tsnk.ru, +7 495 228-18-28	

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

2

(два)

) листов

цифрами

прописью

Генеральный директор
ООО «Диагностика-М»

В.Е.Усачев

М.П.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Диагностика-М»


В.Е. Усачёв


20.11.2022 г.

М.П.


**Фотографическое изображение
на медицинское изделие**

**«Система рентгеновская диагностическая для преобразования цифровых
изображений «ДИАГНОСТ-МЕД» по ТУ 26.60.11-002-17942806-2021»**


2022

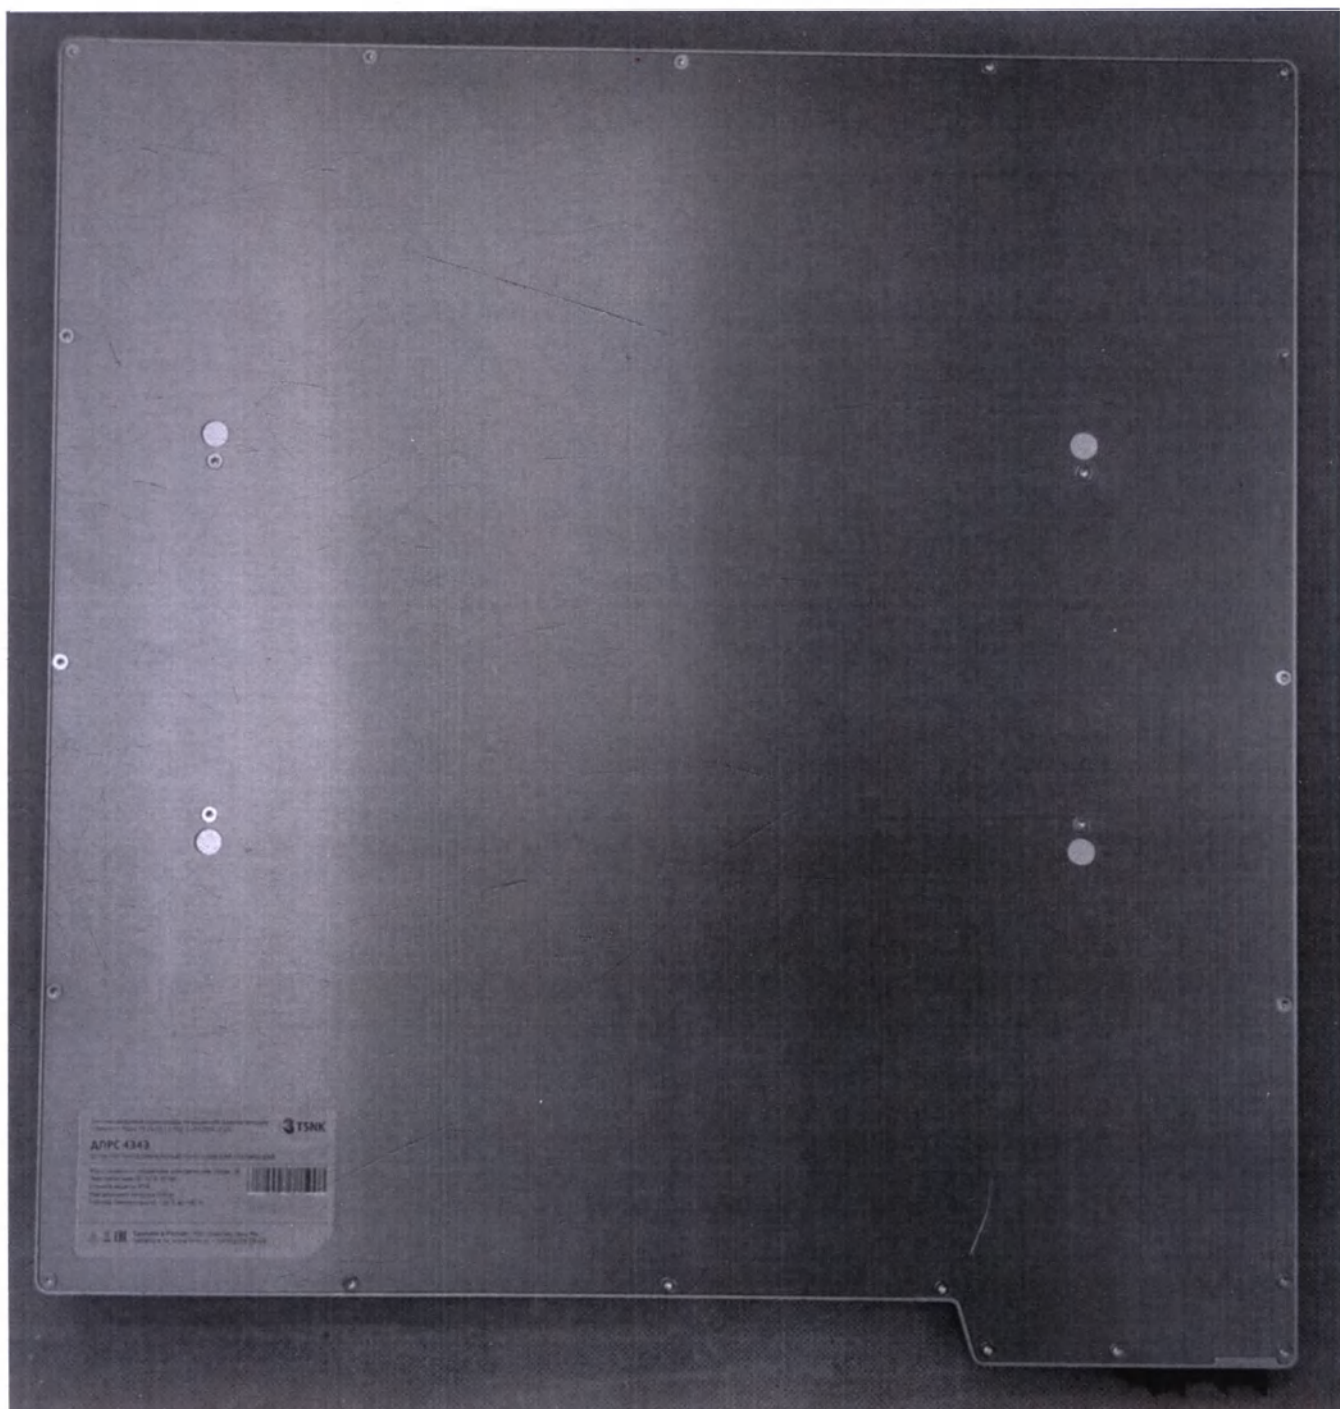


Детектор плоскпанельный рентгеновский статический «ДПРС 4343»

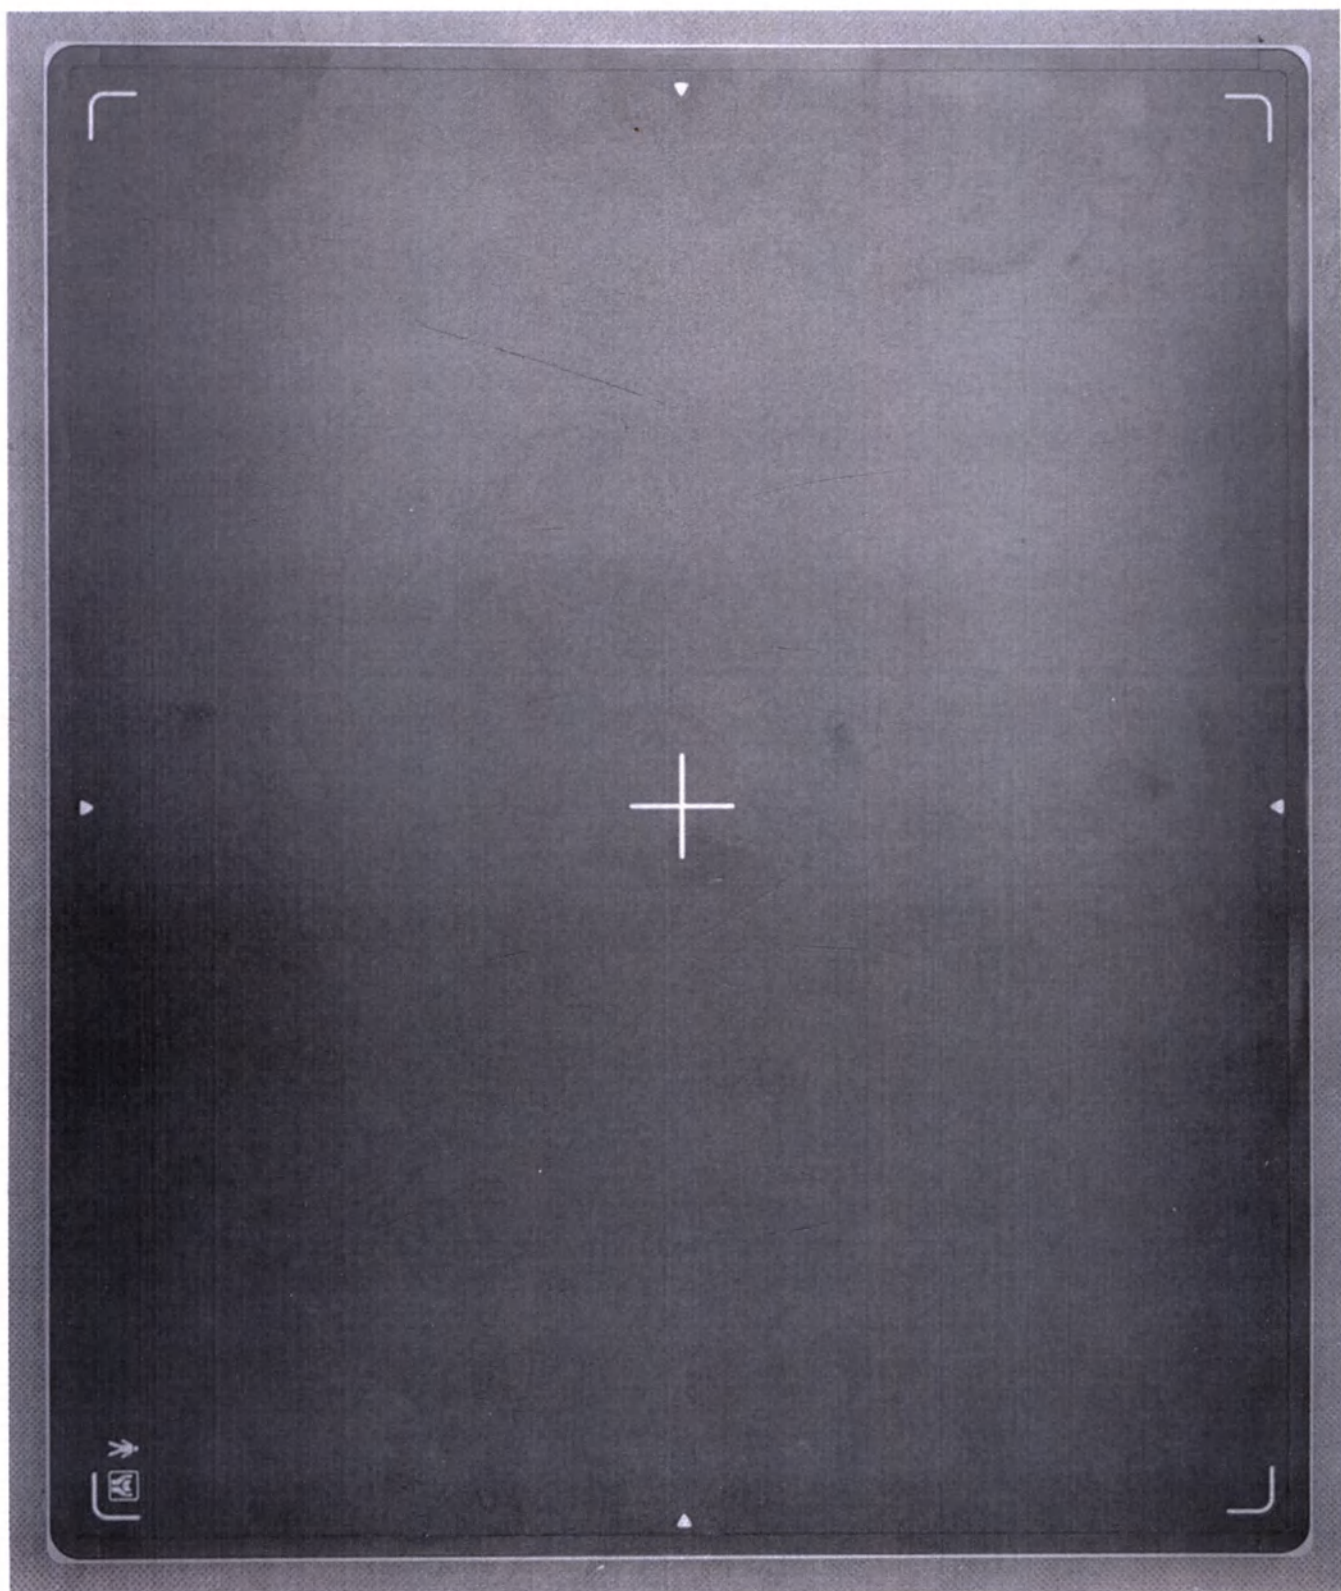


Детектор плоскпанельный рентгеновский статический «ДПРС 3643»

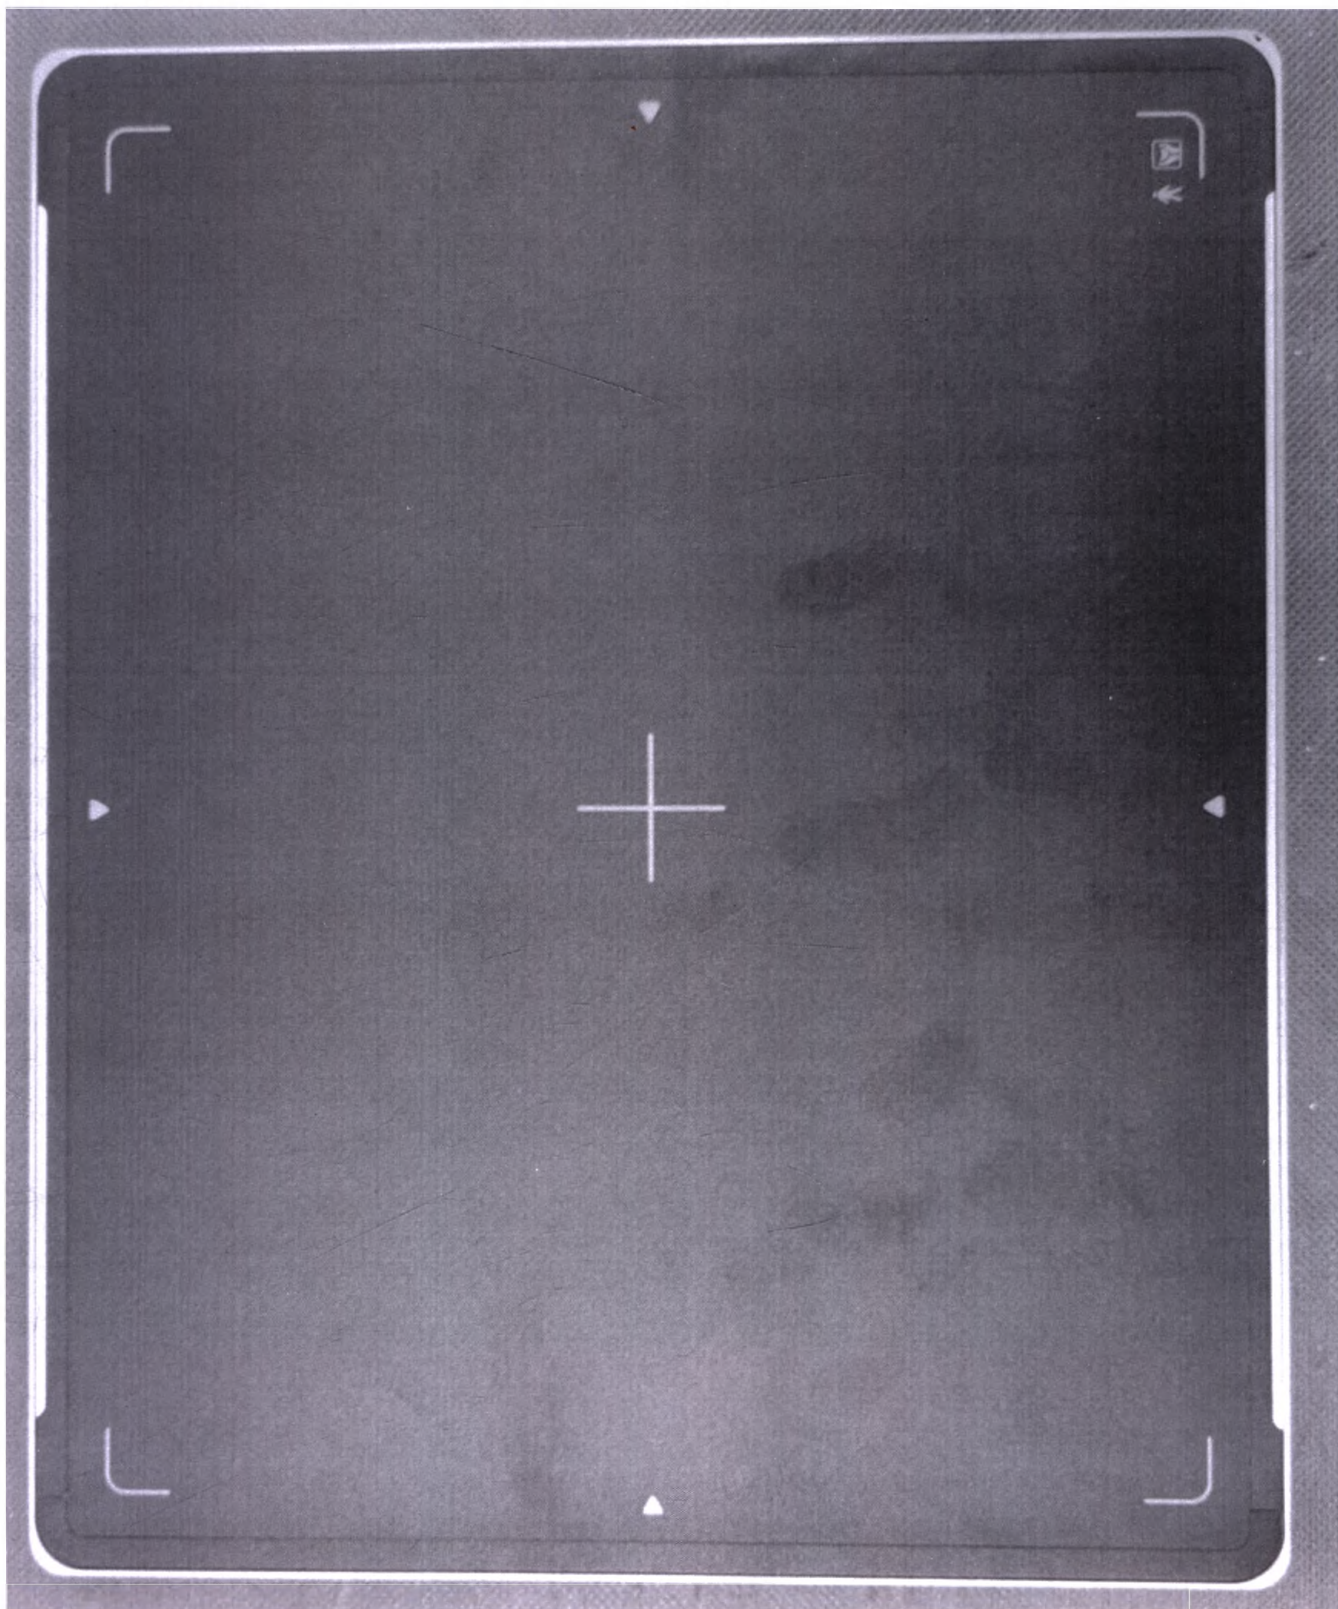


Детектор плоскпанельный рентгеновский статический «ДПРС 2430»

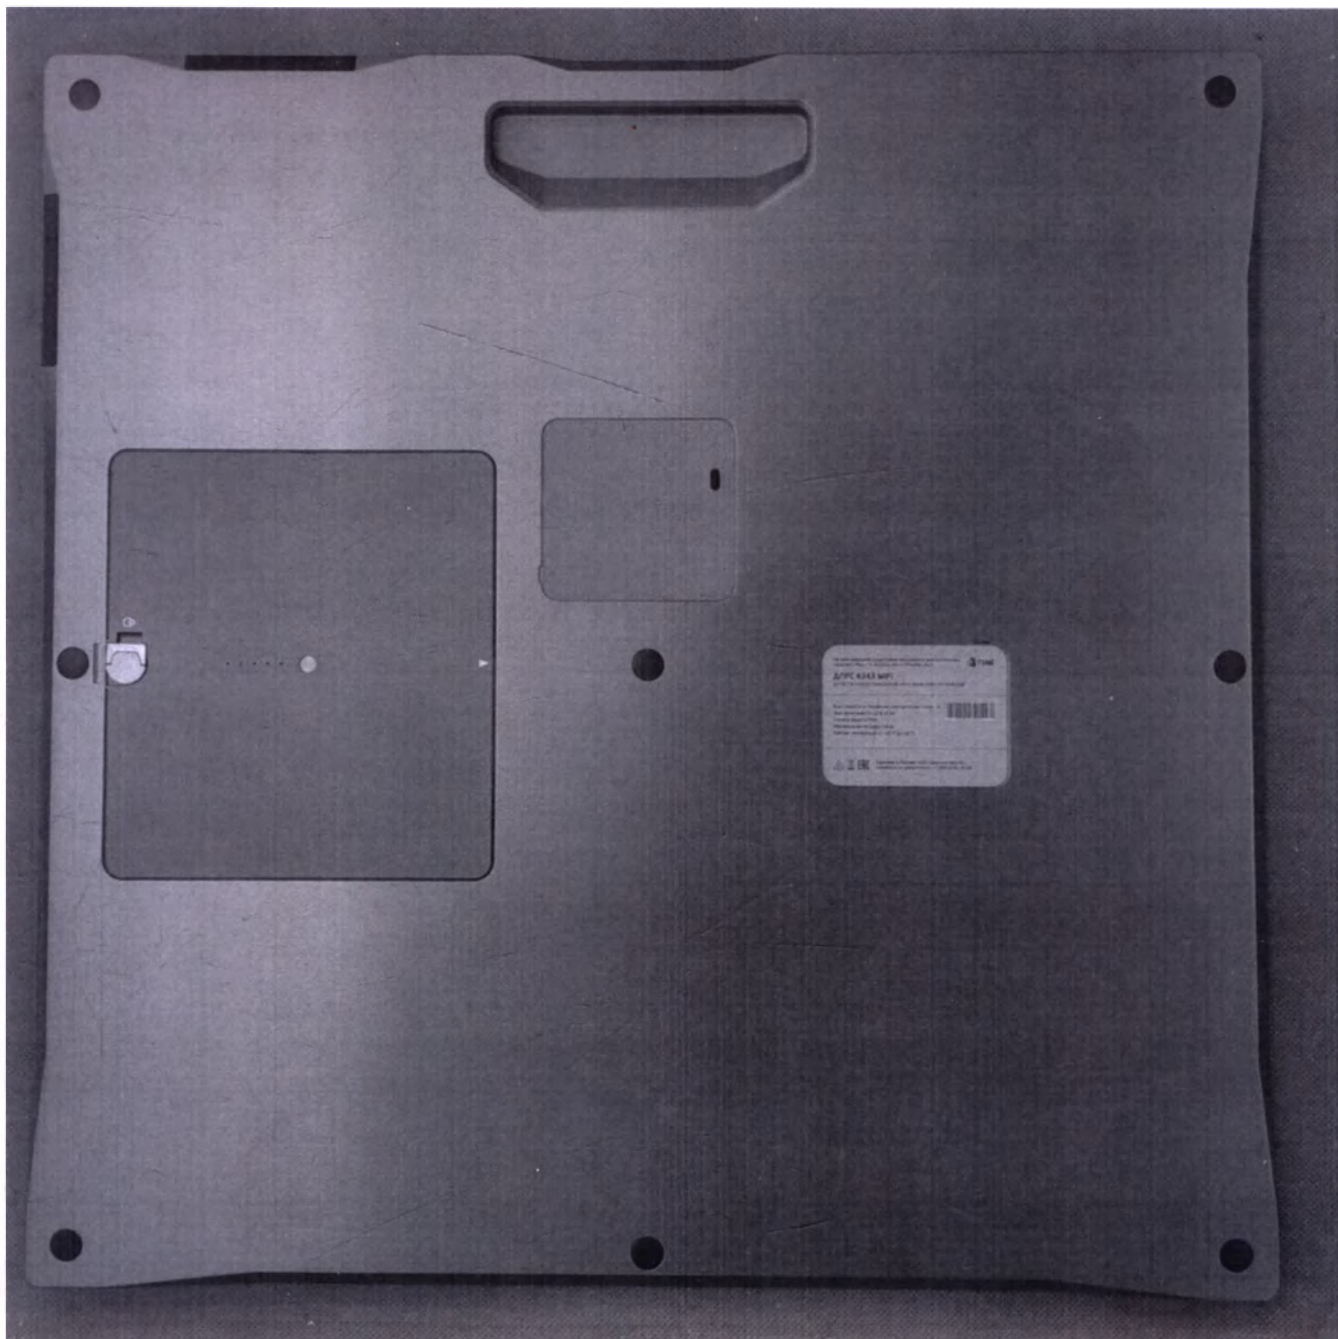


Детектор плоскпанельный рентгеновский статический «ДПРС 4343WiFi»

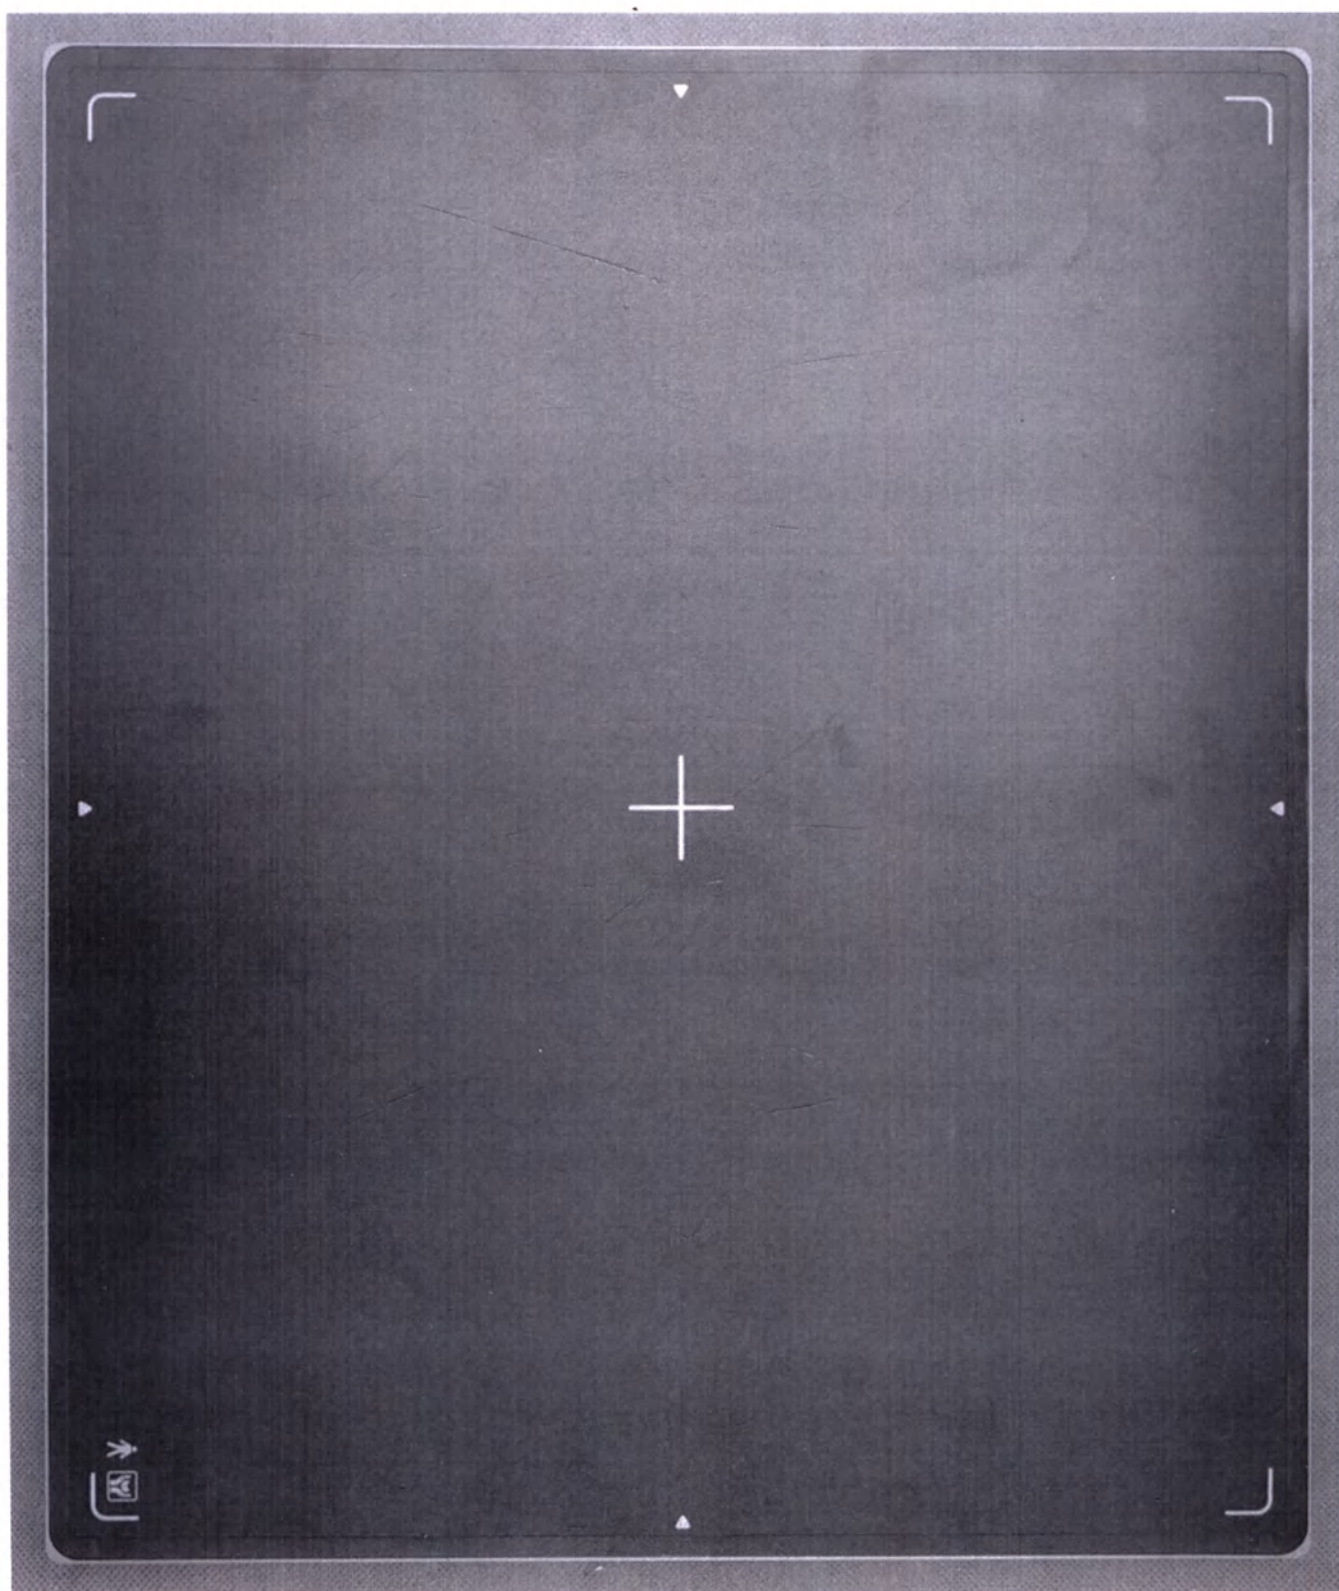


Детектор плоскпанельный рентгеновский статический «ДПРС 3643WiFi»

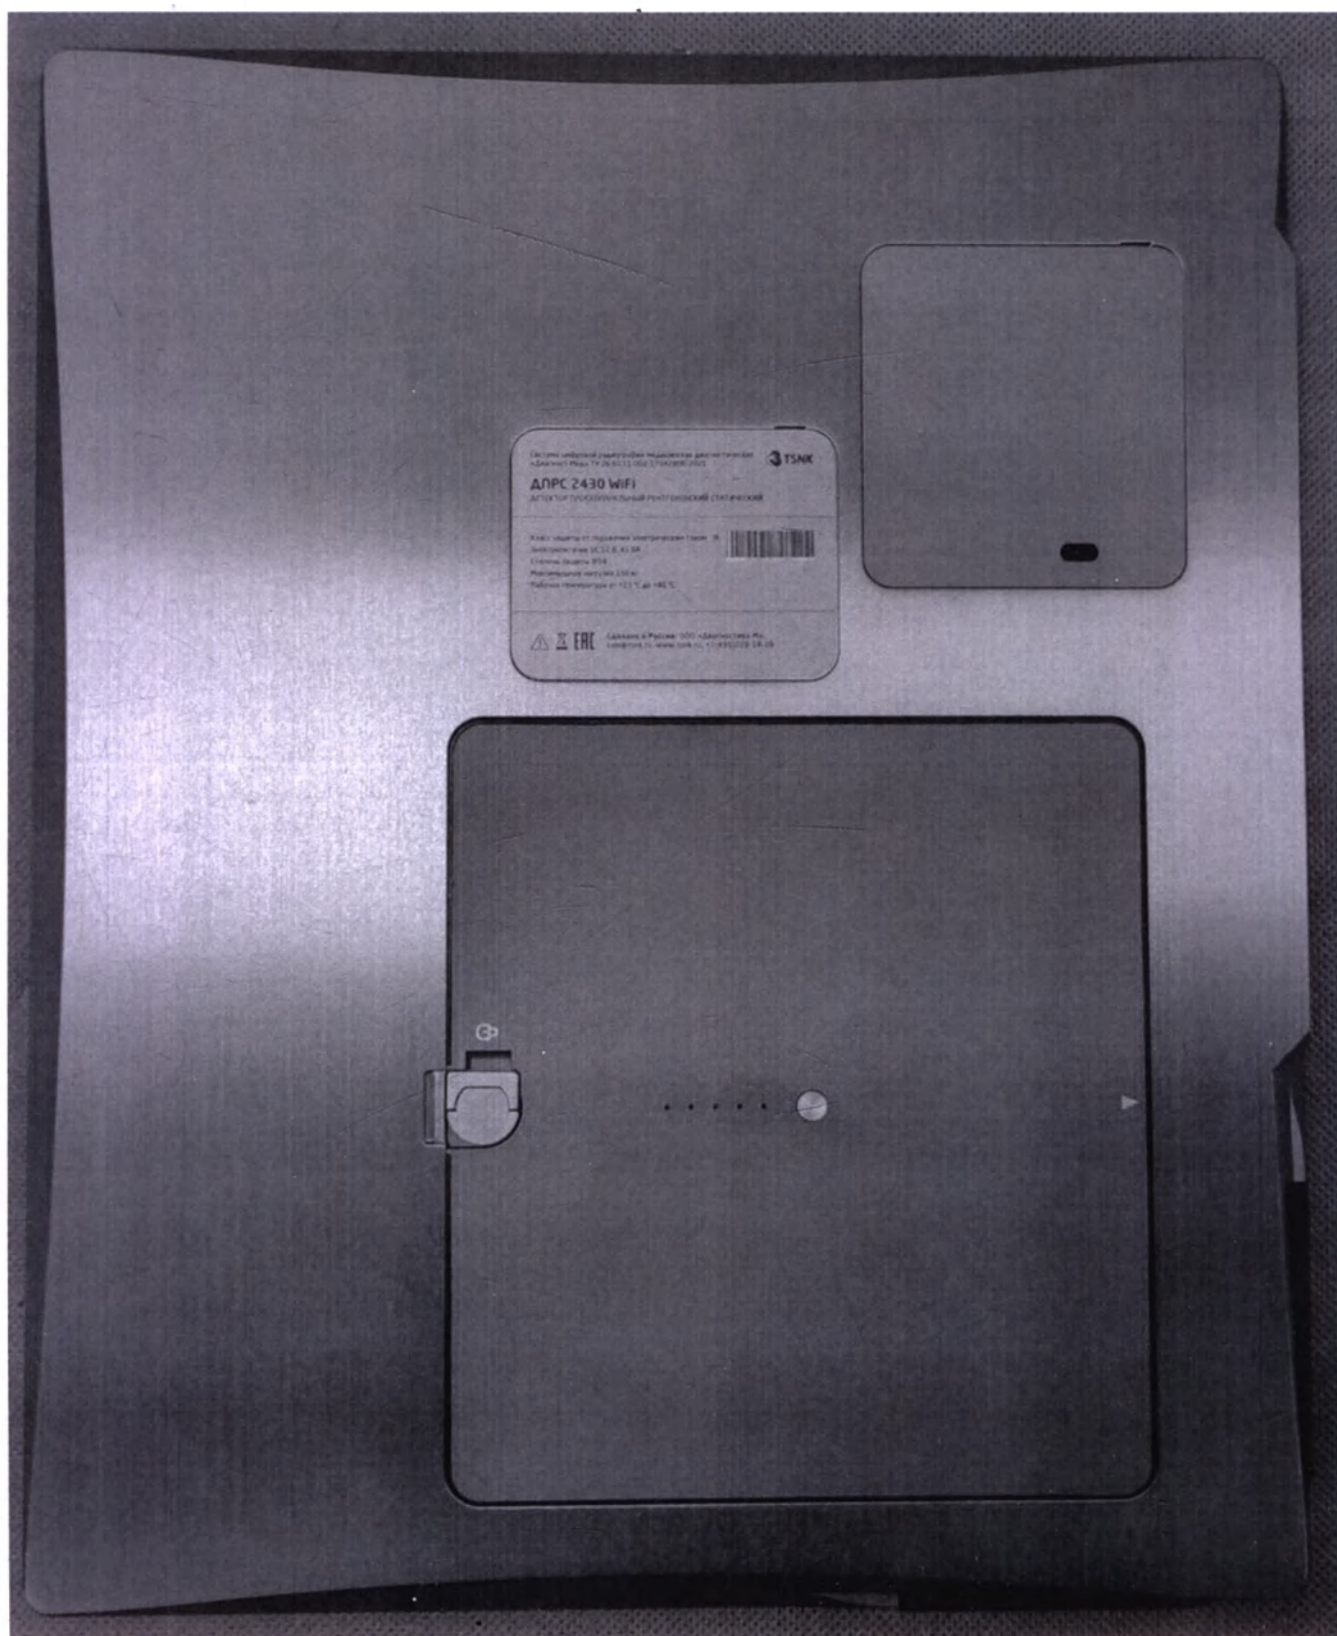

Детектор плоскпанельный рентгеновский статический «ДПРС 2430WiFi»

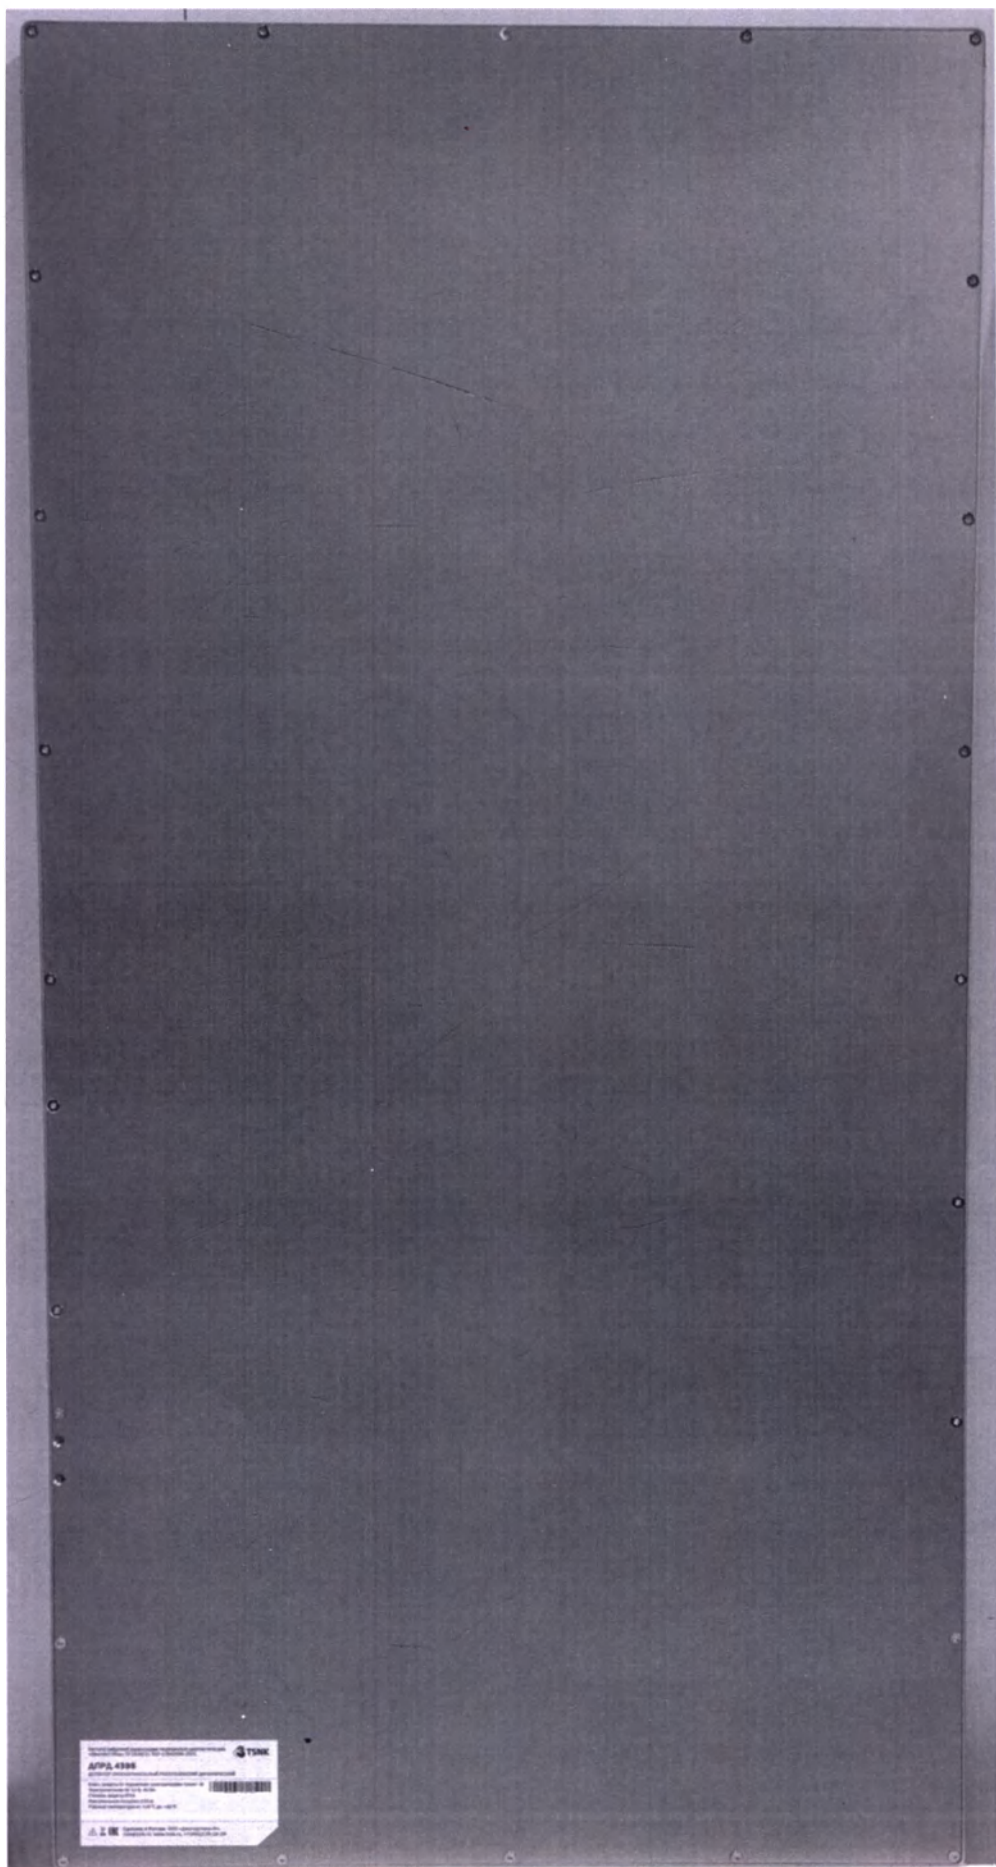


Детектор плоскпанельный рентгеновский статический «ДПРС 4386»

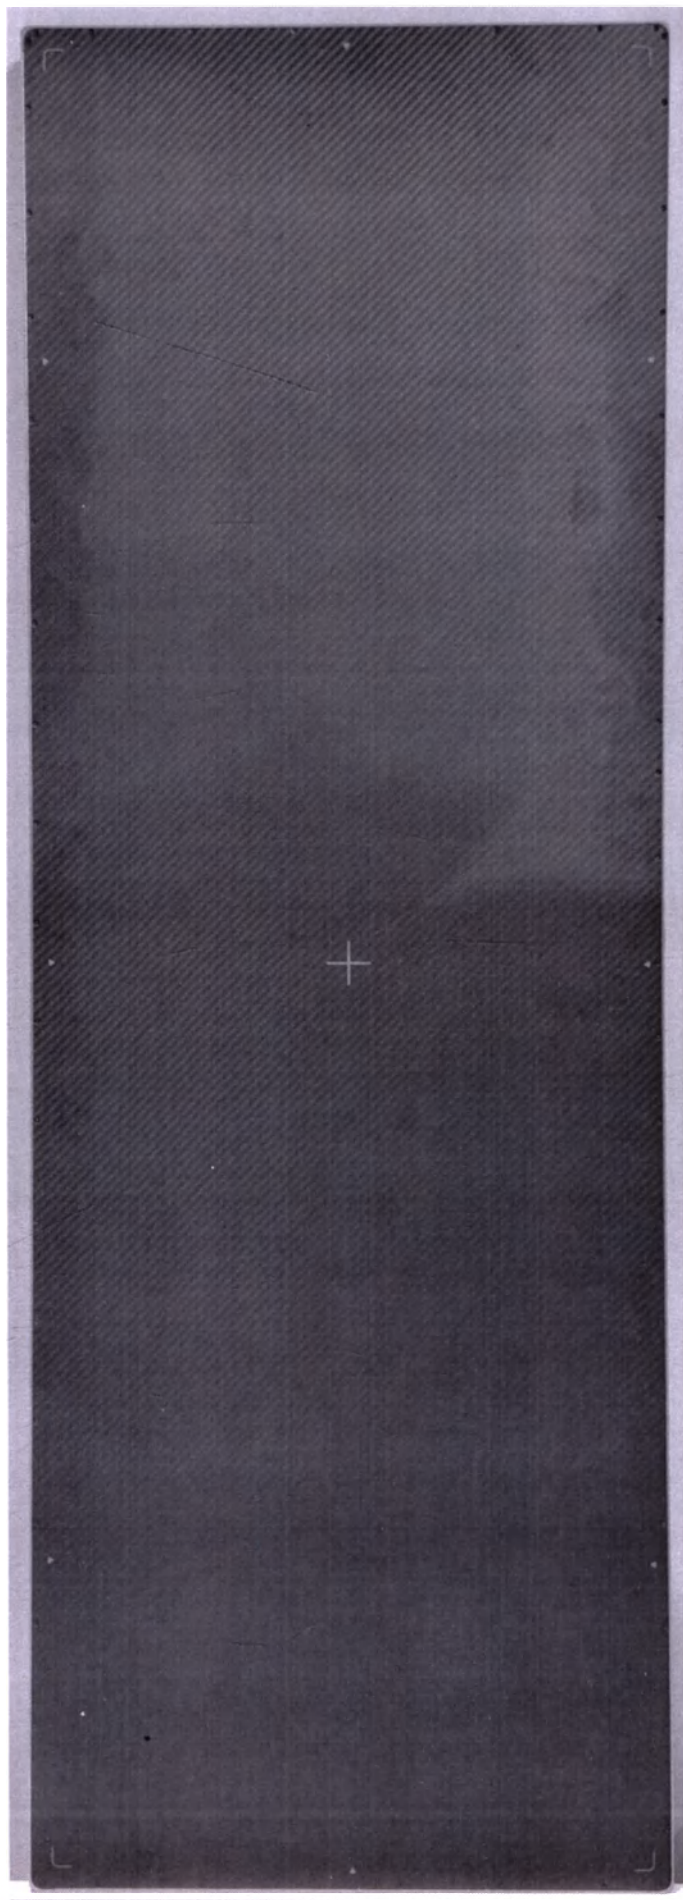


Детектор плоскпанельный рентгеновский статический «ДПРС 43129»




Модуль питания и синхронизации

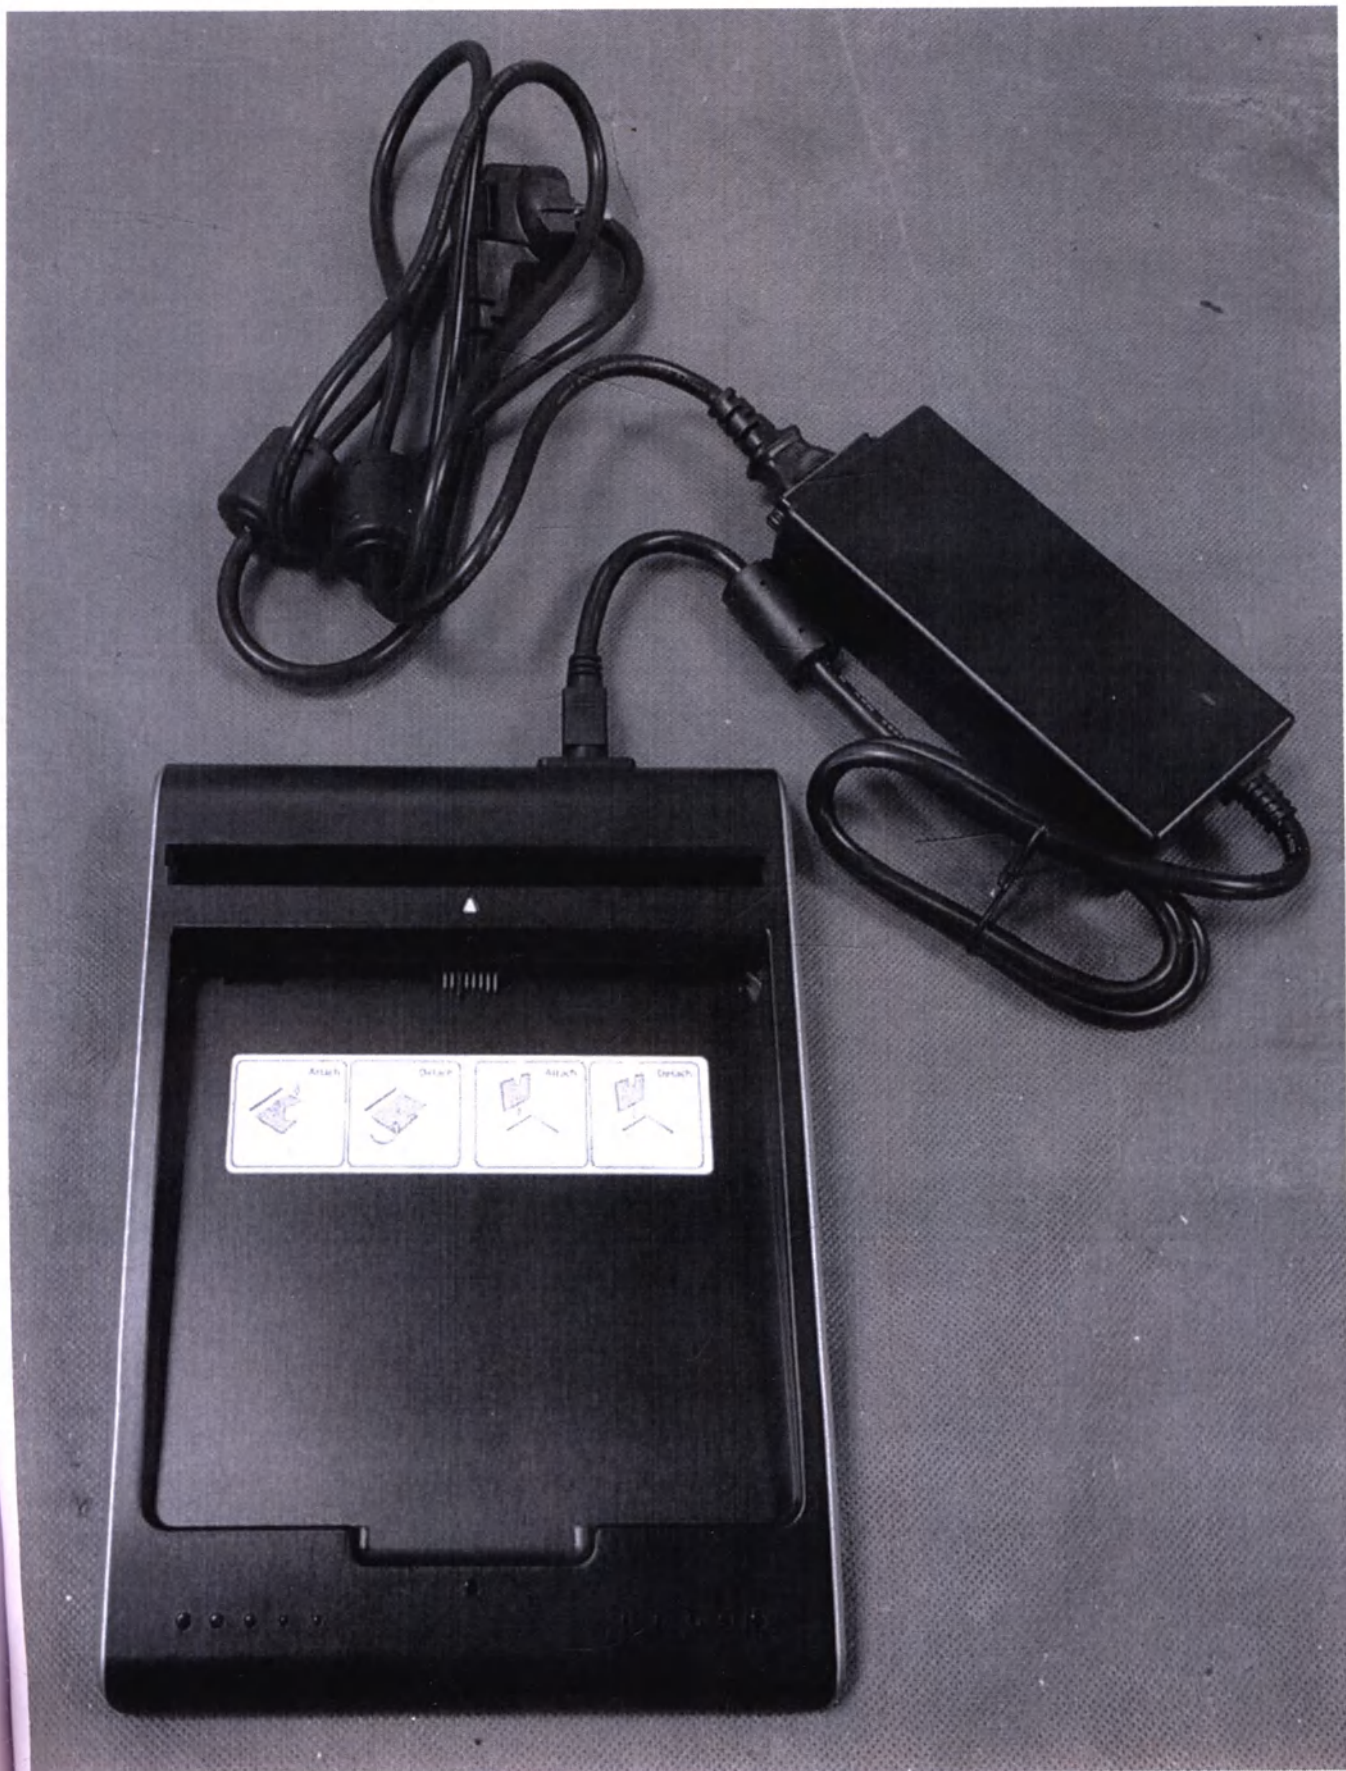

Зарядное устройство для аккумуляторов детекторов с WiFi

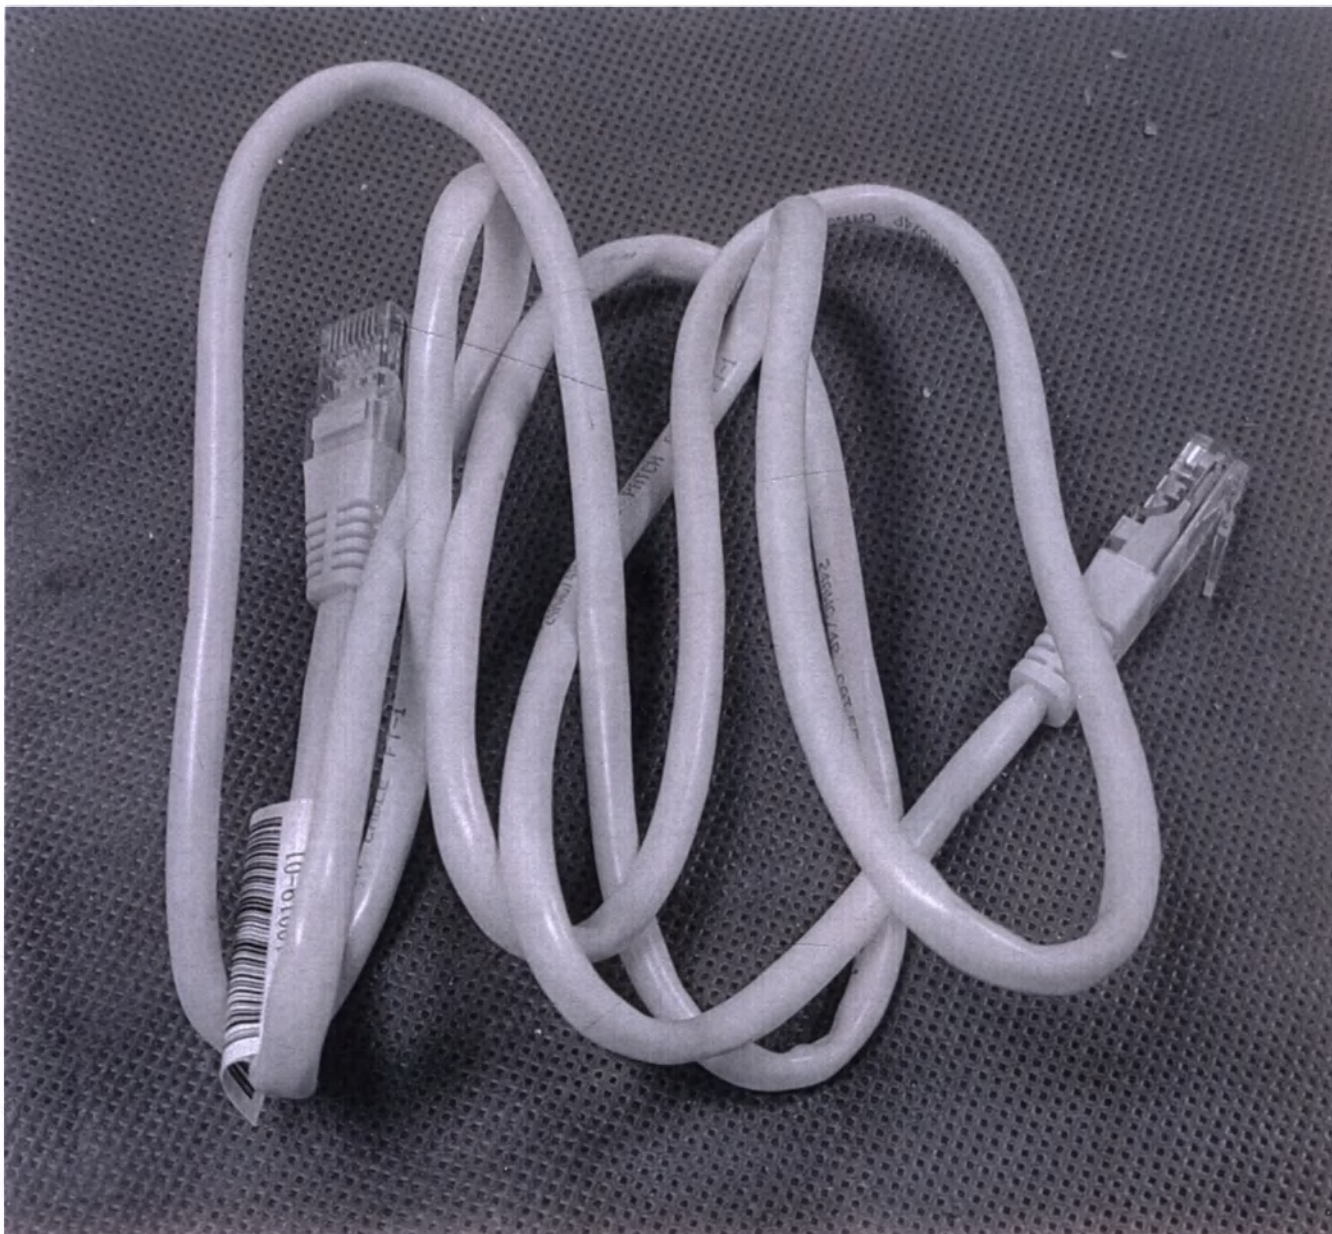


Кабель Ethernet 1м

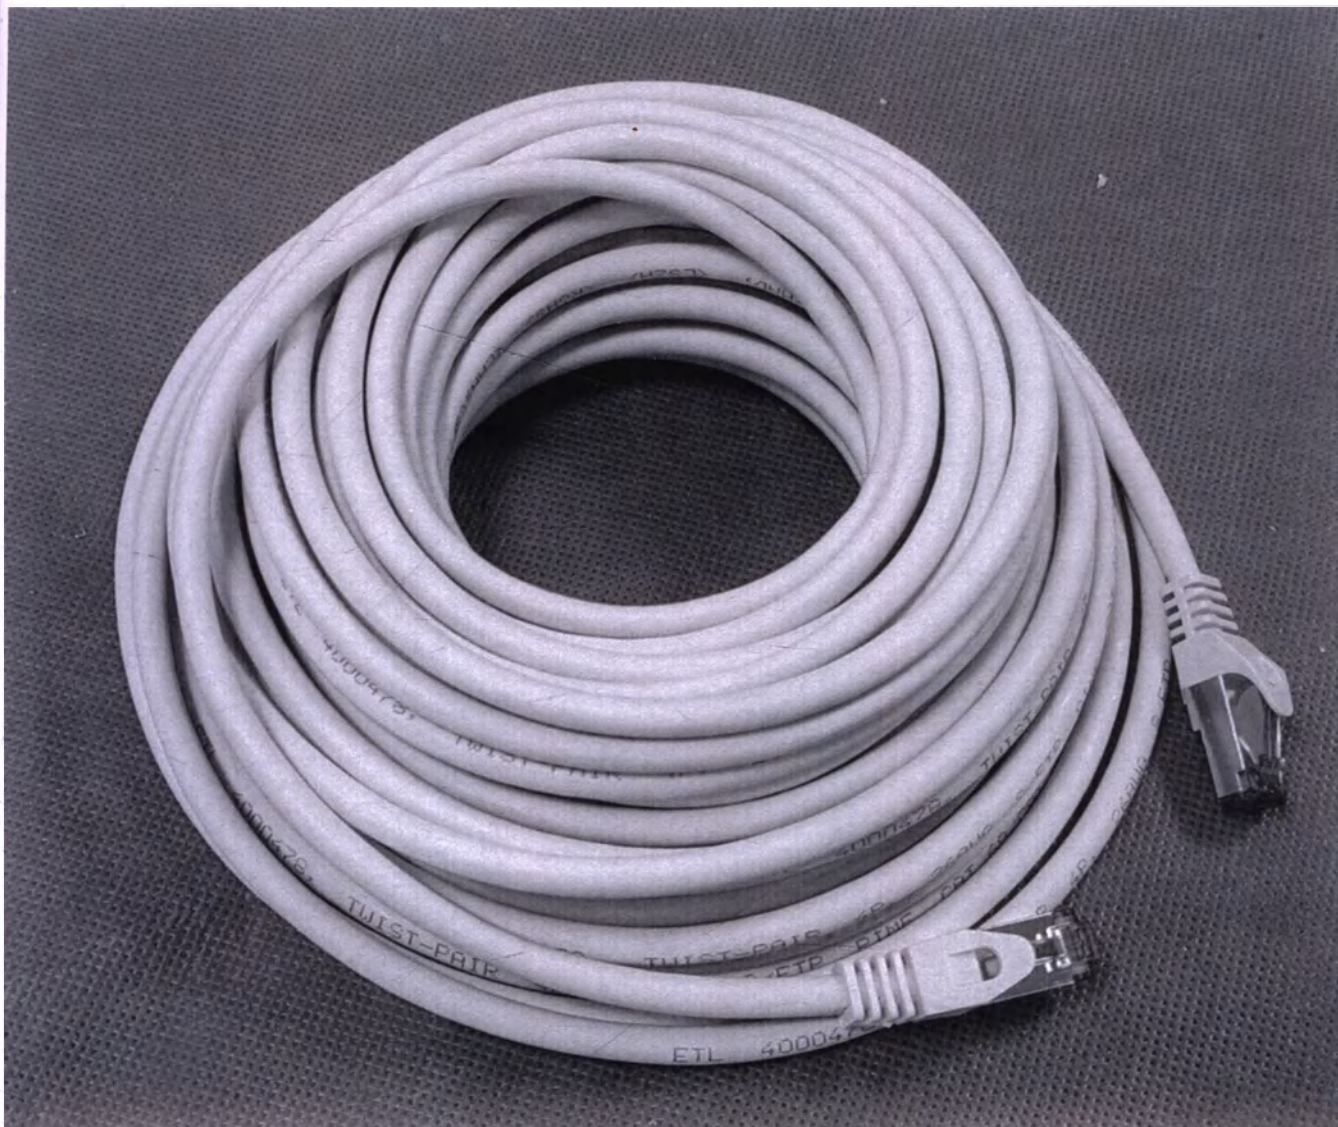

Кабель Ethernet 15м




Кабель HDMI 2м

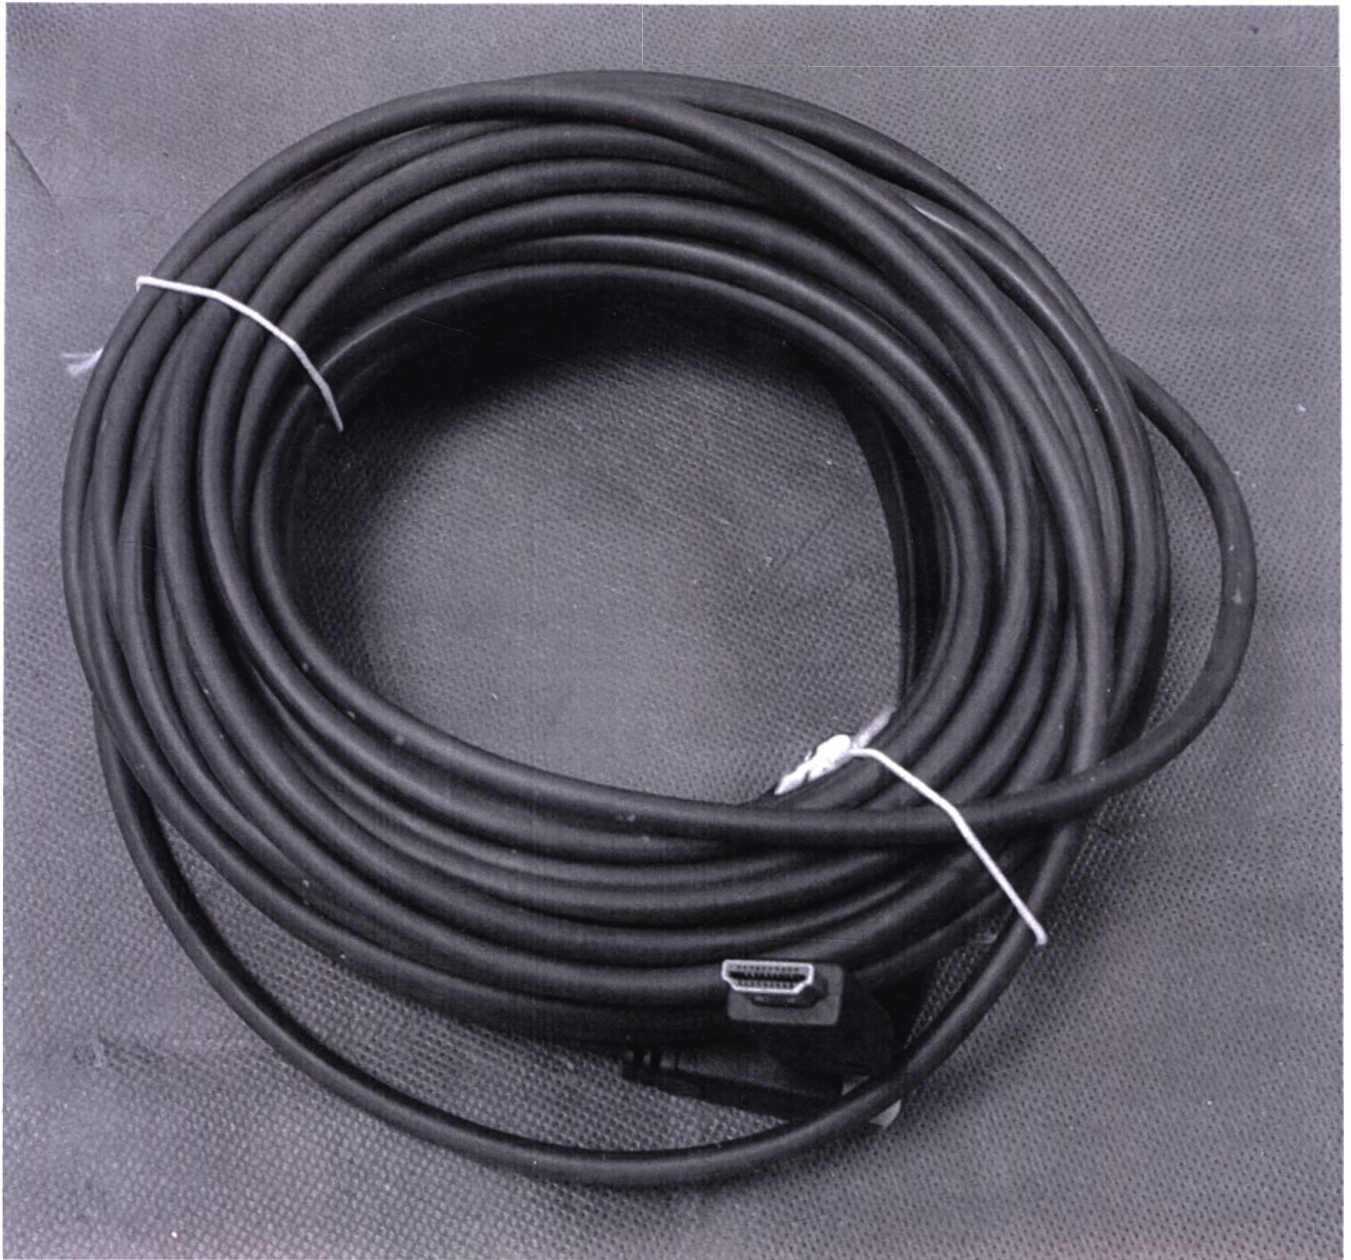


Кабель HDMI 20м



Блок преобразования USB - HDMI

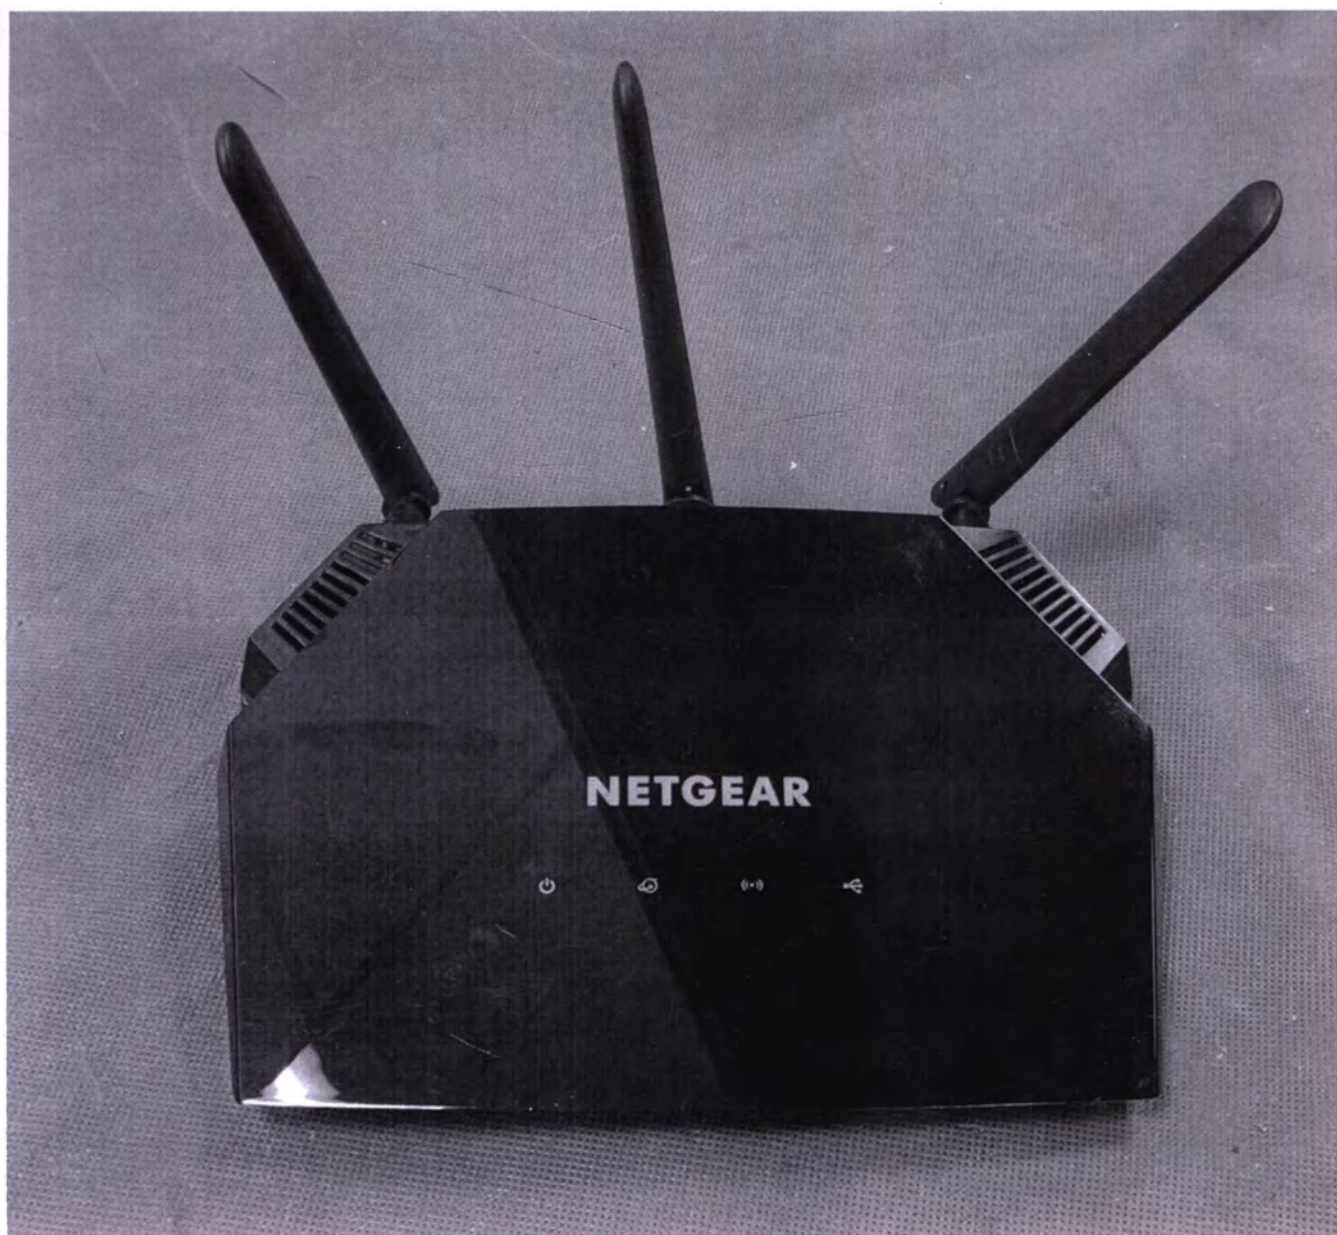

Маршрутизатор с WiFi

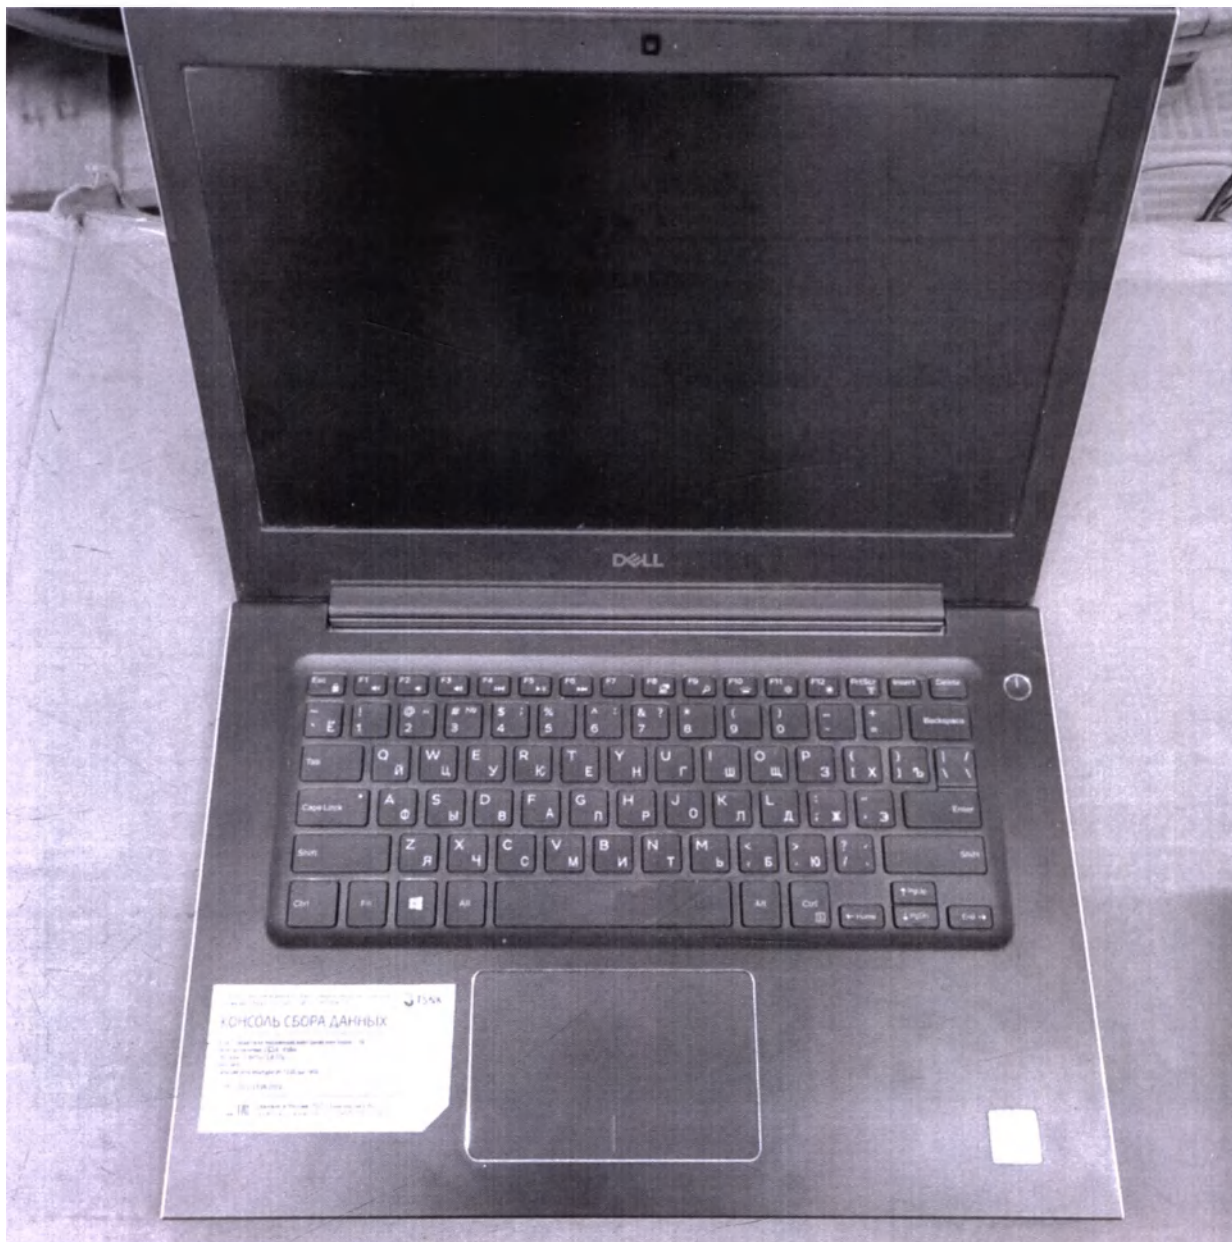


Консоль сбора данных




АКБ для ДПРС 2430WiFi марк



АКБ для ДПРС 2430WiFi

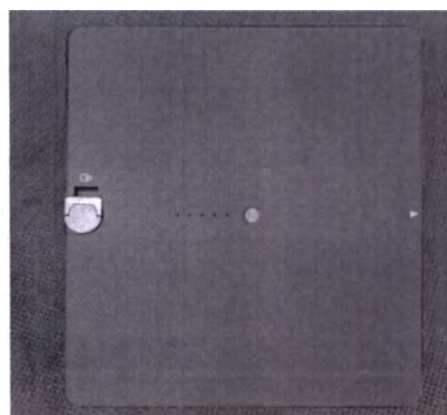

АКБ для ДПРС 3643WiFi и 4343WiFi

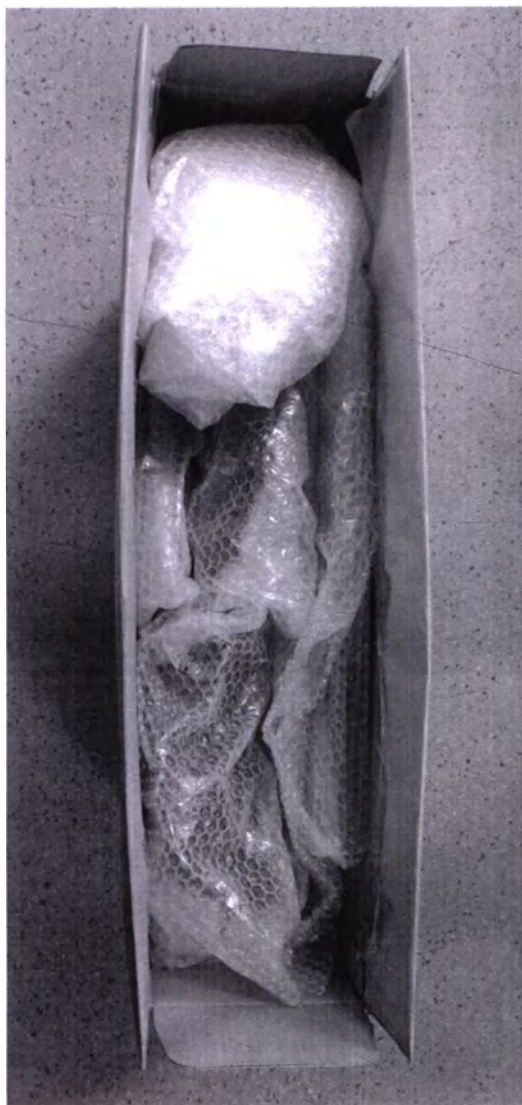

Система рентгеновская диагностическая для преобразования цифровых изображений «Диагност-Мед» ТУ 26.60.11-002-17942806-2021		 ТSNK
Детектор ДЛРС 4343WiFi Детектор ДЛРС 2430WiFi Блок питания детекторов с WiFi Зарядное устройство для аккумулятора Аккумулятор детектора ДЛРС 4343WiFi Аккумулятор детектора ДЛРС 2430WiFi Кабель Ethernet 1м Кабель блока питания 1 м Блок преобразования USB - HDMI Маршрутизатор с WiFi СПО для сбора и хранения данных на флэш-носителе	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Артикул: ГОРУЧШЭЮ Дата производства: 19 июня 2021		
Сделано в России: ООО «Диагностика-М», sale@tsnk.ru, www.tsnk.ru, +7(495)228-18-28		

Упаковка медицинского изделия.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

Дебет на рубль
цифрами прописью

) ЛИСТОВ

Генеральный директор
ООО «Диагностика-М»

В.Е. Усачев
В.Е. Усачев

М.П.

