

Фотографические изображения медицинского изделия
Система цифровая рентгенографическая Discovery XR656 HD
с принадлежностями

УТВЕРЖДАЮ


**Директор департамента
 регистрации и сертификации, Россия и СНГ
 ООО «ДжиИ Хэлскеа»
 А.П. Харитонов**



А.П. Харитонов
 «23» *декабря* 2022 г.

Подвес потолочный для трубки рентгеновской.




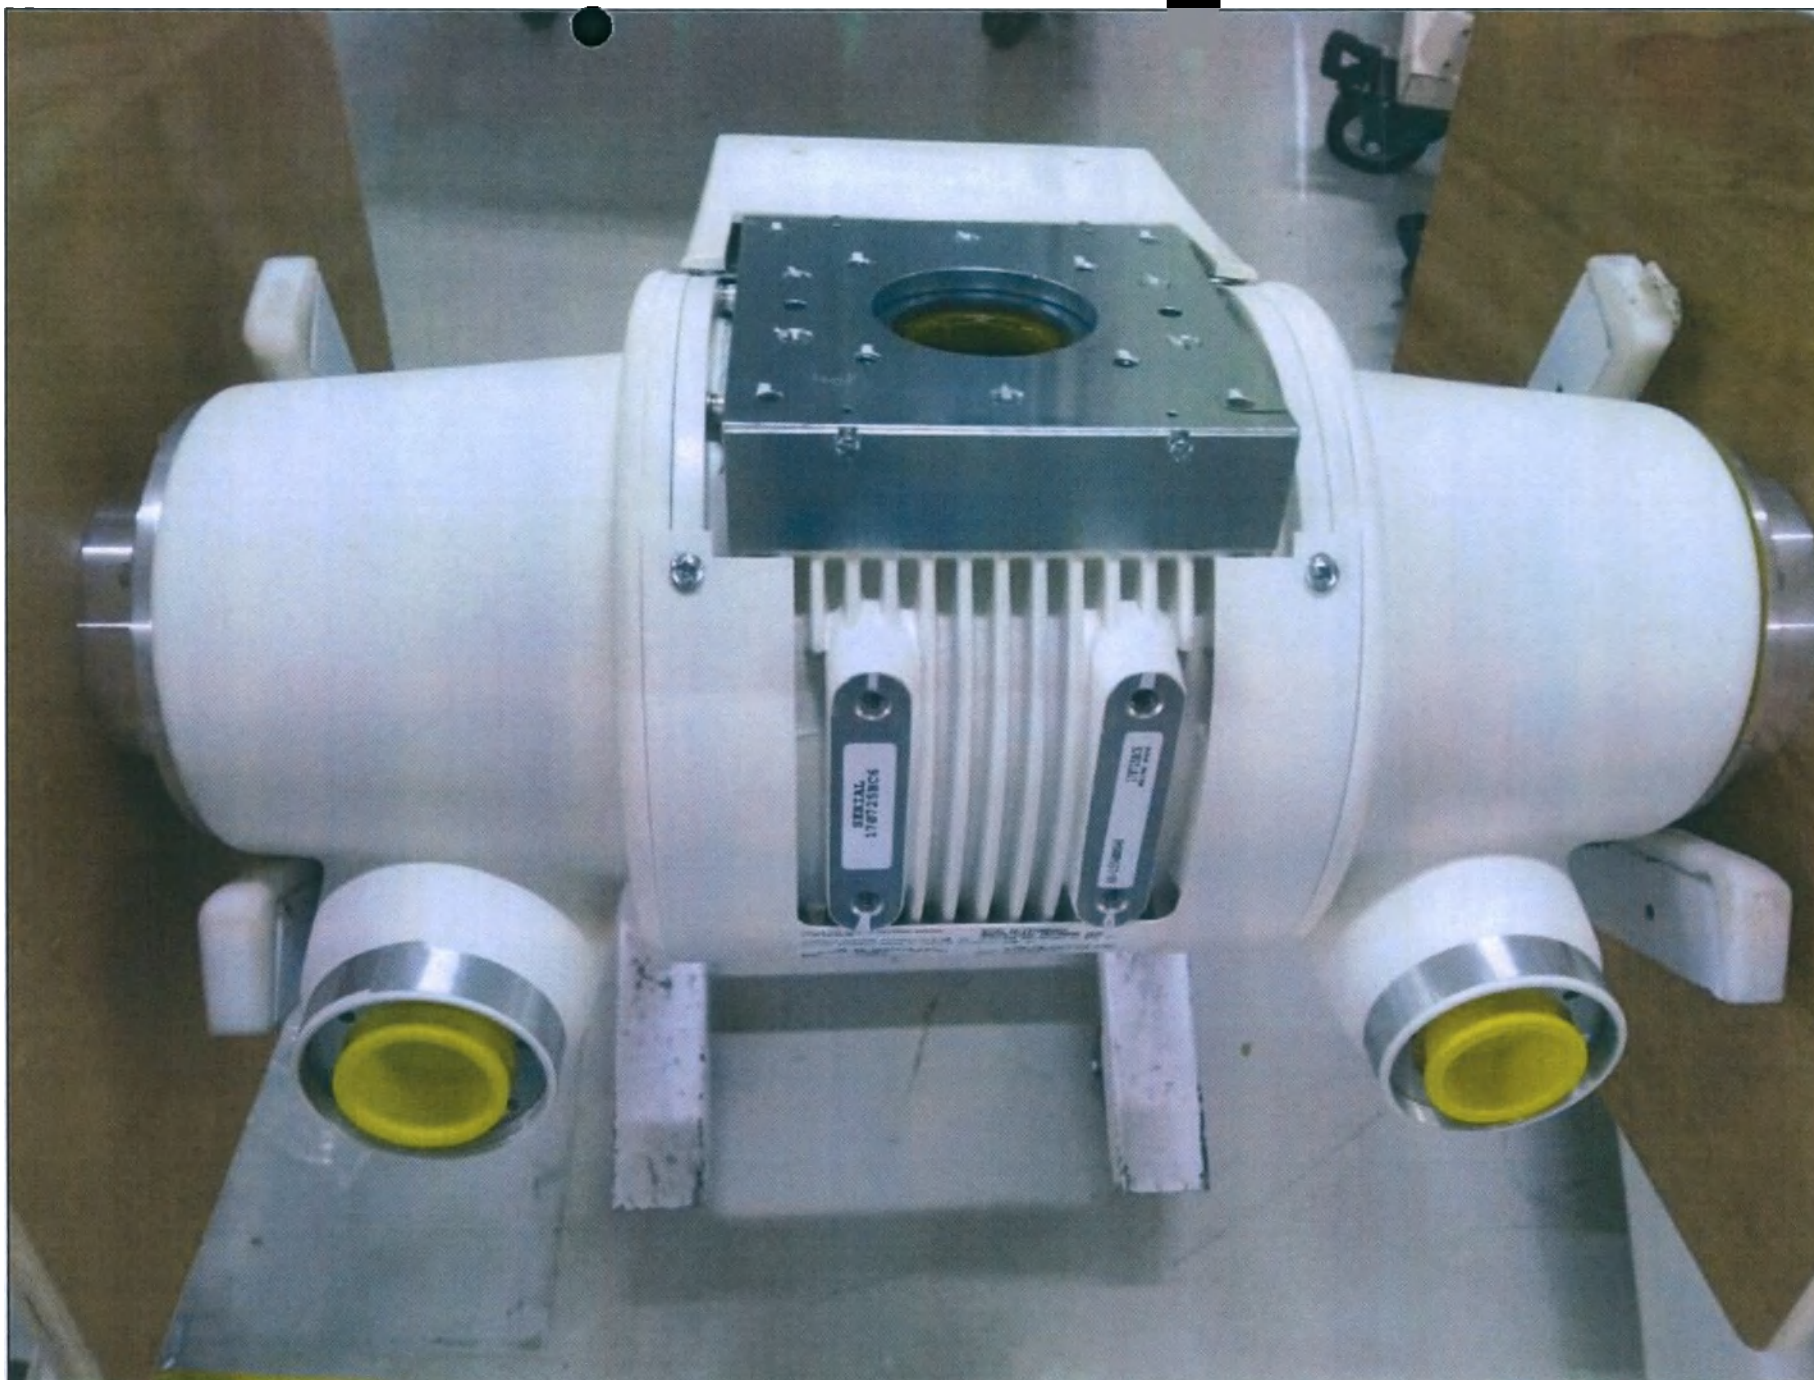

Трубка рентгеновская.



Трубка рентгеновская.

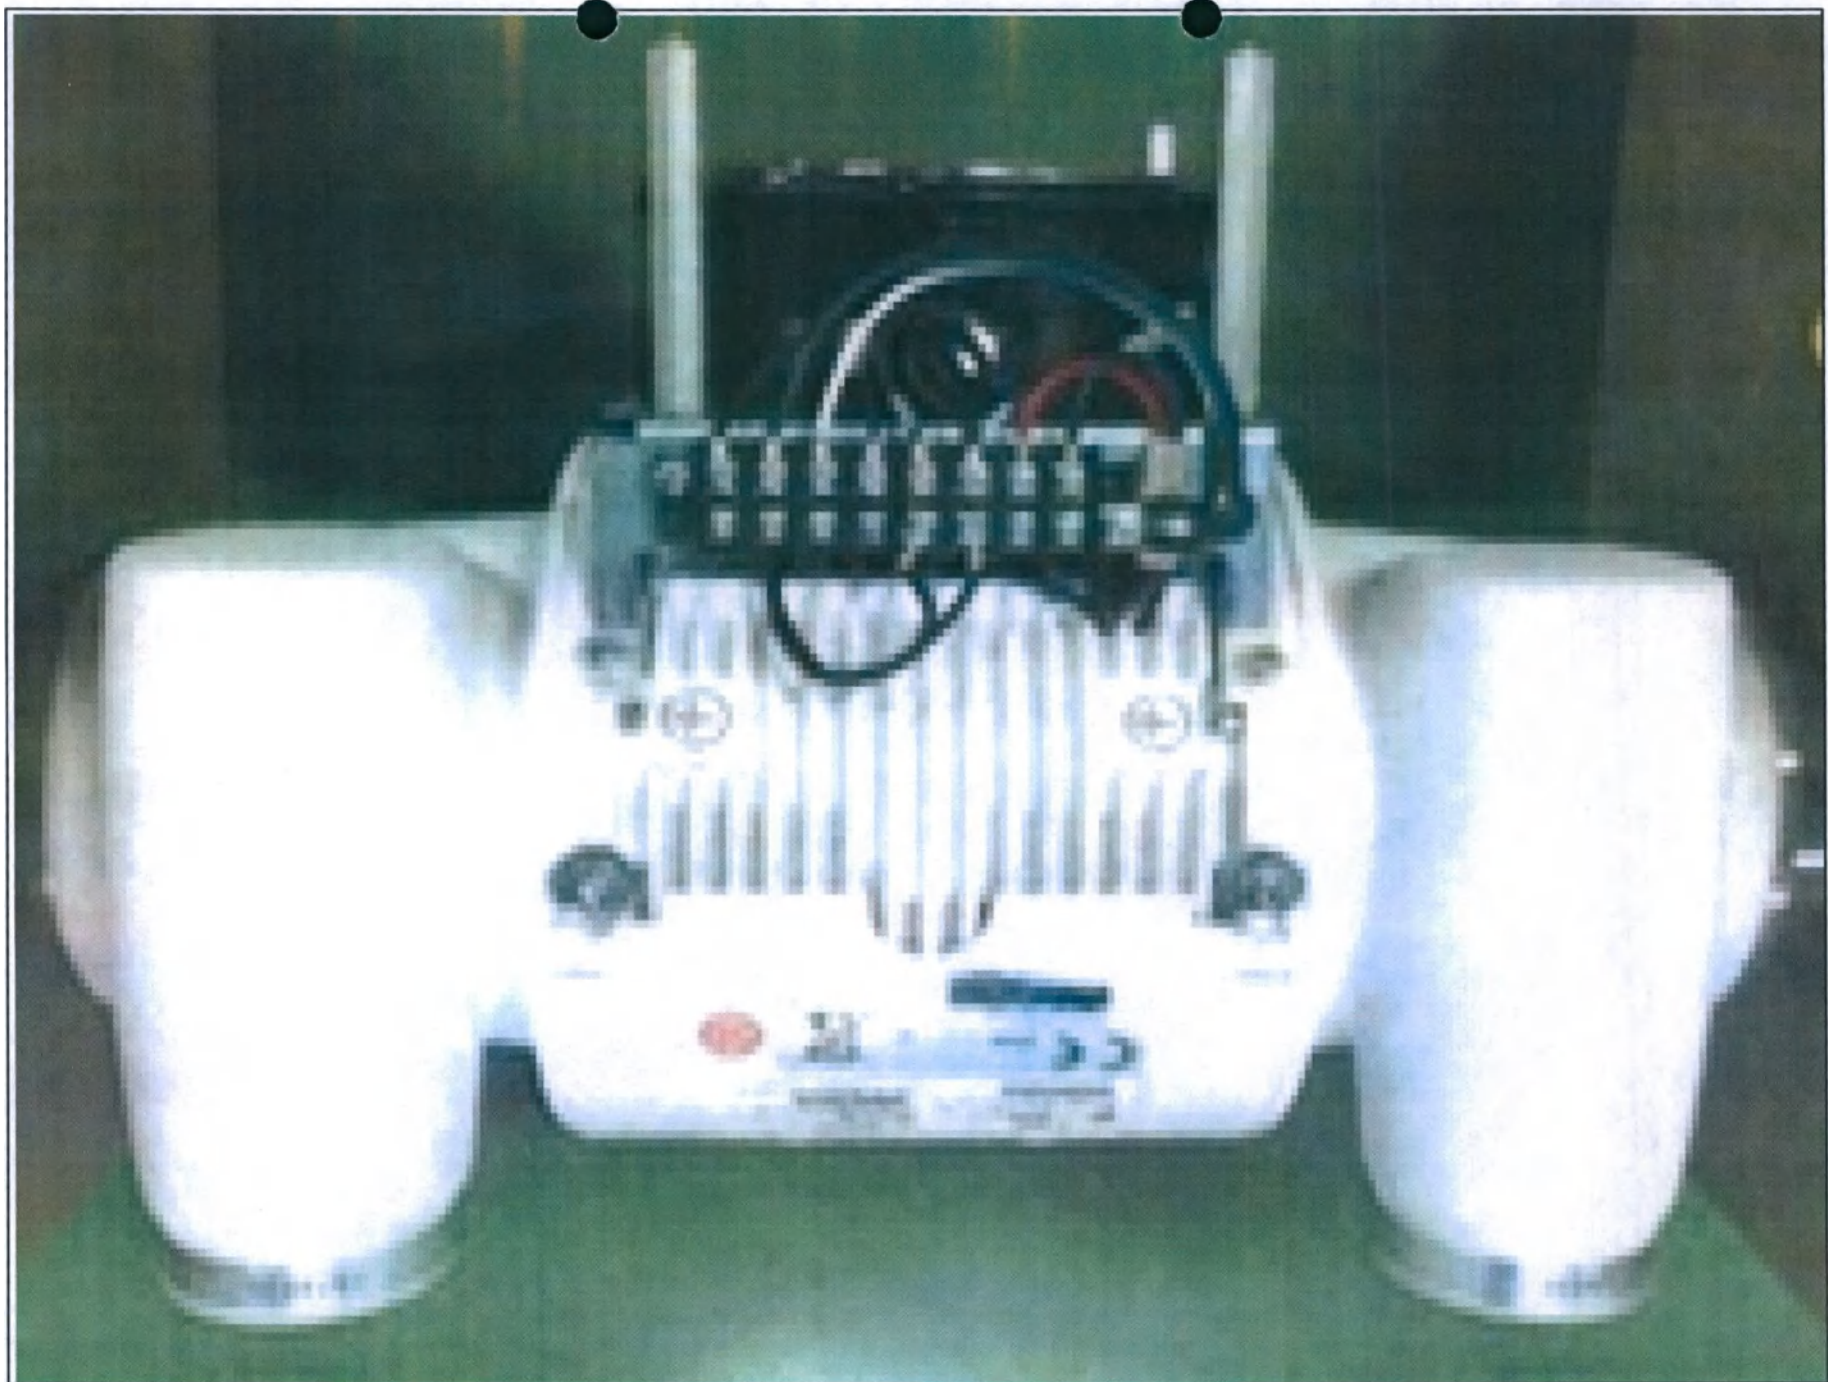

Трубка рентгеновская.



Коллиматор многолепестковый.

Высокочастотный генератор.






Высокочастотный генератор.




Пульт дистанционного управления позиционированием.

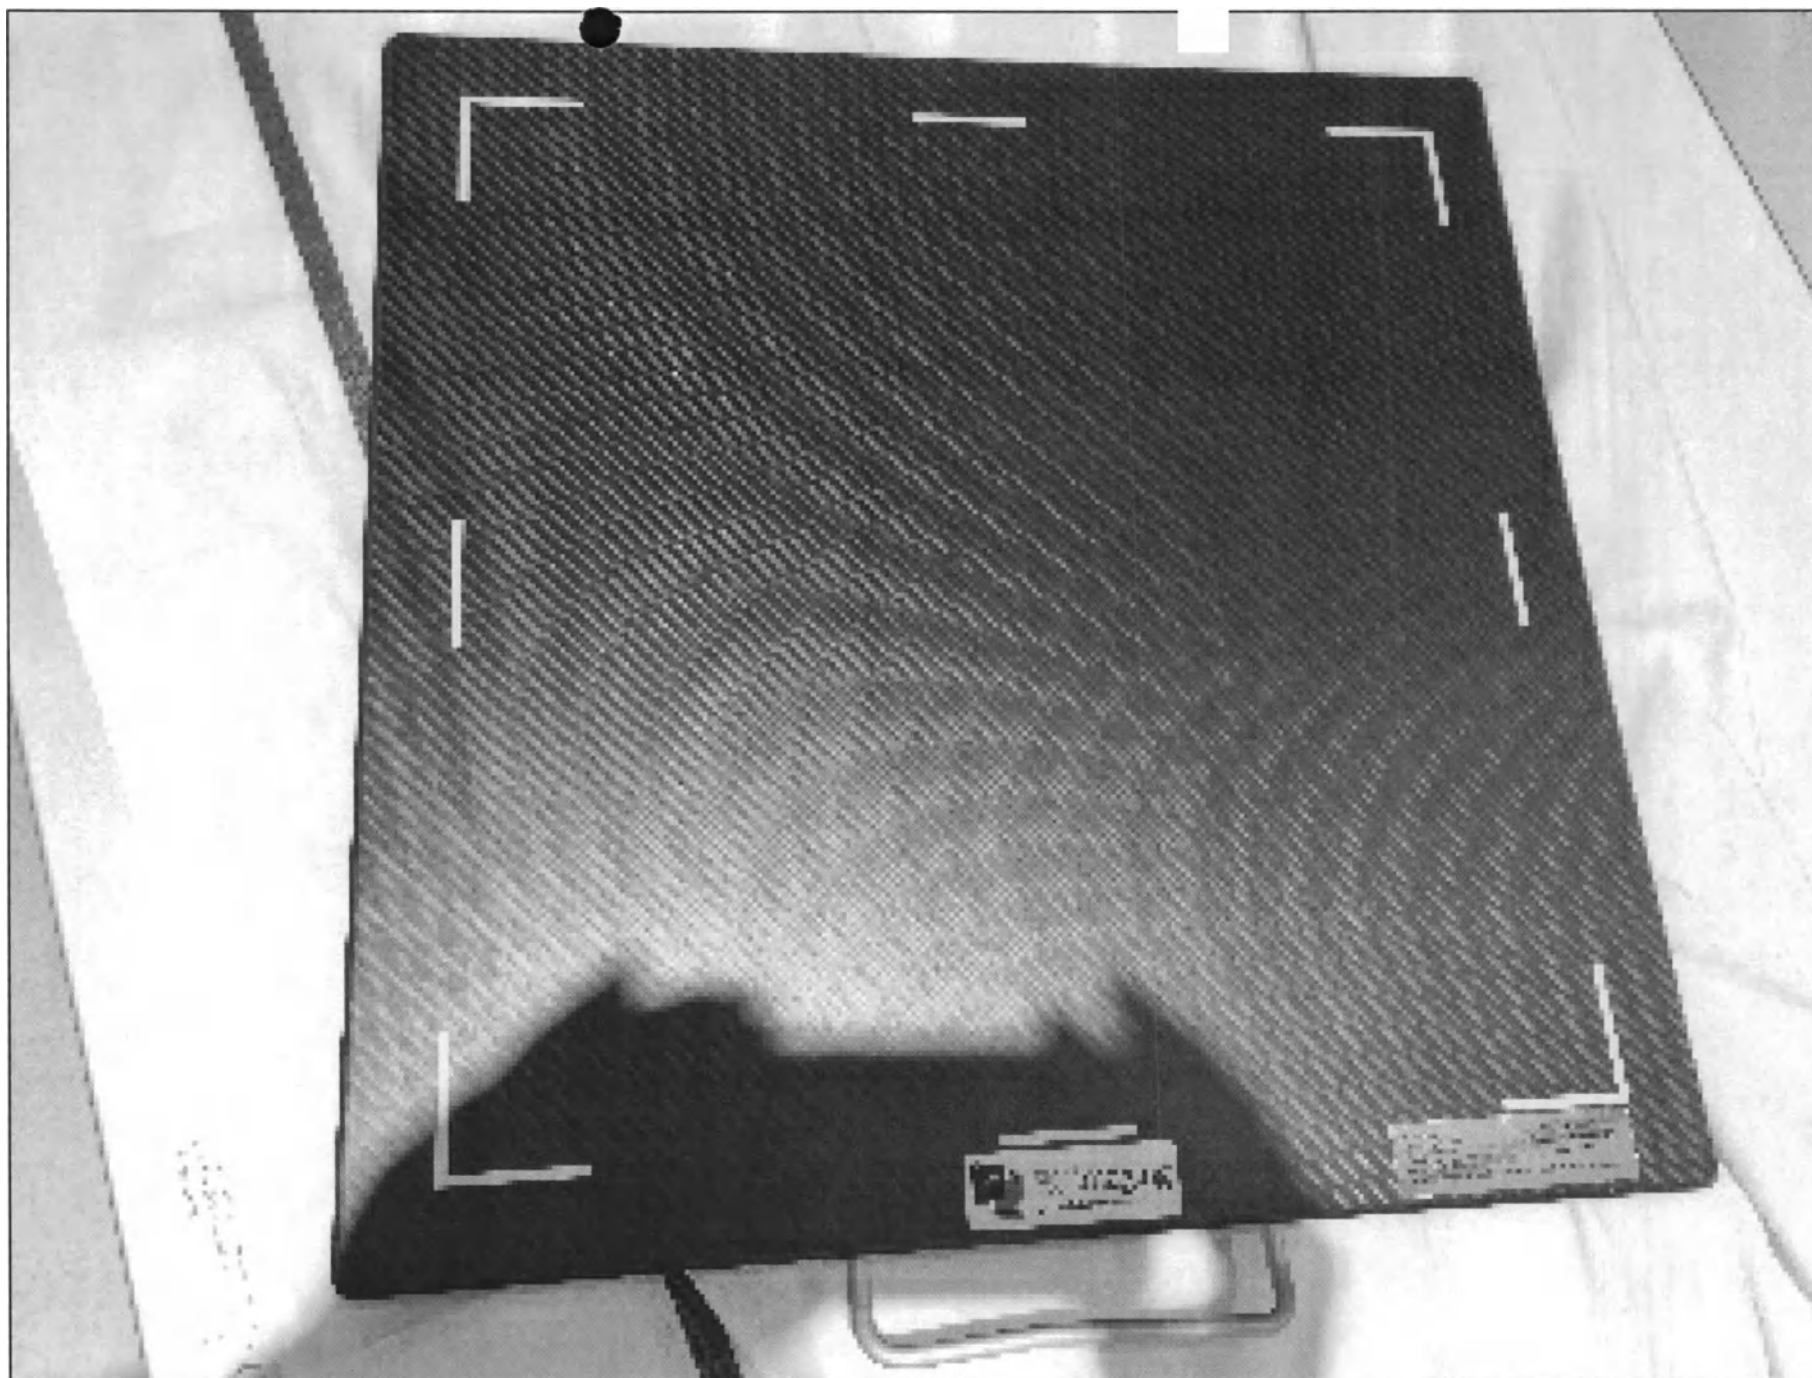

Детекторы беспроводные FlashPad HD.

Штатив настенный со стандартным кронштейном.

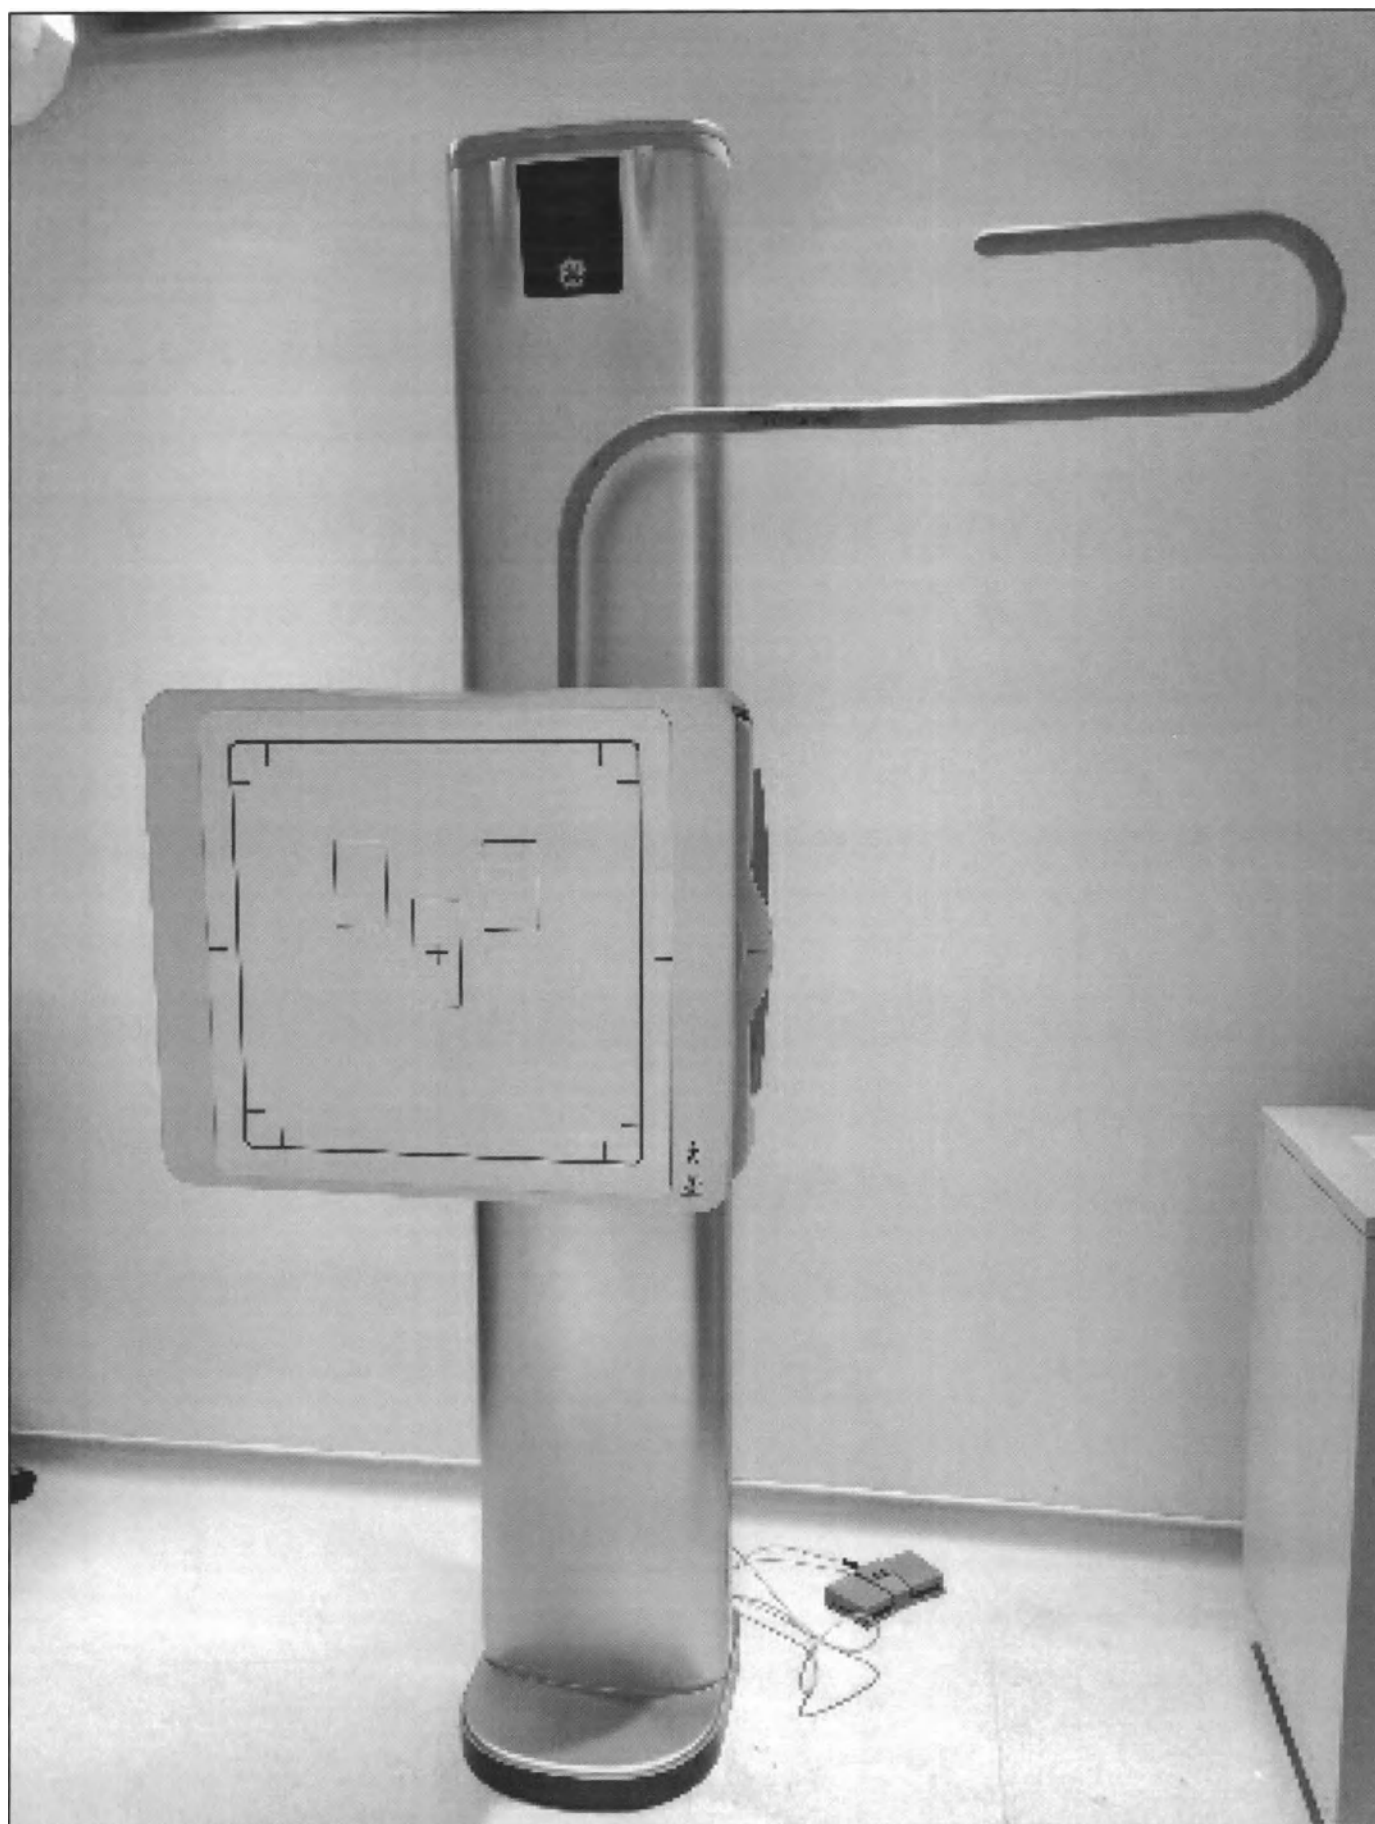

Штатив настенный с удлинённым кронштейном.





Стол для цифровой рентгенографии.

GE Healthcare

Discovery XR656 HD

Цифровая рентгенографическая система

Руководство оператора


5496960-1RU

Ред. 8

Компания GE осуществляет коммерческую деятельность под наименованием GE Healthcare

Discovery XR656 HD
Цифровая рентгенографическая система
Руководство оператора, на русском языке
5496960-1RU
Редакция 8
© 2017 - 2022 General Electric Company, все
права защищены.



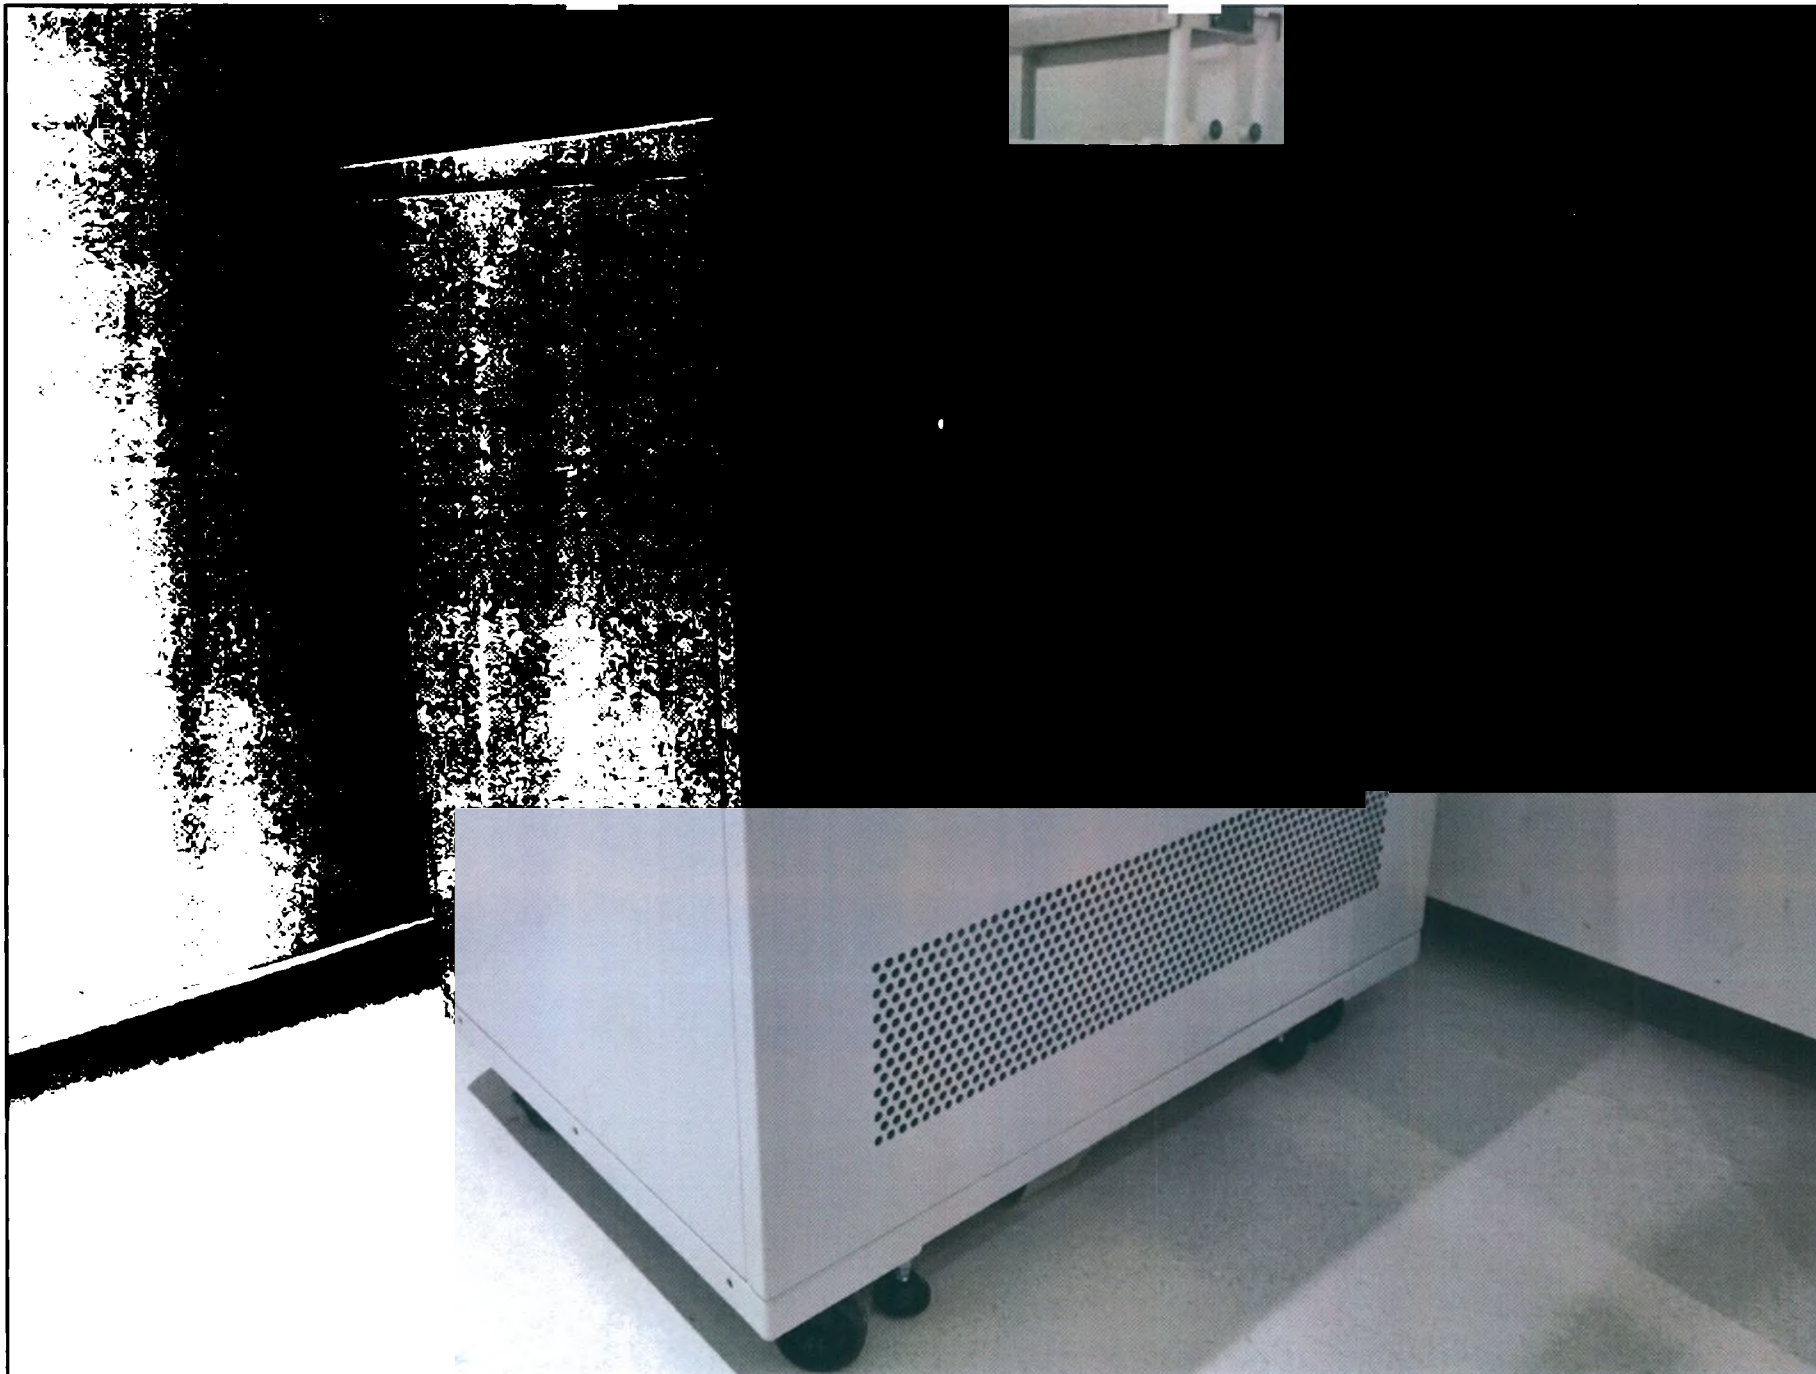


Системный шкаф.

Аккумуляторы для детекторов.



Аккумуляторы для детекторов.

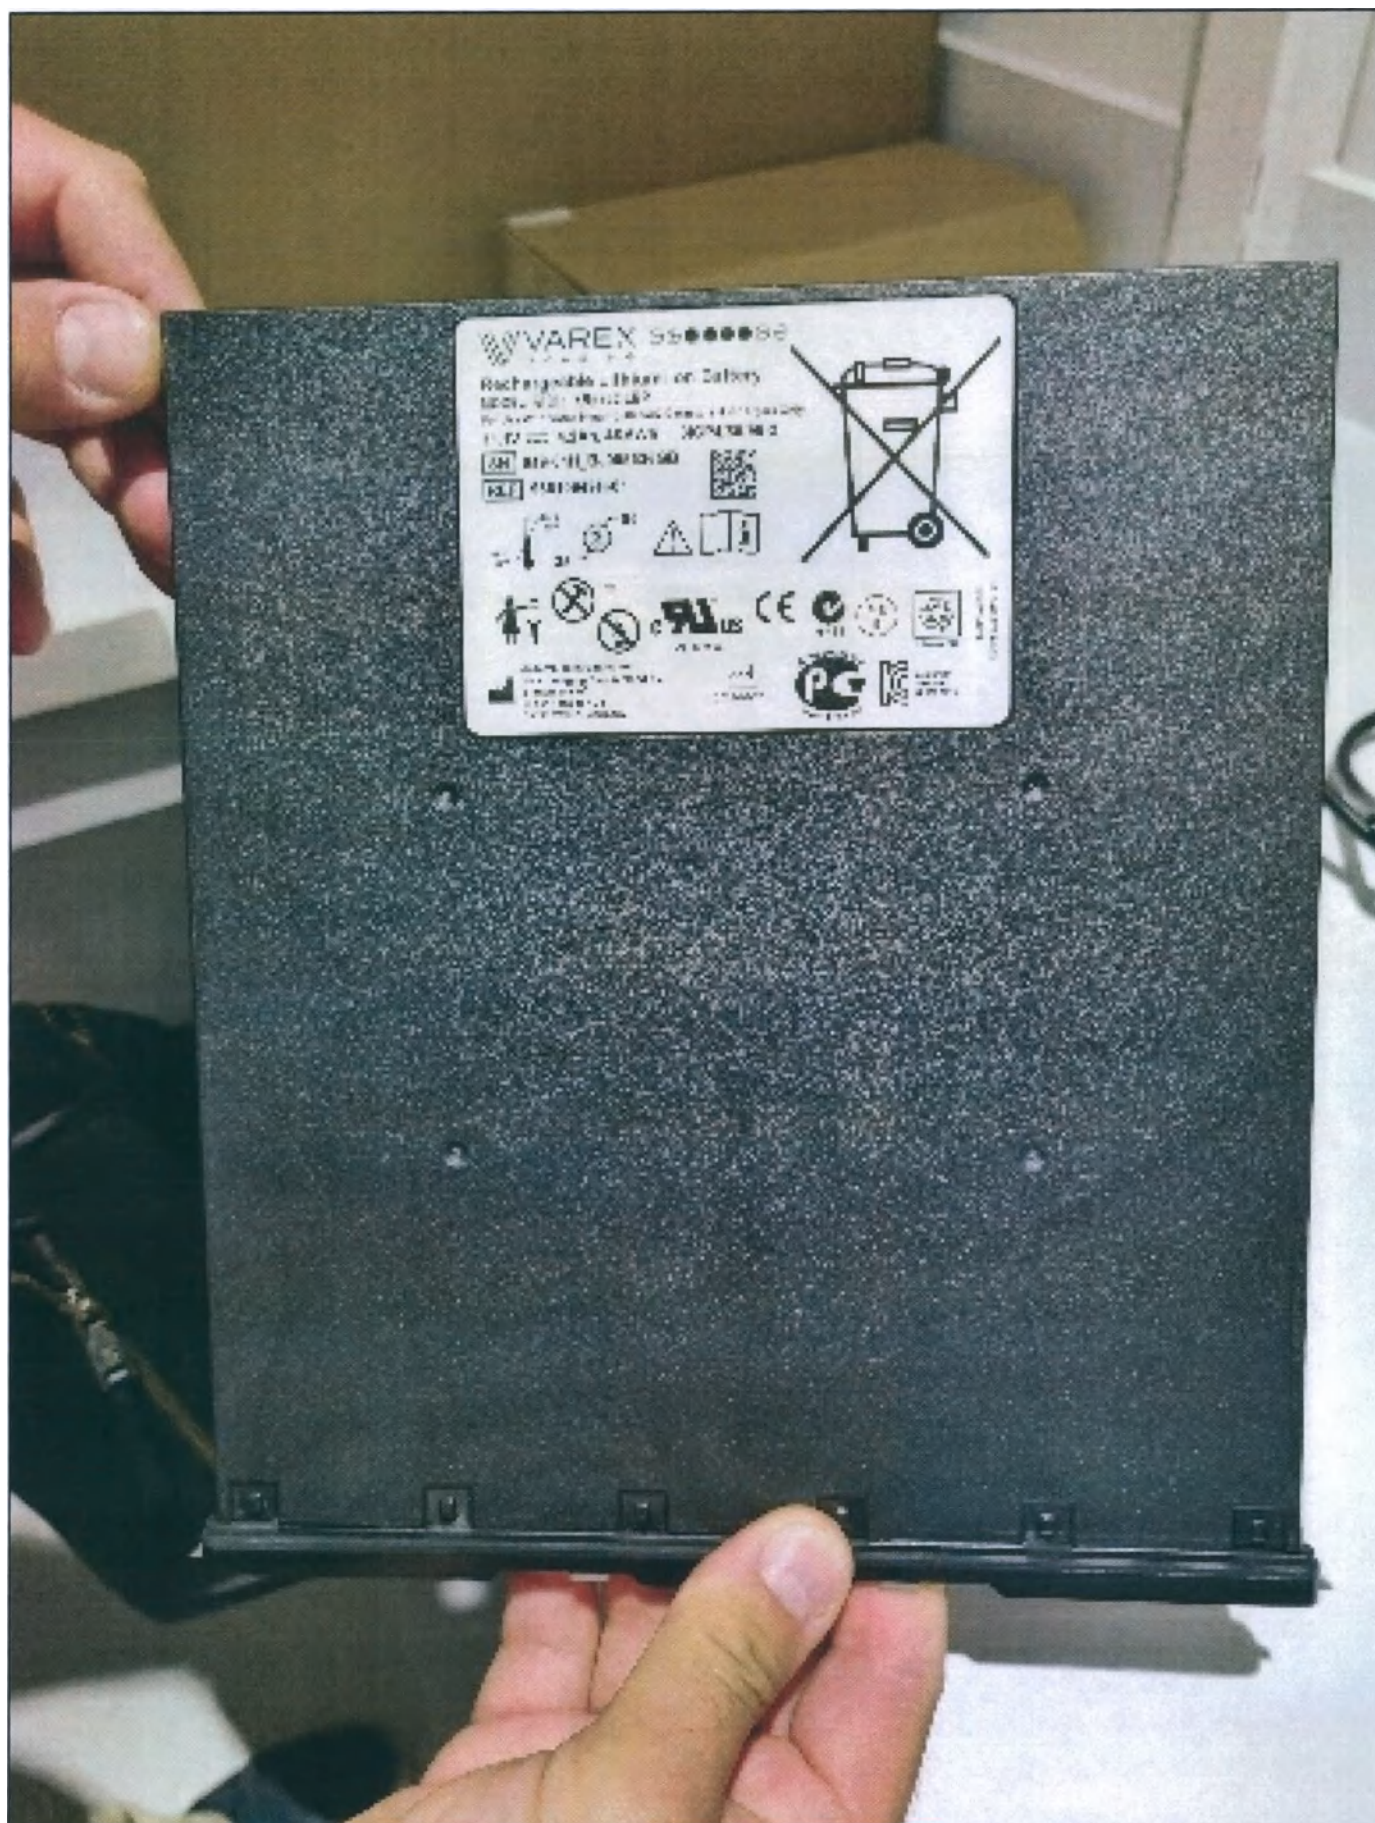




Держатель решёток и принадлежностей.

Держатель детектора боковой.




Держатель детектора передвижной.

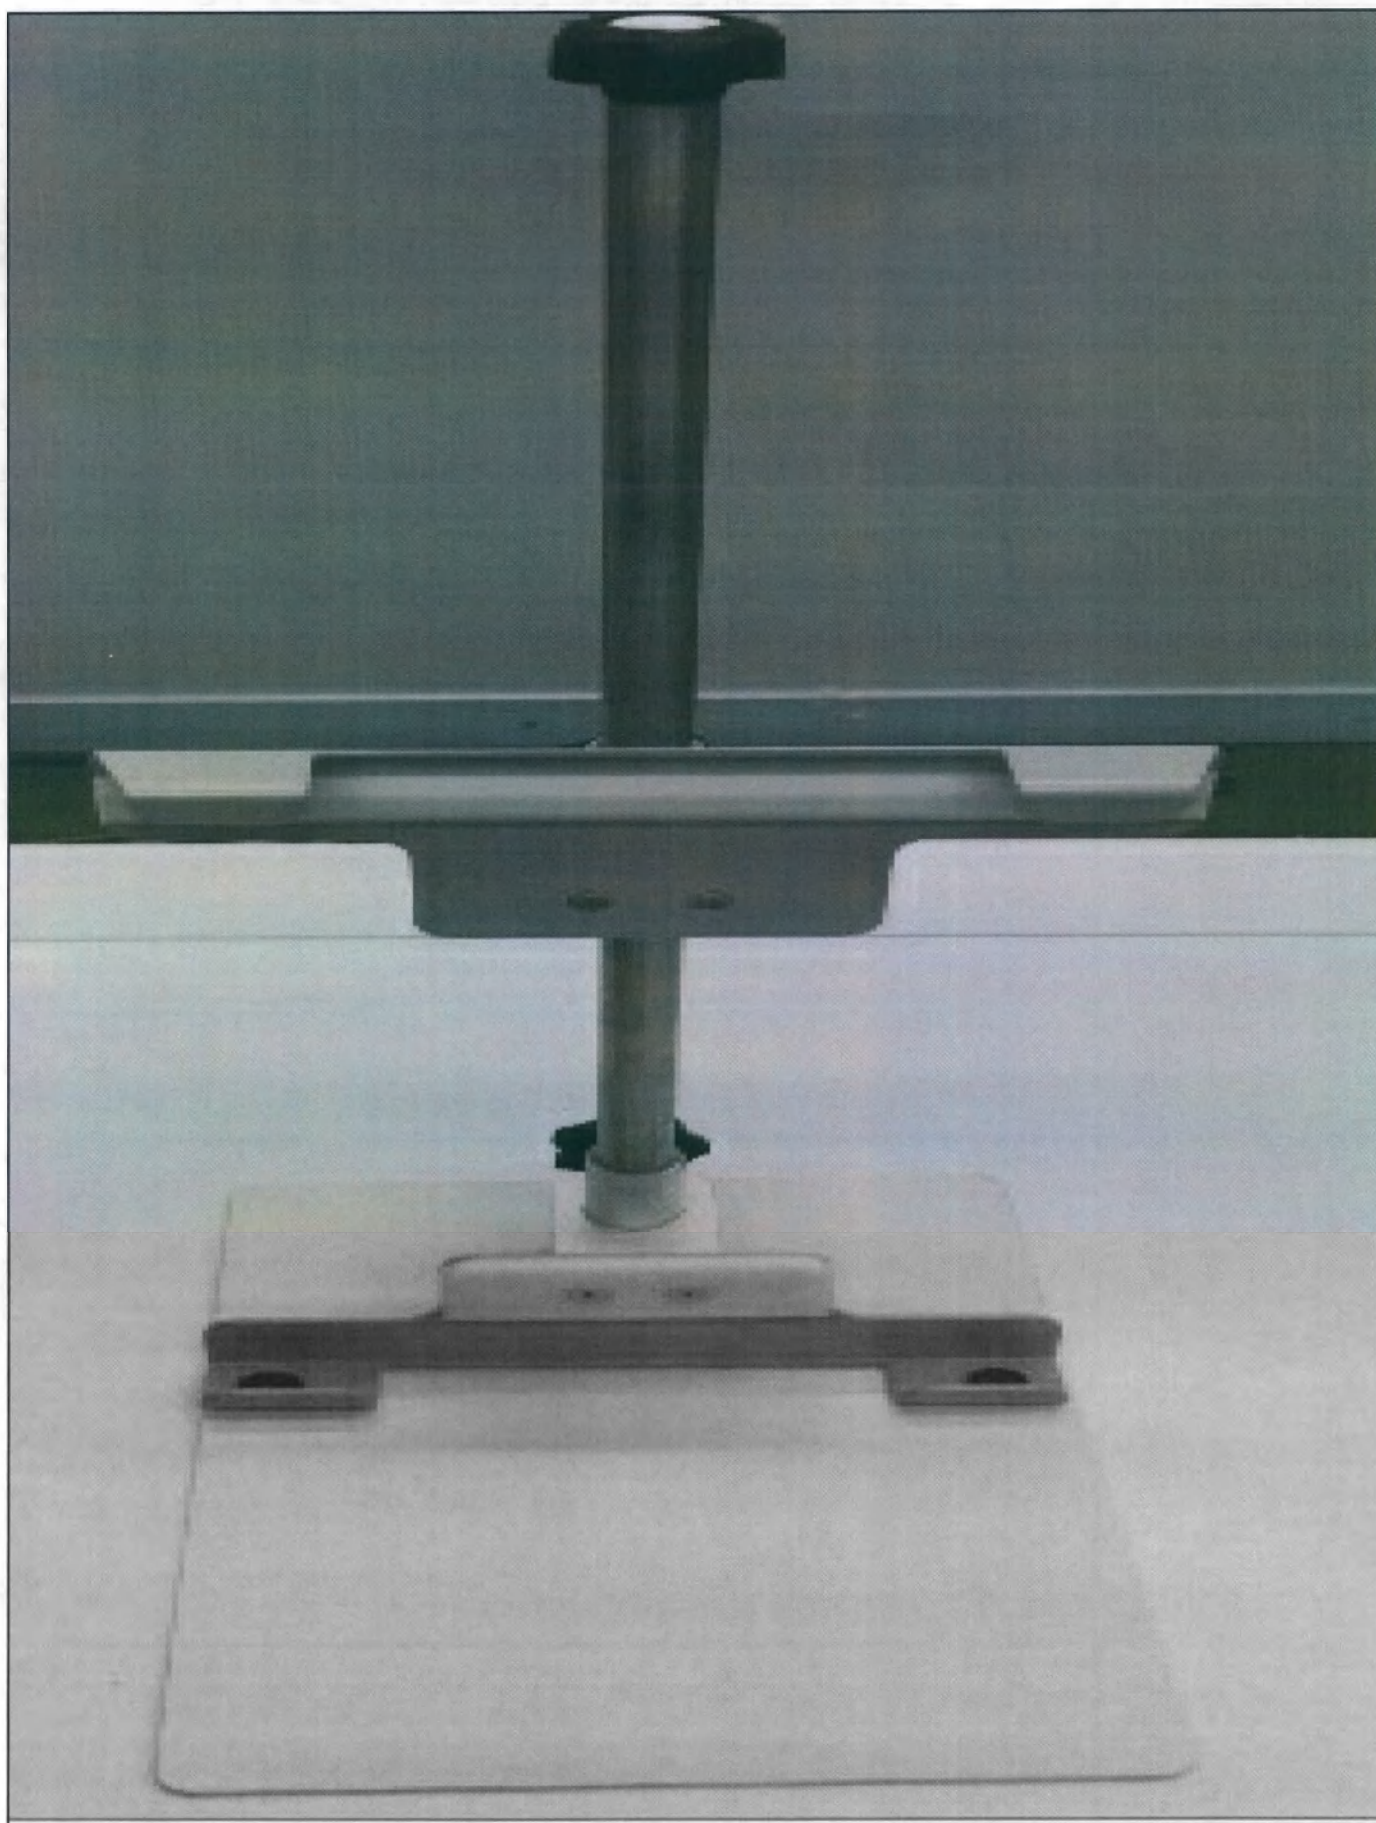



Корзина зарядная для детектора.

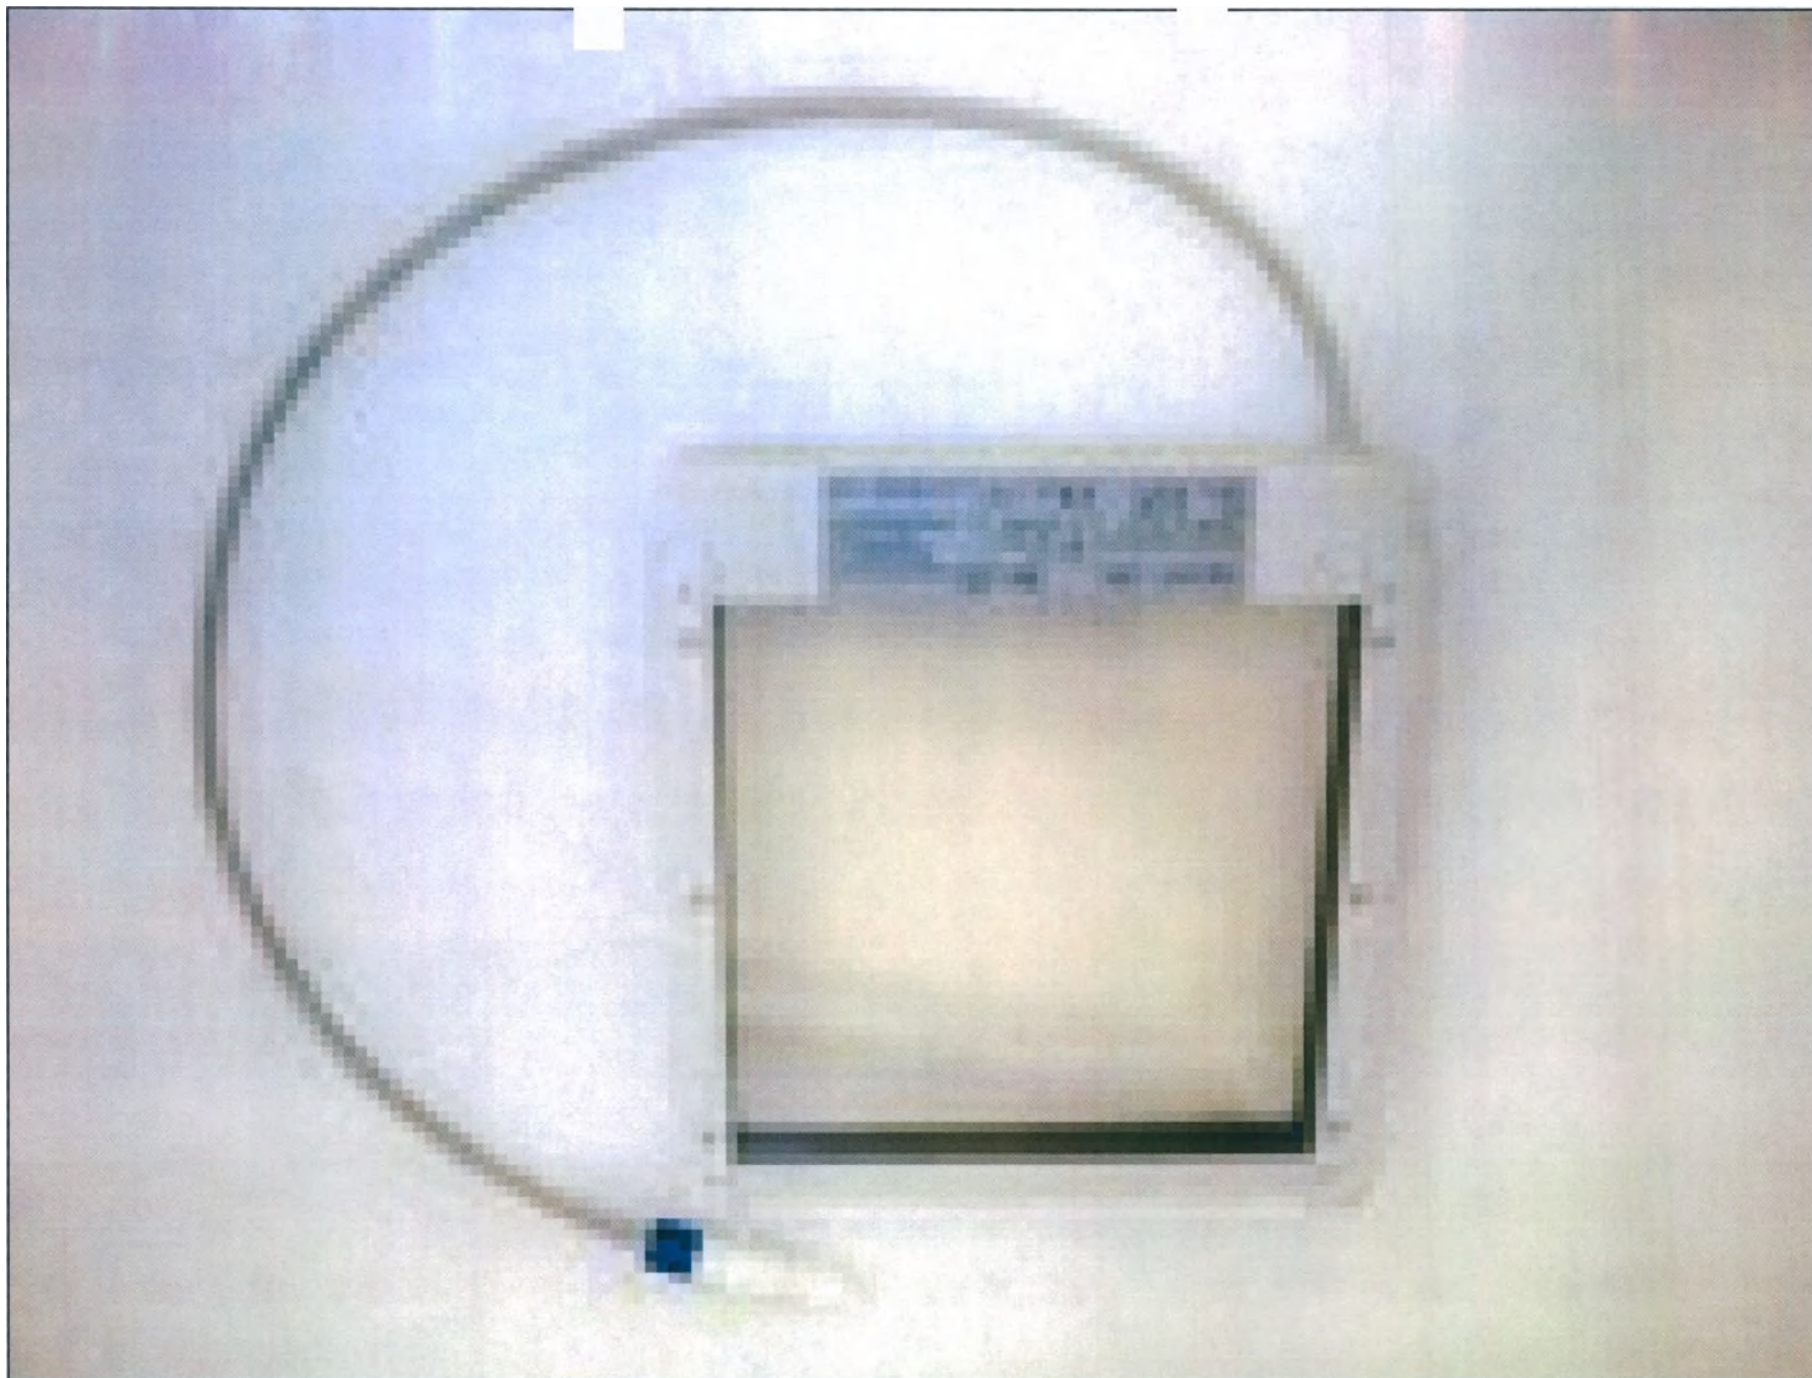

Индикатор дозы.




Устройства настольные зарядные для аккумуляторов.



Устройства настольные зарядные для аккумуляторов.


Устройства настольные зарядные для аккумуляторов.



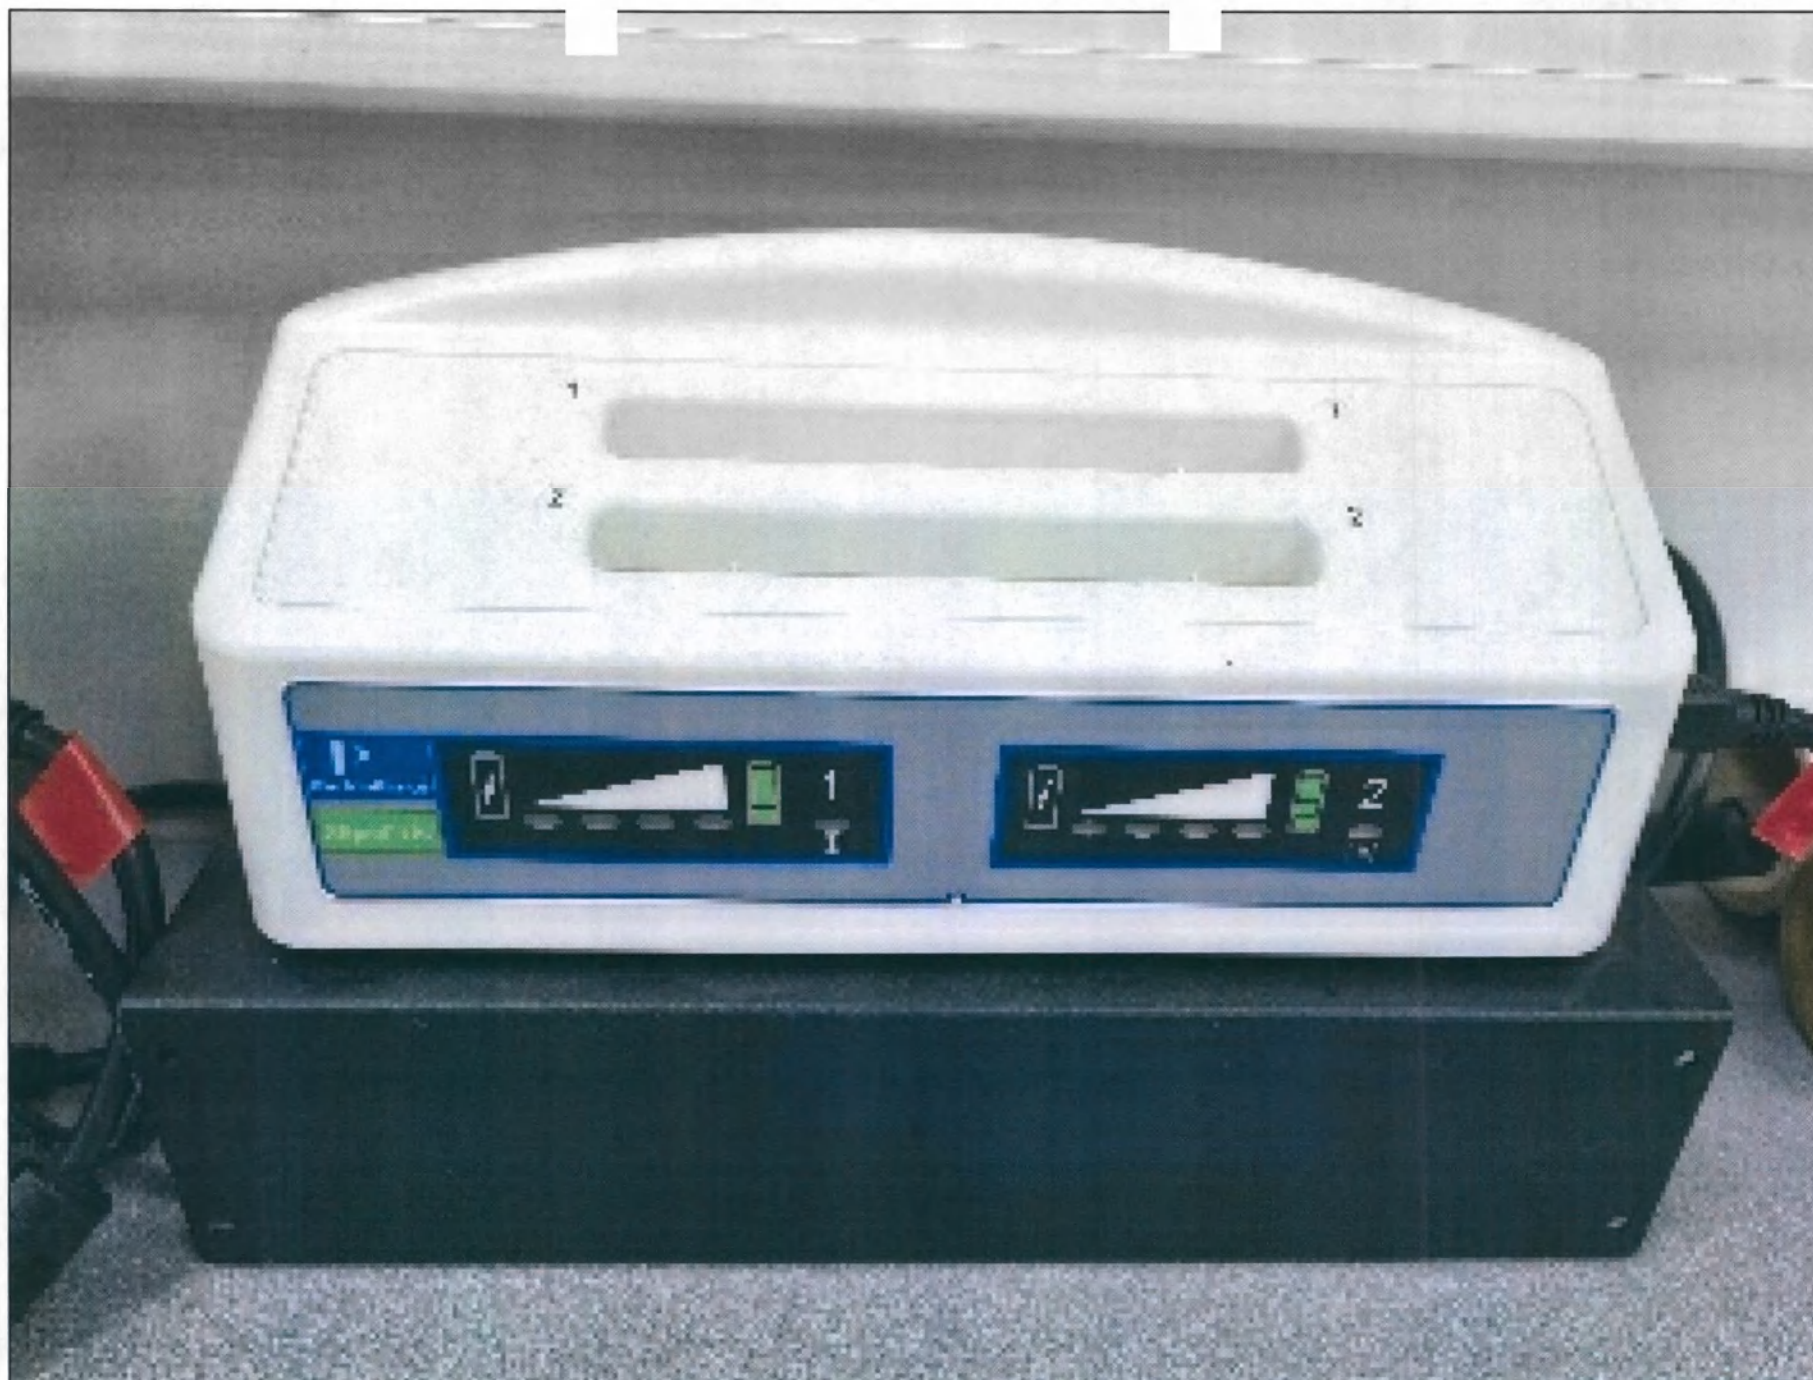

Устройства настольные зарядные для аккумуляторов.

Блок бесперебойного питания.

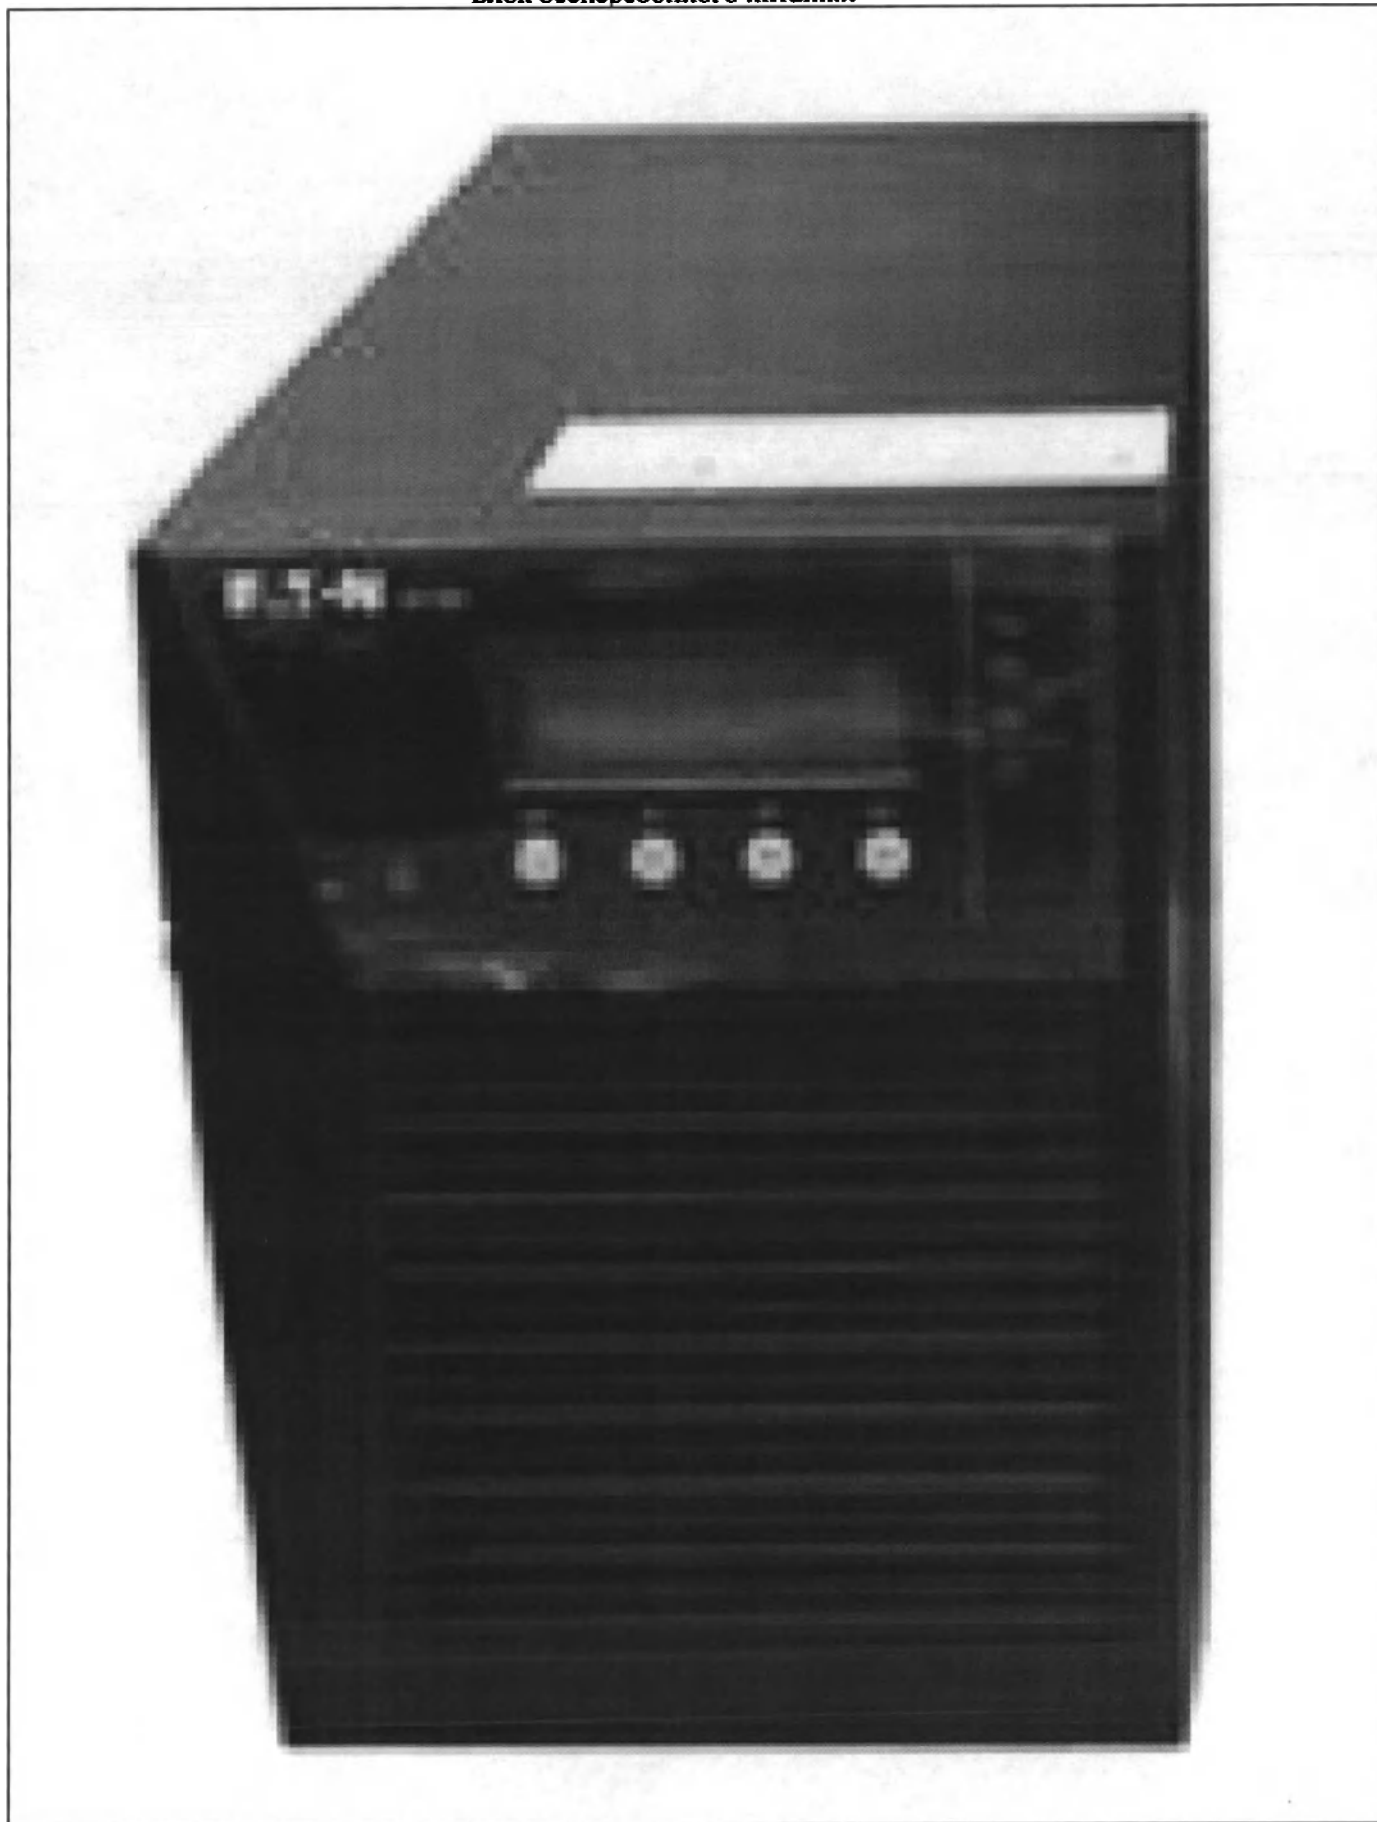


Блок бесперебойного питания.





Кабели.

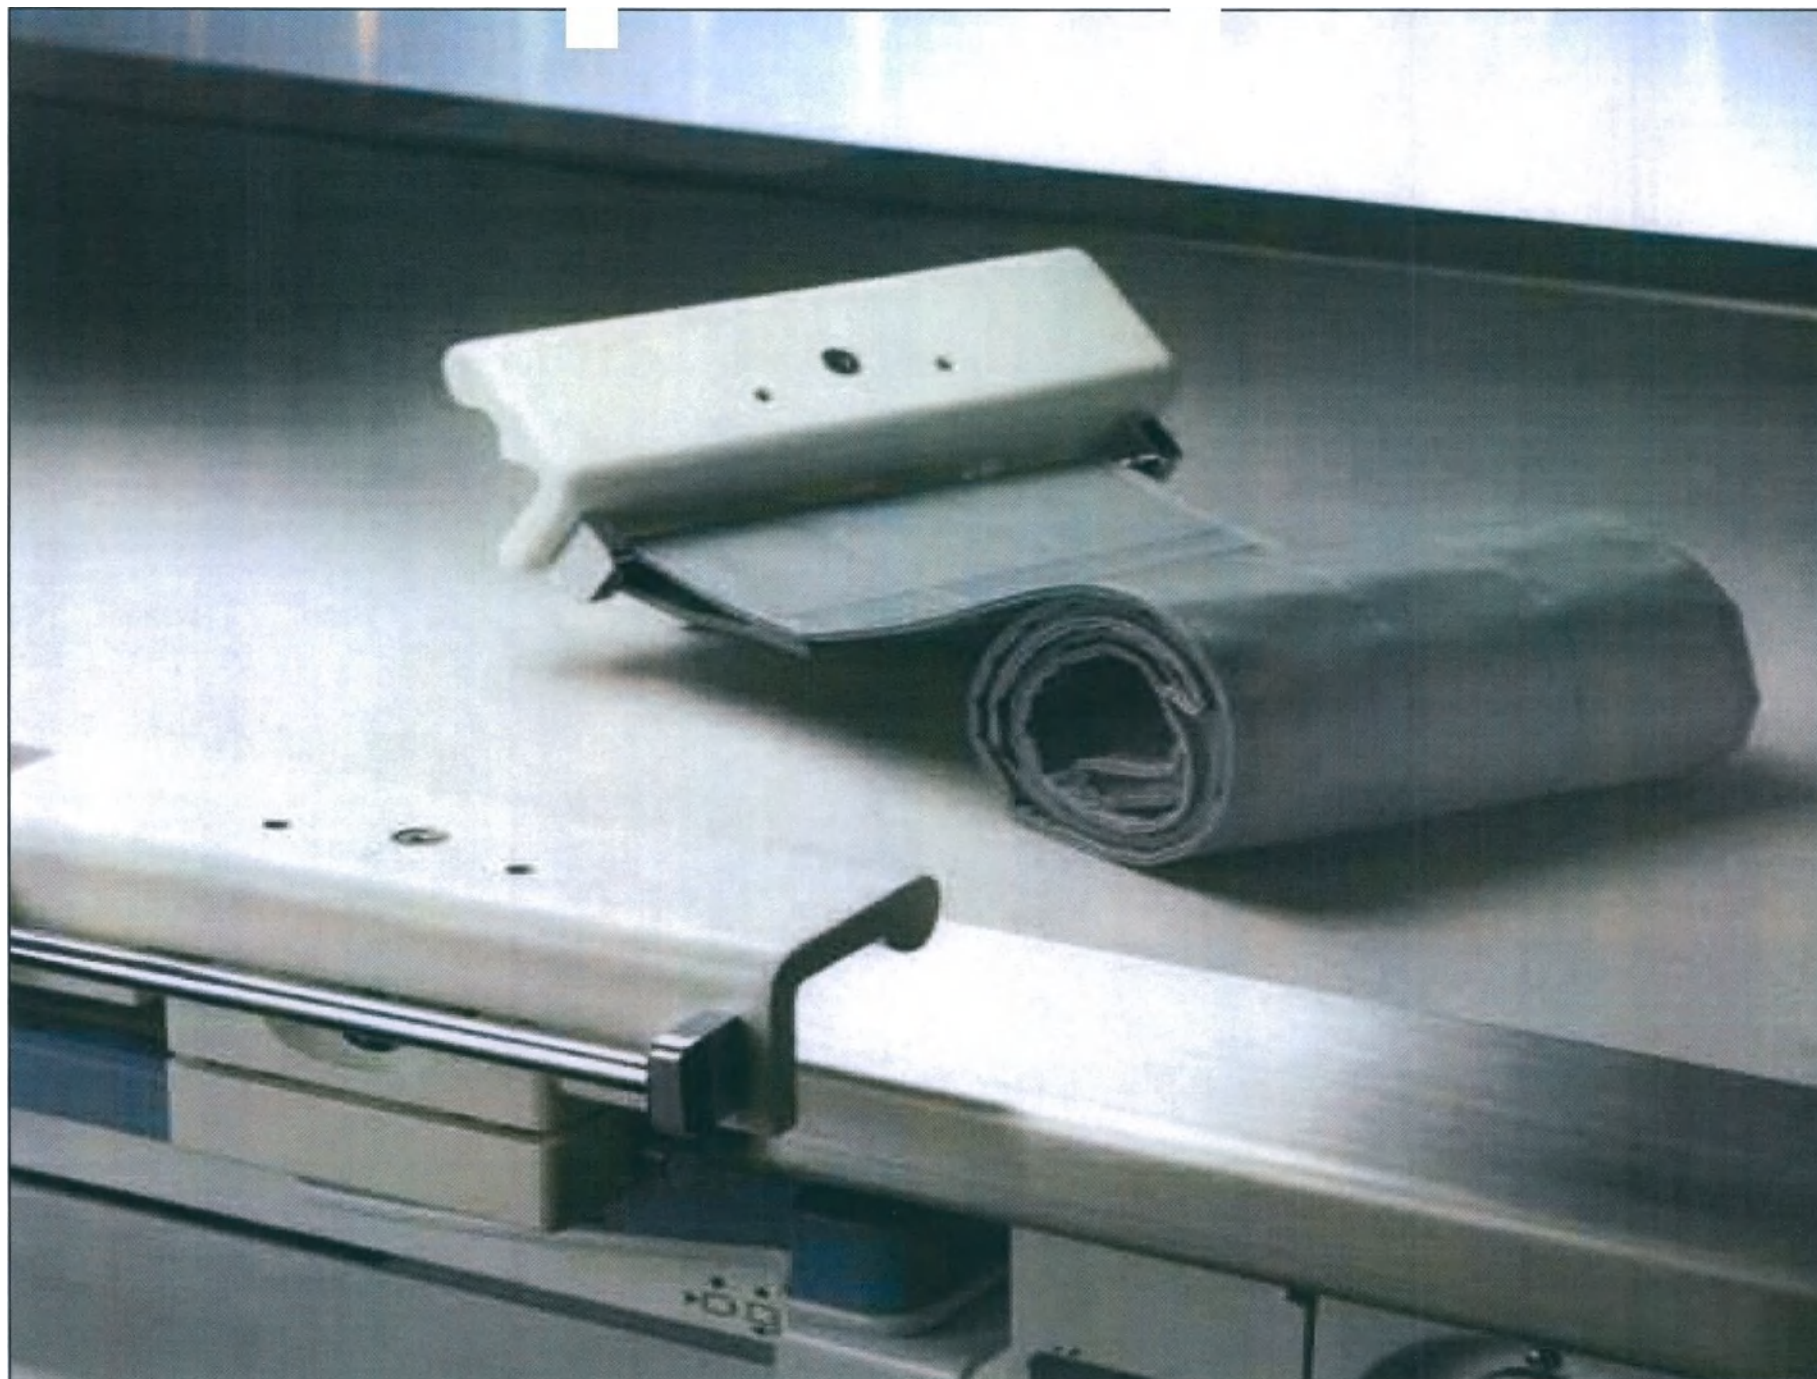

Ремень фиксирующий брюшной.




Ремень фиксирующий брюшной.



Мониторы для станций управления и сбора информации.




Набор наклеек для системы рентгеновской.

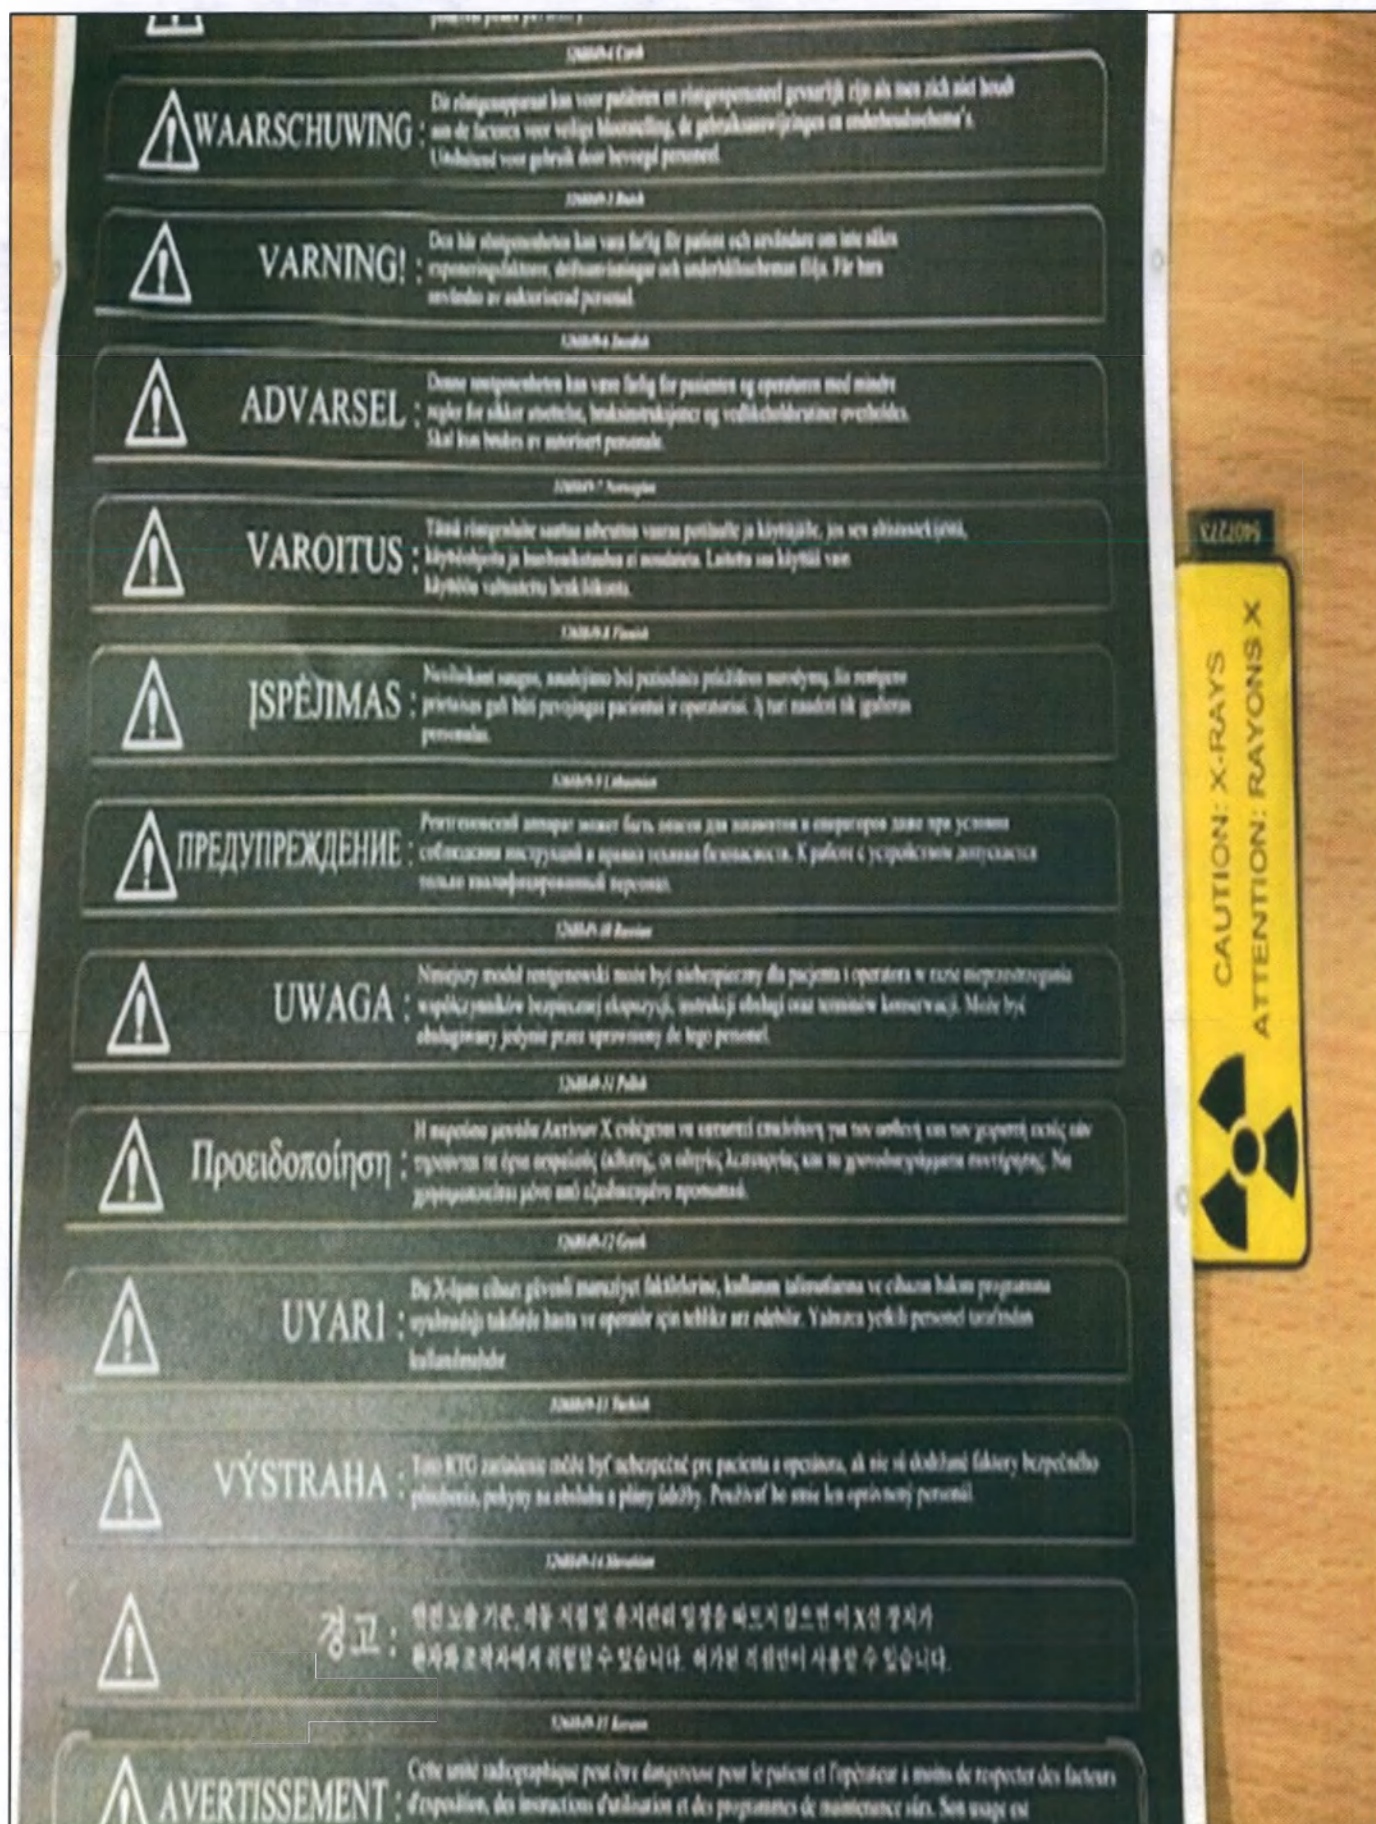


Устройство позиционирования пациента для объединения изображений.



Решетки для настенного штатива.

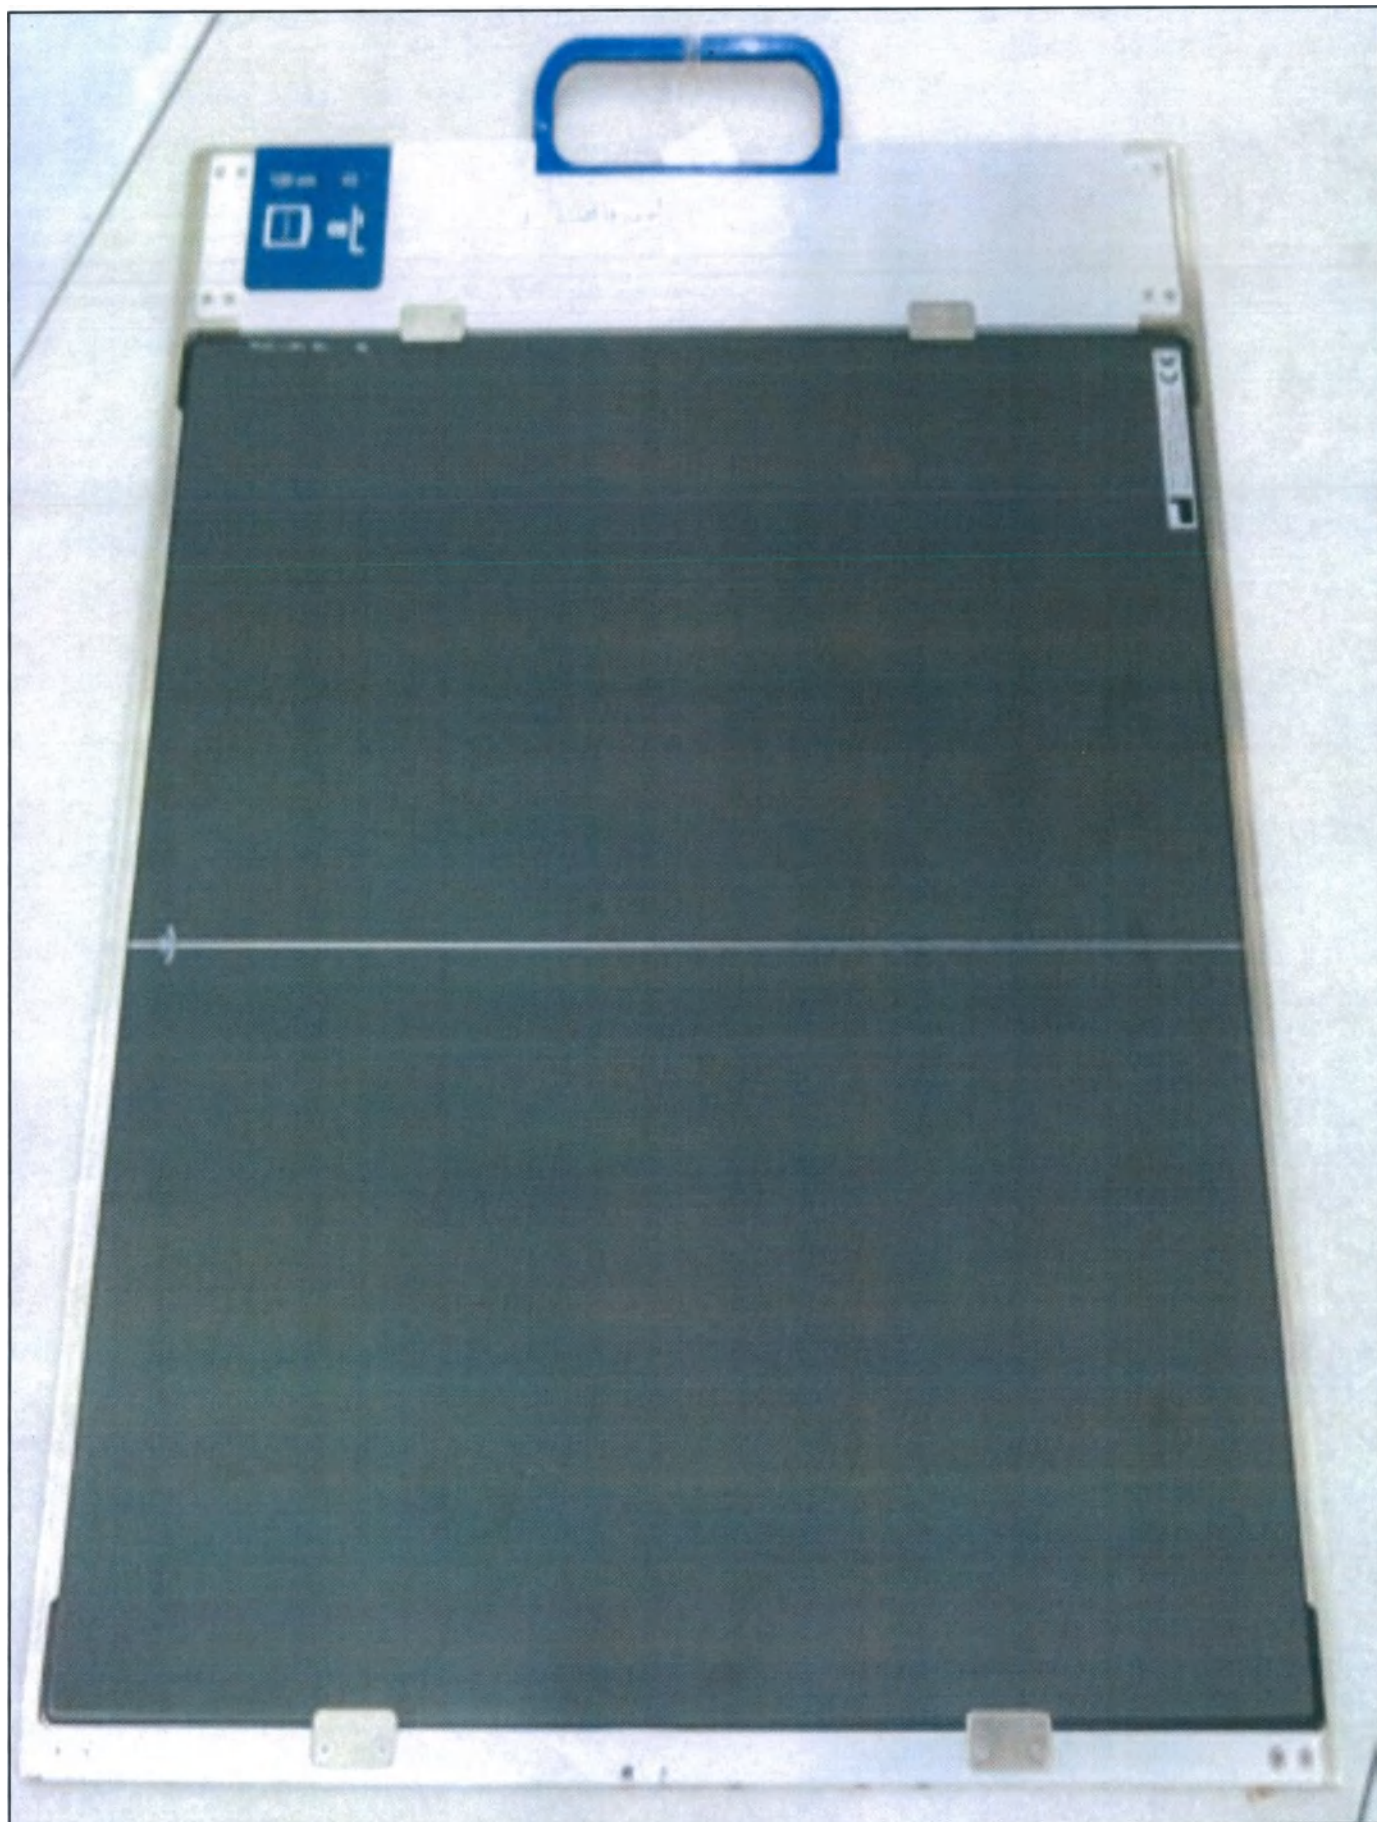

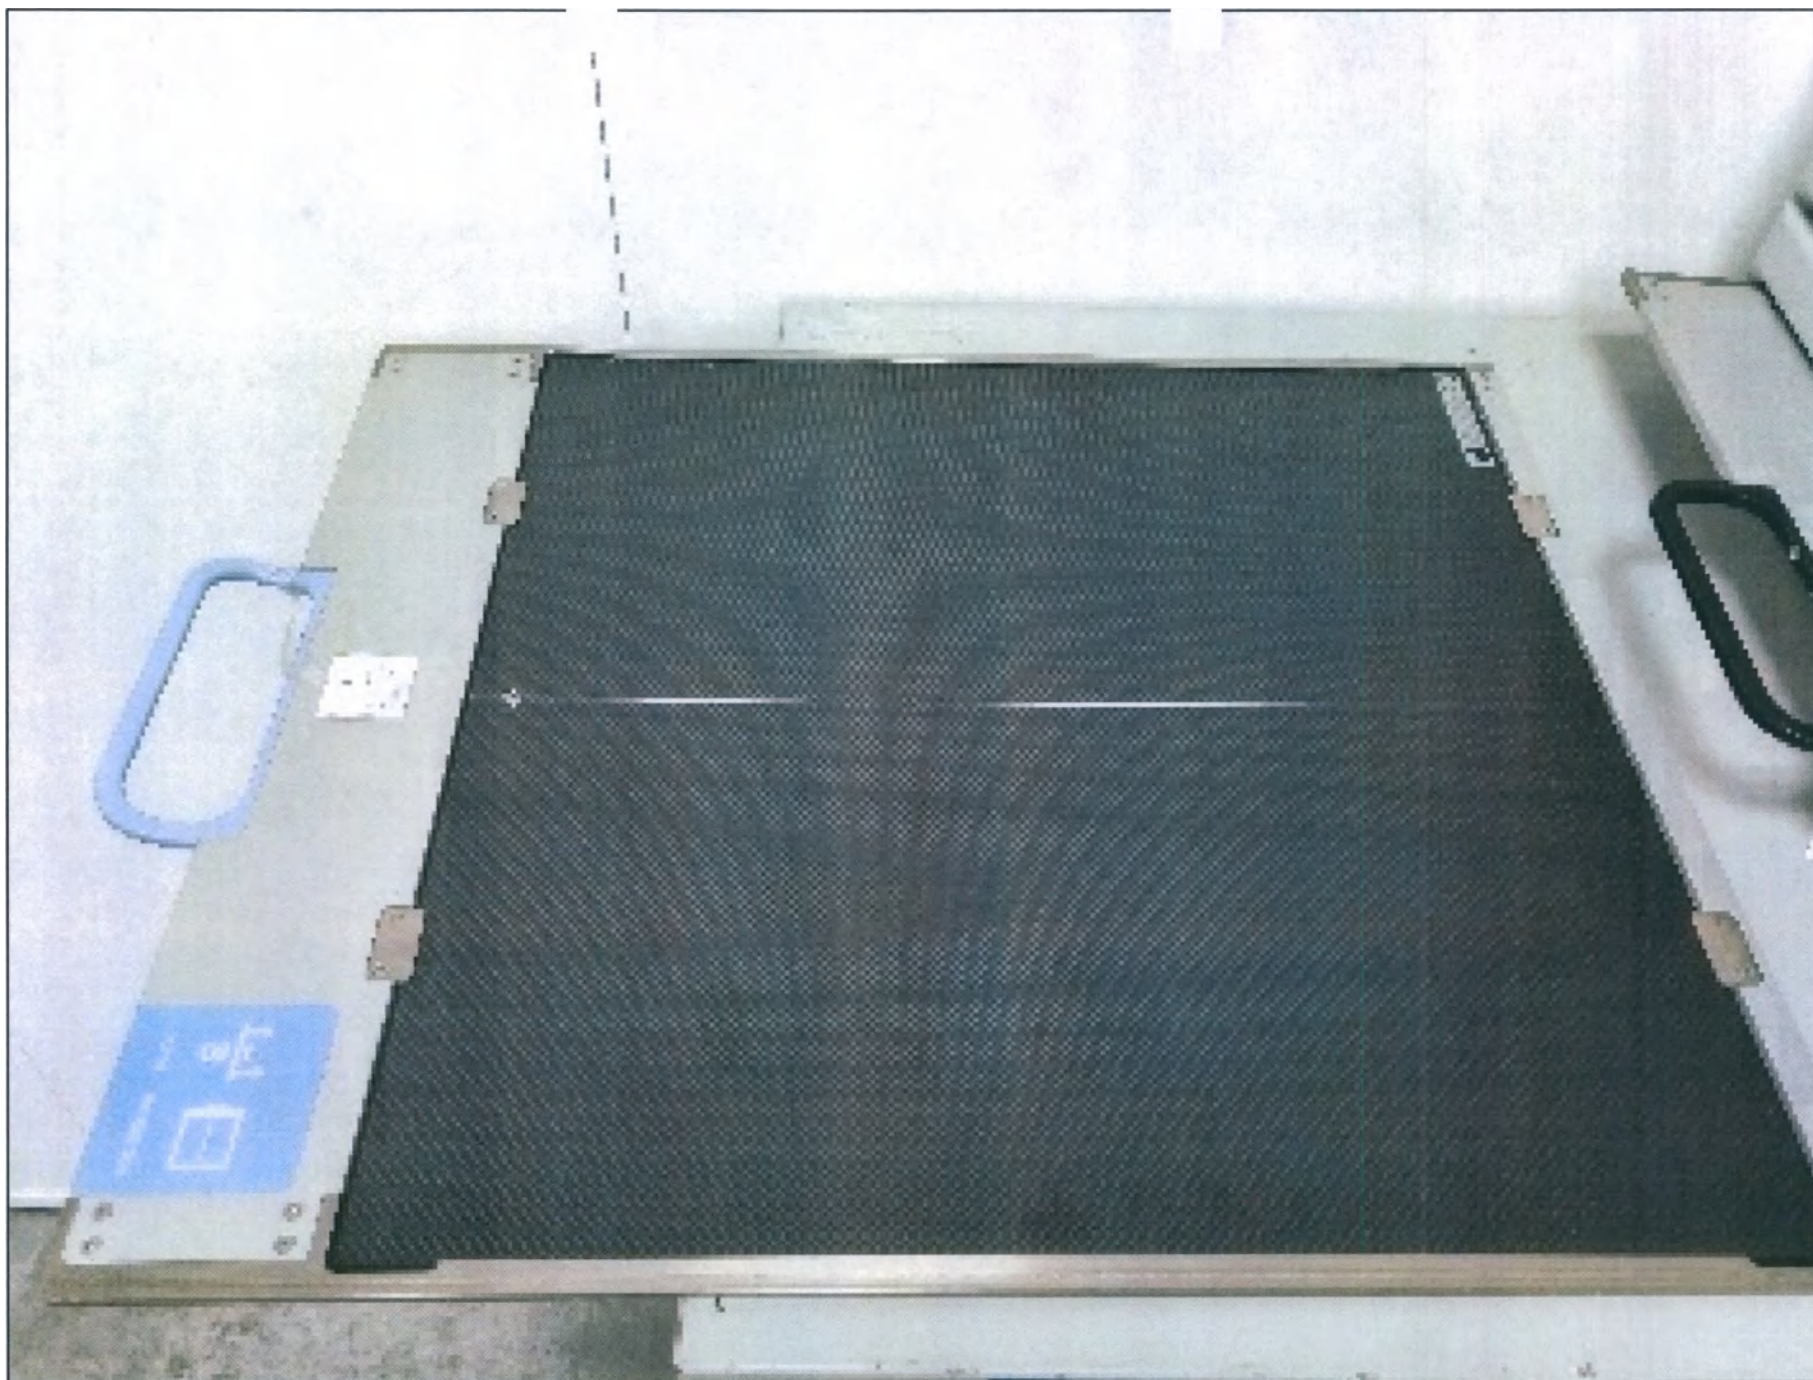

Решетки для настенного штатива.



Решетки для стола.



Устройство переговорное.


Рукоятки.



Боковые траверсы.



Подготовка/Снимок

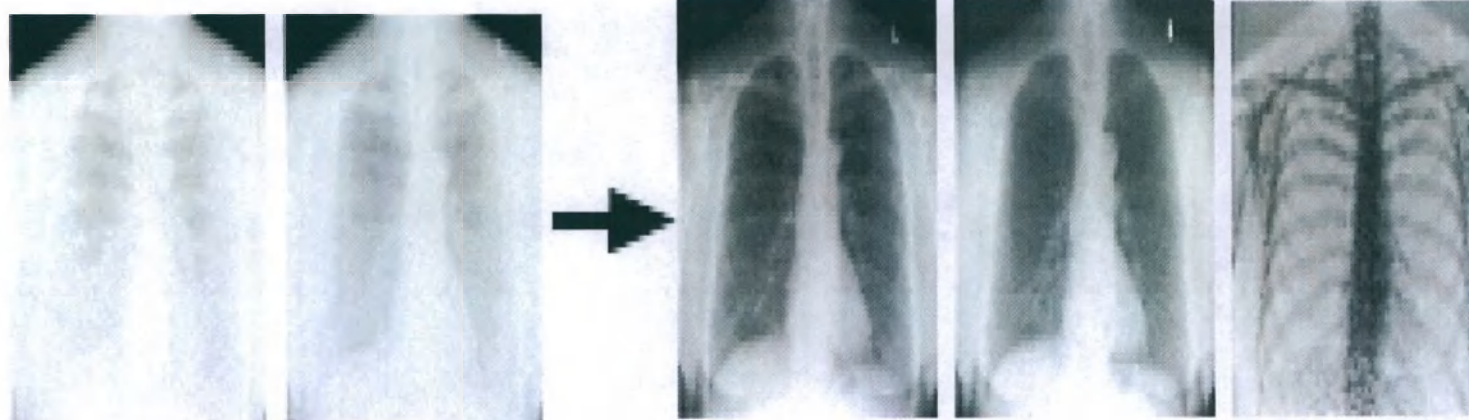

Предварительный просмотр с низким значением кВп

Предварительный просмотр с высоким значением кВп

Стандартная обработка

Обработка мягких тканей

Bone (Кость) Обработка


Сохранено в формате необработанных изображений

Сохранено в формате ОБРАБОТАННЫХ изображений


1 Получение

3 Обработанные изображения


Программное обеспечение для двухэнергетической рентгенографии на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях.

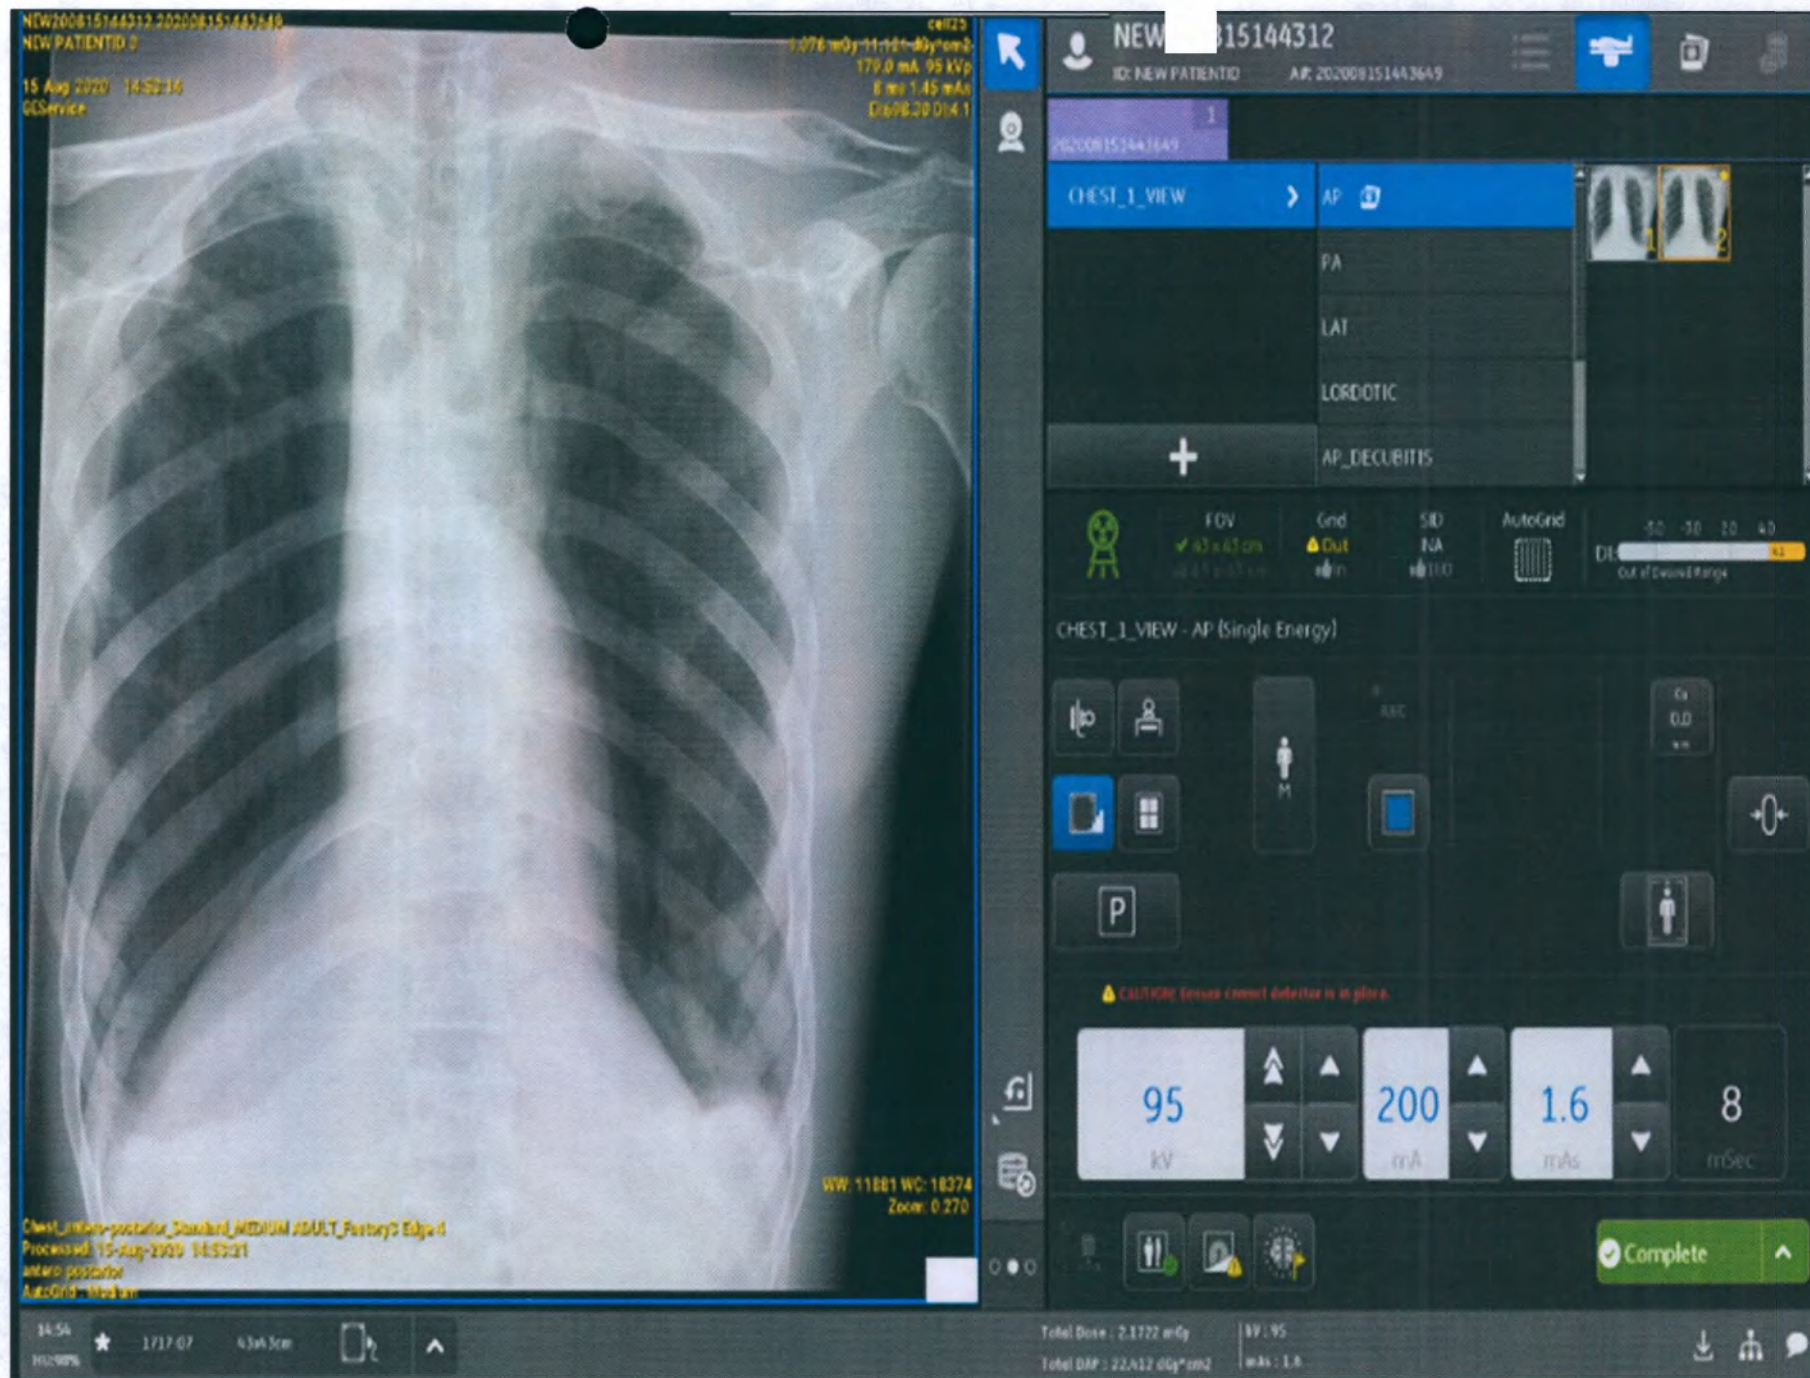

Программное обеспечение Autogrid на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях

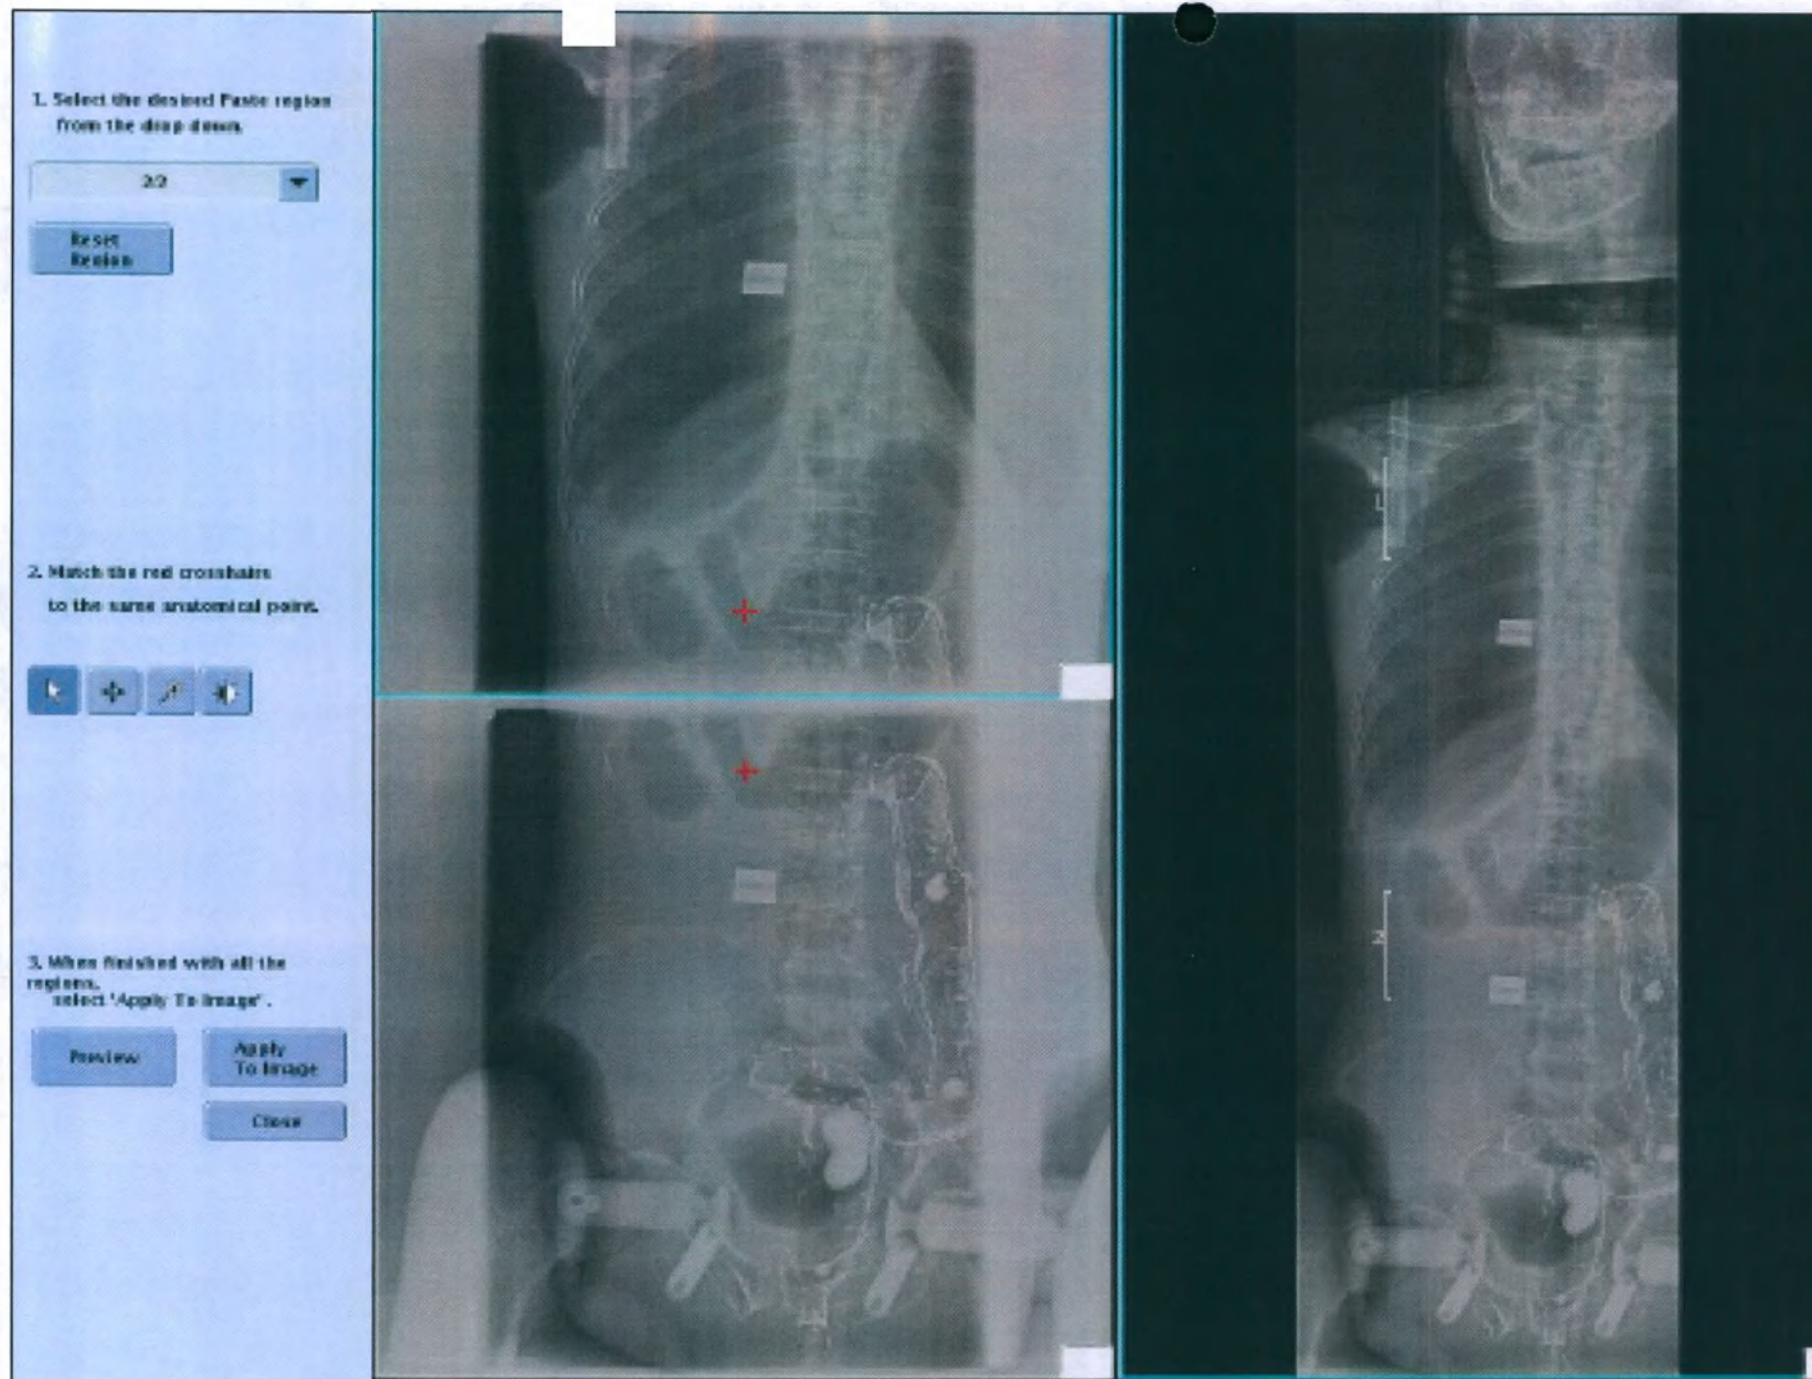

Программное обеспечение для объединения изображений) на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях

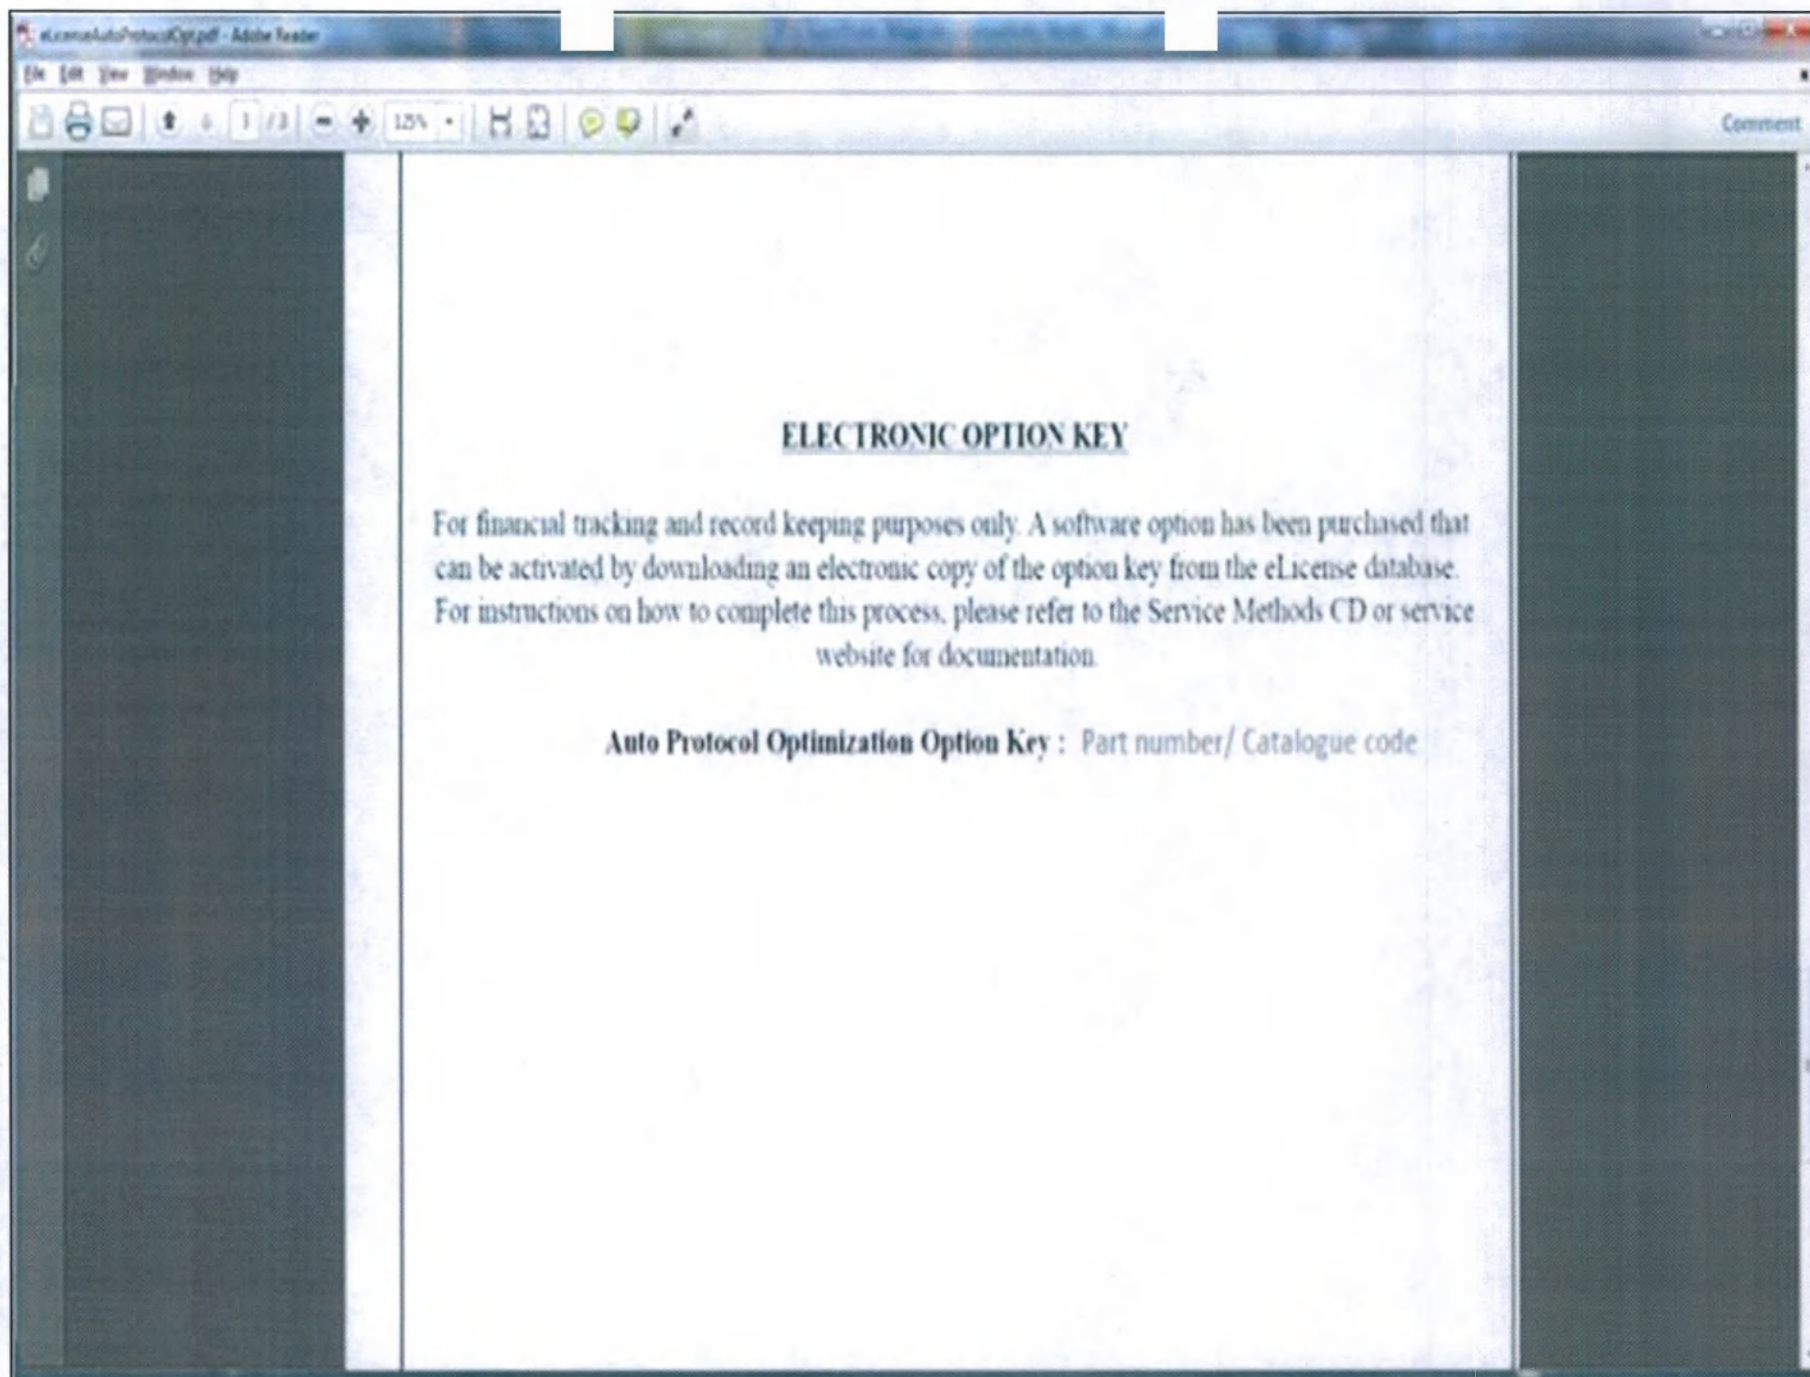

Дополнительные программные обеспечения на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях

Patient
D:NEW PATIEN...
A#:

CHEST_VolumeRAD – AP(VolumeRAD Scout)

Total Dose :
Total DAP :

Patient Size :
Medium Adult

Receptor :
AEC FIXED

Reset Technique :
FOV :
41 cm x 41 cm

Auto Position :
Table-Center-...

Current :
Recommended :

Grid :
100 ✓

SID :
100.2 ✓

100 100

Ion Chamber :

100 kV

320.0 mA

Facal Spot :

Cu Filter :
0.2

Patient Side :
Unpaired

Patient Position :
Head Up

AEC Back-up Time :
1600 mSec

Select Protocols

Auto Send

Suspend Close

Discontinue

LV: 100
mA: 320.0

AEC

11:5
HUA 98

Программное обеспечение томографической реконструкции на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях.

Программное обеспечение «Пакет критической помощи» на оптических и/или электронных и/или бумажных (ключ активации или сертификат) носителях.

GE Optima™ XR646 HD

Doe, John
ID: 1234567891011 A#: 1234567891011

1.2.840.113619.2.418.4.8... >	CHEST	PROC		
	CHEST	RAW		
	HAND_1_VIEW_LEFT	PROC		
	HAND_1_VIEW_LEFT	RAW		

+

Viewer Display

Viewer Display


Zoom

100% 50% 1:1

DI: -5.0 -3.0 2.0 4.0
Optimal Range




Рабочая станция получения изображений.

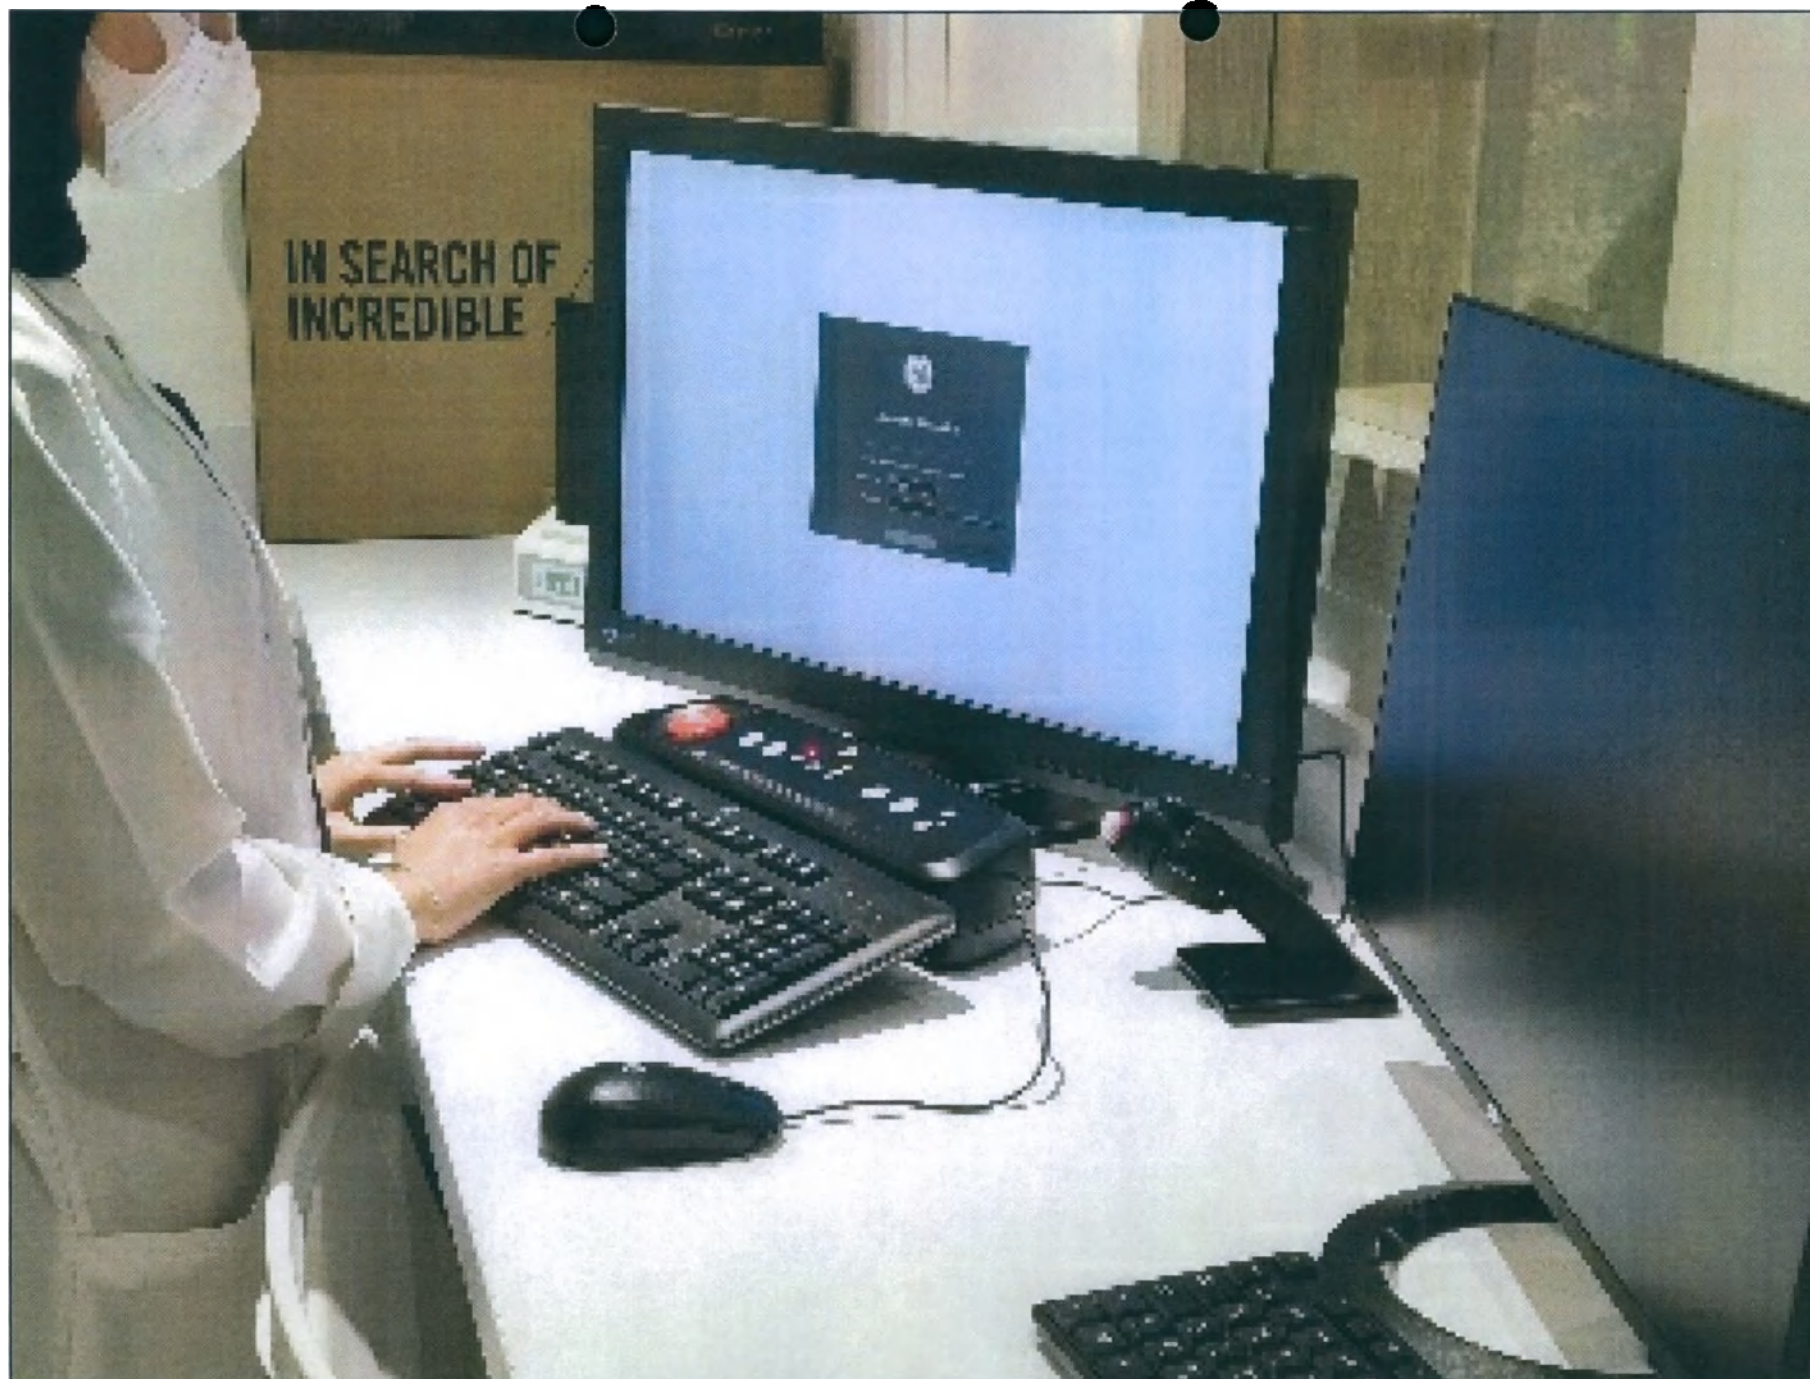

Рабочая станция получения изображений.

Принтеры для печати медицинских изображений.

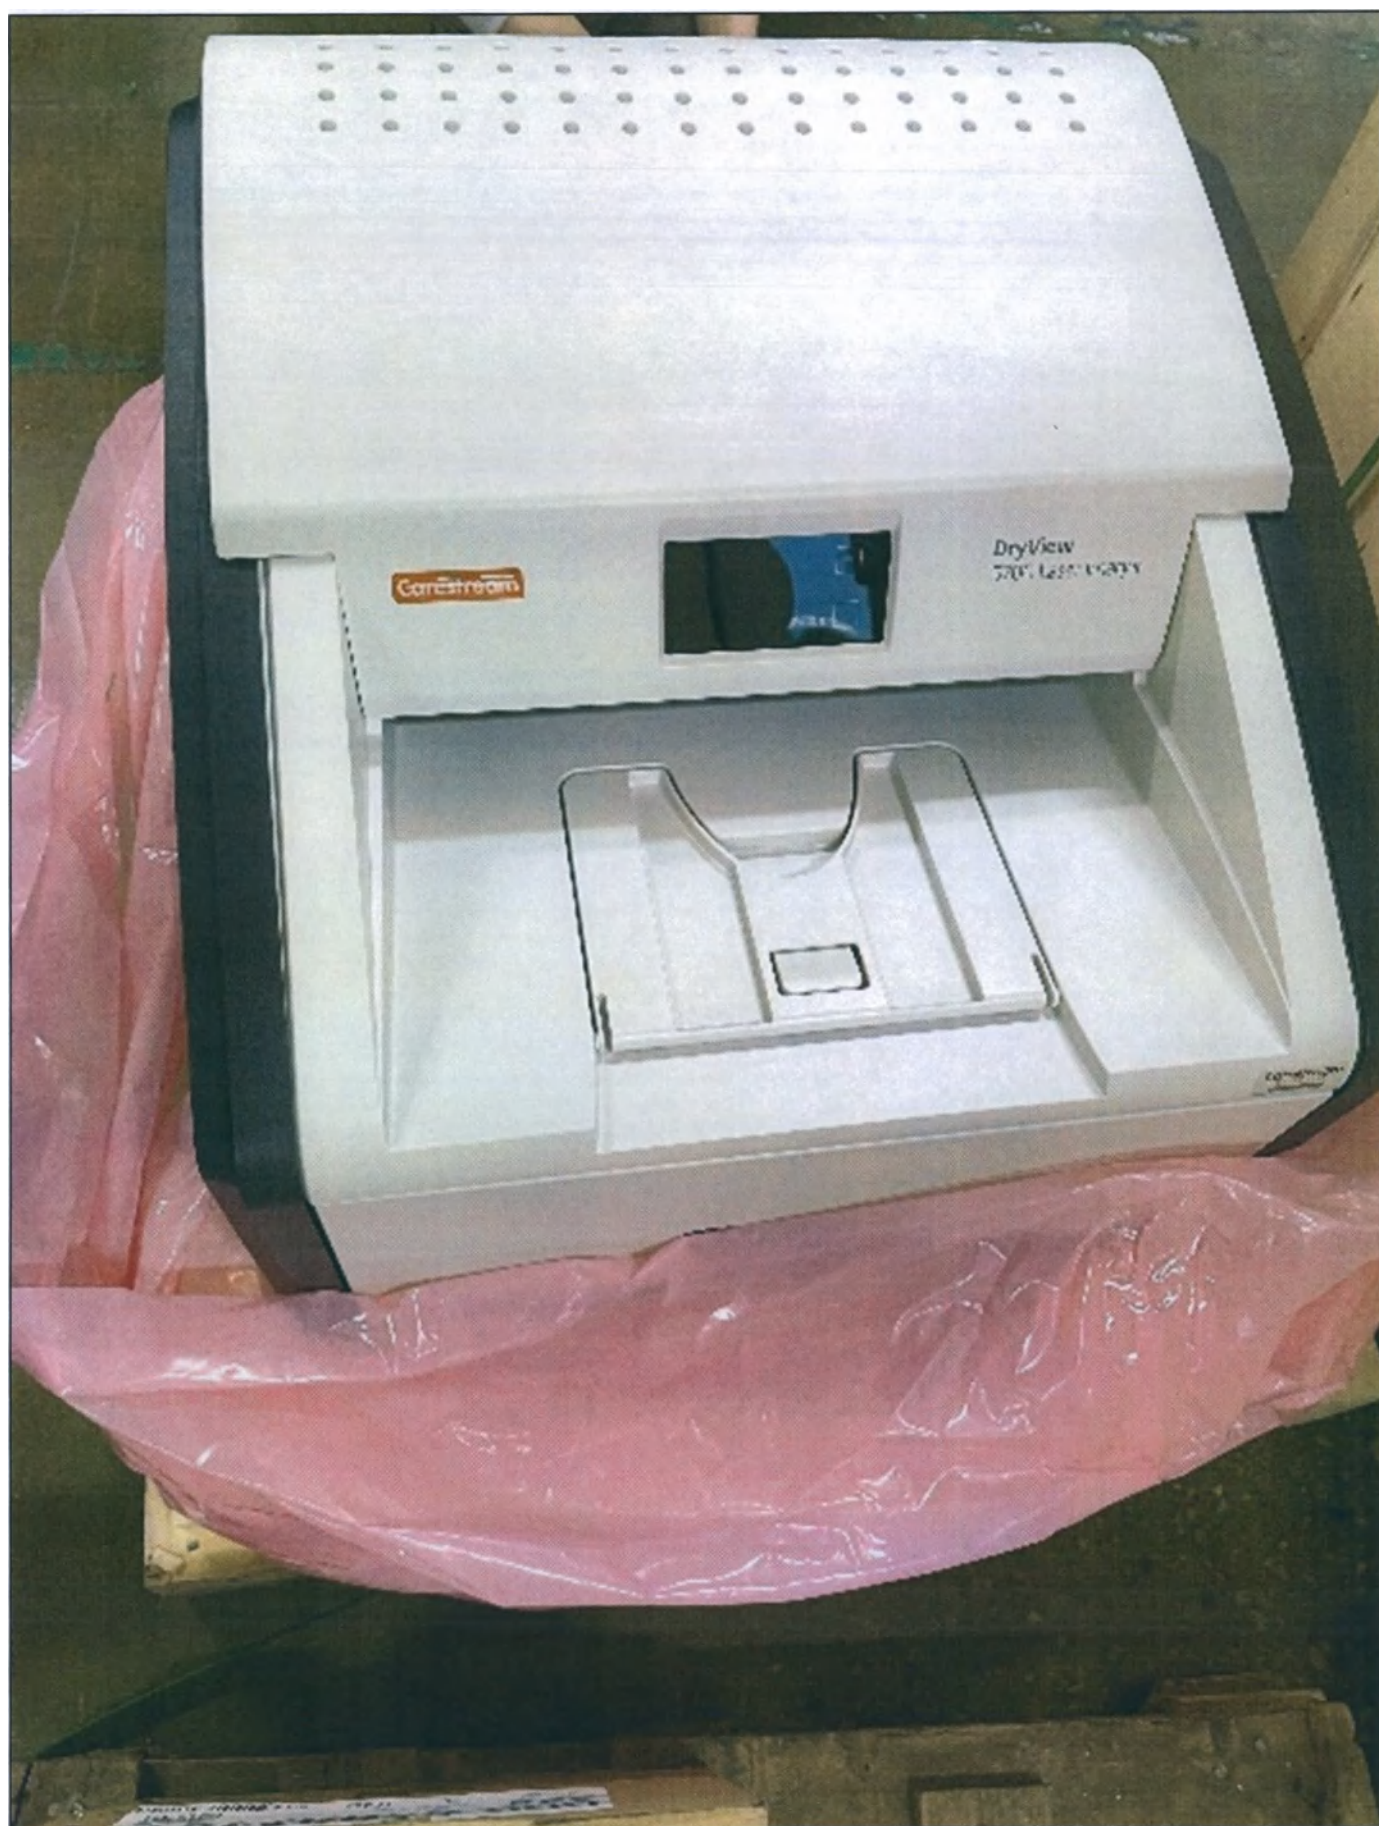

Набор пленки стартовый для принтера медицинских изображений.





Сервисный и монтажный набор инструментов: специальные крепления, фурнитура.



Внешний USB CD/DVD привод.




Рабочая станция.



Рабочая станция.


Сканер штрих-кода.




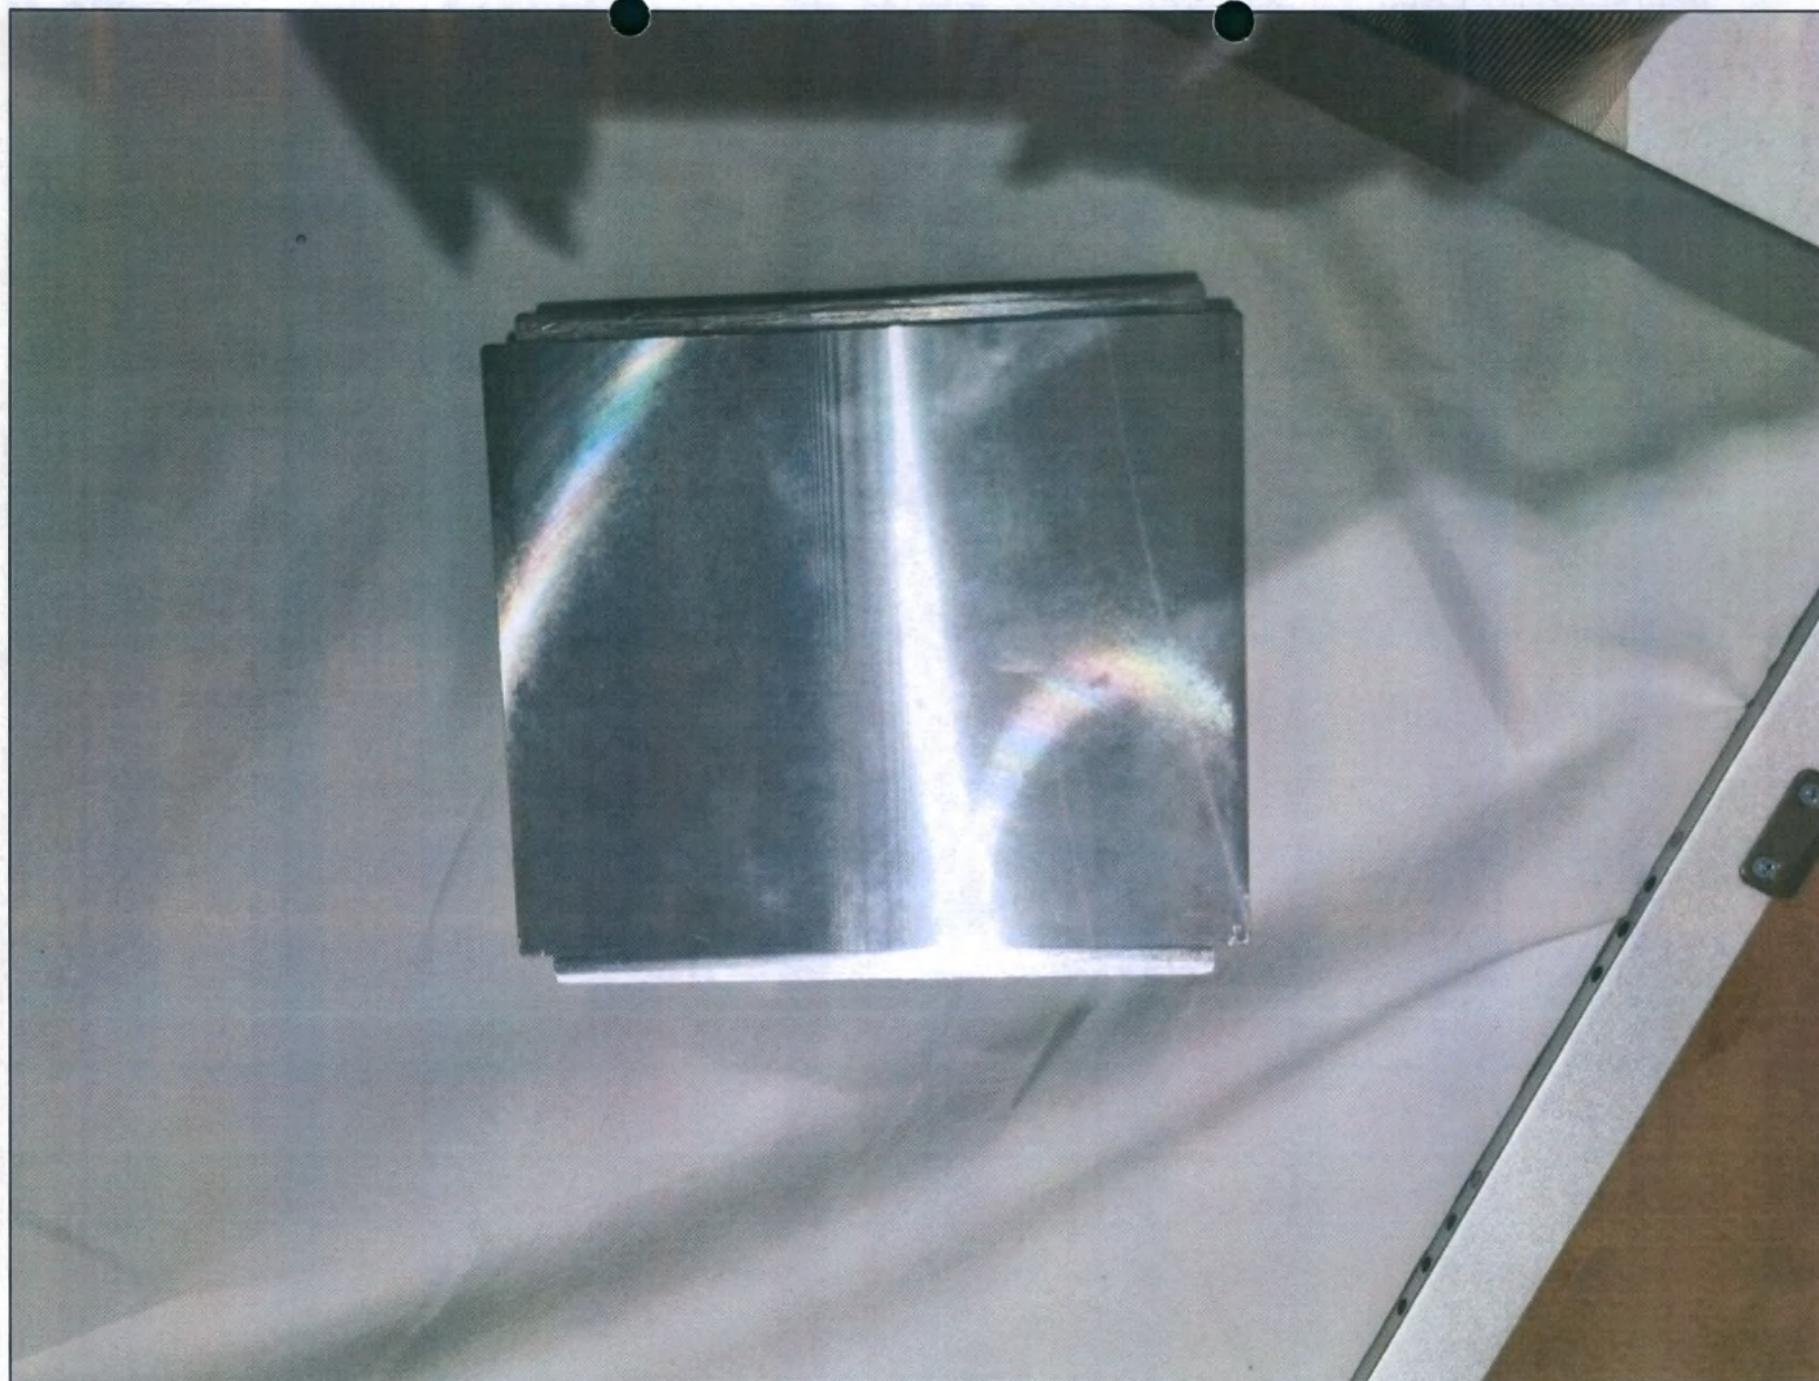

Фантомы


ФАНТОМЫ.

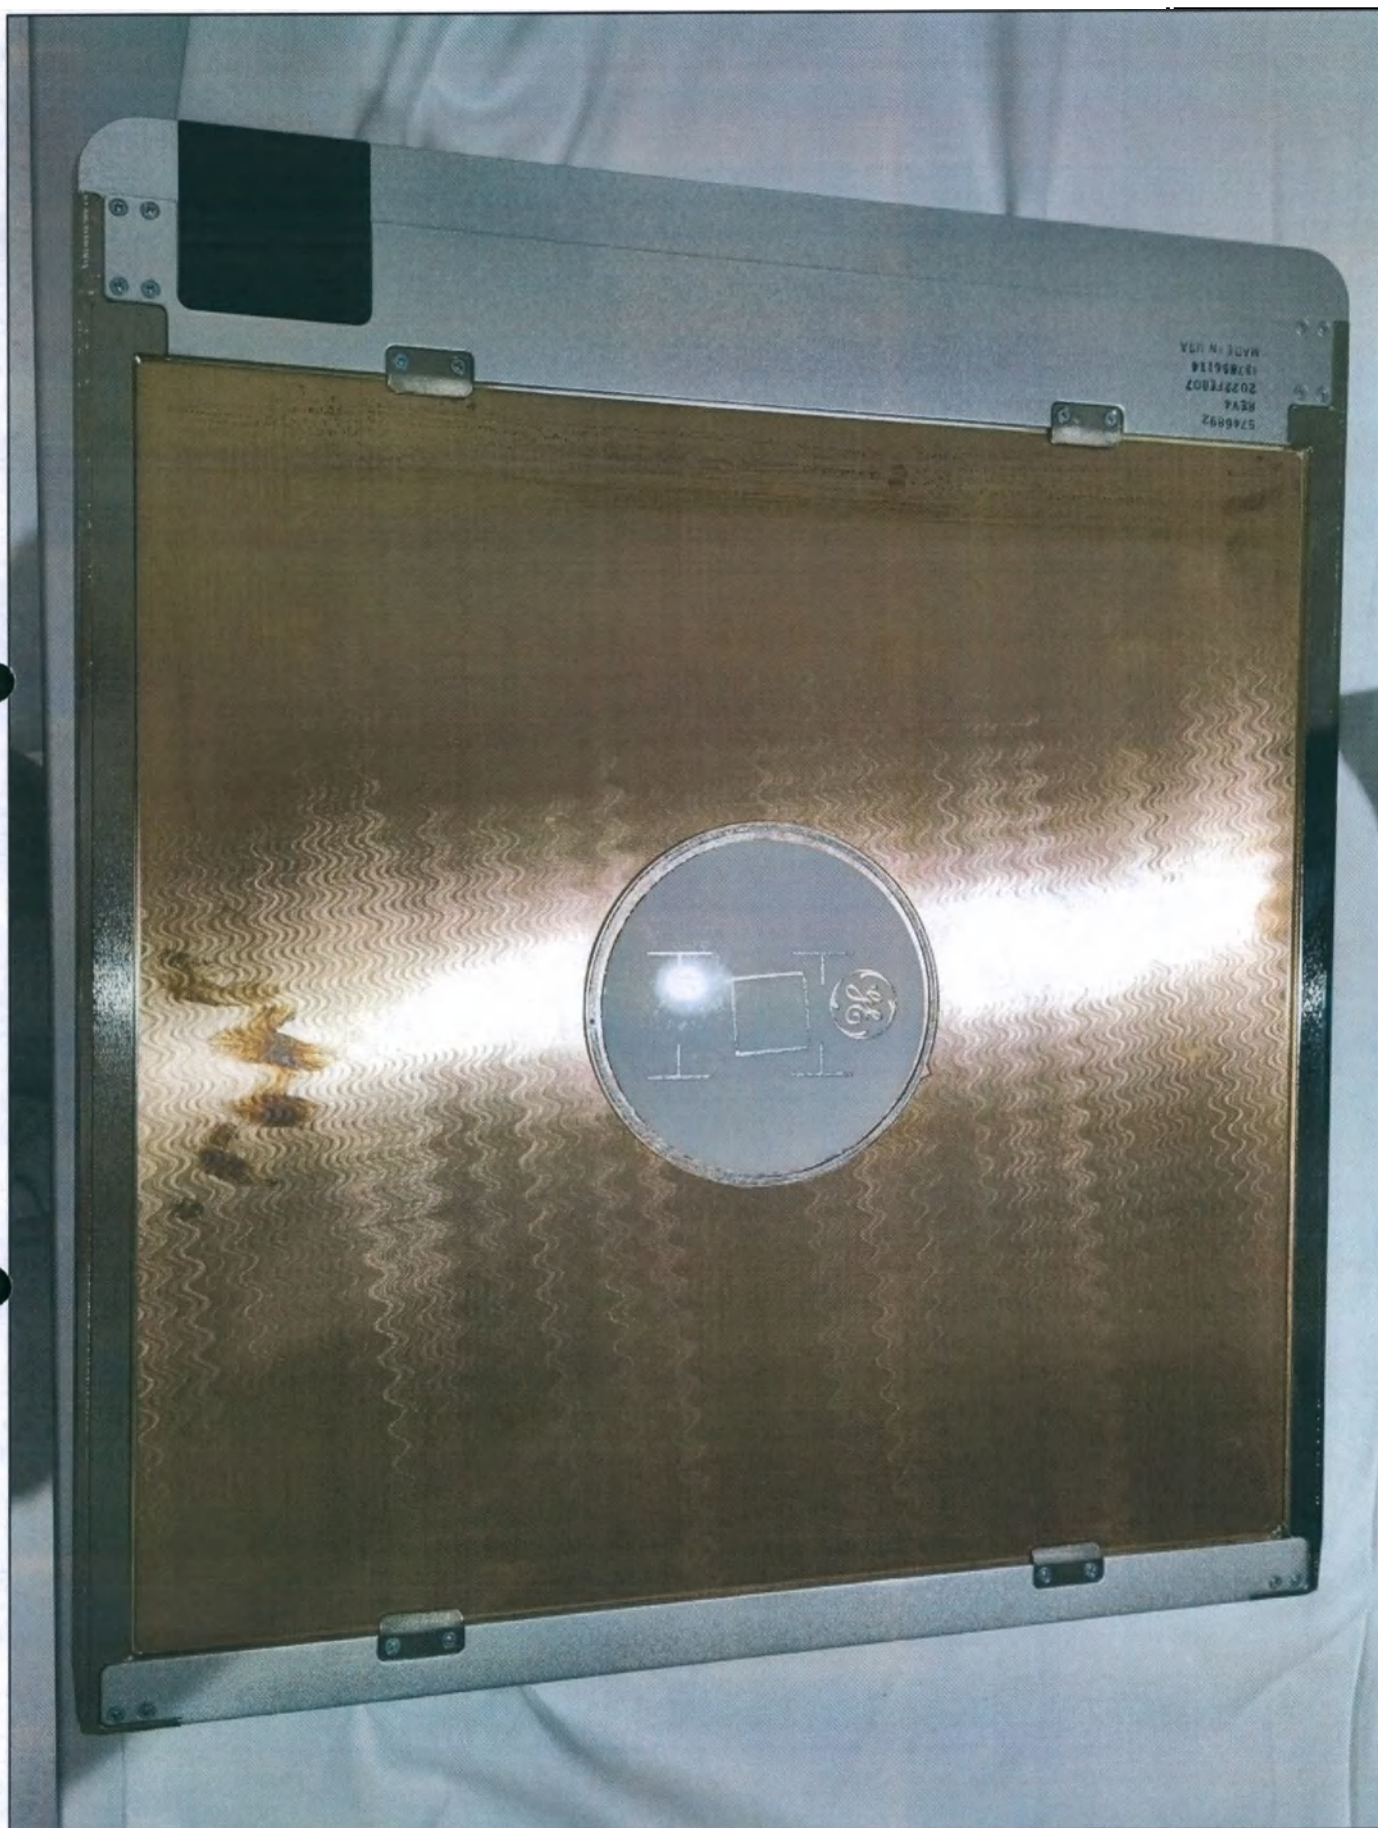

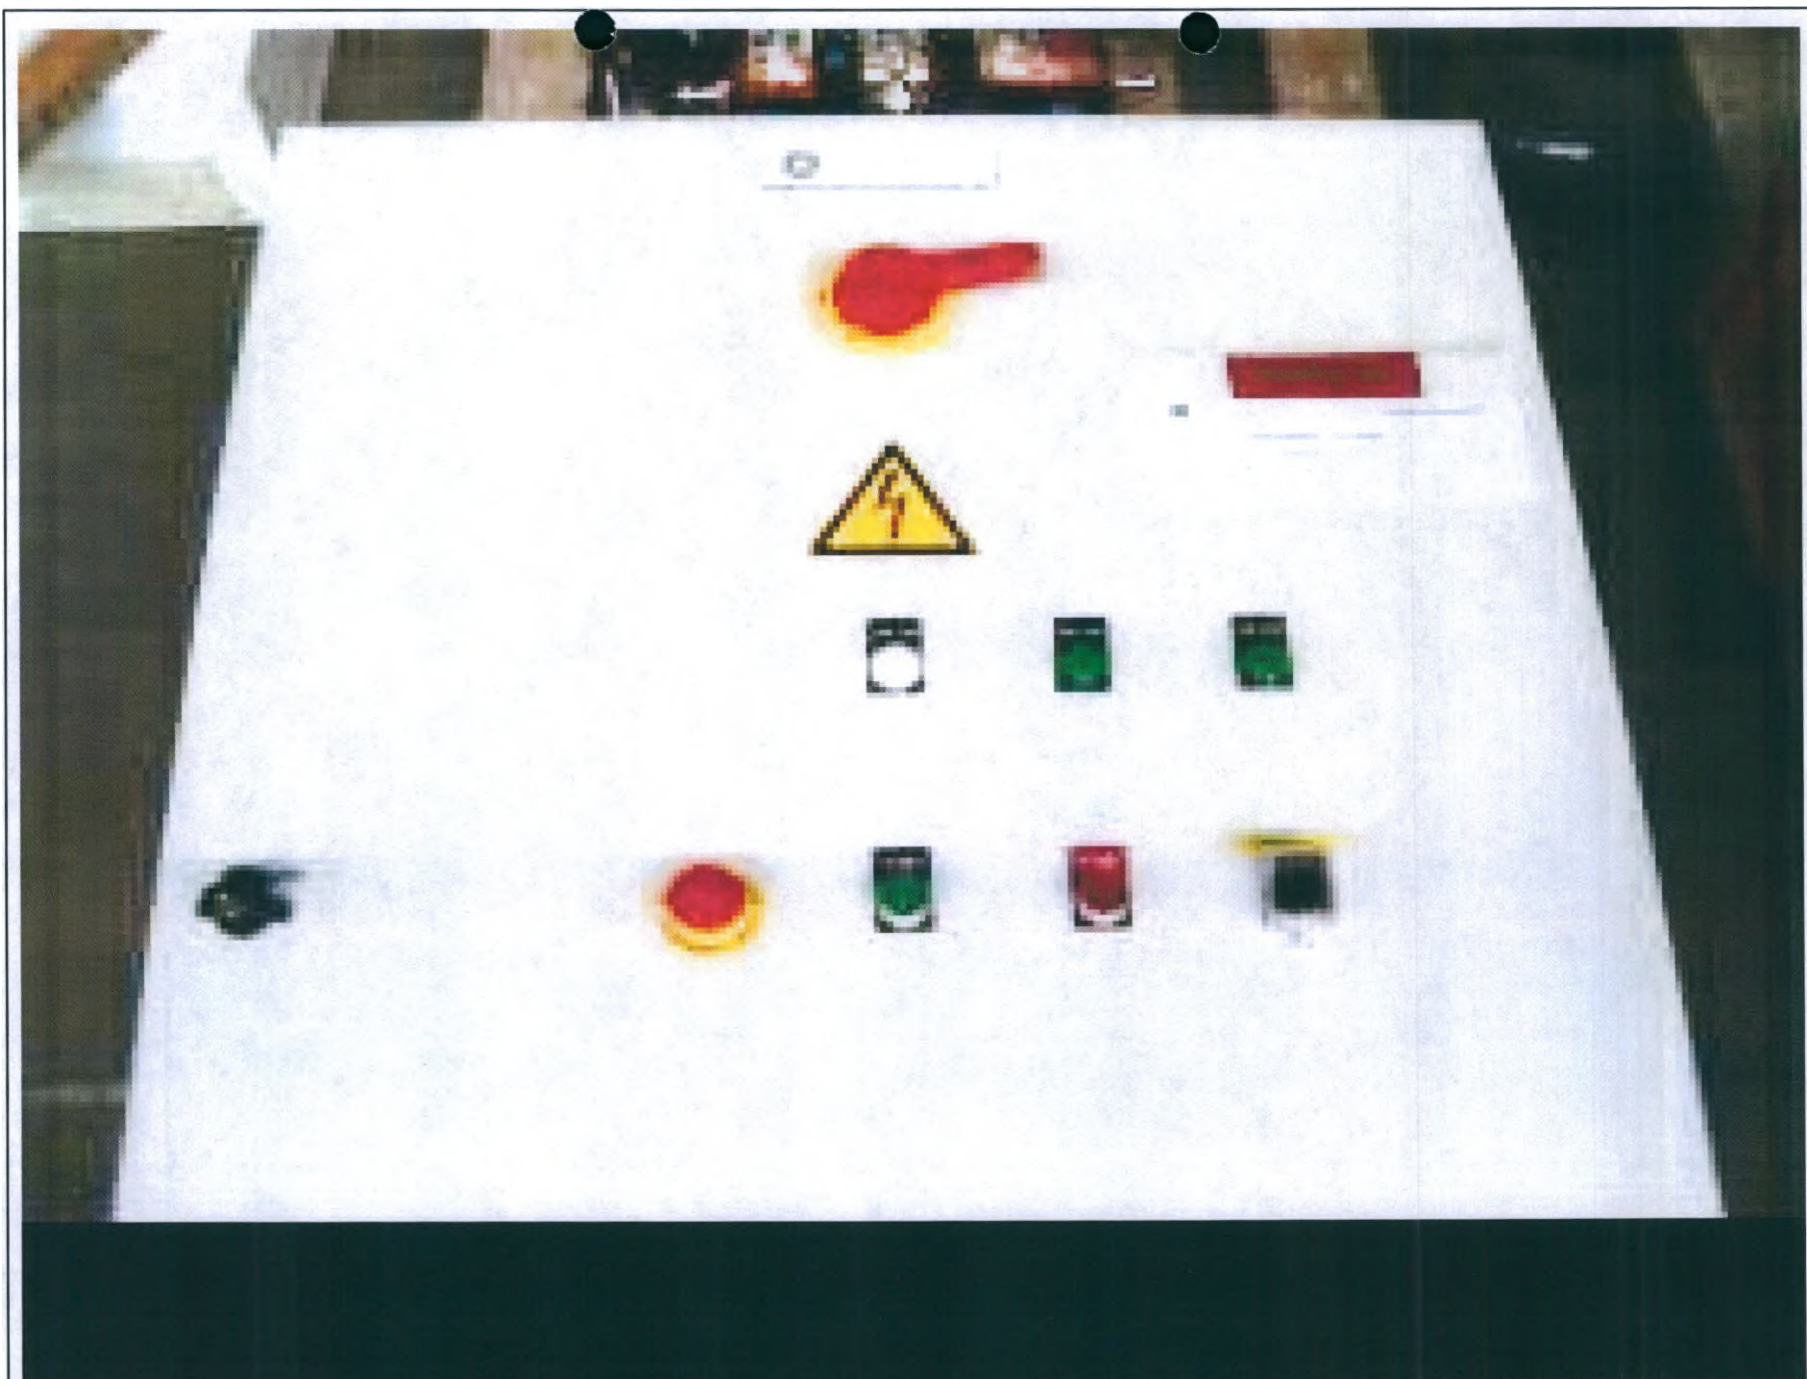

Щиты электрораспределительные.

Щиты электрораспределительные.

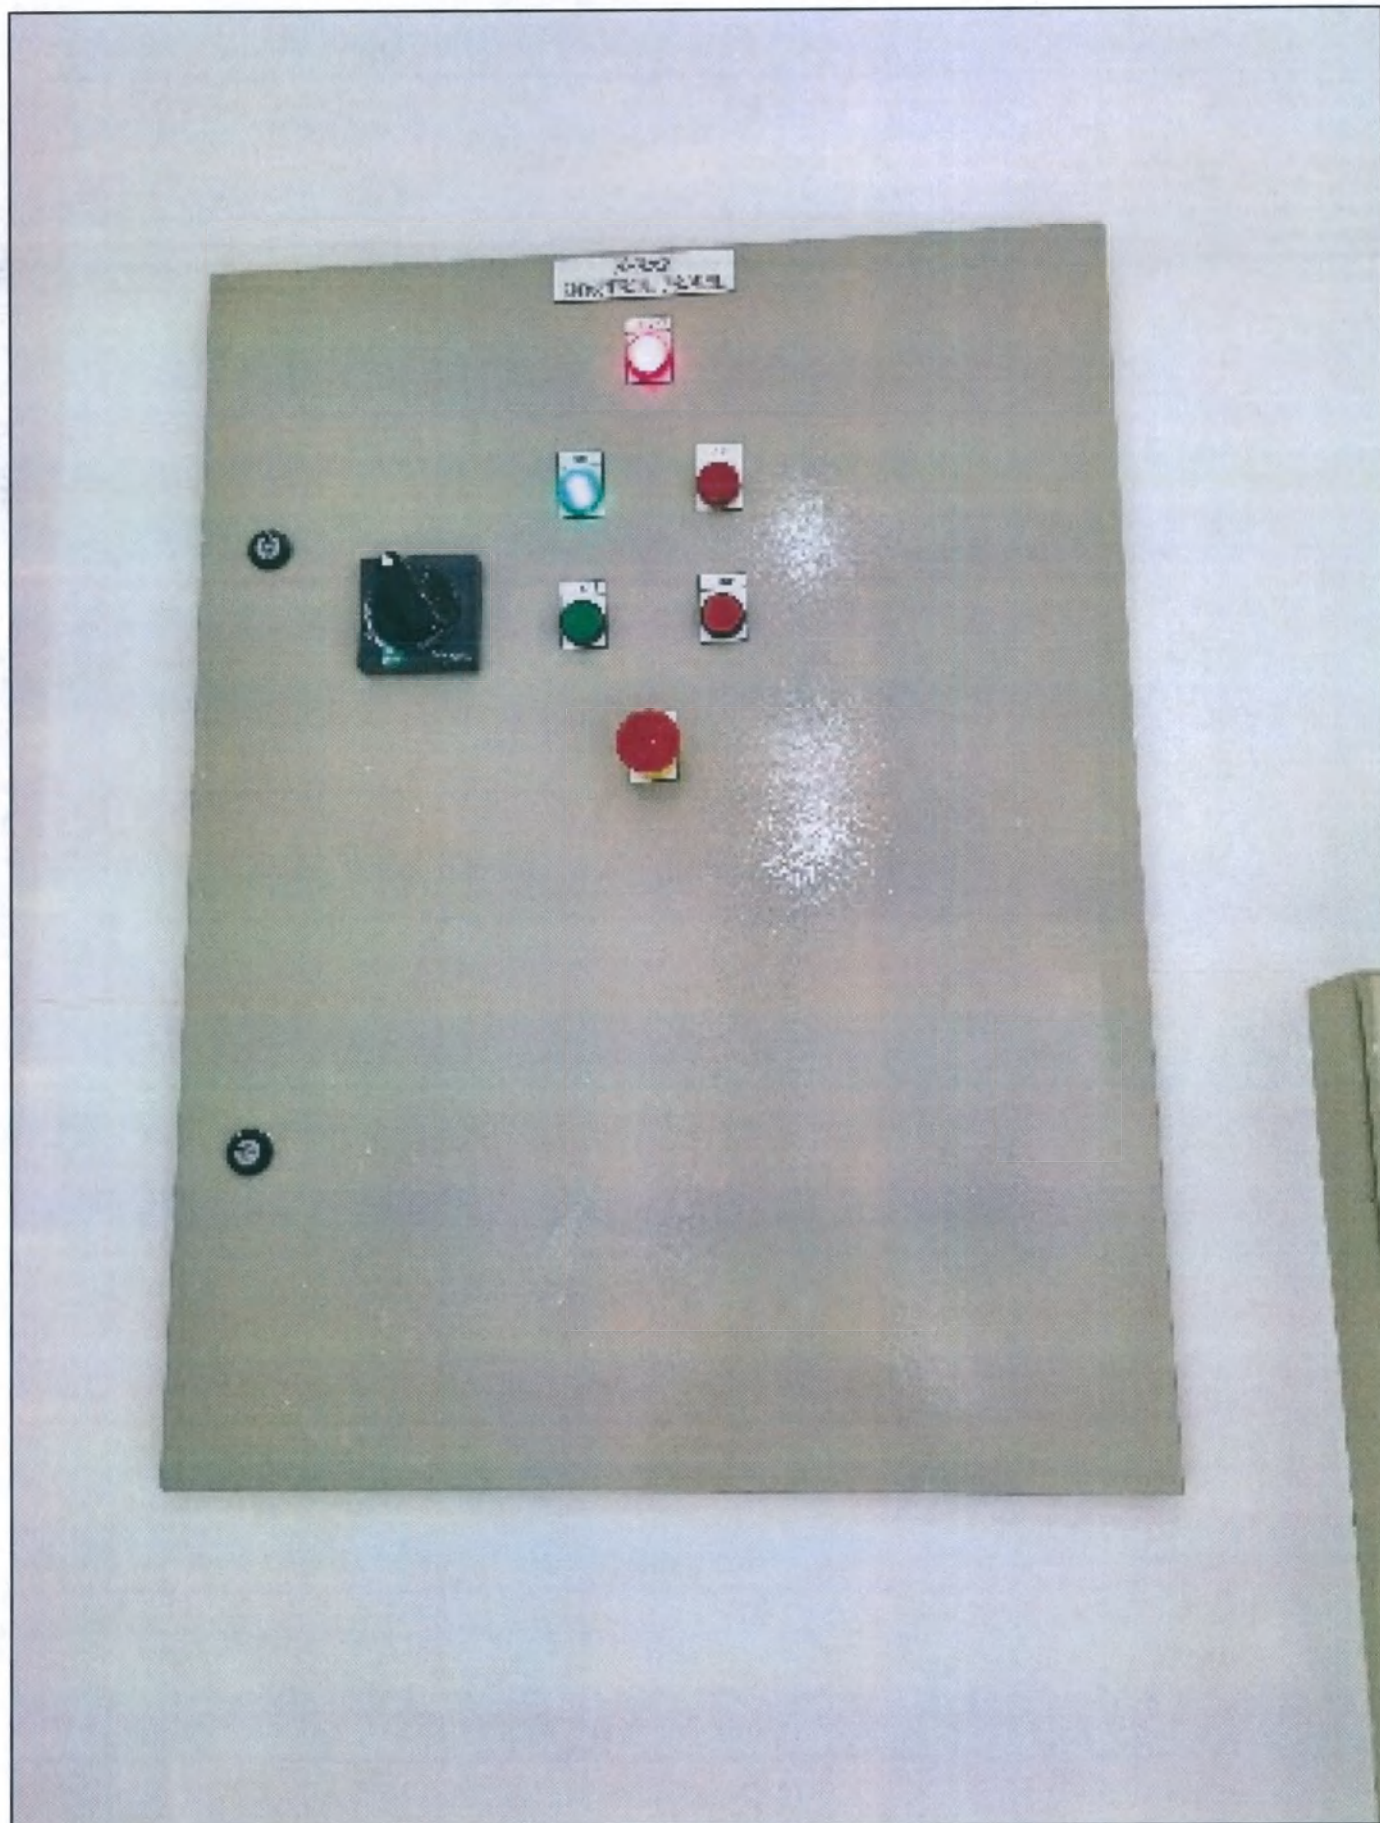


Камера.






Фиксатор детектора.

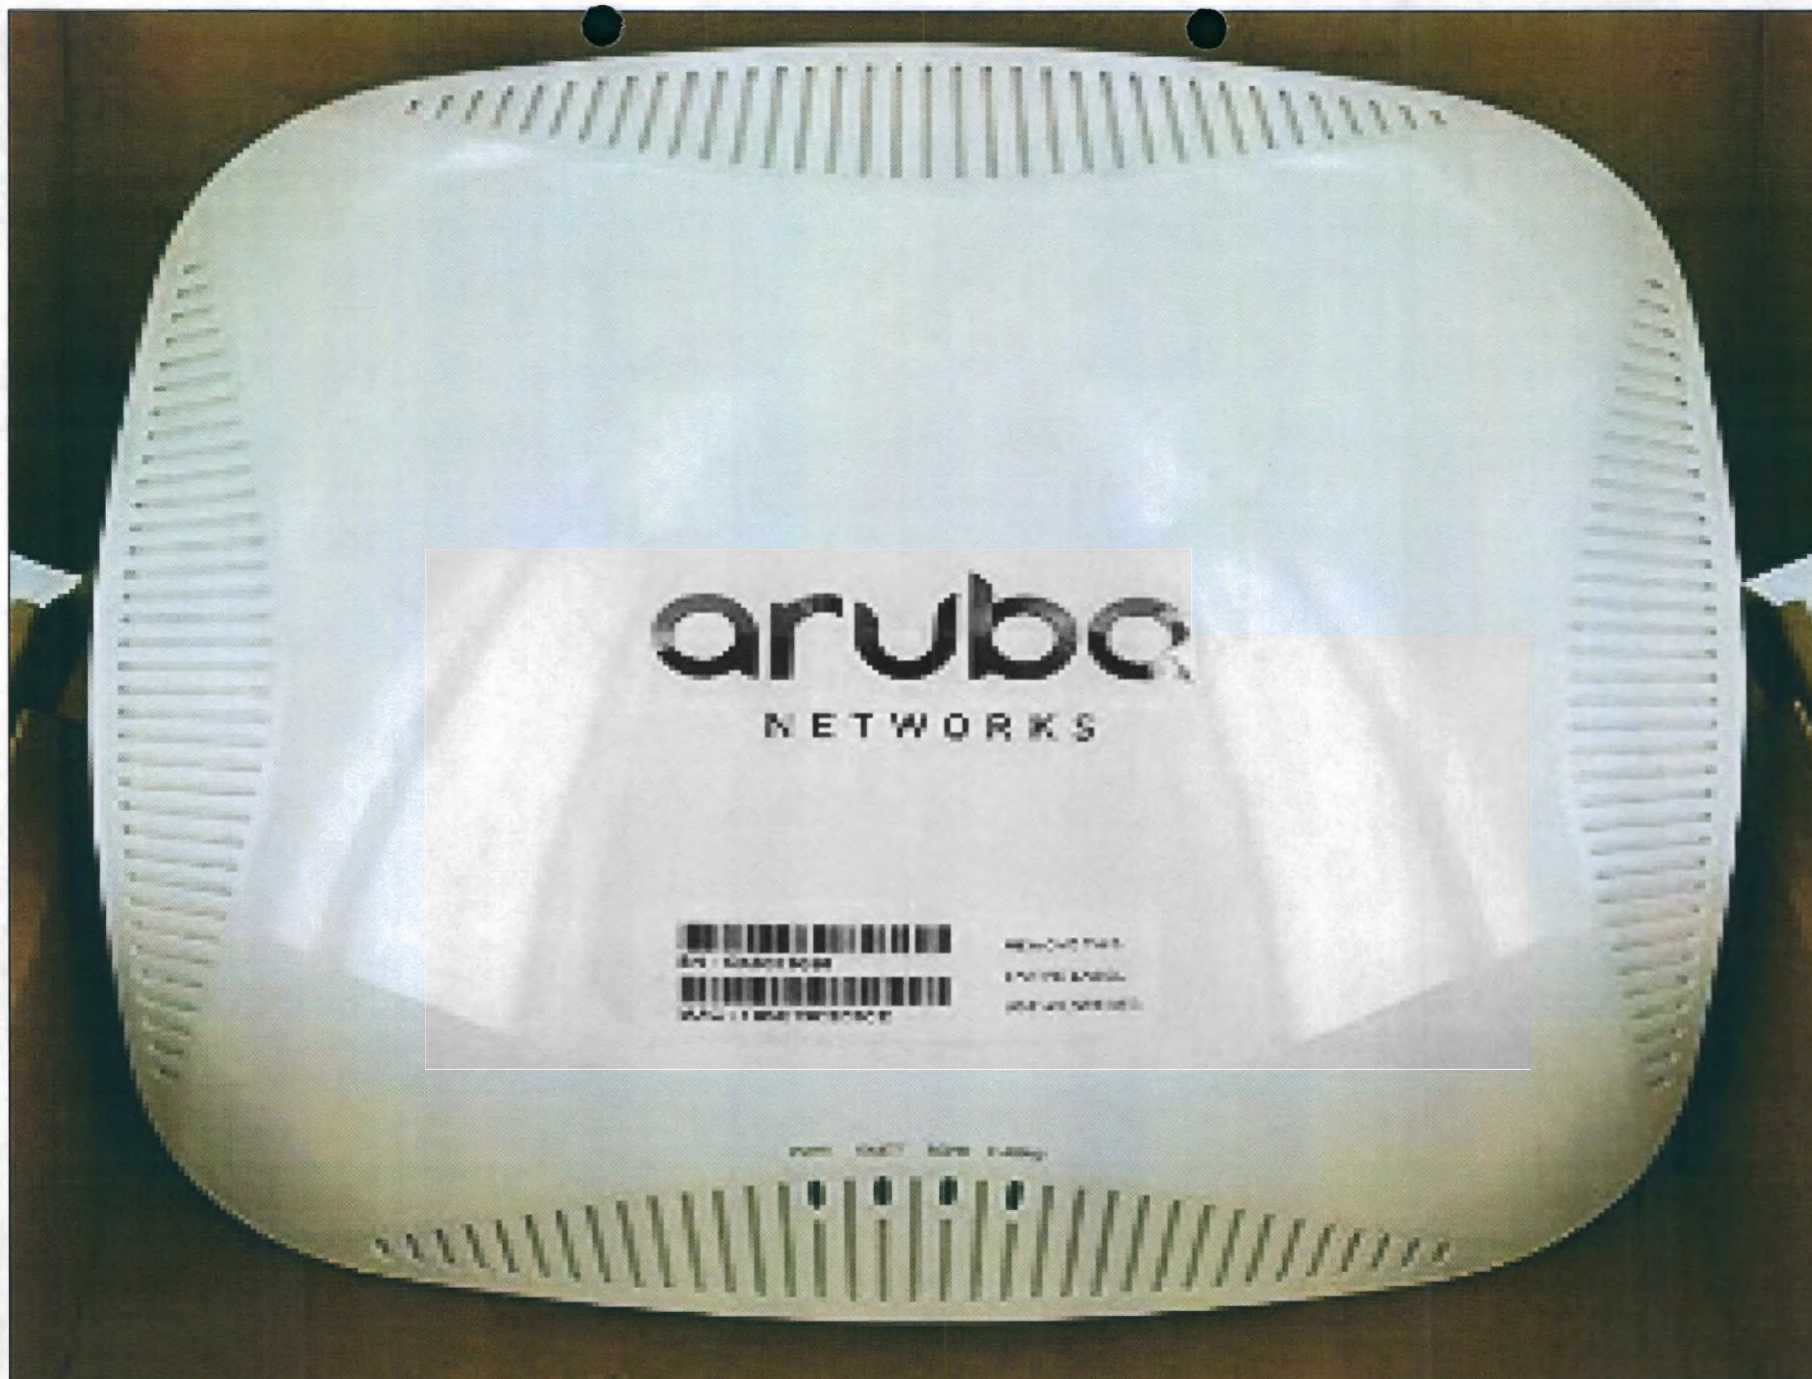

Точка доступа.

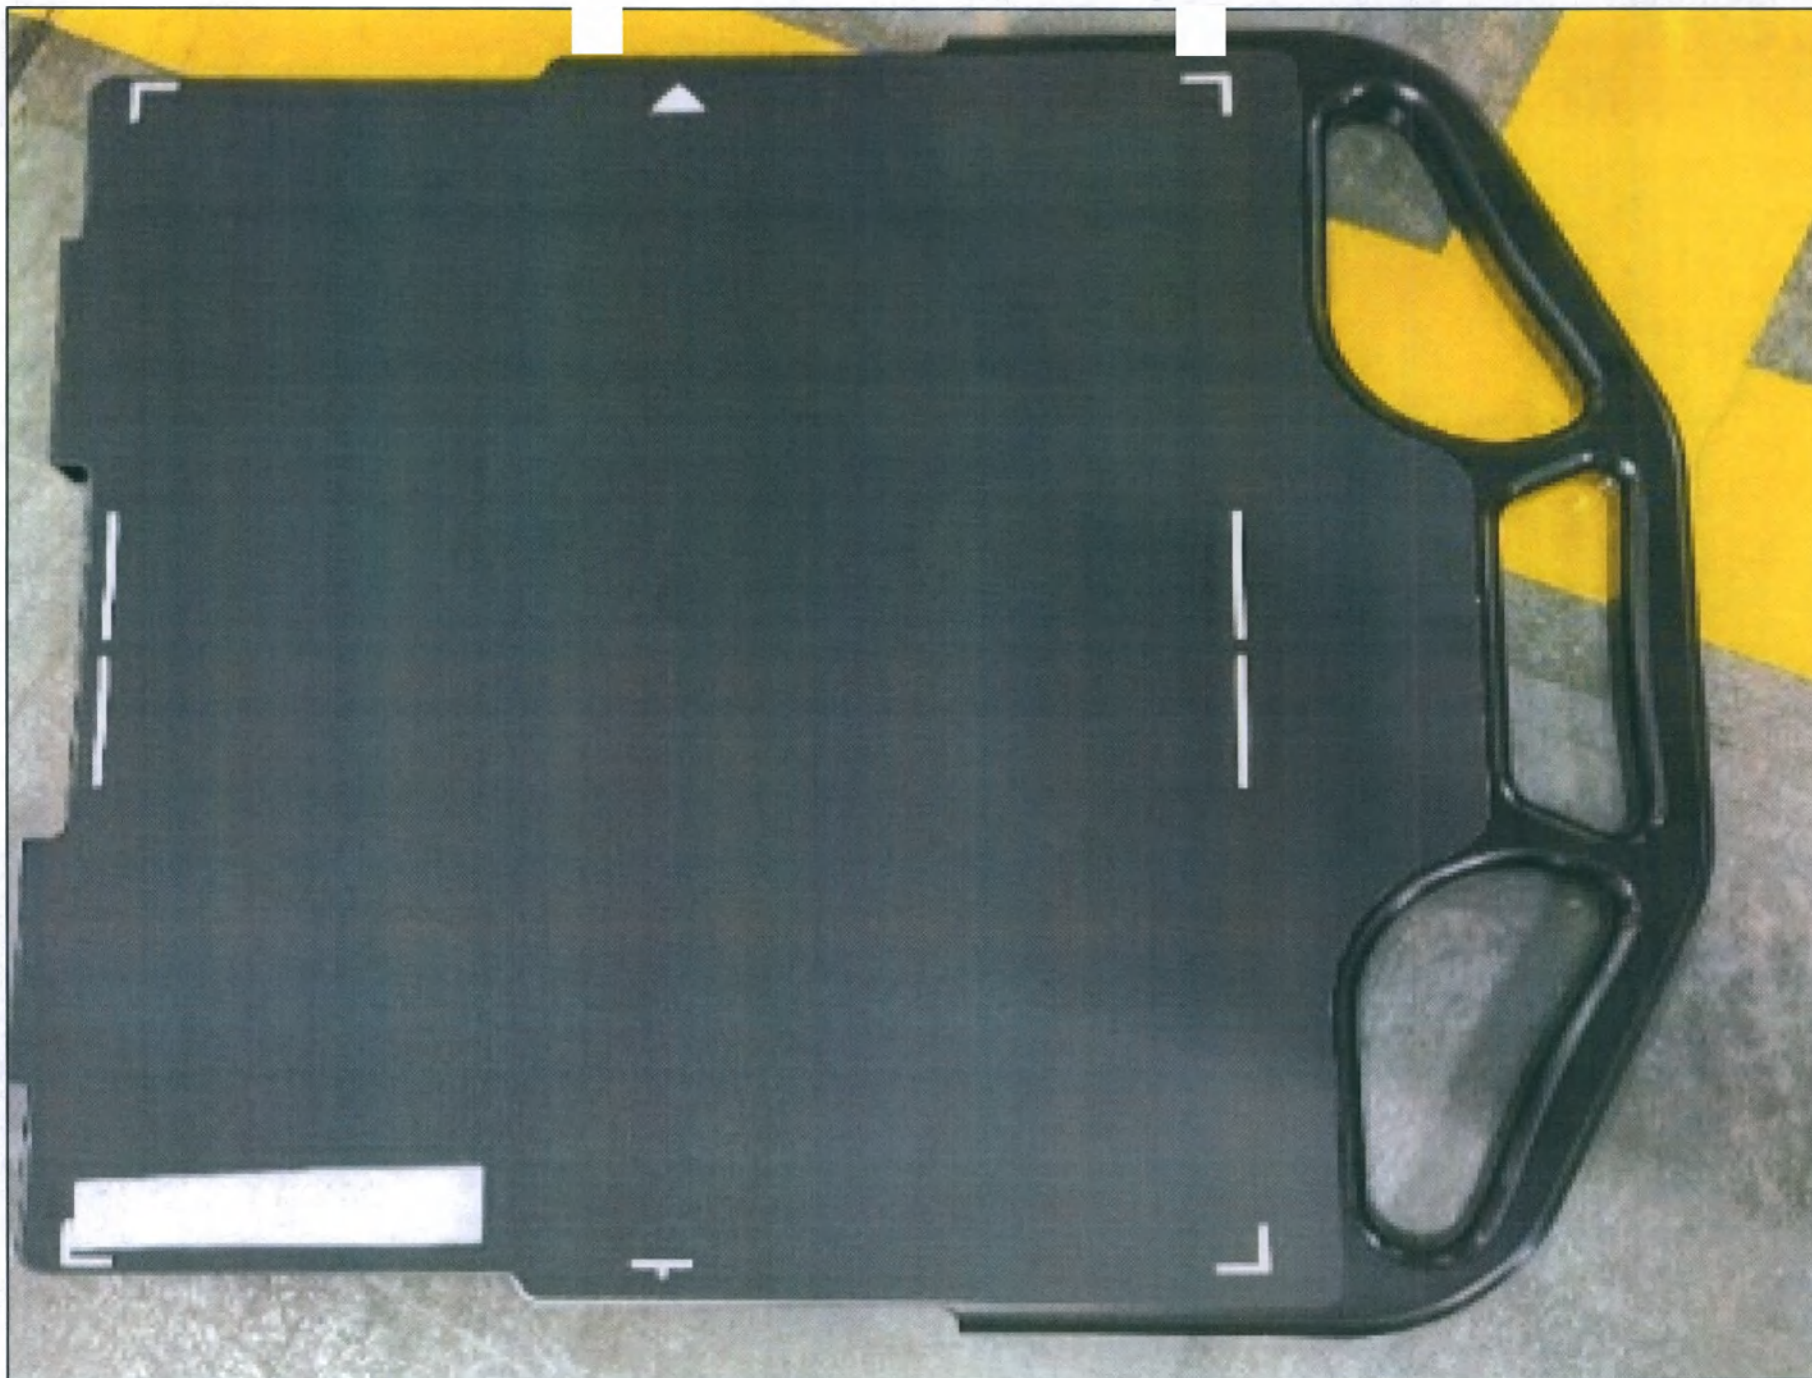

Ручки детектора с решеткой.



Ручки детектора без решетки.




Решетки детектора.

Крышки весовой нагрузки для детектора.



Интерфейсный блок кабеля-троса.

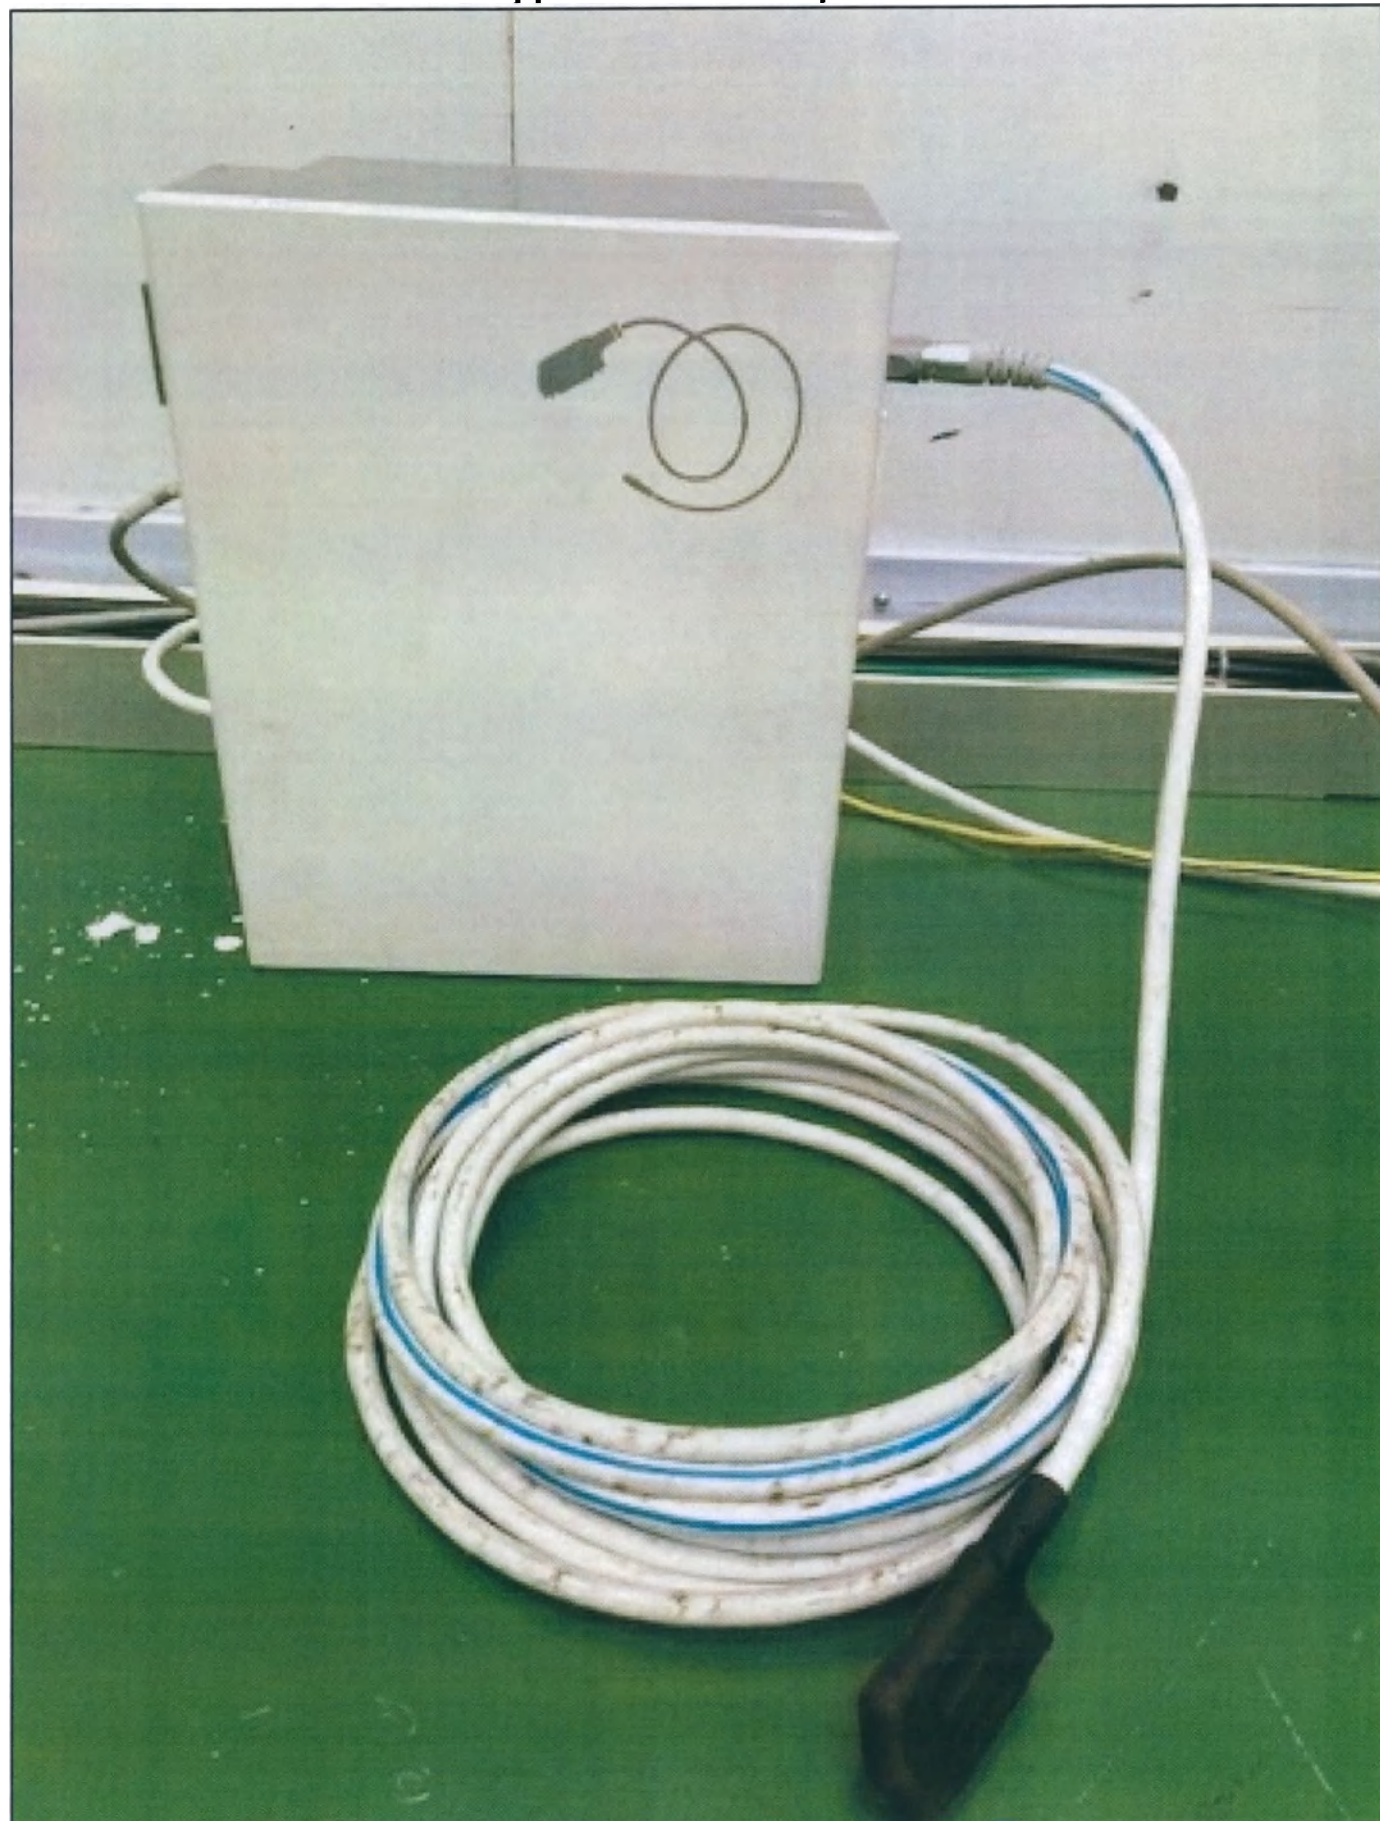




Кабель-трос.

Стул-стремянка.



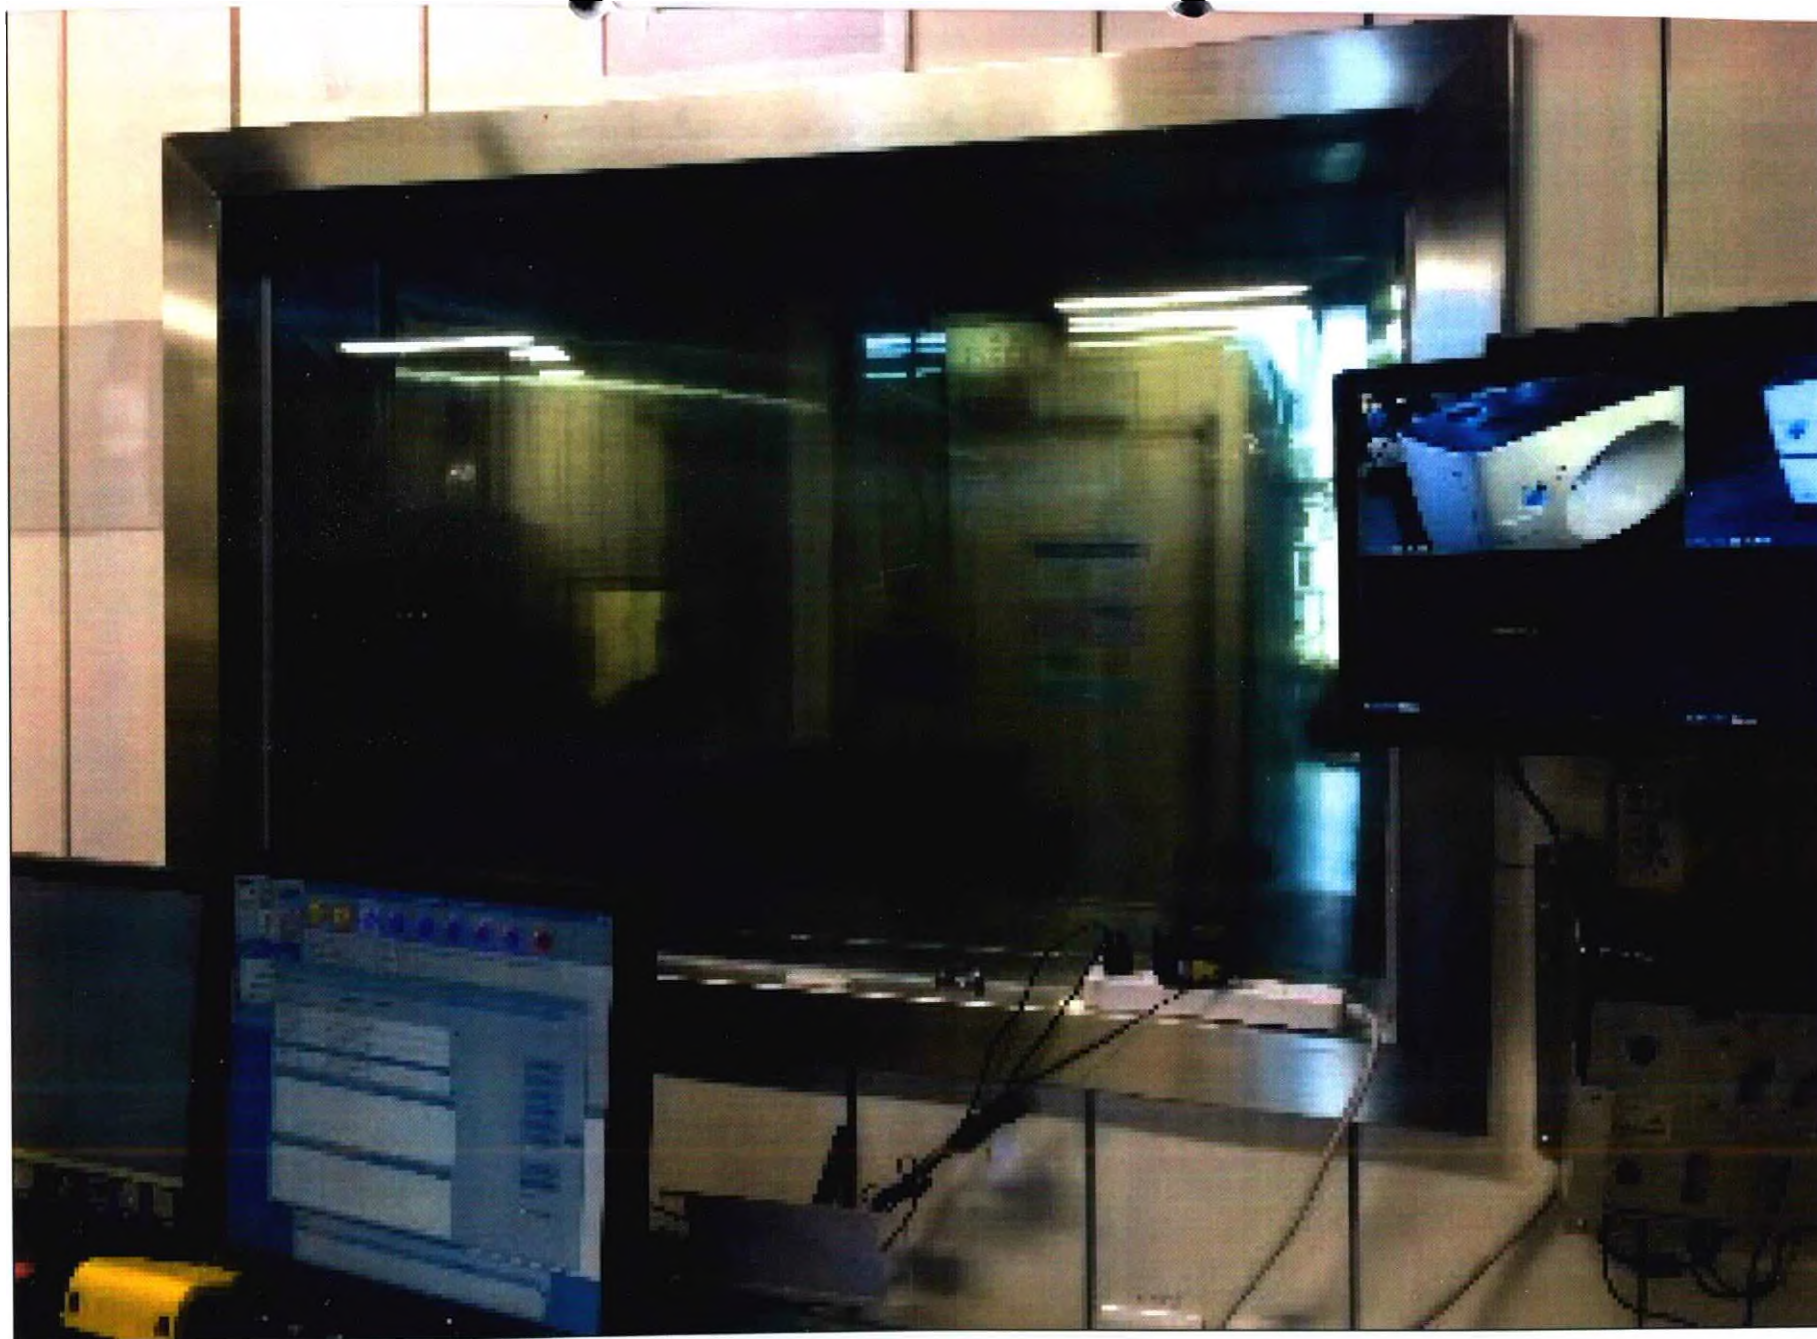

Стекла рентгенозащитные с рамой.

ООО «Джи Хэлскеа»

Итого в настоящем документе
72 (72) листа(-ов)

Директор деп. Регистрации и
сертификации Россия и СНГ
Харитонов А.П.

МП

