



GE Healthcare

123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Пресненский, наб. Пресненская, дом 10,
помещ. I, этаж 14, ком. 30
Т: +7 495 739 6931
Ф: +7 495 739 6932

Фотографические изображения медицинского изделия

Система ультразвуковая диагностическая медицинская Logiq E10 с принадлежностями

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель отдела
регистрации и сертификации Россия и СНГ
ООО «ДжиИ Хэлскеа»




А.П. Харитонов

« 23 »

2022 г.

Консоль для системы ультразвуковой диагностической медицинской

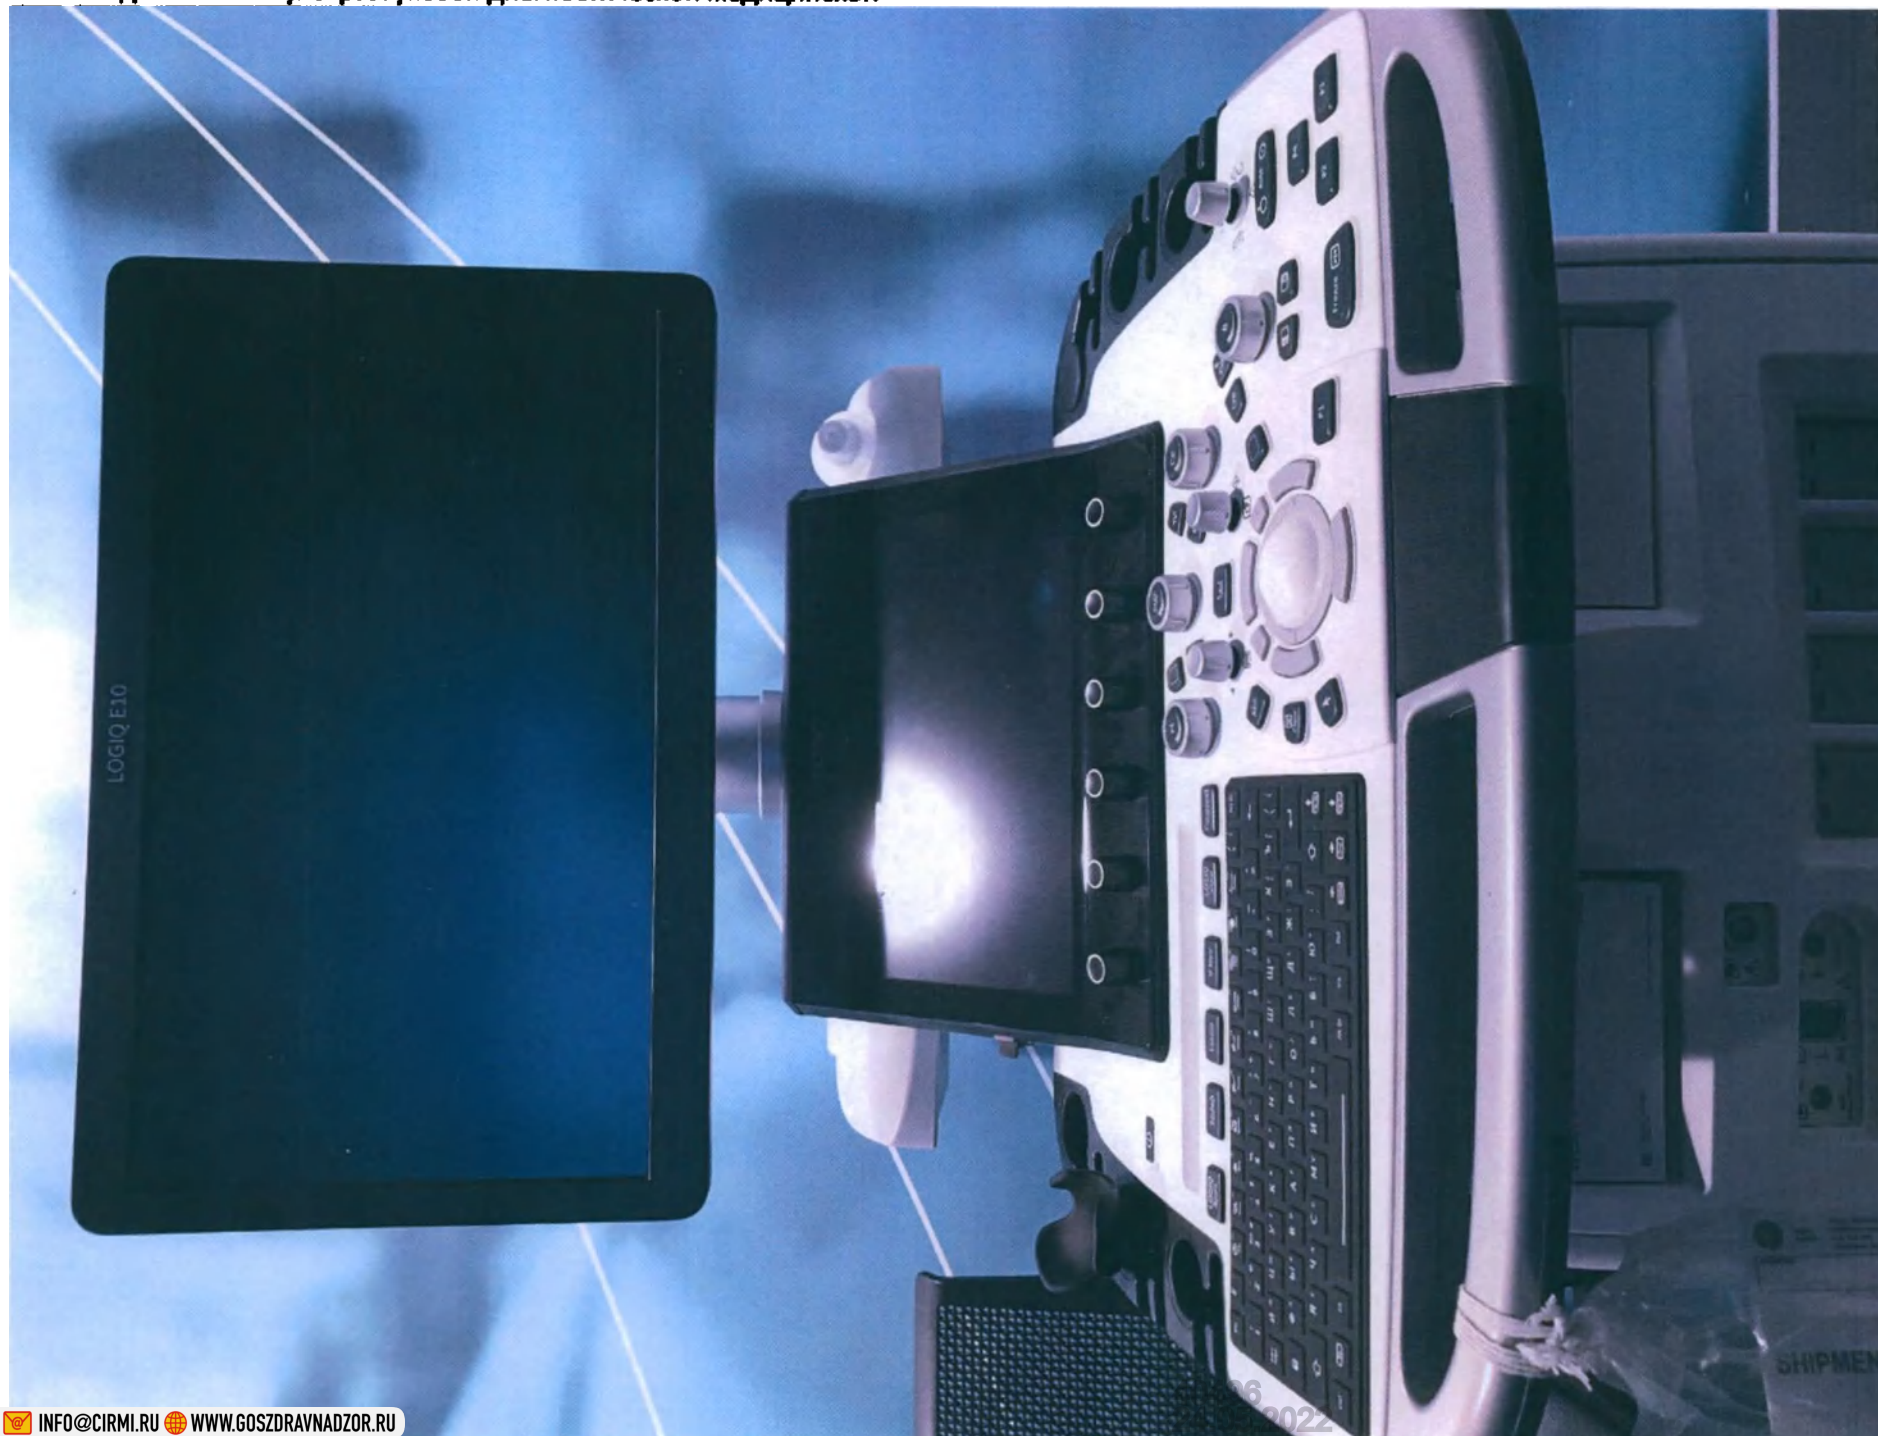



Кабель электропитания - не более 5 шт.



Руководство по эксплуатации - не более 5 шт.

Station & Doc. Disk on Key - catalog No. 33



Датчики секторные фазированные 6S-D, РУ № РЗН 2016/3930 ("ДжиИ Медикал Системз Израиль Лтд.", Израиль) - не более 2 шт. (при необходимости).




Датчики секторные фазированные M5Sc-D, РУ № РЗН 2016/3930 ("ДжиИ Медикал Системз Израиль Лтд.", Израиль) - не более 2 шт. (при необходимости).



Насадка для проведения объемной навигации V Nav для секторных фазированных датчиков, РУ № ФСЗ 2009/04522 ("ДжиИ Медикал Системз Ультрасаунд энд Праймери Кеа Диагностикас, ЛЛС", США) - не более 50 шт. (при необходимости).



Насадка для проведения объемной навигации V Nav для секторных фазированных датчиков, РУ № ФСЗ 2009/04522 ("ДжиИ Медикал Системз Ультрасаунд энд Праймери Кеа Диагностикс, ЛЛС", США) - не более 50 шт. (при необходимости).

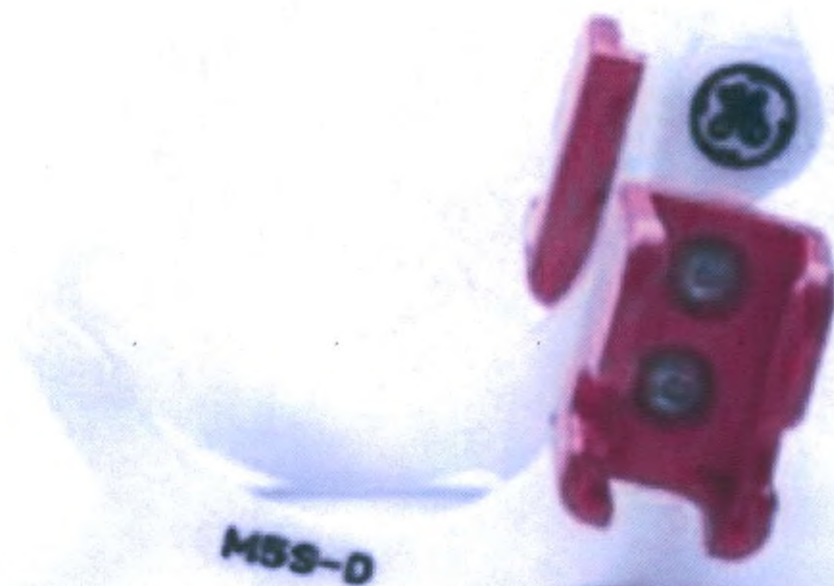

Датчики конвексные серии С, РУ № ФСЗ 2011/11249 ("ДжиИ Ультрасаунд Корея, Лтд., Корея) - не более 20 шт. (при необходимости).



Датчики конвексные серии С, РУ № ФСЗ 2011/11249 ("ДжиИ Ультрасаунд Корея, Лтд., Корея) - не более 20 шт. (при необходимости).
(Датчик конвексный С1-6VN-D)




Датчики конвексные серии С , РУ № ФСЗ 2011/11249 ("ДжиИ Ультрасаунд Корея, Лтд., Корея) - не более 20 шт. (при необходимости).
(Датчик конвексный C2-9VN-D)




Датчики конвексные серии С, РУ № ФСЗ 2011/11249 ("ДжиИ Ультрасаунд Корея, Лтд., Корея) - не более 20 шт. (при необходимости).
(Датчик конвексный С2-6b-D)



Датчики конвексные C1-6-D, РУ № РЗН 2015/3460 ("ДжиИ Хэлскеа Австрия ГмбХ &, Ко ОГ", Австрия) - не более 2 шт. (при необходимости).

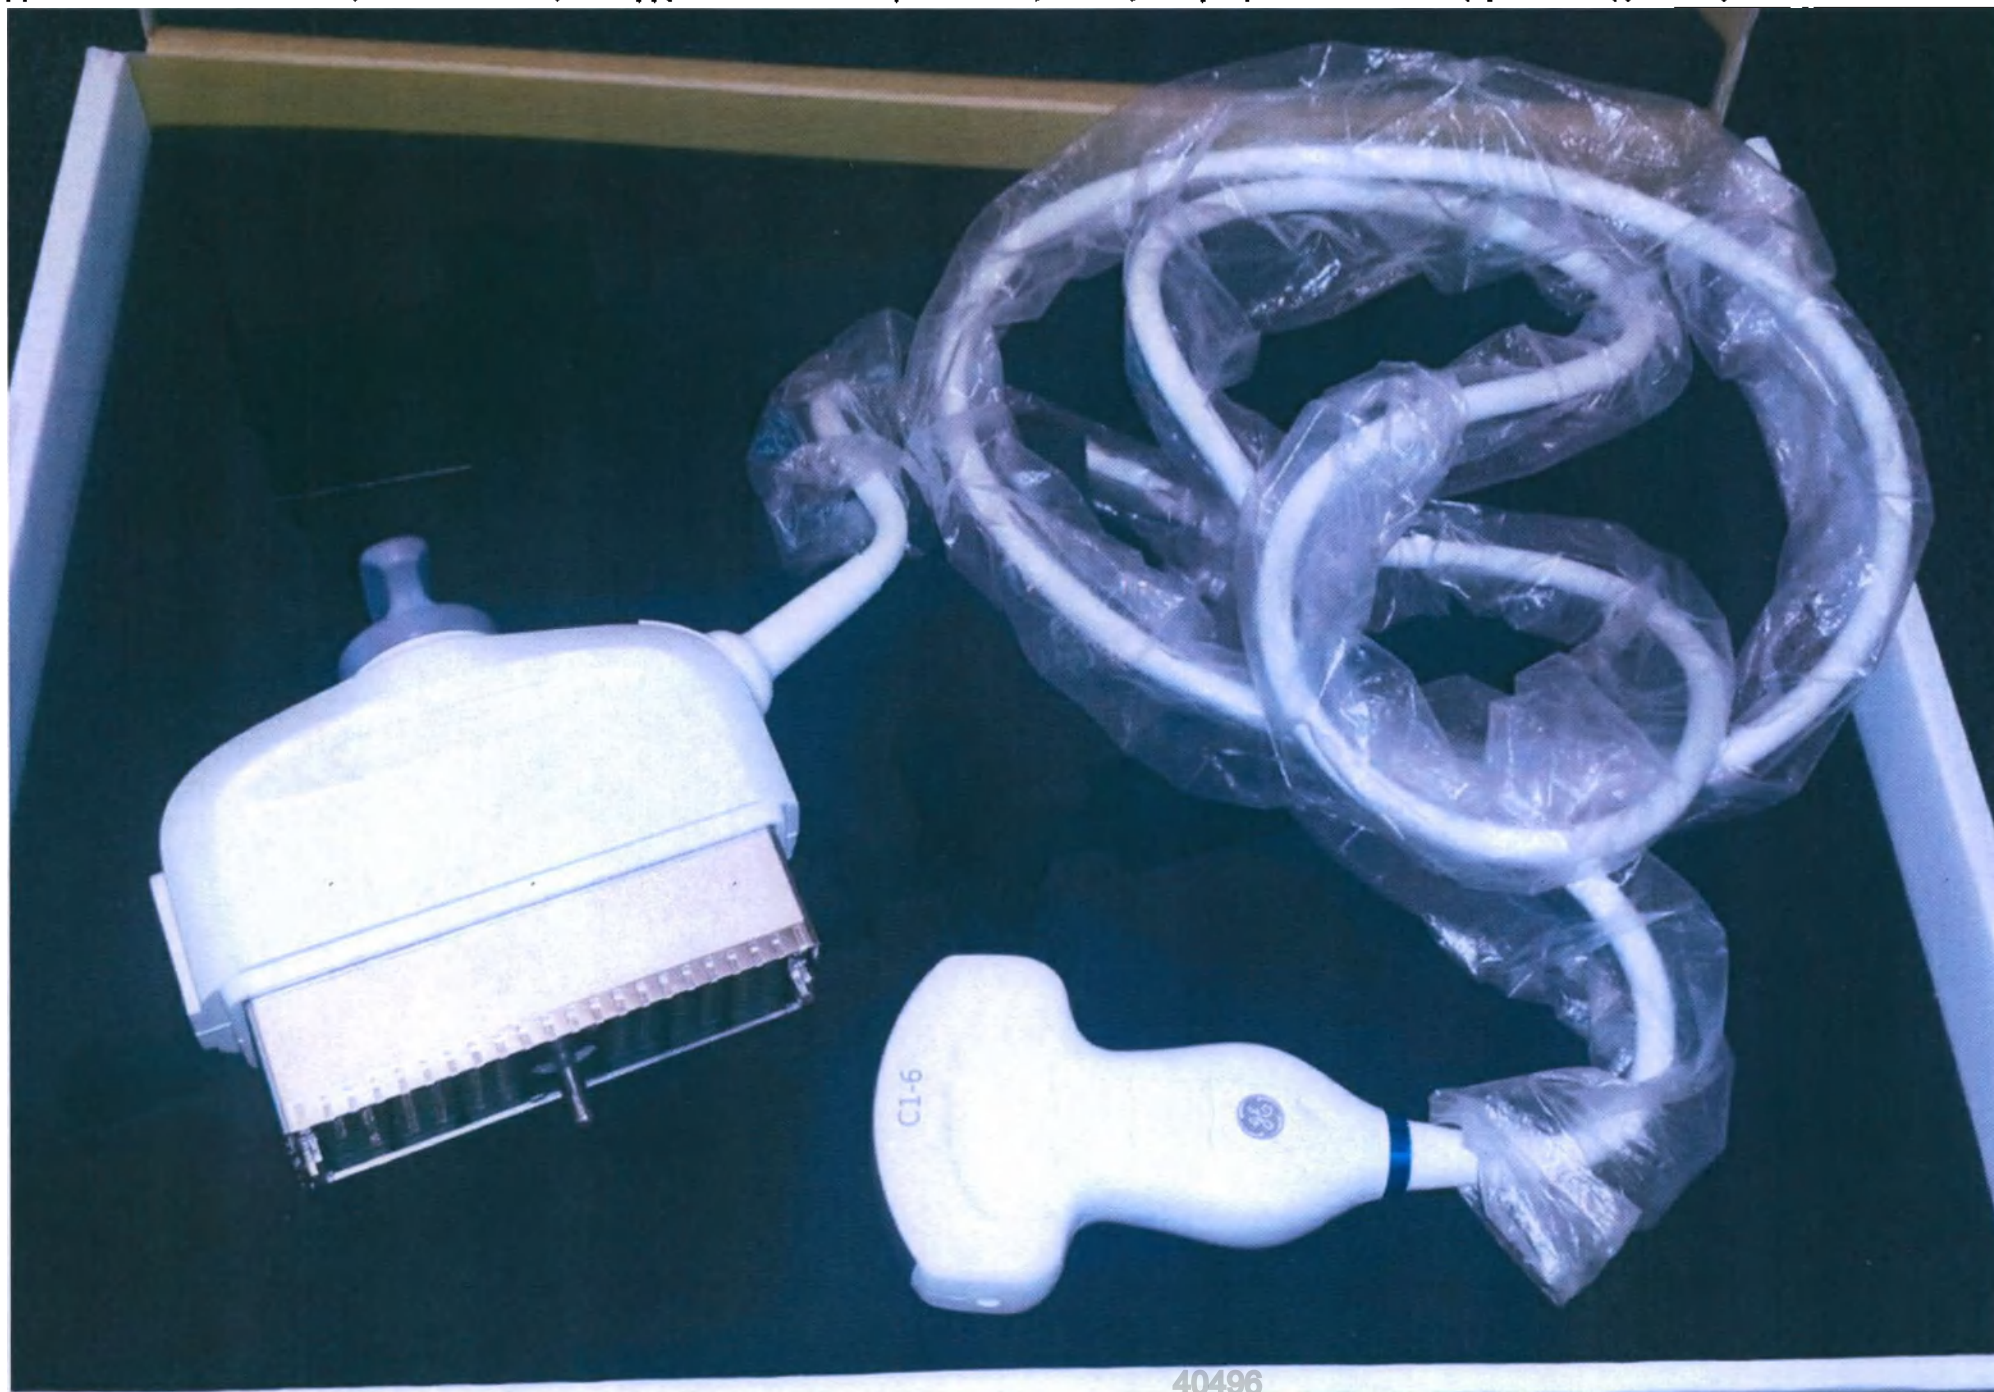

Датчики конвексные С2-9-D, РУ № РЗН 2015/3460 ("Джии Хэлскеа Австрия ГмбХ & Ко ОГ", Австрия) - не более 2 шт. (при необходимости).

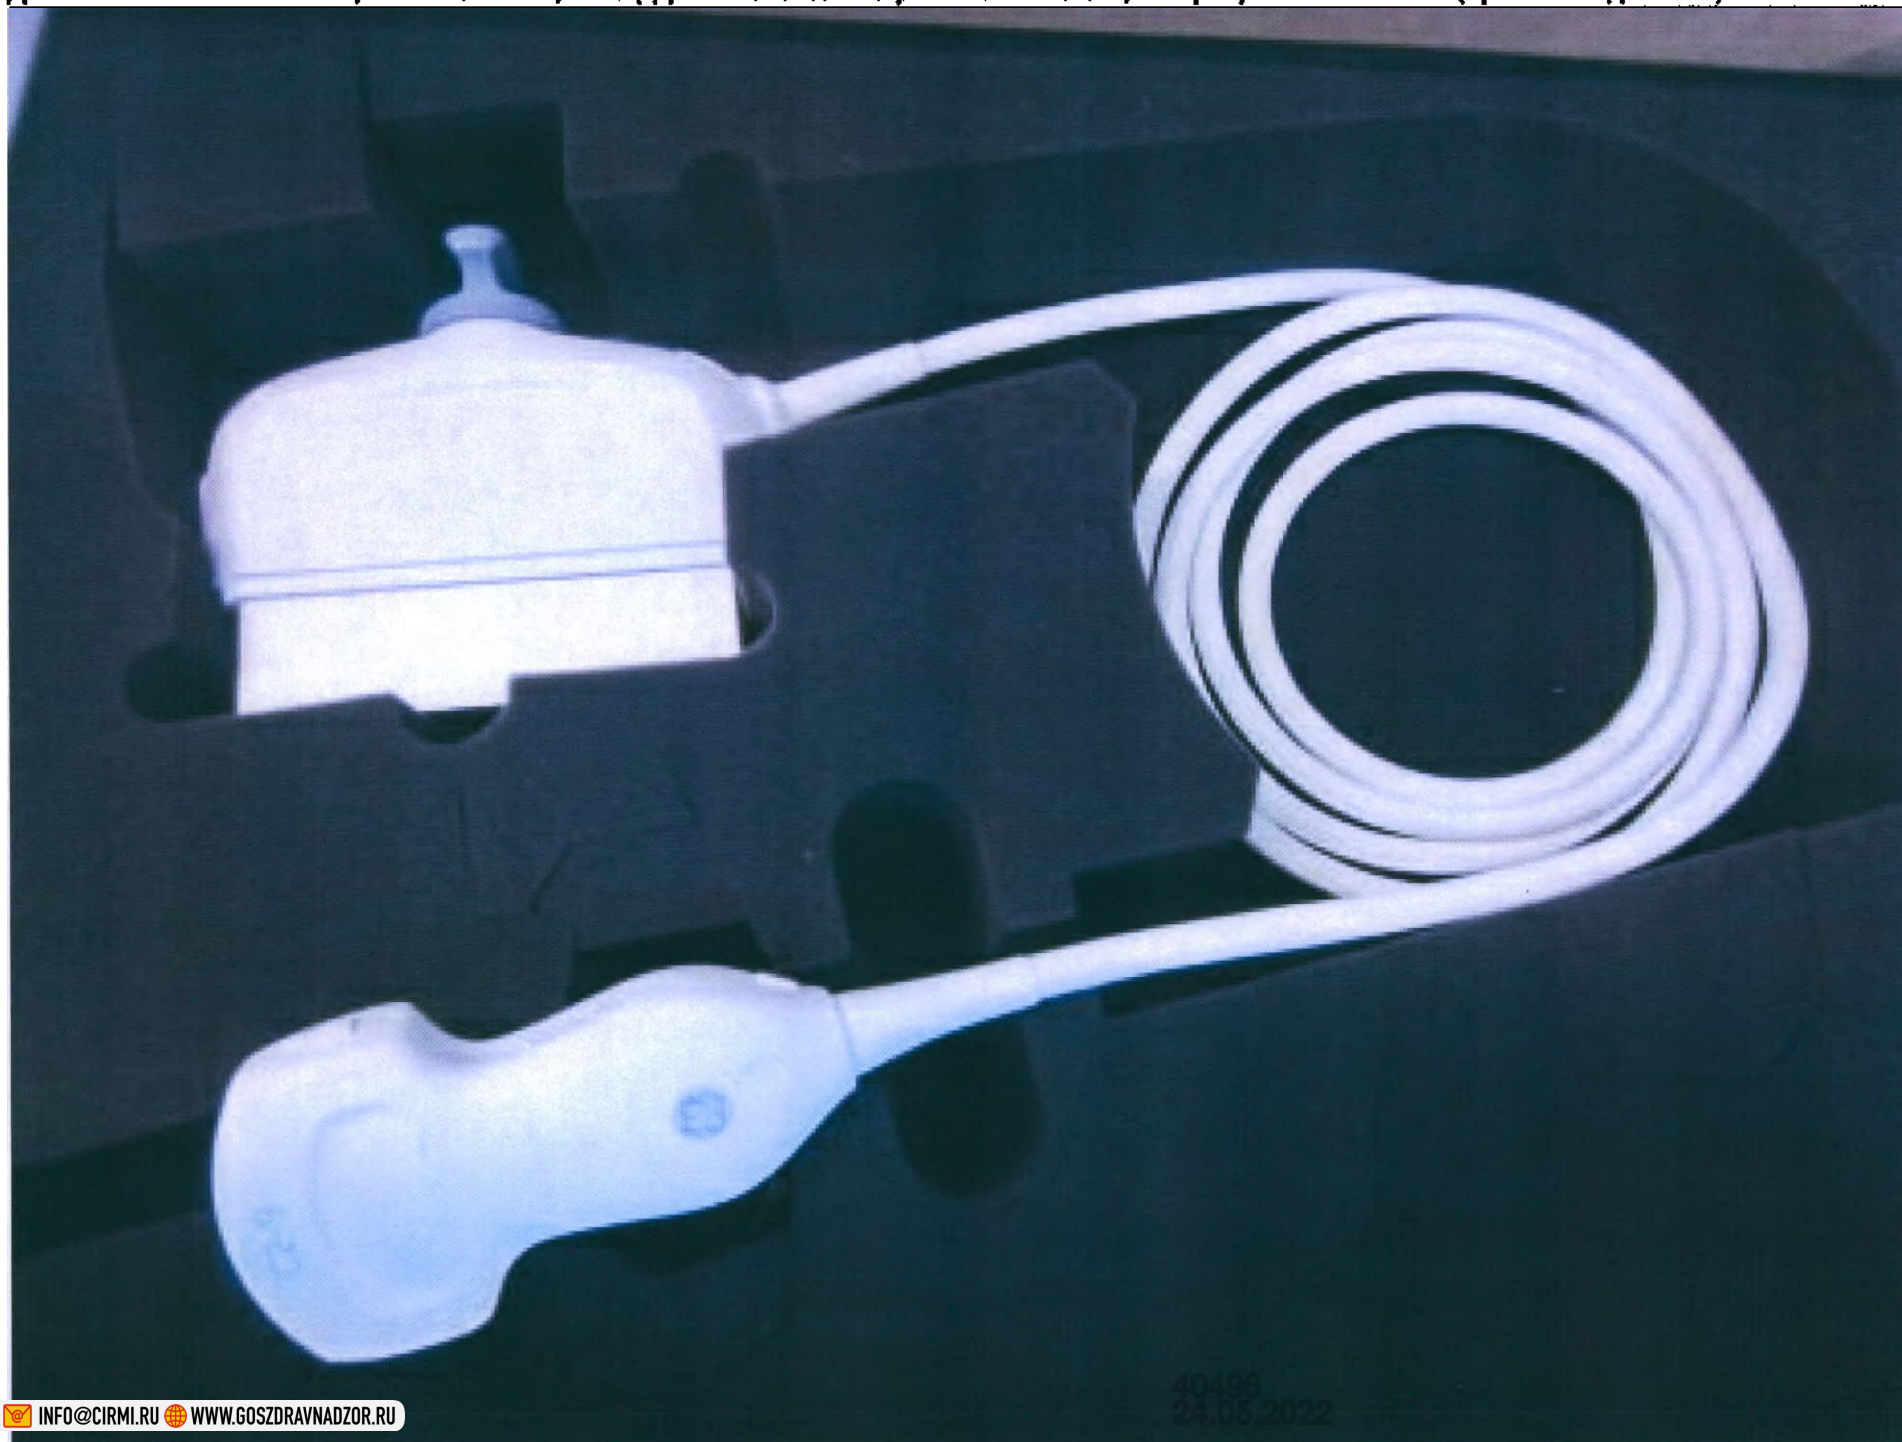

Датчик широкополосный микроконвексный СЗ-10-D, РУ № РЗН 2016/3871 ("ДжиИ Вингмед Ультрасаунд АС", Норвегия) - не более 2 шт. (при необходимости).



Насадка для проведения объемной навигации V Nav для конвексных датчиков, РУ № ФСЗ 2009/04522 ("ДжиИ Медикал Системз Ультрасаунд энд Праймери Кеа Диагностика, ЛЛС", США) - не более 50 шт. (при необходимости).



Насадка для проведения объемной навигации V Nav для конвексных датчиков, РУ № ФСЗ 2009/04522 ("ДжиИ Медикал Системз Ультрасаунд энд Праймери Кеа Диагностикс, ЛЛС", США) - не более 50 шт. (при необходимости).



Датчики линейные серии L, РУ № ФСЗ 2011/11249 ("ДжиИ Ультрасаунд Корея, Лтд.", Корея) - не более 20 шт. (при необходимости).



Датчики линейные серии L, РУ № ФСЗ 2011/11249 ("ДжиИ Ультрасаунд Корея, Лтд.", Корея) - не более 20 шт. (при необходимости).
(Датчик линейный L3-9i-D)



Датчики линейные L2-9-D, РУ № РЗН 2015/3460 ("ДжиИ Хэлскеа Австрия ГмбХ & Ко ОГ", Австрия) - не более 2 шт. (при необходимости).




Датчик линейный L2-9VN-D - не более 2 шт. (при необходимости).



Датчики матричные линейные ML6-15-D, РУ №РЗН 2015/3460 («ДжиИ Хэлскеа Австрия ГмбХ & Ко ОГ», Австрия) - не более 20 шт. (при необходимости).



Датчики линейные L8-18i-D, РУ № РНЗ 2020/10591 ("ДжиИ Вингмед Ультрасаунд АС", Норвегия) - не более 2 шт. (при необходимости).

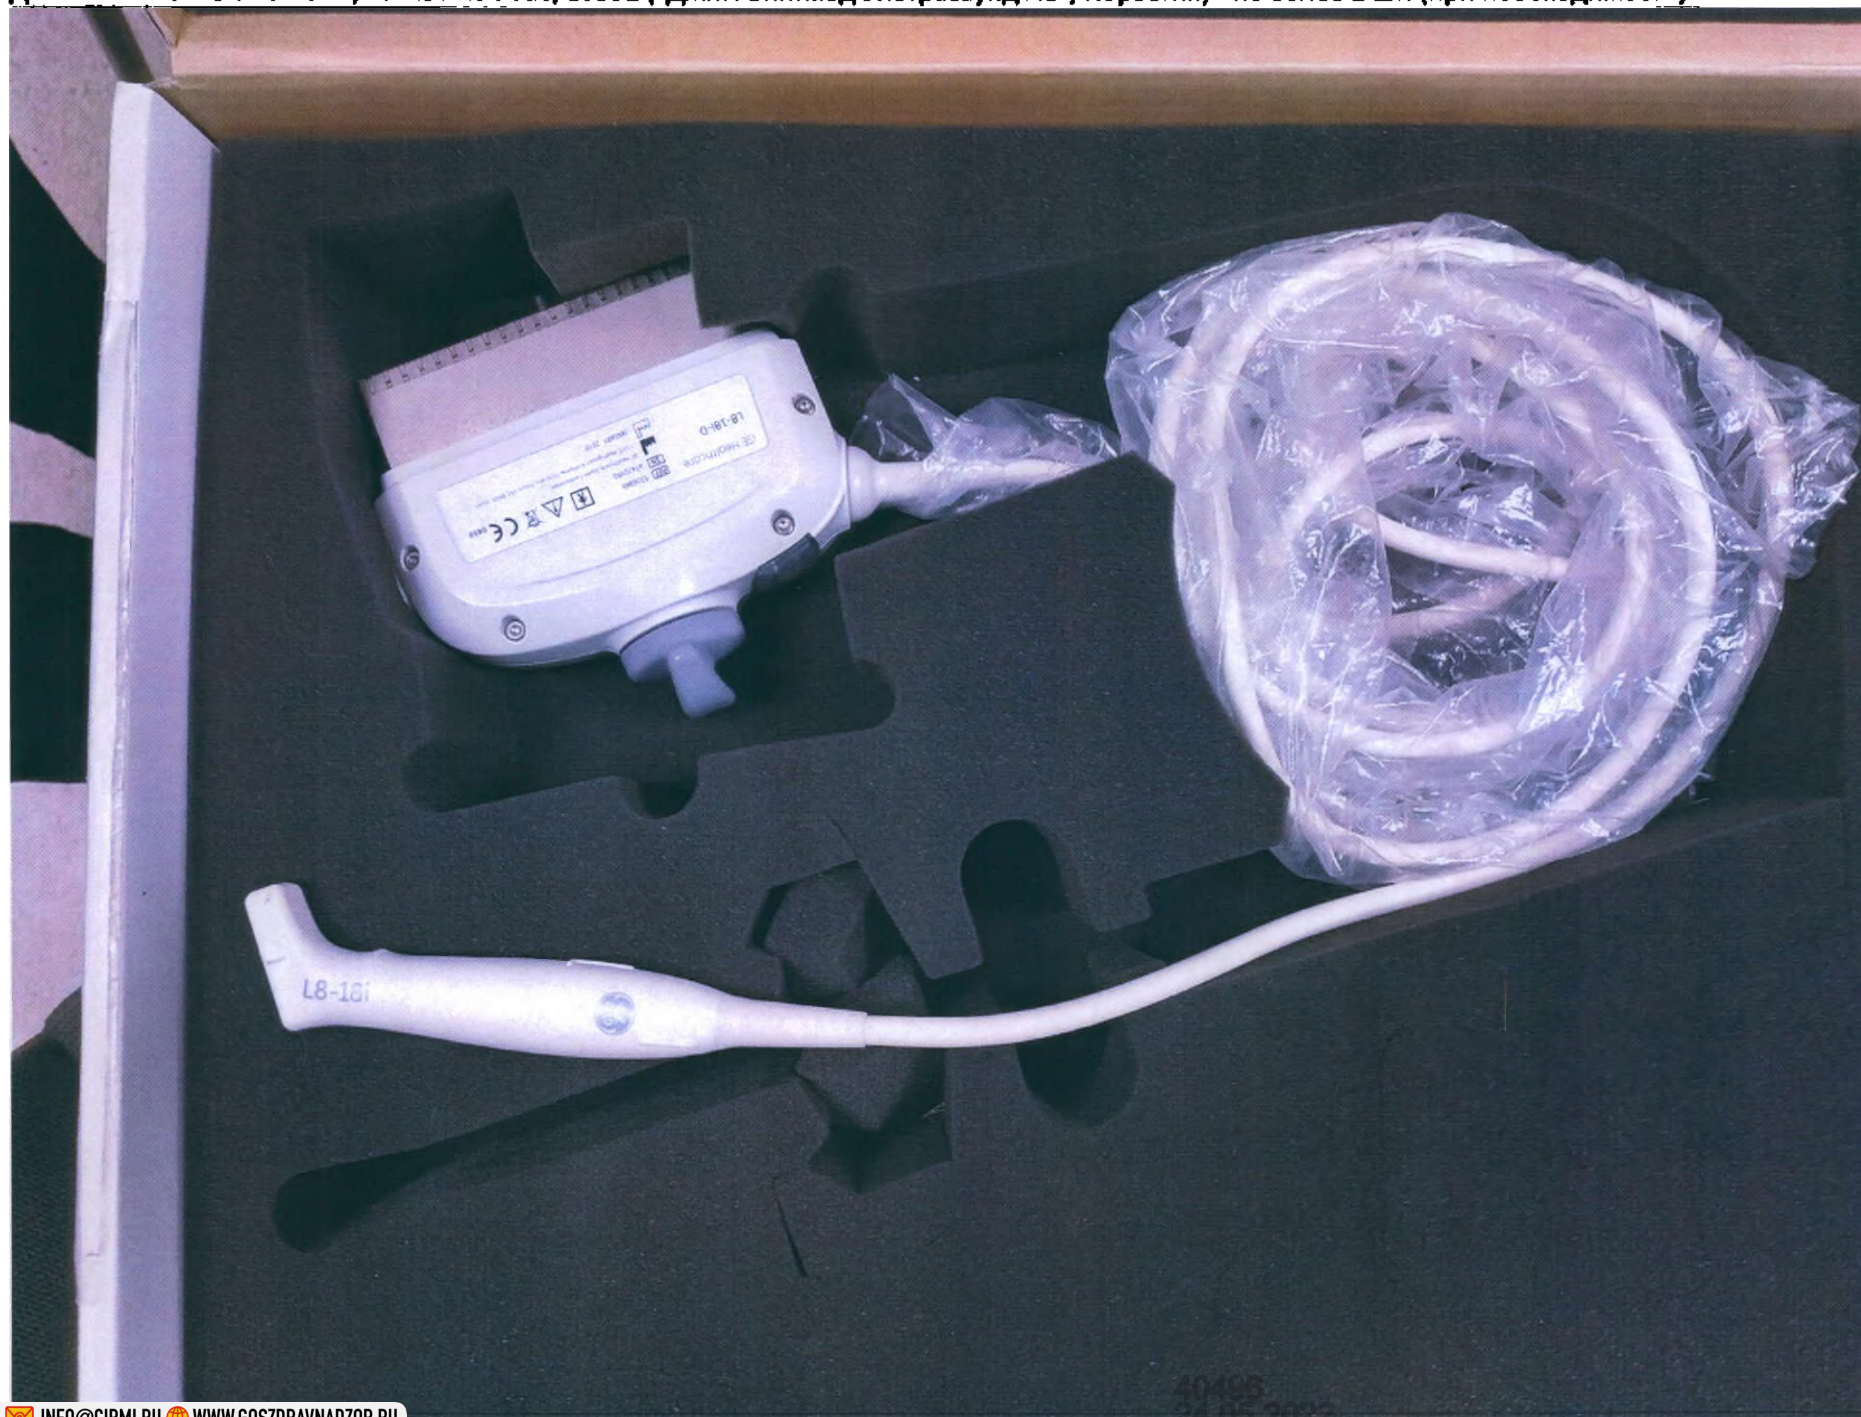


Датчик линейный L6-24-D - не более 2 шт. (при необходимости).



Датчик линейный L6-24-D - не более 2 шт. (при необходимости).



Датчик линейный L3-12-D, РУ № РЗН 2016/3657 ("ДжиИ Ультрасаунд Корея, Лтд.", Корея) - не более 2 шт. (при необходимости).

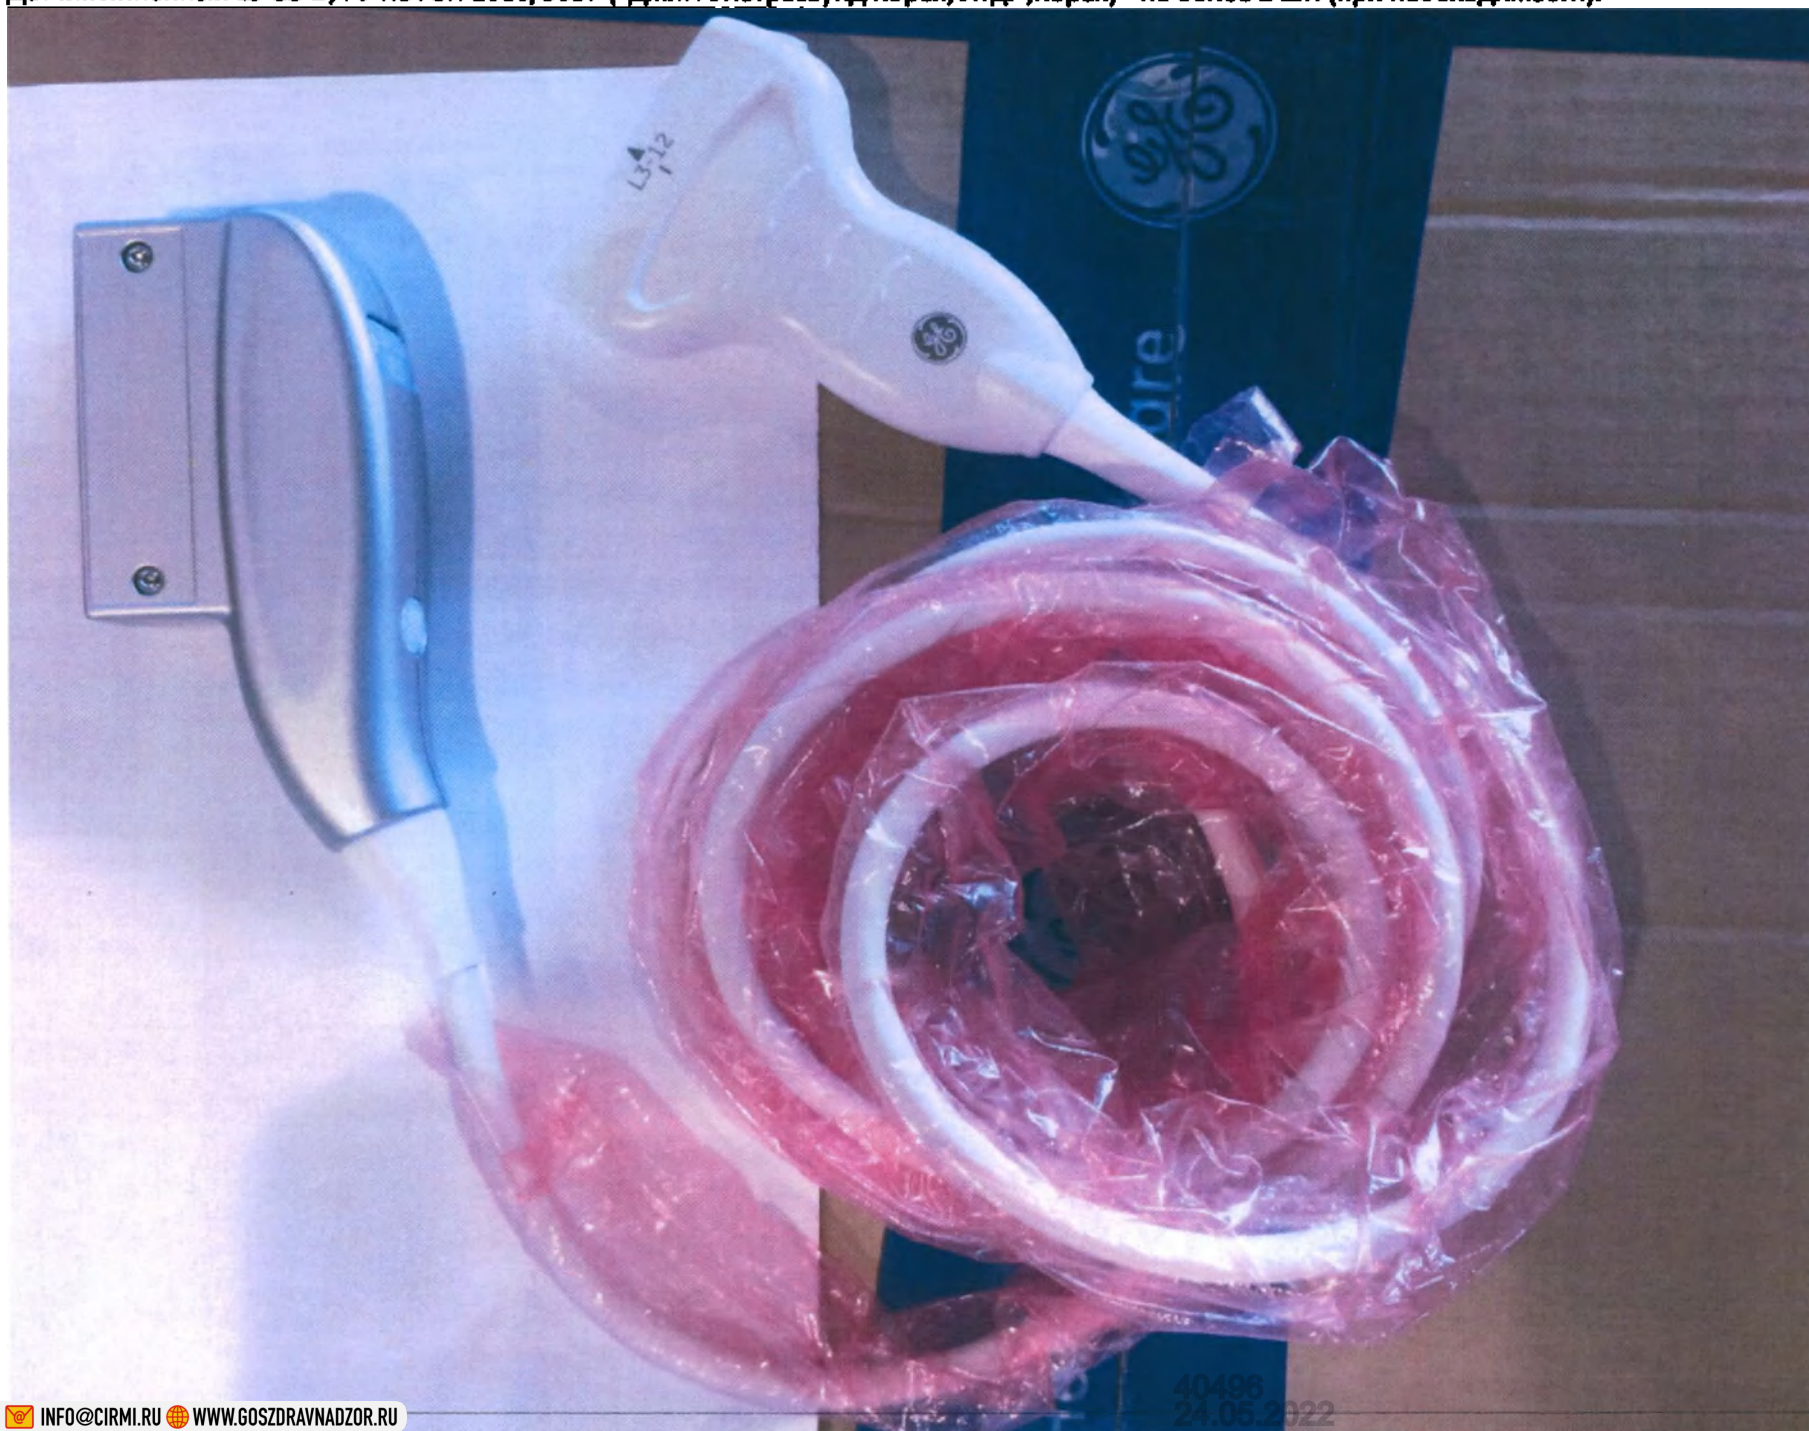

Насадка для проведения объемной навигации V Nav для линейных датчиков, РУ № ФСЗ 2009/04522 ("ДжиИ Медикал Системз Ультрасаунд энд Праймери Кеа Диагностика, ЛЛС", США) - не более 50 шт. (при необходимости).




Насадка для проведения объемной навигации V Nav для линейных датчиков, РУ № ФСЗ 2009/04522 ("ДжиИ Медикал Системз Ультрасаунд энд Праймери Кеа Диагностика, ЛЛС", США) - не более 50 шт. (при необходимости).




Датчики микроконвексные серии С, РУ № ФСЗ 2011/11249 ("ДжиИ Ультрасаунд Корея, Лтд. ", Корея) - не более 20 шт. (при необходимости).




Датчики микроконвексные серии С, РУ № ФСЗ 2011/11249 ("ДжиИ Ультрасаунд Корея, Лтд. ", Корея) - не более 20 шт. (при необходимости).
(Датчик C2-7VN-D)

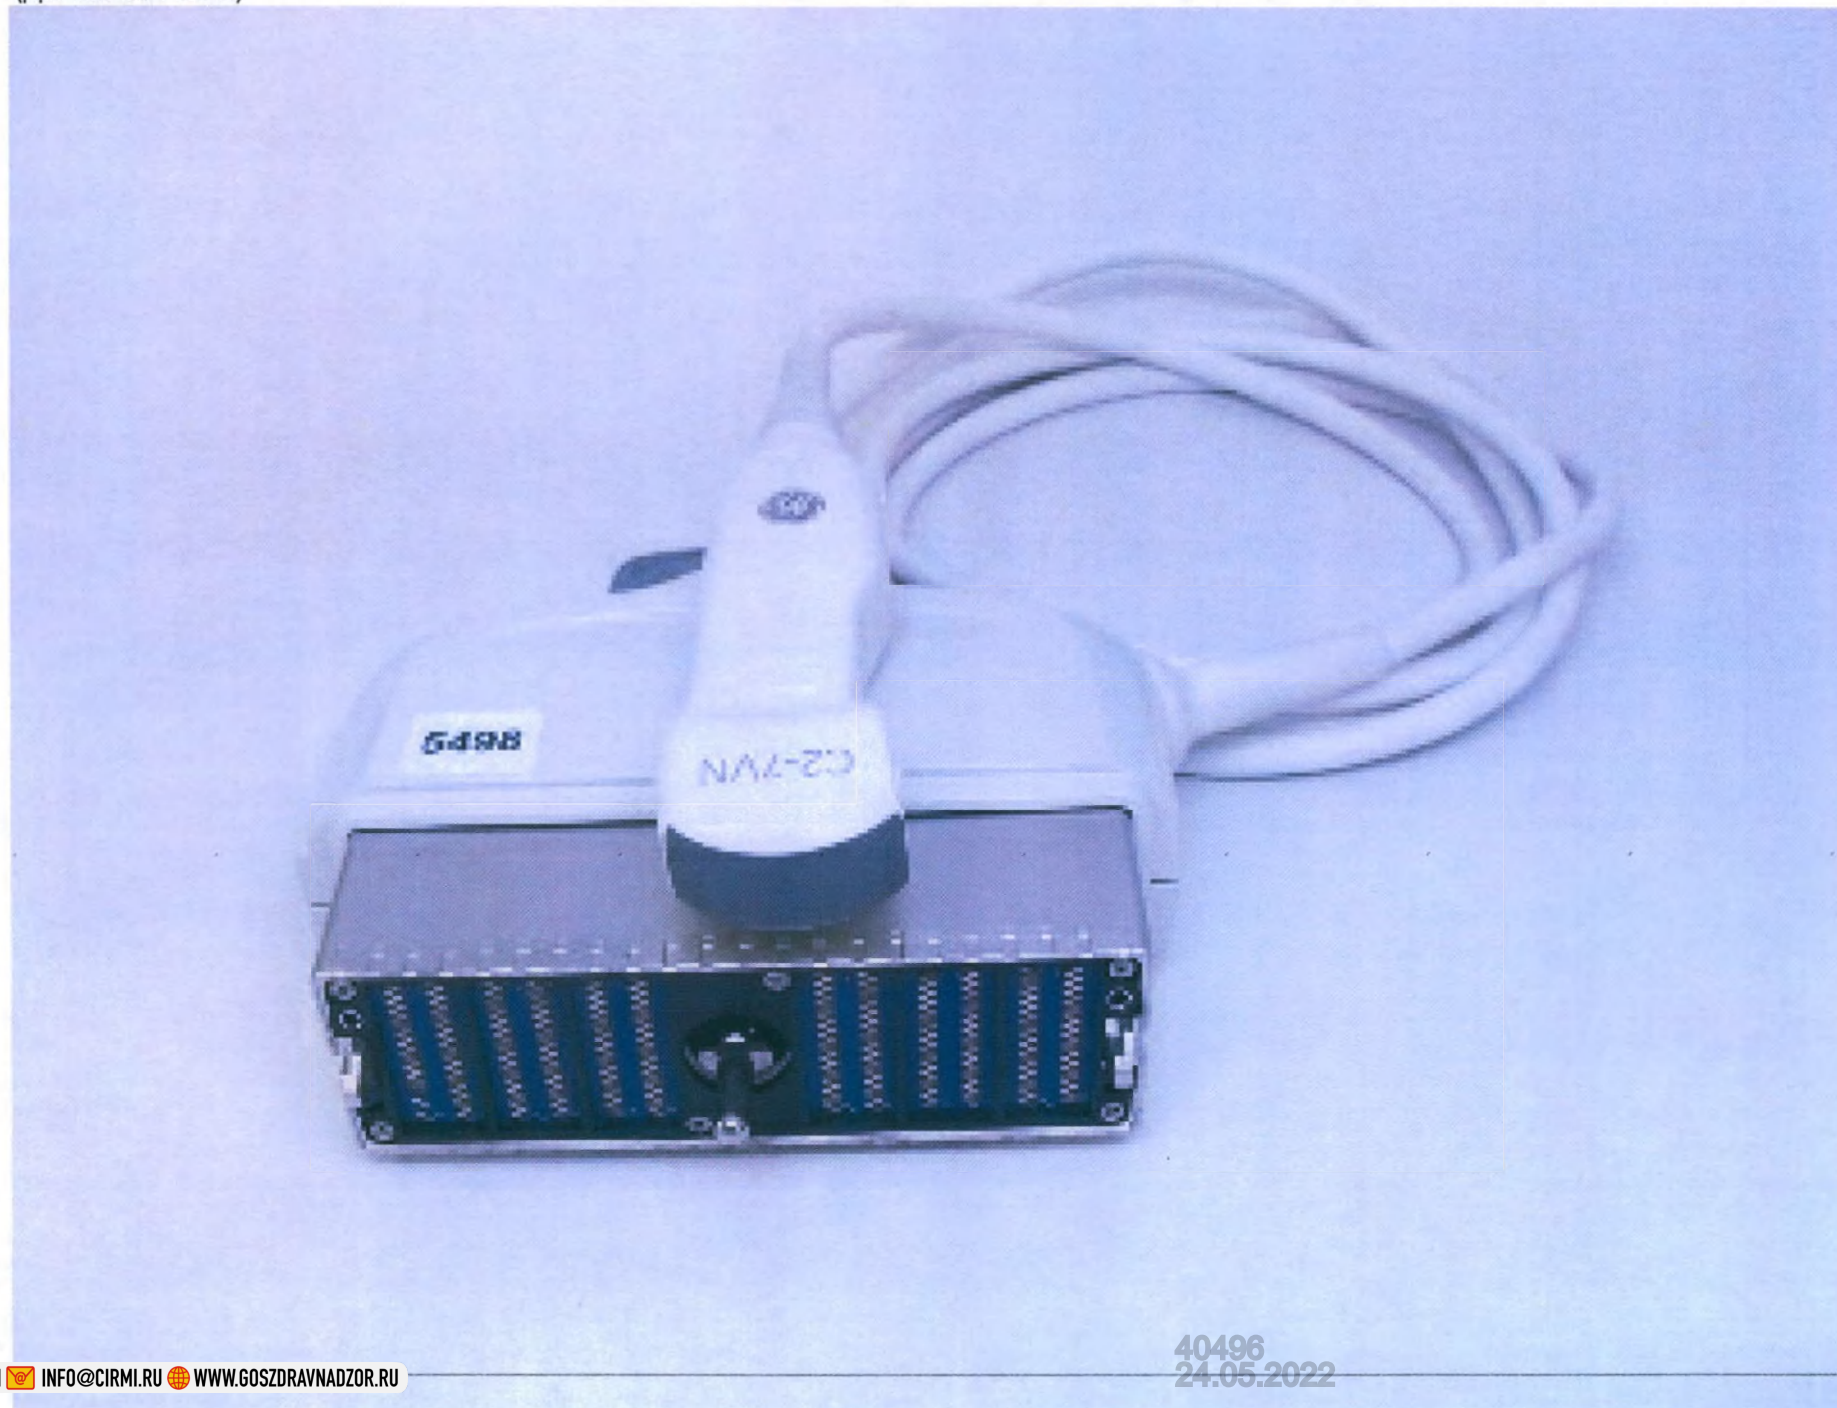

Датчики микроконвексные серии С, РУ № ФСЗ 2011/11249 ("ДжиИ Ультрасаунд Корея, Лтд. ", Корея) - не более 20 шт. (при необходимости).
(Датчик C2-7-D)

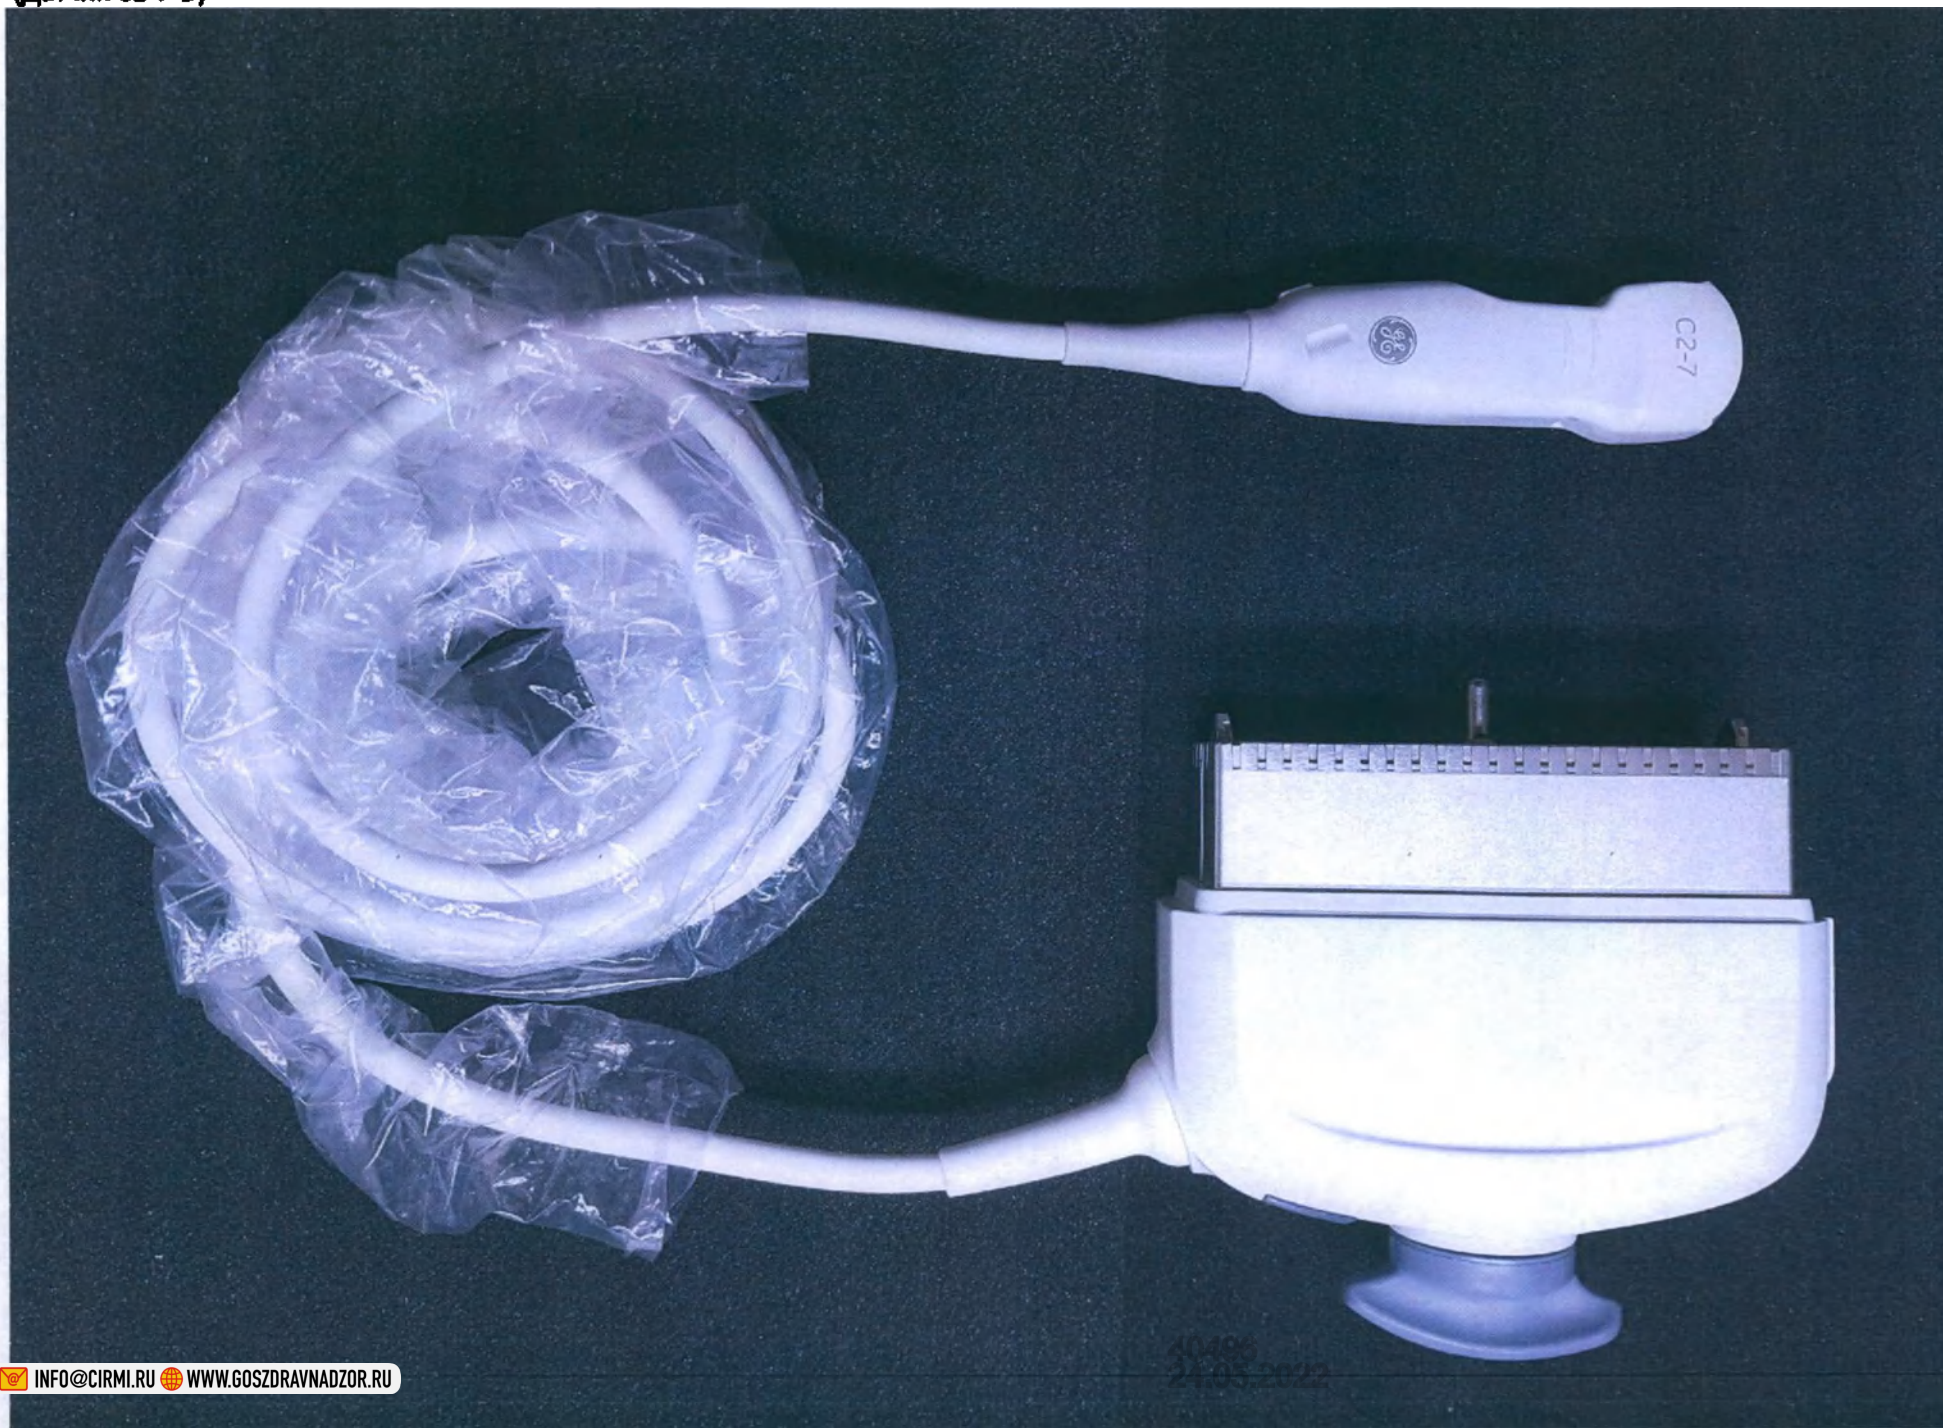

Датчики микроконвексные внутрисполостные IC5-9-D, РУ № ФСЗ 2010/06039 ("ДжиИ Хэлскеа Австрия ГмбХ & Ко ОГ", Австрия) - не более 2 шт. (при необходимости).

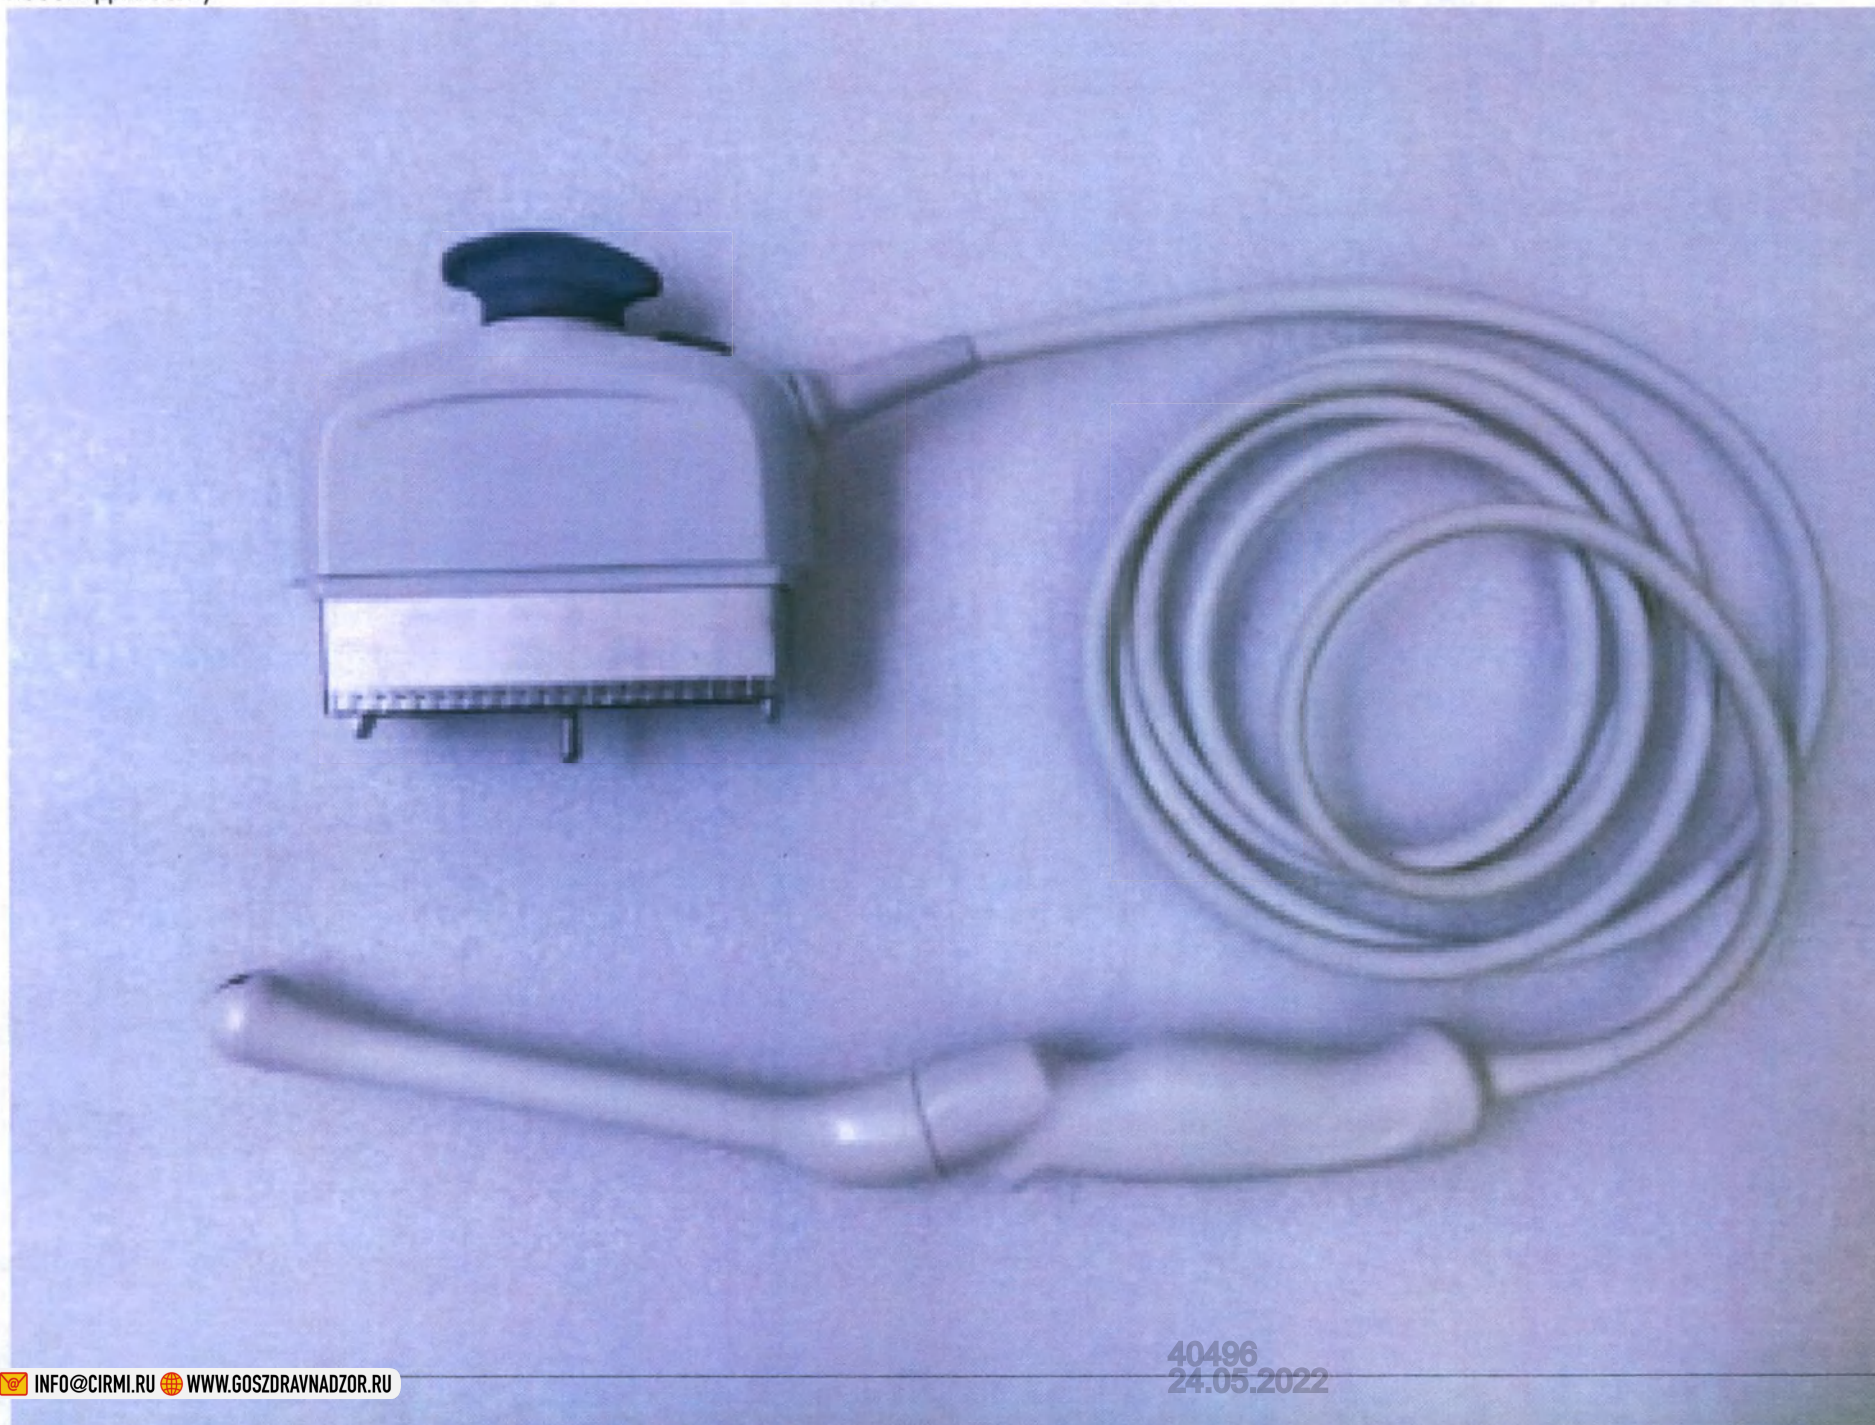


Датчик микроконвексный внутриполостной BE9CS-D, РУ № РЗН 2016/3657 ("ДжиИ Ультрасаунд Корея, Лтд. ", Корея). (при необходимости).



Насадки биопсийные для микроконвексного внутриматочного датчика IC5-9-D, РУ № ФСЗ 2010/06039 ("ДжиИ Хэлскеа Австрия ГмбХ & Ко ОГ", Австрия) - не более 50 шт. (при необходимости).



Насадки биопсийные для микроконвексного внутриматочного датчика IC5-9-D, РУ № ФСЗ 2010/06039 ("ДжиИ Хэлскеа Австрия ГмбХ & Ко ОГ", Австрия) - не более 50 шт. (при необходимости).

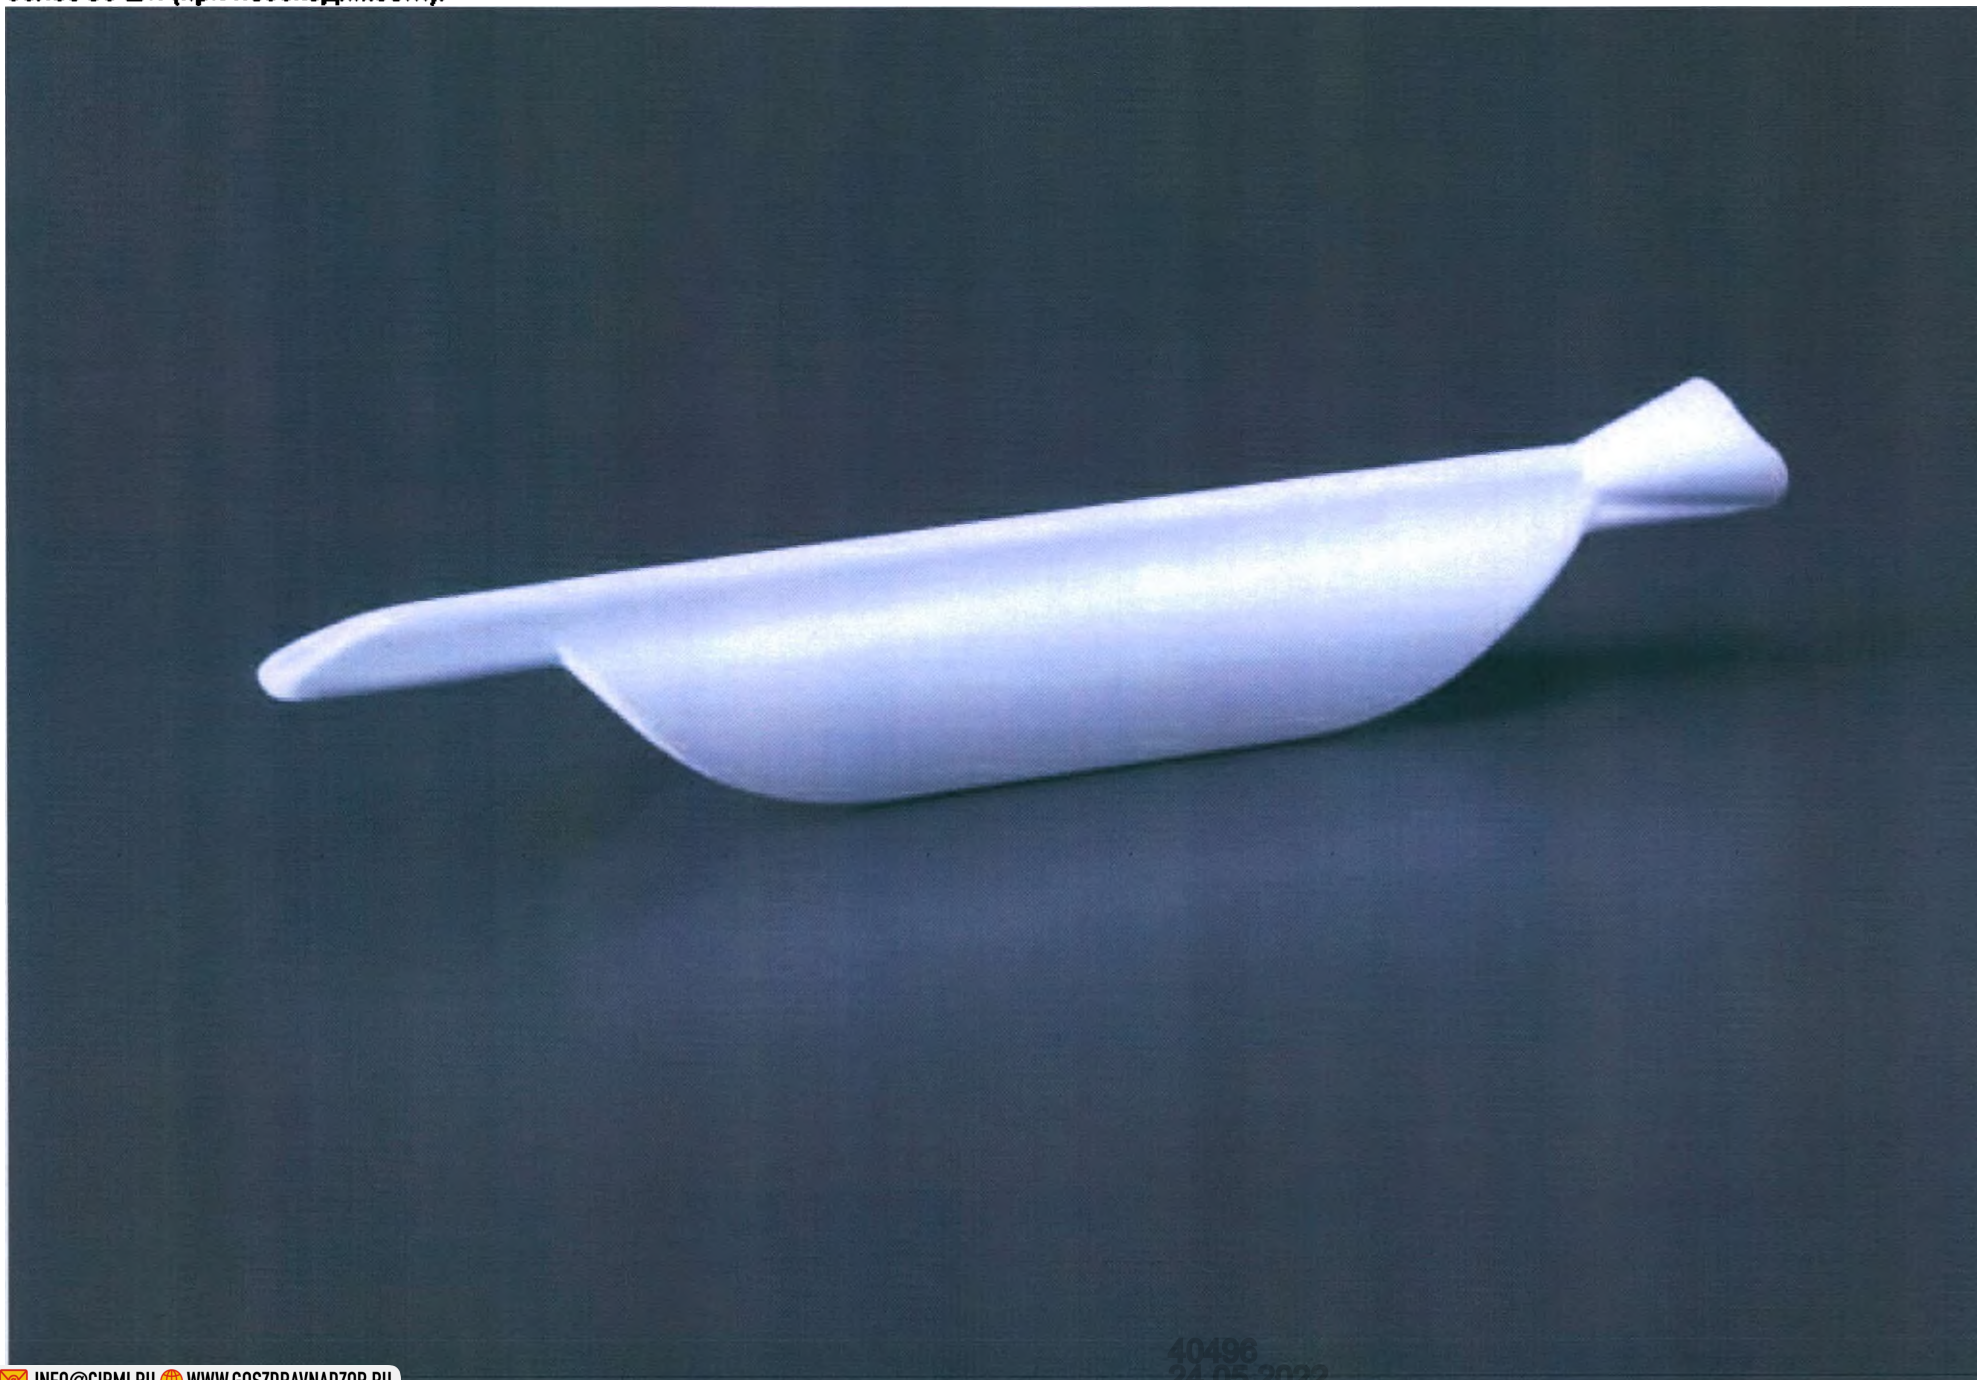

Насадка для проведения объемной навигации V Nav для микроконвексных датчиков, РУ № ФСЗ 2009/04522 ("ДжиИ Медикал Системз Ультрасаунд энд Праймери Кеа Диагностика, ЛЛС", США) - более 50 шт. (при необходимости).



Насадка для проведения объемной навигации V Nav для микроконвексных датчиков, РУ № ФСЗ 2009/04522 ("ДжиИ Медикал Системз Ультрасаунд энд Праймери Кеа Диагностикас, ЛЛС", США) - более 50 шт. (при необходимости).



Датчики карандашные доплеровские серии D, РУ № РЗН 2016/4247 ("ДжиИ Ультрасаунд Корея, Лтд.", Корея) - не более 5 шт. (при необходимости).
(Датчик P2D)




Датчики карандашные доплеровские серии D, РУ № РЗН 2016/4247 ("ДжиИ Ультрасаунд Корея, Лтд.", Корея) - не более 5 шт. (при необходимости).
(Датчик Р6D)




Датчики объемные конвексные RAB6-D, РУ № РЗН 2015/3460 ("ДжиИ Хэлскеа Австрия ГмбХ & Ко ОГ", Австрия,) - не более 2 шт. (при необходимости).



Датчики объемные внутриполостные микроконвексные RIC5-9-D, РУ № РЗН 2015/3460 ("ДжиИ Хэлскеа Австрия ГмбХ & Ко ОГ", Австрия) - не более 2 шт. (при необходимости).

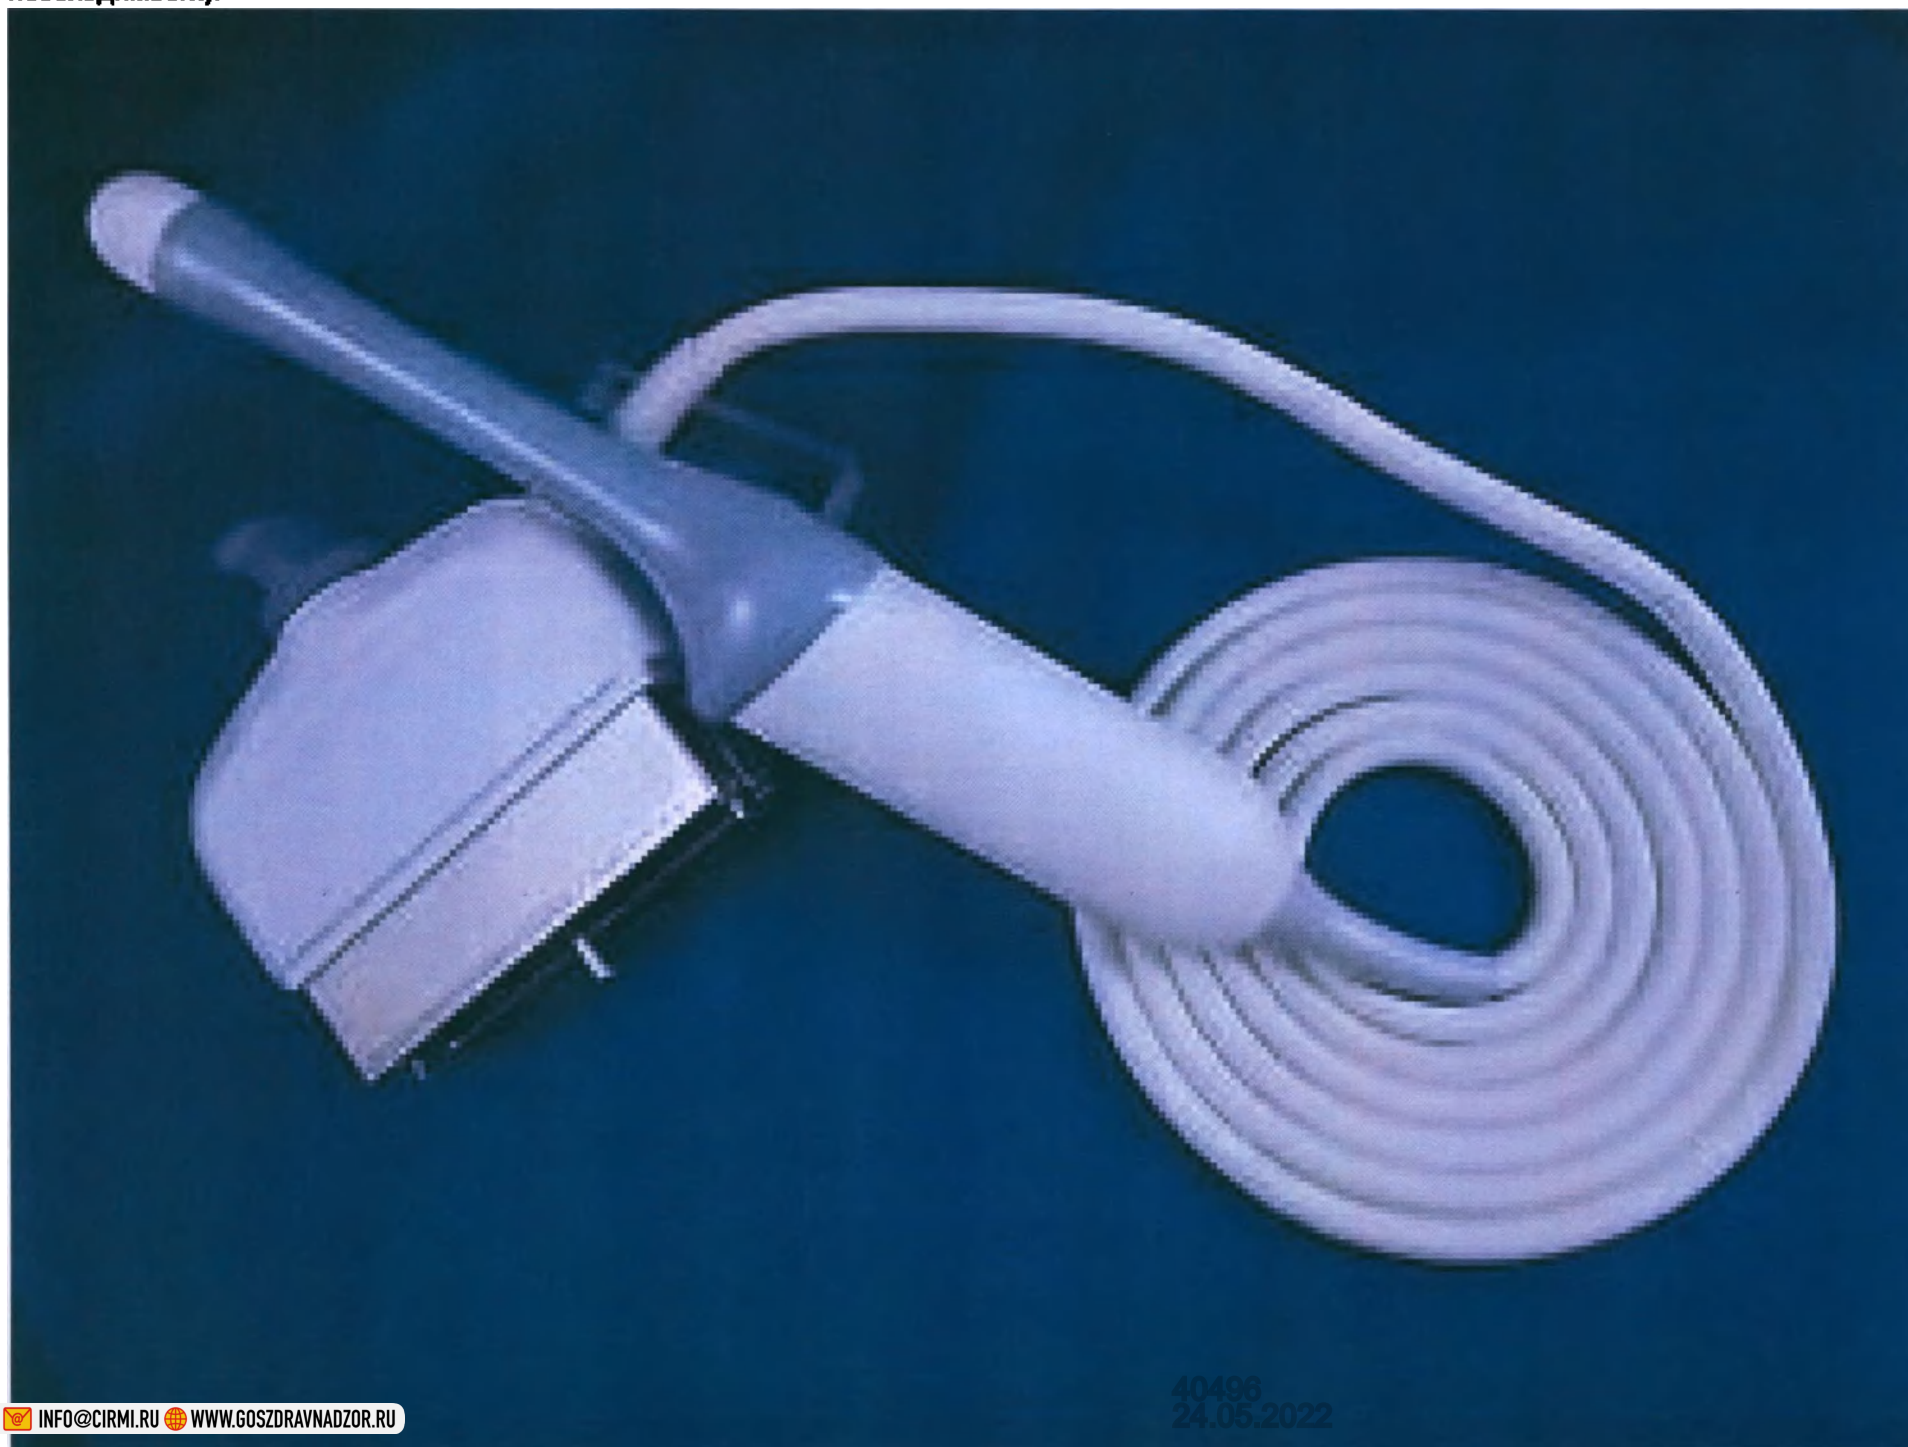


Датчик чреспищеводный секторный фазированный БТс-RS, РУ № РЗН 2016/3657 (производства "ДжиИ Ультрасаунд Корея, Лтд. ", Корея) - не более 2 шт. (при необходимости).

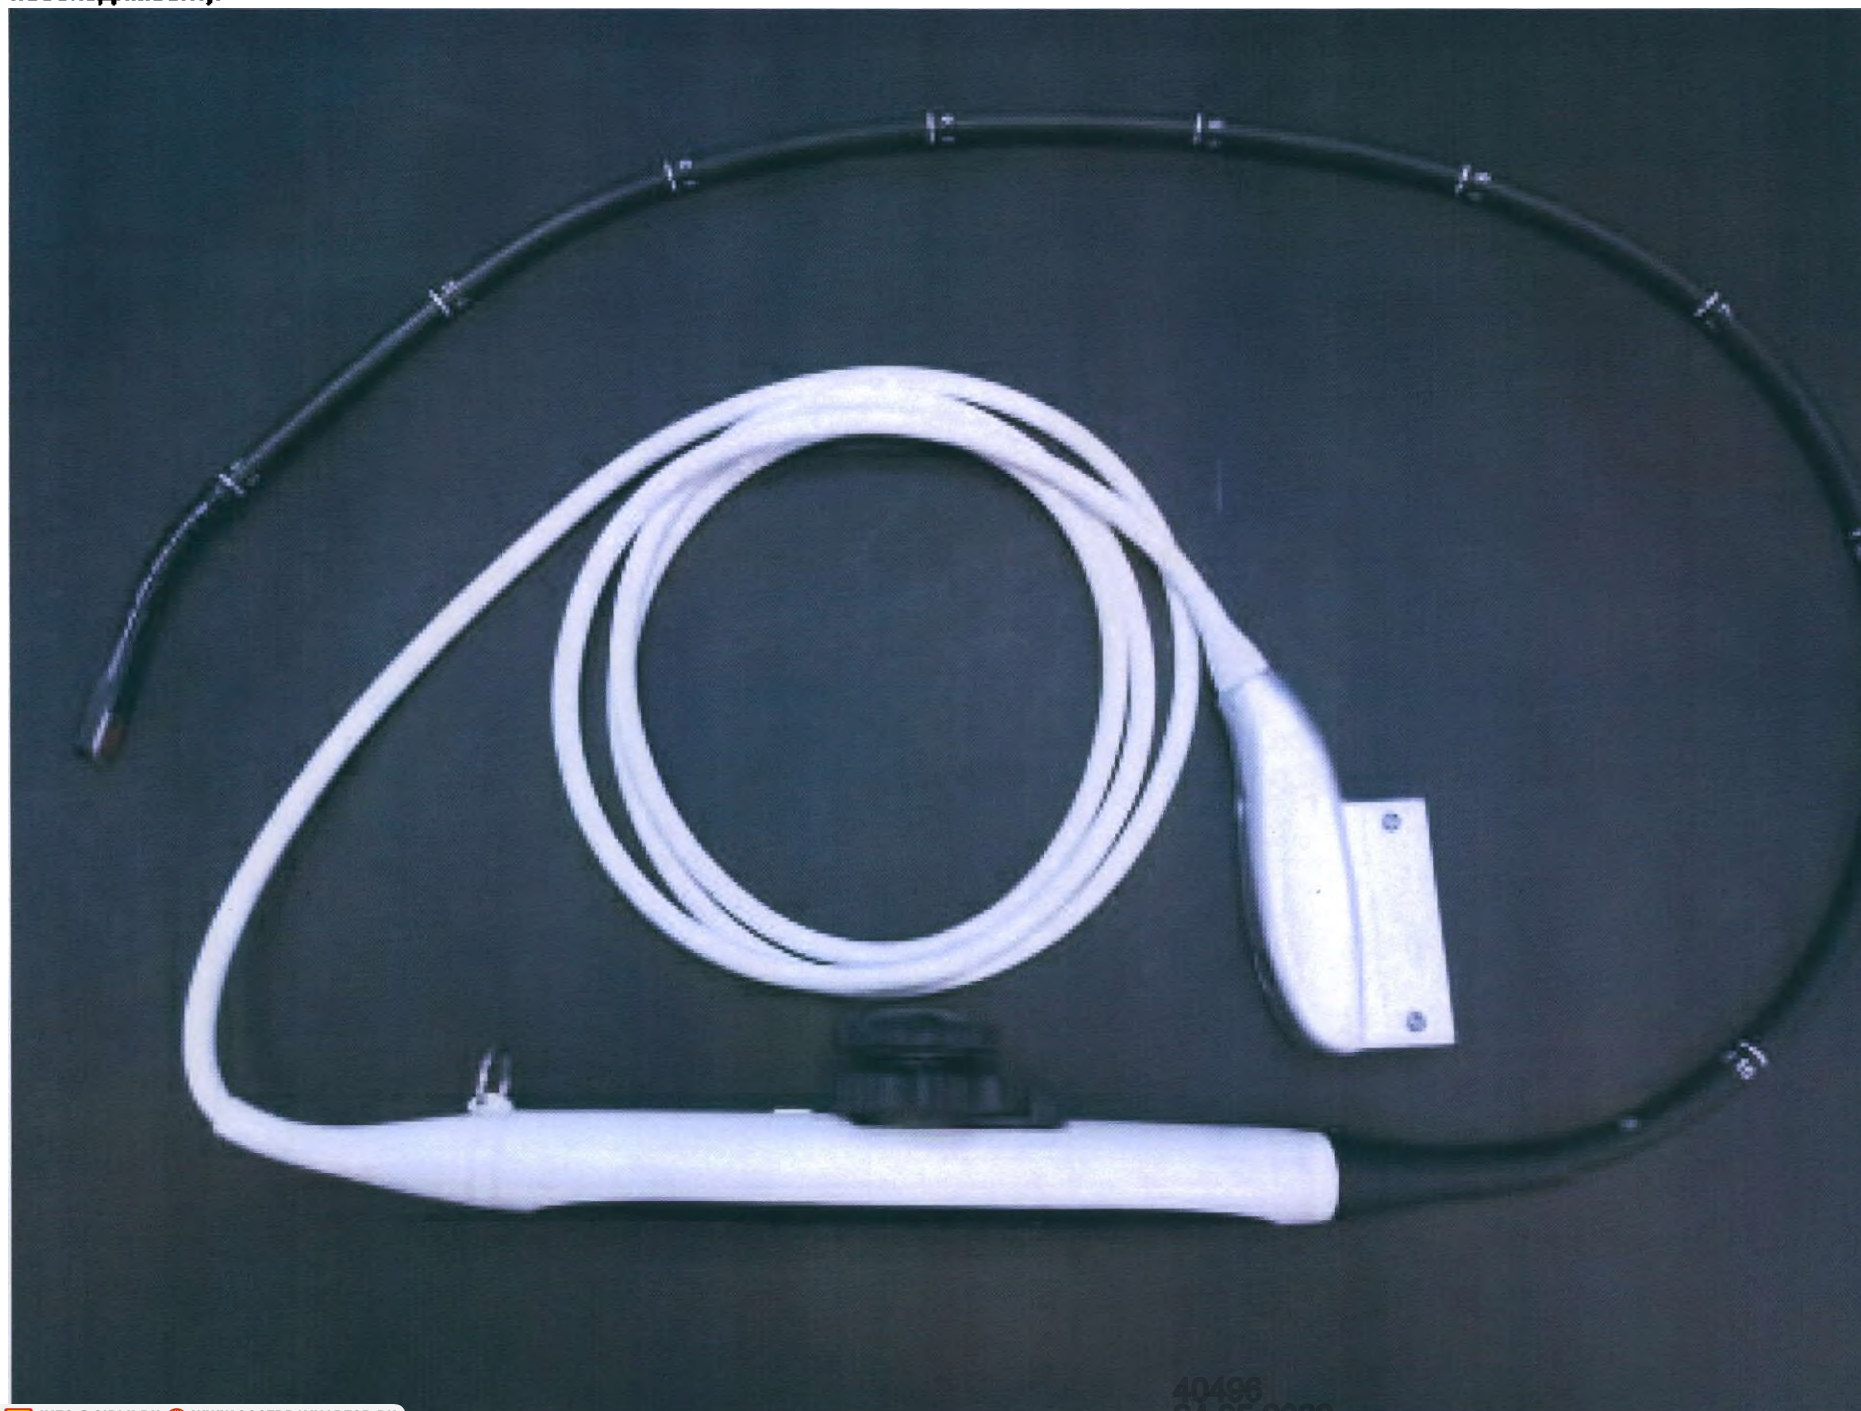

Загубники для чреспищеводных датчиков, РУ № ФСЗ 2011/11249 ("ДжиИ Ультрасаунд Корея, Лтд. ", Корея) - не более 20 шт. (при необходимости).




Загубники для чреспищеводных датчиков, РУ № ФСЗ 2011/11249 ("ДжиИ Ультрасаунд Корея, Лтд. ", Корея) - не более 20 шт. (при необходимости).

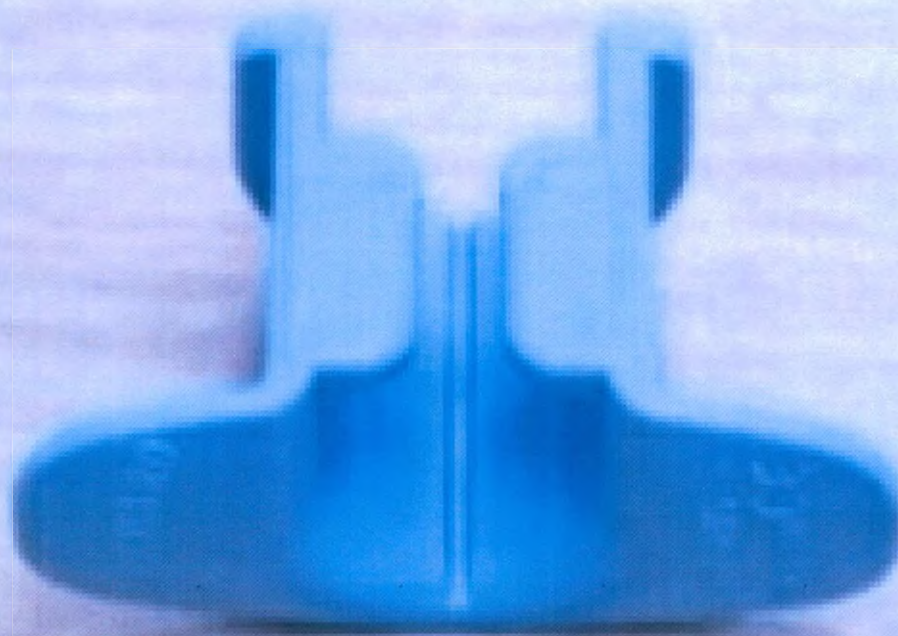

Загубники для чреспищеводных датчиков, РУ № ФСЗ 2011/11249 ("ДжиИ Ультрасаунд Корея, Лтд. ", Корея) - не более 20 шт. (при необходимости).



Загубники для чреспищеводных датчиков, РУ № ФСЗ 2011/11249 ("ДжиИ Ультрасаунд Корея, Лтд. ", Корея) - не более 20 шт. (при необходимости).

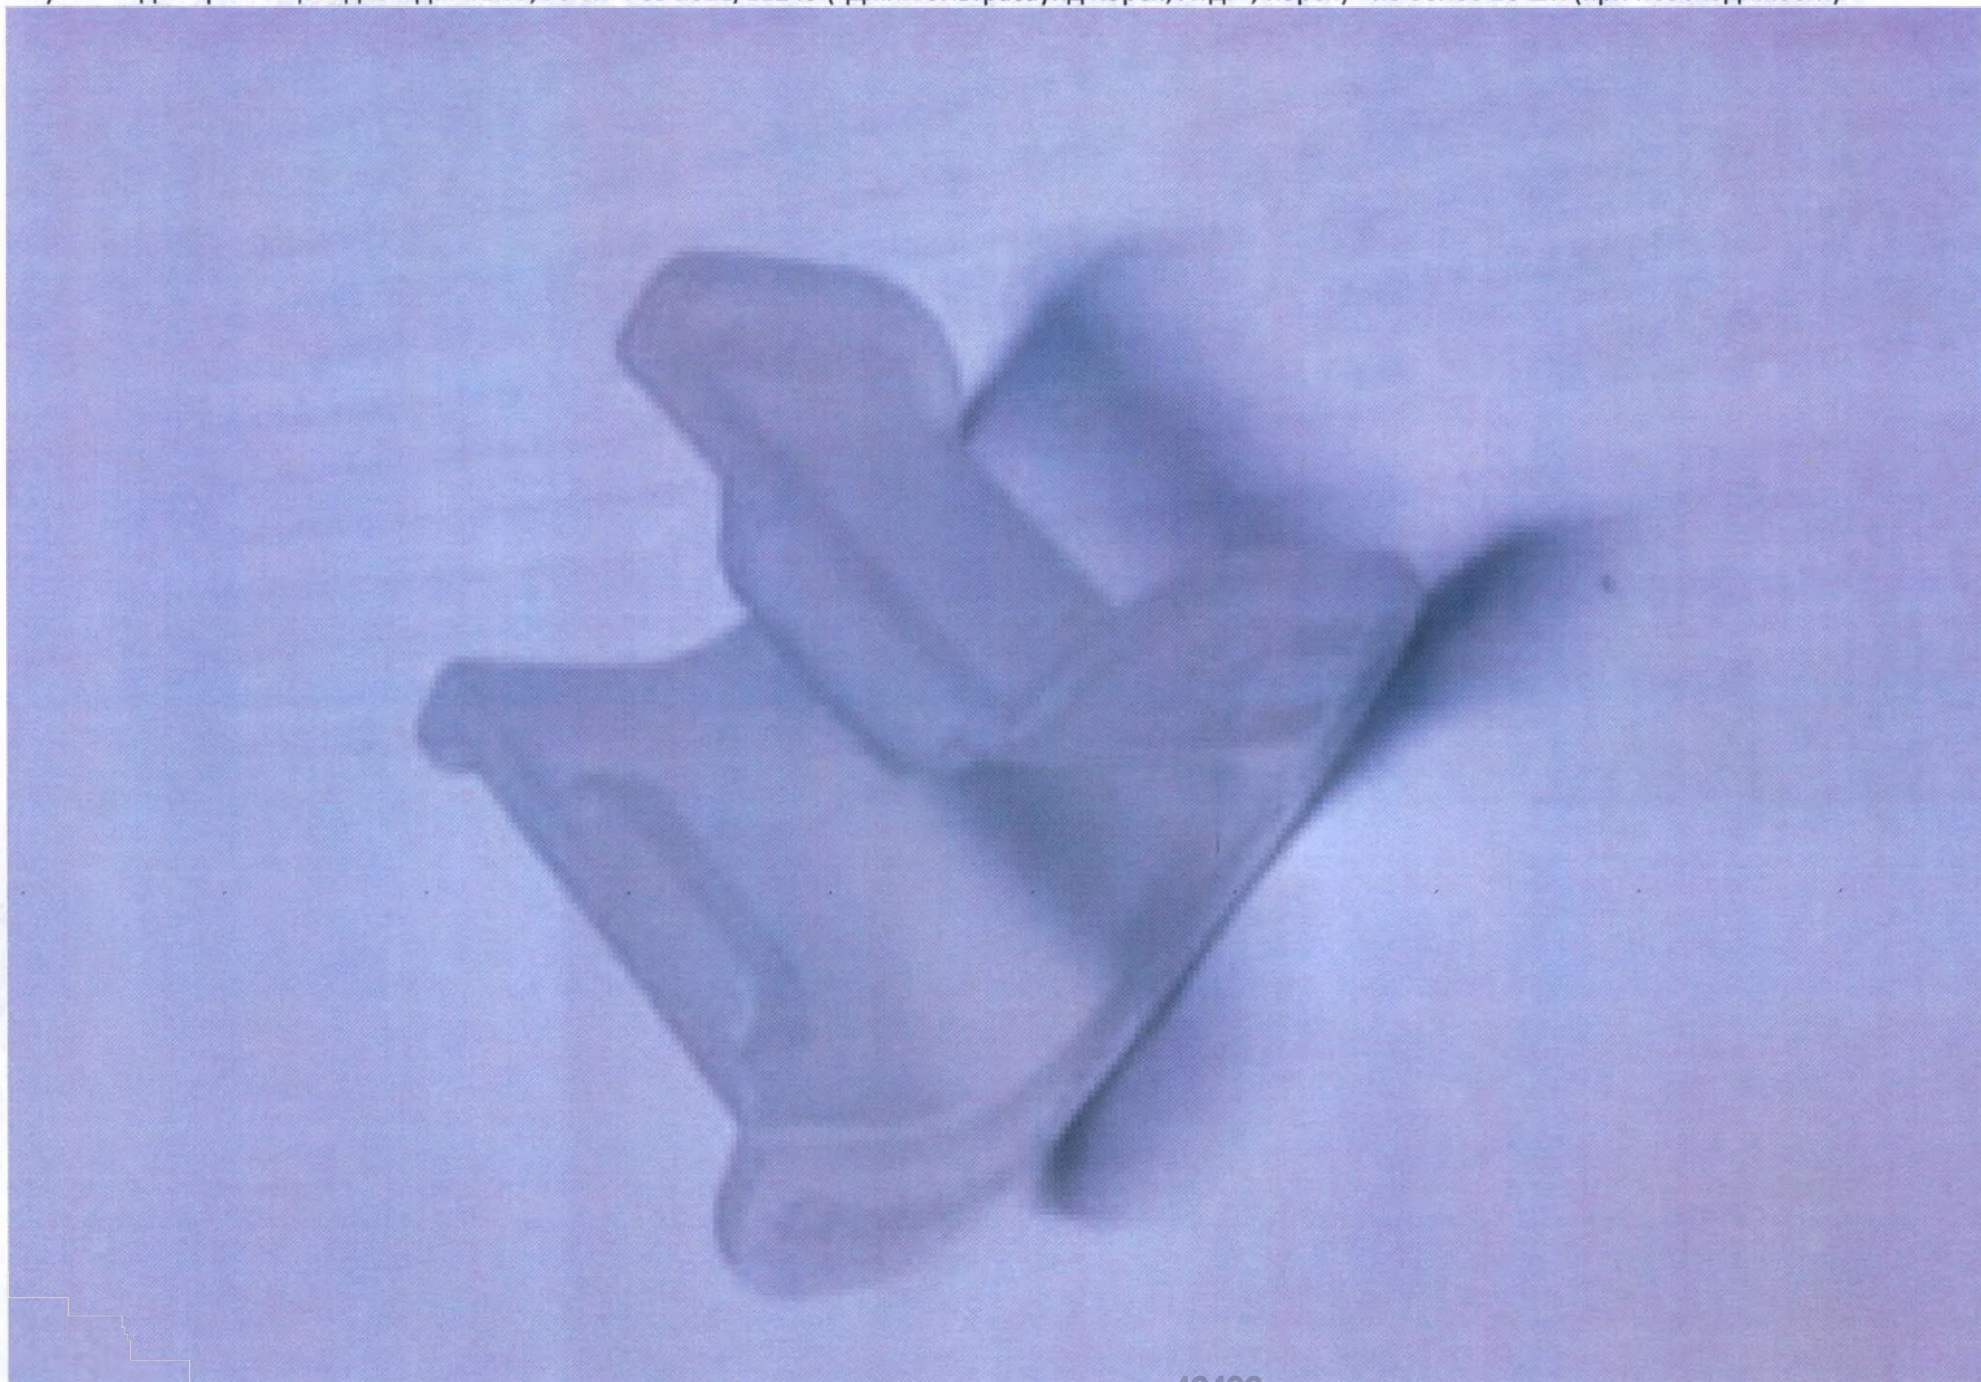


Загубники для чрепшцеводных датчиков, РУ № ФСЗ 2011/11249 ("Джии Ультрасаунд Корея, Лтд. ", Корея) - не более 20 шт. (при необходимости).



Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме объемной навигации с автоматическим совмещением - Active Tracker, РУ № ФСЗ 2009/04522 ("ДжиИ Медикал Система Ультрасаунд энд Праймери Кеа Диагностики, ЛЛС", США) - не более 20 шт. (при необходимости).



Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме объемной навигации с автоматическим совмещением с МРТ изображениями - MR Active Tracker РУ № ФСЗ 2009/04522 ("ДжиИ Медикал Системз Ультрасаунд энд Праймери Кеа Диагностикс, ЛЛС", США) - не более 20 шт. (при необходимости).

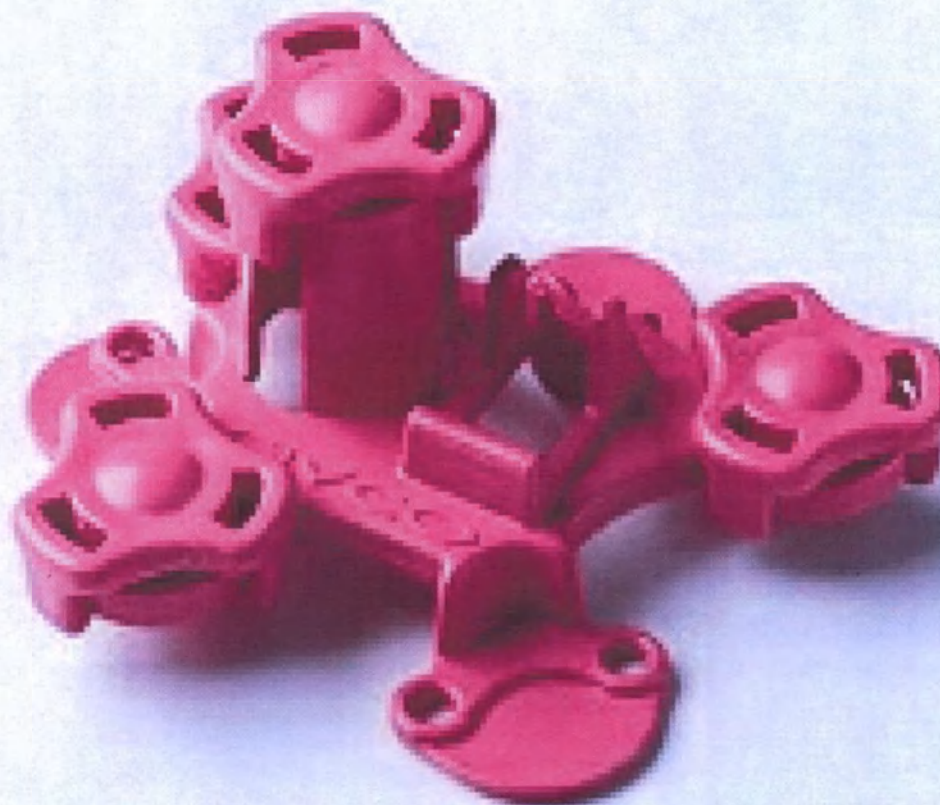

Устройство для виртуального отслеживания положения биопсийной иглы в режиме объемной навигации - Virtual Needle Tracker, РУ № ФСЗ 2009/04522 ("ДжиИ Медикал Системз Ультрасаунд энд Праймери Кеа Диагностикас, ЛЛС", США) - не более 20 шт. (при необходимости).



Устройство для виртуального отслеживания положения биопсийной иглы в режиме объемной навигации - Virtual Needle Tracker, РУ № ФСЗ 2009/04522 ("ДжиИ Медикал Системз Ультрасаунд энд Праймери Кеа Диагностикс, ЛЛС", США) - не более 20 шт. (при необходимости).




Сенсоры для проведения объемной навигации, РУ № ФСЗ 2009/04522 ("ДжиИ Медикал Системз Ультрасаунд энд Праймери Кеа Диагностикас, ЛЛС", США) - не более 5 шт. (при необходимости).



Сенсоры для проведения объемной навигации, РУ № ФСЗ 2009/04522 ("ДжиИ Медикал Системз Ультрасаунд энд Праймери Кеа Диагностикас, ЛЛС", США) - не более 5 шт. (при необходимости).




Кабели для устройства, обеспечивающего регистрацию физиологических сигналов, РУ № ФСЗ 2011/11249 ("ДжиИ Ультрасаунд Корея, Лтд. ", Корея). (при необходимости).

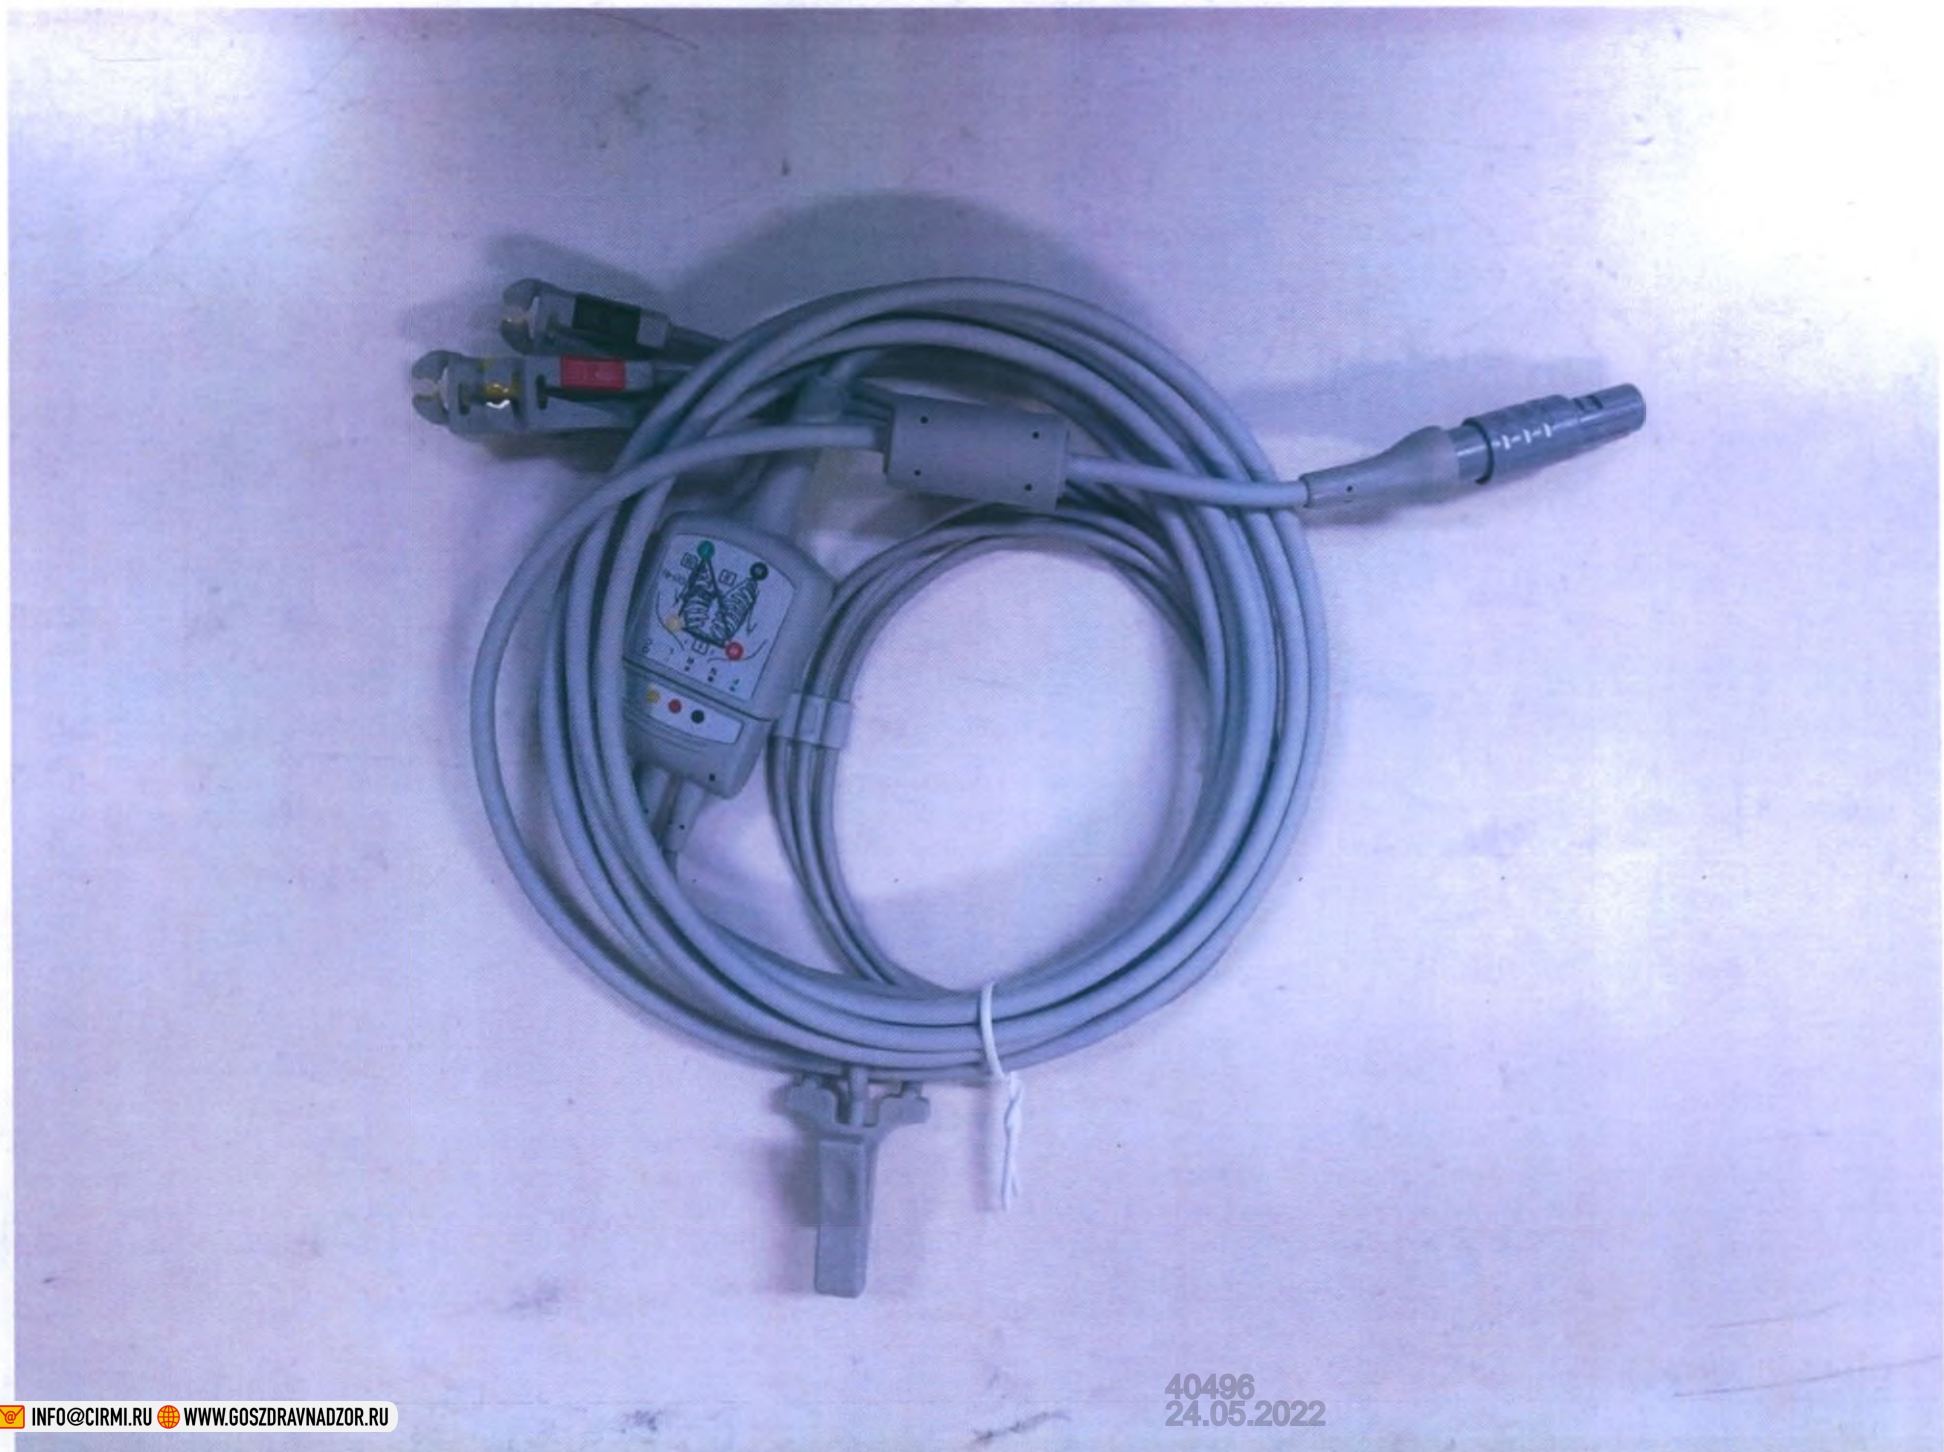


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ


Комплект документации на русском языке - не более 5 шт.

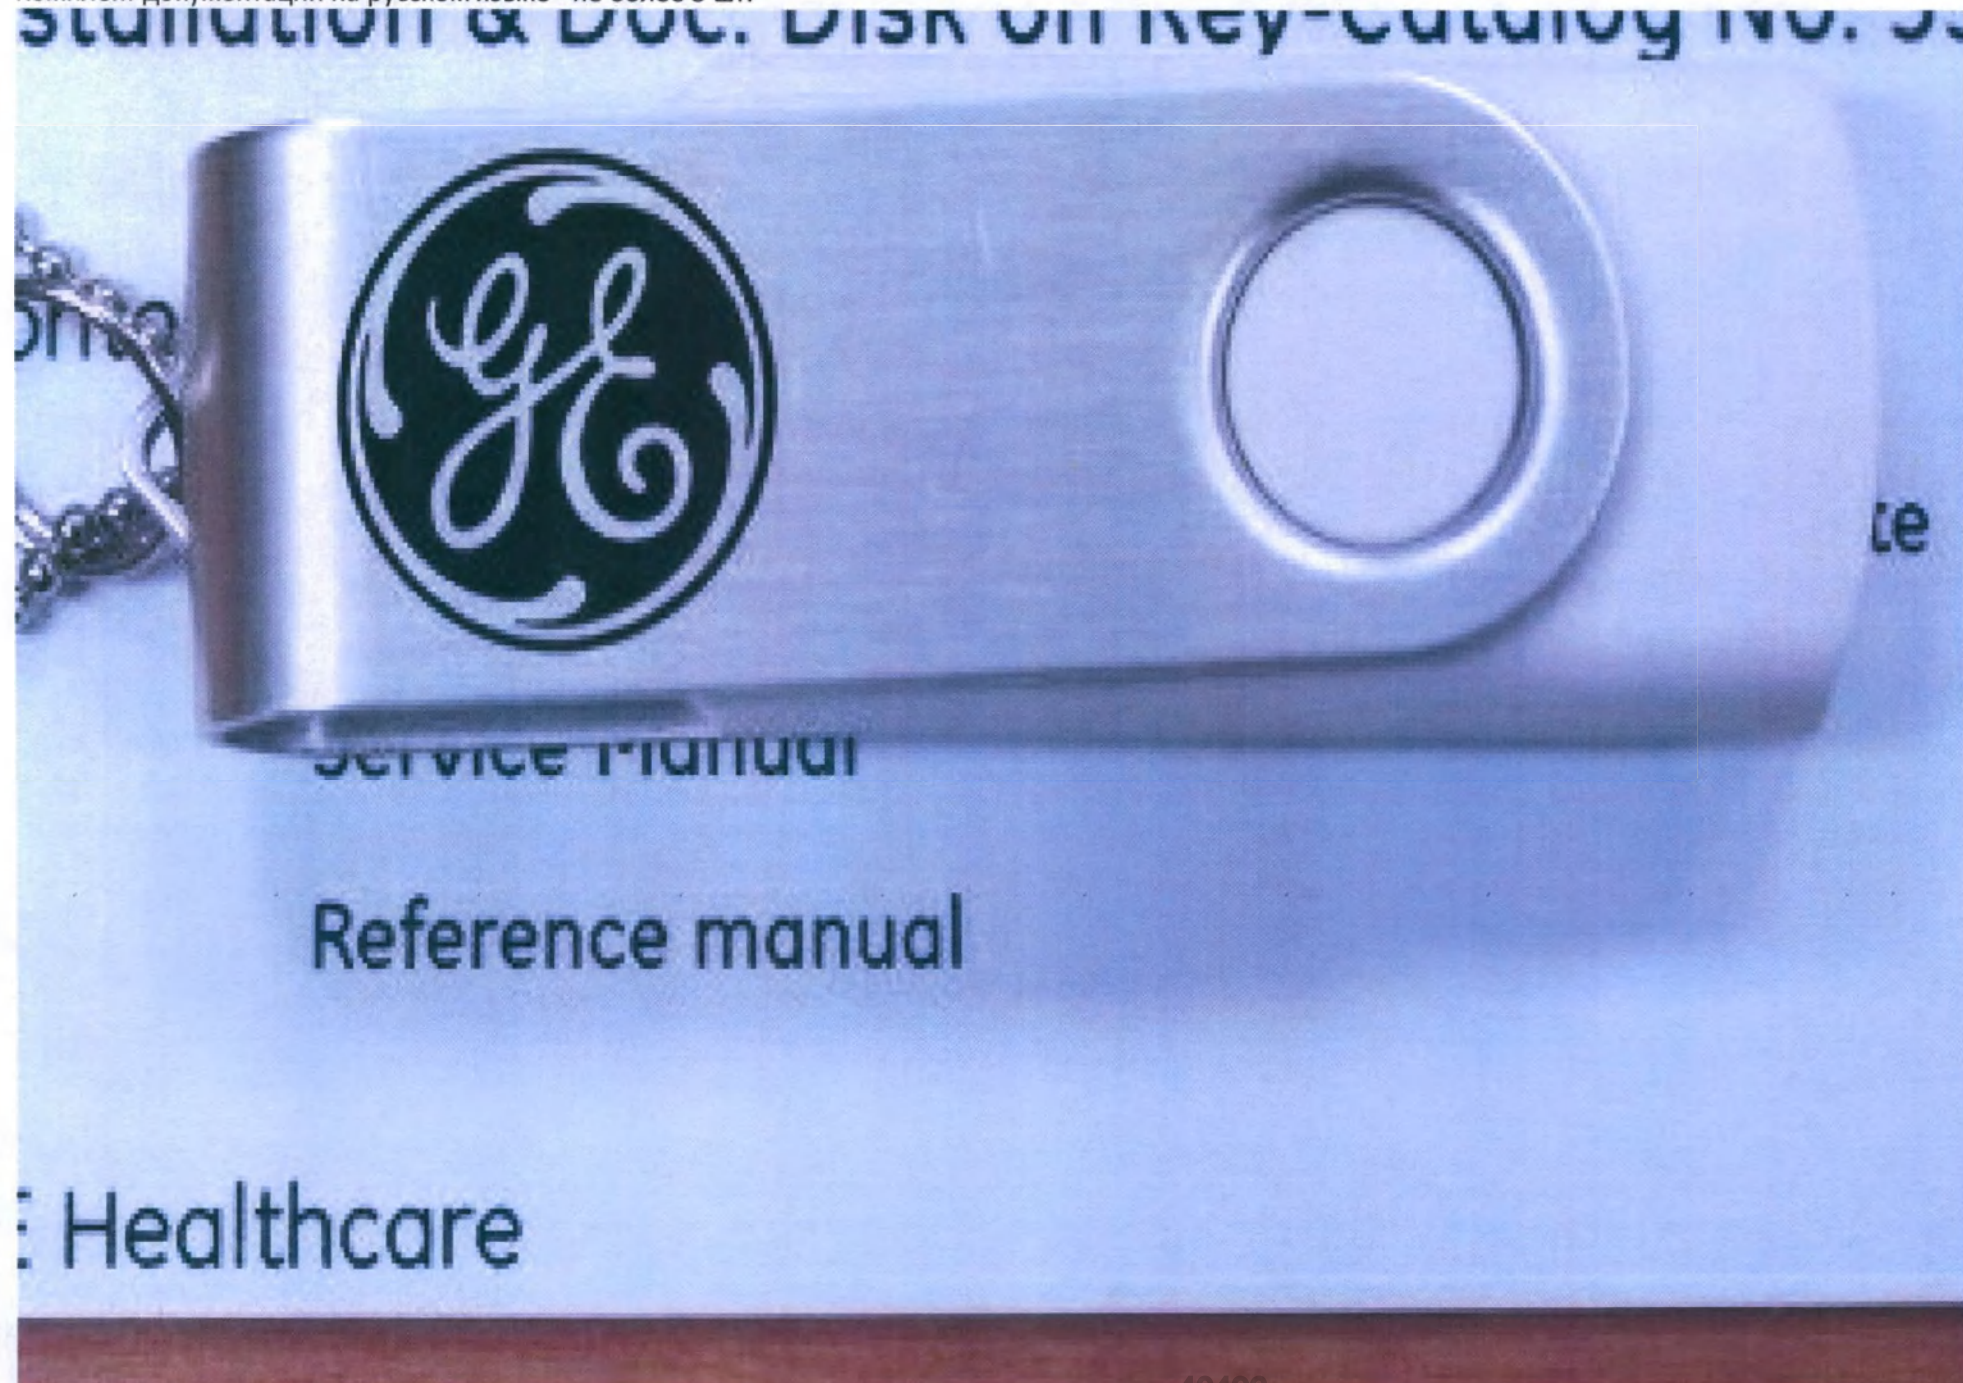


Комплект документации на английском языке - не более 5 шт.

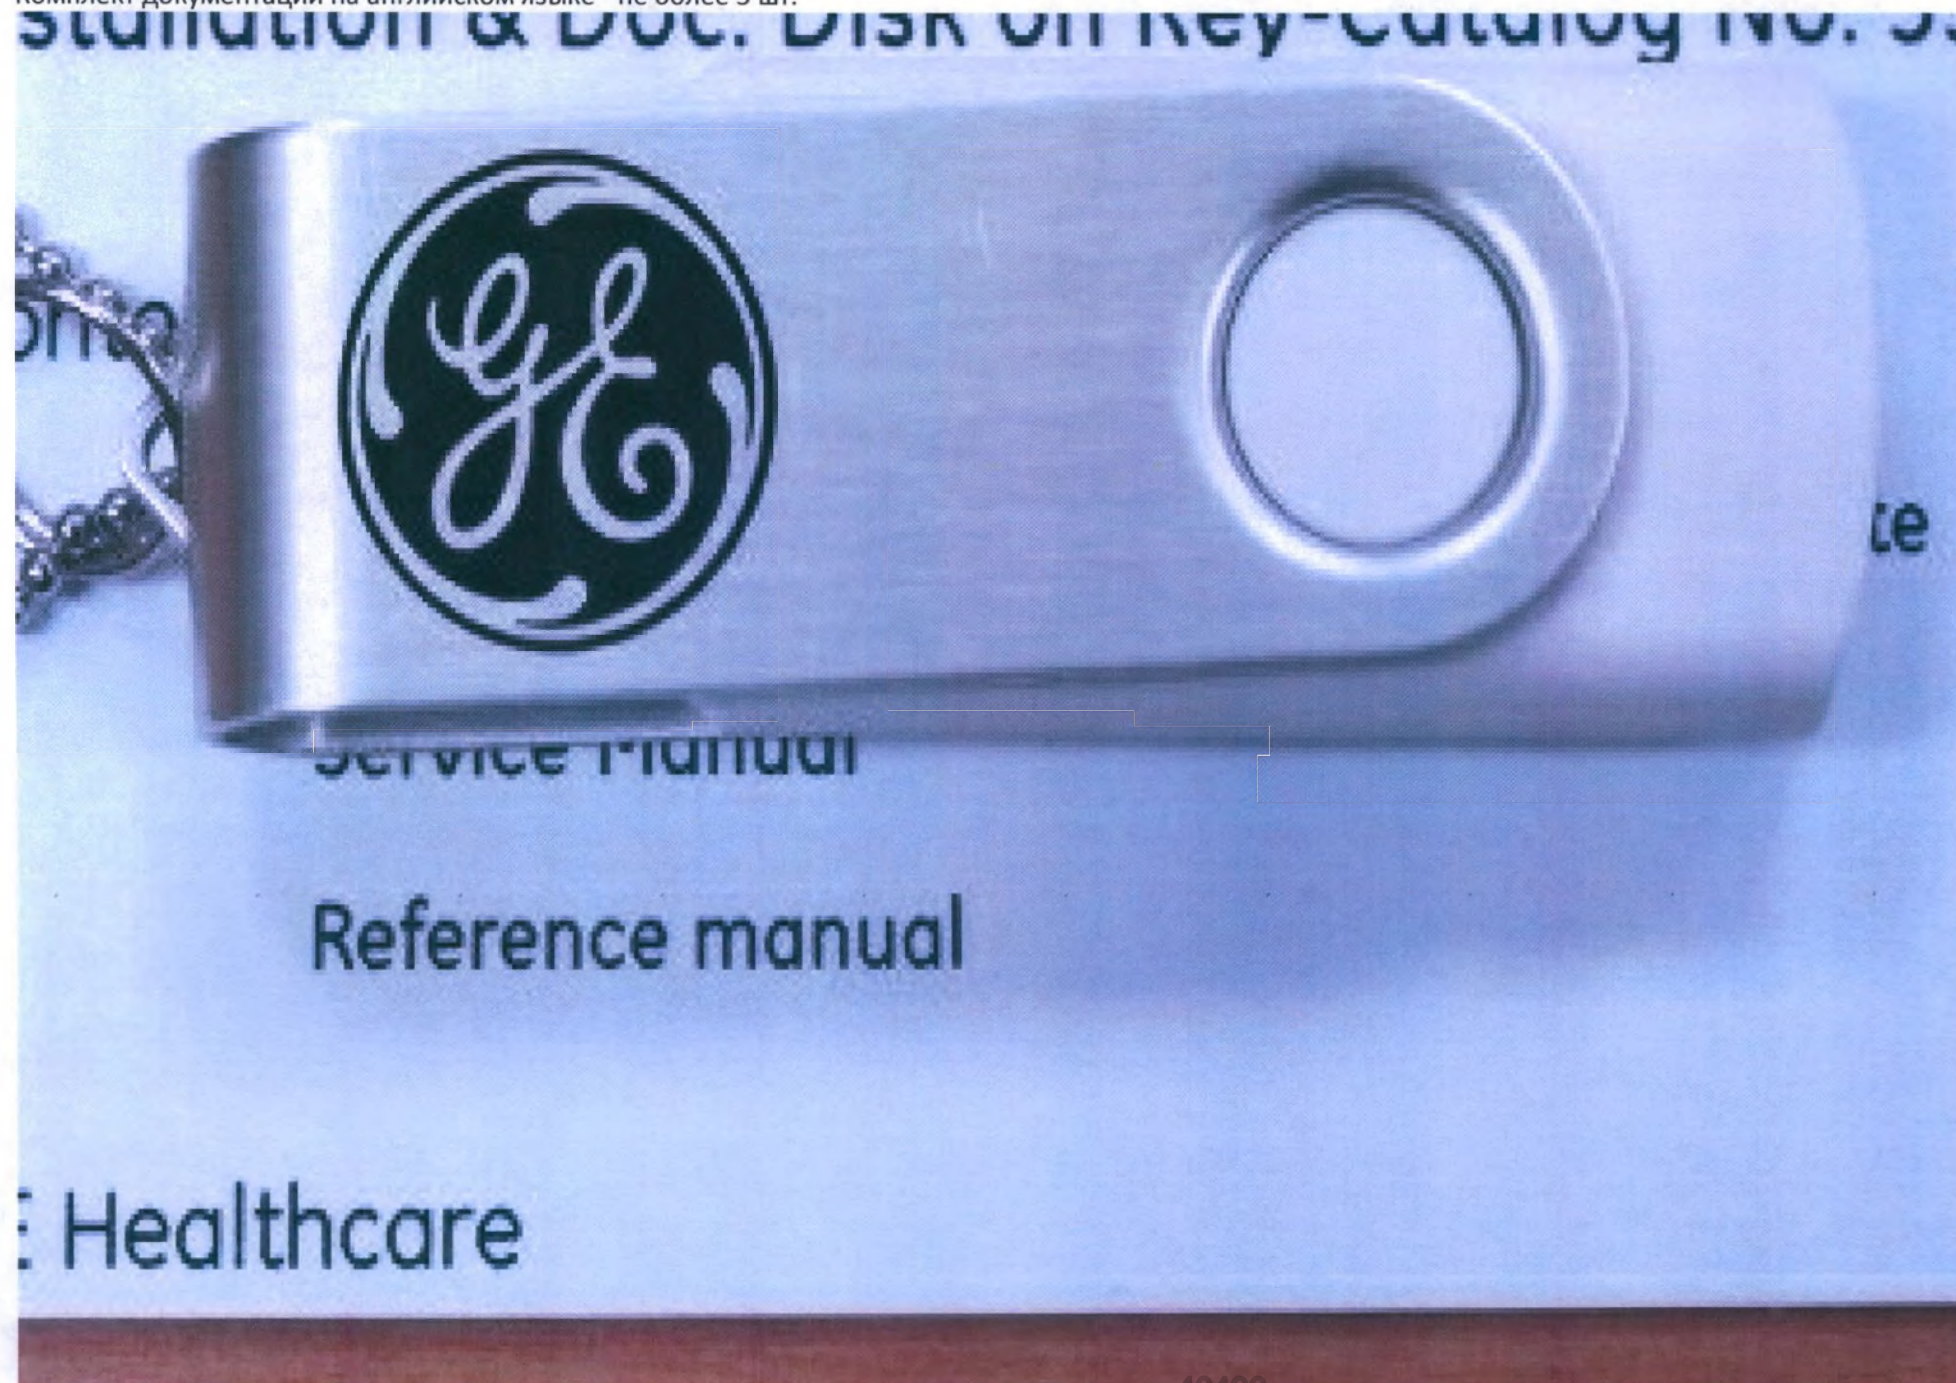

Русифицированная клавиатура

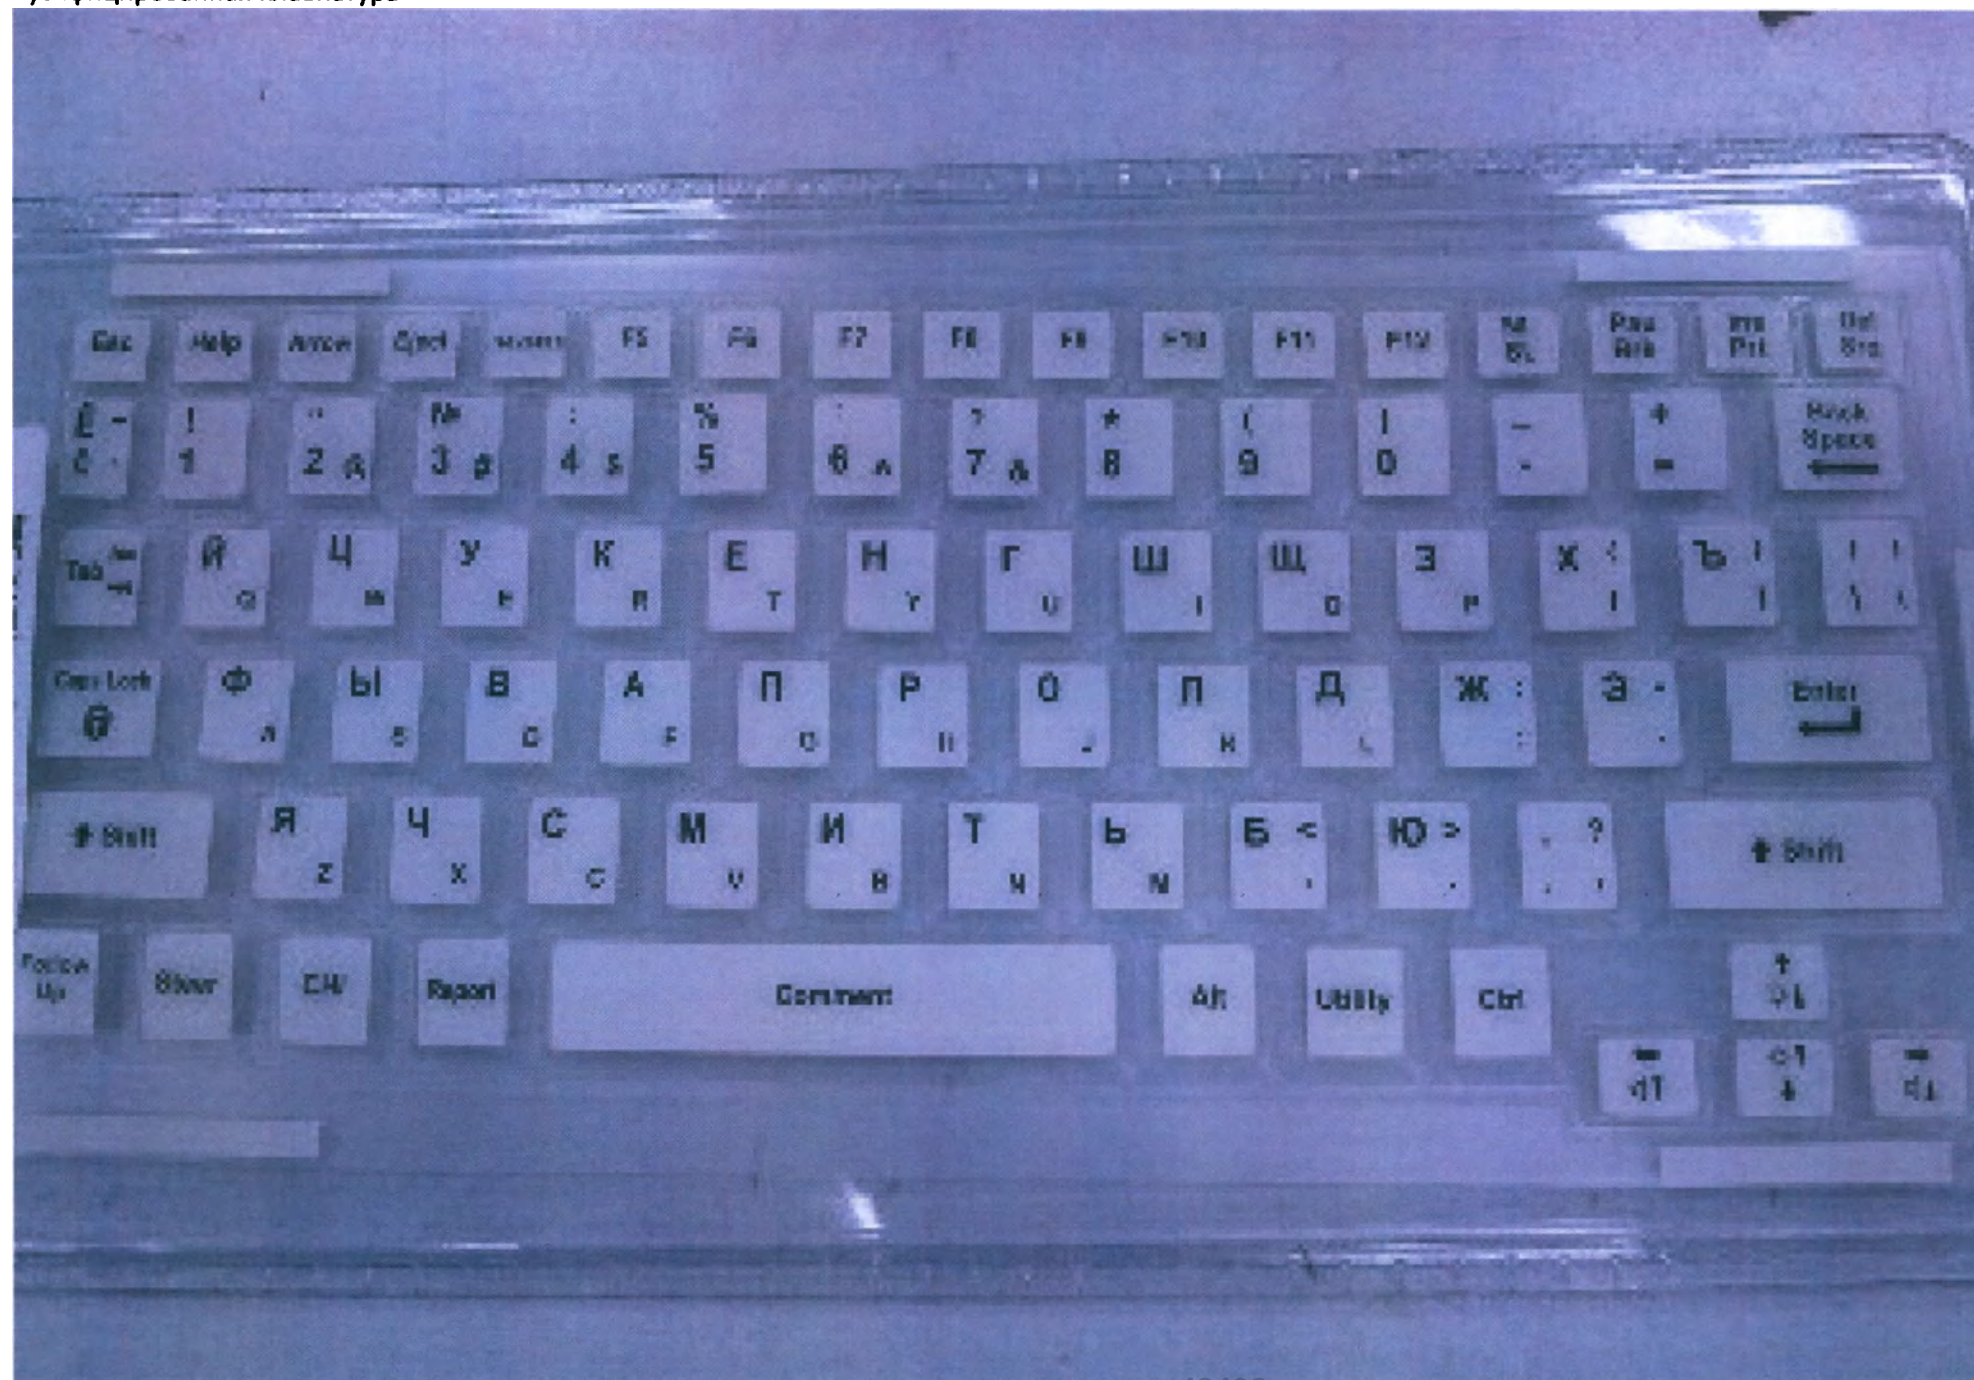

Подогреватель геля

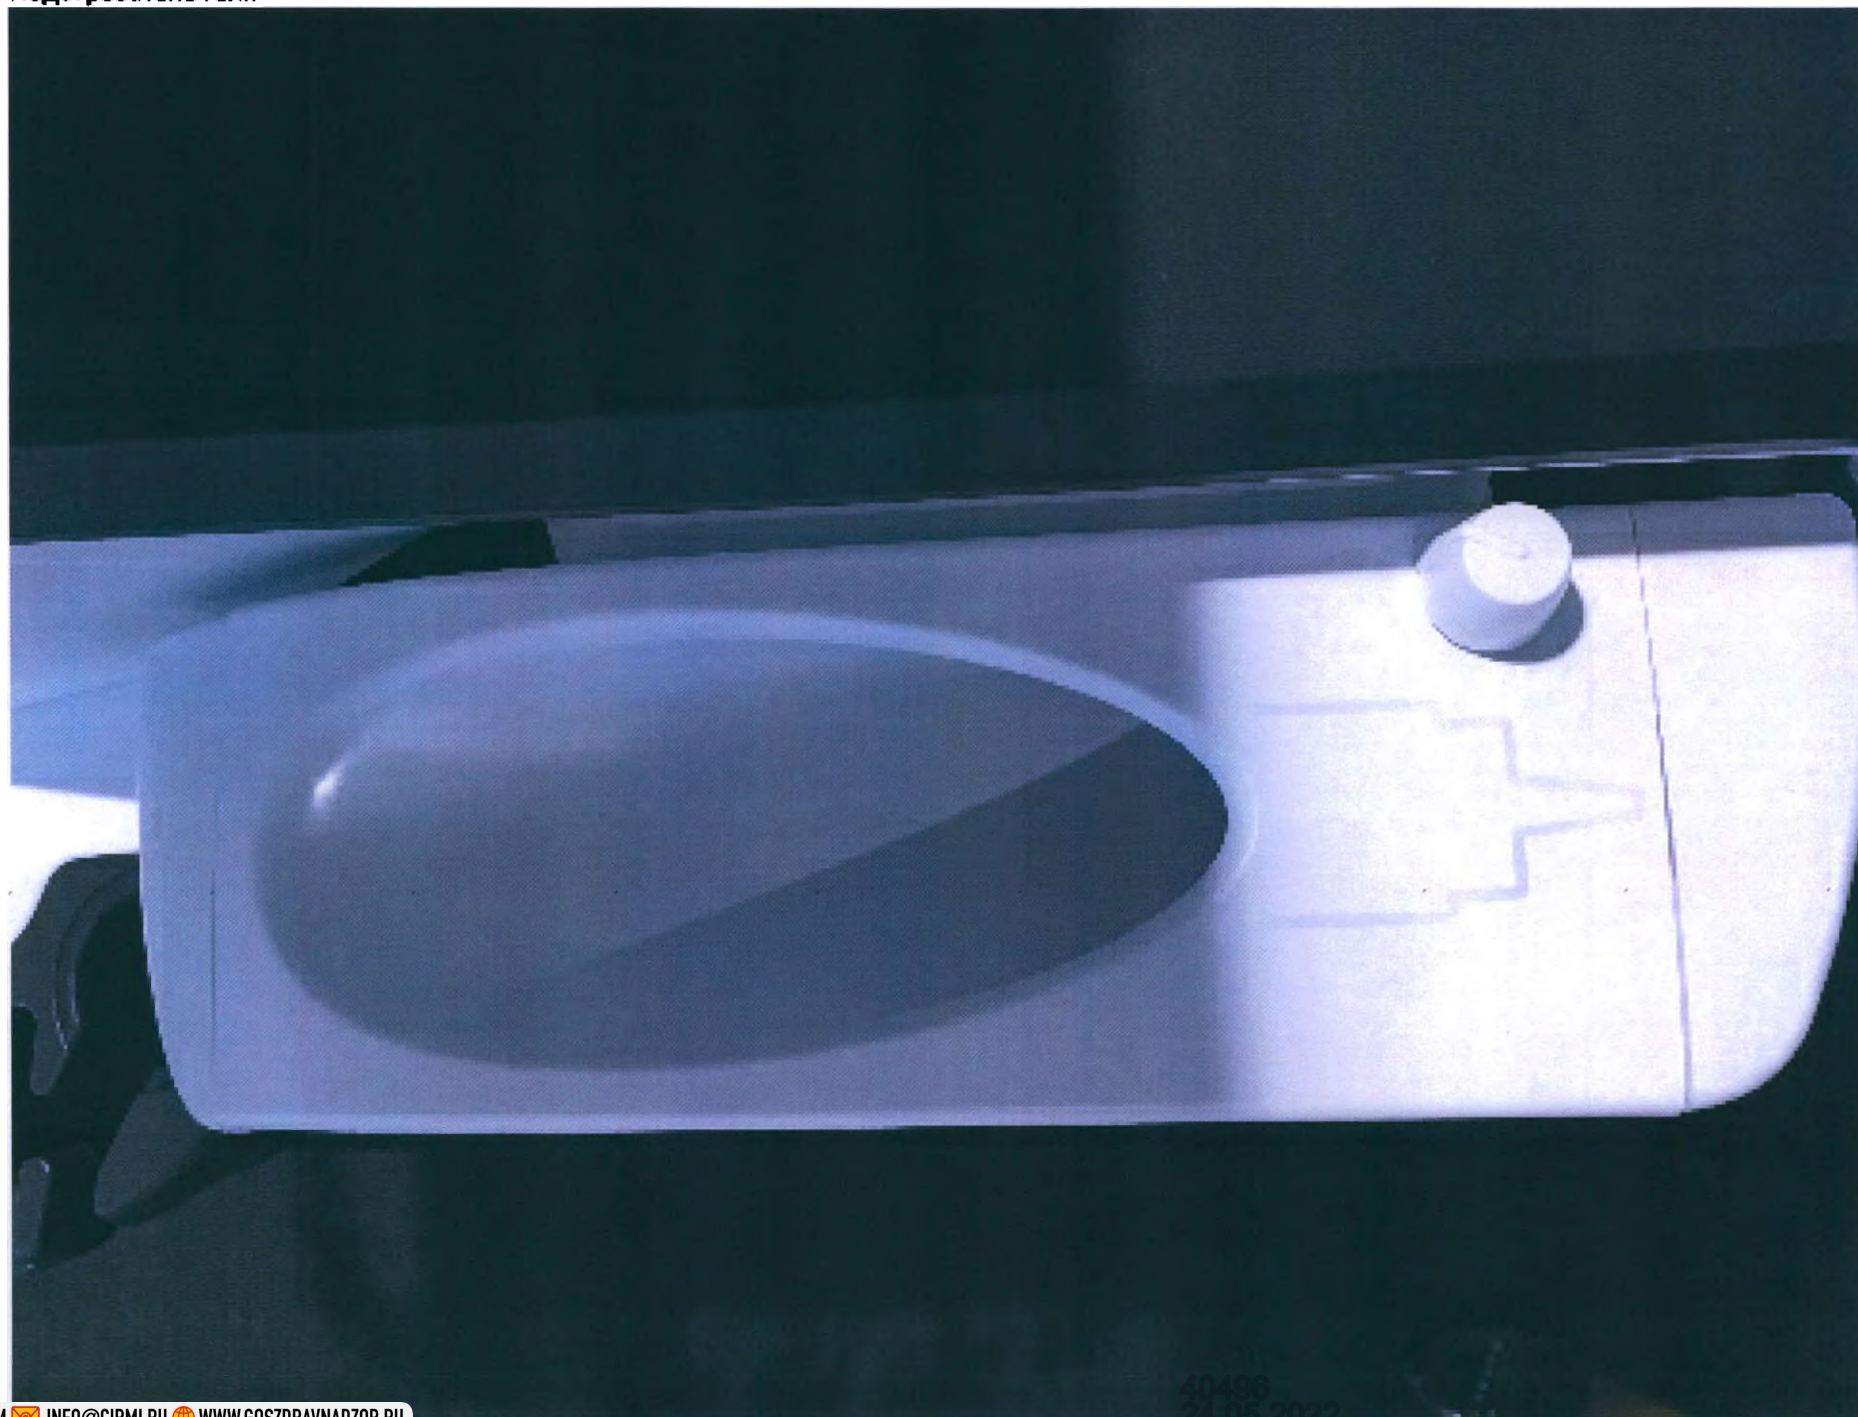

Набор для биопсии для секторных фазированных датчиков - не более 50 шт.




Набор для биопсии для конвексных датчиков - не более 50 шт.




Набор для биопсии для линейных датчиков - не более 20 шт.



Модуль для модернизации системы - не более 3 шт.

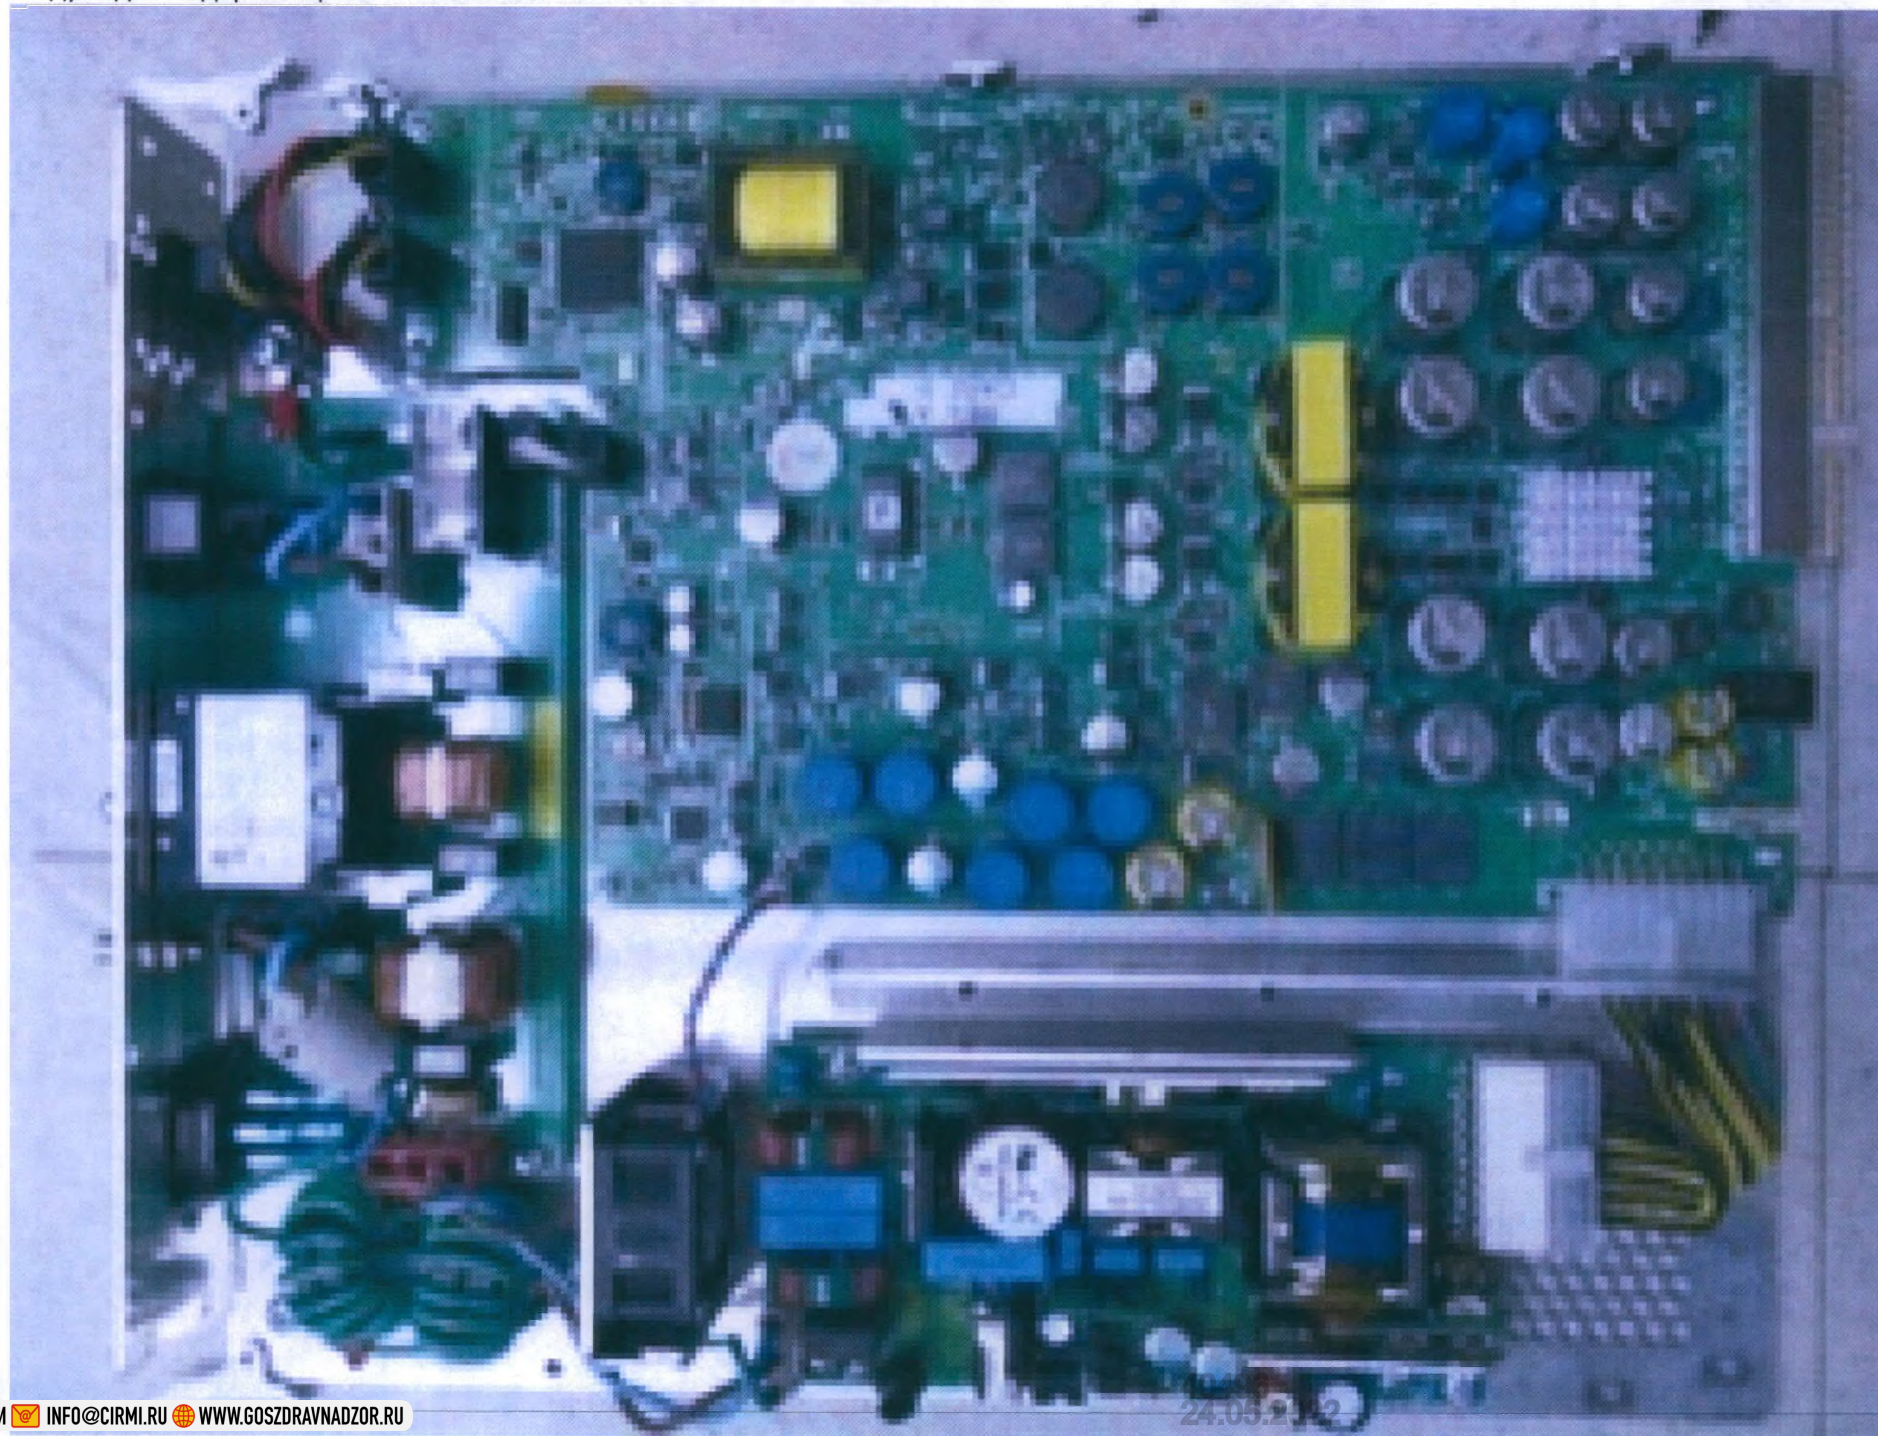


Устройство для хранения чреспищеводного датчика - не более 5 шт.

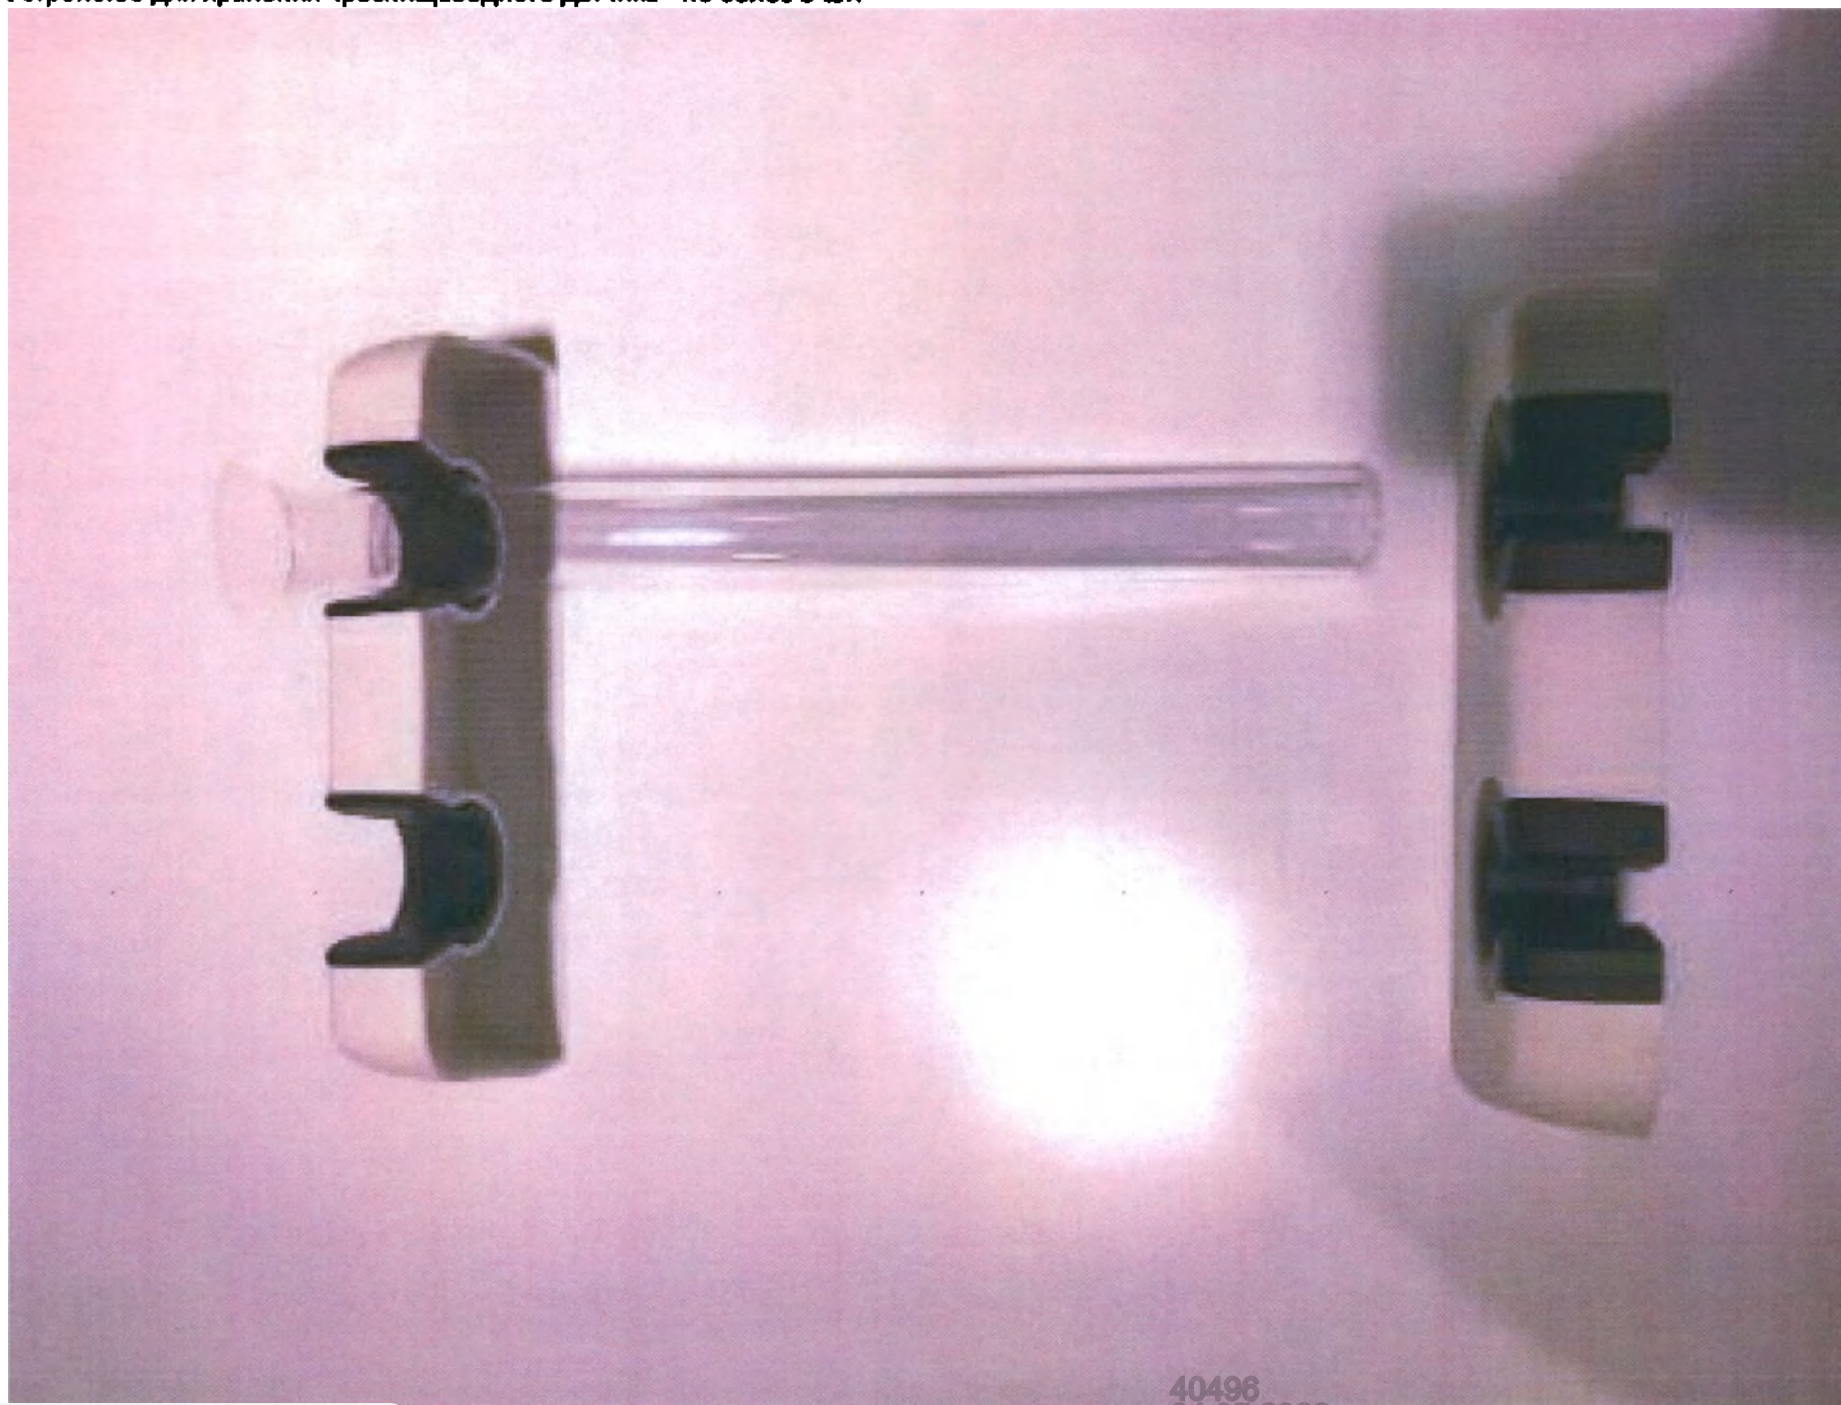

Индикатор механических повреждений чреспищеводных датчиков - не более 5 шт.



Адаптер для подключения чреспищеводного датчика - не более 3 шт.

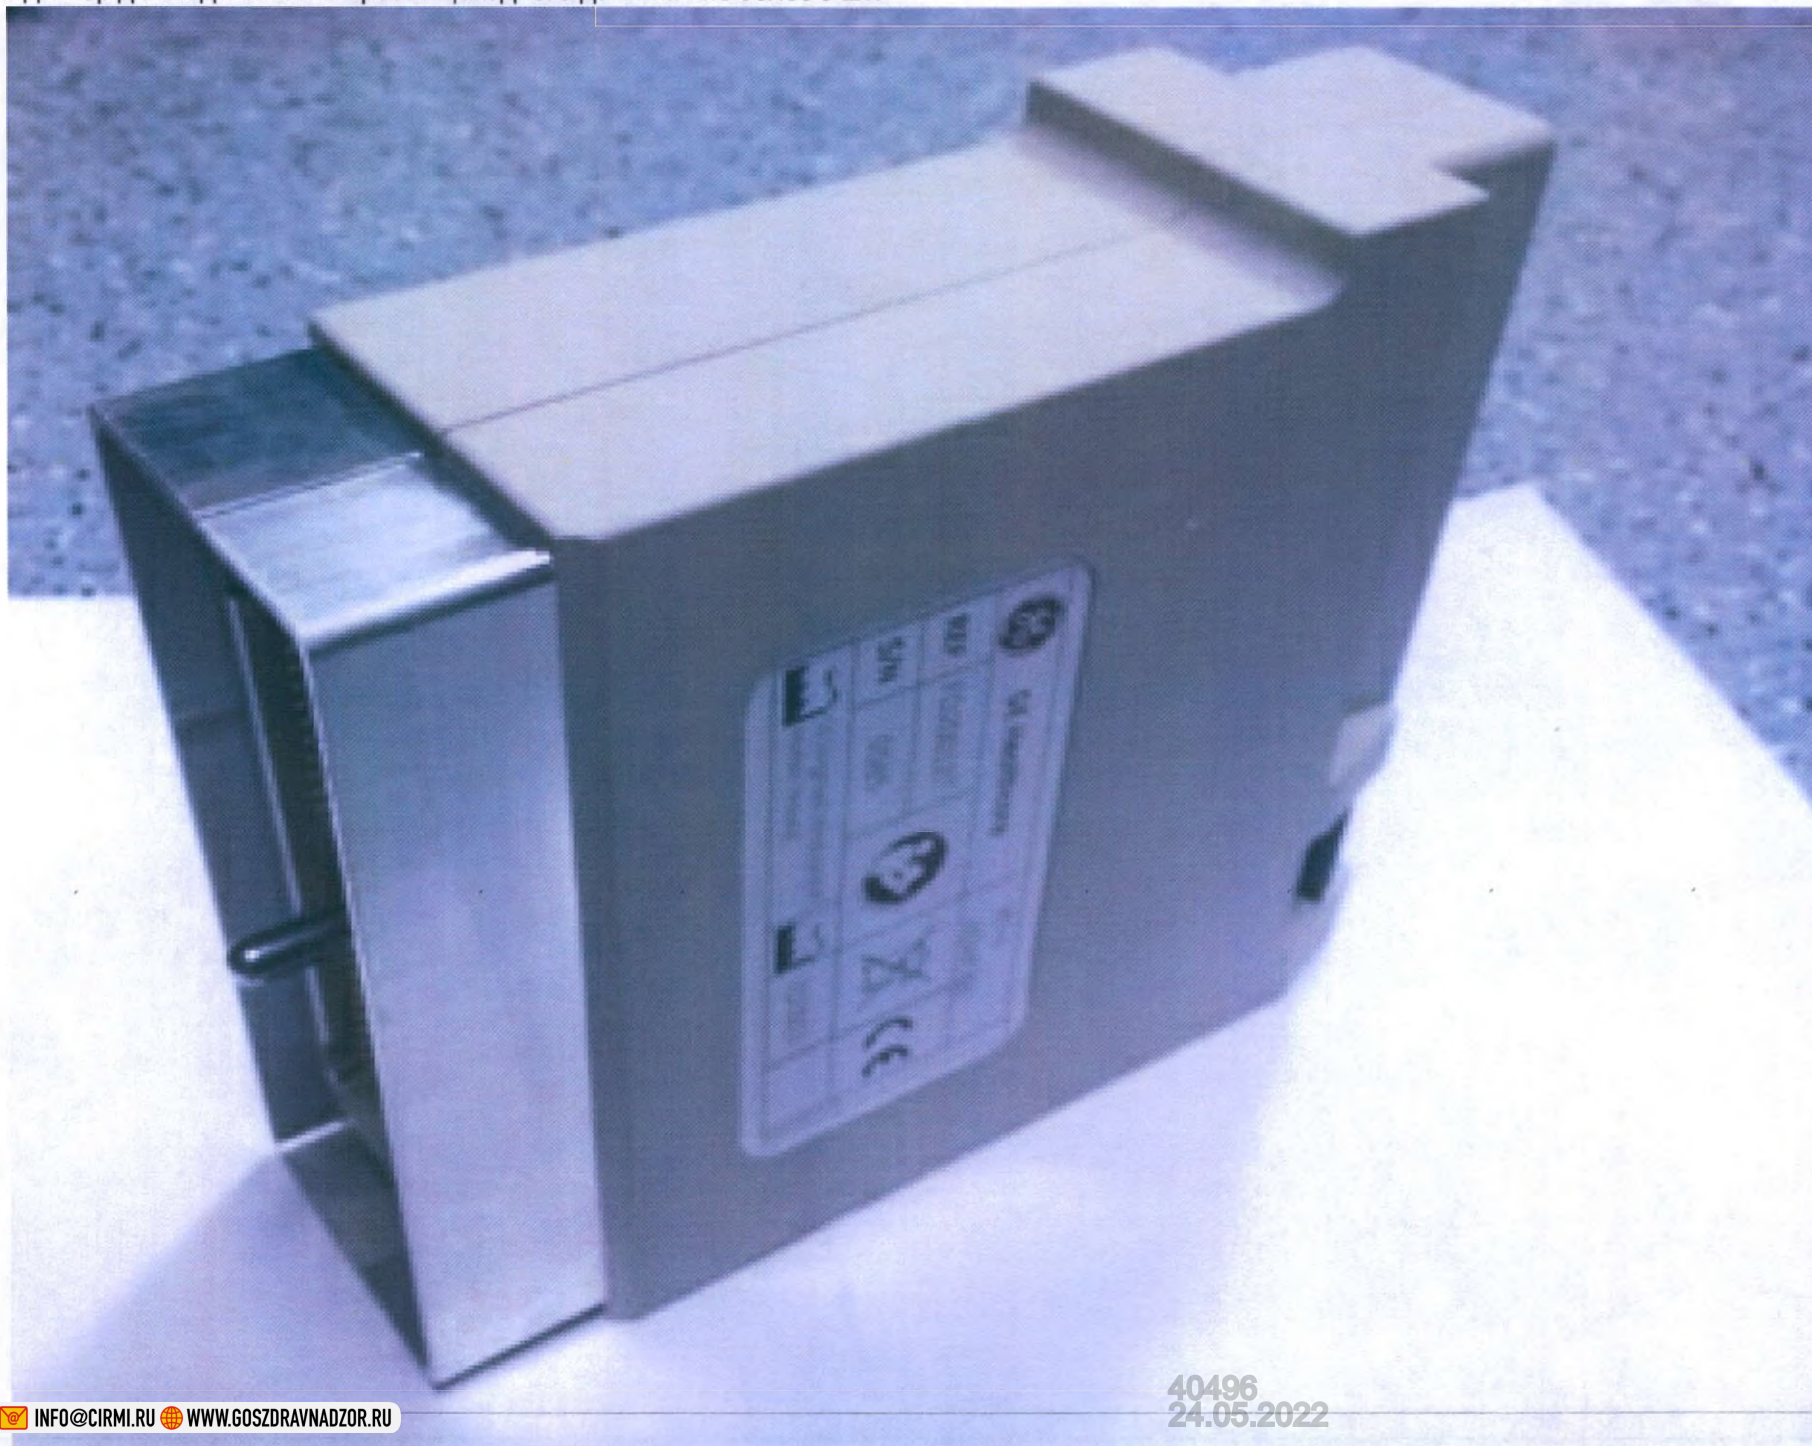


Устройство для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме объемной навигации – LOGIQ E10 Volume Navigation.



Стойка для объемной навигации.



Стойка для объемной навигации.

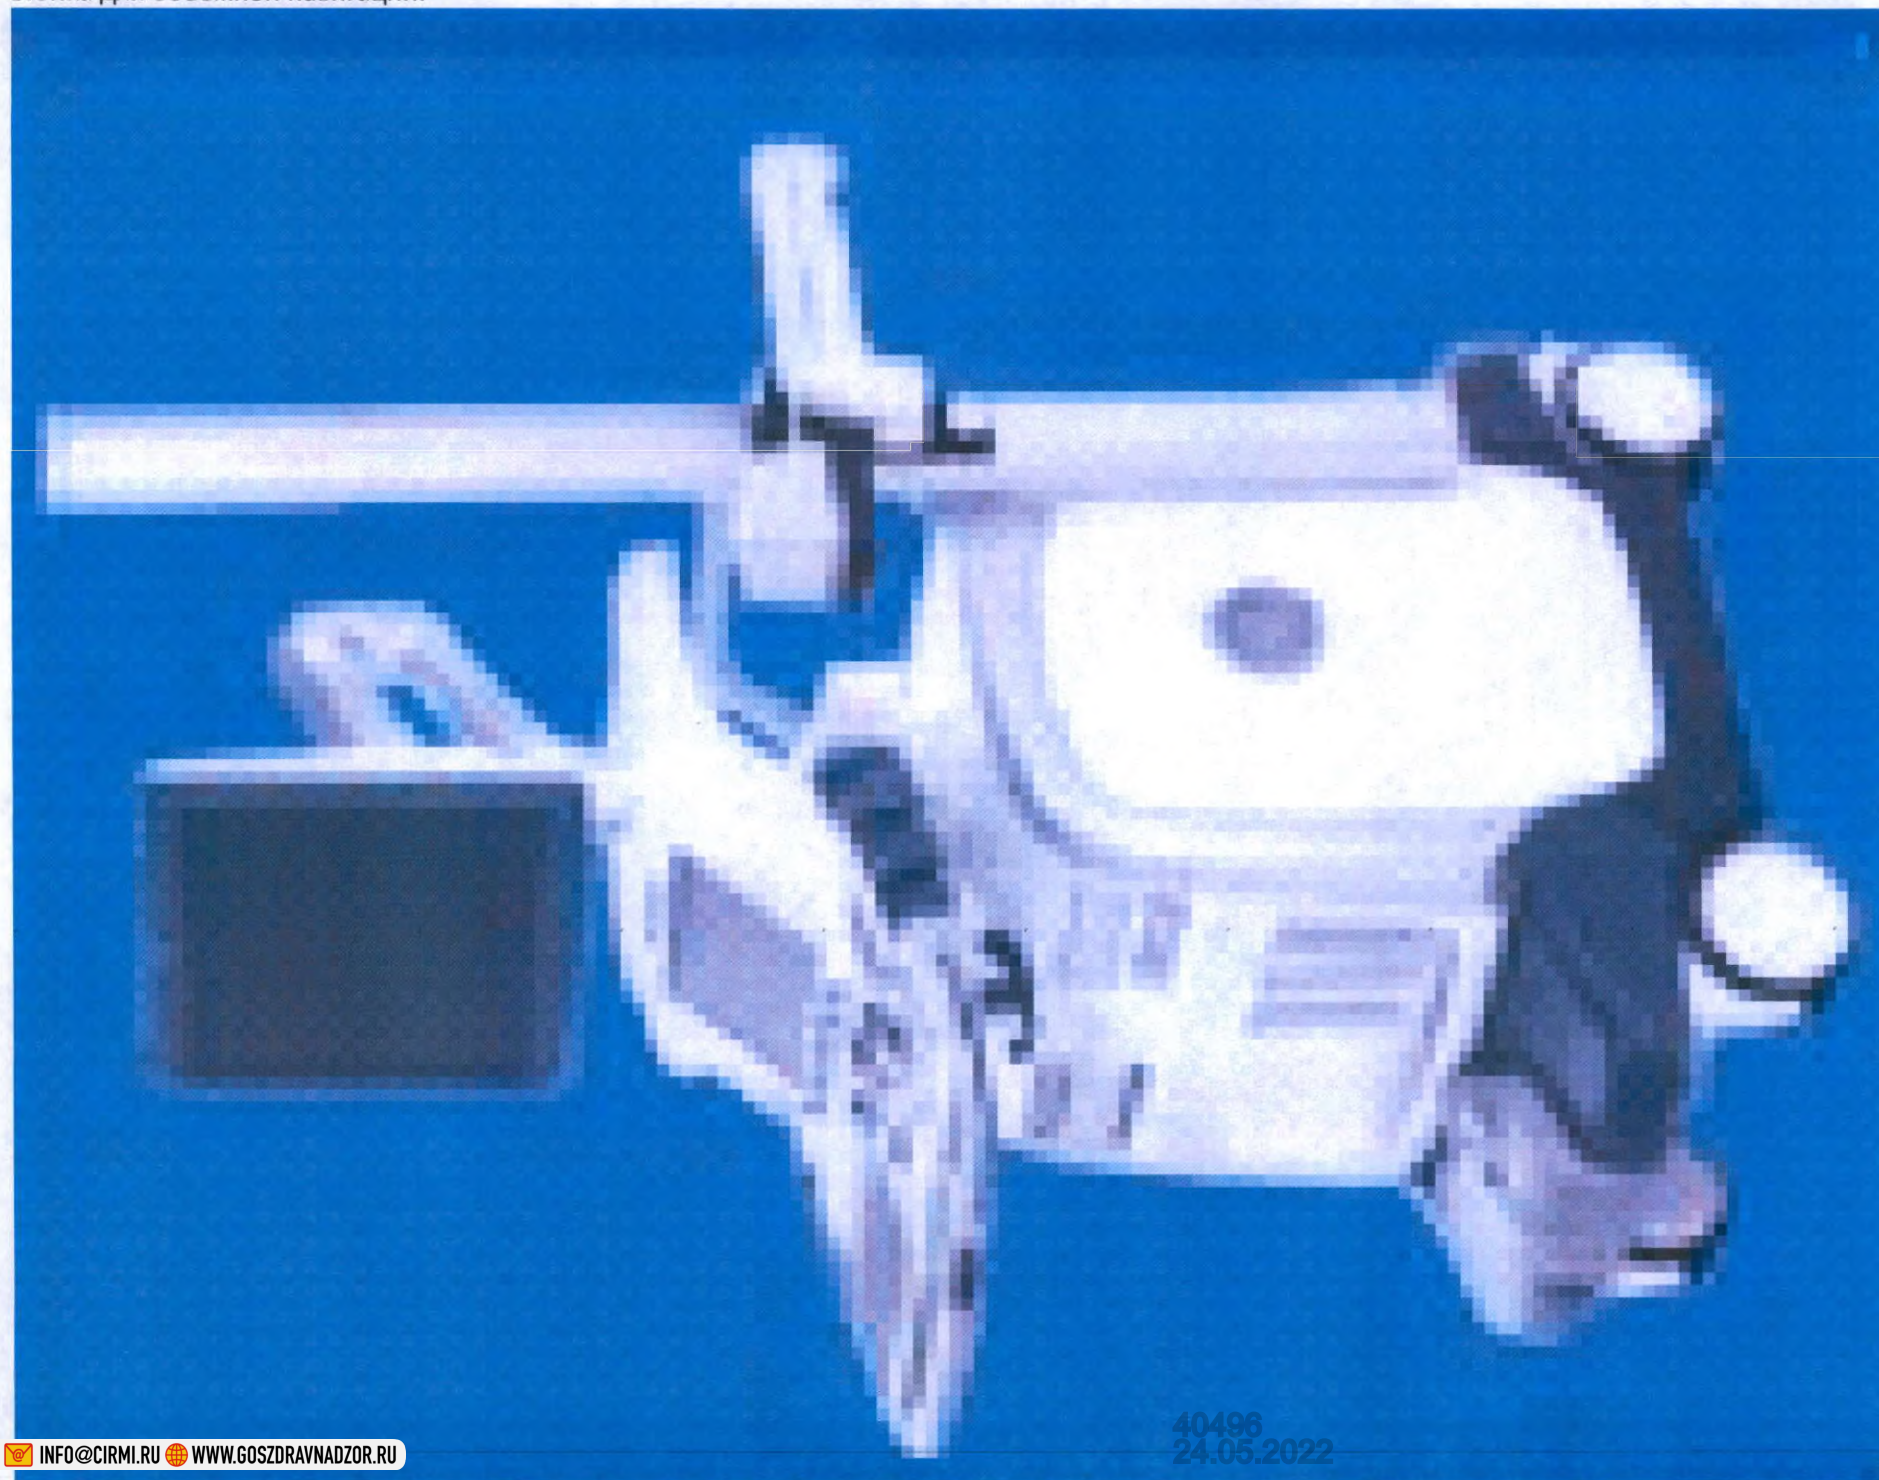

Сенсоры для отслеживания датчиков - не более 10 шт.



BLUESSO Wireless Network Properties

Connect...

Secu...

Security type:

WPA2-Enterprise

Encryption type:

AES

Choose a network authentication method:

Cisco: PEAP


Settings


☒ Remember my credentials for this connection each time I'm logged on


Advanced settings

OK

Cancel

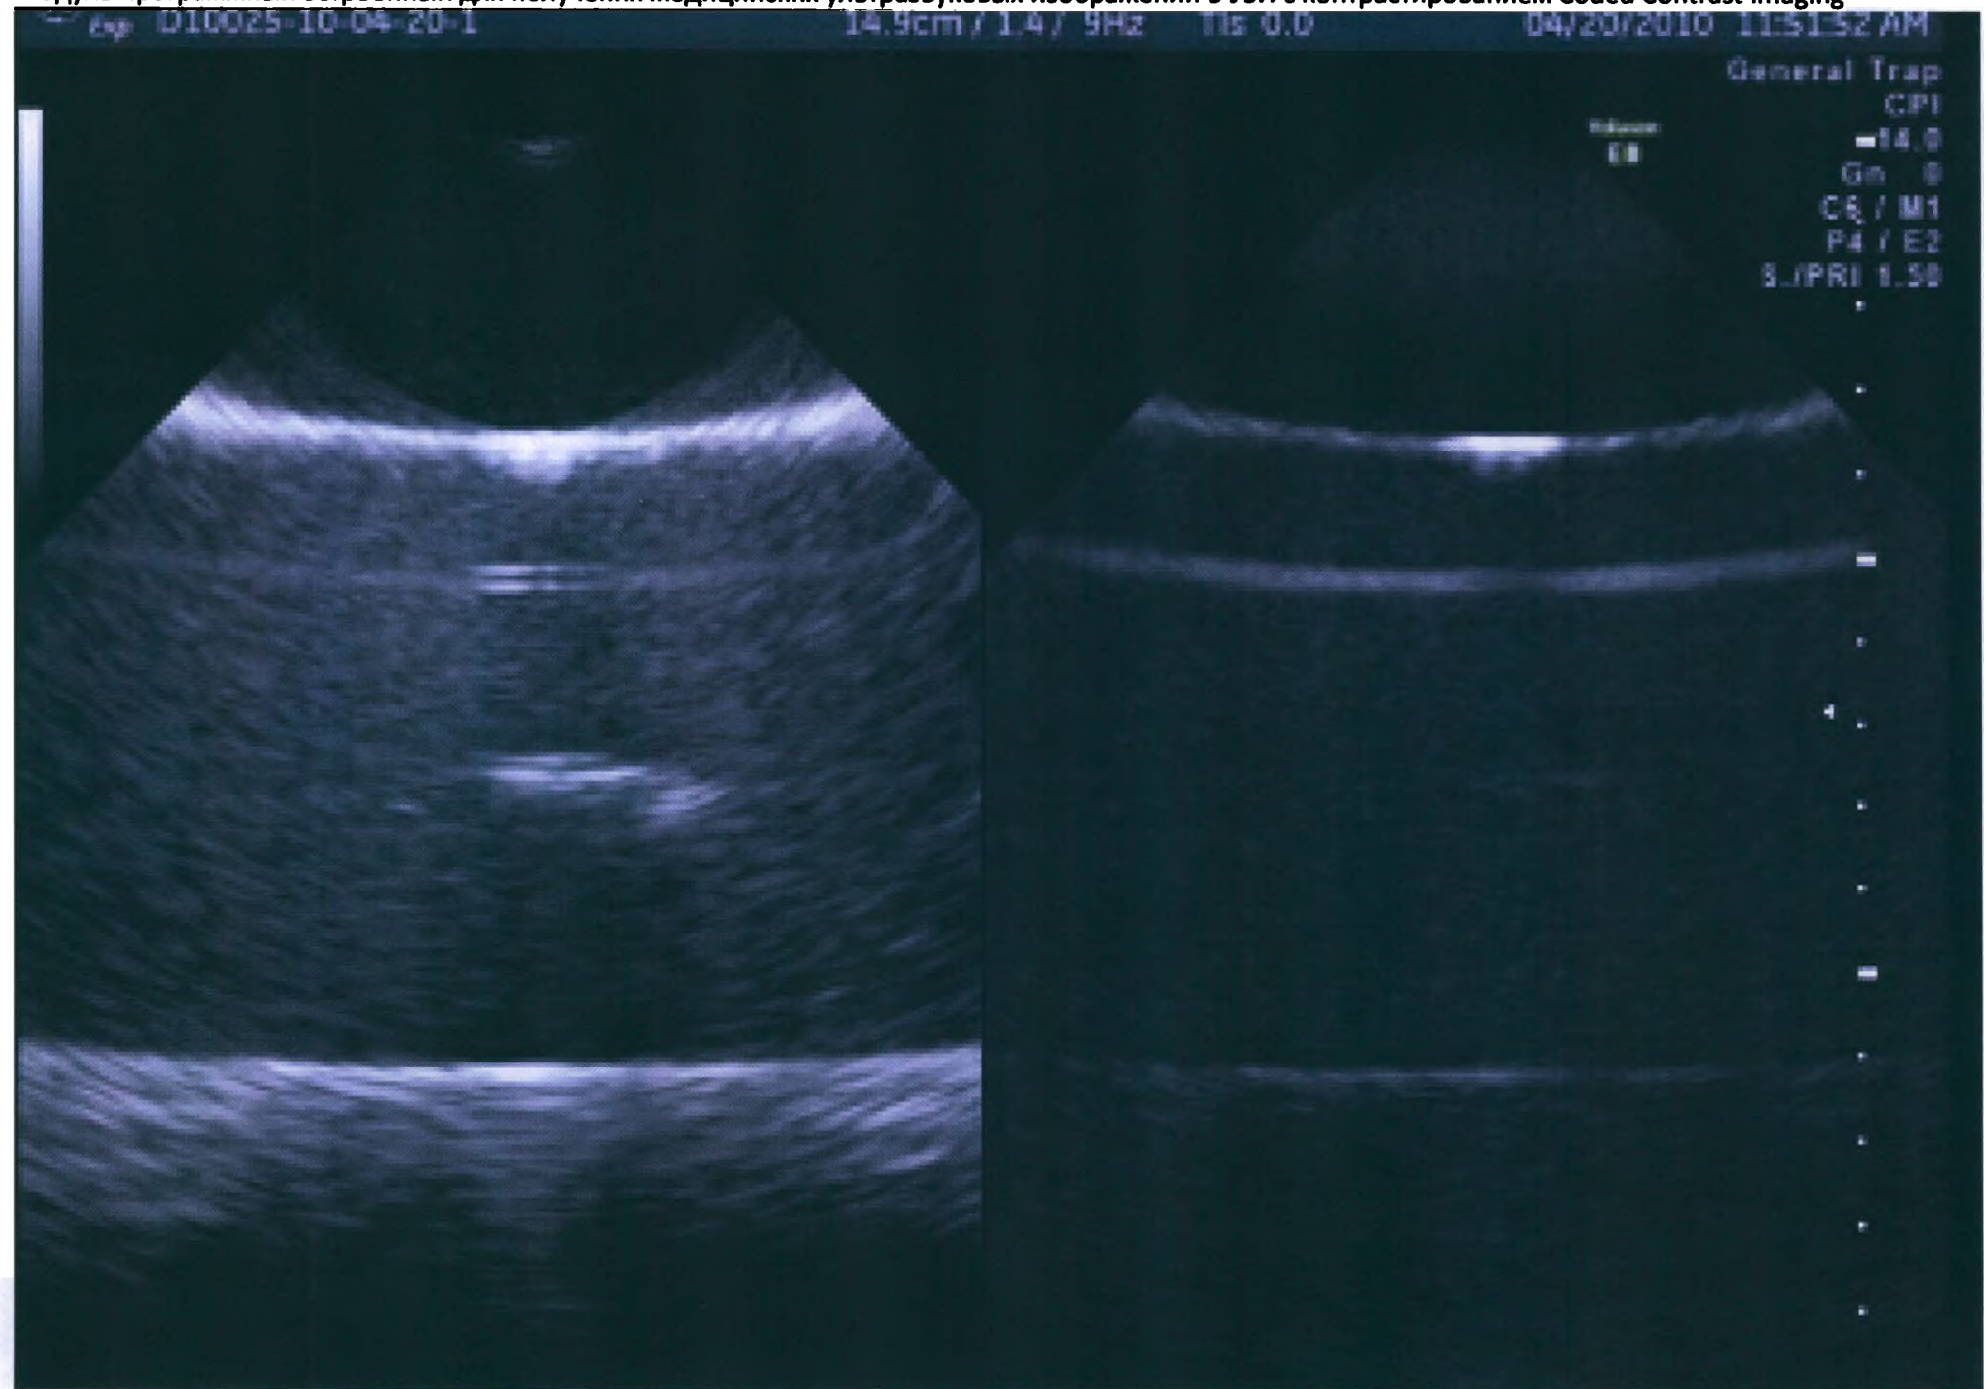

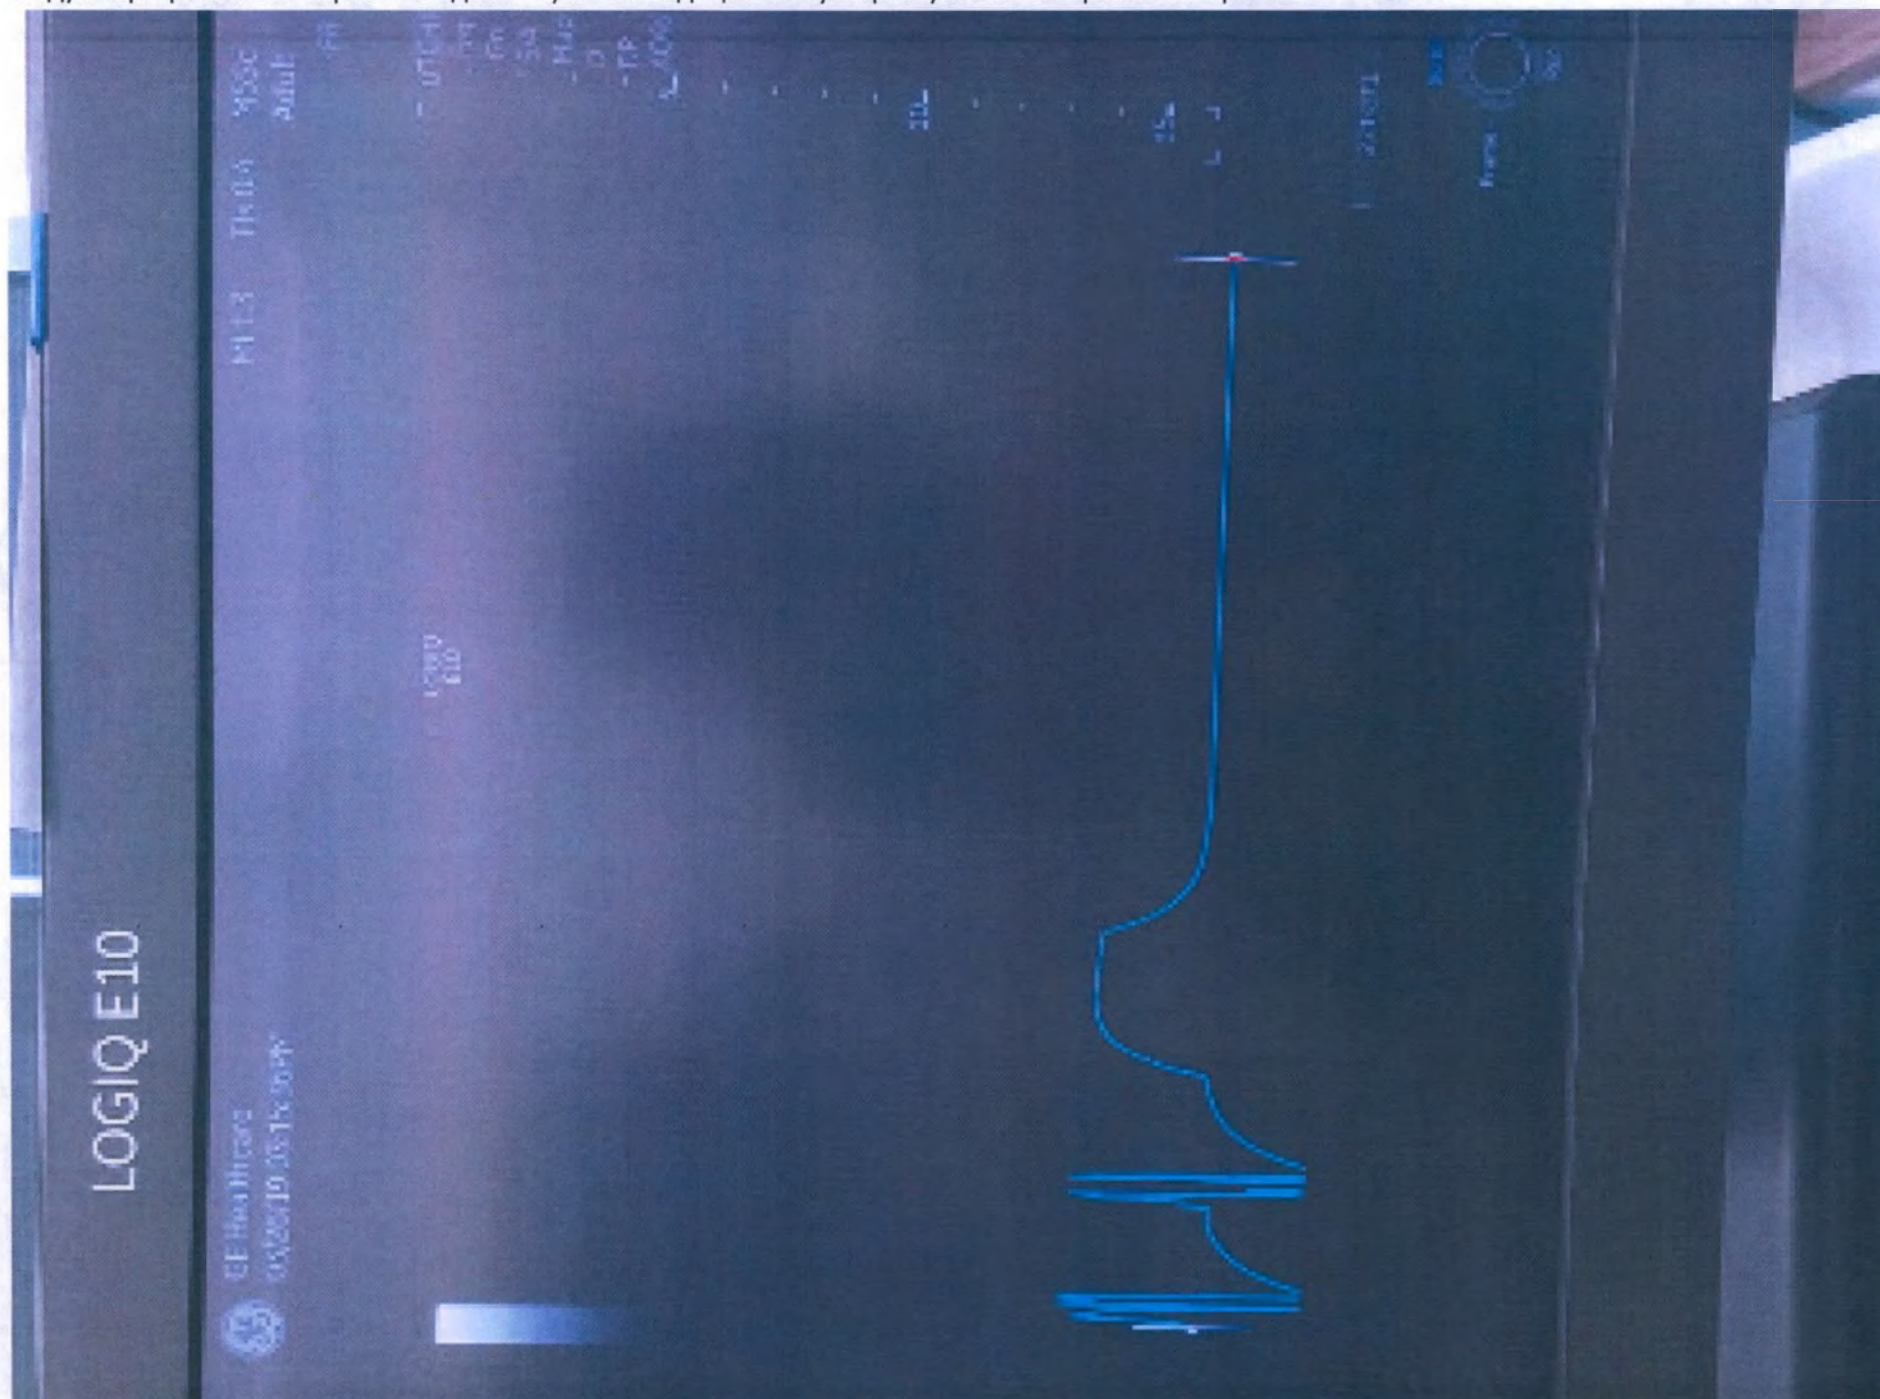

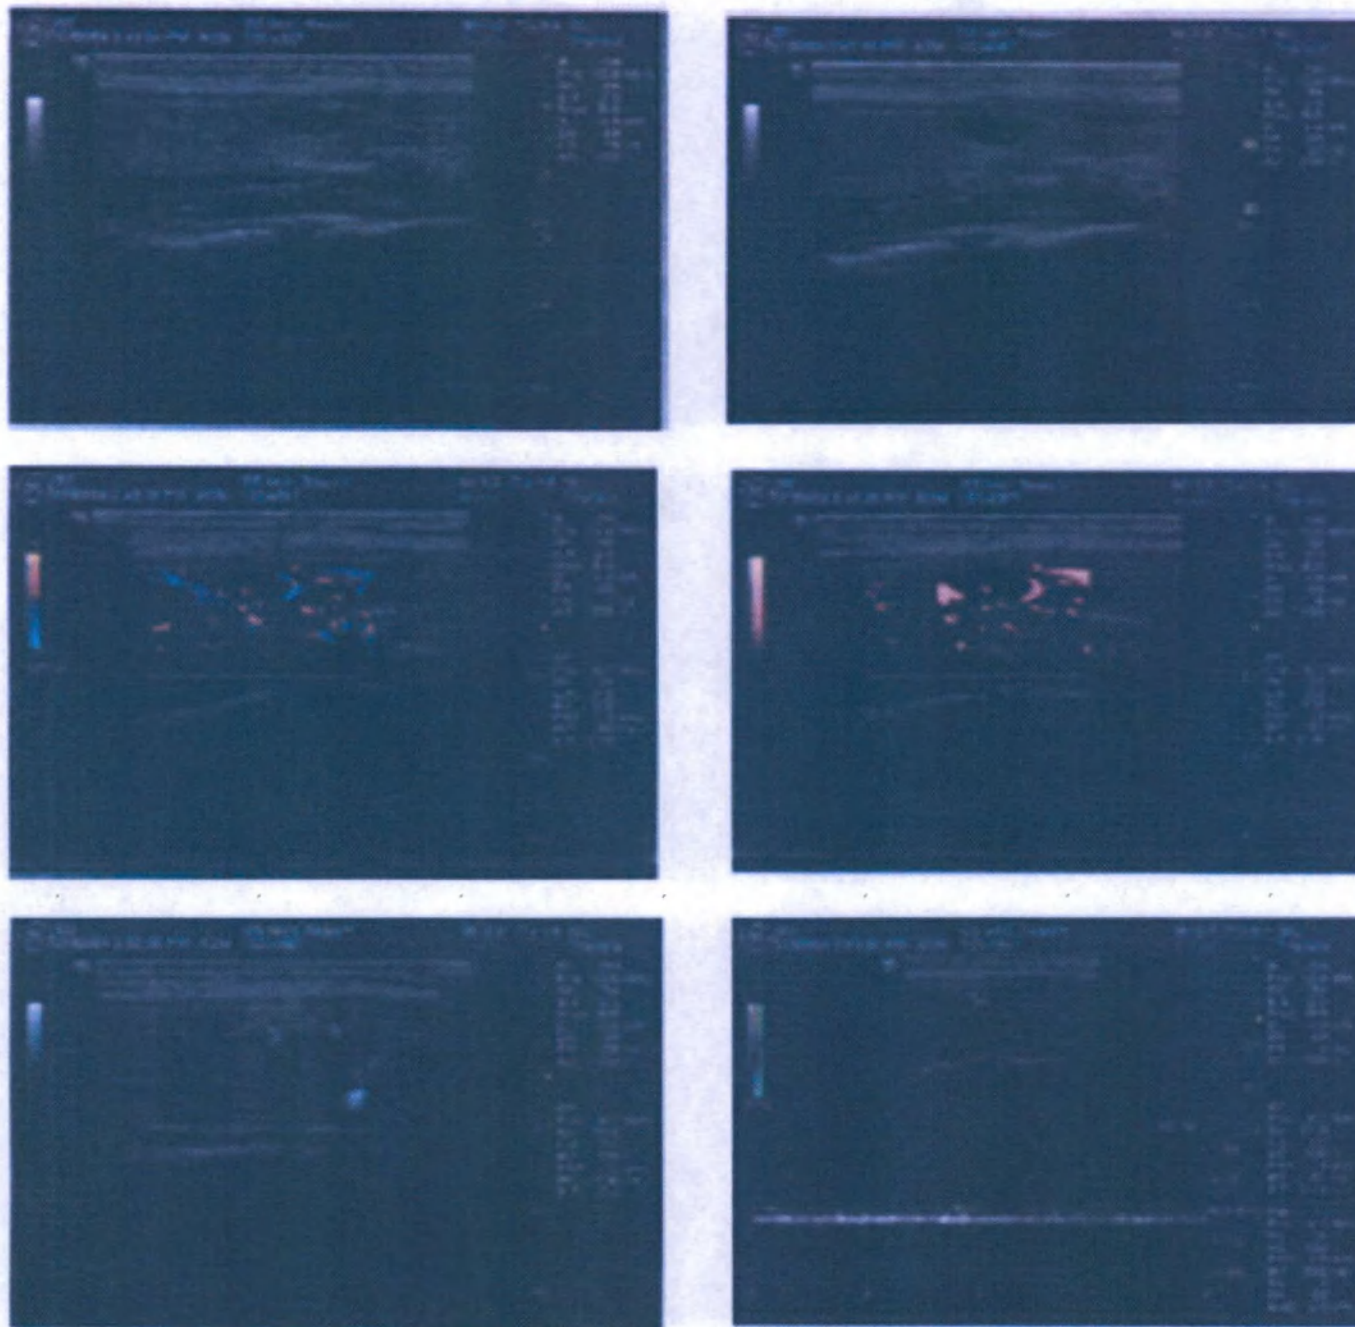




IONS








Модуль программный встроенный для получения медицинских ультразвуковых изображений в режиме эластографии сдвиговой волны Shearwave

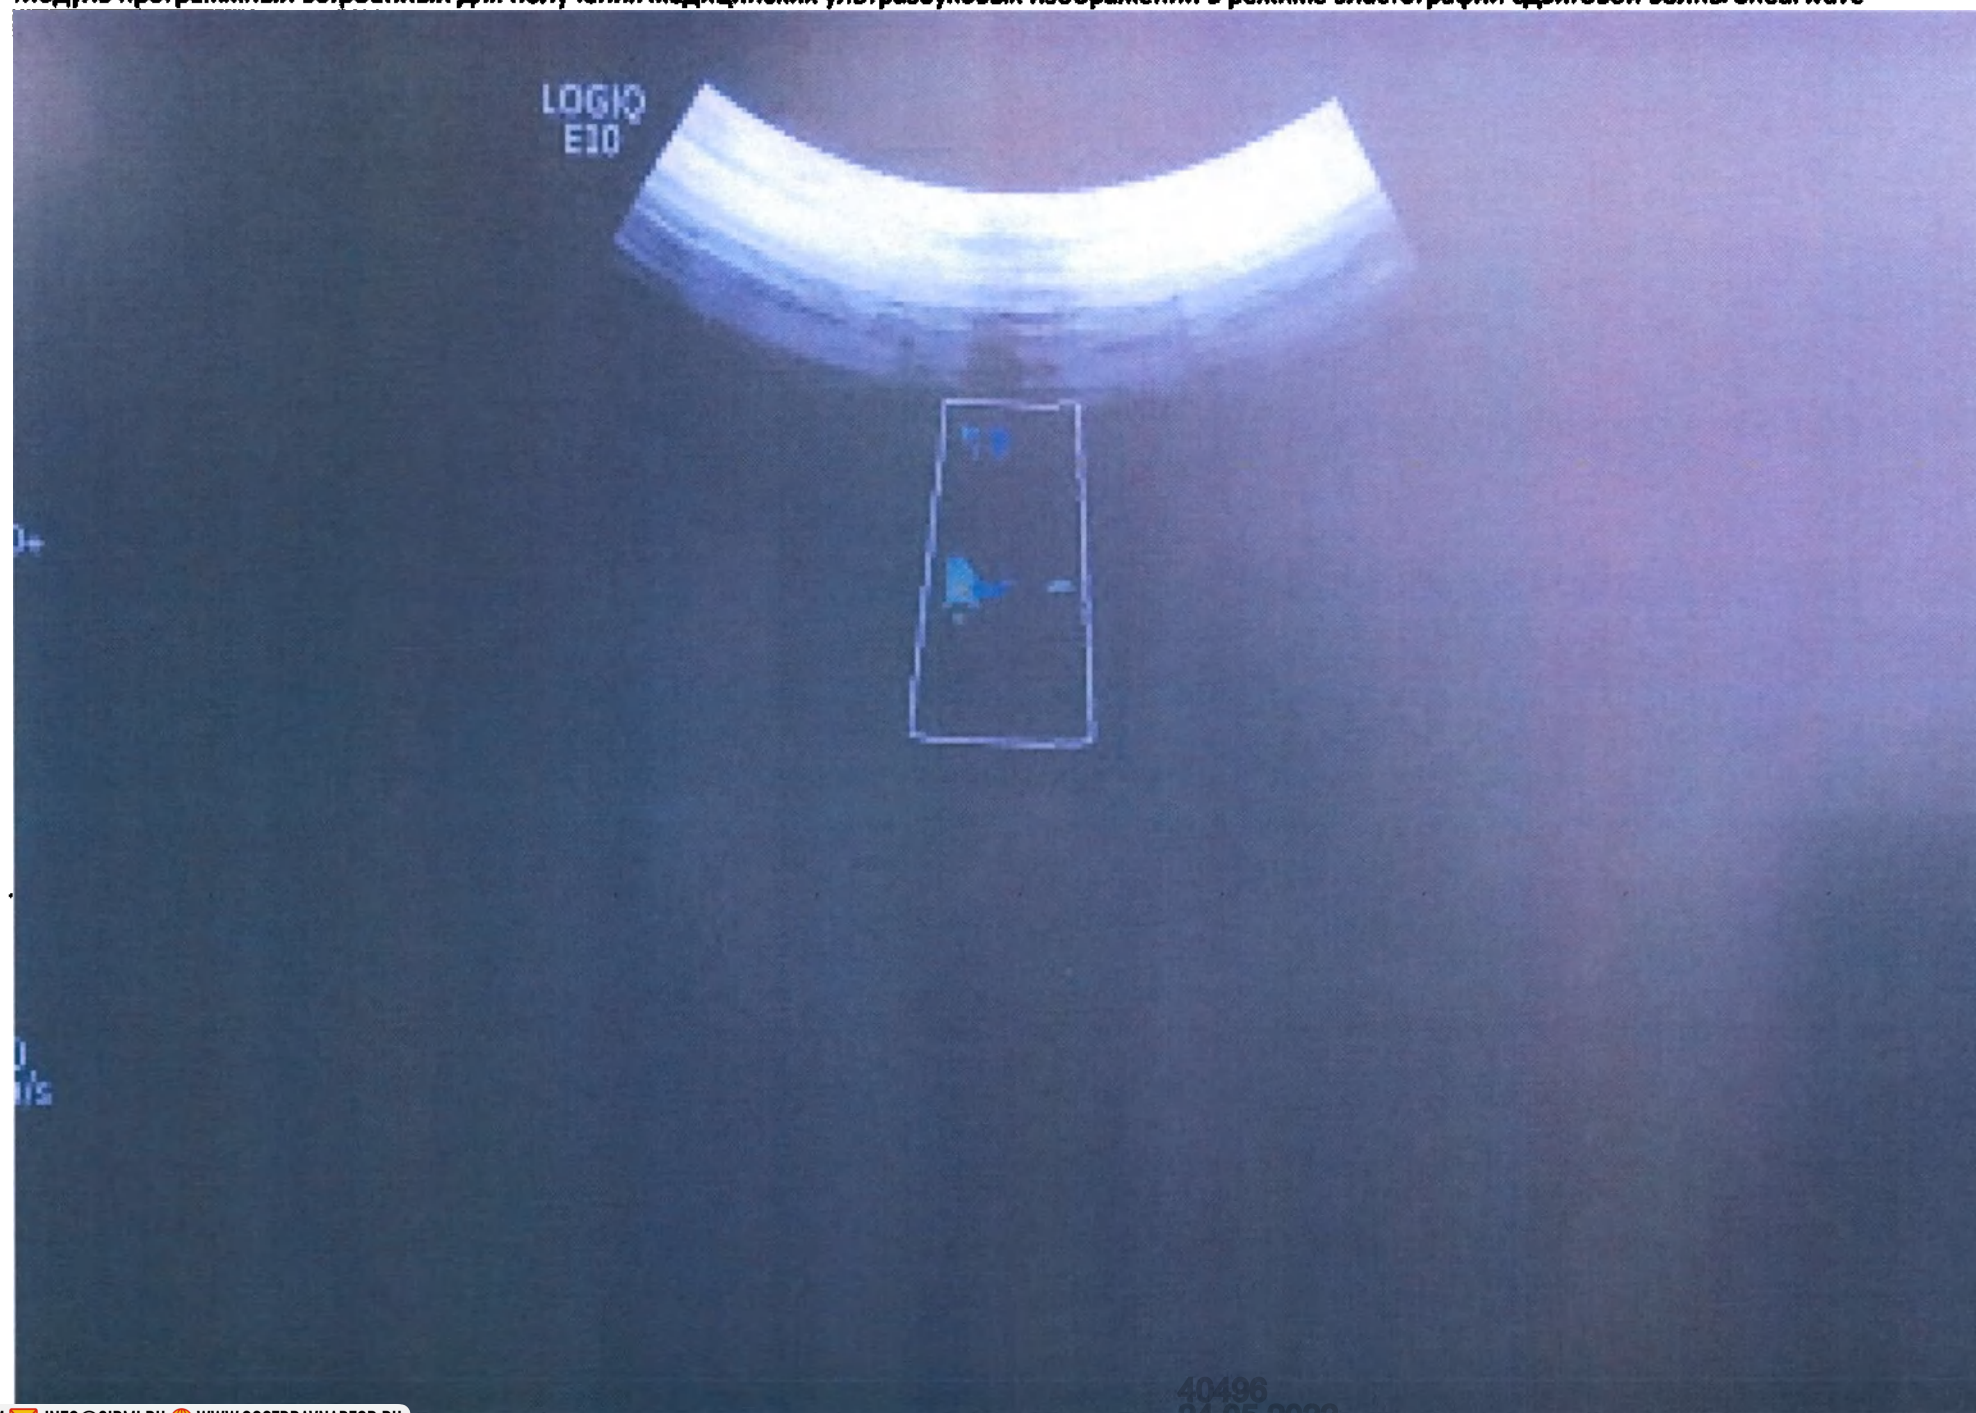

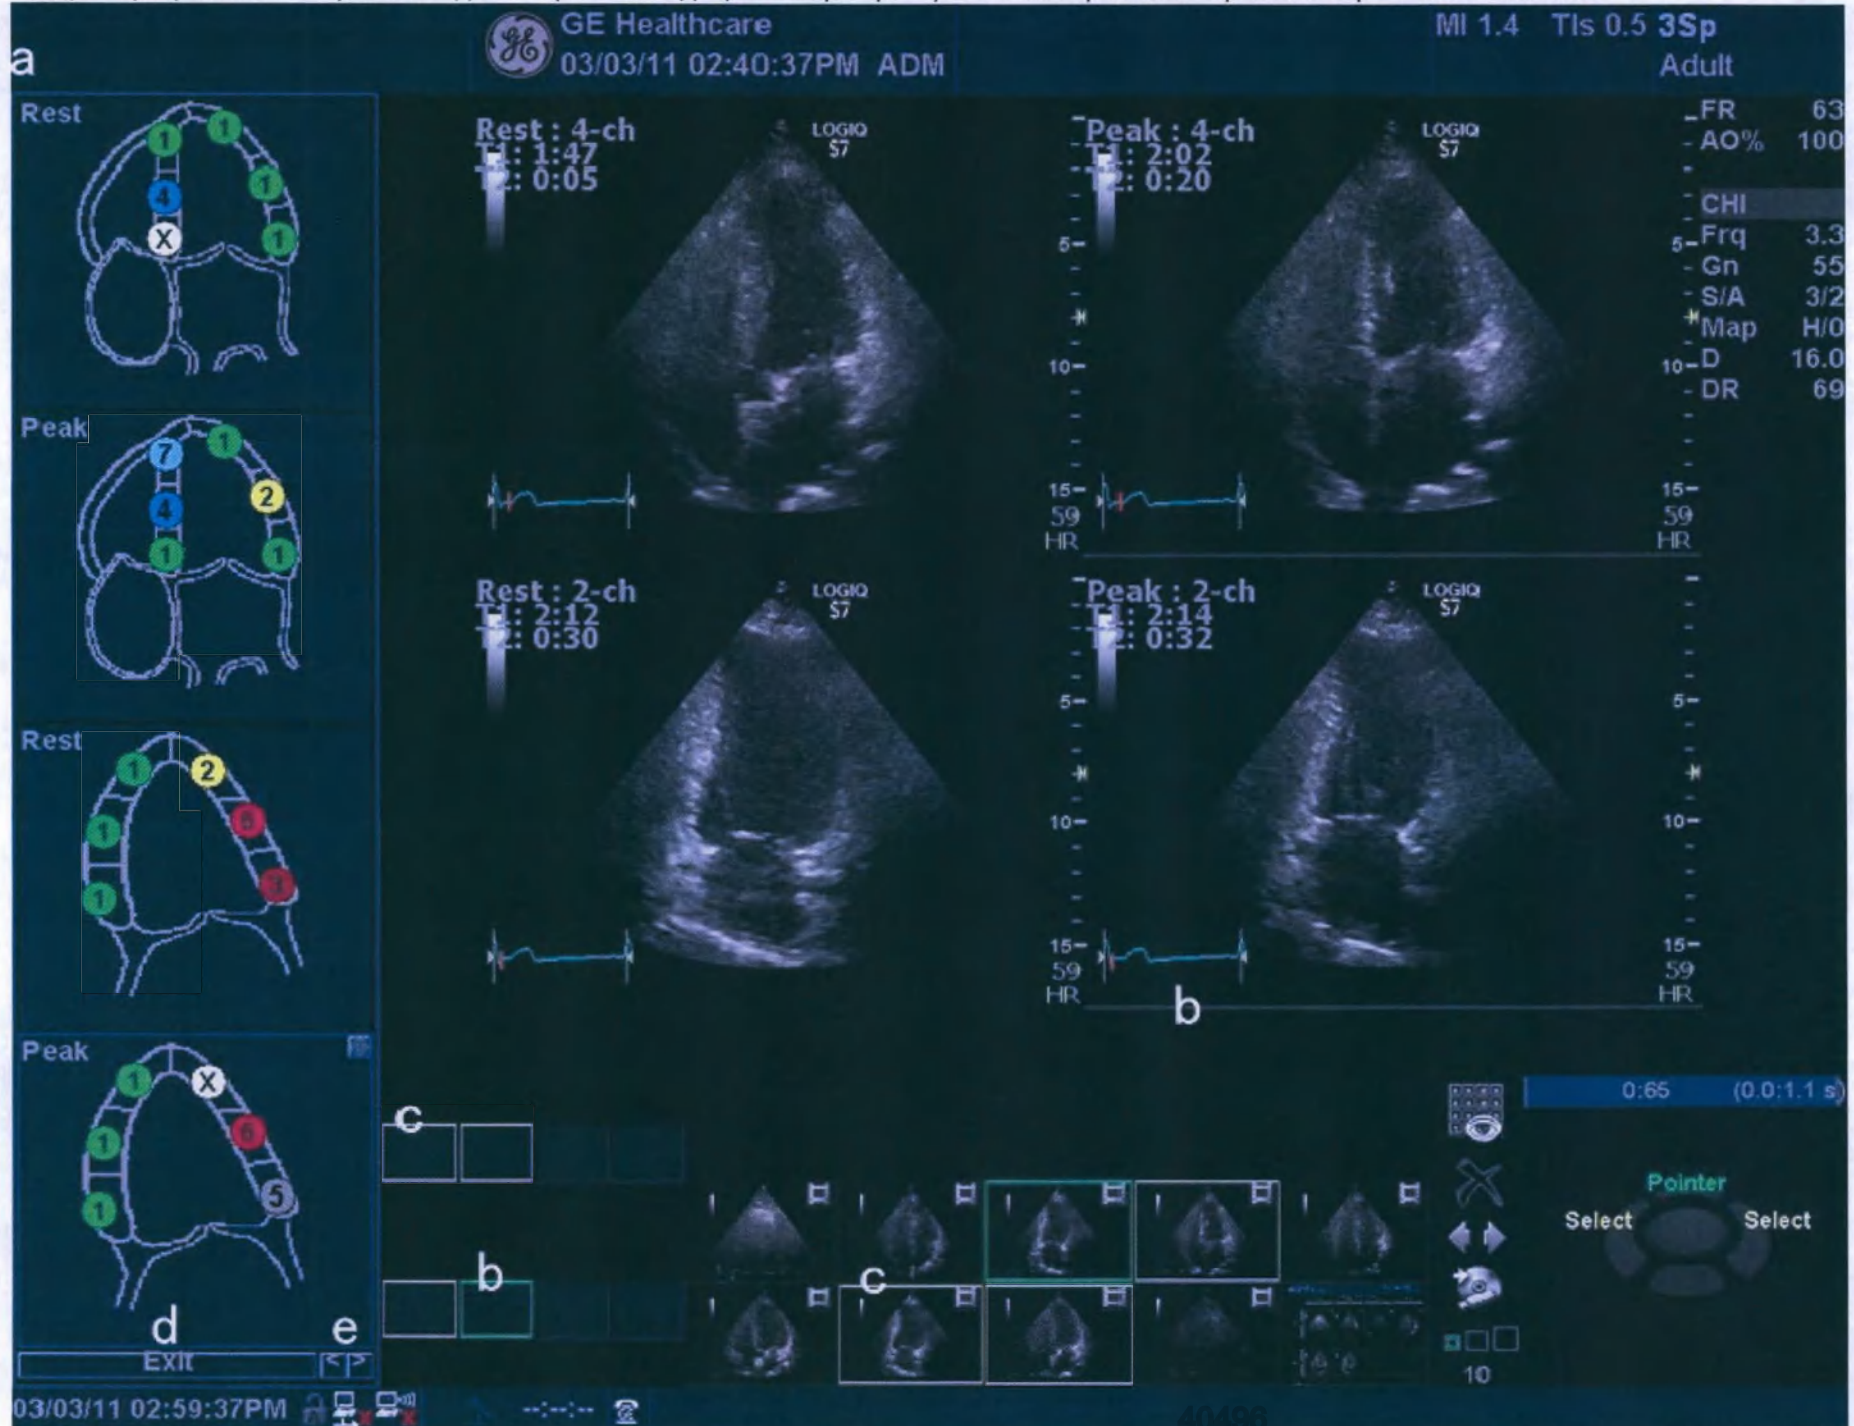

Imaging

Mech/Text

Report

Connectivity

System

About

Admin

Service

Dataflow

Additional Outputs

Tools

TCP/IP

Remote

DIACOM

Tricefy

Patient ID

Patient List

Disk Management

Other

10 Enable Tricefy

Enter your email address to register

mlgus@gs.com

Deactivate account

Account Info Account Active

mlgus@gs.com

Account Name: GE D45

Customer Name: General Electric

Account Status: Trial

Test connection

✓ Connection OK. Your device is connected to Tricefy.

1 Go to Additional Outputs to configure the P buttons for Send and Store Images with Tricefy cloud service

UplinkID:1e227c6d-eded-42e7-b8c6-390acc0192d4

Tricefy

Tricefy is the Ultrasound Cloud. Archive, collaborate and share images, clips and reports. Start a free trial by registering with your email address. Your device will be immediately cloud-enabled giving you an offsite secure image archive, a zero-footprint DICOM viewer and all the sharing and collaboration features in Tricefy.

Visit Tricefy Imaging online
info@tricefyimaging.com

Customer Support
www.tricefyimaging.com





Mobile UI





Tablet UI


Модуль программный для оптимизации и обработки медицинских ультразвуковых изображений - не более 10 шт.

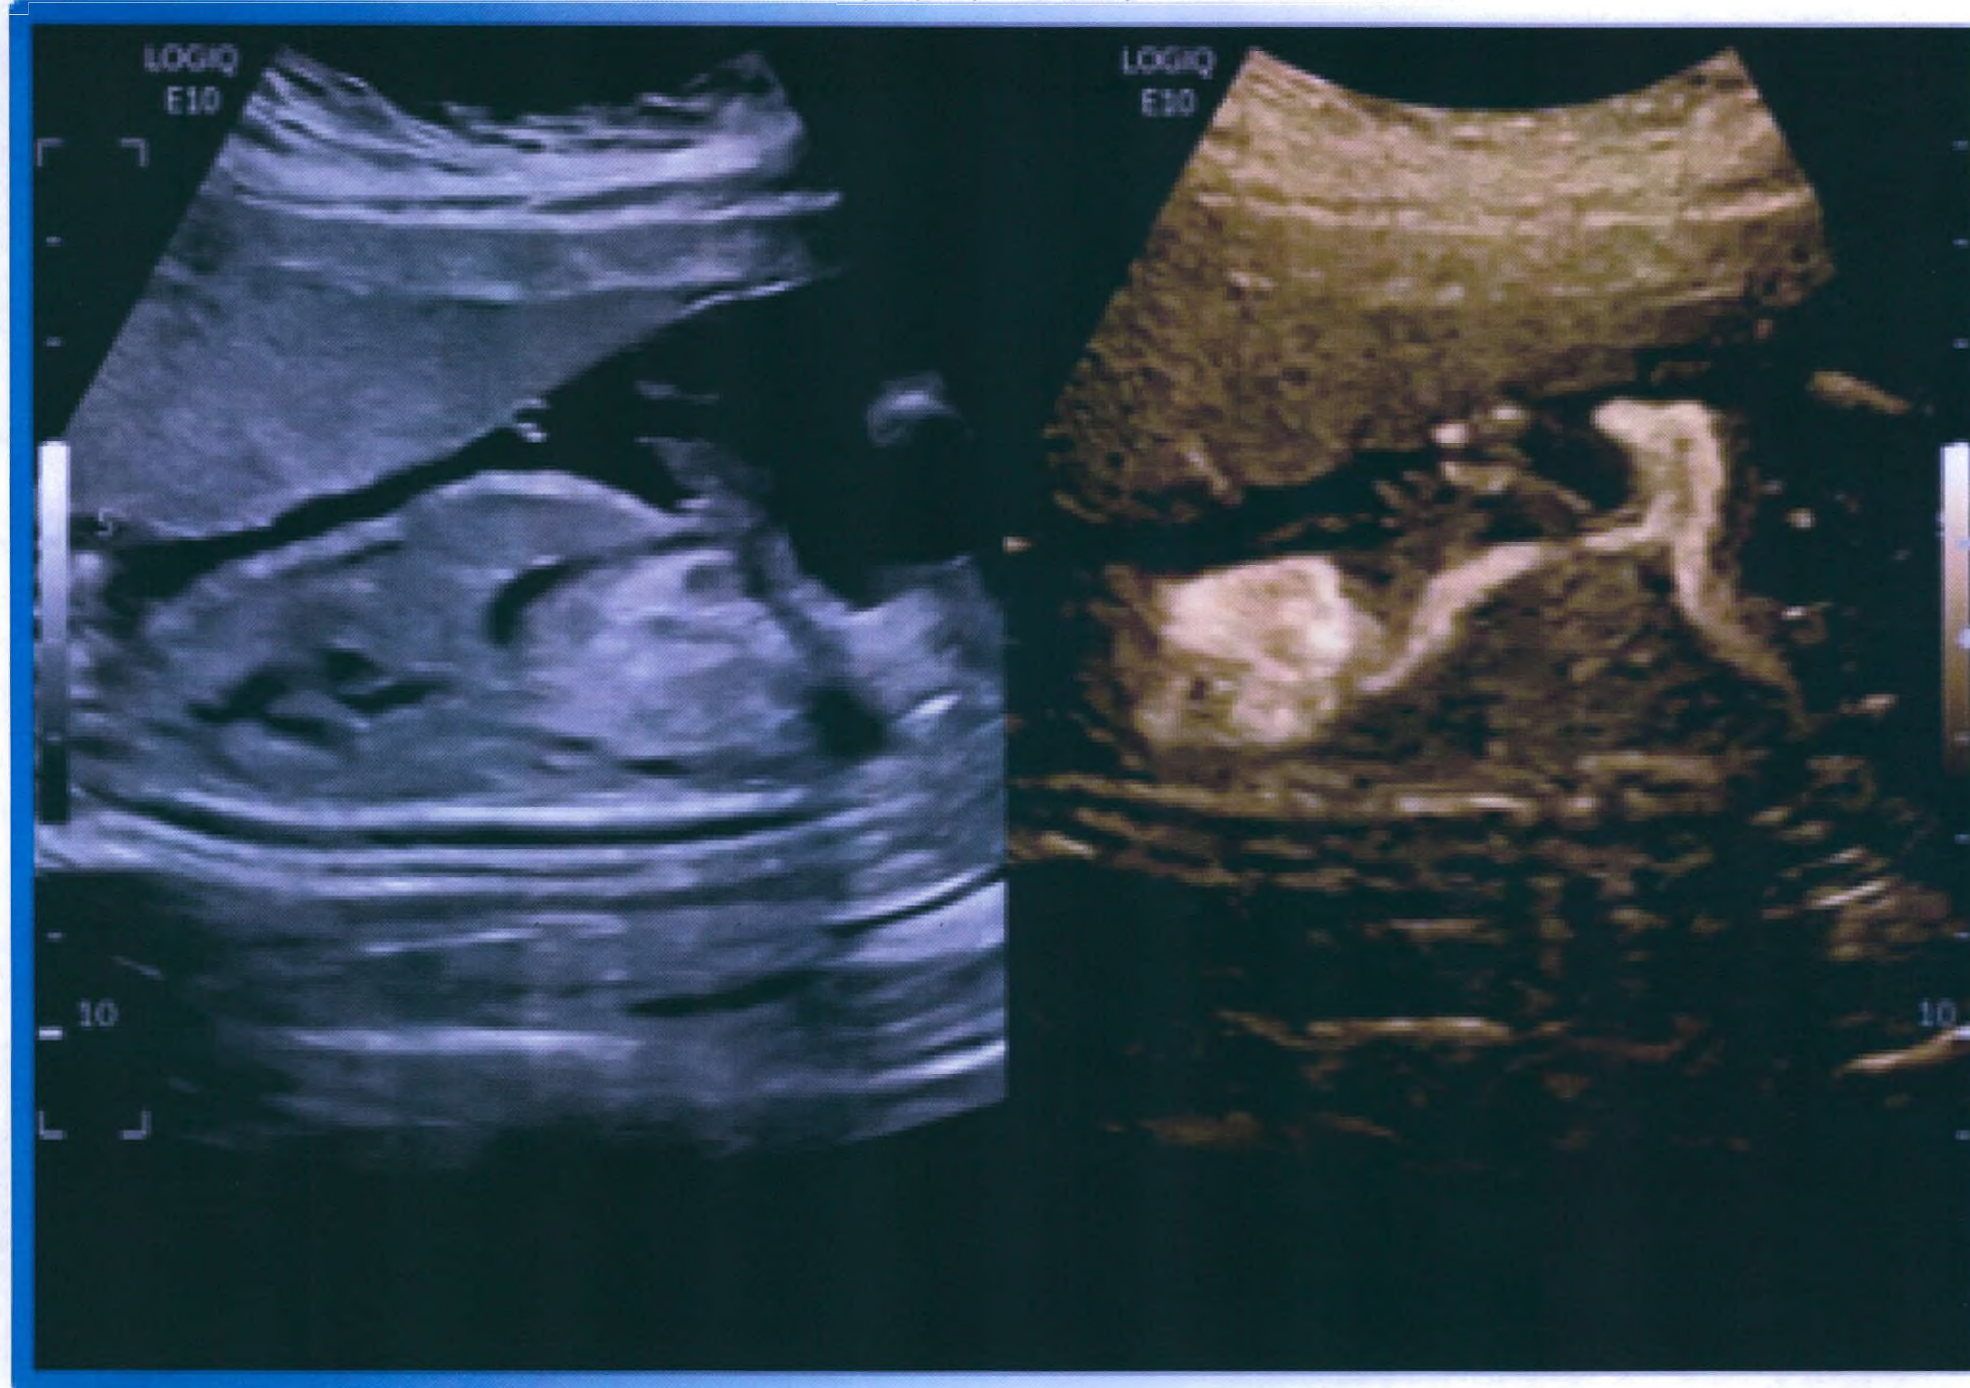


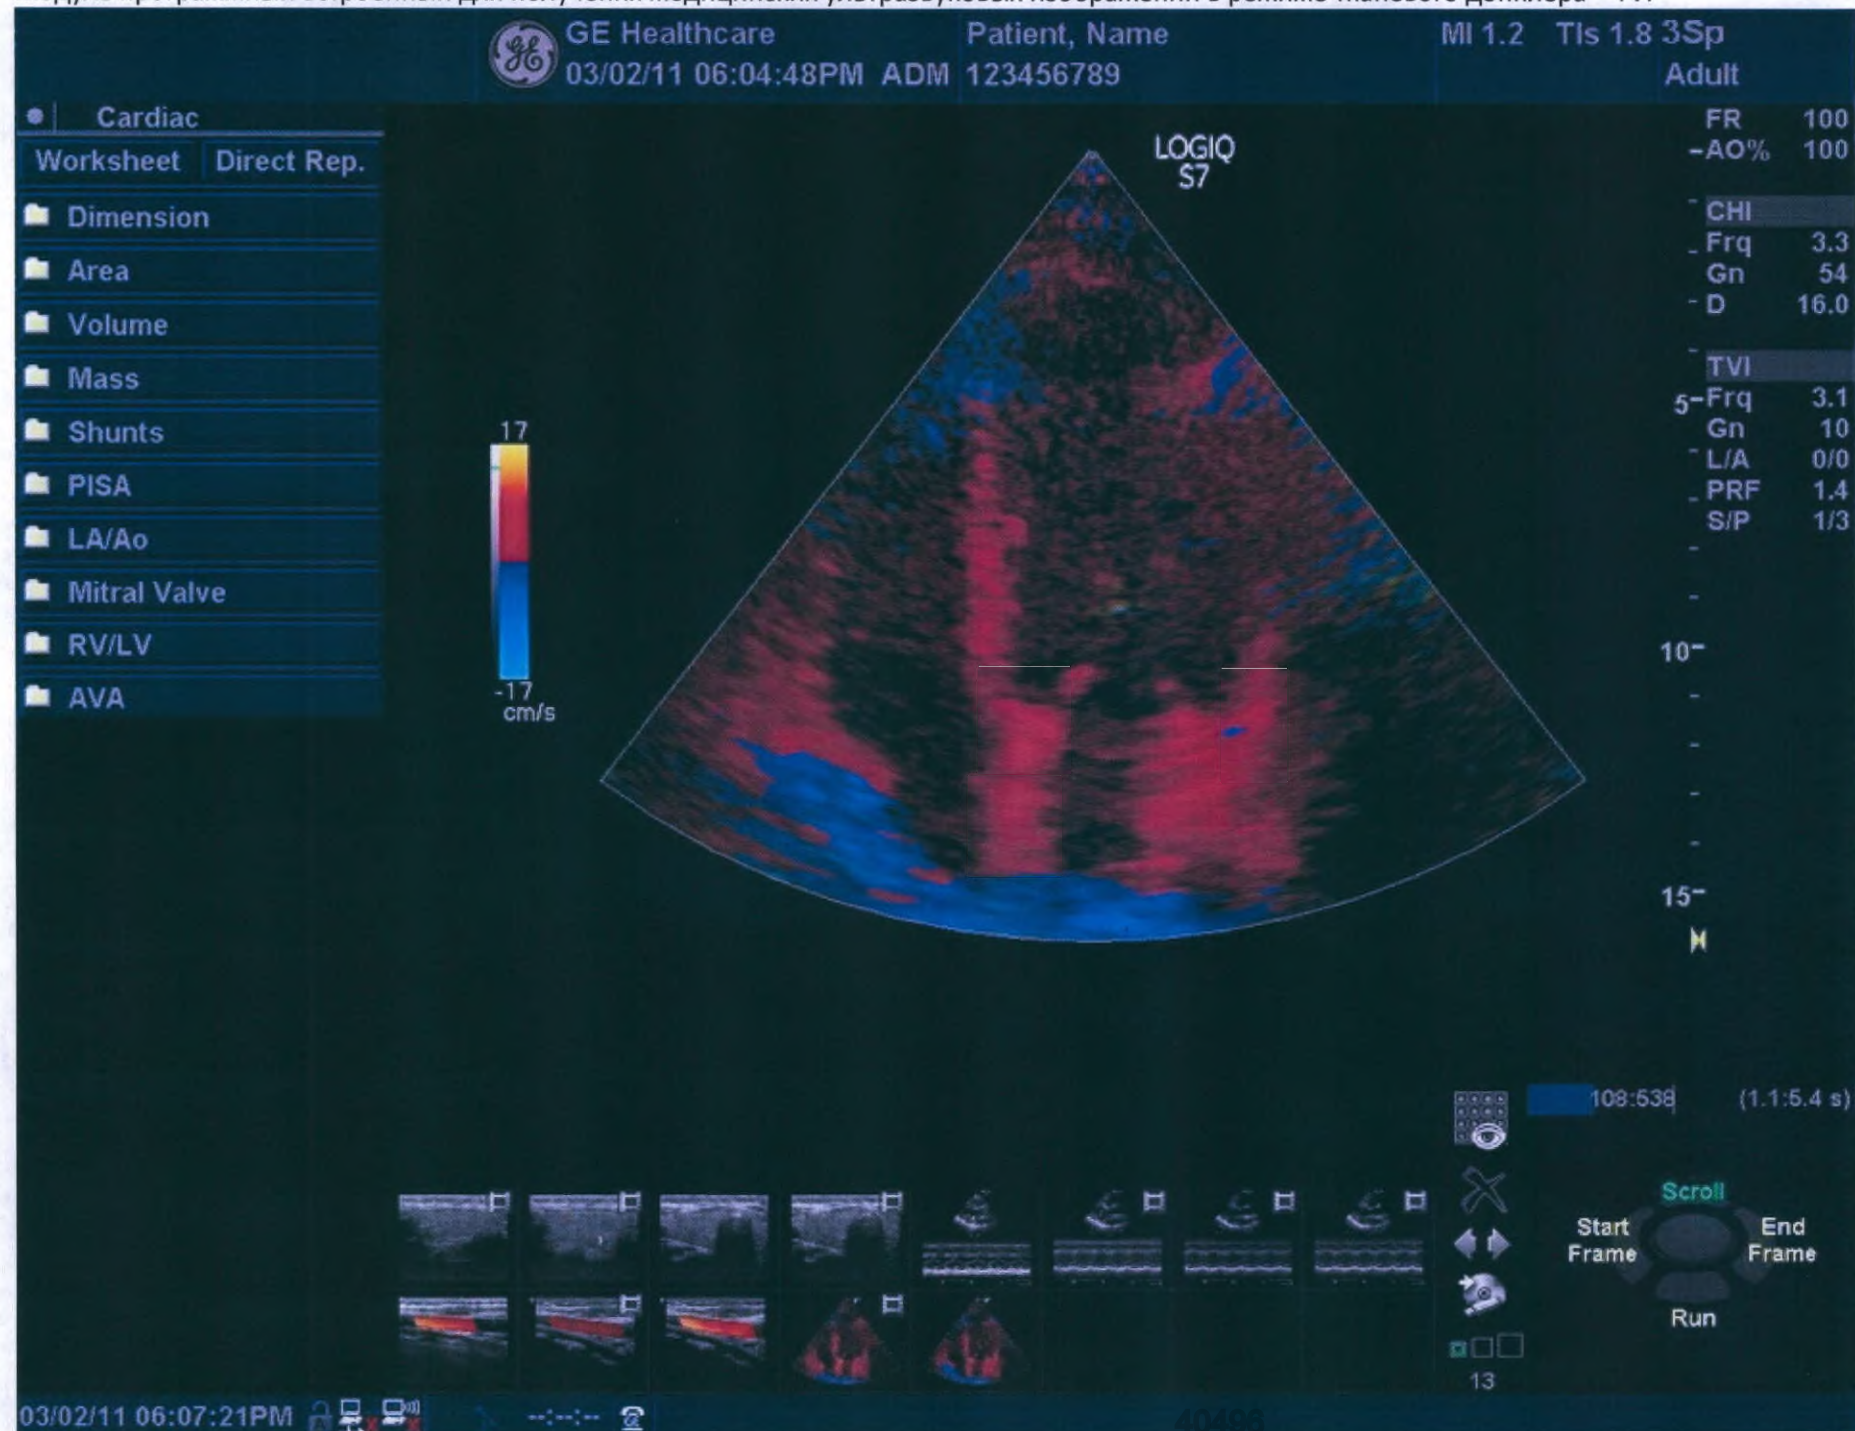


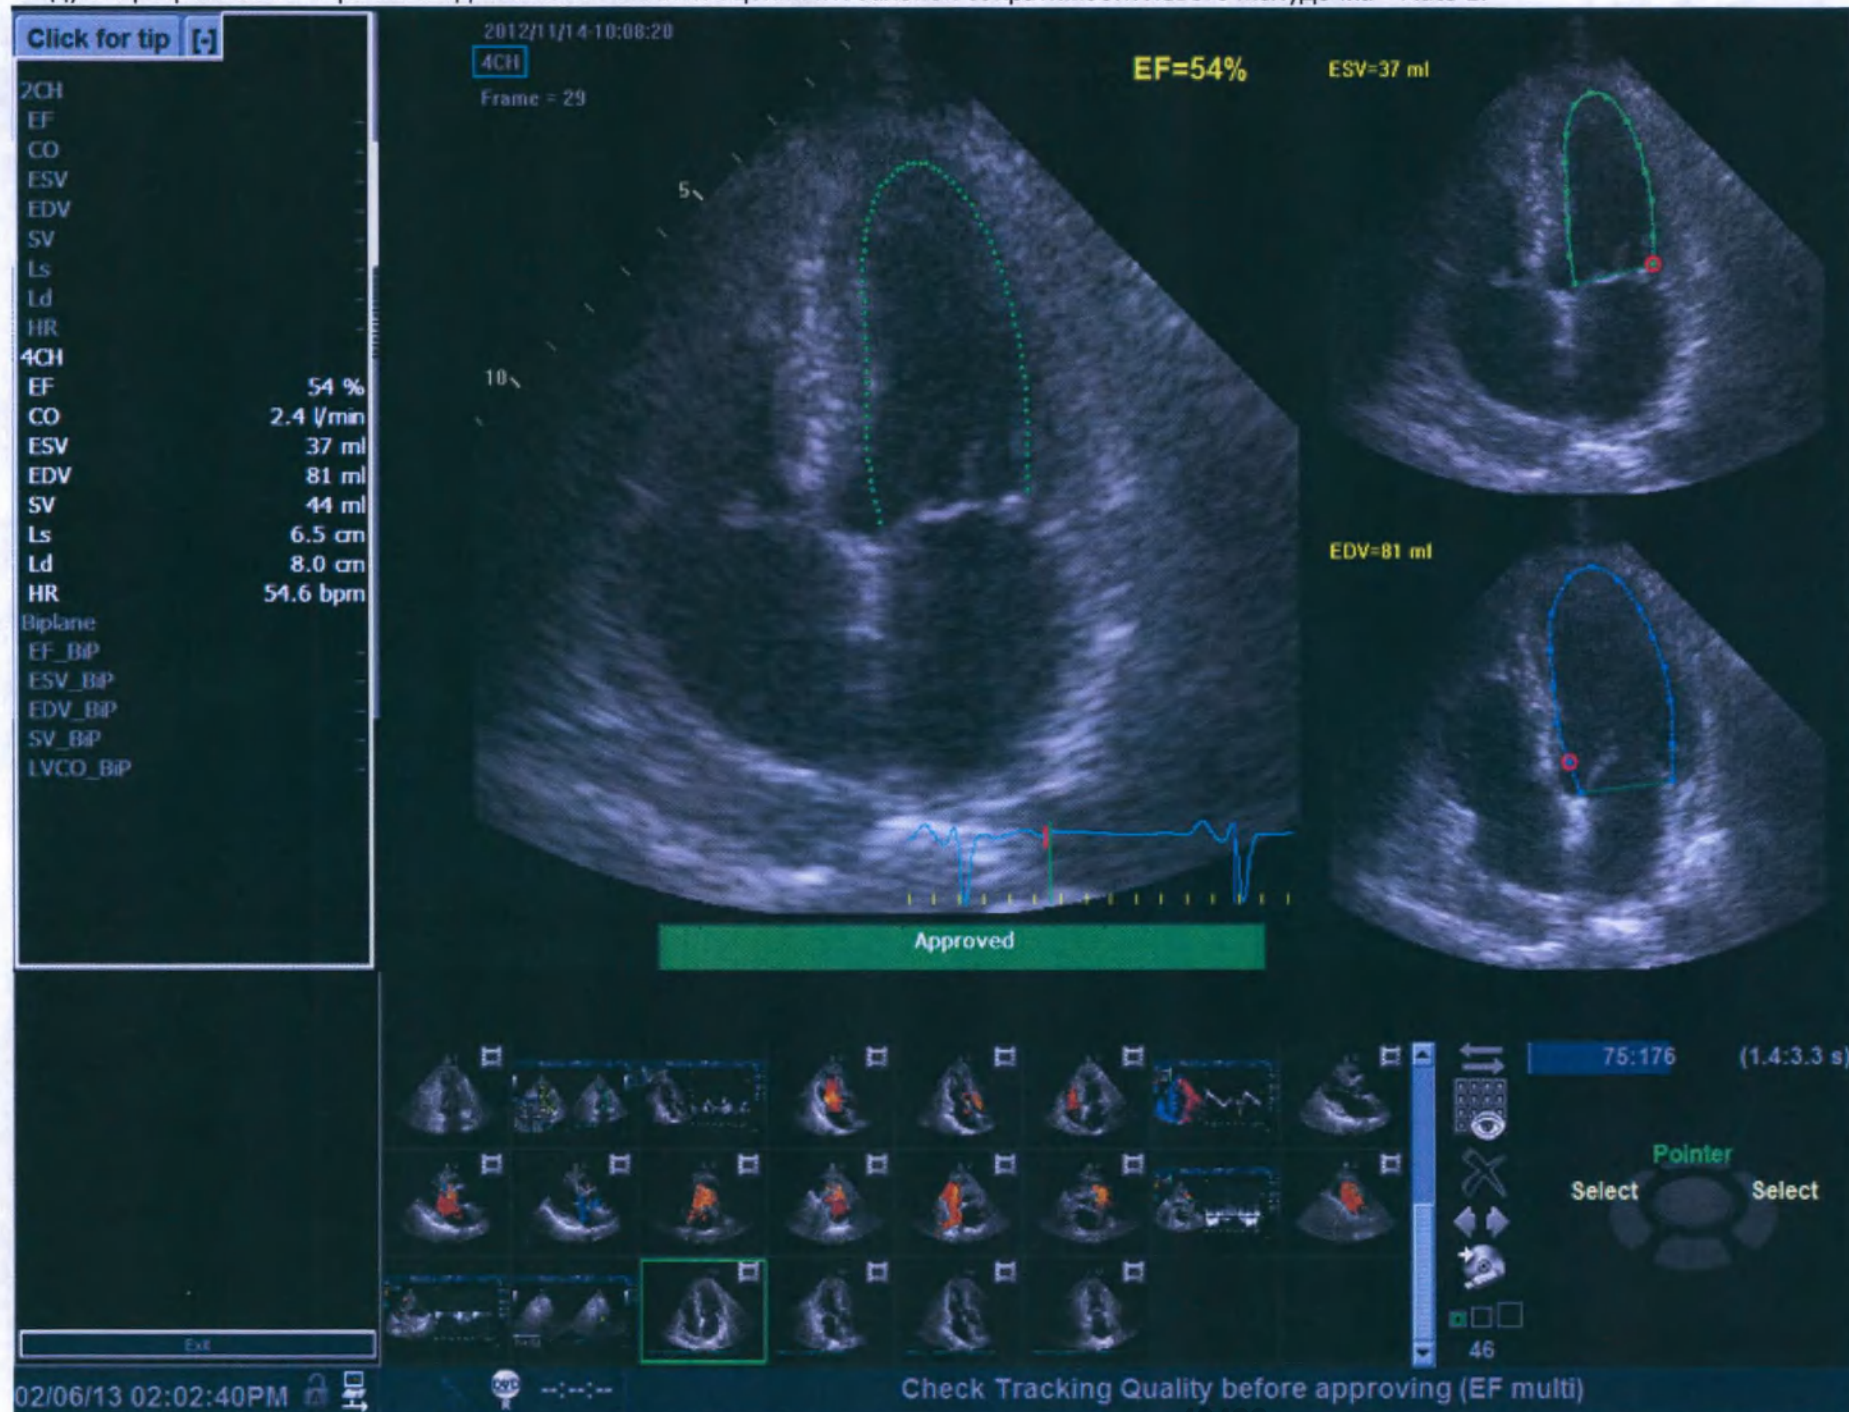

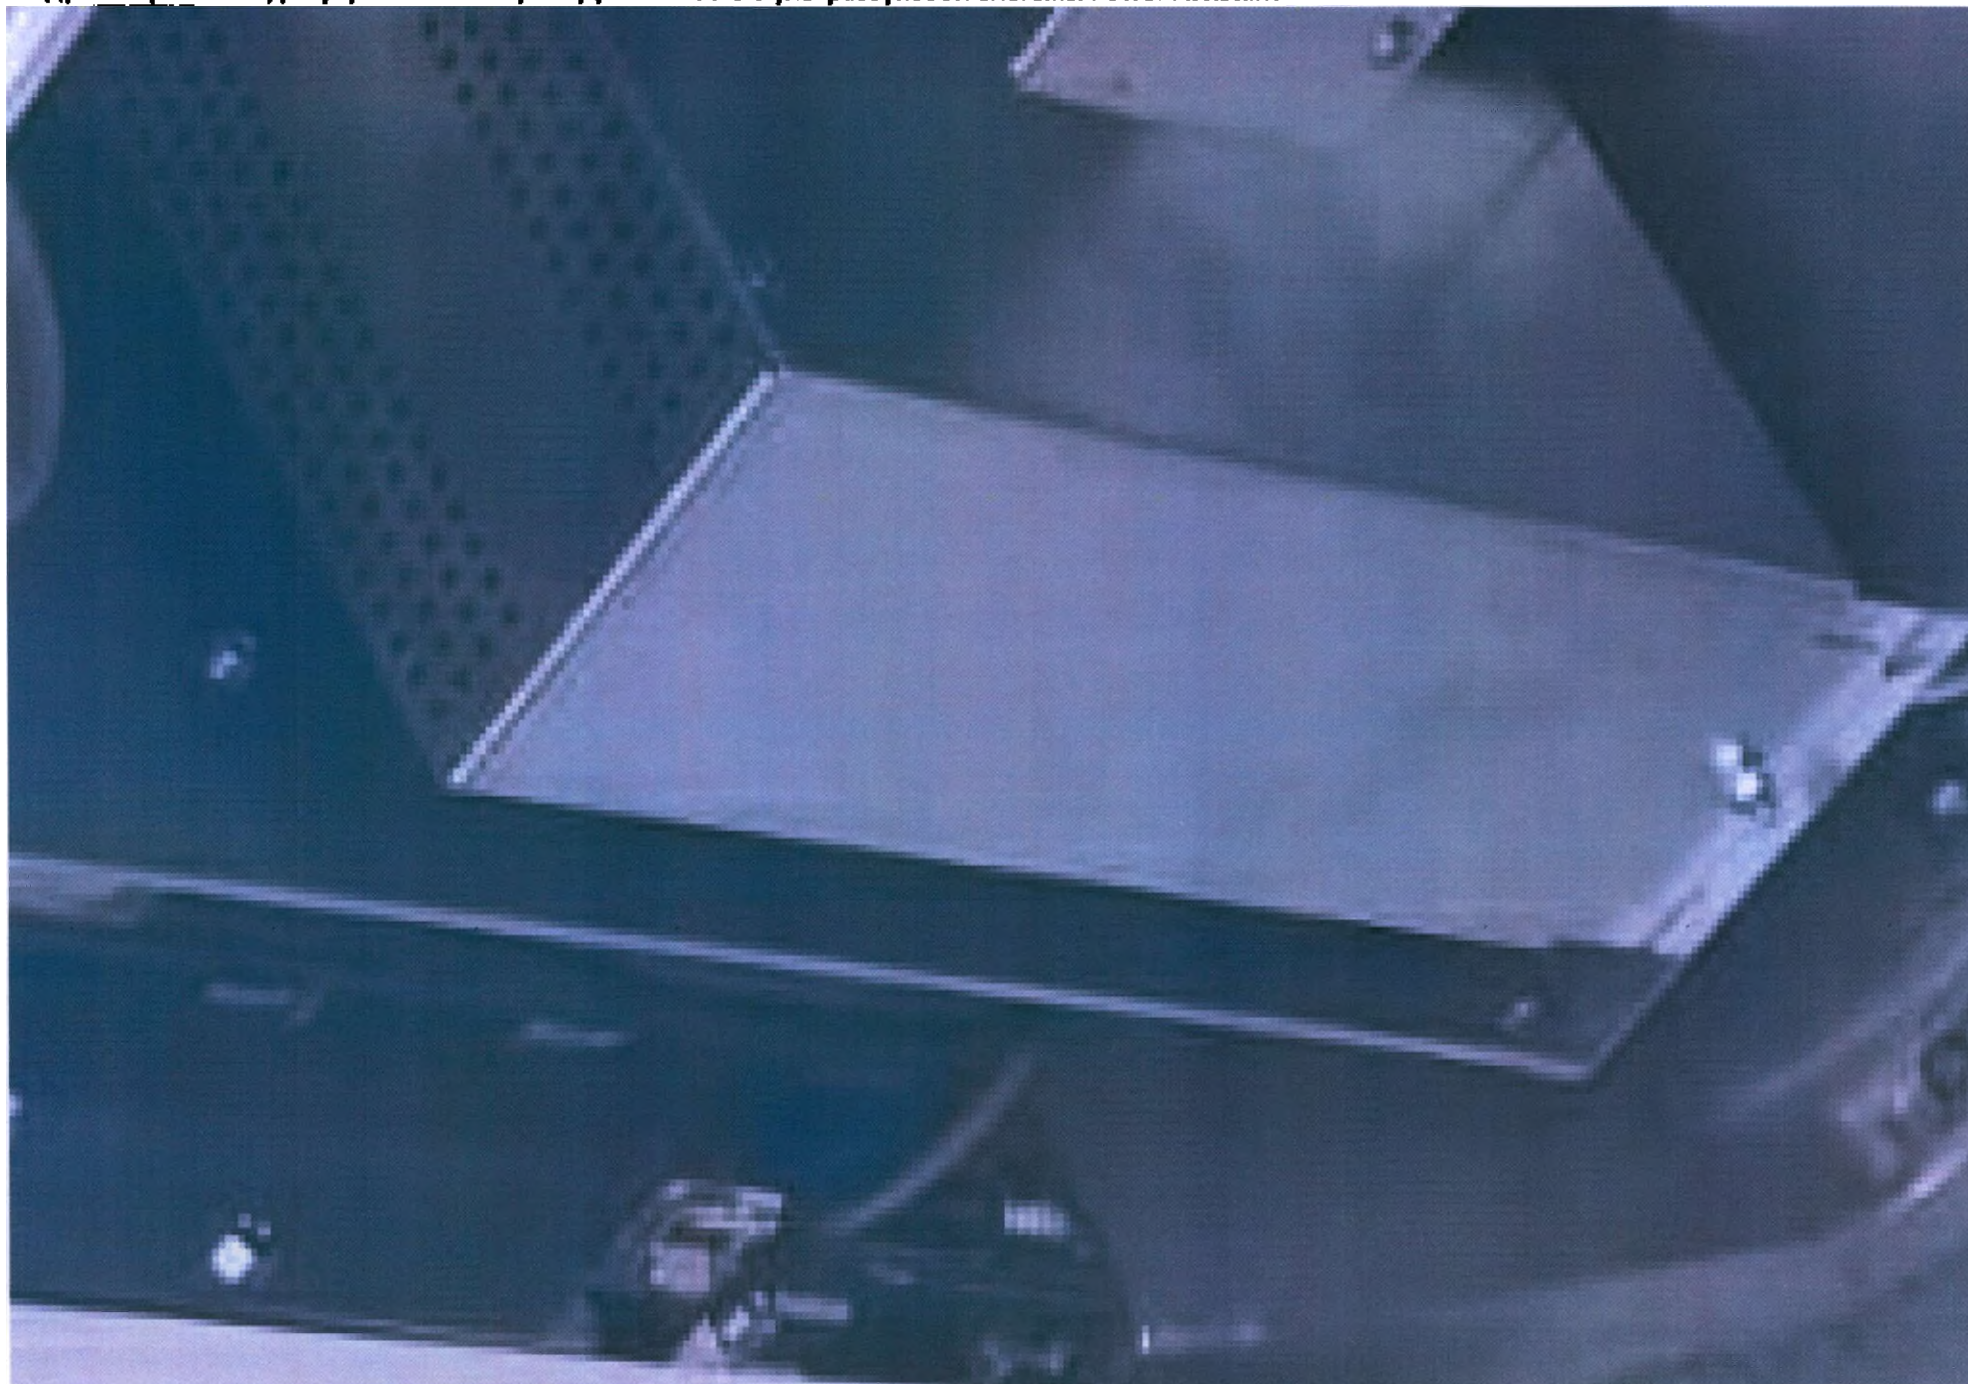

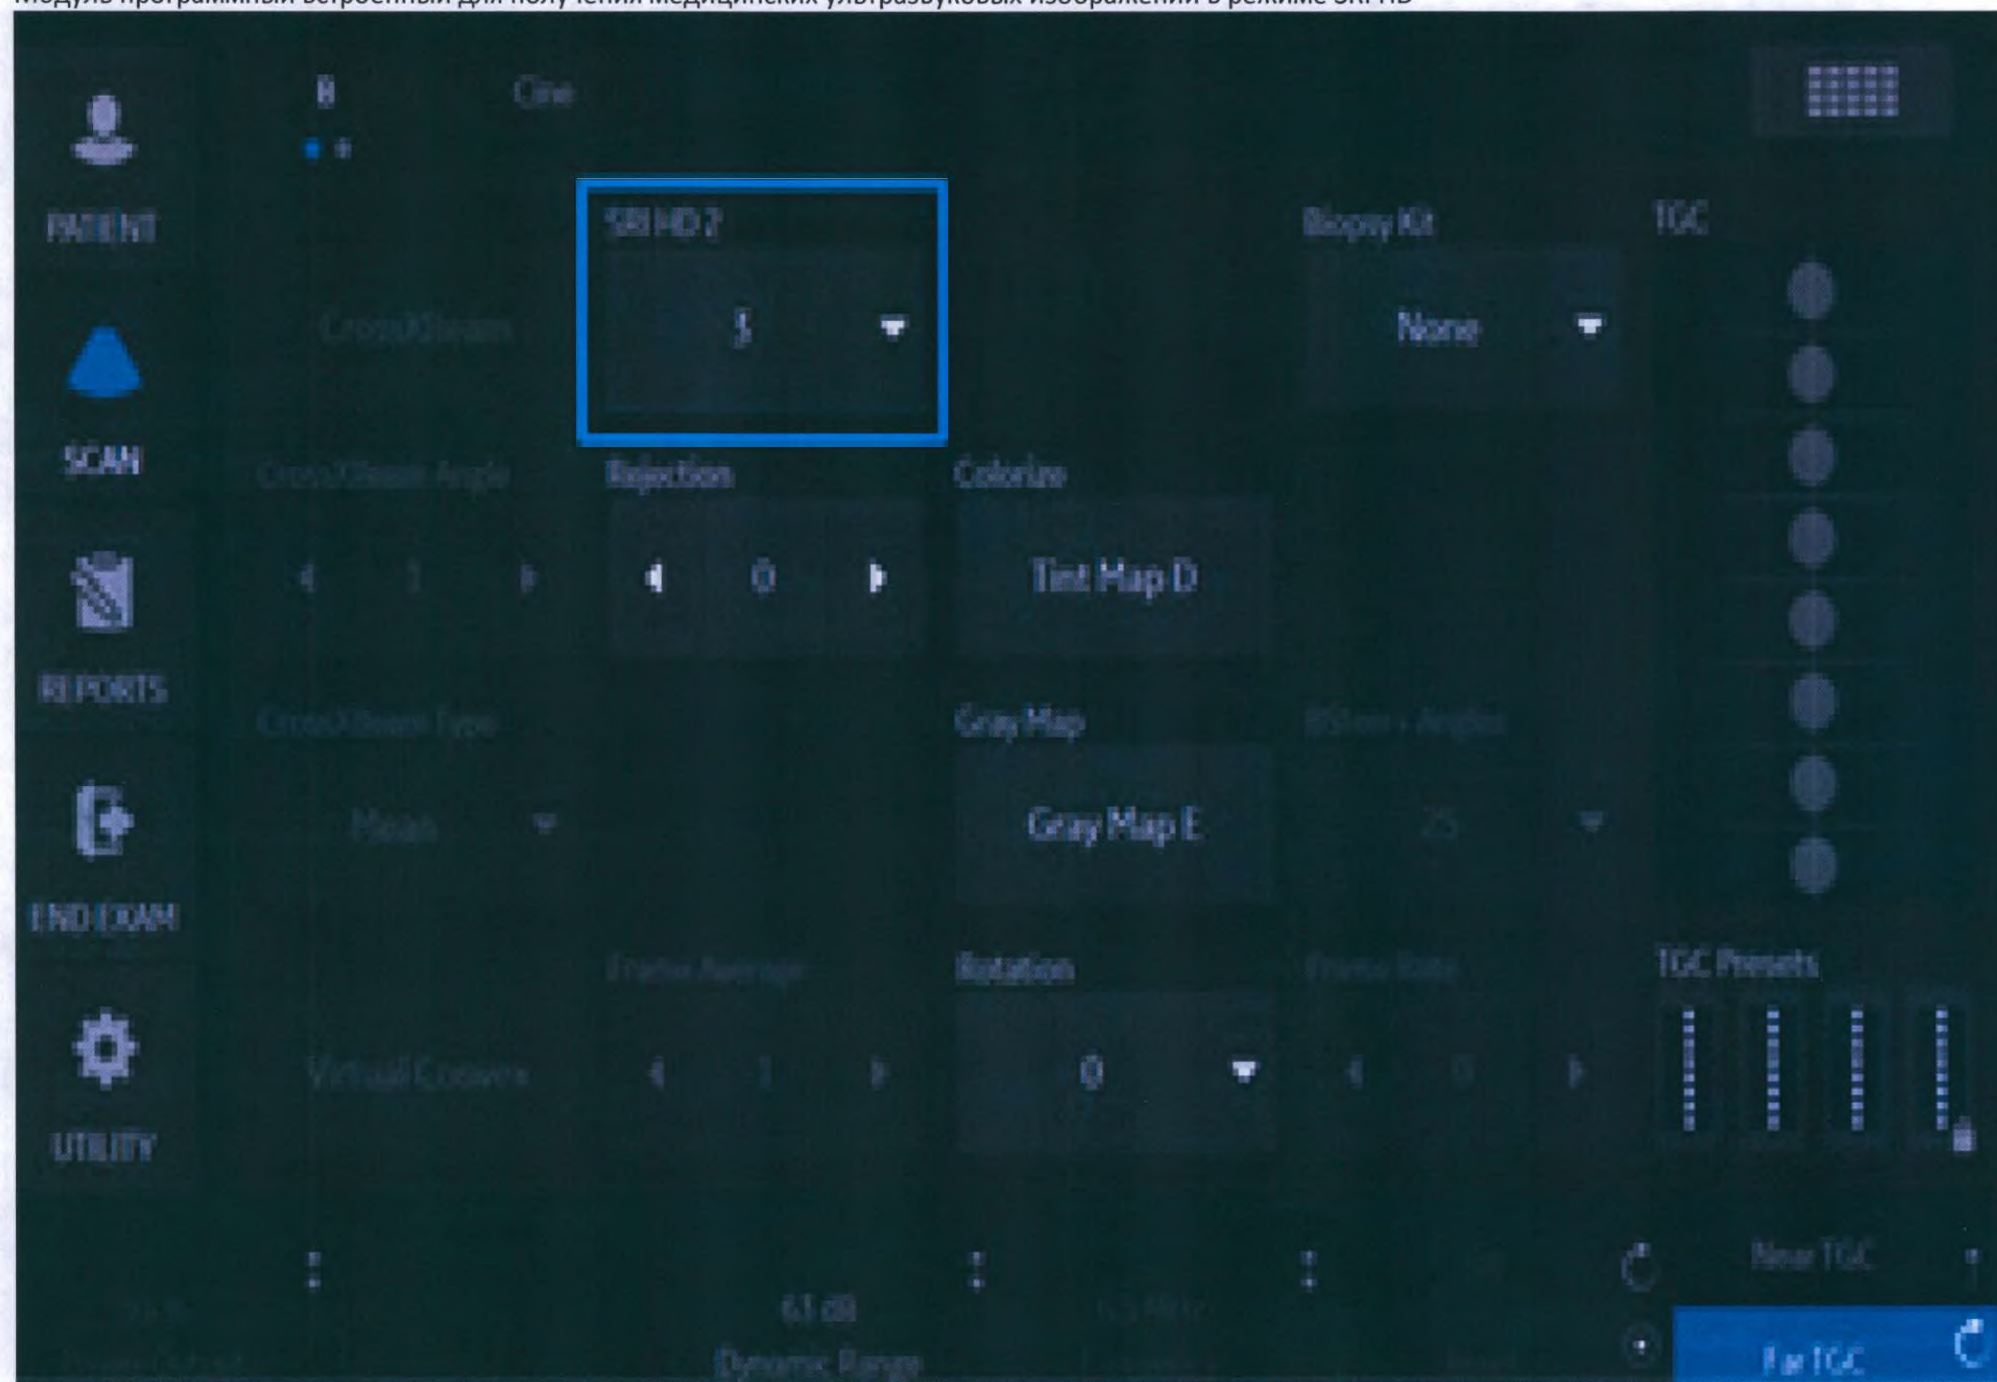

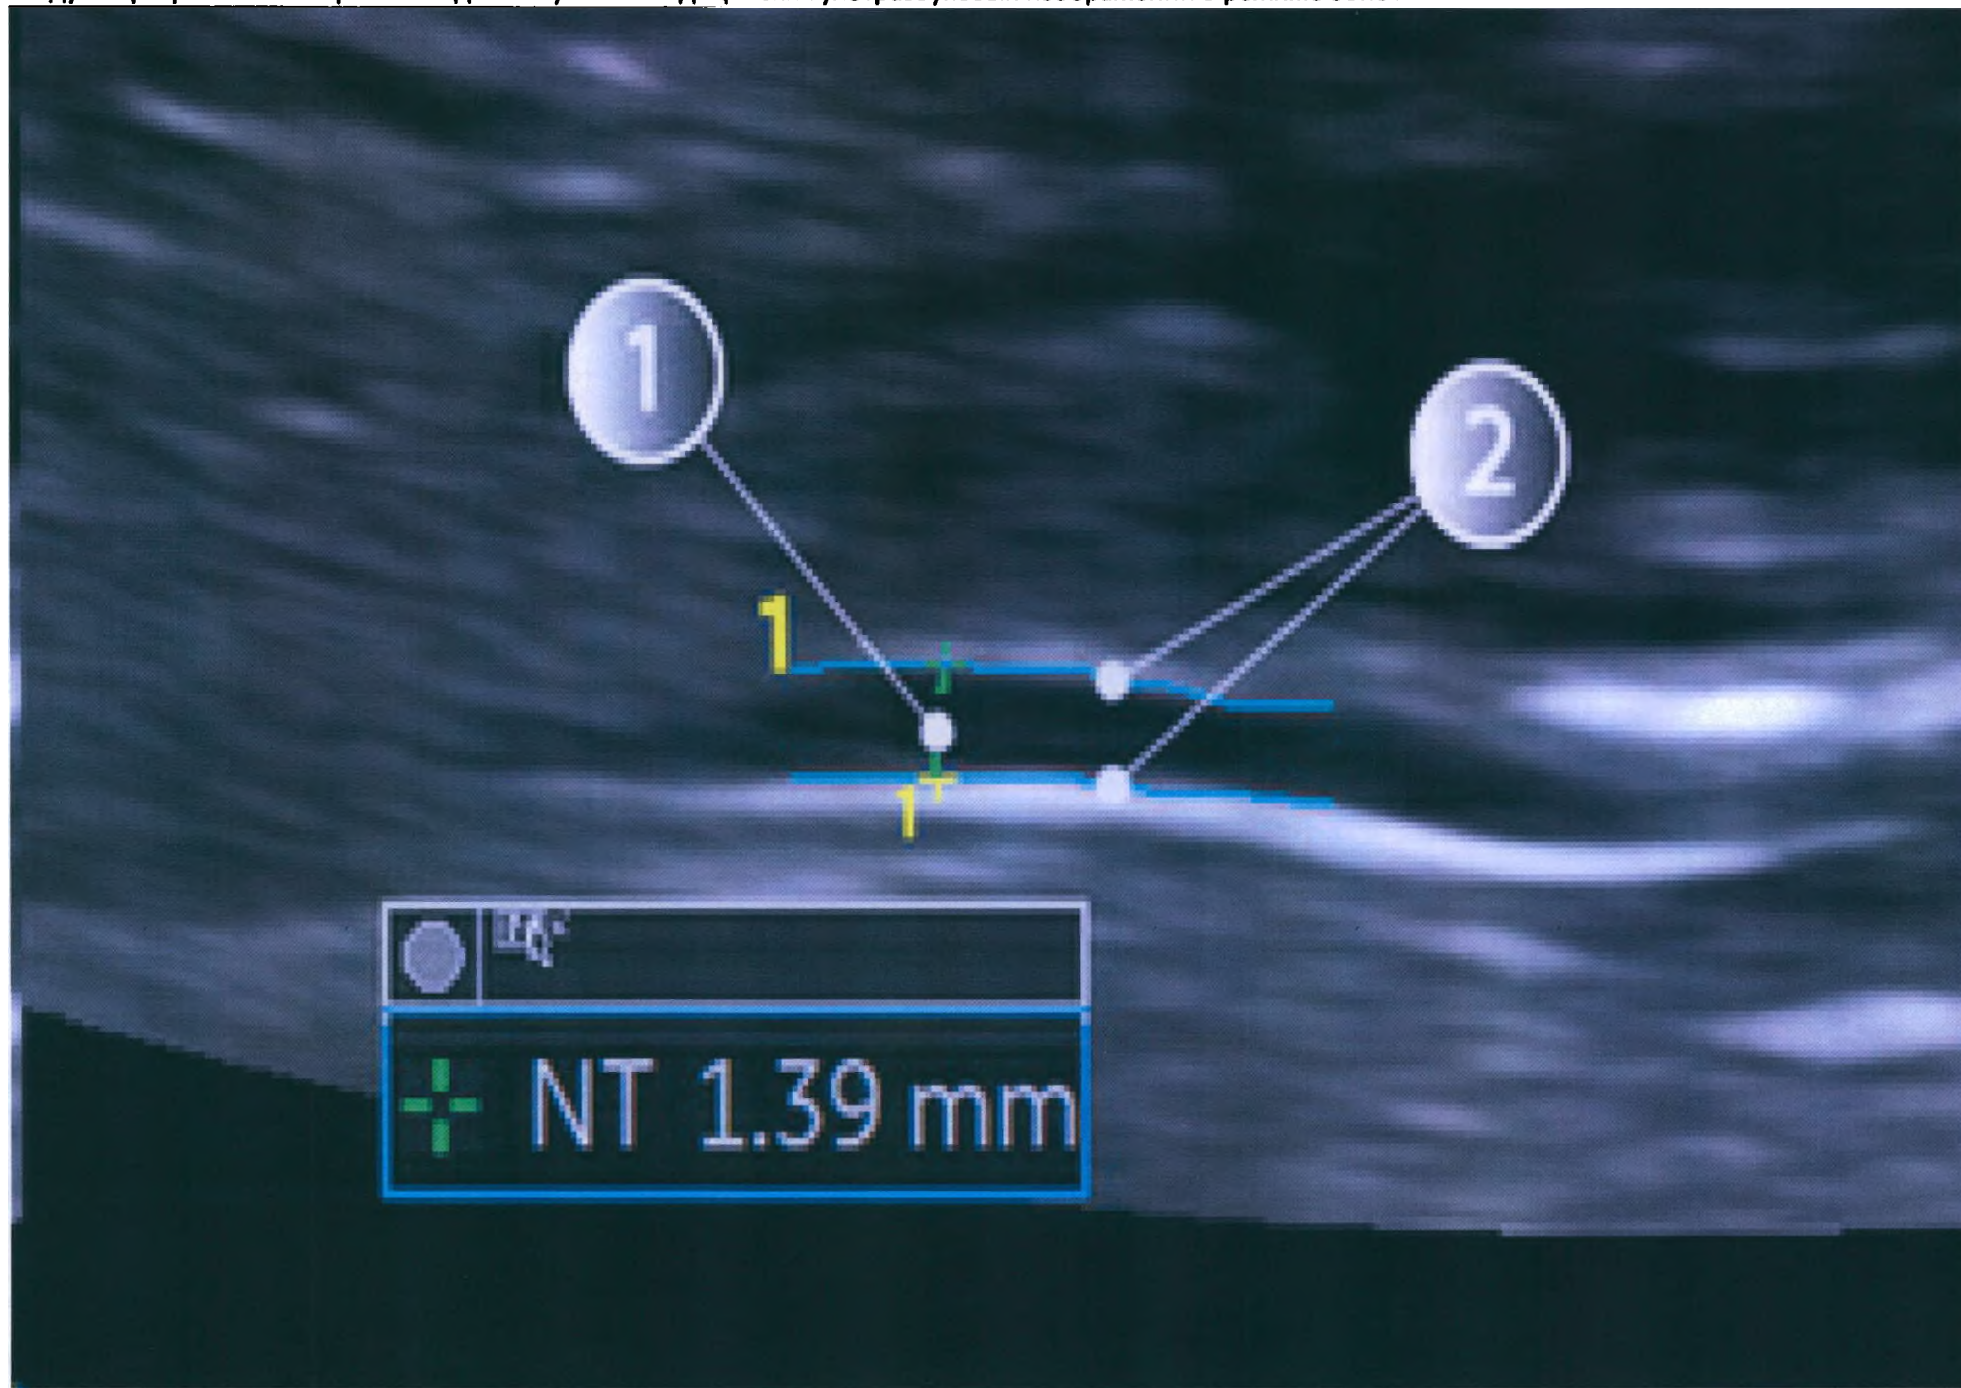

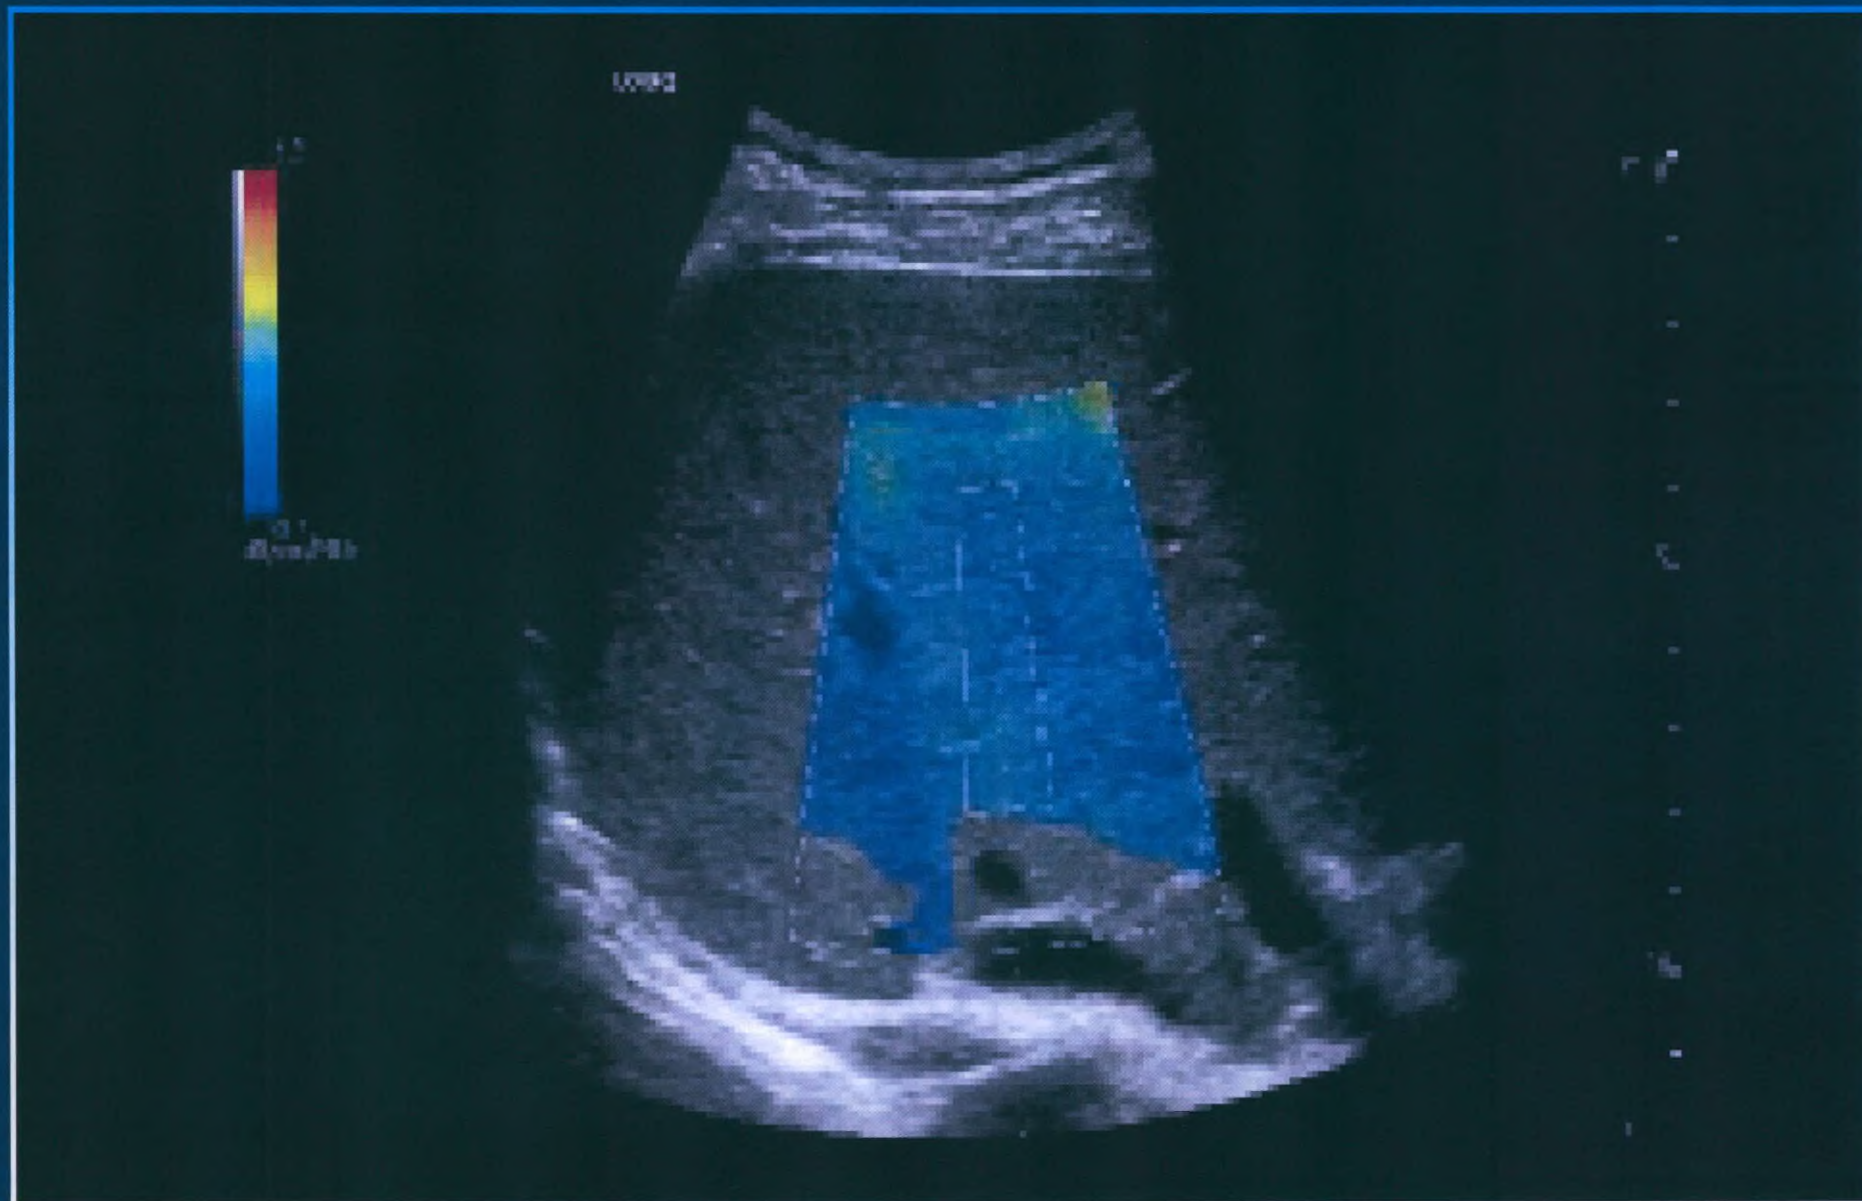


Liver UGAP, C1-6-D




Ножной переключатель – Footswitch




Устройство, обеспечивающее регистрацию физиологических сигналов

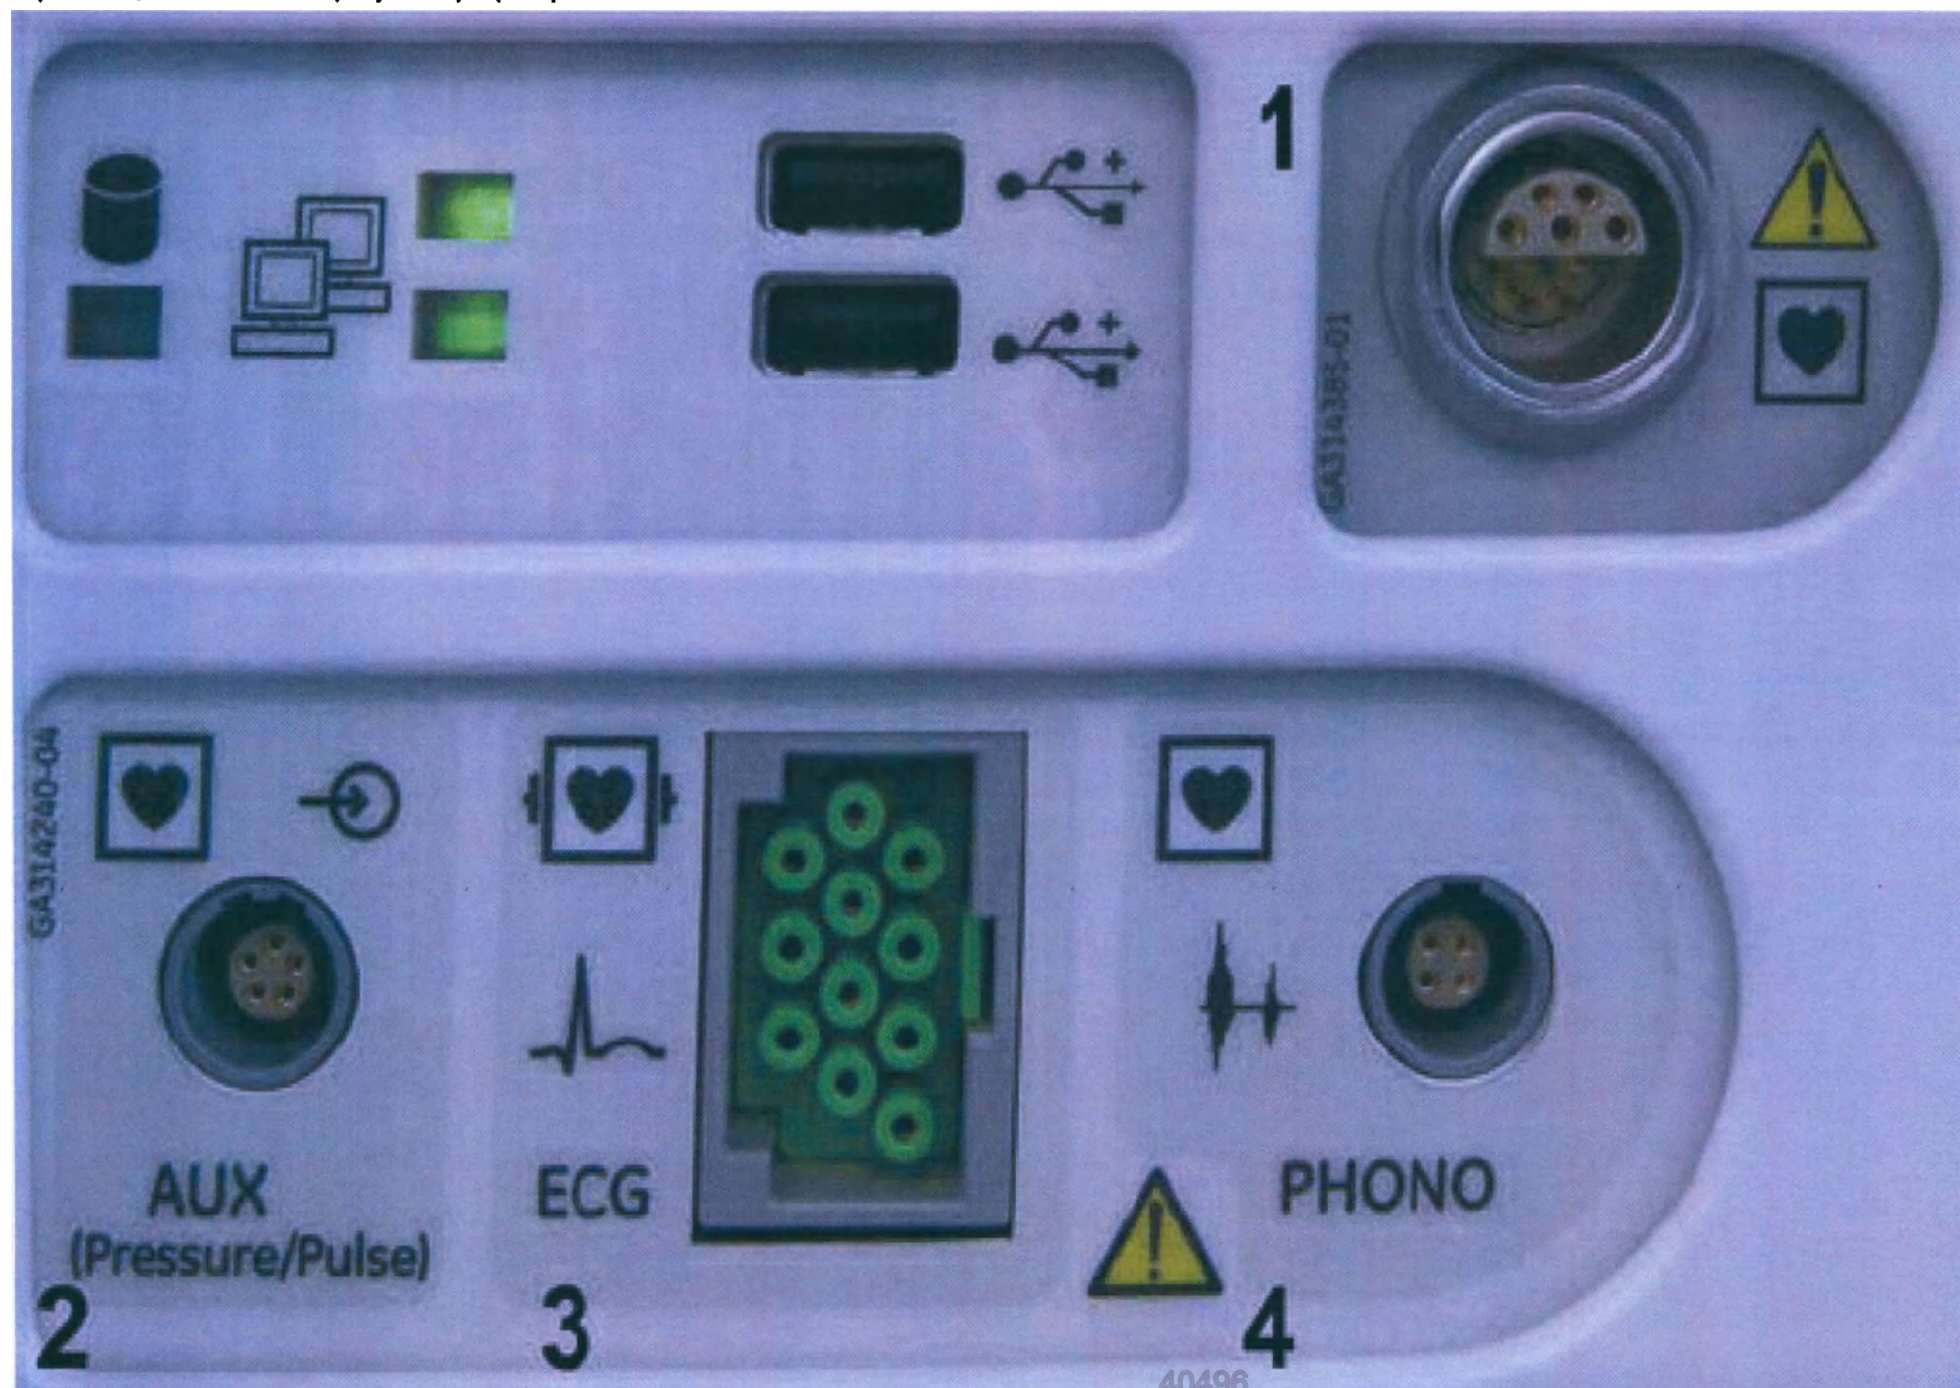

Устройство цифровое видеозаписывающее DVR в комплекте с кабелями для подключения

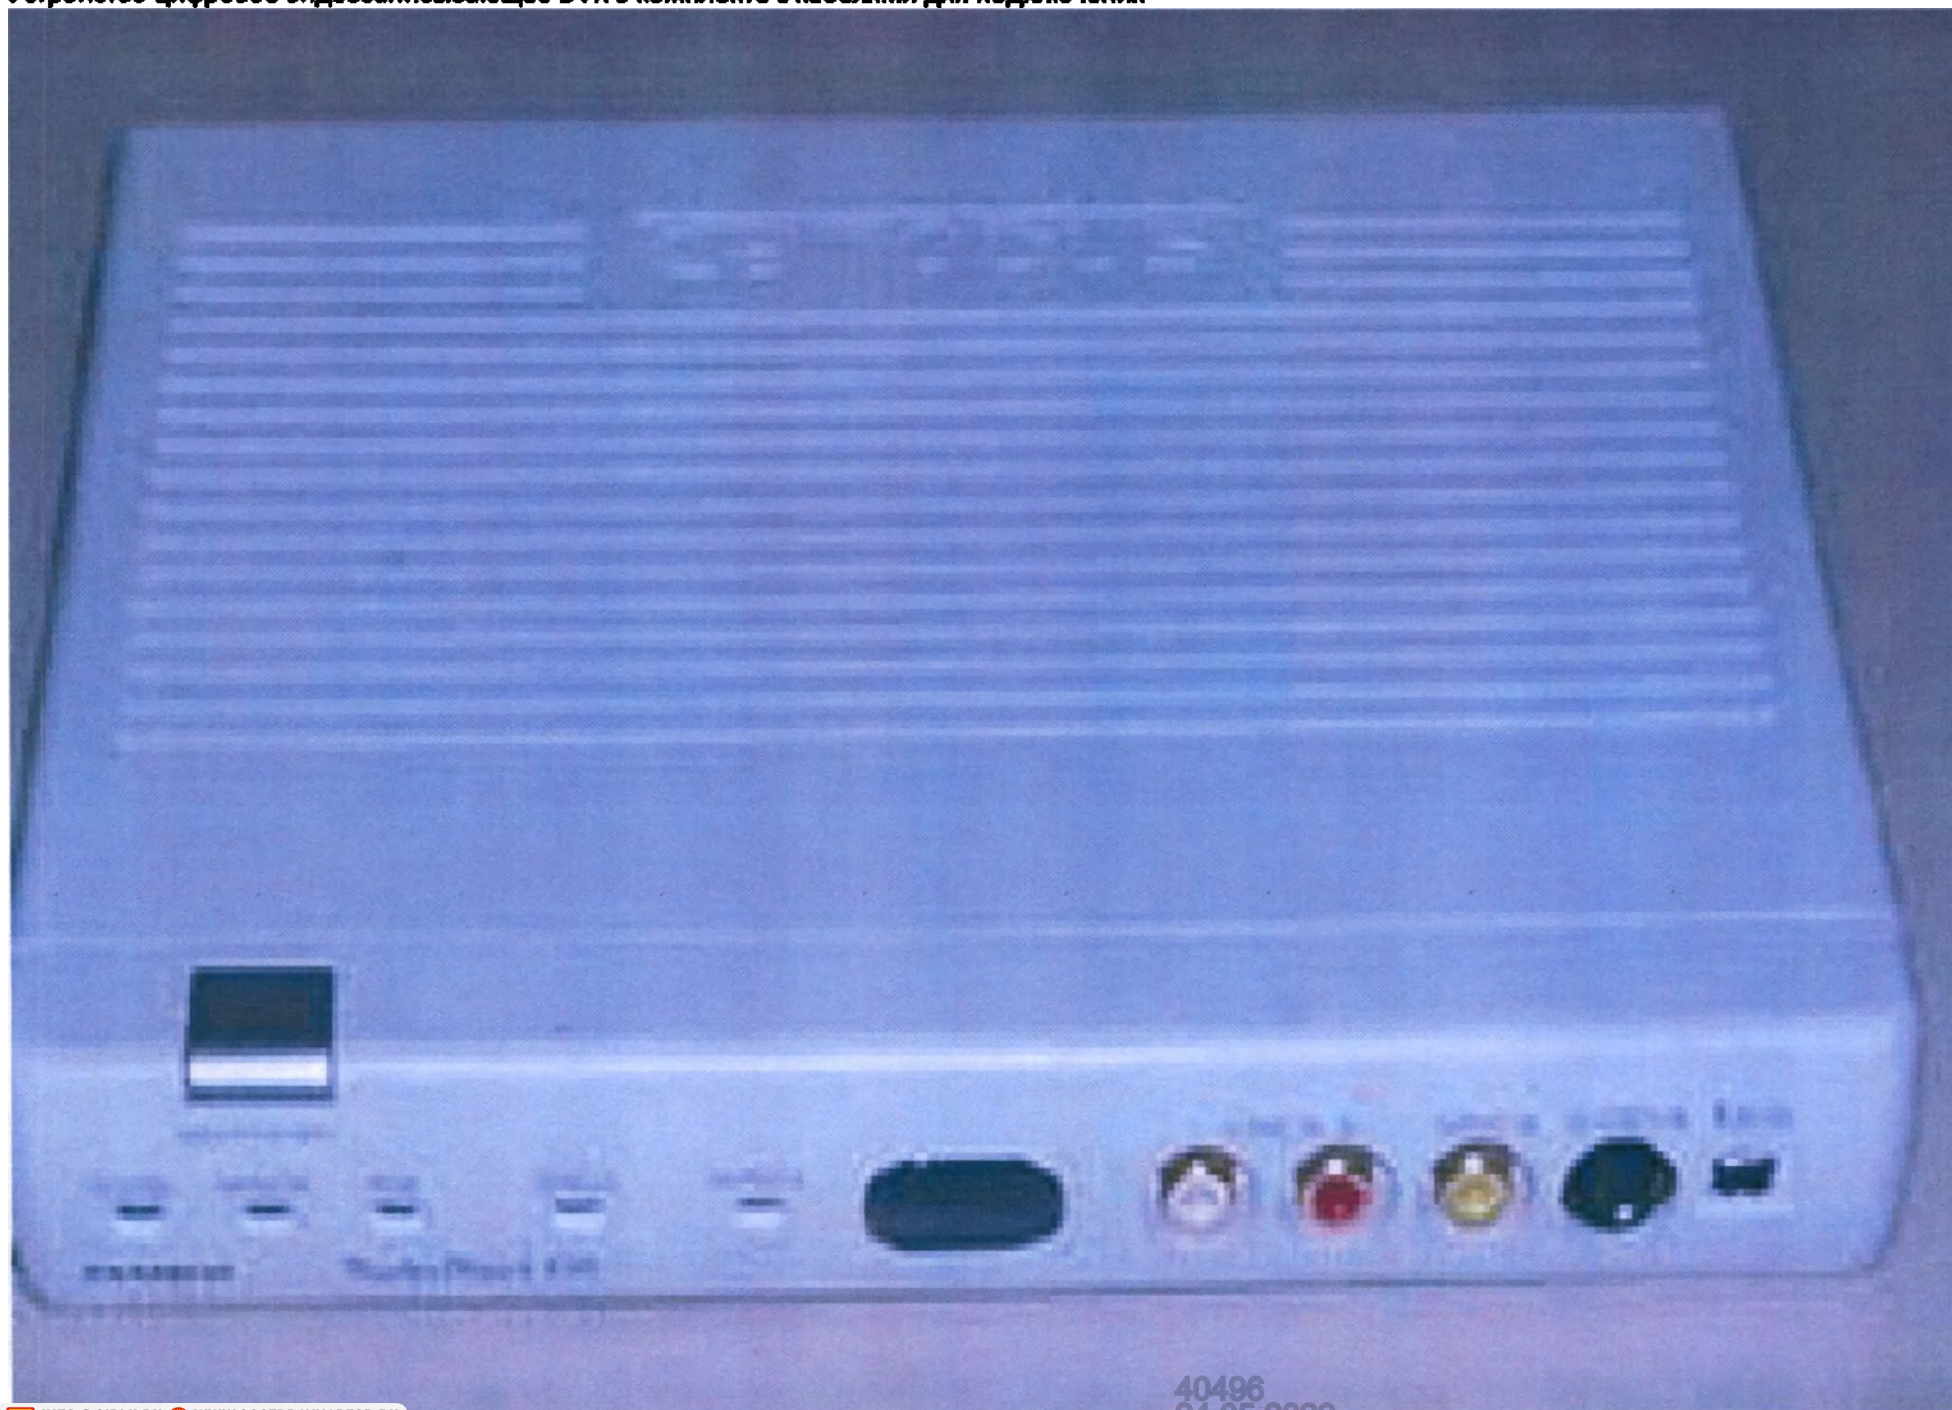

Устройство для печати черно-белых медицинских ультразвуковых изображений с комплектом для подключения

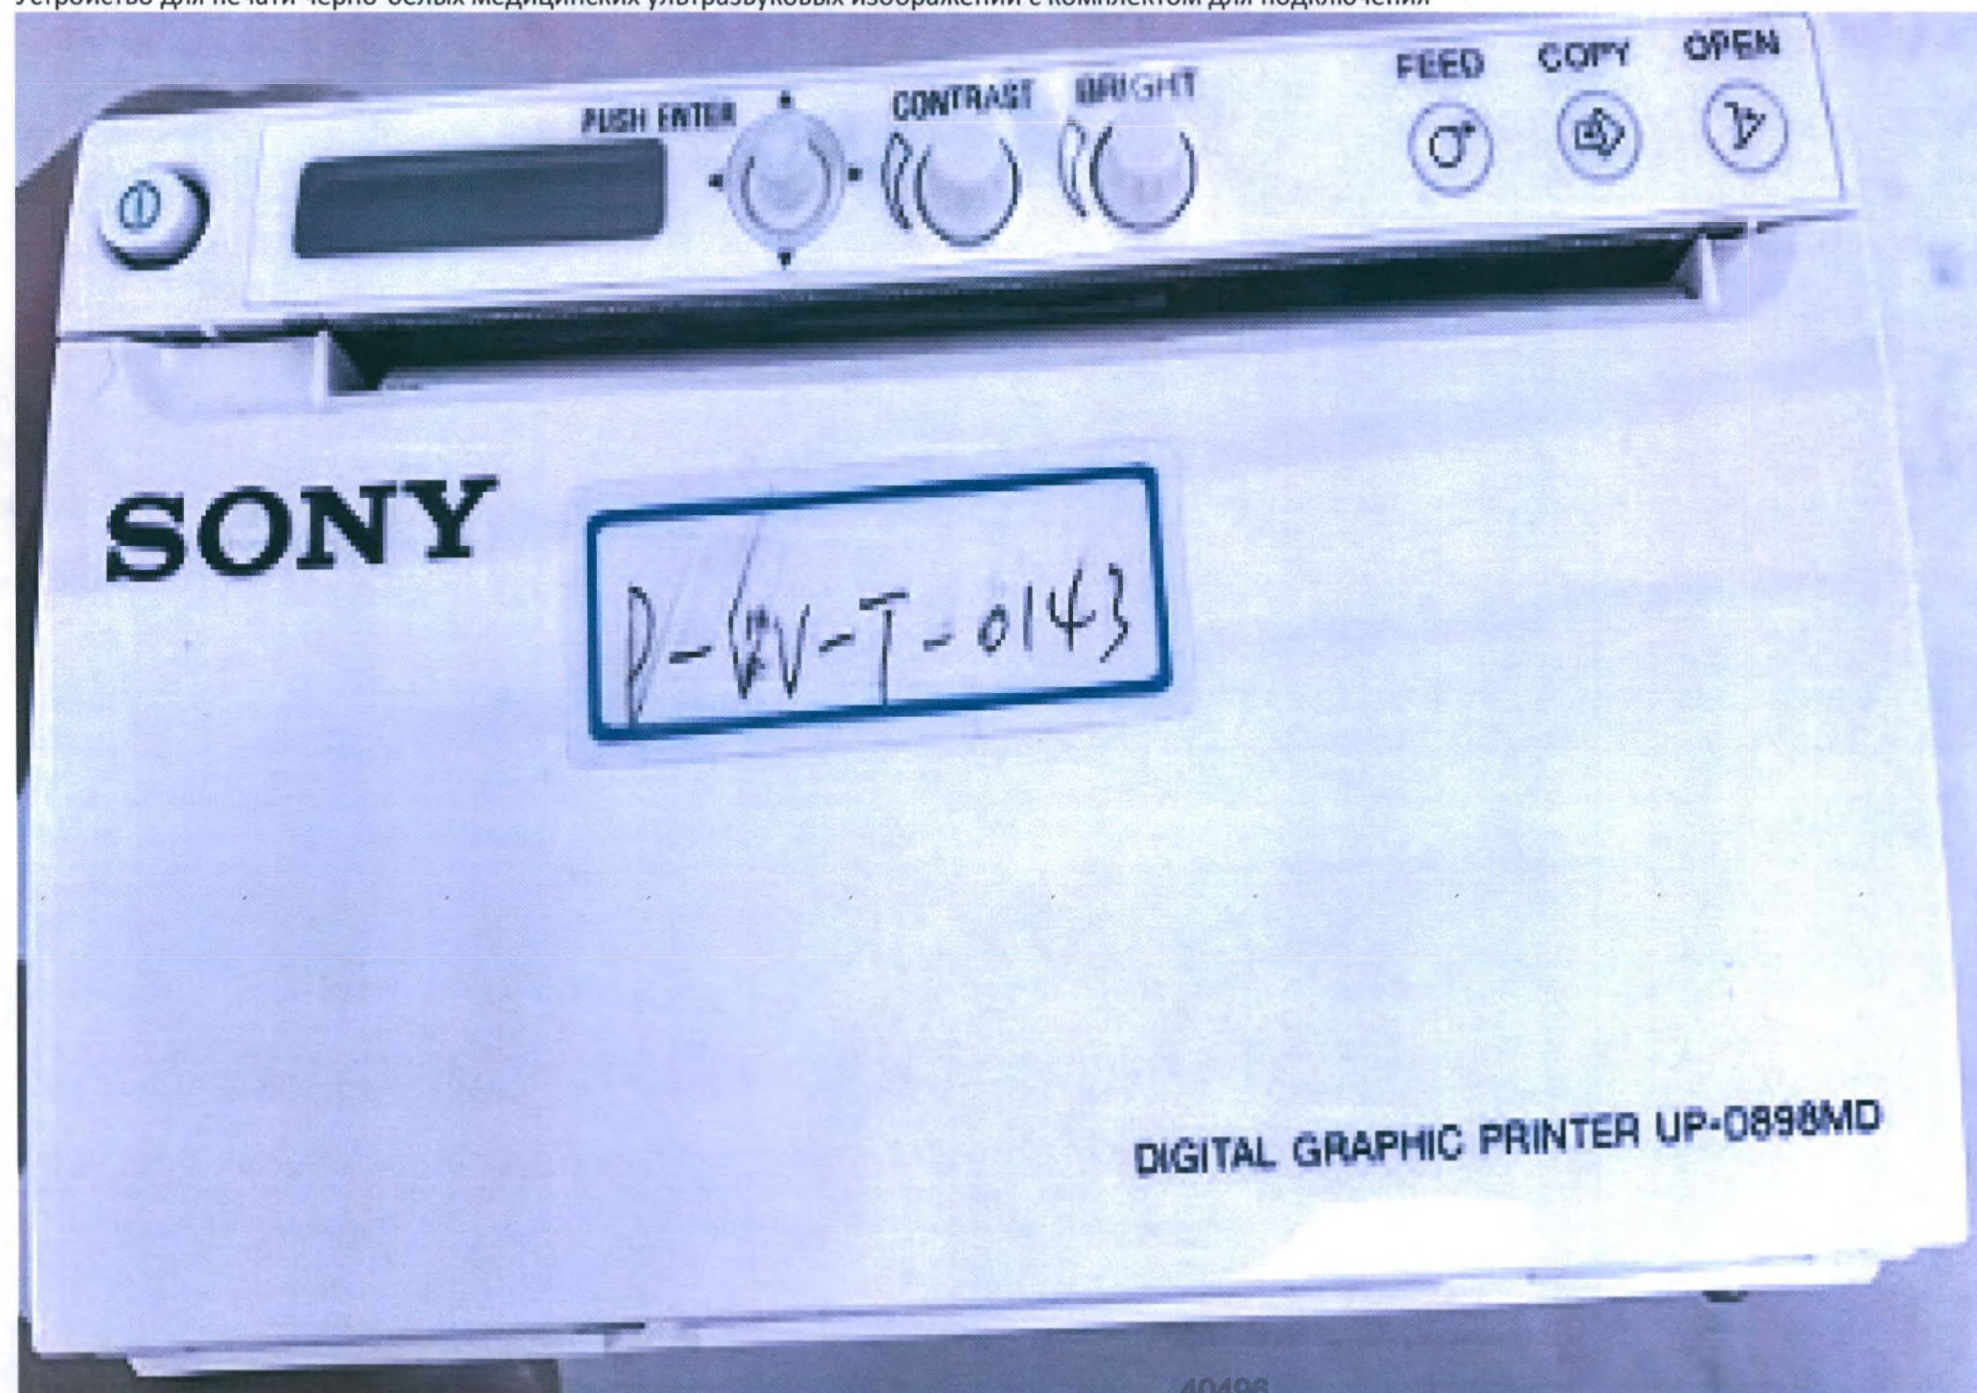


Комплект для крепежа устройства для печати ультразвуковых изображений - не более 5 шт.



Бумага для устройства для печати черно-белых медицинских ультразвуковых изображений - не более 50 шт.



Дополнительный внешний специальный монитор для системы ультразвуковой диагностической - не более 2 шт.

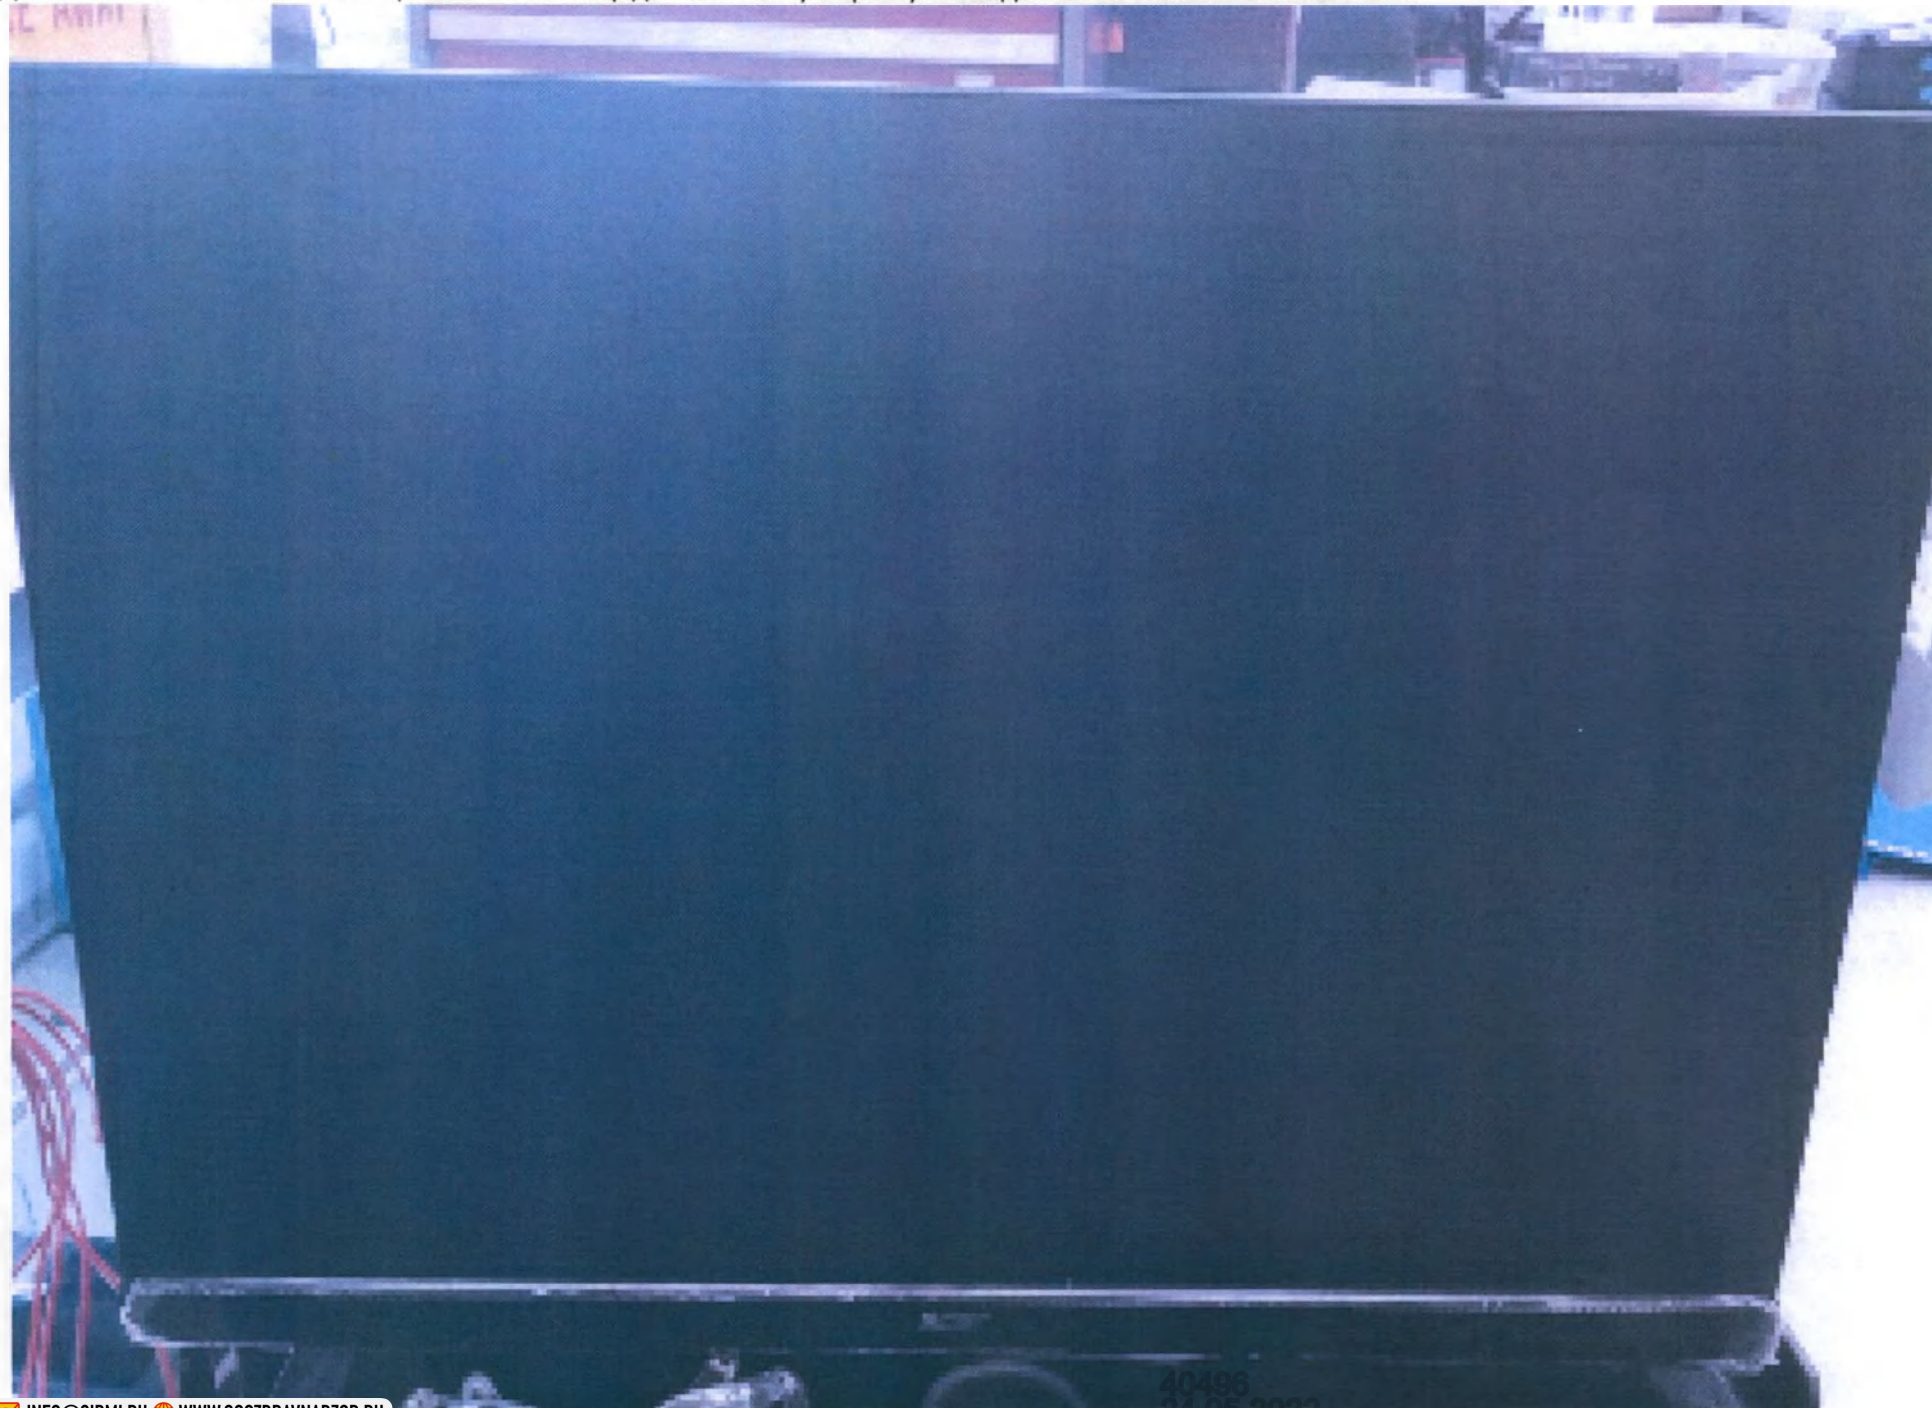

Держатель для микроконвексных и внутриполостных датчиков




Большая корзина для хранения аксессуаров



Двойная корзина для хранения аксессуаров



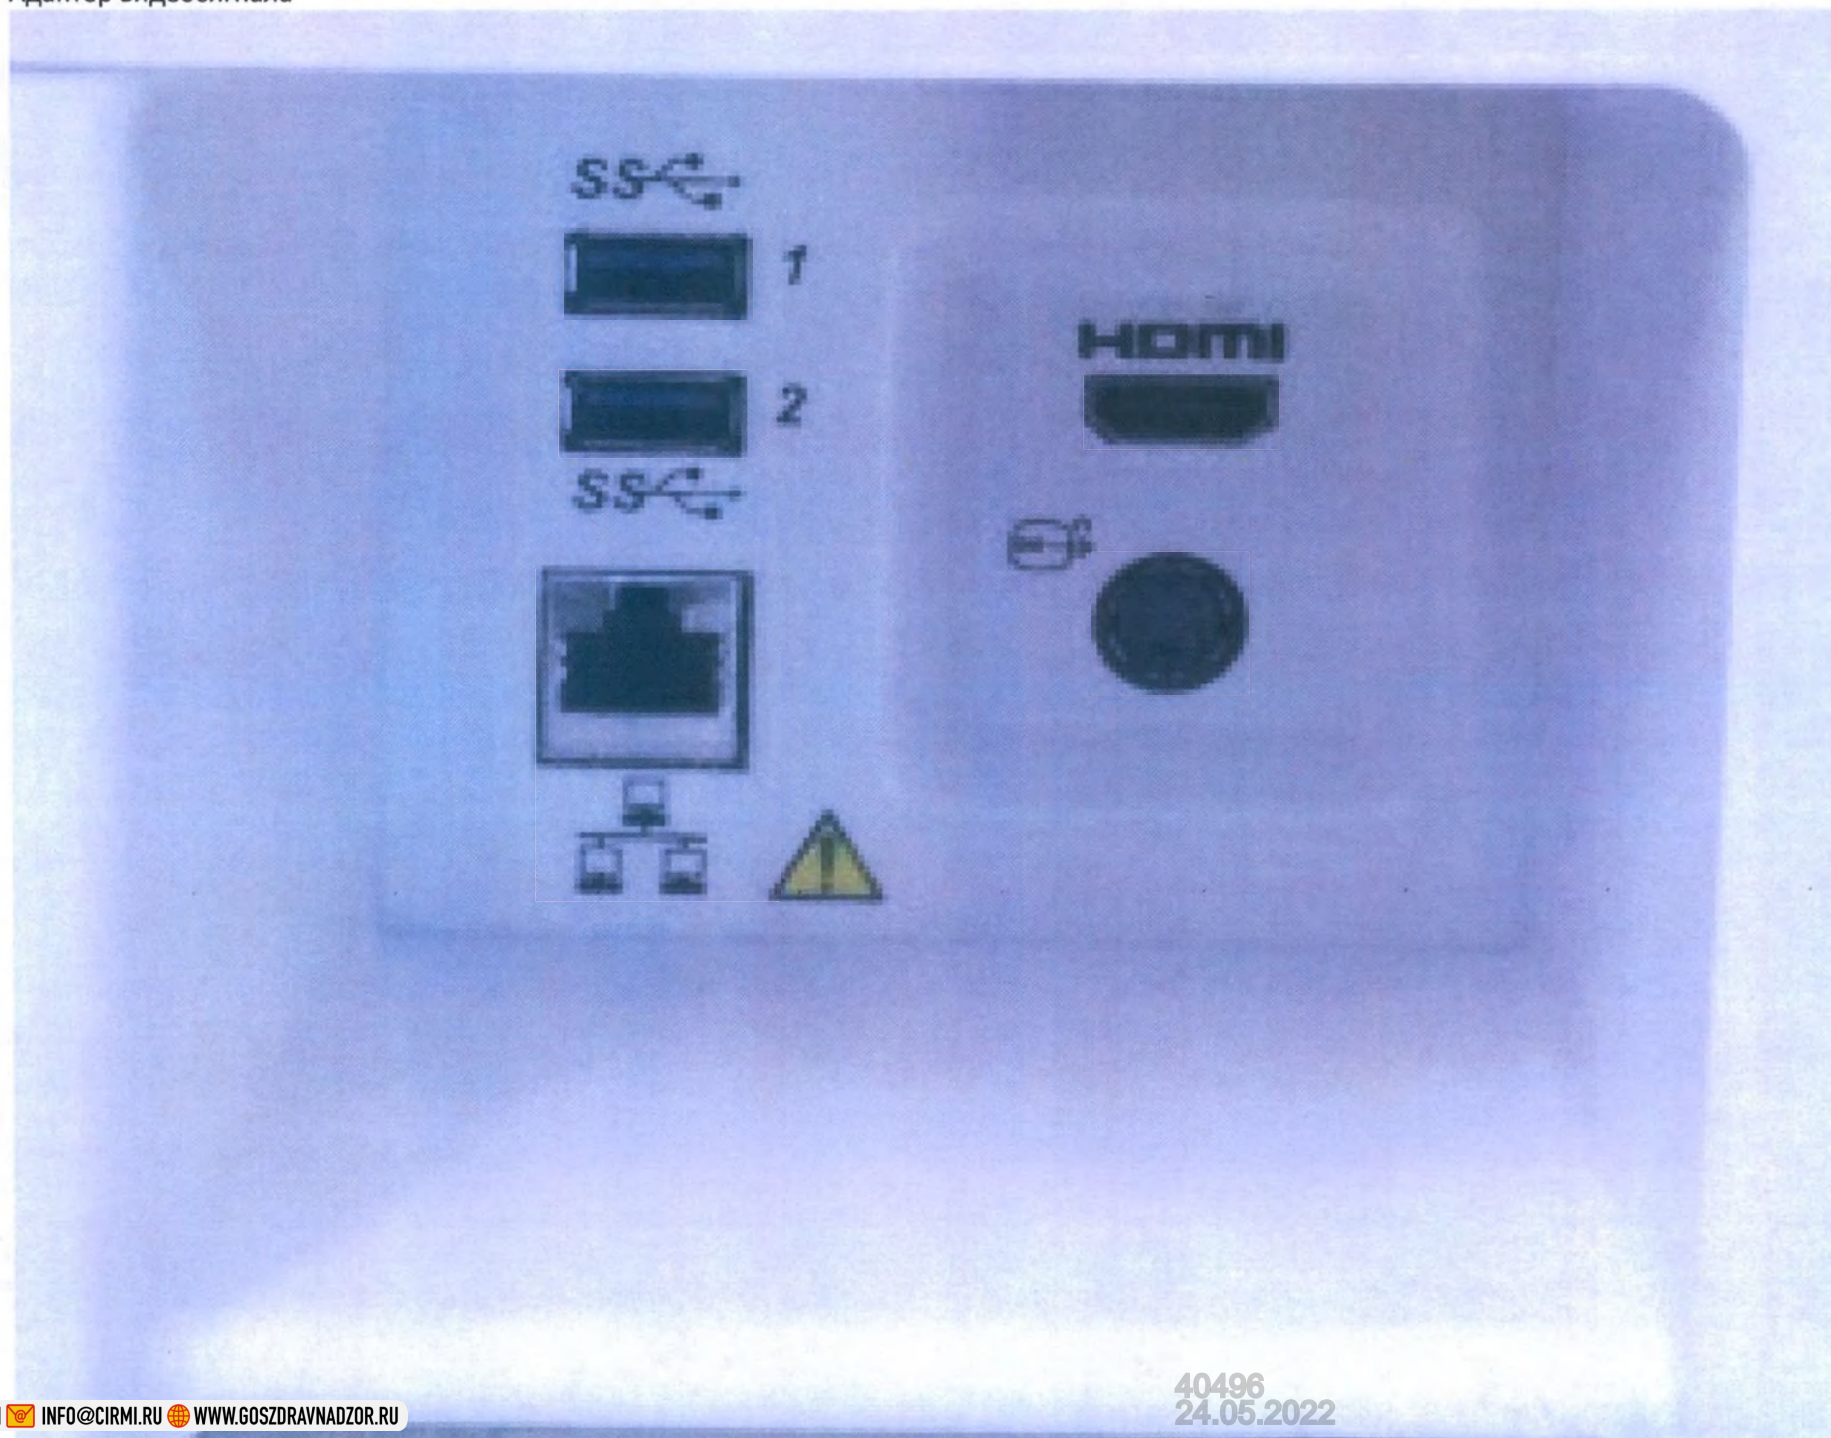

LOGIQ E10
 (01)00840682145640(11)YYMMDD(21)XXXXXXXXYZ
 100-240В~ 50/60 Гц 0.9 кВА **UDI** 
 P/N 5935000E10-2
REF LOGIQ E10 R2 **СДЕЛАНО В США**
S/N XXXXXXXYZ  GE Medical Systems Ultrasound
 and Primary Care Diagnostics, LLC
 9900 Innovation Drive
 Wauwatosa, WI 53226, USA
 YYYY-MM-DD

LOGIQ E10
 (01)00840682145640(11)YYMMDD(21)XXXXXXXXYZ
 100-240В~ 50/60 Гц 0.9 кВА **UDI** 
 P/N 5935000E10-2
REF LOGIQ E10 R2 **СДЕЛАНО В КОРЕЕ**
S/N XXXXXXXYZ  GE Medical Systems Ultrasound
 and Primary Care Diagnostics, LLC
 9900 Innovation Drive
 Wauwatosa, WI 53226, USA
 YYYY-MM-DD



Пролито, пронумеровано и скреплено
печатьо 103 лист(ов)
Руководитель отдела регистрации
и сертификации Россия и СНГ
ООО «ДжиИ Хэлскеа»
Харитонова А.П.



Anton Gurev