

ООО «Смит энд Нефью»

Smith+Nephew

Юр.адрес: 105120 г. Москва,
2-й Сыромятнический пер, 1
эт.9, пом.1, комн.1

Почт.адрес: 105120 г. Москва,
2-й Сыромятнический пер, 1

Т: + 7 495 755 55 03
www.smith-nephew.com
info.russia@smith-nephew.com

Подтверждаю

Руководитель отдела регистрации
и нормативно-правовой документации

ООО «Смит энд Нефью»

А.А. Хайруллина

«28» ноября 2022 г.



Фотографические изображения медицинского изделия
**Аппарат портативный для лечения ран отрицательным
давлением RENASYS TOUCH, с принадлежностями**



Рис. 1 Аппарат портативный для лечения ран отрицательным давлением RENASYS TOUCH вид спереди

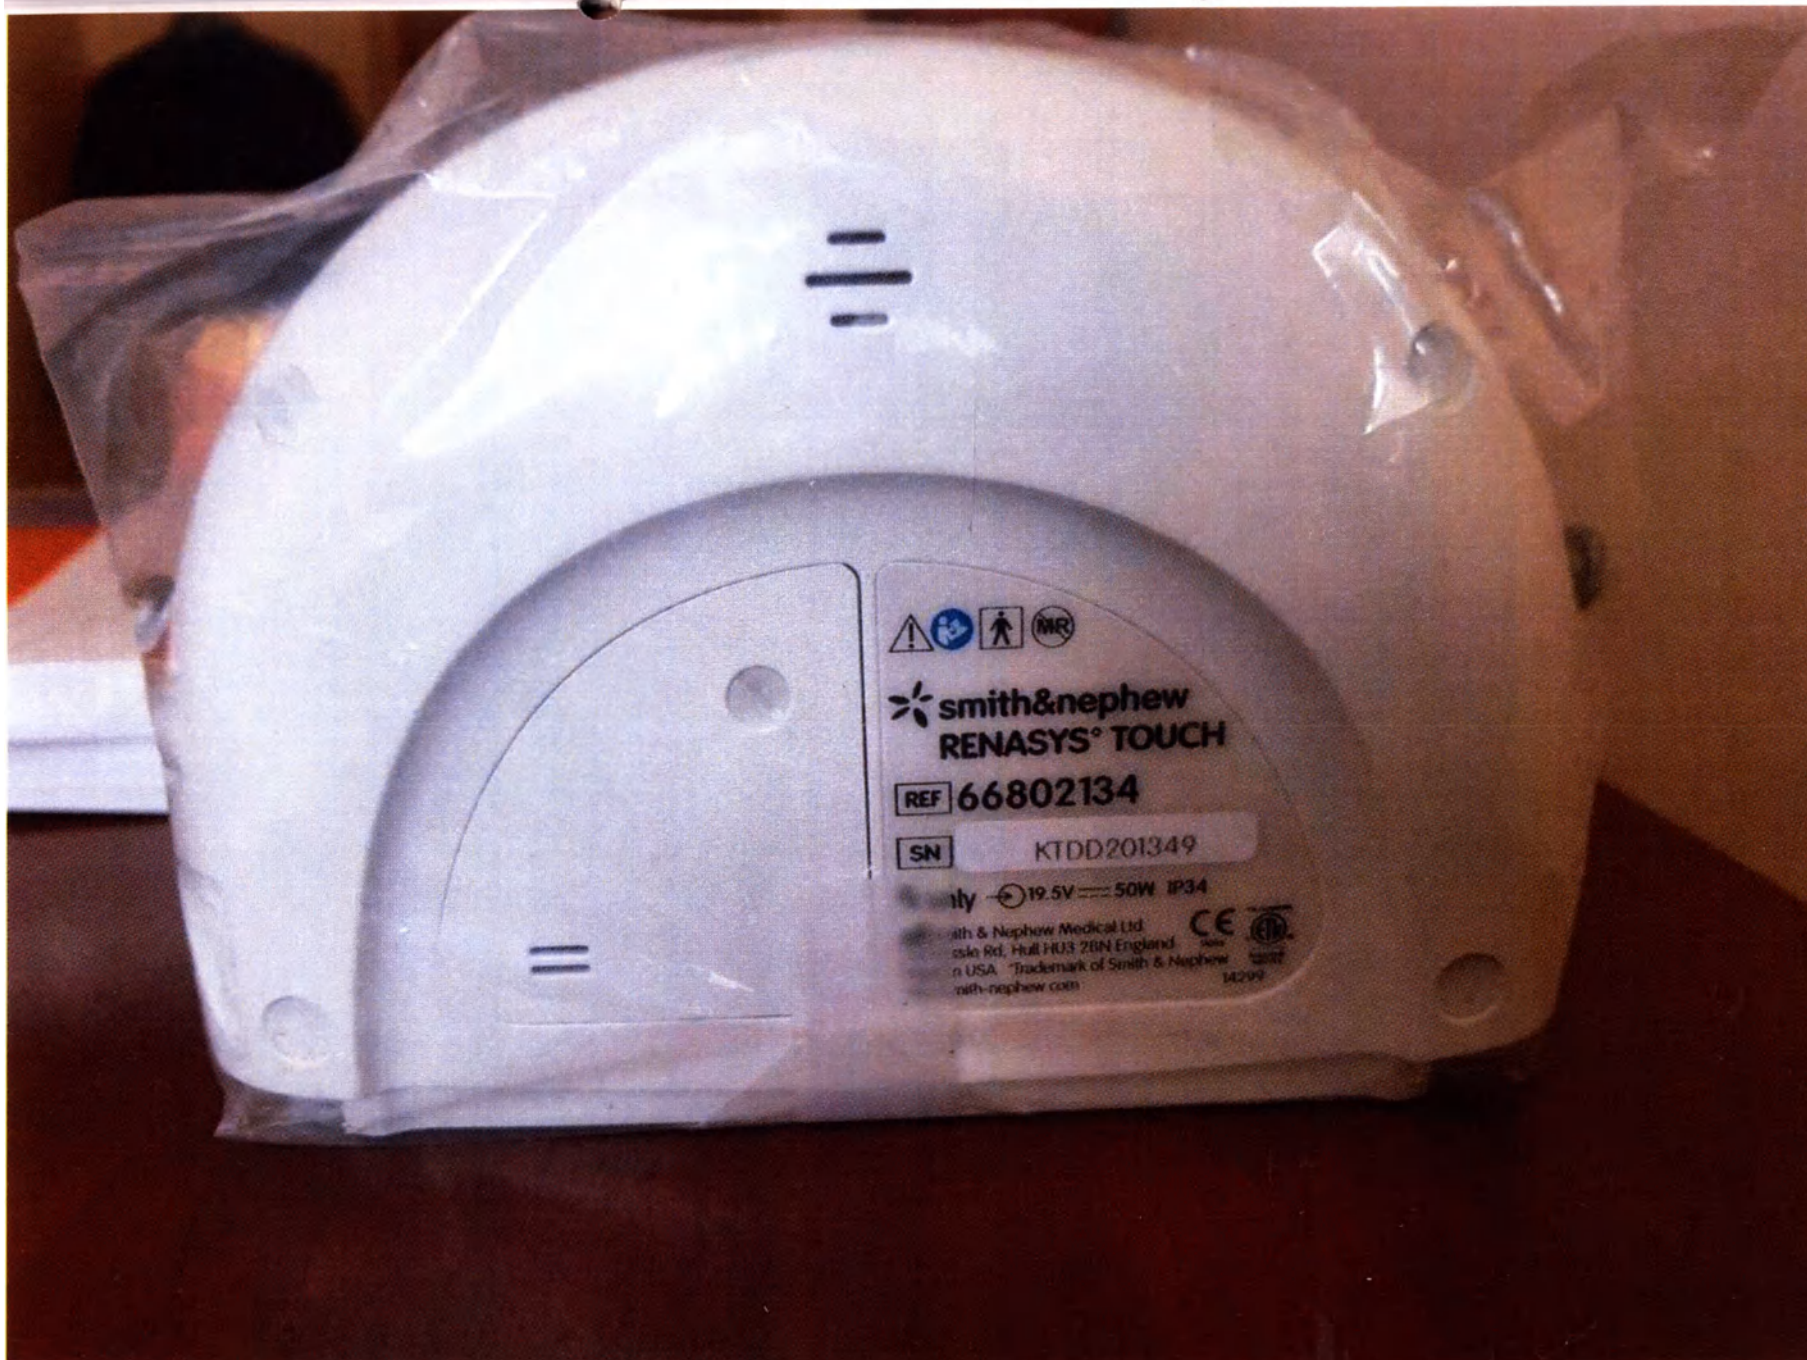


Рис. 2 Аппарат портативный для лечения ран отрицательным давлением RENASYS TOUCH вид сзади



Рис. 4 Адаптер питания, подключенный к сетевому кабелю



Рис. 5 Ёмкость RENASYS TOUCH 300мл, с отвердителем



Рис. 6 Ёмкость RENASYS TOUCH 300мл, без отвердителя

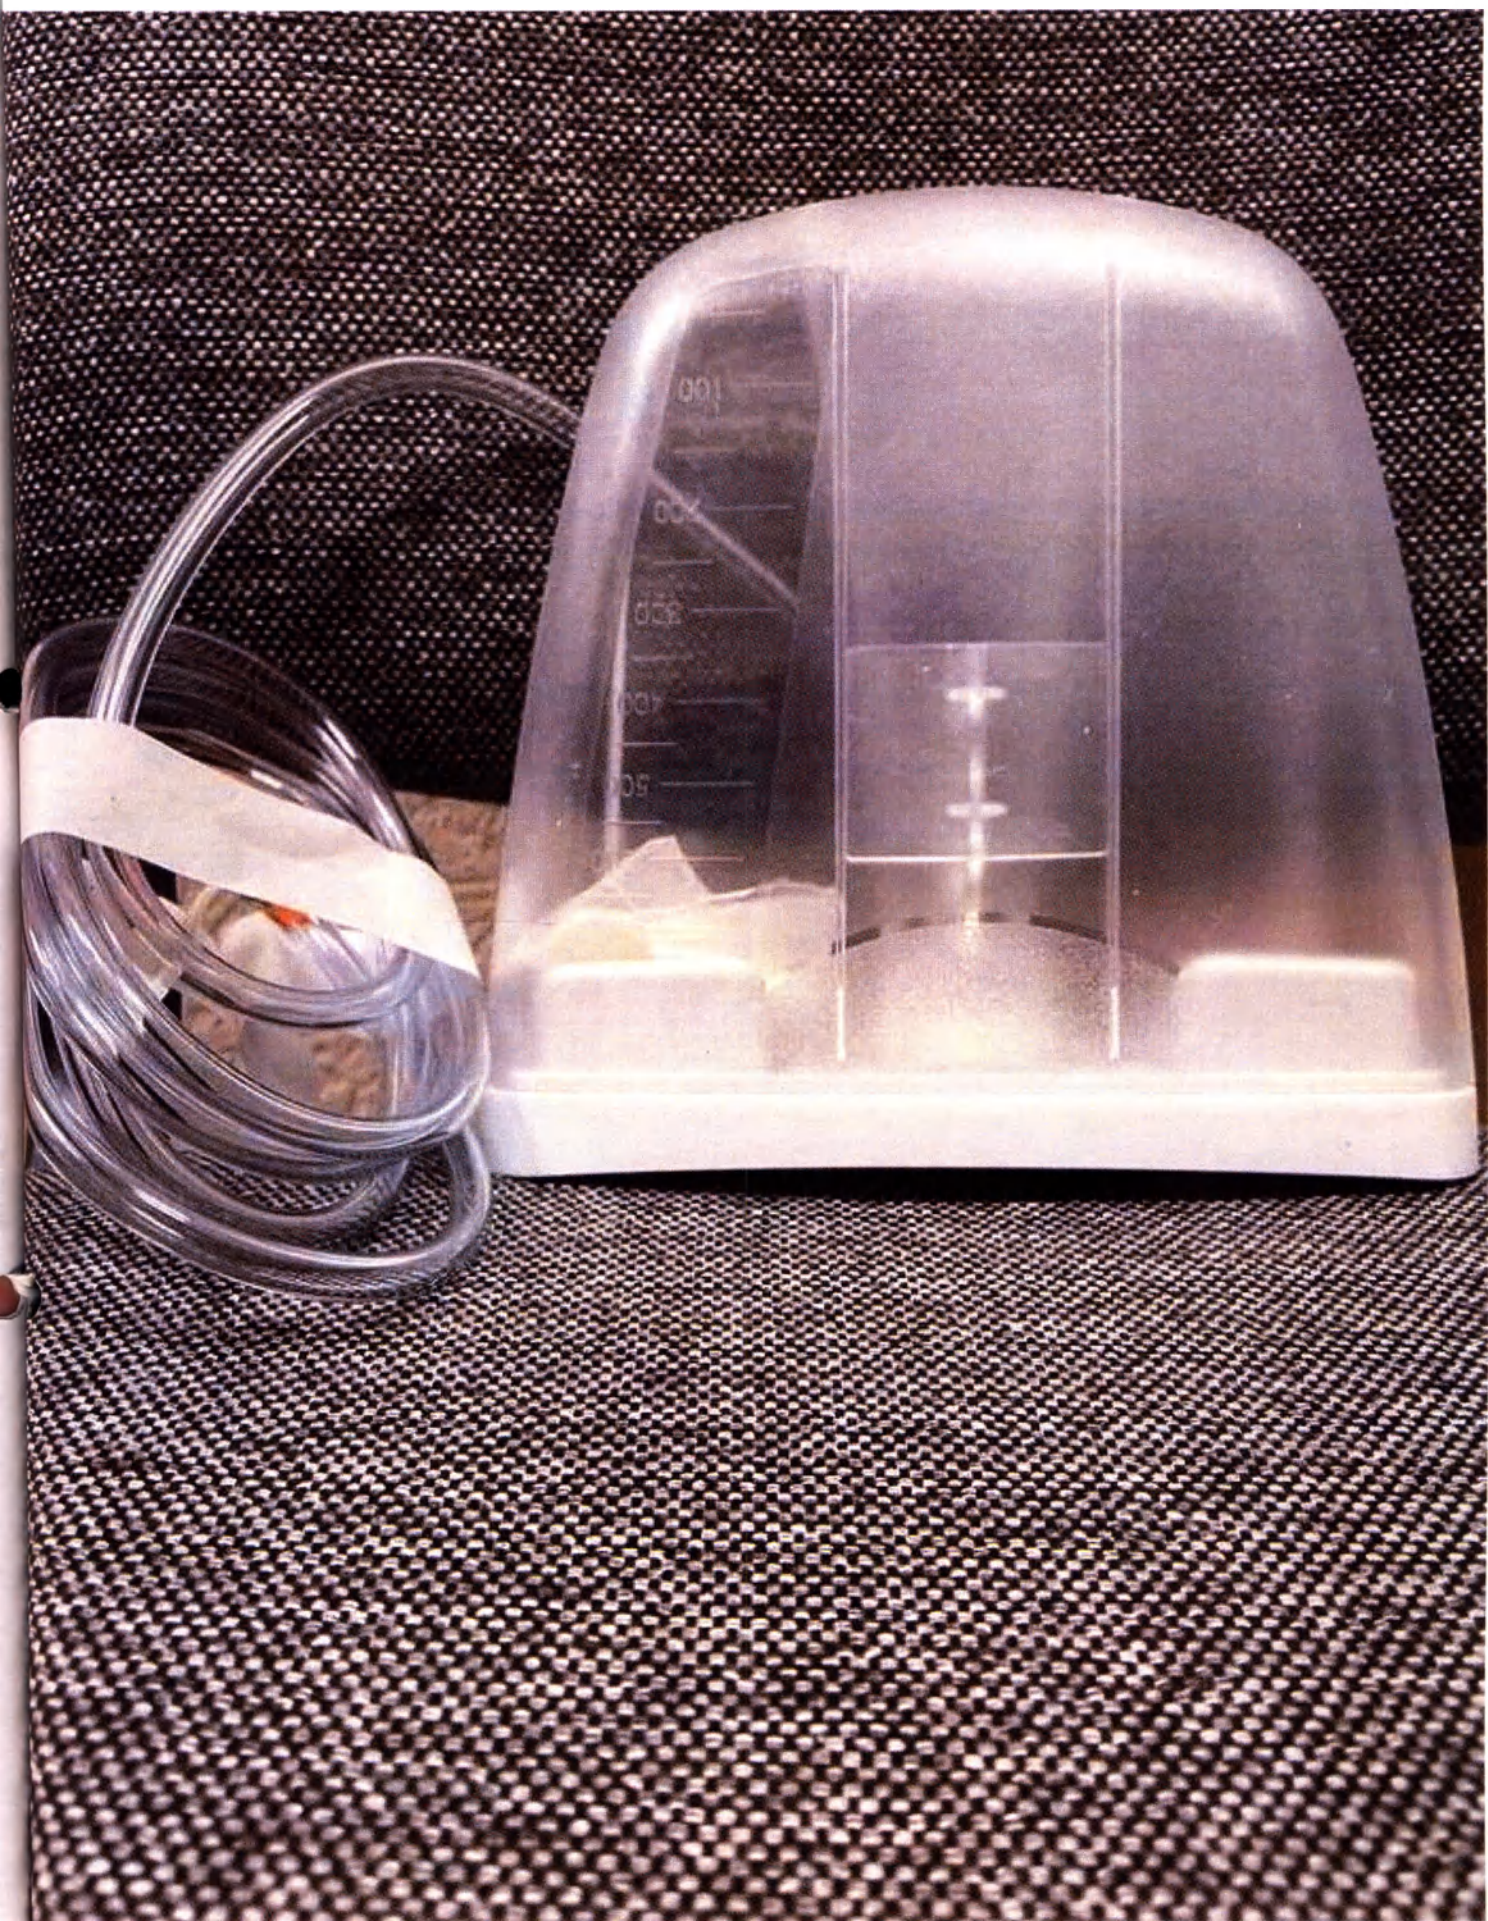


Рис. 7 Ёмкость RENASYS TOUCH 800мл, с отвердителем



Рис. 8 Уплотнительное кольцо

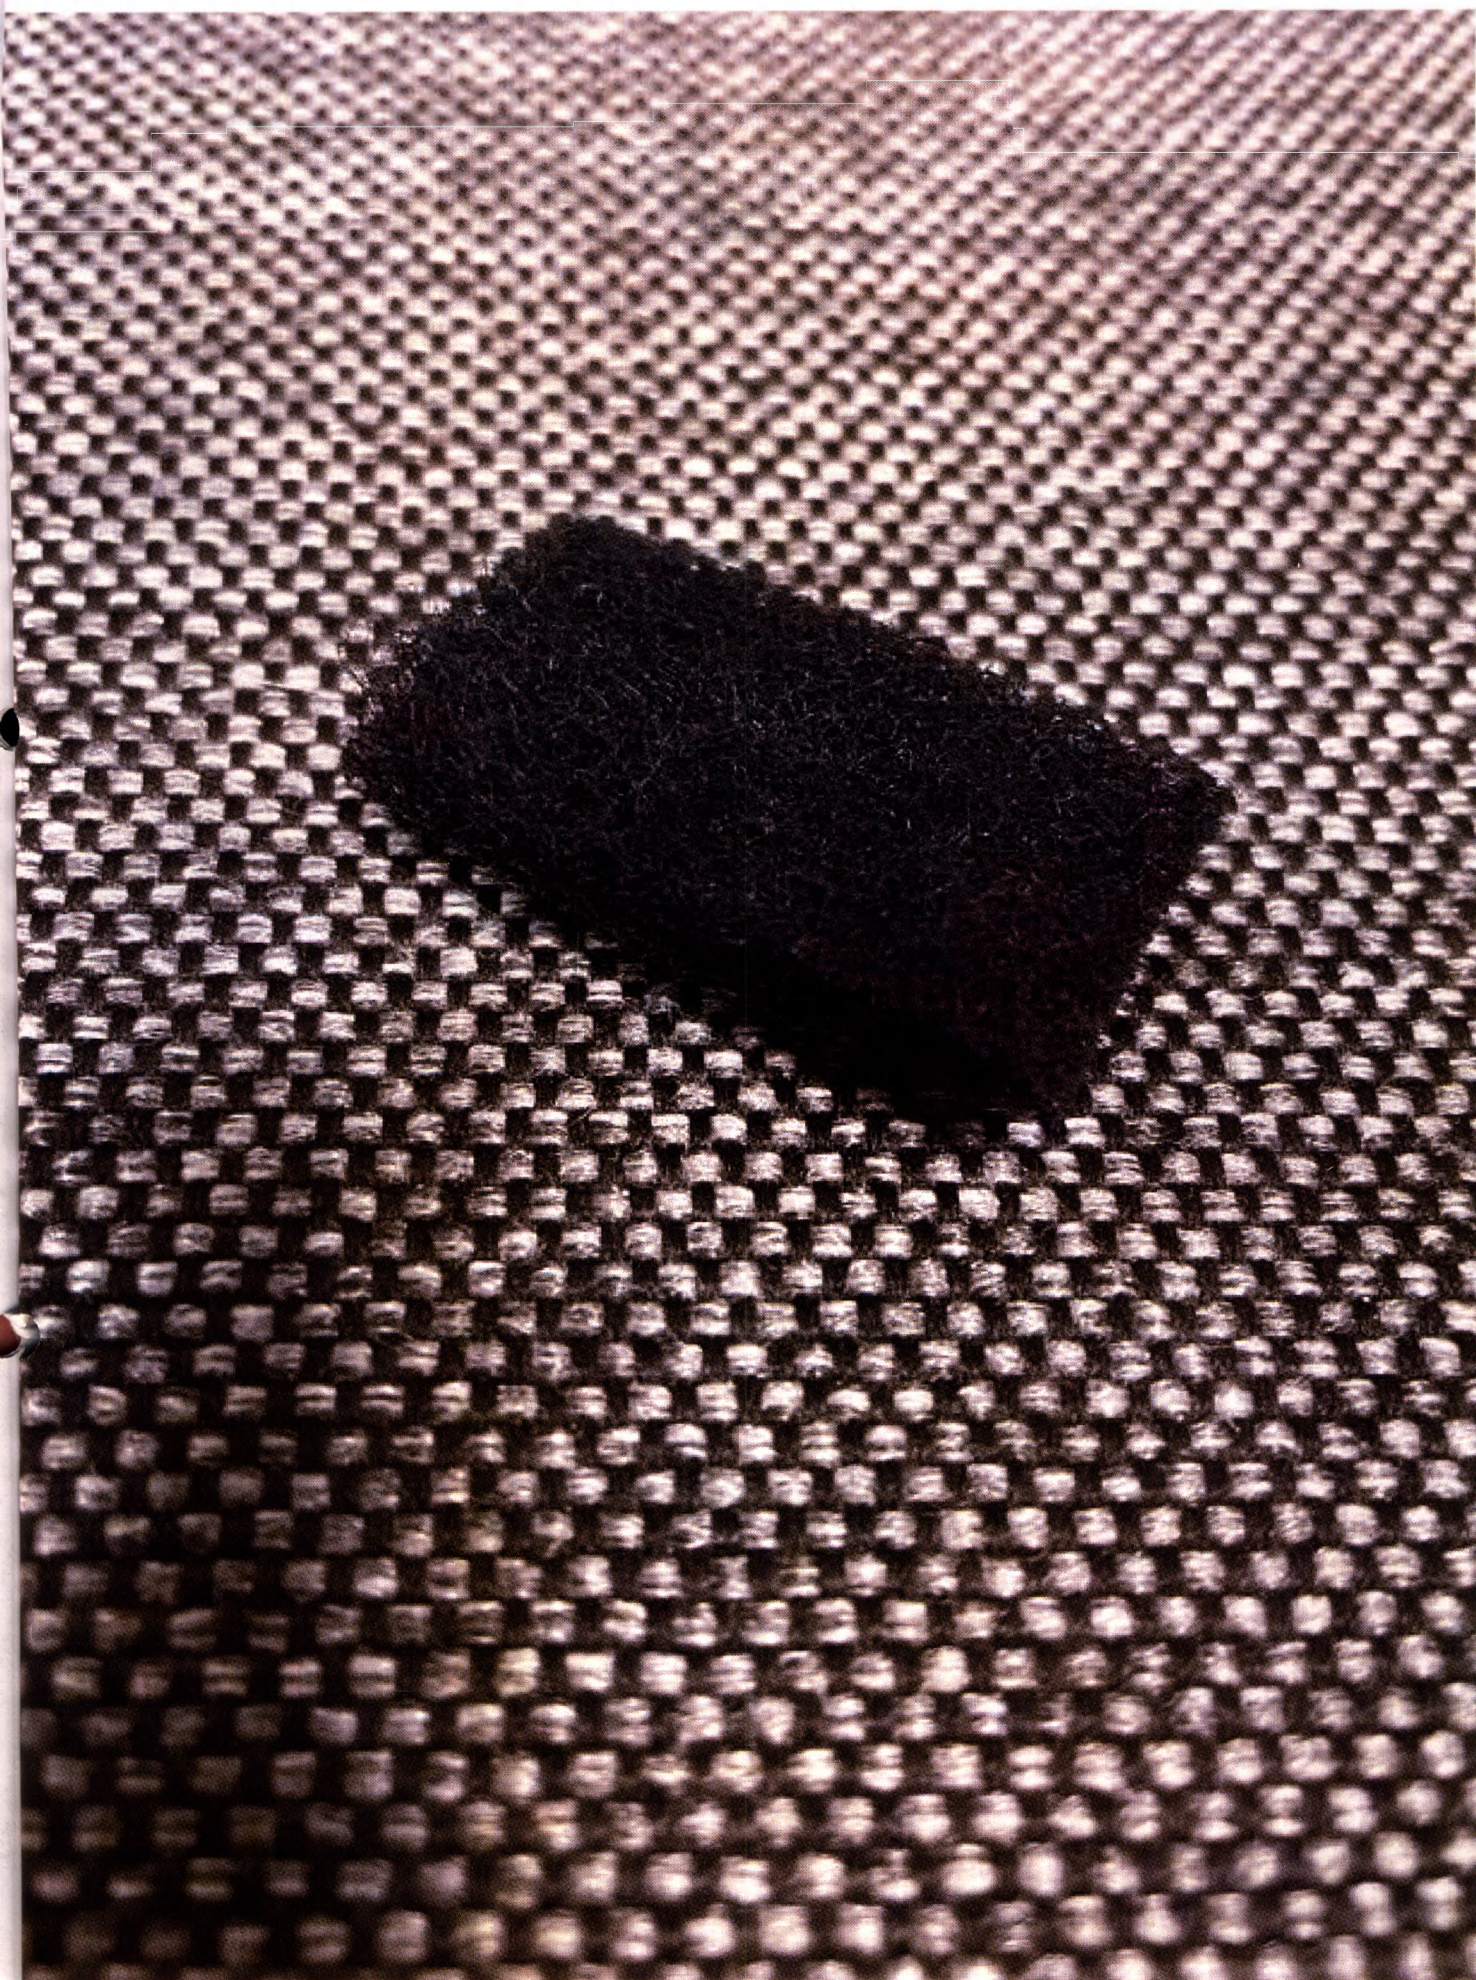


Рис. 9 Фильтр против запаха



Рис. 10 Футляр транспортировочный RENASYS TOUCH



Рис. 11 Сумка для переноски

Рис. 12 Ремешки для переноски



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 13

А. Кайрат листах



Утверждаю

Общество с ограниченной ответственностью «Смит энд Нефью»

Организация

105120 г. Москва, 2-й Сыромятнический пер., 1, эт. 9, пом.1, ком.1

Адрес

Руководитель отдела регистрации и нормативно-правовой

документации

Должность

А.А. Хайруллина

ФИО

25.04.2023

Дата ДД.ММ.ГГГГ

Подпись, печать



Сведения об упаковке и маркировке медицинского изделия

**Аппарат портативный для лечения ран отрицательным давлением
RENASYS TOUCH, с принадлежностями**

ДАННЫЕ О МАРКИРОВКЕ И УПАКОВКЕ АППАРАТА RENASYS TOUCH, ФОРМА ПОСТАВКИ

Маркировка на корпусе аппарата RENASYS TOUCH

Этикетка на нижней панели корпуса аппарата RENASYS Touch содержит следующую информацию:



- 1) Номер по каталогу
- 2) Серийный номер
- 3) Дата производства (ГГГГ-ММ-ДД)
- 4) Код GTIN (штрих код)
- 5) ЕС: символ WEEE не для обычных отходов

Идентификационная табличка на задней панели корпуса аппарата RENASYS TOUCH содержит следующую информацию:



- Логотип Смит энд Нефью
- Наименование изделия
- Номер по каталогу
- Серийный номер.
- Информация о производителе.
- Информационные символы

Маркировка на адаптере питания

Идентификационная табличка на передней стороне адаптера питания



- Логотип Смит энд Нефью
- Наименование изделия
- Номер по каталогу
- Оборудование класса II
- Информация о стране происхождения
- Информация о производителе

Идентификационная табличка на задней стороне адаптера питания



- Наименование изделия
- Заводской номер
- Параметры электропитания
- Деректива США
- Знак CE
- Информация о стране происхождения
- Корпус защищен от проникновения твердых предметов (> 12,5 мм в ширину) и каплепадения (номинальный угол 15°)
- Предупредительные надписи и информационные символы

ФОРМА ПОСТАВКИ

Аппарат портативный для лечения ран отрицательным давлением RENASYS TOUCH, с принадлежностями поставляется в следующей комплектации:

№	Наименование	Кол-во*(шт.)
	Аппарат портативный для лечения ран отрицательным давлением RENASYS TOUCH	1
	Адаптер питания	1
	Сетевой кабель	1
	Сумка для переноски (при необходимости)	1
	Ремень для переноски (при необходимости)	1
	Руководство по клиническому применению	2
*Количество изделий/устройств/средств/материалов/документов при поставке		

Индивидуальная упаковка

Изделие помещается в прозрачный полиэтиленовый пакет который затем запечатывается клейкой лентой.


Потребительская (транспортная) упаковка

Потребительская (транспортная) упаковка содержит одно изделие и включает:

- Внешнюю картонную коробку размером 308 x 214 x 215 (мм) ±5%
- картонную коробку адаптера питания
- нижний картонный лоток
- верхний картонный лоток
- губчатую прокладку

Состав потребительской (транспортной) упаковки


Внешняя коробка с нижним лотком:

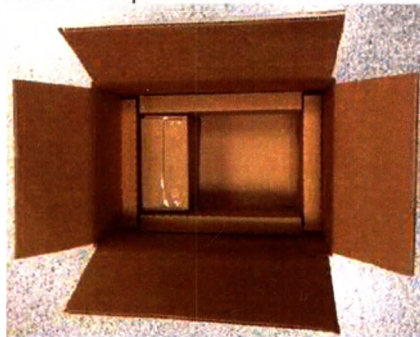


Нижний лоток с вложенным изделием.



Внешняя коробка с нижним и верхним лотками.

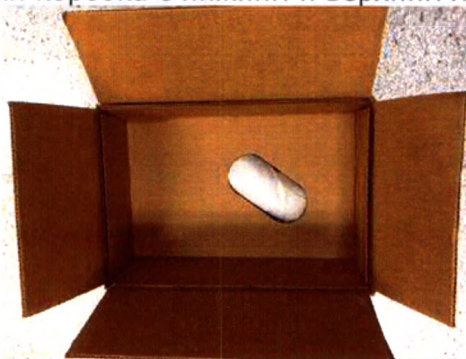


Маркировка потребительской (транспортной) упаковки

	
RENASYS[®] TOUCH Negative Pressure Wound Therapy	
Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull HU3 2BN England. *Trademark of Smith & Nephew. www.smith-nephew.com. Made in USA. [EC] REP Smith & Nephew Orthopaedics GmbH Alemanntenstrae 14, 78532 Tuttlingen, Germany.	
GTIN (01)05000223494988	
REF 66802134	
QTY 1	
SN (21)KTCA180001	
(11)YYYY-MM-DD	
    	
	
(0 1) 0 5 0 0 0 2 2 3 4 9 4 9 8 8 (2 1) K T C A 1 8 0 0 0 1 19621	

Маркировка потребительской упаковки содержит следующую информацию:

- Логотип Смит энд Нефью
- Наименование изделия
- Информация о производителе
- Код GTIN
- Номер по каталогу
- Количество
- Серийный номер
- Дата производства
- Информация о стране происхождения
- Информационные символы

Схема упаковки аппарата RENASYS TOUCH

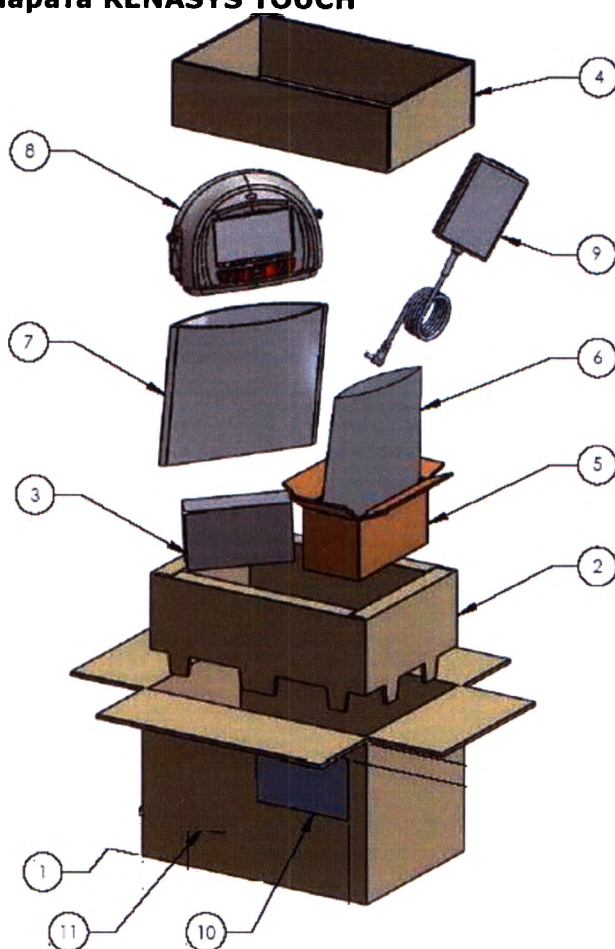

- 1 – картонная коробка с клеевым соединением;
- 2 – лоток с вырезами;
- 3 – поролоновая прокладка;
- 4 – лоток с обрезанным углом;
- 5 – картонная коробка адаптера питания;
- 6 – полиэтиленовый пакет адаптера питания;
- 7 – полиэтиленовый пакет аппарата RENASYS TOUCH;
- 8 – аппарат RENASYS TOUCH;
- 9 – адаптер питания;
- 10 – транспортная маркировка;

ДАННЫЕ О МАРКИРОВКЕ И УПАКОВКЕ ЁМКОСТИ RENASYS TOUCH

Индивидуальная упаковка (пакет)

Основа: Формовочная ламинированная прозрачная плёнка 10.0 MIL (0,254 мм)

Покрытие: Упаковочная ламинированная плёнка, белая 4,0 MIL (0,1 мм).

Размеры пакета 156 x 203 (мм) ±5%

Содержит 1 одну ёмкость RENASYS TOUCH.



Маркировка индивидуальной упаковки (на примере ёмкости 800мл)



Этикетка на индивидуальной упаковке ёмкости RENASYS TOUCH содержит следующую информацию:

- Логотип Смит энд Нефью
- Наименование изделия мультязычное
- Информация о производителе
- Код GTIN
- Номер по каталогу
- Количество
- Номер партии
- Дата производства
- Информация о представителе в Европейском Союзе
- Информация о стране происхождения
- Информационные символы

Потребительская (транспортная) упаковка (на примере ёмкости 800мл)


Коробка из гофрированного картона (средний гофр) с внутренними размерами 368 x 184 x 200 (мм) ($\pm 5\%$).

Конструкция соответствует требованиям Европейской Ассоциации производителей гофрированного картона 0201.

Содержит 5 ёмкостей RENASYS TOUCH в индивидуальной упаковке

Примечание: Ориентация индивидуальных упаковок с ёмкостями в транспортной упаковке – 3 сверху, 2 снизу.


Маркировка транспортной упаковки

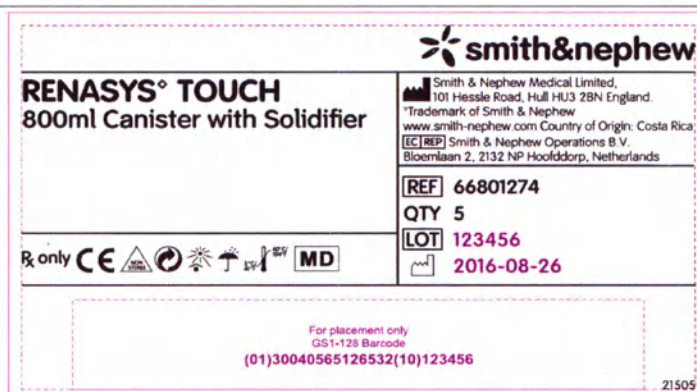

Этикетка на транспортной упаковке ёмкости RENASYS TOUCH содержит следующую информацию:

- Логотип Смит энд Нефью
- Наименование изделия
- Информация о производителе
- Код GTIN
- Номер по каталогу
- Количество
- Номер партии
- Дата производства
- Информация о представителе в Европейском Союзе
- Информация о стране происхождения
- Информационные символы

Схема упаковки ёмкости RENASYS TOUCH (на примере ёмкости 800мл)

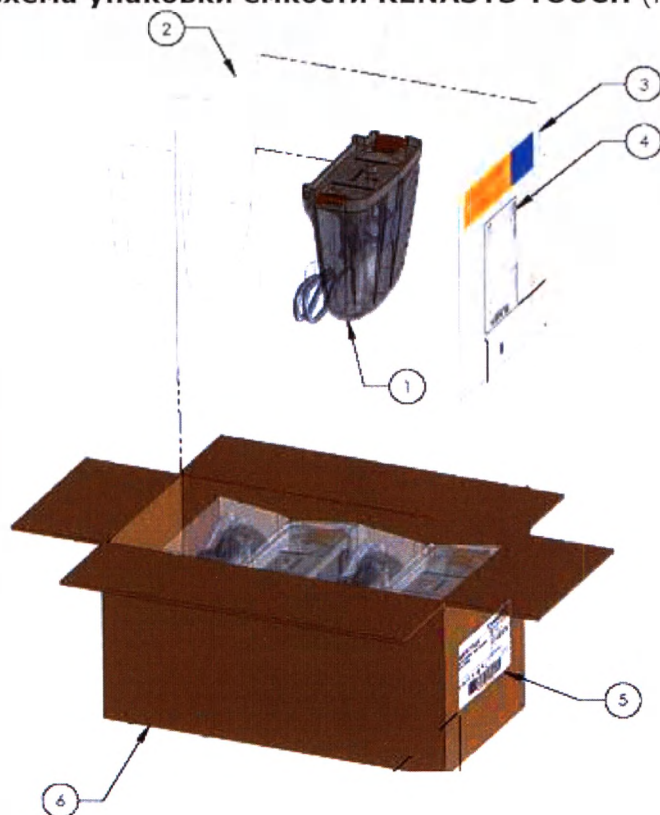


- 1 – ёмкость RENASYS TOUCH;
- 2 – формовочная ламинированная прозрачная плёнка;
- 3 – упаковочная ламинированная плёнка, белая;
- 4 – маркировка индивидуальной упаковки;
- 5 – маркировка транспортной упаковки;
- 6 – транспортная коробка

ДАННЫЕ О МАРКИРОВКЕ И УПАКОВКЕ СЕТЕВОГО КАБЕЛЯ

Индивидуальная упаковка (пакет)

Запечатываемый прозрачный полиэтиленовый пакет размерами 297 x 177 (мм) $\pm 5\%$ содержащий 1 сетевой кабель.

Маркировка индивидуальной упаковки сетевого кабеля

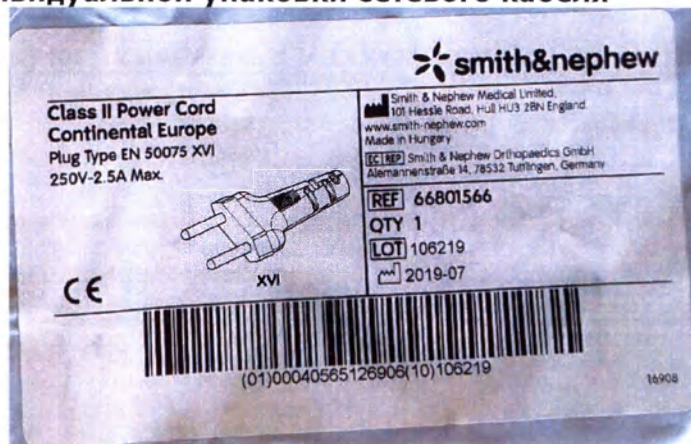

Этикетка на индивидуальной упаковке сетевого кабеля содержит следующую информацию:

- Логотип Смит энд Нефью
- Наименование изделия
- Информация о производителе
- Код GTIN
- Номер по каталогу
- Количество
- Номер партии
- Информация о представителе в Европейском Союзе
- Информация о стране происхождения
- Информация о дате производства
- Информационные символы

ДАННЫЕ О МАРКИРОВКЕ И УПАКОВКЕ СУМКИ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

Индивидуальная упаковка (пакет)

Запечатываемый прозрачный полиэтиленовый пакет размерами 245 x 298 (мм) $\pm 5\%$ содержащий 1 сумку для переноски.

Маркировка индивидуальной упаковки сумки для переноски



Этикетка на индивидуальной упаковке сумки для переноски содержит следующую информацию:

- Логотип Смит энд Нефью
- Наименование изделия мультязычное
- Информация о производителе
- Код GTIN
- Номер по каталогу


- Количество
- Номер партии
- Информация о представителе в Европейском Союзе
- Информация о стране происхождения
- Информация о дате производства
- Информационные символы
- Код UDI

ДАННЫЕ О МАРКИРОВКЕ И УПАКОВКЕ РЕМНЯ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ

Индивидуальная упаковка (пакет)

Запечатываемый прозрачный полиэтиленовый пакет размерами 260 x 117 (мм) ±5% содержащий 1 ремень для переноски.

Маркировка индивидуальной упаковки ремня для переноски

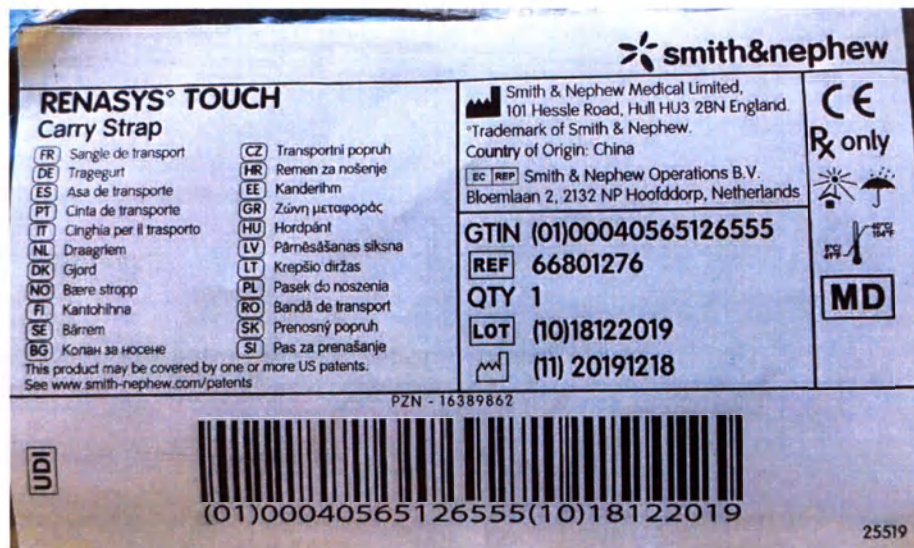

Этикетка на индивидуальной упаковке ремня для переноски содержит следующую информацию:

- Логотип Смит энд Нефью
- Наименование изделия мультязычное
- Информация о производителе
- Код GTIN
- Номер по каталогу
- Количество
- Номер партии
- Информация о представителе в Европейском Союзе
- Информация о стране происхождения
- Информация о дате производства
- Информационные символы
- Код UDI

ДАННЫЕ О МАРКИРОВКЕ И УПАКОВКЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОГО КОЛЬЦА

Индивидуальная упаковка (пакет)

Запечатываемый прозрачный полиэтиленовый пакет размерами 3" x 4" (76,2 x 101,6 мм) ±5% содержащий 20 уплотнительных колец.

Маркировка индивидуальной упаковки уплотнительного кольца



Этикетка на индивидуальной упаковке уплотнительного кольца содержит следующую информацию:

- Логотип Смит энд Нефью
- Наименование изделия мультязычное
- Информация о производителе
- Код GTIN
- Номер по каталогу
- Количество
- Номер партии
- Информация о представителе в Европейском Союзе
- Информация о стране происхождения

Потребительская (транспортная) упаковка

Коробка из гофрированного картона (средний гофр) с внутренними размерами 4" x 4" x 4" (101,6 x 101,6 x 101,6 мм) $\pm 5\%$.

Конструкция соответствует требованиям Европейской Ассоциации производителей гофрированного картона 0201.

Содержит 20 индивидуальных упаковок

Маркировка транспортной упаковки



Этикетка на транспортной упаковке уплотнительного кольца содержит следующую информацию:

- Логотип Смит энд Нефью
- Наименование изделия
- Информация о производителе
- Код GTIN
- Номер по каталогу
- Количество
- Номер партии
- Информация о стране происхождения

ДАННЫЕ О МАРКИРОВКЕ И УПАКОВКЕ ФИЛЬТРА ПРОТИВ ЗАПАХА

Индивидуальная упаковка

Запечатываемый прозрачный полиэтиленовый пакет размерами 6" x 9" (152,4 x 228,6

мм) $\pm 5\%$, содержащий 20 фильтров против запаха.

Маркировка индивидуальной упаковки



Этикетка на индивидуальной упаковке фильтра против запаха содержит следующую информацию:

- Логотип Смит энд Нефью
- Наименование изделия мультязычное
- Информация о производителе
- Код GTIN
- Номер по каталогу
- Количество
- Номер партии
- Информация о представителе в Европейском Союзе
- Информация о стране происхождения

Потребительская (транспортная) упаковка

Коробка из гофрированного картона (средний гофр) с внутренними размерами 20" x 8" x 8" (508 x 203 x 203 мм) $\pm 5\%$.

Конструкция соответствует требованиям Европейской Ассоциации производителей гофрированного картона 0201.

Содержит 20 индивидуальных упаковок

Маркировка транспортной упаковки



Этикетка на транспортной упаковке фильтра против запаха содержит следующую информацию:

- Логотип Смит энд Нефью
- Наименование изделия
- Информация о производителе
- Код GTIN
- Номер по каталогу
- Количество
- Номер партии
- Информация о стране происхождения

ДАННЫЕ О МАРКИРОВКЕ И УПАКОВКЕ ФУТЛЯРА ТРАНСПОРТИРОВОЧНОГО

Футляр транспортировочный поставляется в коробке из гофрированного картона (средний гофр), содержащей 3 изделия.


Маркировка изделия:

На верхней крышке футляра транспортировочного нанесён логотип Смит энд Нефью



Внутренняя маркировка:

Графическая этикетка, прикрепленная по центру к поперечине на внутреннем отсеке крышки содержит следующую информацию:

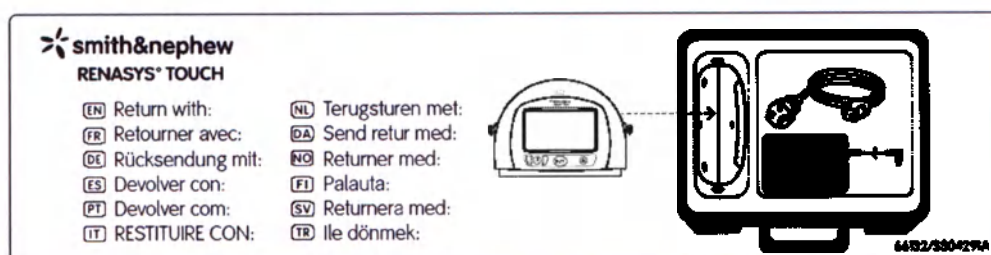


- Логотип Смит энд Нефью
- Наименование изделия
- Надпись на разных языках: Вернуть с:
- Схема расположения медицинского изделия и комплектующих в футляре транспортировочном.

Этикетка с номером партии размером 25x10 мм, прикрепленная к верхнему правому углу внутренней крышки.



Наклейка размером 55 x 32 мм, прикрепленная к верхнему левому углу внутренней крышки, содержащая информацию об официальном представителе производителя в

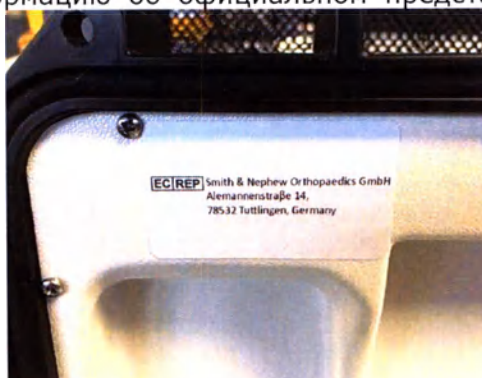

EC.

Макеты маркировки упаковки медицинского изделия на территории РФ

Макет маркировки упаковки аппарата RENASYS TOUCH

Артикул: 66802134

Наименование: Аппарат портативный для лечения ран отрицательным давлением RENASYS TOUCH, с принадлежностями

Размер: 180 x 190 x 76 мм.

Кол-во шт. в упаковке: 1шт.

Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: См. на упаковке

Наименование и адрес изготовителя: Смит энд Нефью Медикал Лтд./ Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull, HU3 2BN, *United Kingdom* (Соединенное Королевство)

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО "Смит энд Нефью", 105120, г. Москва, 2-й Сыромятнический переулок, дом 1, эт.9, пом. 1, ком.1. тел./факс: + 7 495 755 55 03

Метод стерилизации: Нестерильно

Номер РУ:

Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от +5 до 40 °C

Меры предосторожности: -

Информация о соответствии стандартам качества (при необходимости)

Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ifus>

Макет маркировки упаковки ёмкости RENASYS TOUCH 800 мл, с отвердителем

Артикул: 66801274

Наименование: Аппарат портативный для лечения ран отрицательным давлением RENASYS TOUCH, с принадлежностями. Ёмкость RENASYS TOUCH 800мл, с отвердителем.

Размер: 800 мл

Кол-во шт. в упаковке: 1шт.

Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: См. на упаковке

Наименование и адрес изготовителя: Смит энд Нефью Медикал Лтд./ Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull, HU3 2BN, United Kingdom (Соединенное Королевство)

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО "Смит энд Нефью", 105120, г. Москва, 2-й Сыромятнический пер., дом 1, эт.9, пом. 1, ком.1. тел./факс: + 7 495 755 55 03

Метод стерилизации: Нестерильно

Номер РУ:

Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от +5 до 40 °C

Меры предосторожности: -

Информация о соответствии стандартам качества (при необходимости)

Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ifus>

Макет маркировки упаковки ёмкости RENASYS TOUCH 300 мл, без отвердителя

Артикул: 66801275

Наименование: Аппарат портативный для лечения ран отрицательным давлением RENASYS TOUCH, с принадлежностями. Ёмкость RENASYS TOUCH 300мл, без отвердителя.

Размер: 300 мл

Кол-во шт. в упаковке: 1шт.

Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: См. на упаковке

Наименование и адрес изготовителя: Смит энд Нефью Медикал Лтд./ Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull, HU3 2BN, United Kingdom (Соединенное Королевство)

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО "Смит энд Нефью", 105120, г. Москва, 2-й Сыромятнический переулок, дом 1, эт.9, пом. 1, ком.1. тел./факс: + 7 495 755 55 03

Метод стерилизации: Нестерильно

Номер РУ:

Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от +5 до 40 °C

Меры предосторожности: -

Информация о соответствии стандартам качества (при необходимости)

Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ifus>

Макет маркировки упаковки ёмкости RENASYS TOUCH 300 мл, с отвердителем

Артикул: 66801273

Наименование: Аппарат портативный для лечения ран отрицательным давлением RENASYS TOUCH, с принадлежностями. Ёмкость 300мл RENASYS TOUCH, с отвердителем

Размер: 300 мл

Кол-во шт. в упаковке: 1шт.

Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: См. на упаковке

Наименование и адрес изготовителя: Смит энд Нефью Медикал Лтд./ Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull, HU3 2BN, United Kingdom (Соединенное Королевство)

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО "Смит энд Нефью", 105120, г. Москва, 2-й Сыромятнический переулок, дом 1, эт.9, пом. 1, ком.1. тел./факс: + 7 495 755 55 03

Метод стерилизации: Нестерильно

Номер РУ:

Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от +5 до 40 °C

Меры предосторожности: -

Информация о соответствии стандартам качества (при необходимости)

Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ifus>

Макет маркировки упаковки ремня для переноски

Артикул: 66801276

Наименование: Аппарат портативный для лечения ран отрицательным давлением RENASYS TOUCH, с принадлежностями. Ремень для переноски.

Размер: 840 x 25мм

Кол-во шт. в упаковке: 1 шт.

Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: См. на

упаковке

Наименование и адрес изготовителя: Смит энд Нефью Медикал Лтд./ Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull, HU3 2BN, United Kingdom (Соединенное Королевство)

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО "Смит энд Нефью", 105120, г. Москва, 2-й Сыромятнический переулок, дом 1, эт.9, пом. 1, ком.1. тел./факс: + 7 495 755 55 03

Метод стерилизации: Нестерильно

Номер РУ:

Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от +5 до 40 °C

Меры предосторожности: -

Информация о соответствии стандартам качества (при необходимости)

Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ifu>

Макет маркировки упаковки сумки для переноски

Артикул: 66801277

Наименование: Аппарат портативный для лечения ран отрицательным давлением RENASYS TOUCH, с принадлежностями. Сумка для переноски.

Размер: 191 x 177 x 78мм

Кол-во шт. в упаковке: 1 шт.

Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: См. на упаковке

Наименование и адрес изготовителя: Смит энд Нефью Медикал Лтд./ Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull, HU3 2BN, United Kingdom (Соединенное Королевство)

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО "Смит энд Нефью", 105120, г. Москва, 2-й Сыромятнический переулок, дом 1, эт.9, пом. 1, ком.1. тел./факс: + 7 495 755 55 03

Метод стерилизации: Нестерильно

Номер РУ:

Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от +5 до 40 °C

Меры предосторожности: -

Информация о соответствии стандартам качества (при необходимости)

Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ifu>

Макет маркировки упаковки уплотнительного кольца

Артикул: 66801283

Наименование: Аппарат портативный для лечения ран отрицательным давлением RENASYS TOUCH, с принадлежностями. Уплотнительное кольцо.

Размер: 8мм

Кол-во шт. в упаковке: 20 шт.

Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: См. на упаковке

Наименование и адрес изготовителя: Смит энд Нефью Медикал Лтд./ Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull, HU3 2BN, United Kingdom (Соединенное Королевство)

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО "Смит энд Нефью", 105120, г. Москва, 2-й Сыромятнический переулок, дом 1, эт.9, пом. 1, ком.1. тел./факс: + 7 495 755 55 03

Метод стерилизации: Нестерильно

Номер РУ:

Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от +5 до 40 °C
Меры предосторожности: -
Информация о соответствии стандартам качества (при необходимости)
Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ifus>

Макет маркировки упаковки фильтра против запаха

Артикул: 66801284
Наименование: Аппарат портативный для лечения ран отрицательным давлением RENASYS TOUCH, с принадлежностями. Фильтр против запаха.
Размер: 38,5 x 23,5 x 12мм
Кол-во шт. в упаковке: 20 шт.
Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: См. на упаковке
Наименование и адрес изготовителя: Смит энд Нефью Медикал Лтд./ Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull, HU3 2BN, United Kingdom (Соединенное Королевство)
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО "Смит энд Нефью", 105120, г. Москва, 2-й Сыромятнический переулок, дом 1, эт.9, пом. 1, ком.1. тел./факс: + 7 495 755 55 03
Метод стерилизации: Нестерильно
Номер РУ:
Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию
Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от +5 до 40 °C
Меры предосторожности: -
Информация о соответствии стандартам качества (при необходимости)
Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ifus>

Макет маркировки упаковки футляра транспортировочного

Артикул: 66801279
Наименование: Аппарат портативный для лечения ран отрицательным давлением RENASYS TOUCH, с принадлежностями. Футляр транспортировочный.
Размер: 334 x 283 x 143мм
Кол-во шт. в упаковке: 1 шт.
Дата изготовления, использовать до, номер партии/серии: См. на упаковке
Наименование и адрес изготовителя: Смит энд Нефью Медикал Лтд./ Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hessle Road, Hull, HU3 2BN, United Kingdom (Соединенное Королевство)
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО "Смит энд Нефью", 105120, г. Москва, 2-й Сыромятнический пер., дом 1, эт.9, пом. 1, ком.1. тел./факс: + 7 495 755 55 03
Метод стерилизации: Нестерильно
Номер РУ:
Назначение, способ применения, противопоказания: См. инструкцию
Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте, при температуре от +5 до 40 °C
Меры предосторожности: -
Информация о соответствии стандартам качества (при необходимости)
Инструкция по применению: <http://www.smith-nephew.com/about-us/where-we-operate/europe/russia/ifus>

Катрушкова А.А.

LLC Smith & Nephew