

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ЗАО "АНАЛИТИКА"


С.А. Балабаев

«22» декабря 2022 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для качественного экспресс-определения антигена SARS-CoV-2 в назальном мазке
(RAMP COVID-19 Antigen Test)

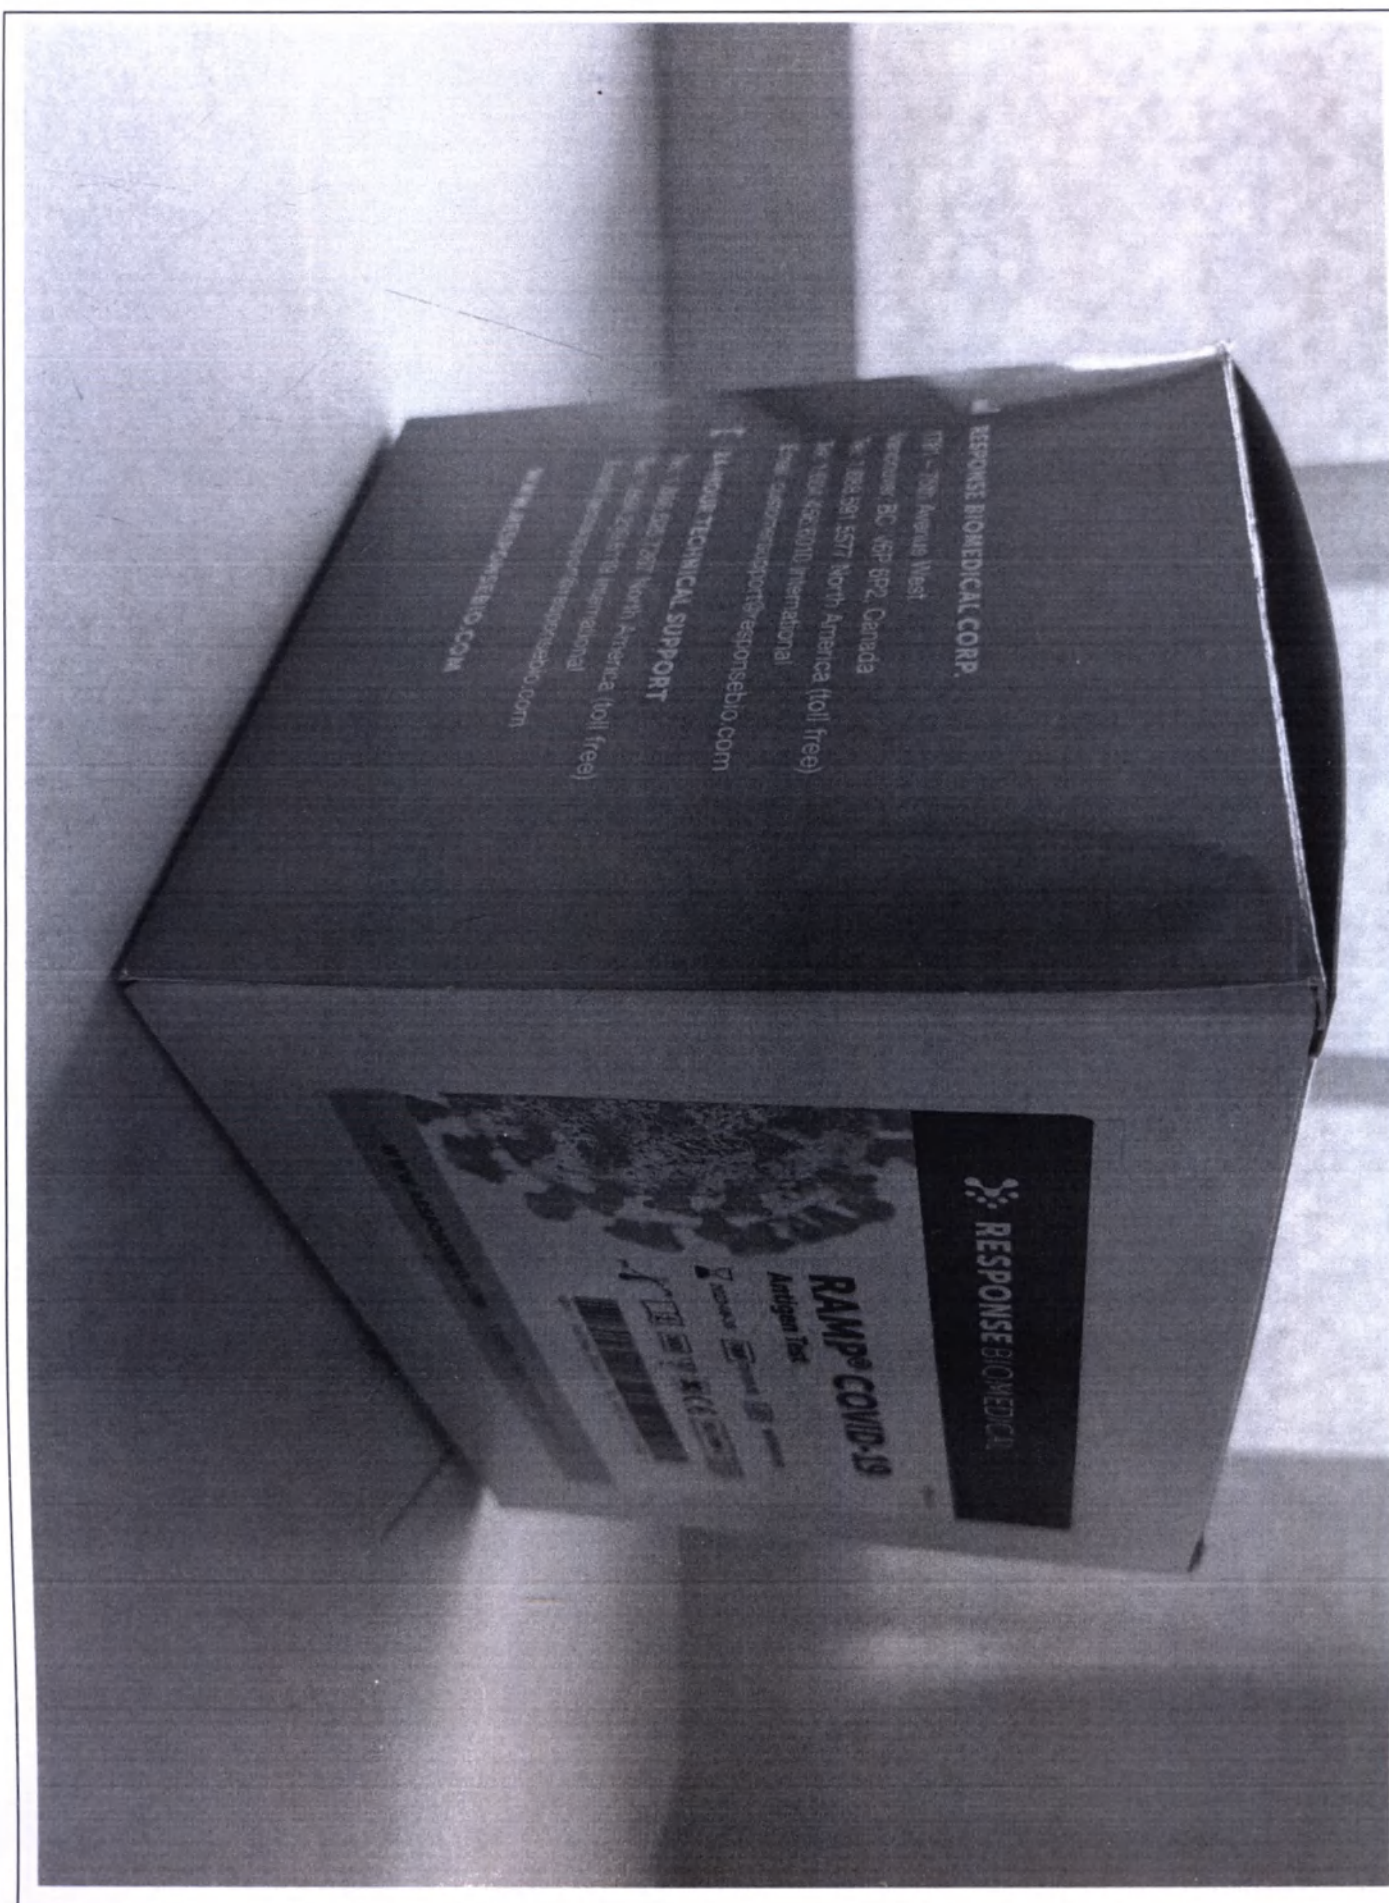

Общий вид набора

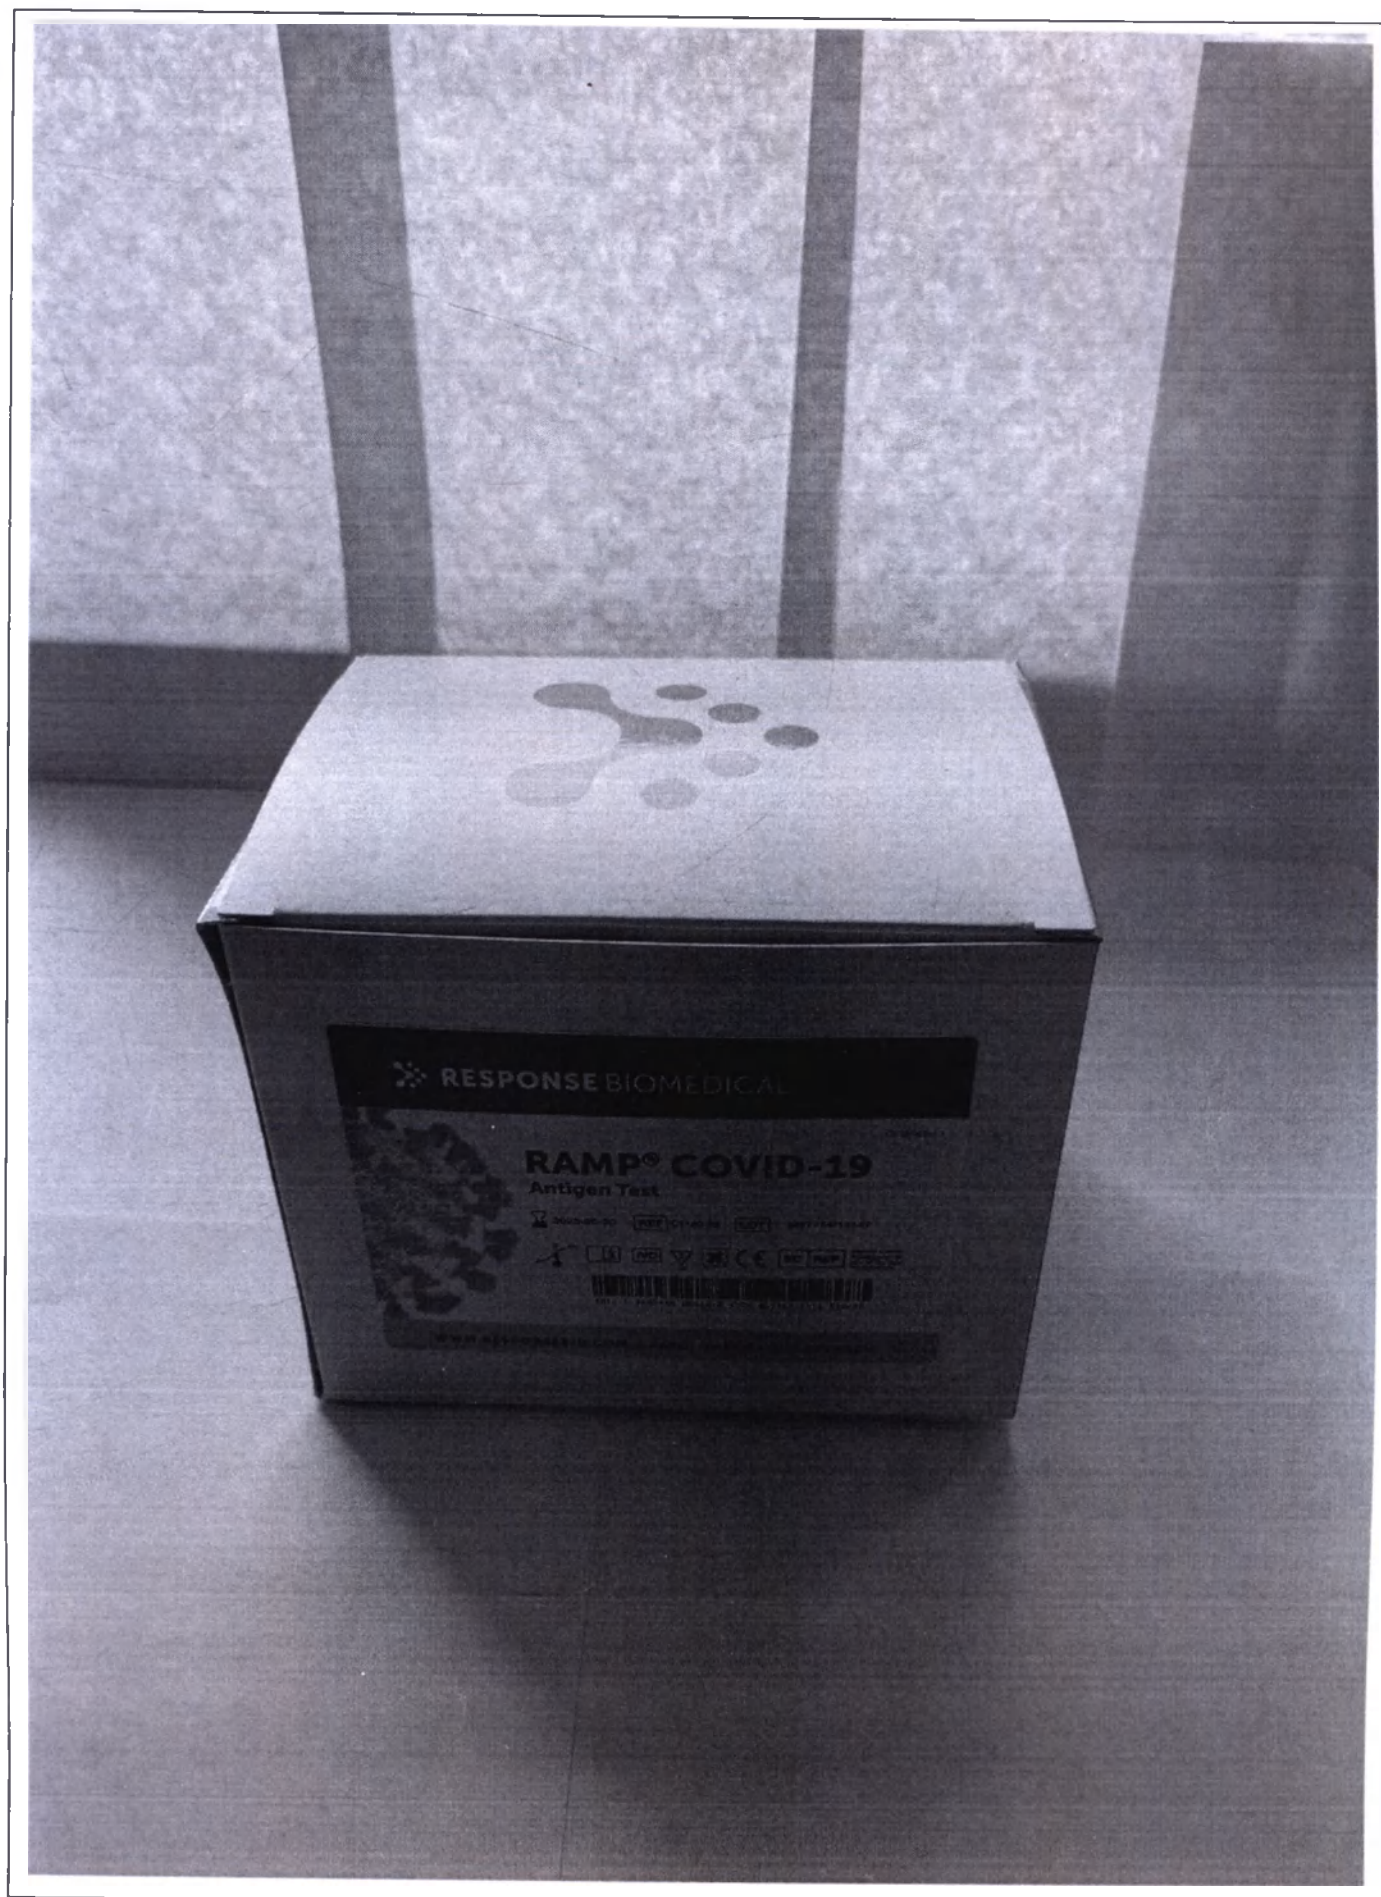

Общий вид набора



Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку. Вид спереди.

 **RESPONSE** BIOMEDICAL

C1120-25-1.1

RAMP® COVID-19

Antigen Test



2023-06-30

REF

C1120-25

LOT

M07754/13147




EMERGO EUROPE
Pruissengracht 20
2814 AP The Hague
The Netherlands



(01) 1 0627966 00542 8 (10) M07754 (17) 230630

WWW.RESPONSEBIO.COM | SPEED. PRECISION. ACCURACY.

Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку. Вид сверху.

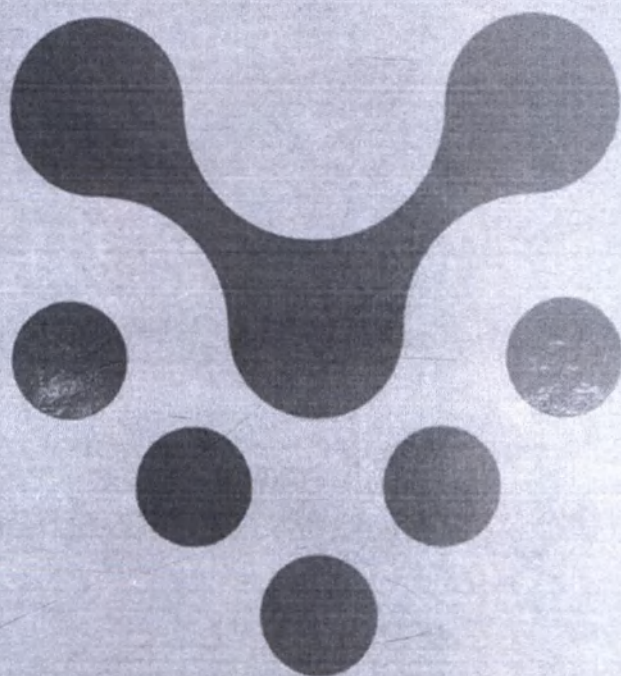



RESPONSE BIOMEDICAL CORP.

1781 – 75th Avenue West

Vancouver, BC V6P 6P2, Canada

Tel: 1.888.591.5577 North America (toll free)

Tel: 1.604.456.6010 International

Email: customersupport@responsebio.com



24-HOUR TECHNICAL SUPPORT

Tel: 1.866.525.7267 North America (toll free)

Tel: 1.604.219.6119 International

Email: techsupport@responsebio.com

WWW.RESPONSEBIO.COM



RESPONSE

BIOMEDICAL

WWW.RESPONSEBIO.COM

Маркировка, наносимая на потребительскую упаковку. Вид сбоку.



SPEED




PRECISION



ACCURACY



Тест-кассета и наконечник в фольгированной упаковке с осушителем

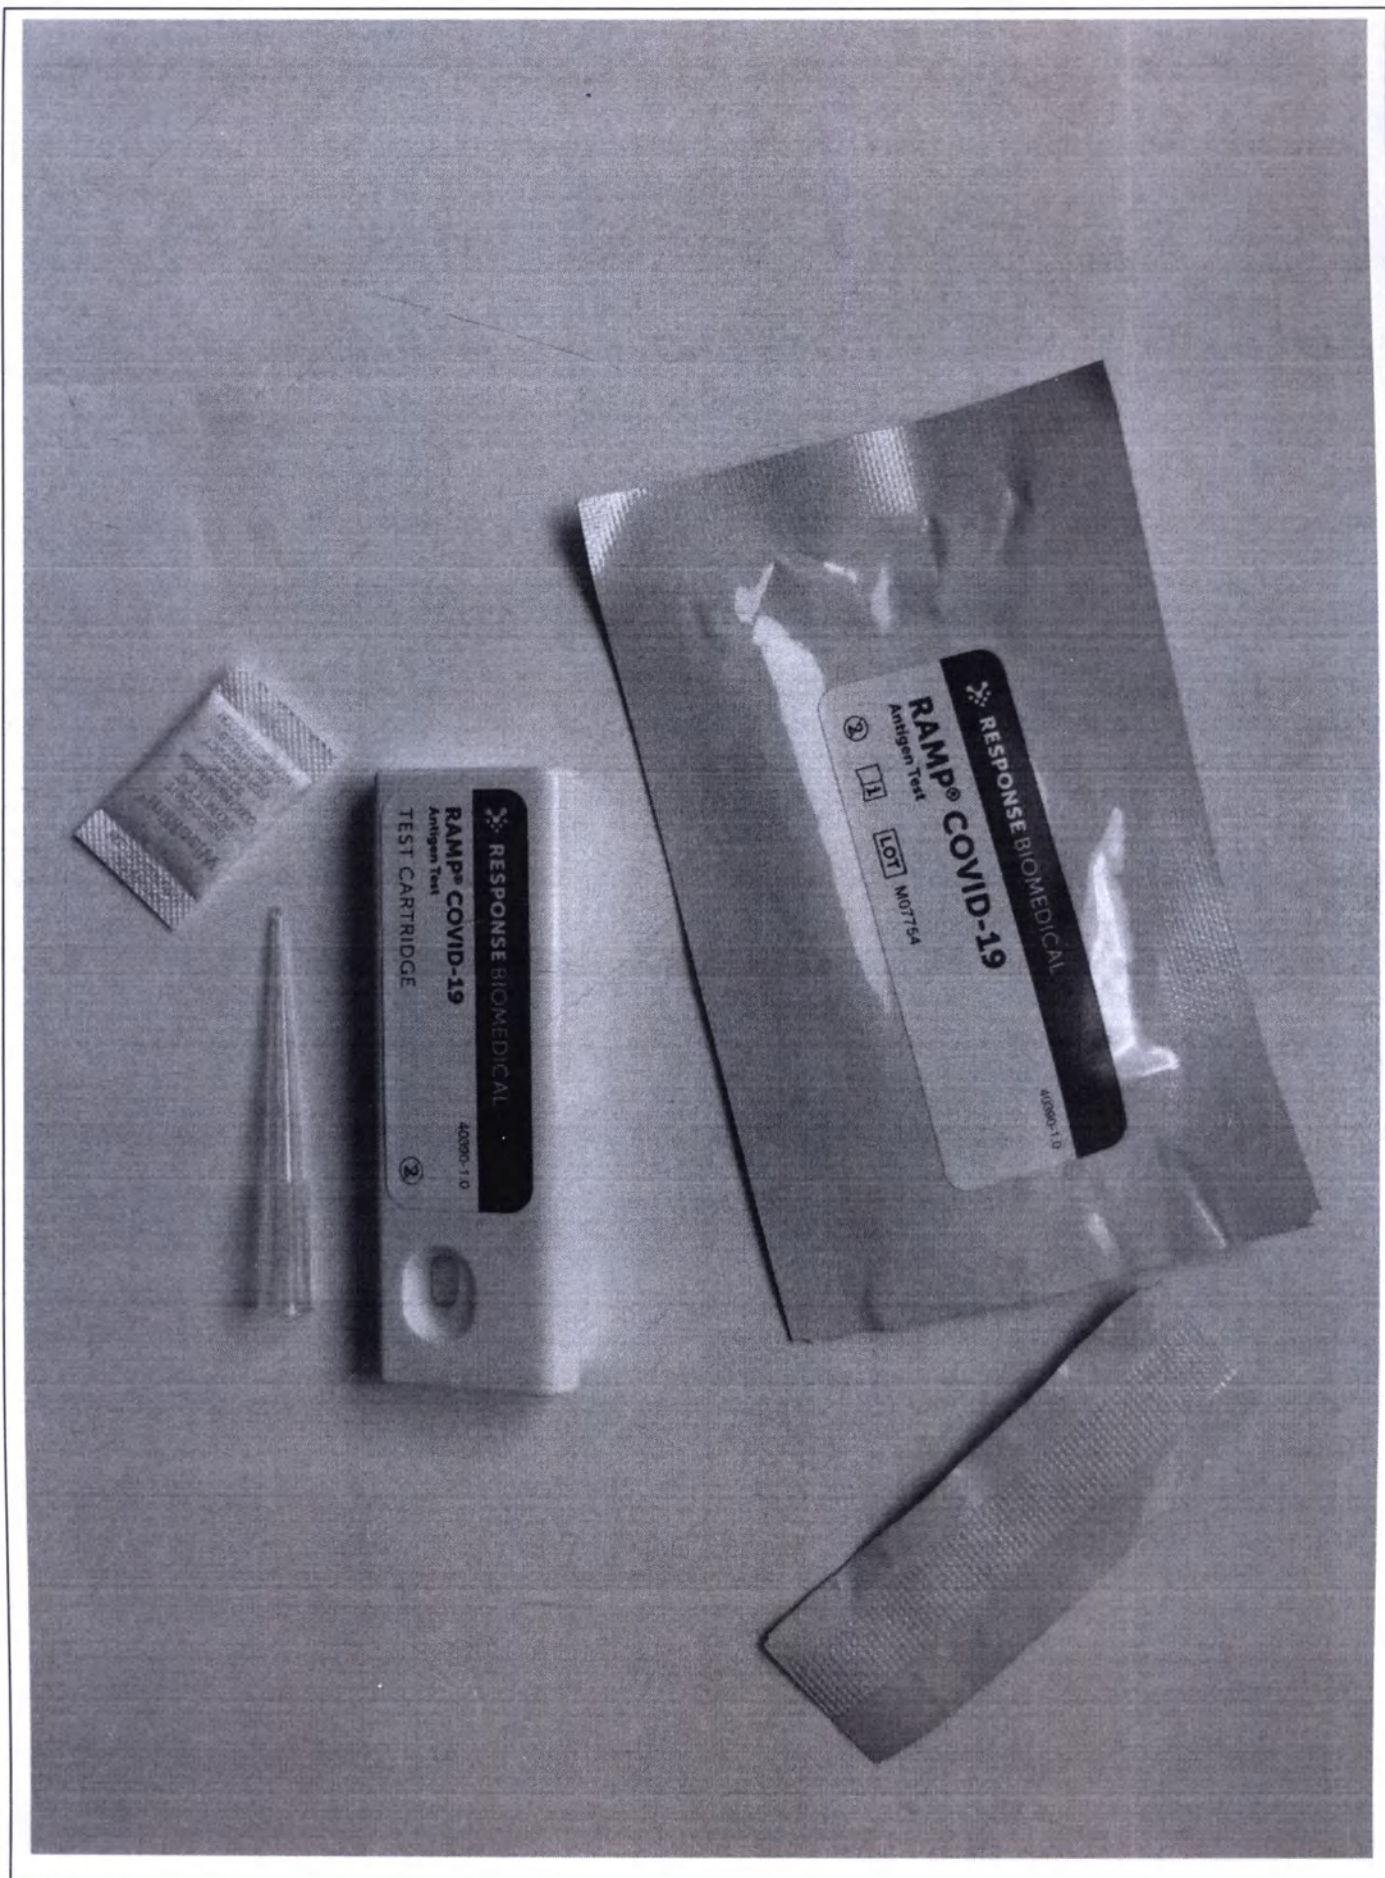

 **RESPONSE** BIOMEDICAL

RAMP® COVID-19

40390-1.0

Antigen Test

TEST CARTRIDGE



внешний вид тест-кассеты

Маркировка и внешний вид раствора буферного для разведения образцов объёмом 1,3 мл в пробирке





Puritan®
Quality since 1919

Symbols glossary: www.puritanmedproducts.com/symbols-glossary

Sterile Foam Tipped Applicator

 Puritan Medical Products Company LLC
31 School Street, Guilford, Maine 04443-0149


MADE IN USA

REF 25-1506 1PFB 20

CE 2797


MD

EC REP EMERGO EUROPE
The Hague, The Netherlands



STERILE EO

HP P319 R1 01/21




(01)00609576010330

(17)2026-02-01

LOT (10)S0001

аркировка, наносимая на тампон для взятия биоматериала в индивидуальной упаковке


Внешний вид тампона для взятия биоматериала в индивидуальной упаковке

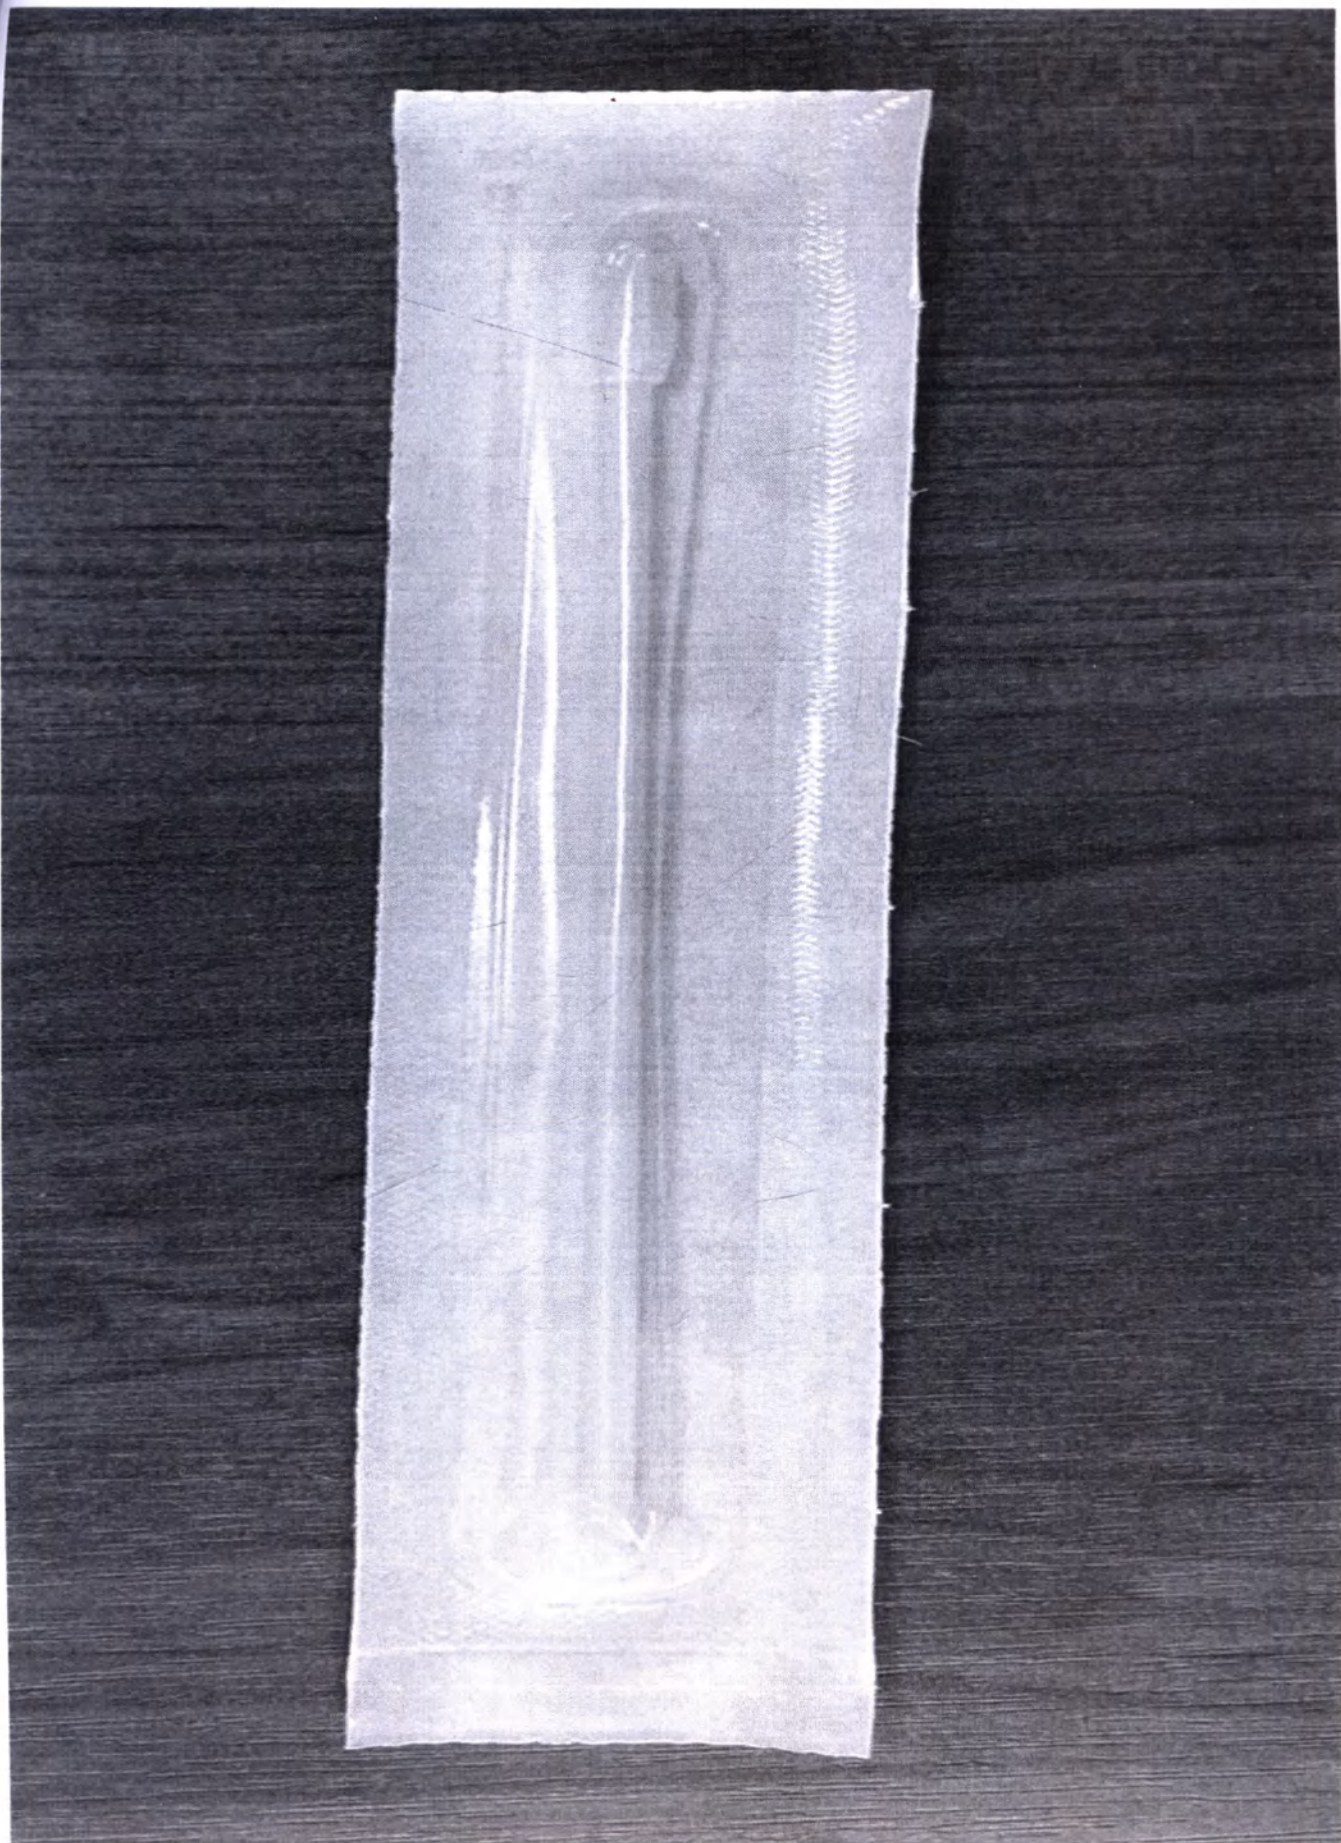


Тампон для взятия биоматериала



аркировка, наносимая на Образец контрольный положительный

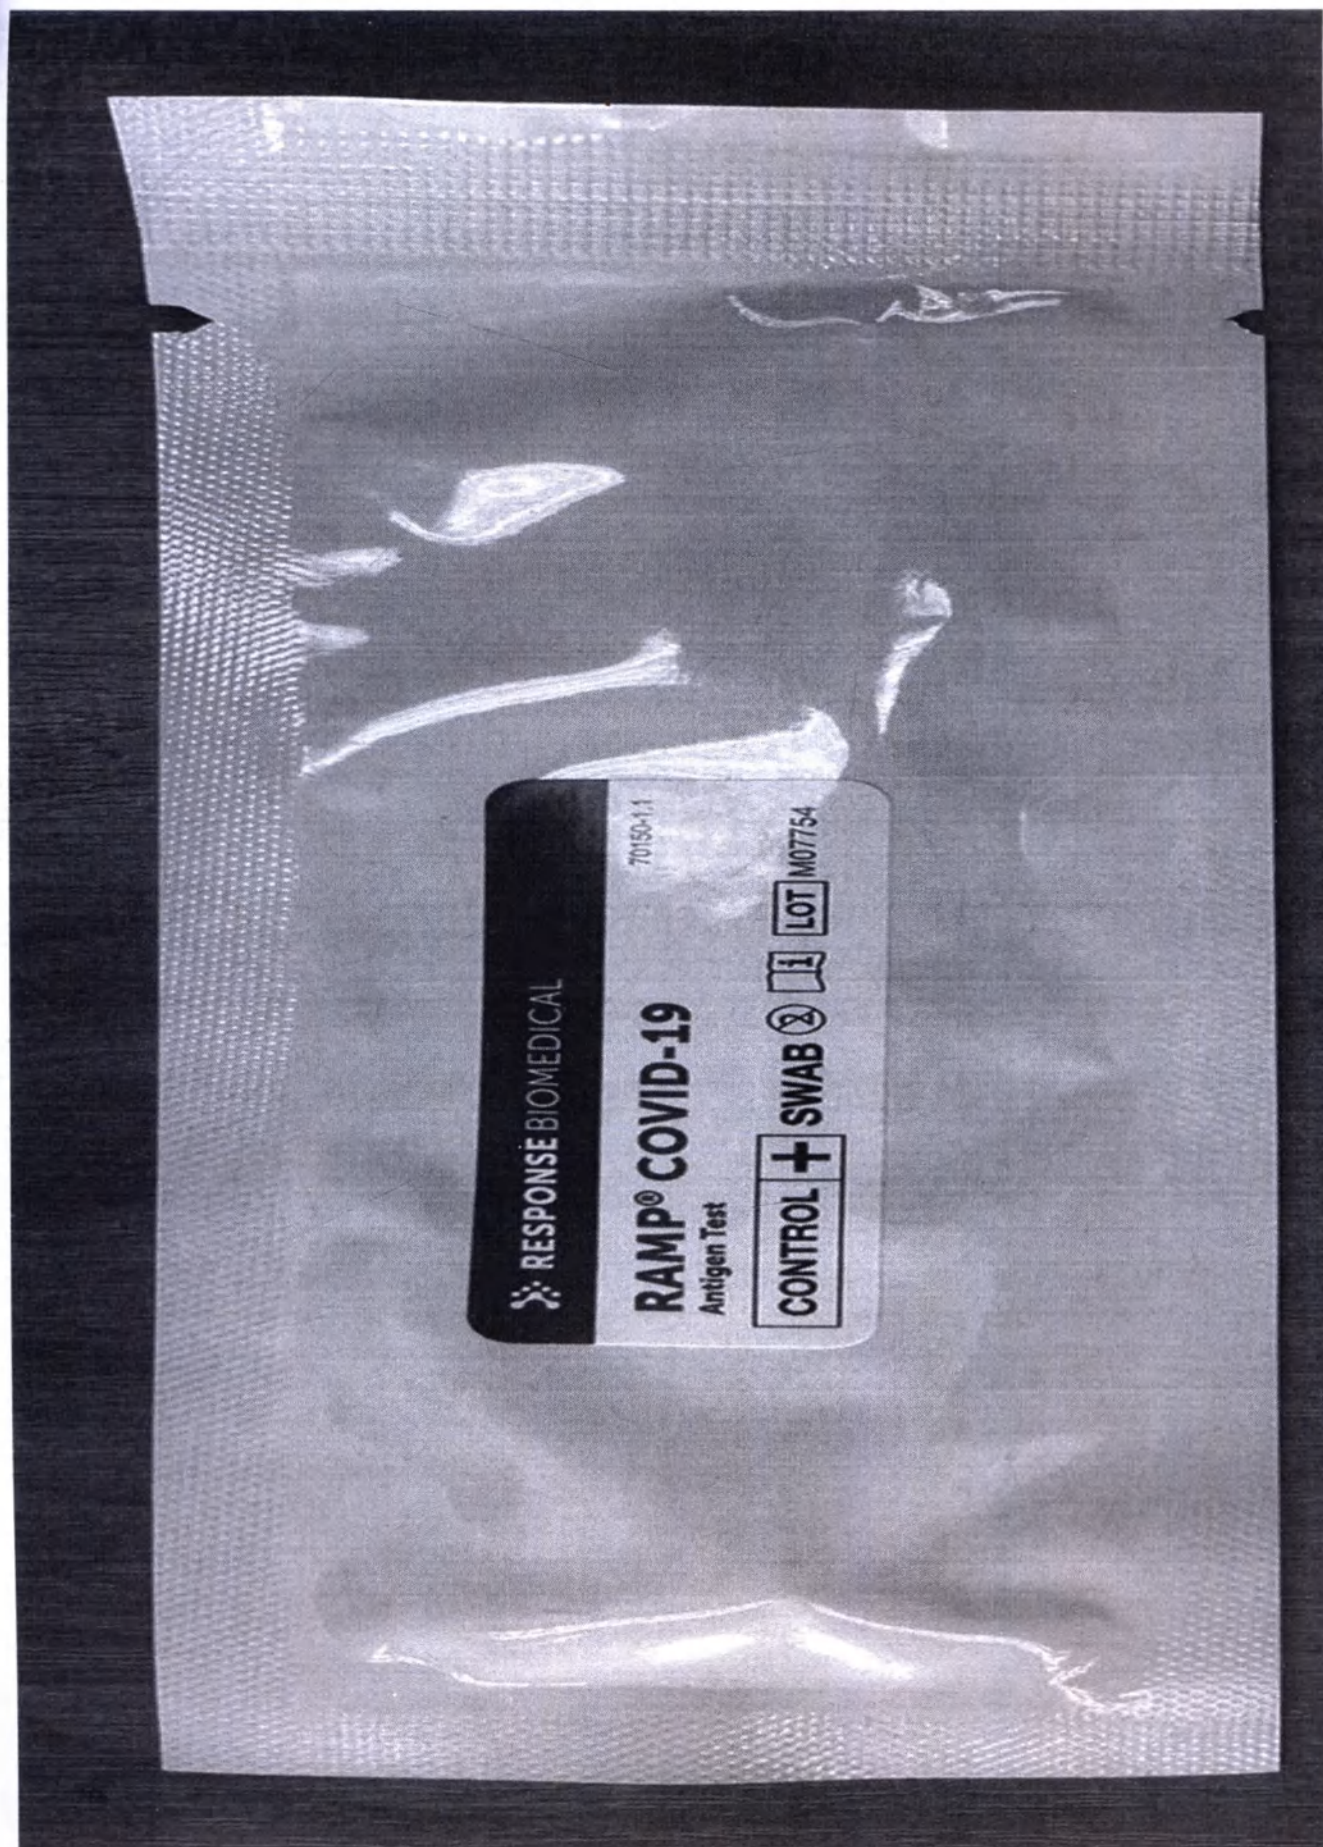

Маркировка, наносимая на Образец контрольный отрицательный

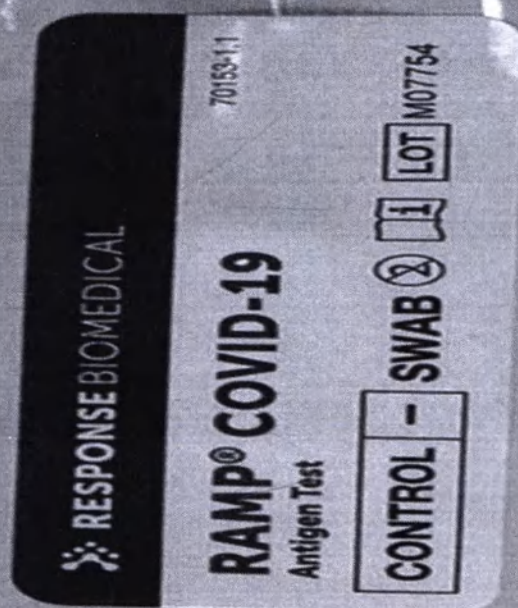

Внешний вид устройства для внесения образца объёмом 75 мкл



Маркировка, наносимая на первичную упаковку карточки серии в индивидуальной упаковке



ATTENTION
OBSERVE PRECAUTIONS
FOR HANDLING
ELECTROSTATIC
SENSITIVE DEVICES

Маркировка, наносимая на карточку серии в индивидуальной упаковке



внешний вид карточки серии в индивидуальной упаковке



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Набор реагентов для качественного экспресс-определения
антигена SARS-CoV-2 в назальном мазке (RAMP COVID-19
Antigen Test)

Инструкция по применению

Всего документов,
проставлено и скреплено
печатью 23 листов.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

БАЛАБАЕВ С.А.

