

ПОДТВЕРЖДАЮ

Супервайзер по регистрации
ООО «Джонсон & Джонсон»



Горбенко Горбенко Е. А.


«20» декабря 2022 г.

Фотографические изображения медицинского изделия


Насадка для диссекции и коагуляции «Энсил» к генератору
электрохирургическому, ультразвуковому G11

2022 г.


Насадка для диссекции и коагуляции EnSeal G2 с прямыми браншами для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 14 см, 25 см, 35 см, 45 см.; Насадка для диссекции и коагуляции EnSeal G2 с изогнутыми браншами для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 14 см, 25 см, 35 см, 45 см на примере варианта исполнения: Насадка для диссекции и коагуляции EnSeal G2 с изогнутыми браншами для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 45 см.

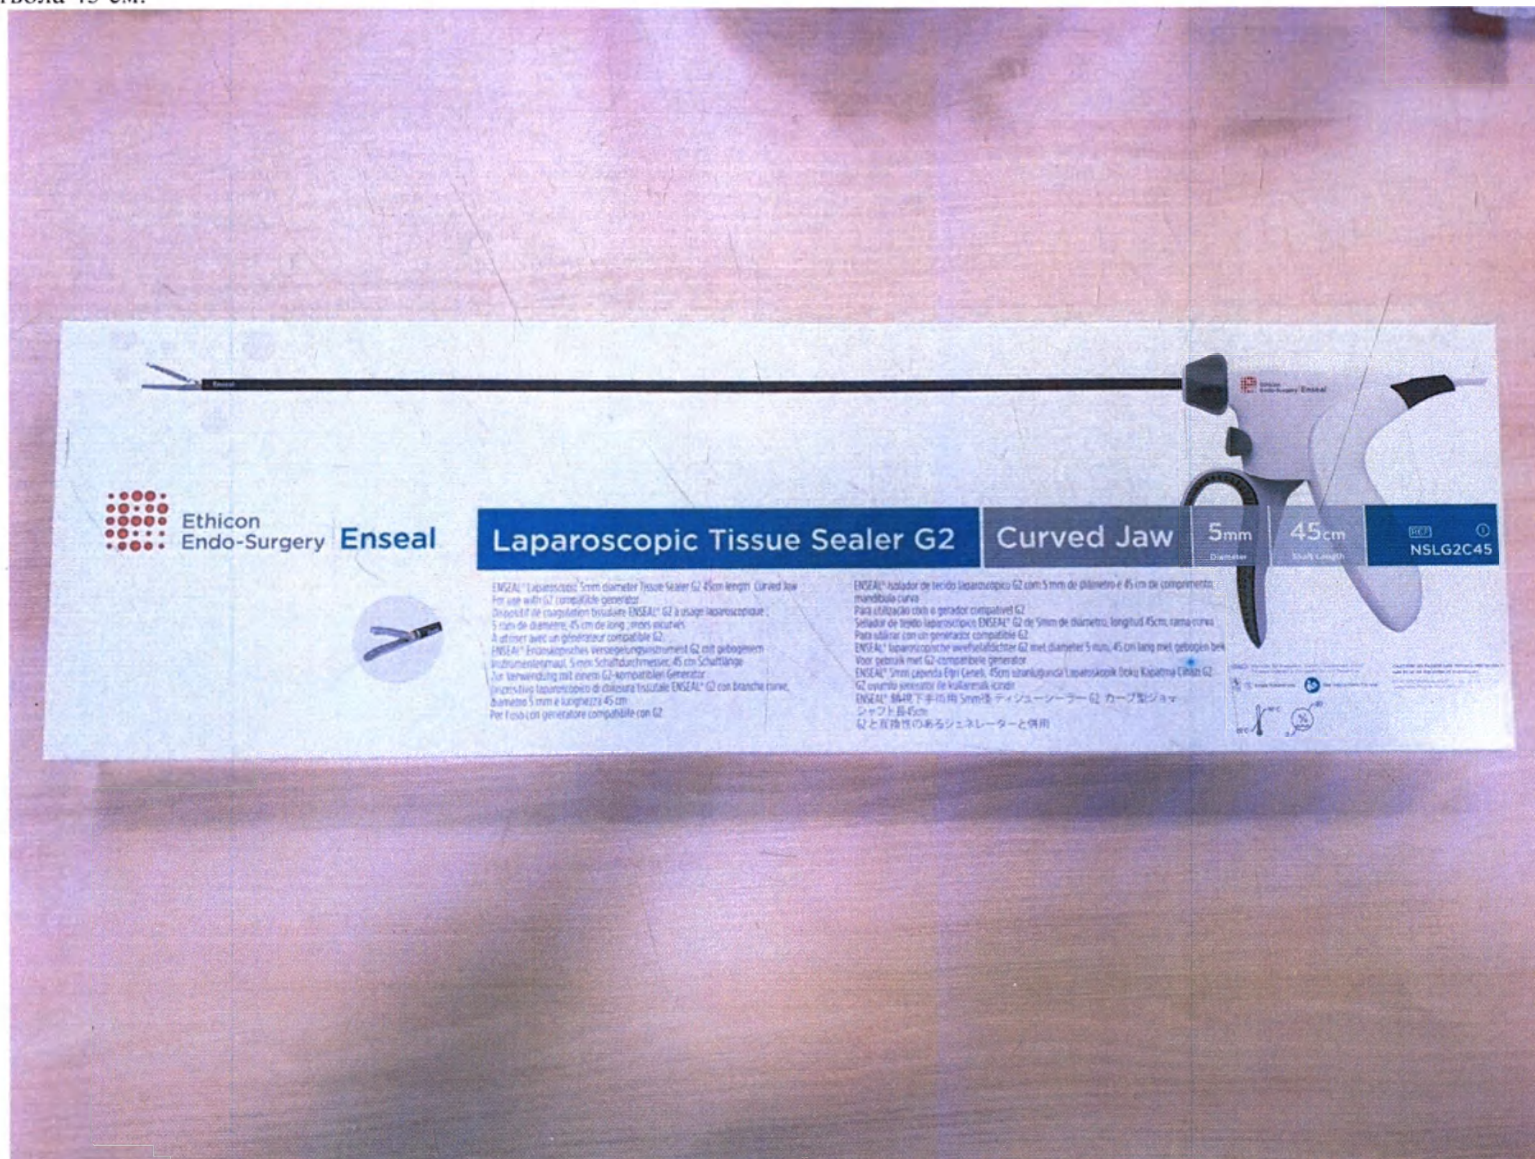


Пользовательская упаковка

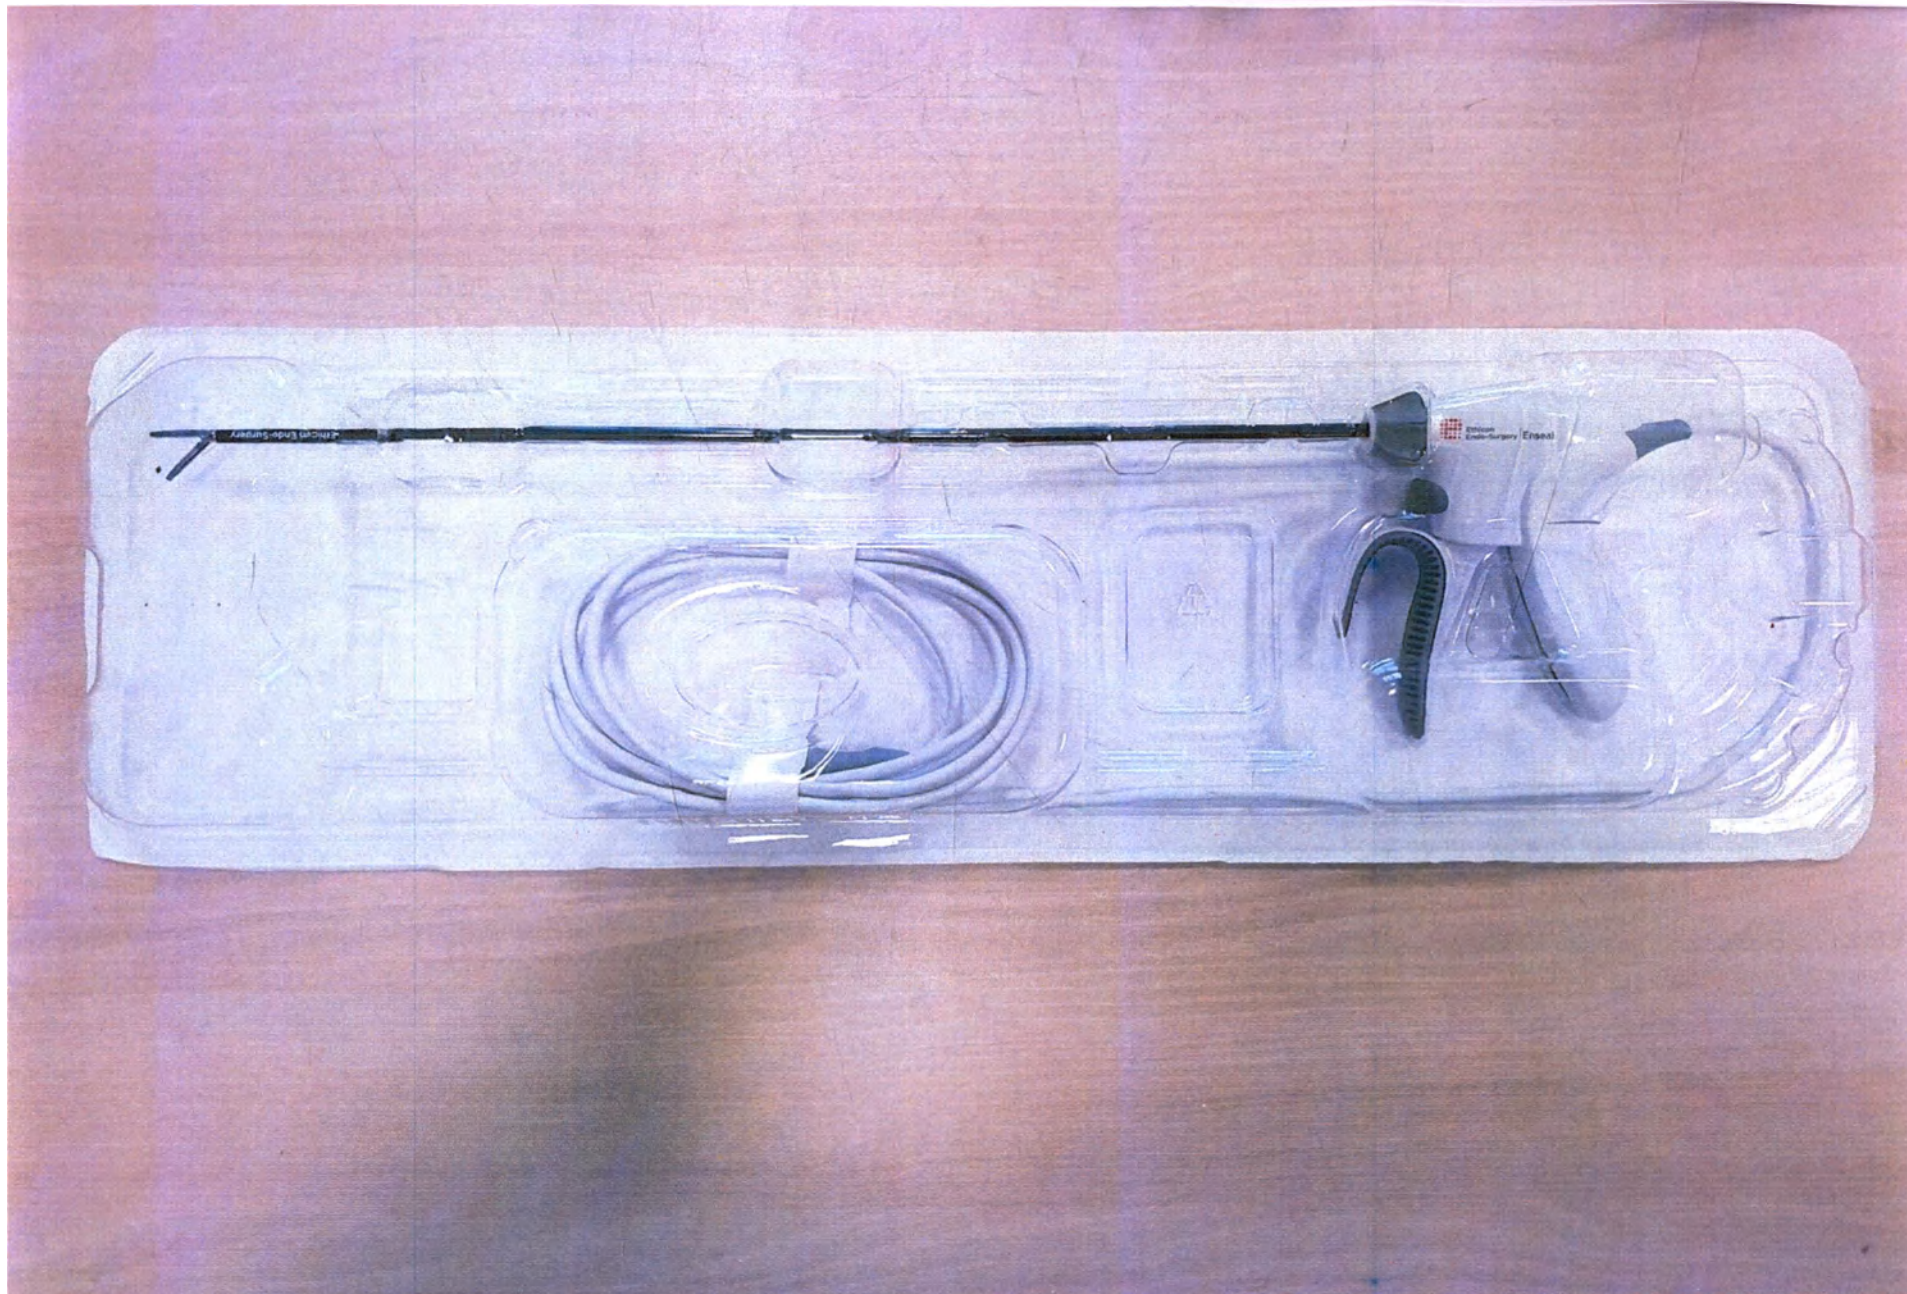

Стерильная упаковка

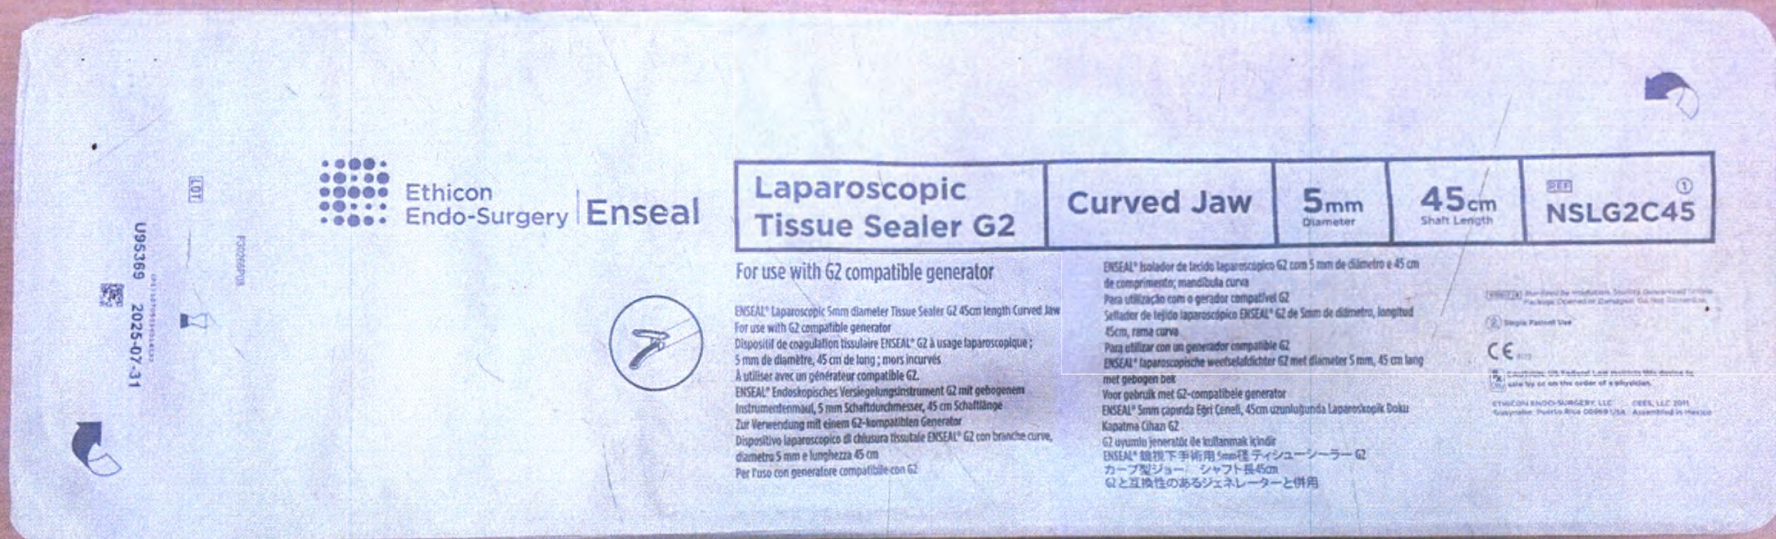

Маркировка стерильной упаковки

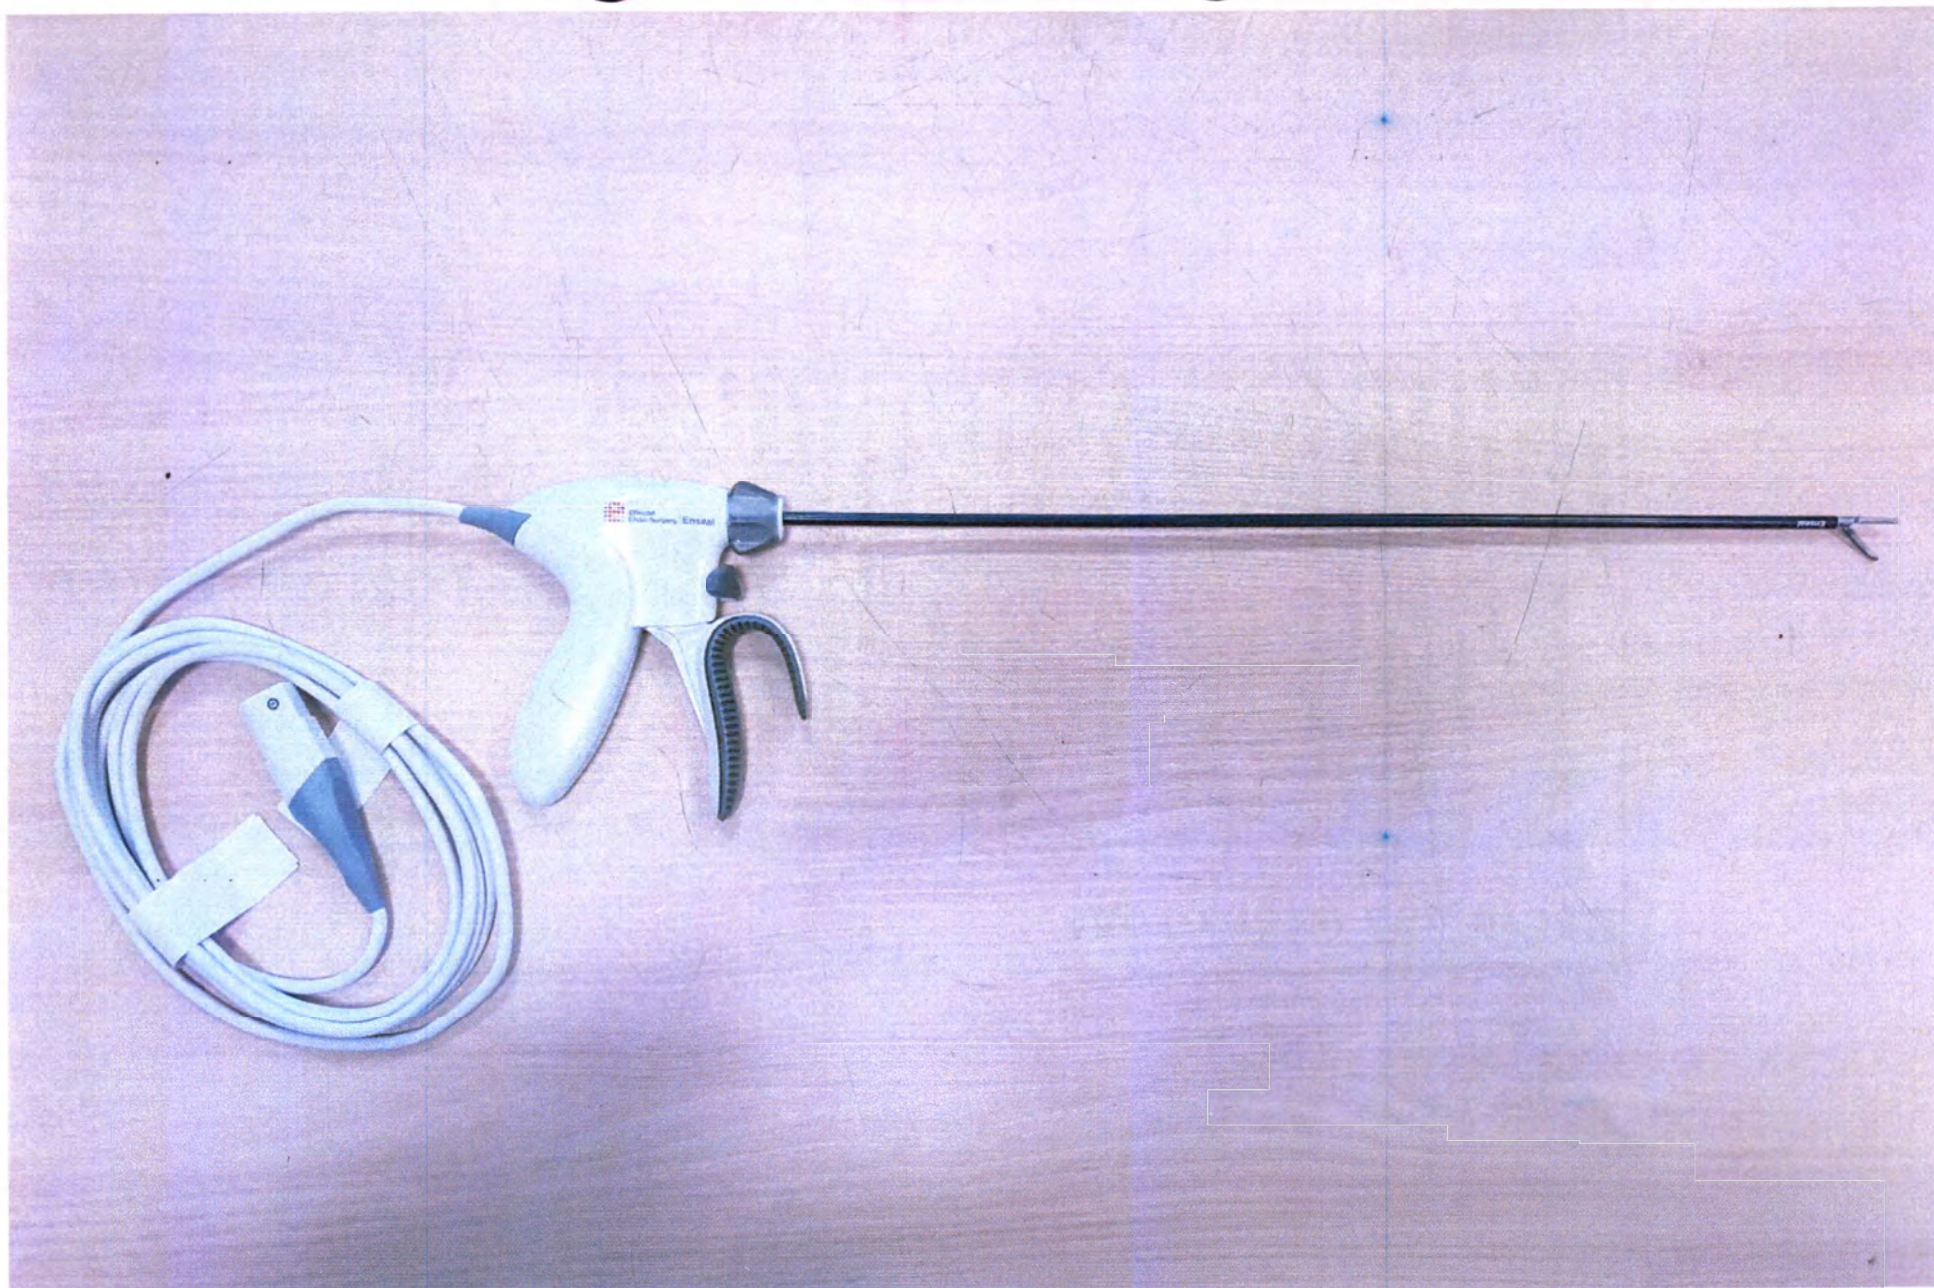

Насадка для диссекции и коагуляции EnSeal G2 с изогнутыми браншами для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 45 см

Место для штрих-кода

REF NSLG2C45

Насадка для диссекции и коагуляции
"Энсил" к генератору
электрохирургическому,
ультразвуковому G11, вариант
исполнения: Насадка для диссекции и
коагуляции EnSeal G2 с изогнутыми
браншами для открытых и
лапароскопических операций, длина
ствола 45 см.

Область применения: Хирургия

Регистрационное удостоверение: XXX
XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX



Ethicon Endo-Surgery, LLC, 475
Calle C, Guaynabo, PR 00969 USA
(США)

Уполномоченный представитель
производителя, адрес: ООО "Джонсон &
Джонсон", 121614, Россия, г. Москва, ул.
Крылатская, д. 17, корп. 2, тел:
+7(495)5807777

Форма бранш: изогнутая

Количество штук в упаковке: см. на
упаковке

Диаметр ствола: 5мм, Длина ствола
45см

Код партии: см. на упаковке


Использовать до: см. на упаковке

Срок годности: 5 лет




Макет русскоязычной маркировки


Насадка для диссекции и коагуляции EnSeal G2 с прямыми браншами артикуляционная для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 35 см, 45 см; Насадка для диссекции и коагуляции EnSeal G2 с изогнутыми браншами артикуляционная для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 35 см, 45 см на примере варианта исполнения: Насадка для диссекции и коагуляции EnSeal G2 с изогнутыми браншами артикуляционная для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 45 см.

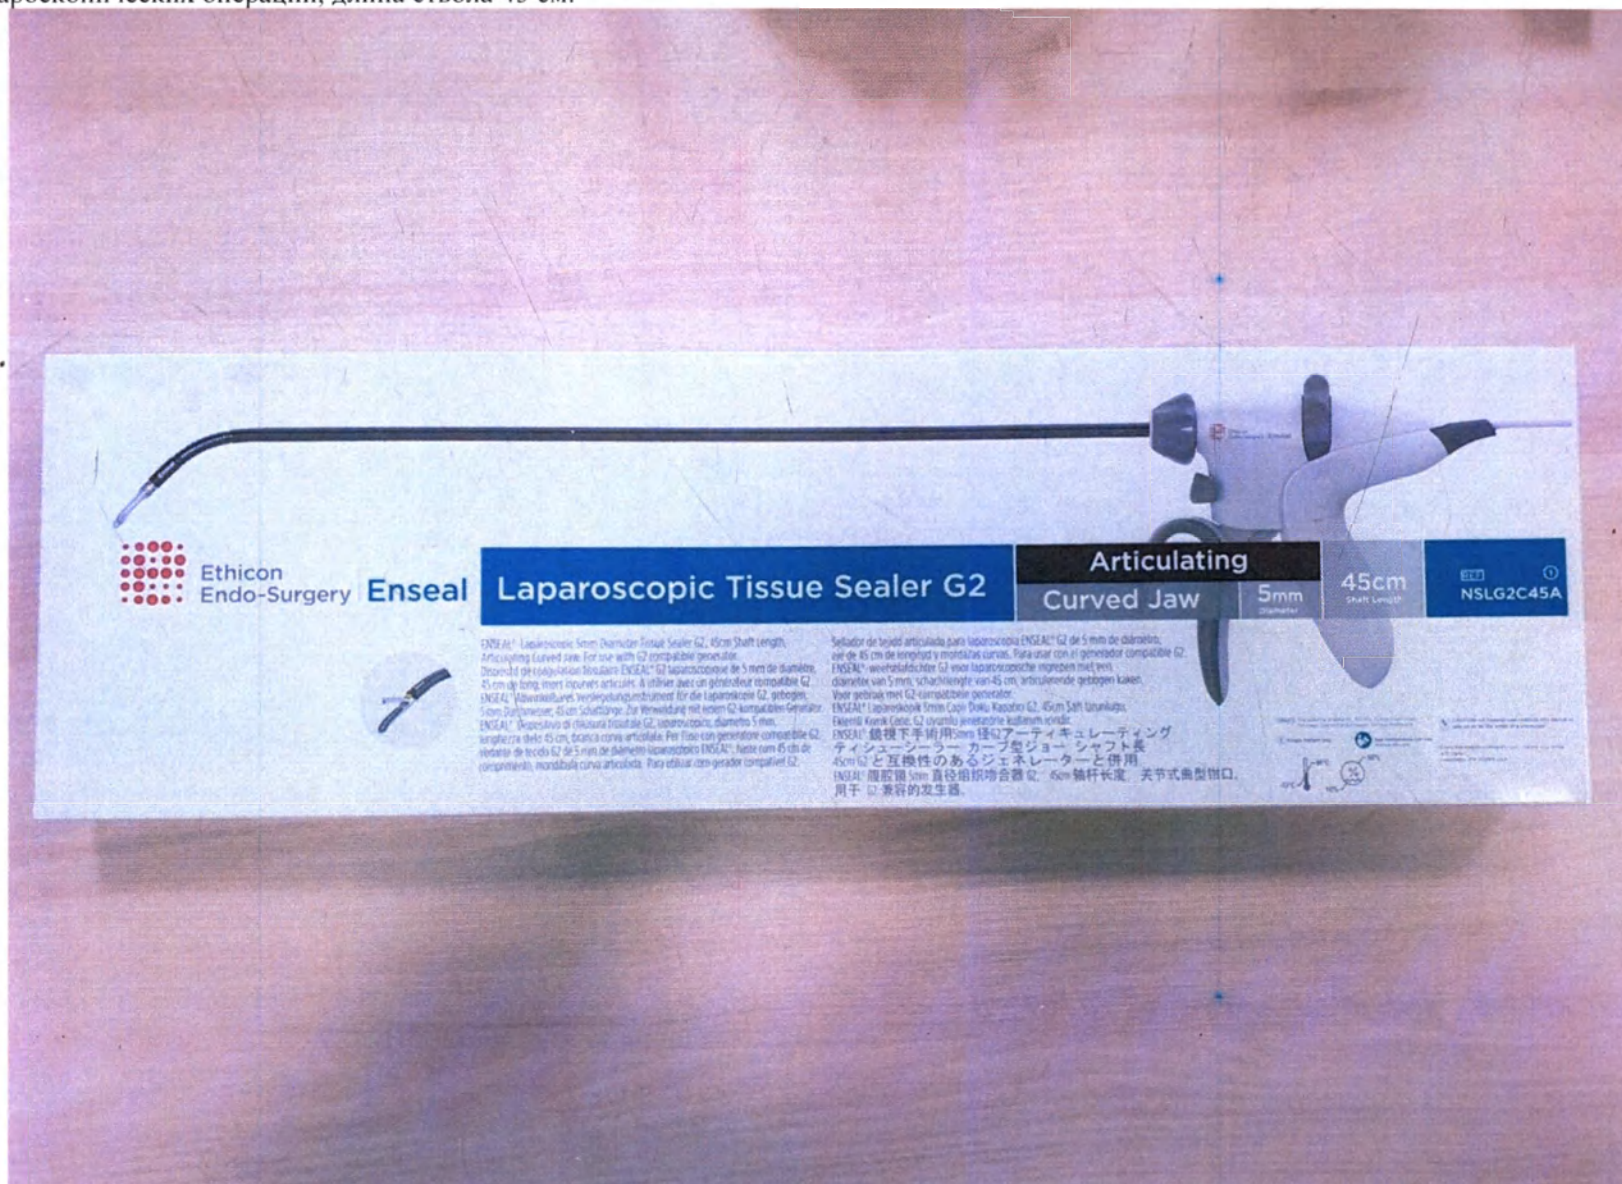

Пользовательская упаковка

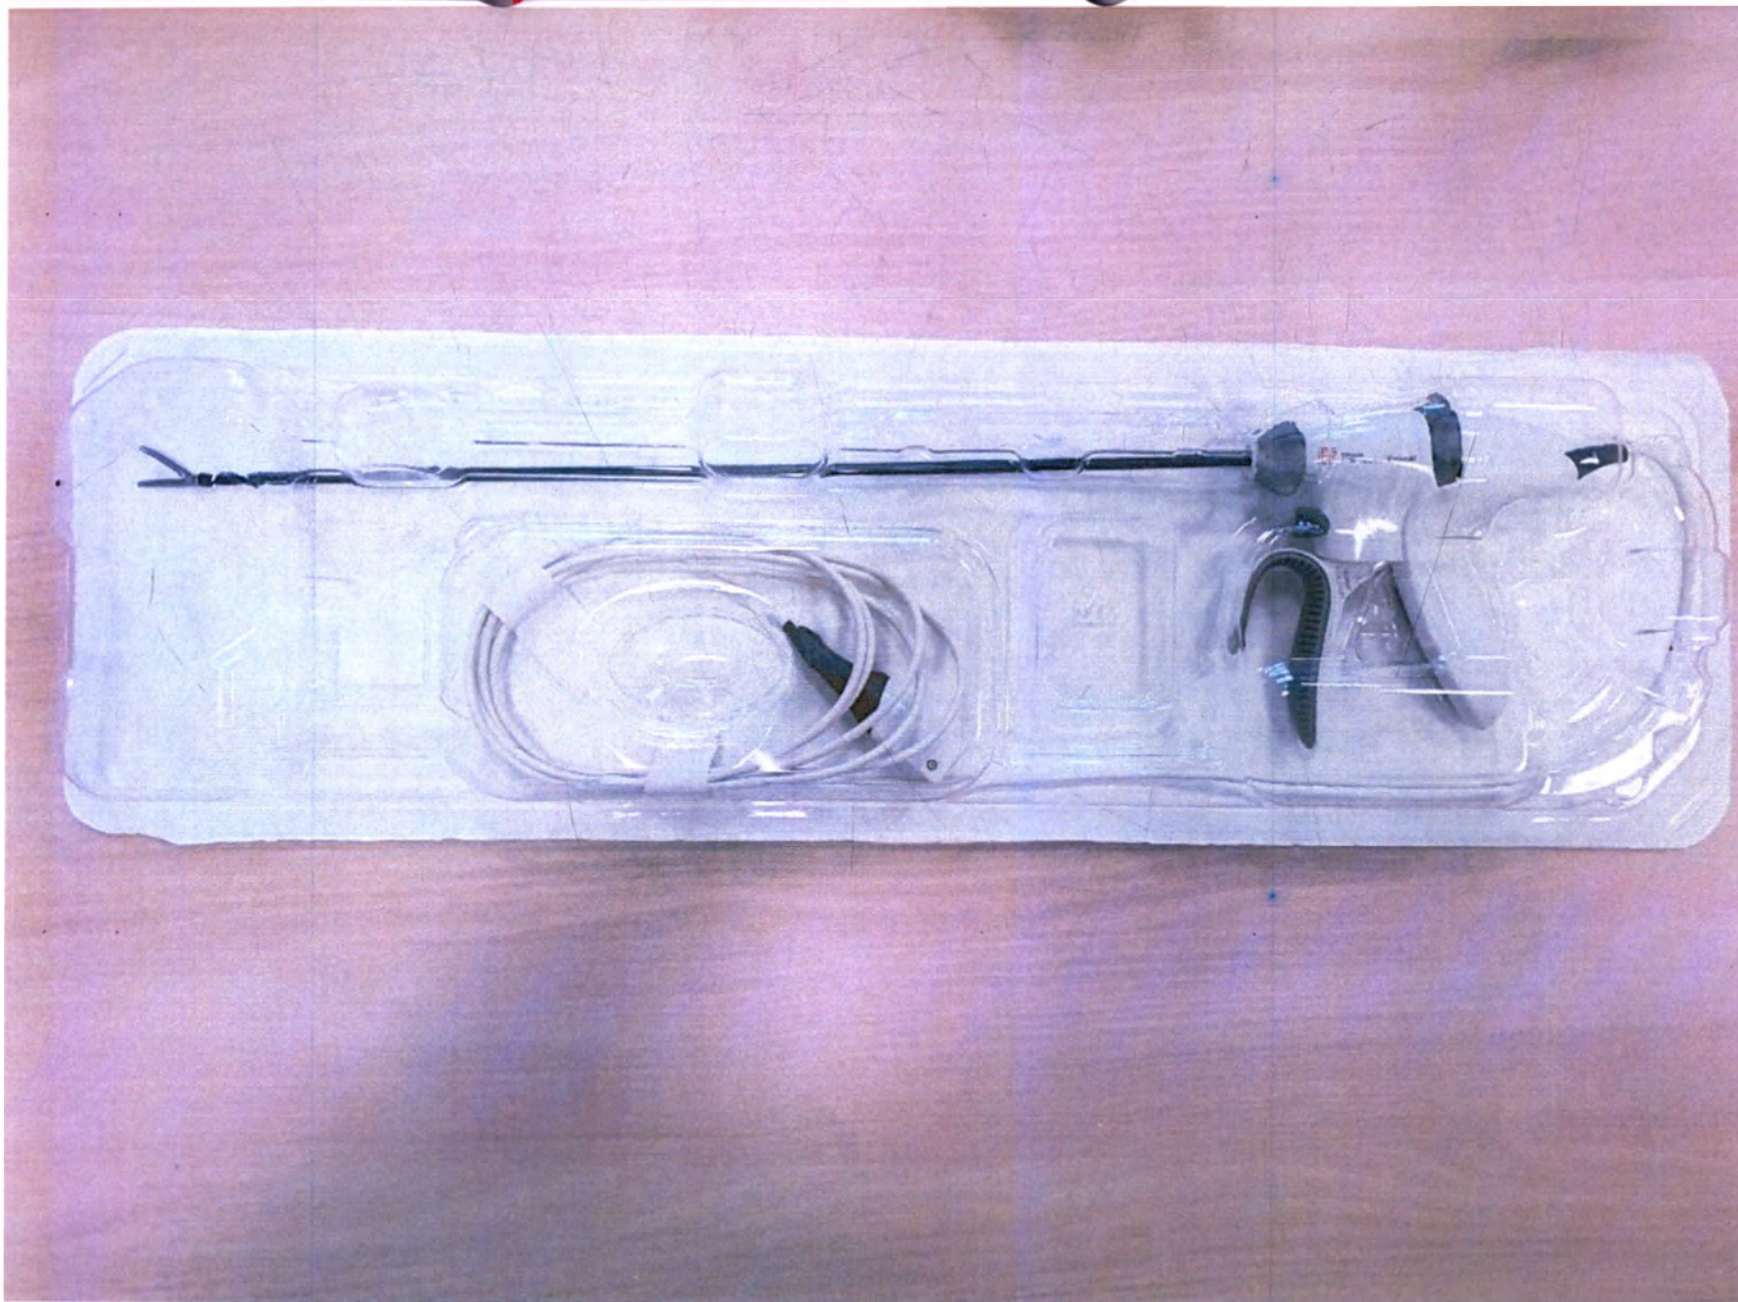

Стерильная упаковка

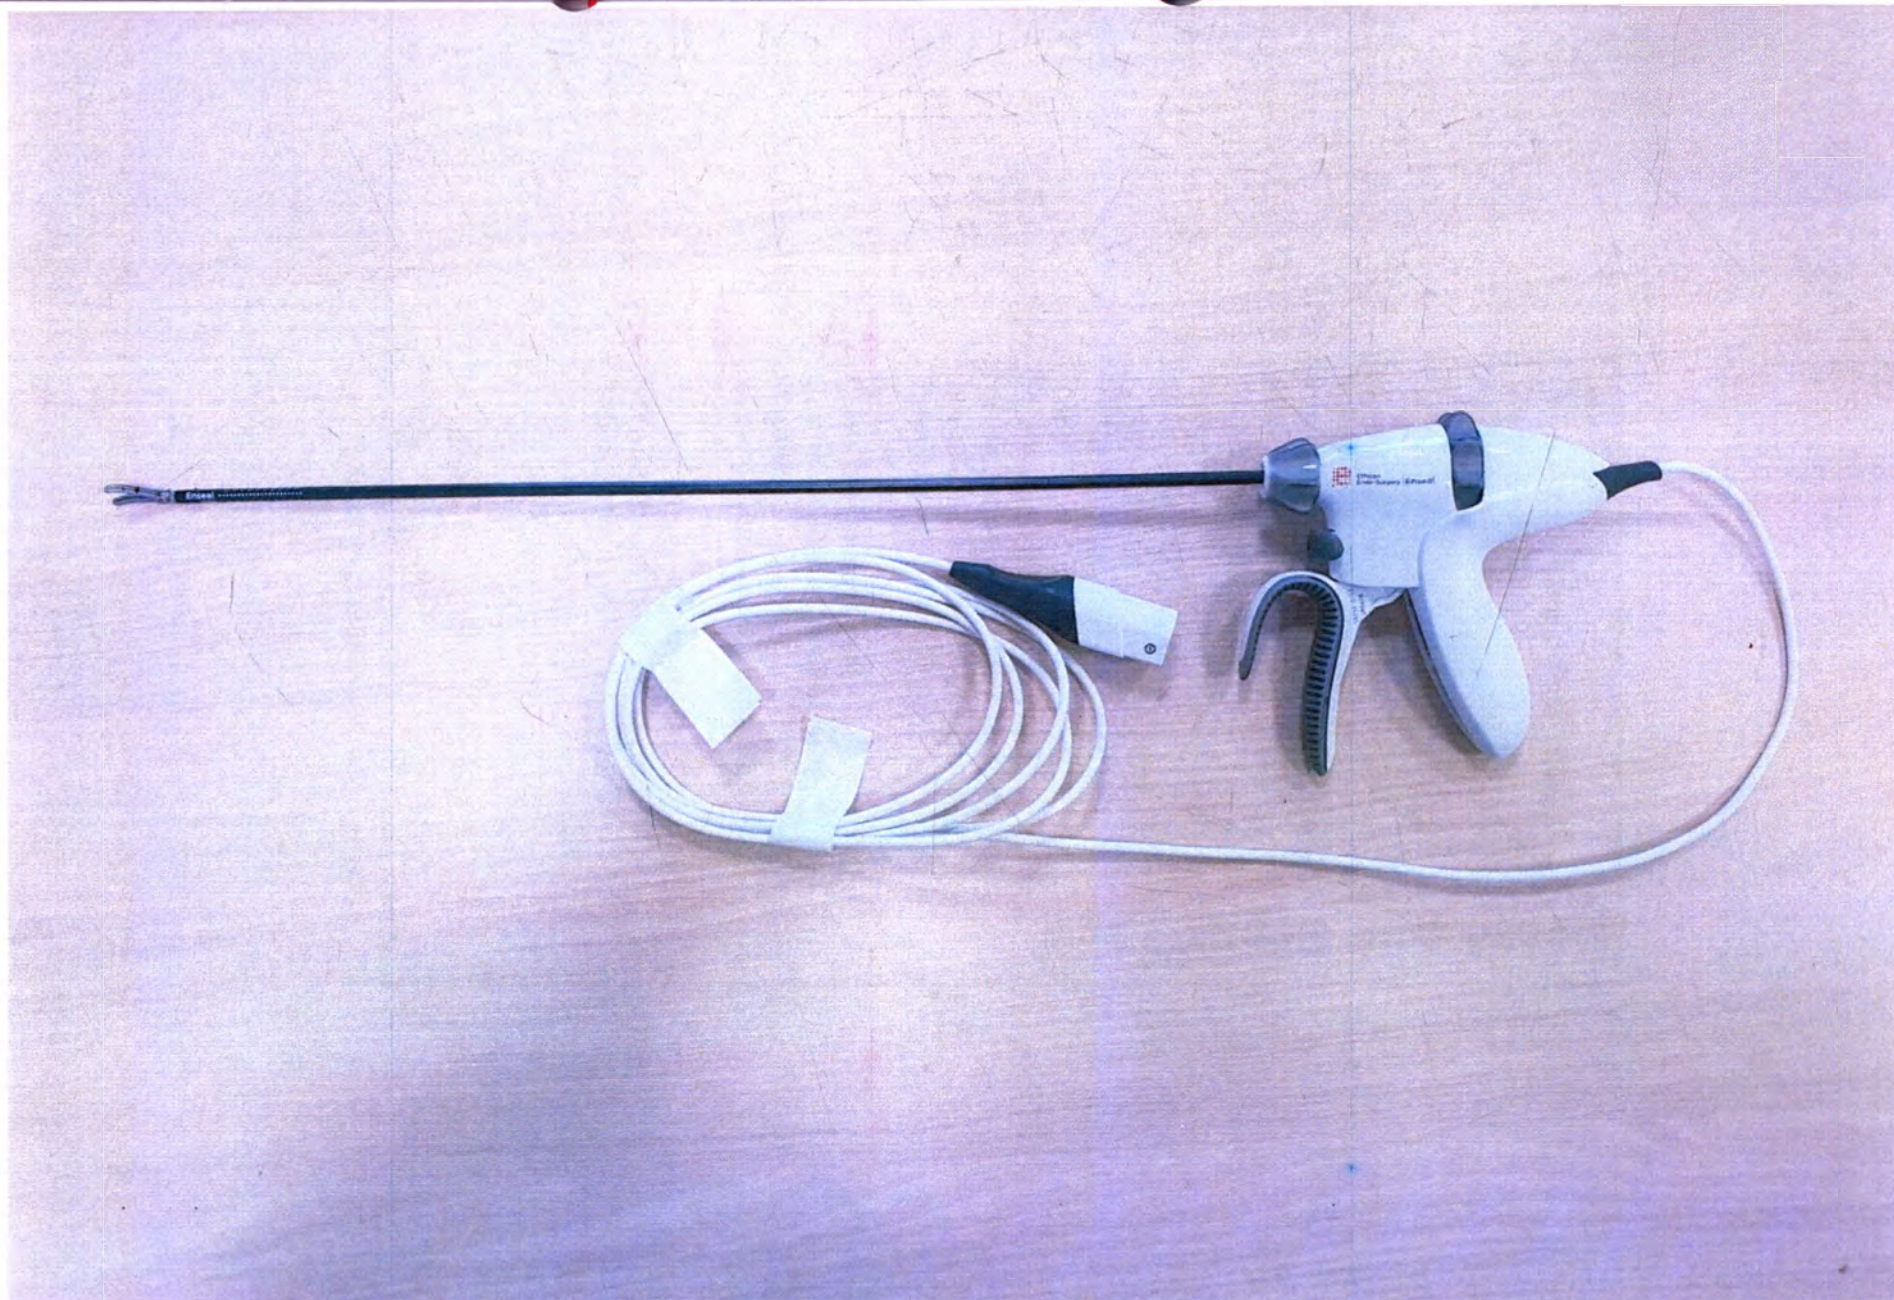

Насадка для диссекции и коагуляции EnSeal G2 с изогнутыми браншами артикуляционная для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 45 см

Место для штрих-кода

REF NSLG2C45A

Насадка для диссекции и коагуляции
"Энсил" к генератору
электрохирургическому,
ультразвуковому G11, вариант
исполнения: Насадка для диссекции и
коагуляции EnSeal G2 с изогнутыми
браншами артикуляционная для
открытых и лапароскопических операций,
длина ствола 45 см.

Область применения: Хирургия

Регистрационное удостоверение: XXX
XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

 Ethicon Endo-Surgery, LLC, 475
Calle C, Guaynabo, PR 00969 USA
(США)

Уполномоченный представитель
производителя, адрес: ООО "Джонсон &
Джонсон", 121614, Россия, г. Москва, ул.
Крылатская, д. 17, корп. 2, тел:
+7(495)5807777

Форма бранш: изогнутая

Количество штук в упаковке: см. на
упаковке

Диаметр ствола: 5мм, Длина ствола
45см

Код партии: см. на упаковке


Использовать до: см. на упаковке

Срок годности: 5 лет




Макет русскоязычной маркировки

Насадка для диссекции и коагуляции EnSeal X1 Large Jaw для открытых операций

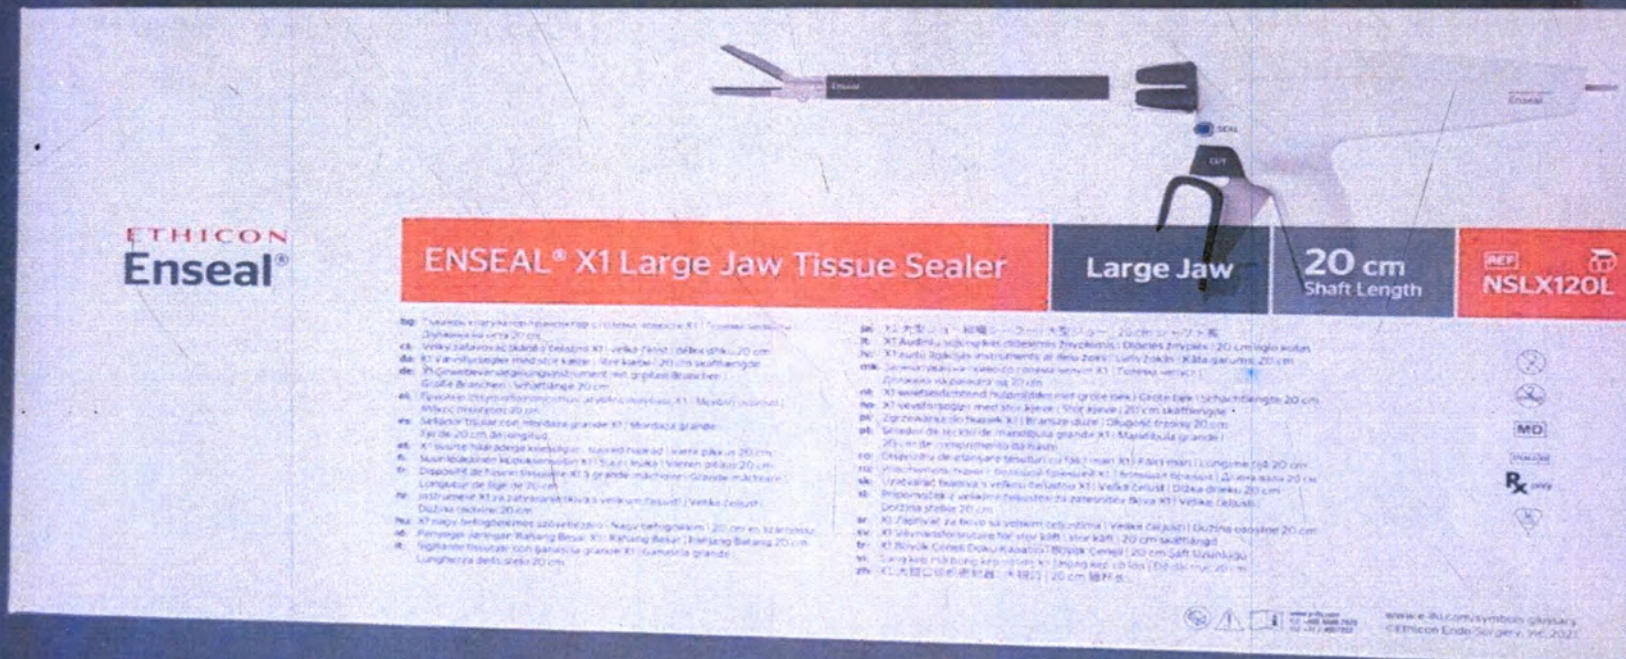

Пользовательская упаковка

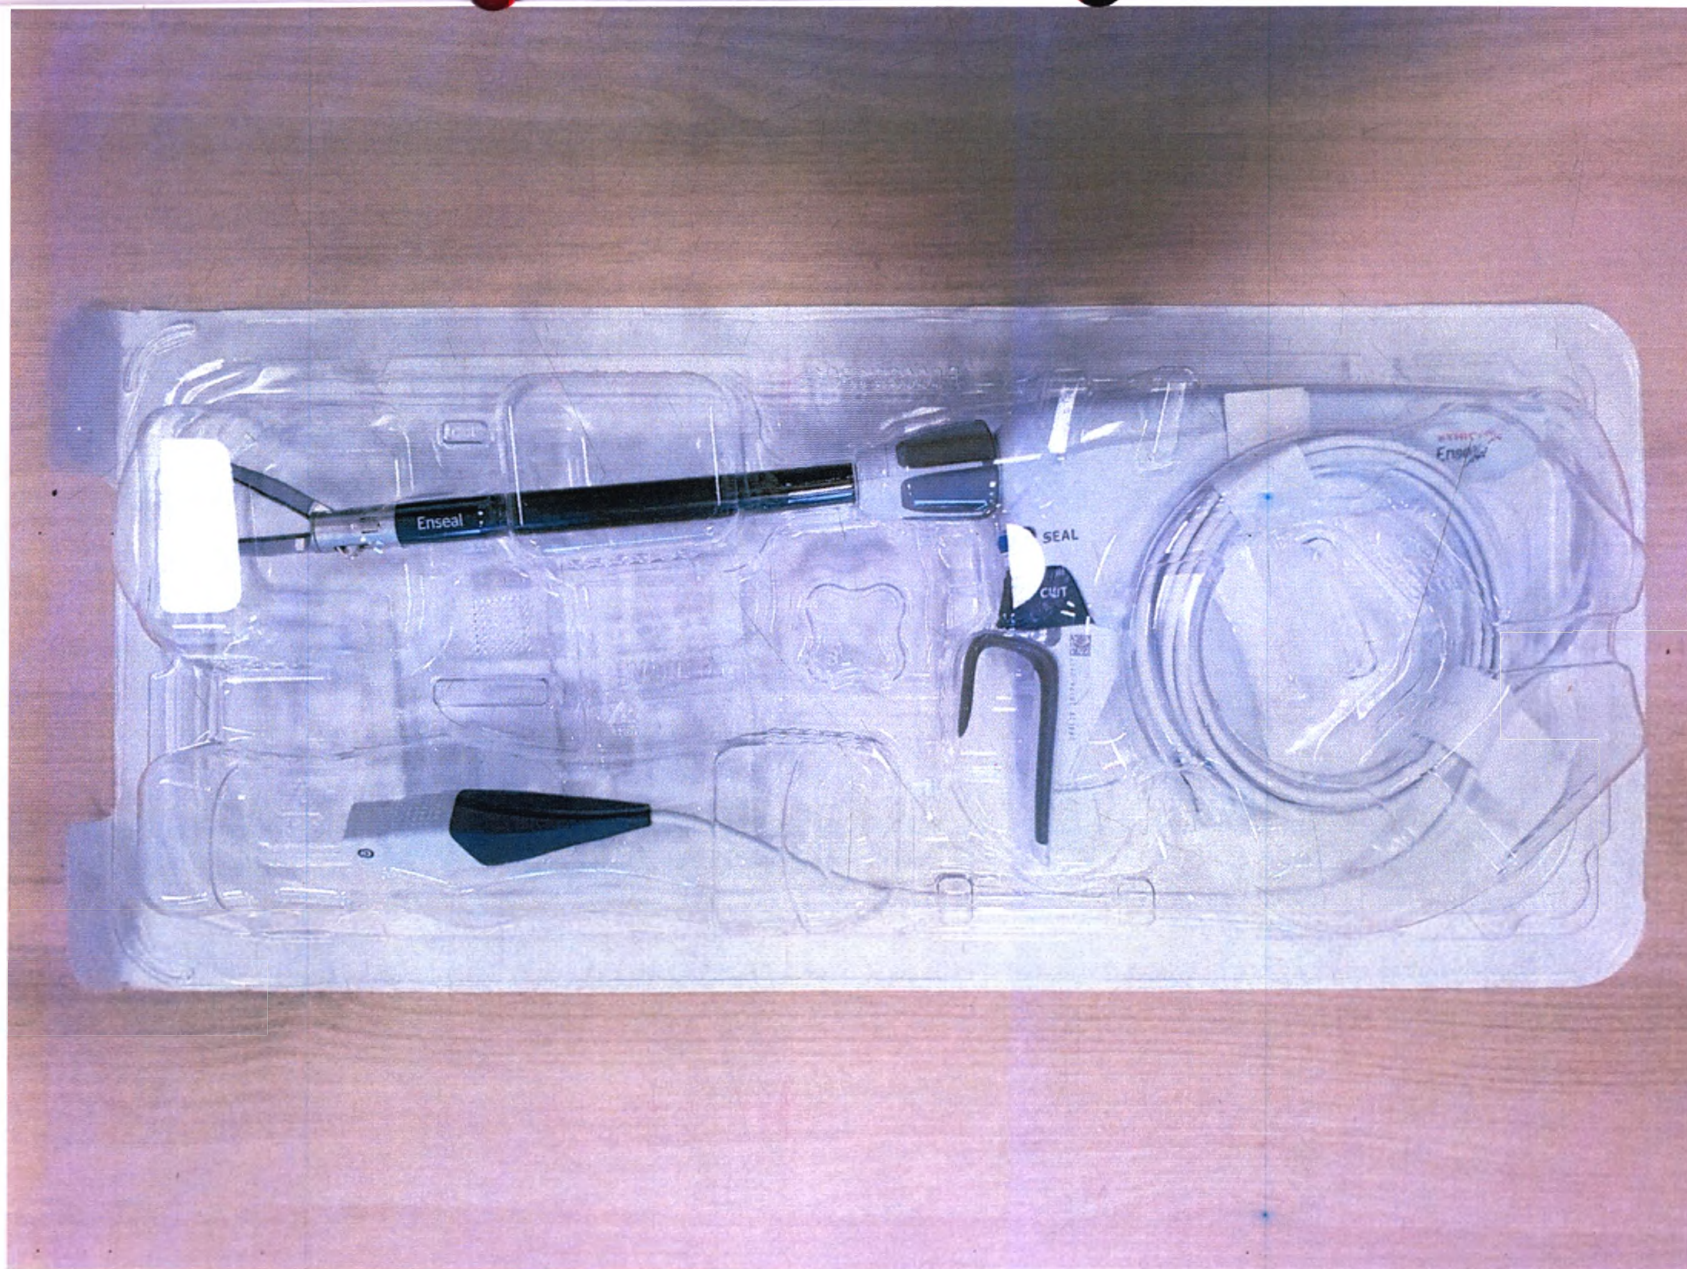

Стерильная упаковка

ETHICON™
Enseal®

ENSEAL® X1 Large Jaw Tissue Sealer

Large Jaw

20 cm
Shaft Length

REF
NSLX120L

bg: Тканев коагулатор-трансектор с големи челюсти X1 | Големи челюсти |
Дължина на оста 20 cm
ca: Velký zabívač tkáně s čelistmi X1 | Velká čelist | Délka dráky 20 cm
da: X1 Vævsforsægl med stor kæbe | Stor kæbe | 20 cm skaftlængde
de: X1 Gewebversiegelungsinstrument mit großen Branchen | Große Branchen | Schaftlänge 20 cm
el: Επυσώλη ισχυροχώνος ιστού με μεγάλη πιάτυνα X1 | Μεγάλη πιάτυνα |
Μήκος στύλπου: 20 cm
es: Sellador tisular con mordaza grande X1 | Mordaza grande |
Eje de 20 cm de longitud
et: X1 suurte haardega koagulur | Suured haard | Varre pikkus 20 cm
fi: Suurleukaanen kudoksensuljin X1 | Suuri leuka | Värren pituus 20 cm
fr: Dispositif de fusion tissulaire X1 à grande mâchoire | Grande mâchoire |
Longueur de tige de 20 cm
hr: Instrument X1 za zatvaranje tkiva s velikom čeljusti | Velika čeljust |
Dužina osovine 20 cm
hu: X1 nagy befogóelemes szövetszáró | Nagy befogóelem | 20 cm-es szárhossz
id: Penyeget Jaringan Rahang Besar X1 | Rahang Besar | Panjang Batang 20 cm
it: Sigillante tissutale con ganaschia grande X1 | Ganaschia grande | Lunghezza
dello stelo 20 cm
ja: X1 大型ジョー組織シーラー | 大型ジョー | 20 cm シャフト長

lt: X1 Audinių sujungiklis didelėmis žnyplėmis | Didelės žnyplės | 20 cm ilgio kotas
lv: X1 audu ligācijas instruments ar lielu žokli | Liels žoklis | Kāta garums: 20 cm
mk: Запечатувач на ткиво со голема челюст X1 | Голема челюст |
Должина на парката од 20 cm
nl: X1 weefsel dichtend hulpmiddel met grote bek | Grote bek |
Schachtelengte 20 cm
no: X1 vevsforsægl med stor kjeve | Stor kjeve | 20 cm skaftlengde
pl: Zgrzewarka do tkanki X1 | Bransze duże | Długość trzonu 20 cm
pt: Selador de tecido de mandíbula grande X1 | Mandíbula grande |
20 cm de comprimento da haste
ro: Dispozitiv de etanșare țesuturi cu țalci mari X1 | Țalci mari | Lungime tijă 20 cm
ru: Ущётчик тканей с большой бра-шей X1 | Большая бра-шея | Длина валя 20 см
sl: Uzatvarač tkani s veliko čeljustjo X1 | Velika čeljust | Dolžina drške 20 cm
sk: Pripomôčok z veľkou čeljustí na zatesnenie tkiva X1 | Veľká čeljust |
Dĺžina stebra 20 cm
sr: X1 Zaptivač za tkivo sa velikim čeljustima | Velike čeljusti |
Dužina osovine 20 cm
sv: X1 Vävnadsförslutare för stor käft | Stor käft | 20 cm skaftlängd
tr: X1 Büyük Çeneli Doku Kapatıcı | Büyük Çeneli | 20 cm Şaft Uzunluğu
vi: Súng kẹp mô họng kẹp có lớn X1 | Họng kẹp có lớn | Độ dài trục 20 cm
zh: X1 大盤口組織密封器 | 大盤口 | 20 cm 轴杆长



CE 0123

Rx only


5005 10224

2022-06-30 W7017Z 2027-05-31

LOT

UDS

Ethicon-Endo-Surgery, LLC
475 Calle C
Guaynabo, PR 00969 USA
1-877-ETHICON
+1-633-337-5901 (English)
Assembled in Mexico



www.ethicon.com/symbols-glossary
©Ethicon-Endo-Surgery, Inc. 2021

Маркировка стерильной упаковки



Насадка для диссекции и коагуляции EnSeal X1 Large Jaw для открытых операций

Место для штрих-кода


REF NSLX120L

Насадка для диссекции и коагуляции
"Энсил" к генератору
электрохирургическому,
ультразвуковому G11, вариант
исполнения: Насадка для диссекции и
коагуляции EnSeal X1 Large Jaw для
открытых операций.
Область применения: Хирургия
Регистрационное удостоверение: XXX
XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

 Ethicon Endo-Surgery, LLC, 475
Calle C, Guaynabo, PR 00969 USA
(США)


Уполномоченный представитель
производителя, адрес: ООО "Джонсон &
Джонсон", 121614, Россия, г. Москва, ул.
Крылатская, д. 17, корп. 2, тел:
+7(495)5807777

Количество штук в упаковке: см. на
упаковке
Диаметр ствола: 13мм, Длина ствола
20см
Код партии: см. на упаковке
Использовать до: см. на упаковке
Срок годности: 5 лет




Макет русскоязычной маркировки


Насадка для диссекции и коагуляции EnSeal X1 с изогнутыми браншами для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 25 см, 37 см, 45 см на примере варианта исполнения: Насадка для диссекции и коагуляции EnSeal X1 с изогнутыми браншами для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 45 см.

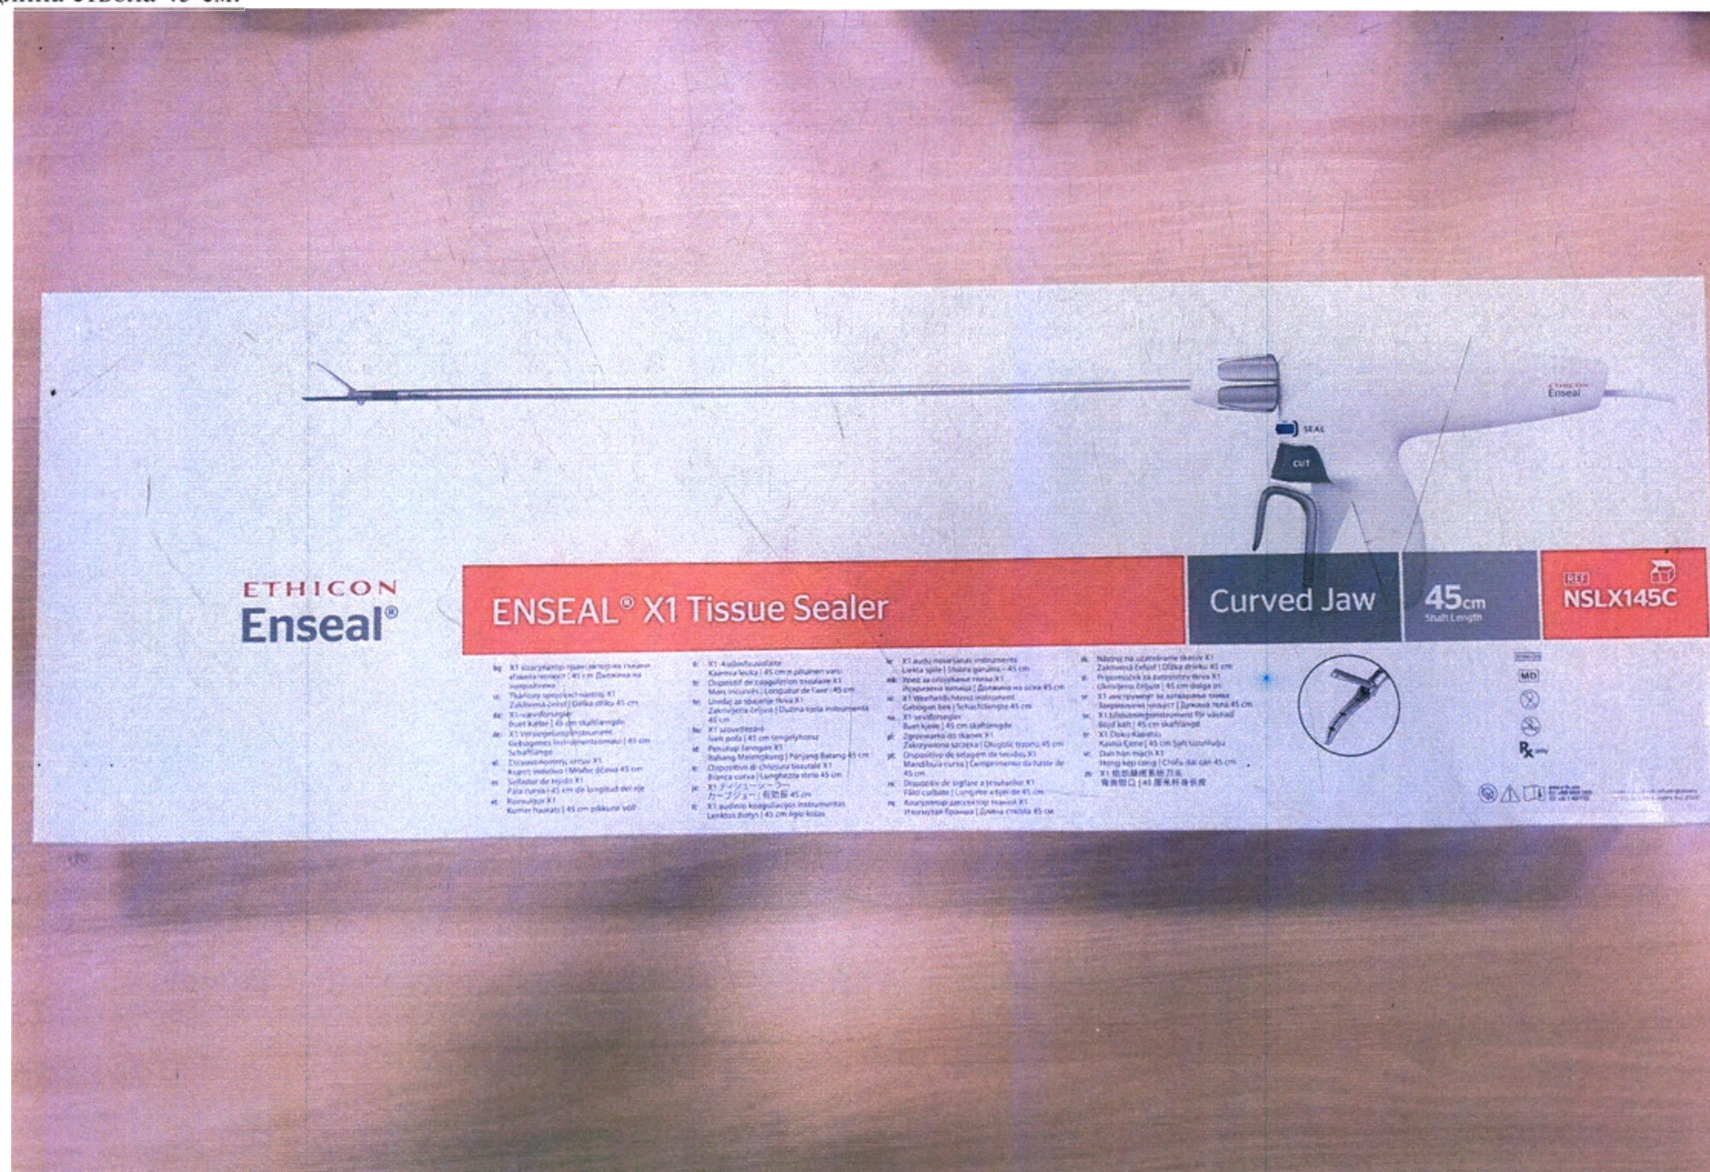

Пользовательская упаковка

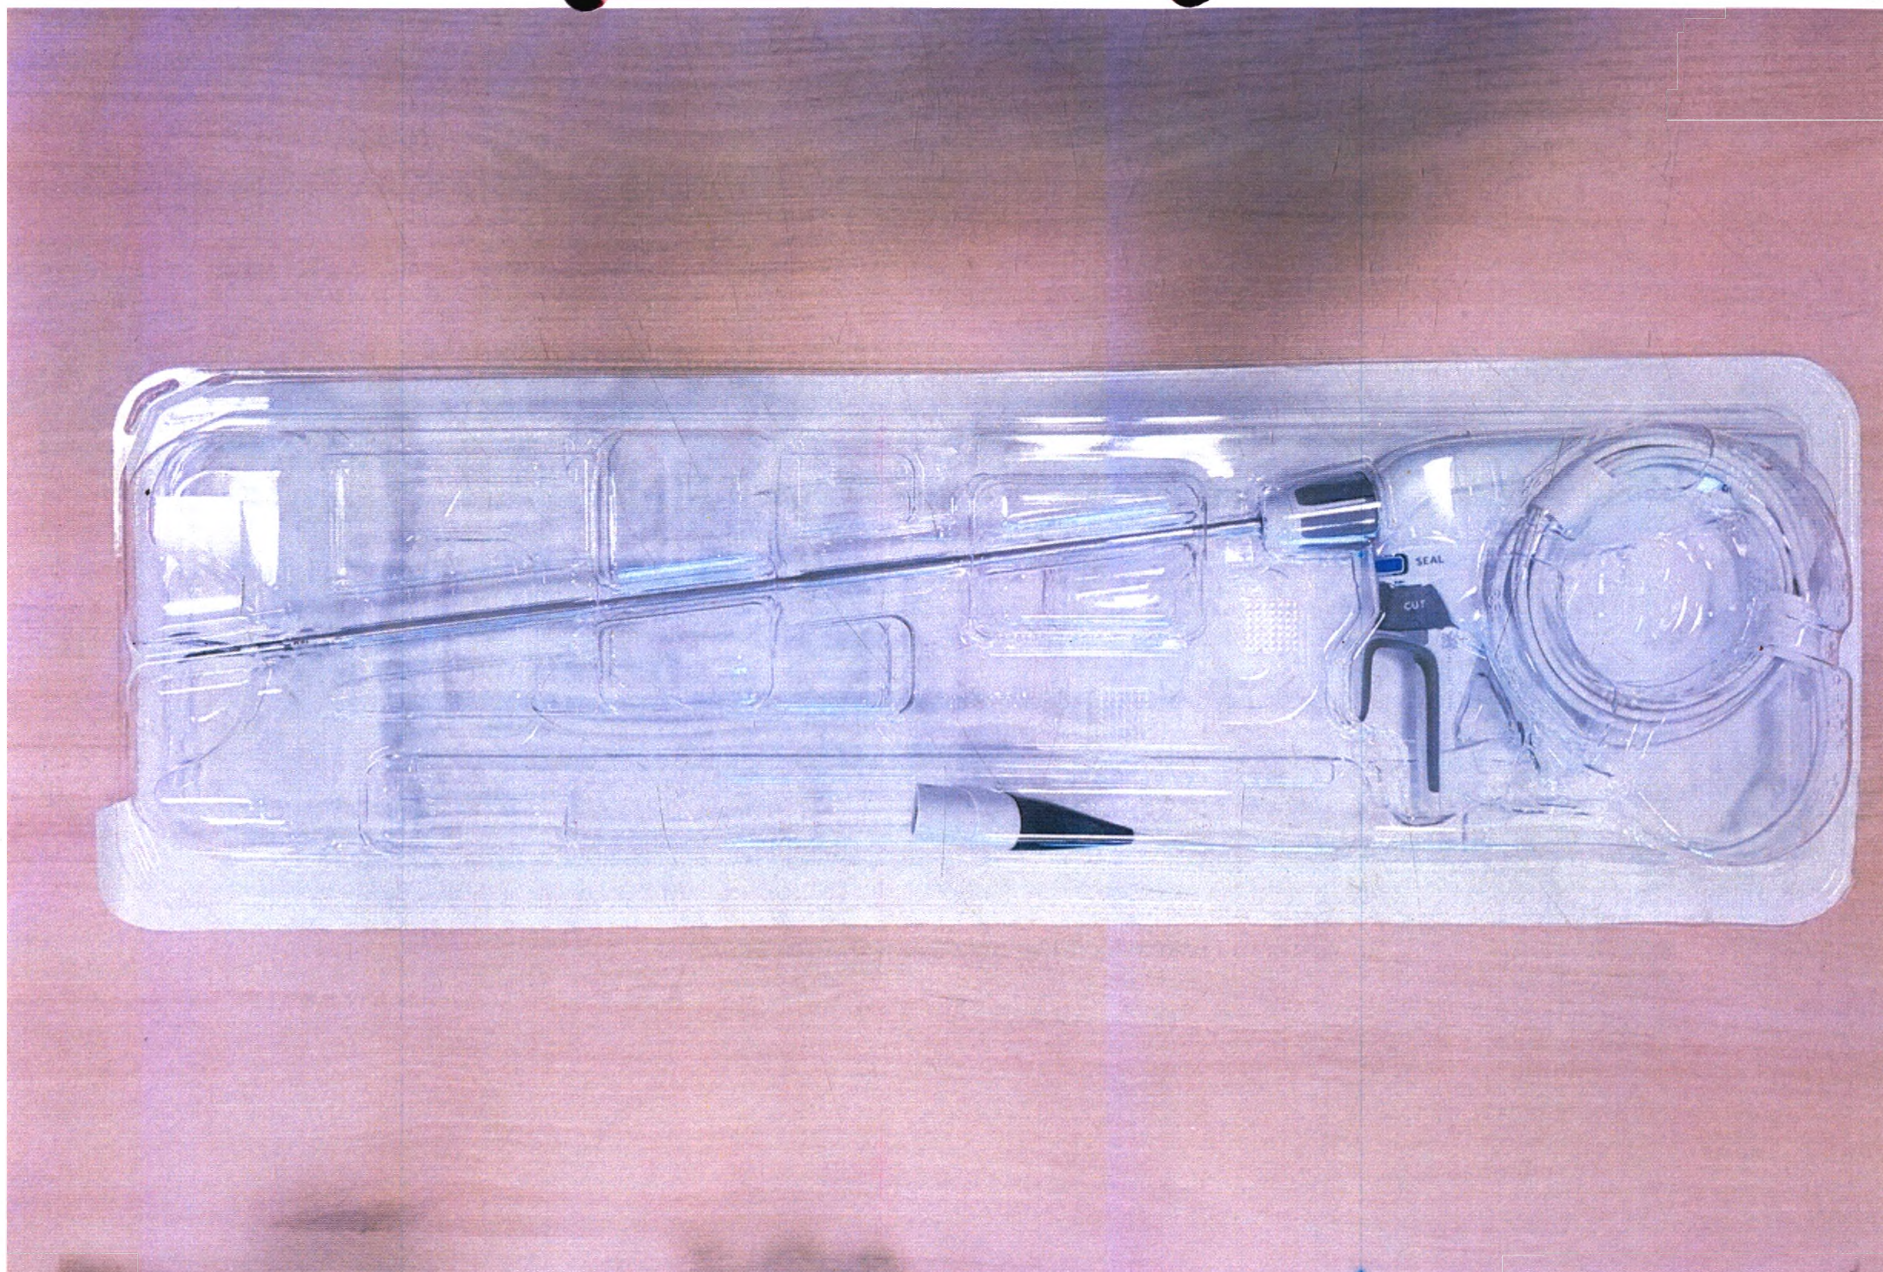

Стерильная упаковка

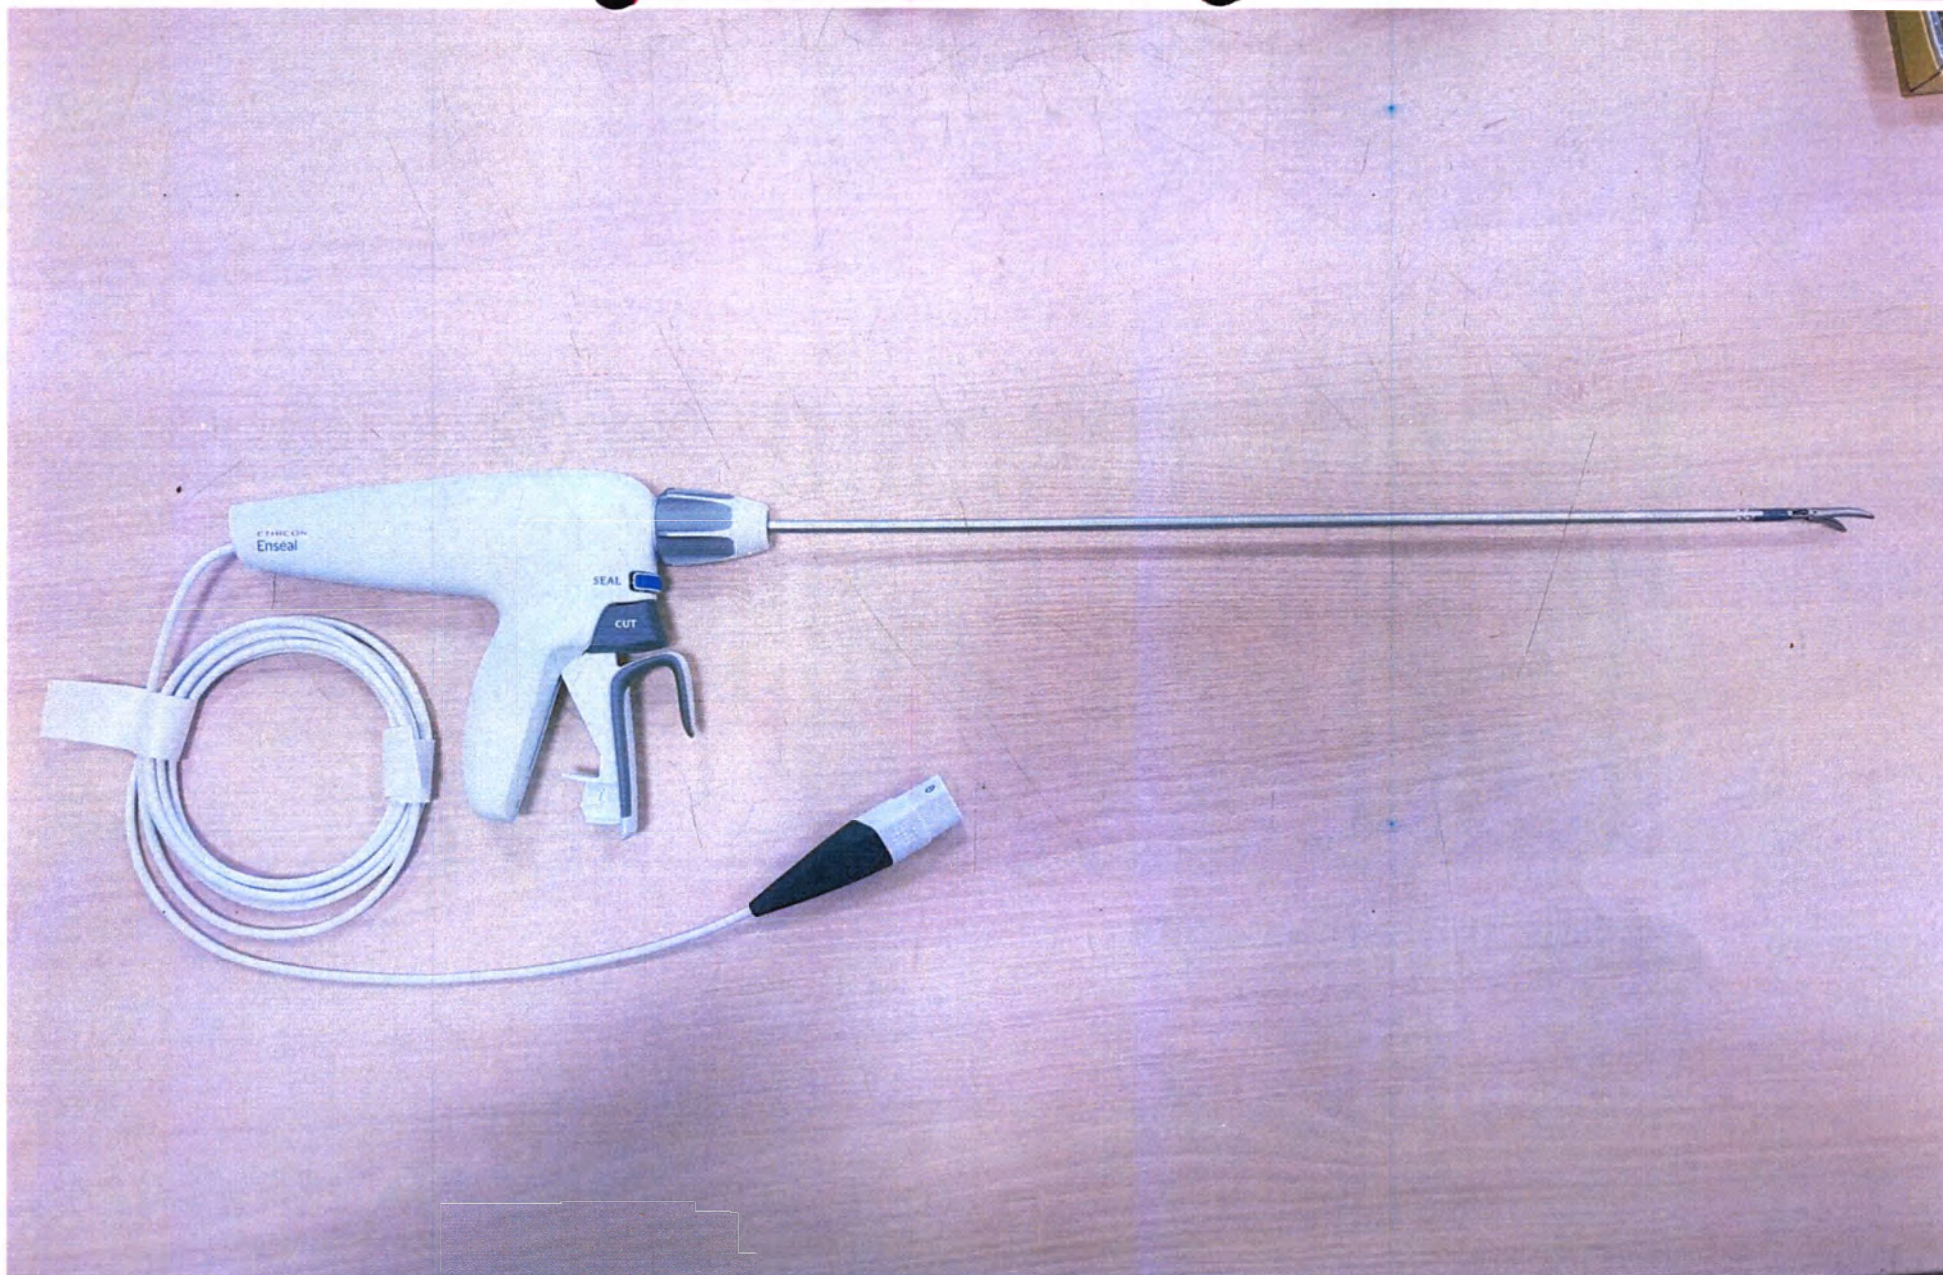

Насадка для диссекции и коагуляции EnSeal X1 с изогнутыми браншами для открытых и лапароскопических операций, длина ствола 45 см

Место для штрих-кода

REF NSLX145C

Насадка для диссекции и коагуляции
«Энсил» к генератору
электрохирургическому,
ультразвуковому G11, в вариантах
исполнения: Насадка для диссекции
и коагуляции EnSeal X1 с изогнутыми
браншами для открытых и
лапароскопических операций, длина
ствола 45 см.

Область применения: Хирургия

Регистрационное удостоверение:

РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX XXXX

Производитель: Ethicon

Endo-Surgery, LLC, 475 Calle C,

Guaynabo, Puerto Rico 00969 USA

(США)

Уполномоченный представитель

производителя, адрес: ООО

"Джонсон & Джонсон", 121614,

Россия, г. Москва, ул. Крылатская, д.

17, корп. 2, тел. +7(495)5807777

Количество штук в упаковке: 3 шт.

Диаметр ствола 5 мм, длина ствола

45 см, форма бранш: изогнутая

Код партии: см. на упаковке

Использовать до: см. на упаковке

Срок годности: 5 лет



Макет русскоязычной маркировки





РЕШЕ
СКРЕПЛЕ
ПЕЧАТЬ
ИСТОЧ

22