

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Миндрей Медикал Рус»



Сюнь Вэй

«19» декабря 2022 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Монитор – дефибриллятор uMED , варианты исполнения: uMED 20, uMED 20A

Общество с ограниченной ответственностью «Миндрей Медикал Рус»

129110, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, ан./пом. 4/л, ком. 7, 11а
Тел.: (499) 553-60-36, факс: (499) 553-60-39


ИНН 7705815069 КПП 770201001

1.1. Основной блок, 1 шт







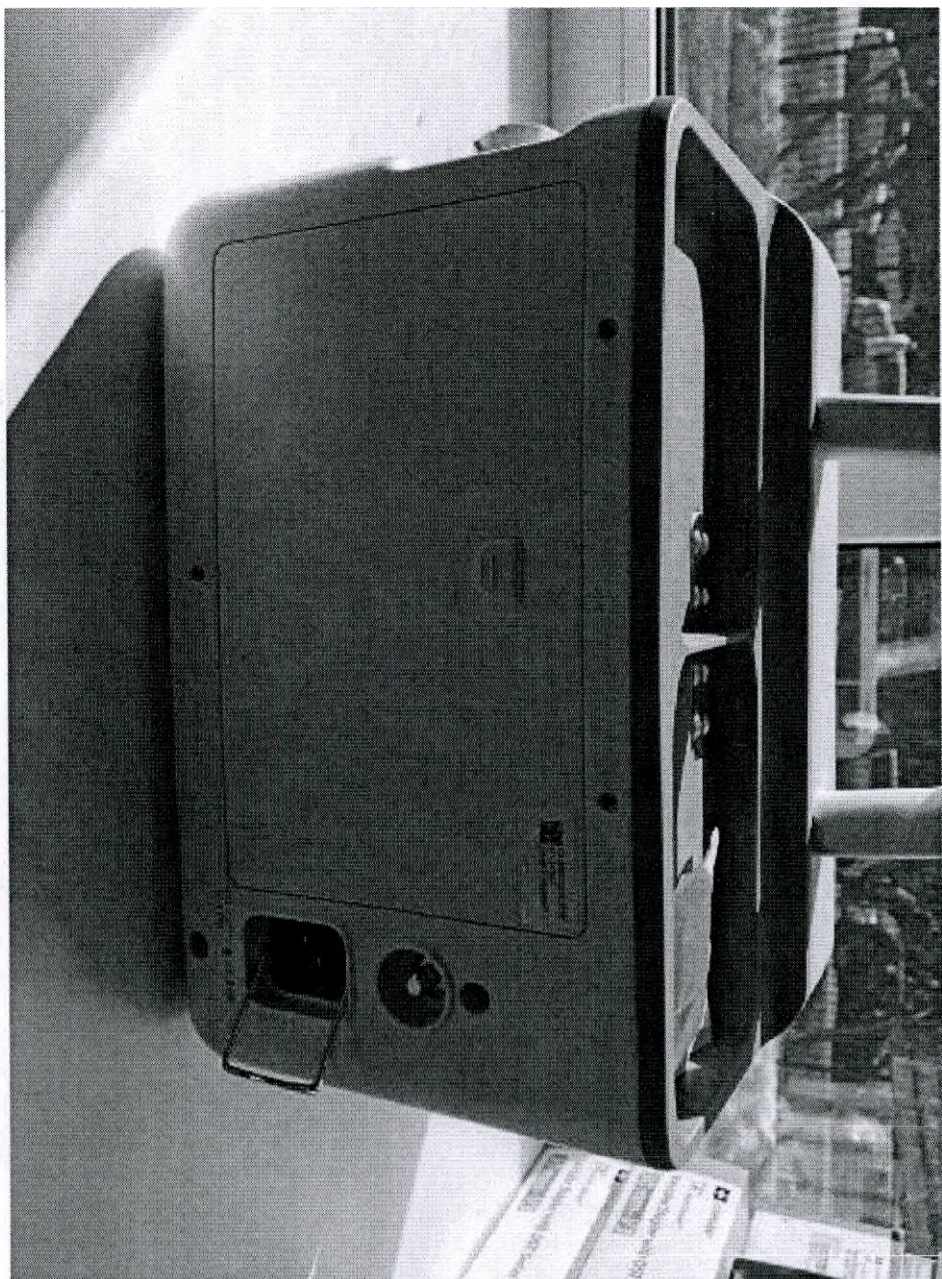





1.3. Батарея, модель LI24I002H – 1 шт.




Кабель питания основного блока, модель MXC00921050EJ9, 1 шт.





2. Пакет программ для передачи данных, - 1 шт.

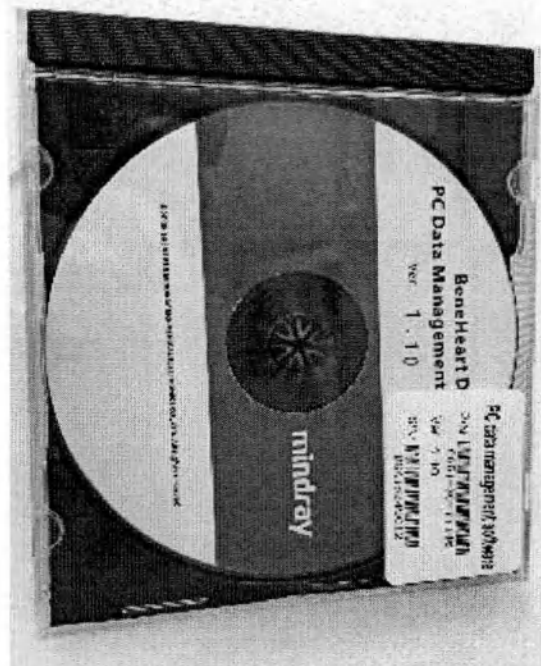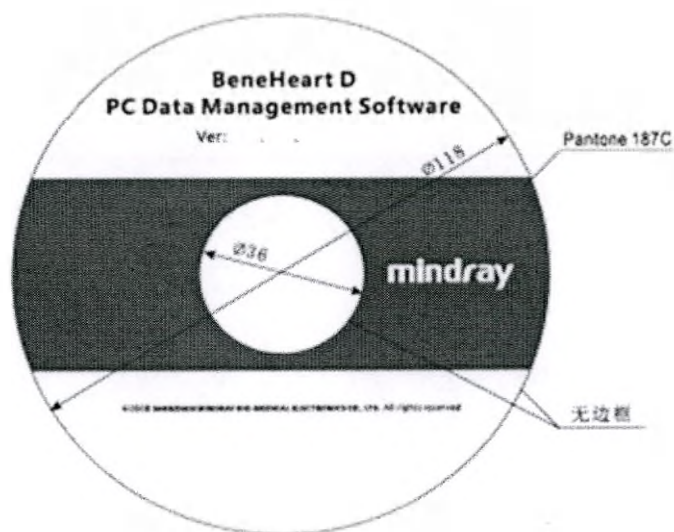


1.6. Электроды многофункциональные, взрослые, одноразовые (1 пара), модель MR60

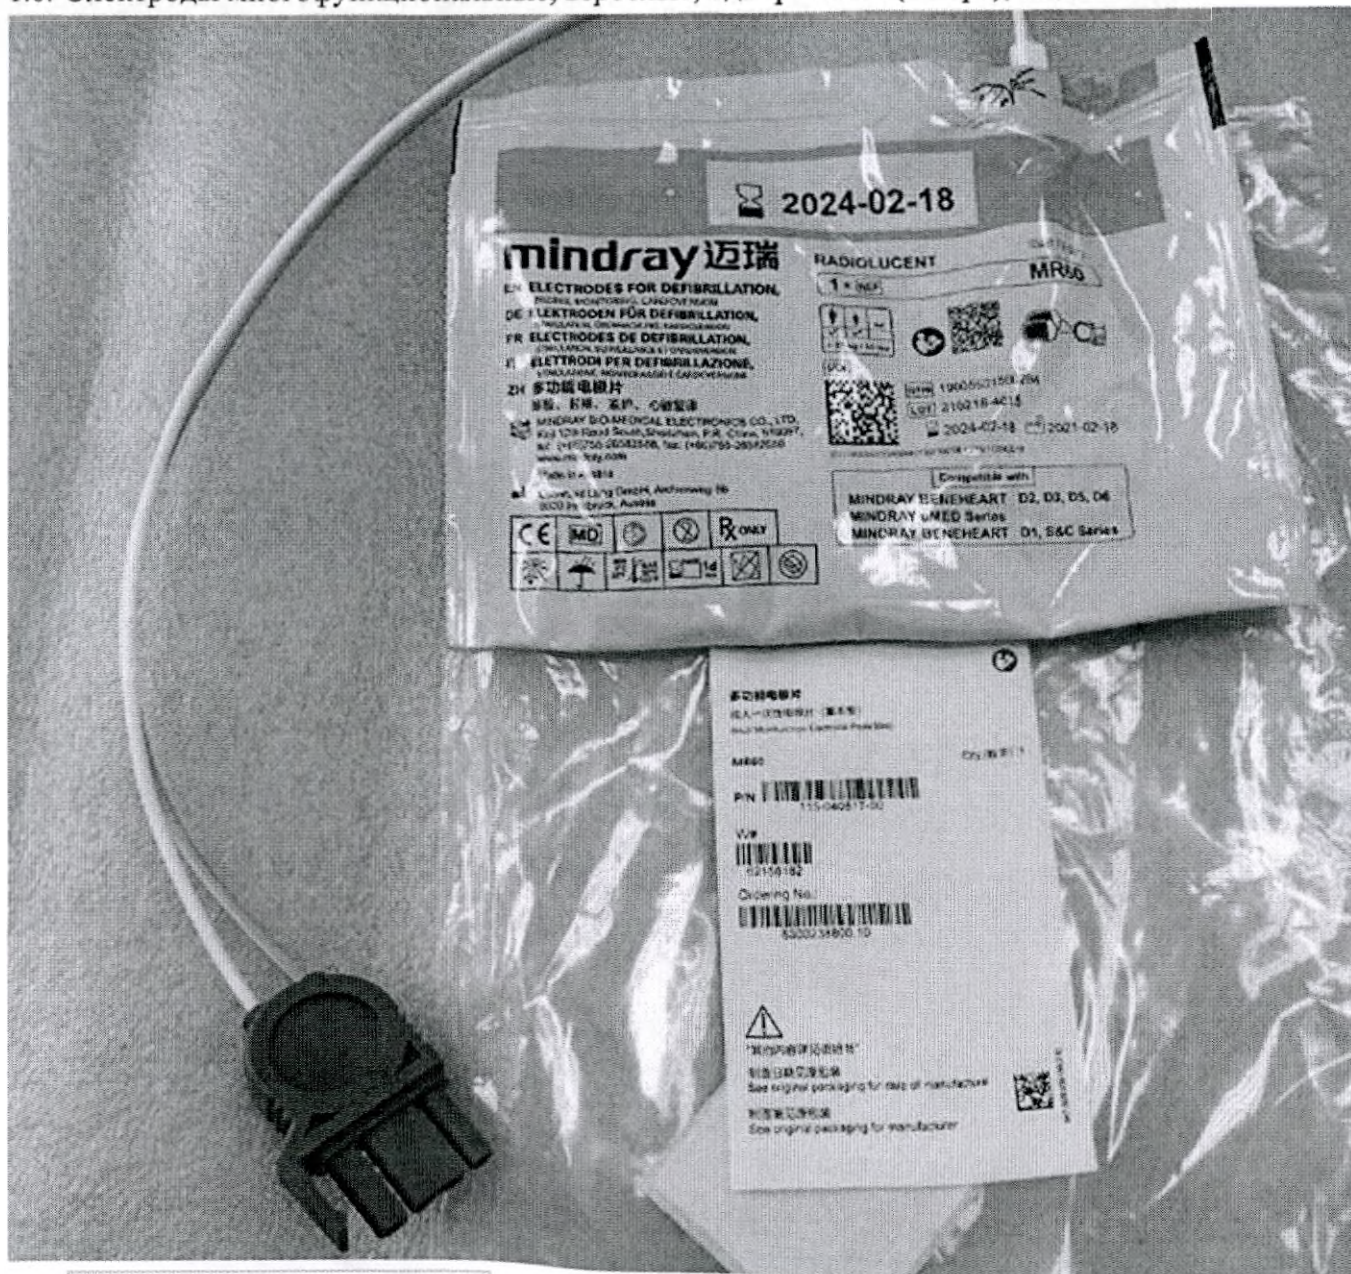

NAME: Adult Multifunction Electrode Pads(Bas)		
REF		Qty: 5
	115-040517-00	
	2019-10-15	
Order No.		
	21162124.10	
 SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. Mindray Building, Key 12th Road South, Hi-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R.China Tel: 86-755-83888888 Fax: 86-755-26682680		



Электроды многофункциональные, детские, одноразовые (1 пара), модель MR61

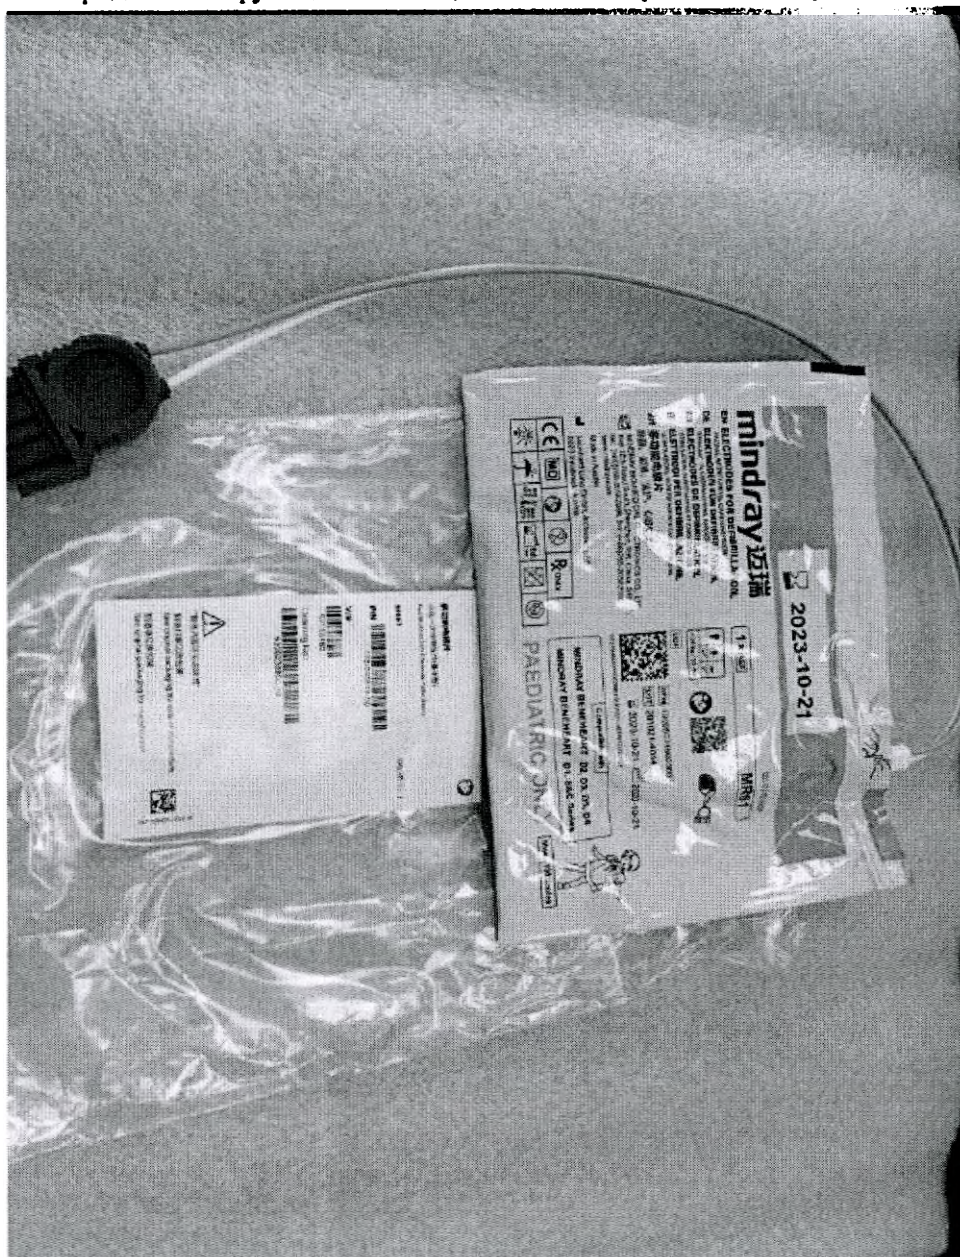

NAME: Ped Multifunction Electrode (ped/level)



1115-0001-001

Qty: 1



2019-06-15

Order No.

1115-0001-001


2115000100



SHENZHEN MINDRAY ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray, Making it easy to protect your patients
Mindray, Shenzhen 518057, P.R. China
Tel: 86-755-22190000 Fax: 86-755-22190000




Внешние электроды для дефибрилляции (пара), модель MR6601

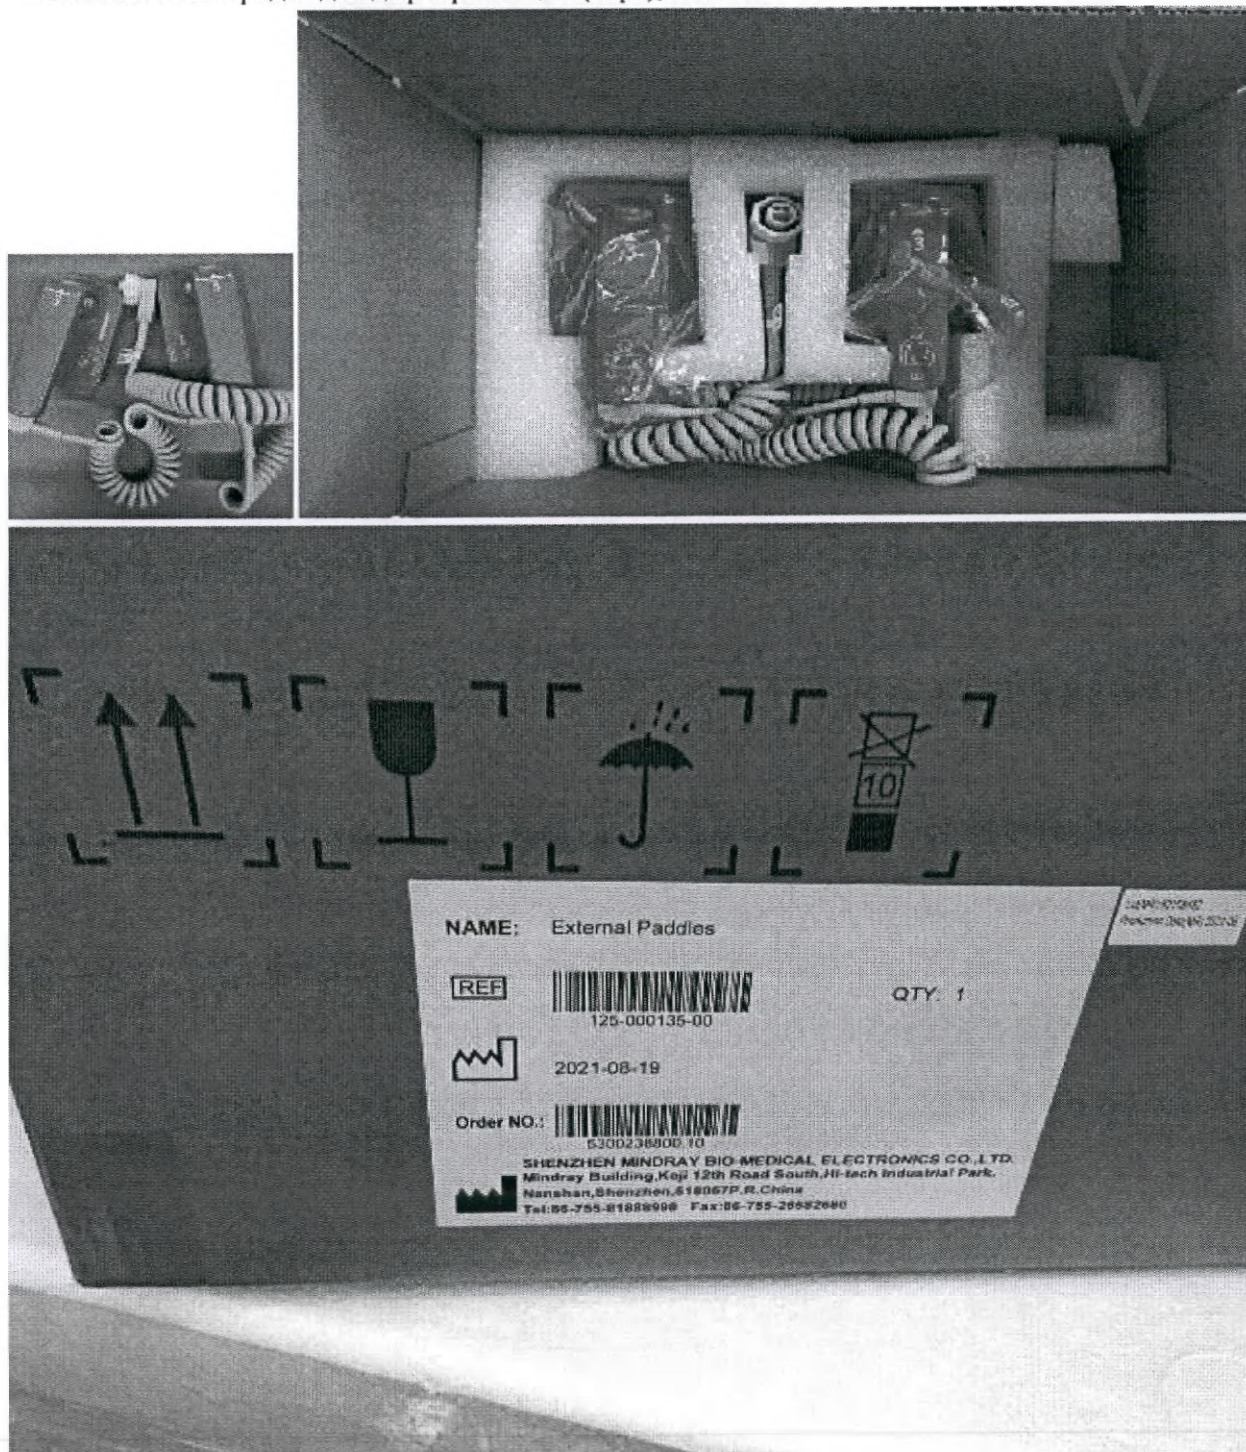



Комплект электродов внутренних, многоразовых, размером 1 дюйм, модель MR6501 – 1 шт. (при необходимости).

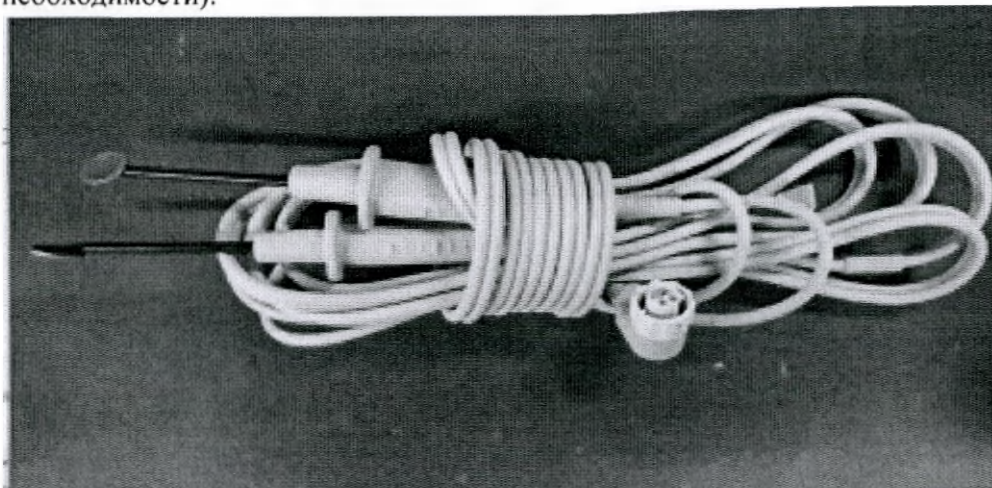


NAME: Internal Defib Paddles(1 in no button)

REF



115-018366-00

QTY: 1



2021-08-19

Order NO.:



5300238800.10


SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO.,LTD.

Mindray Building,Keji 12th Road South,Hi-tech Industrial Park,


Nanshan,Shenzhen,518057P.R.China



Tel:86-755-81888998 Fax:86-755-26582680



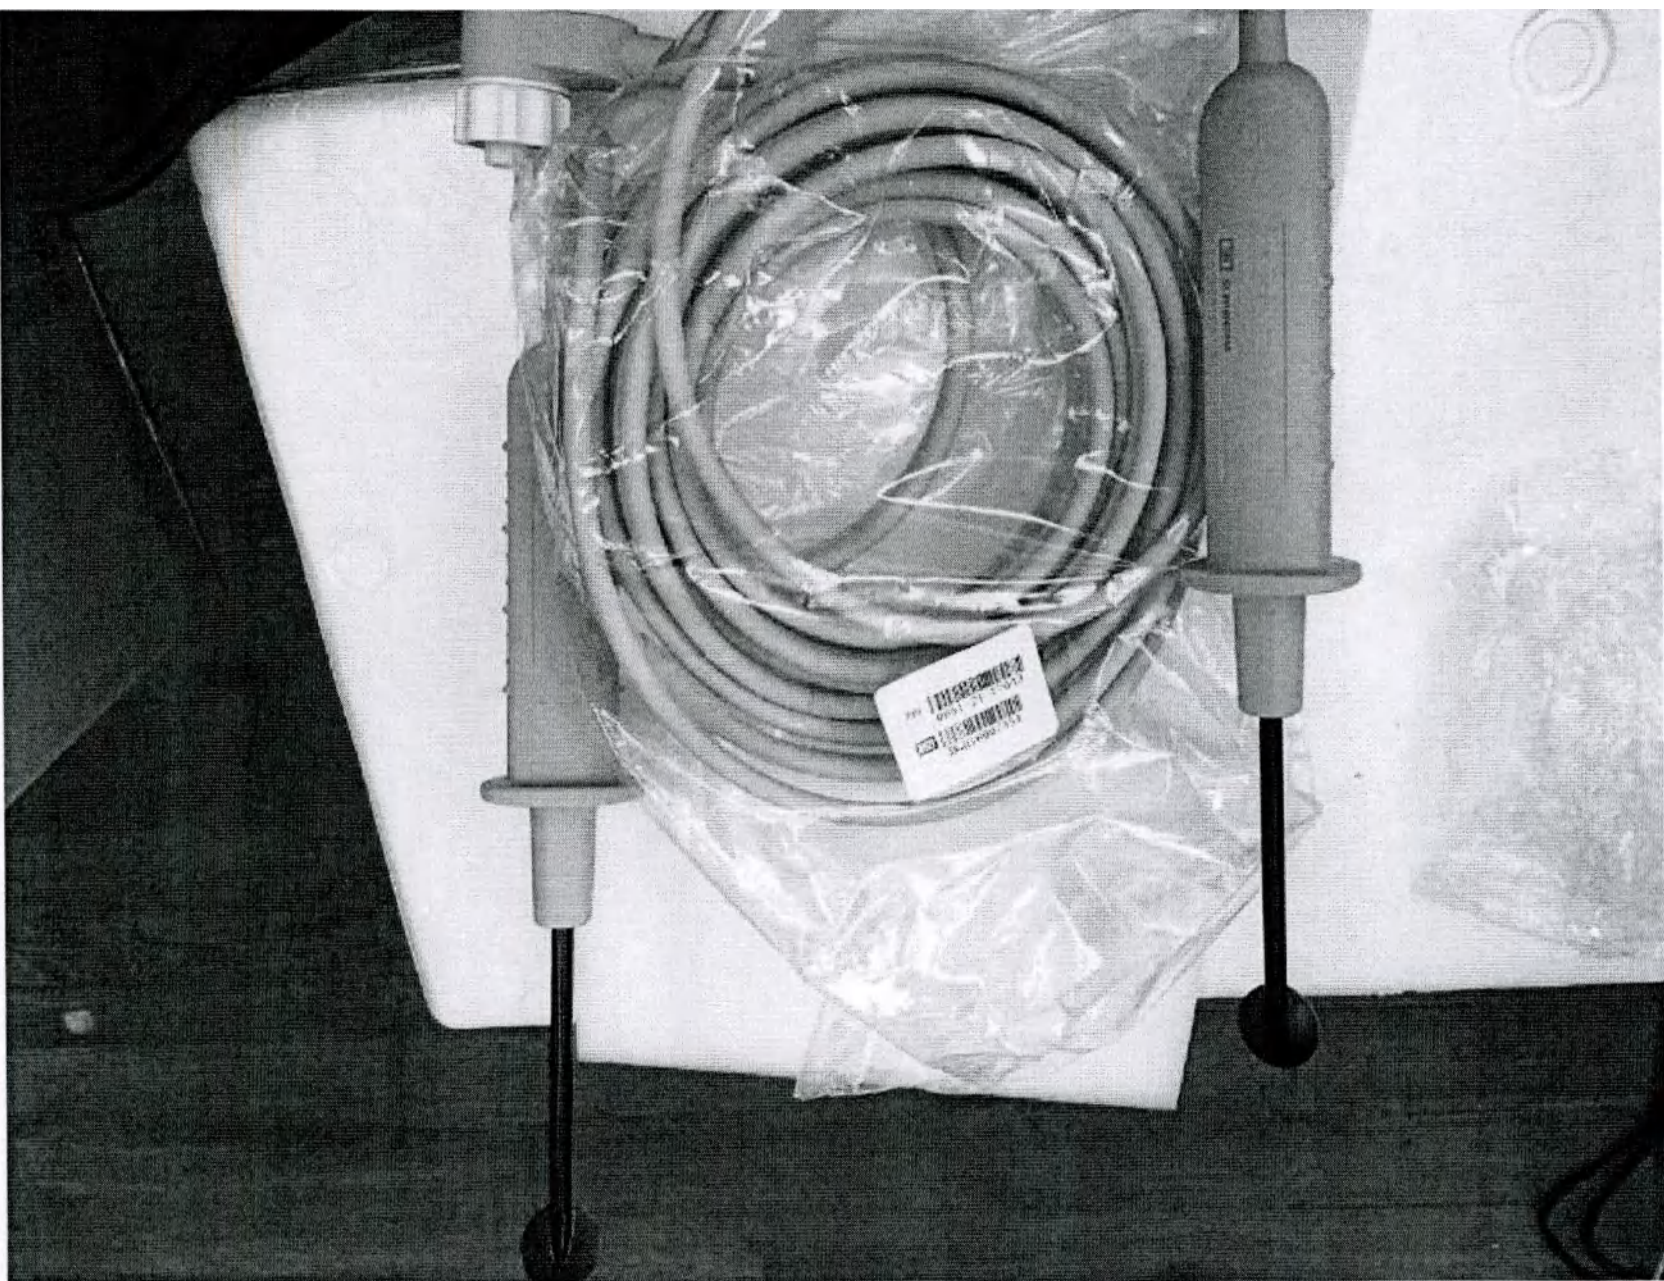




Комплект электродов внутренних, многоразовых, размером 2 дюйма, модель MR6502

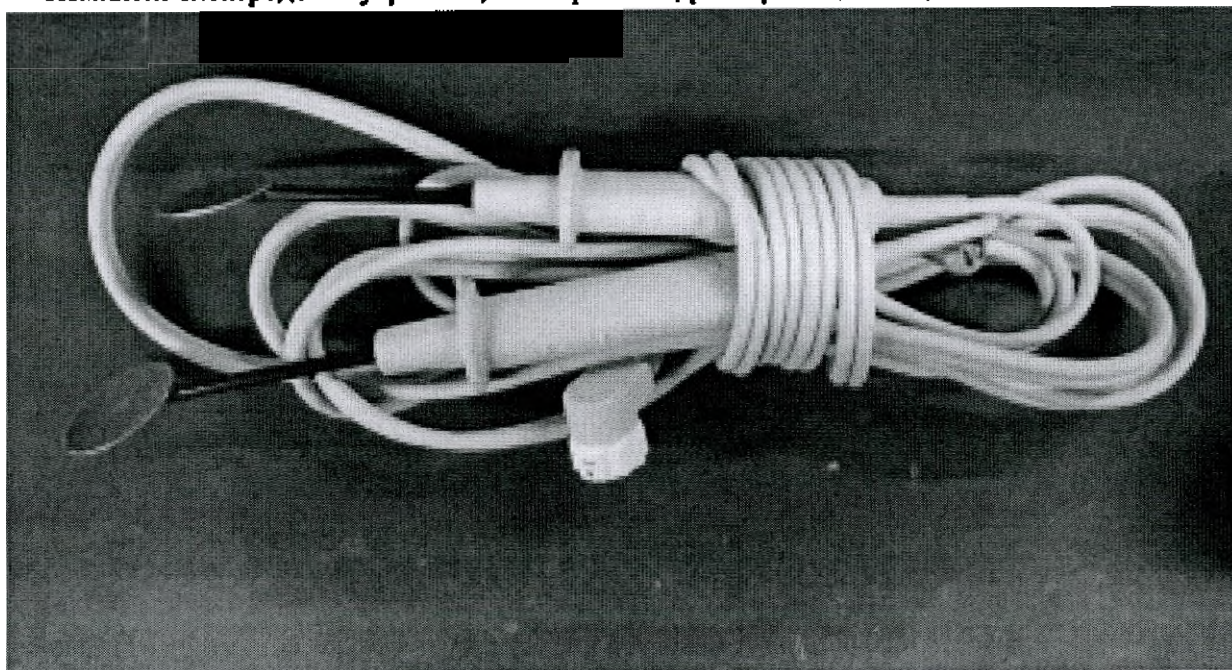

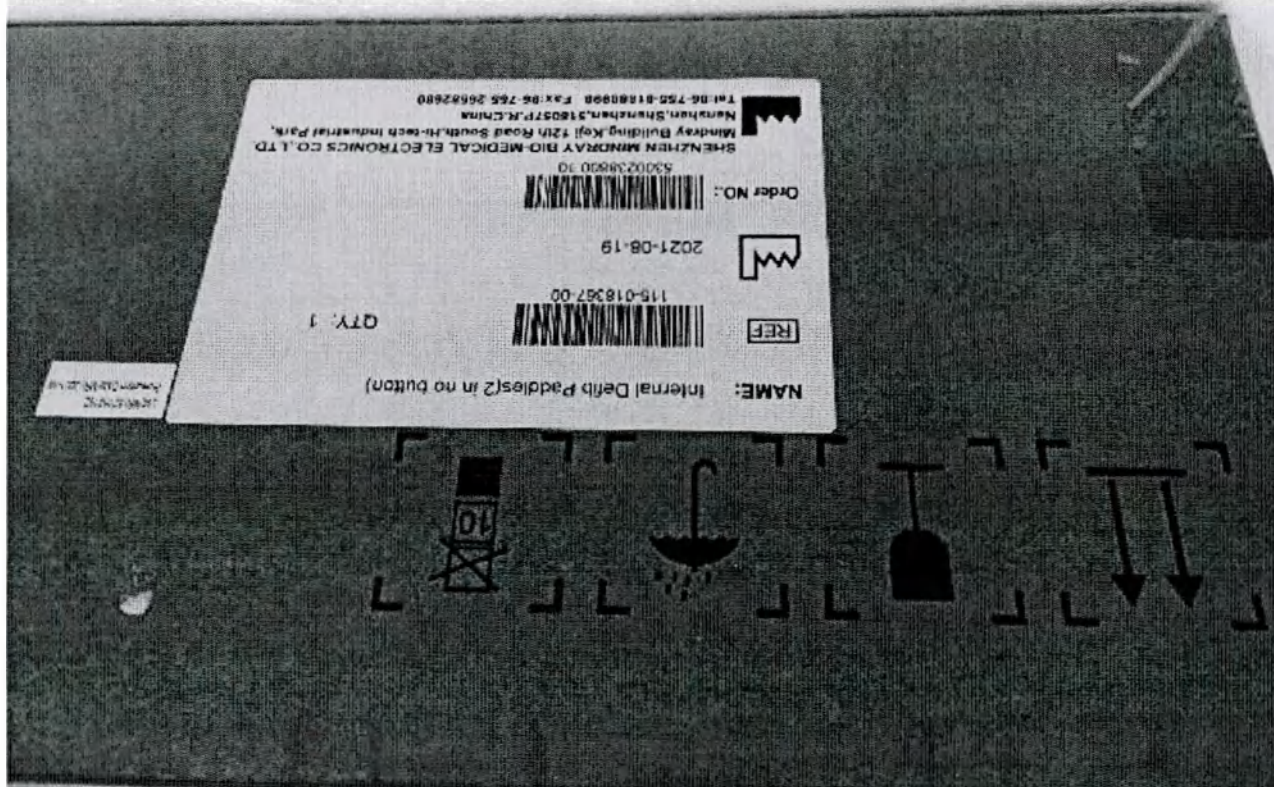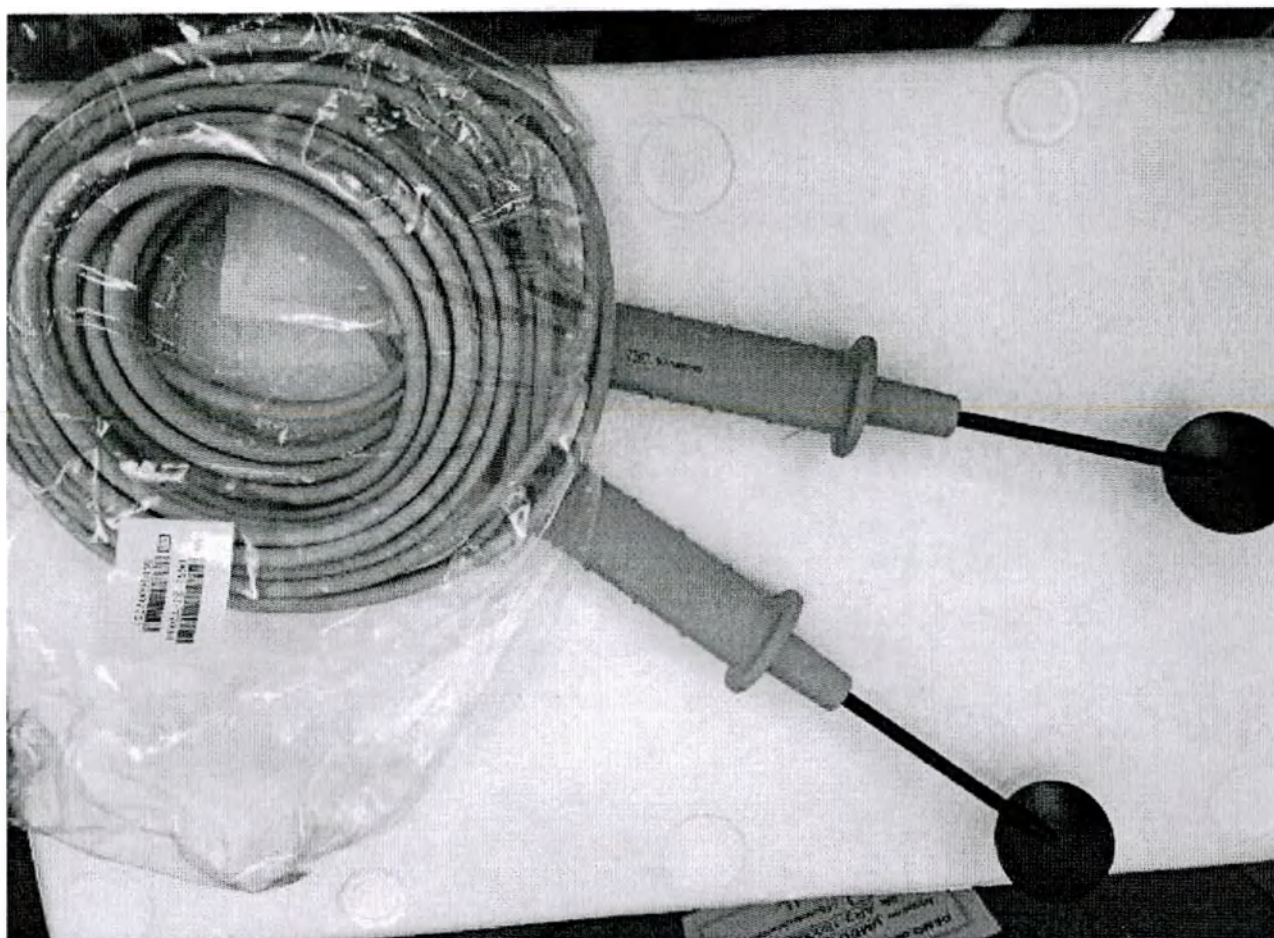

Комплект электродов внутренних, многоразовых, размером 3 дюйма, модель MR6503

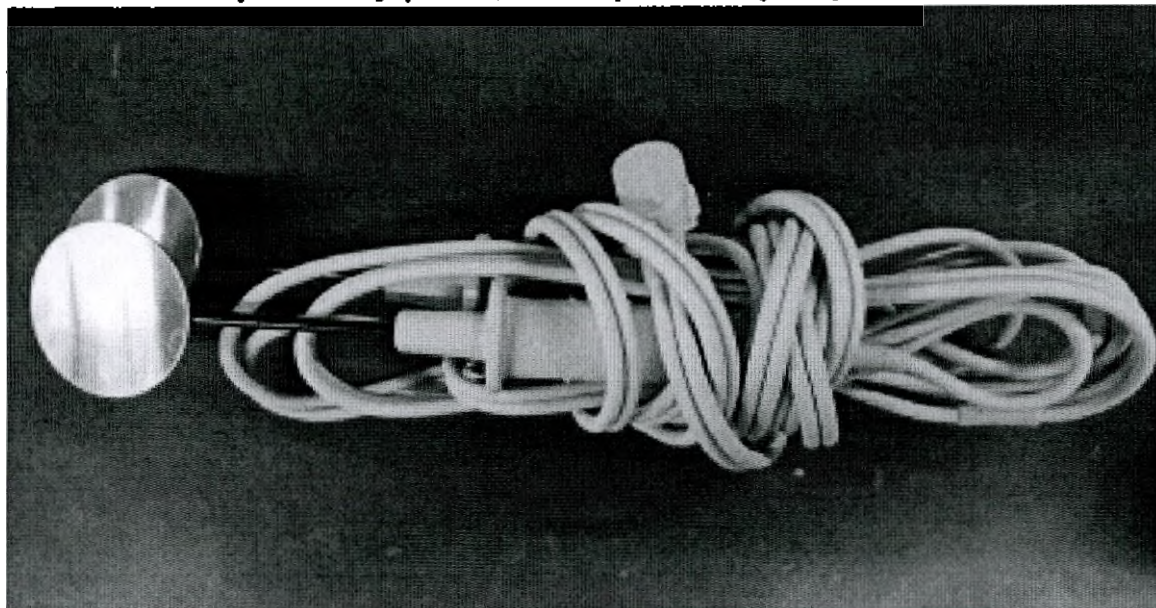

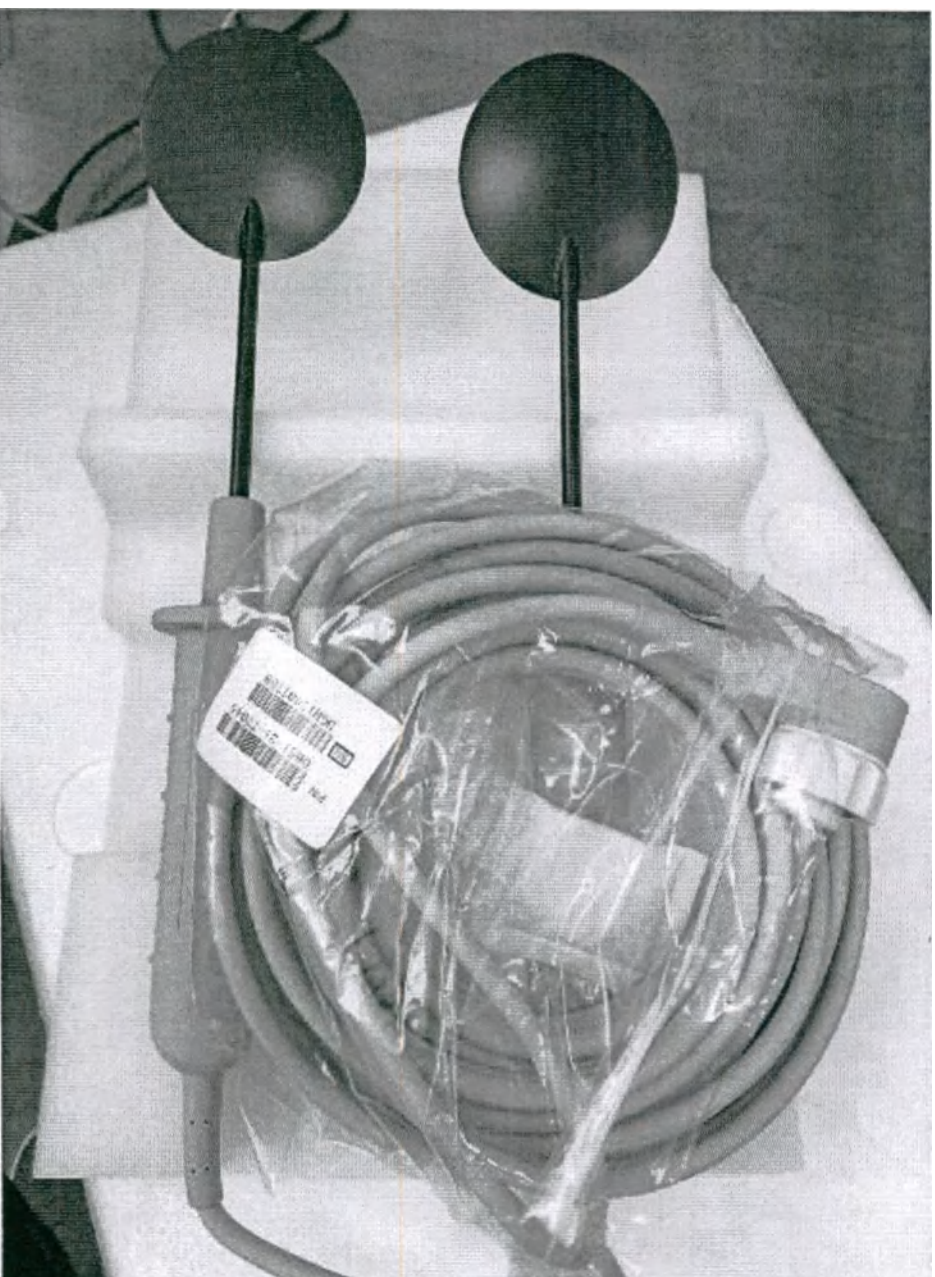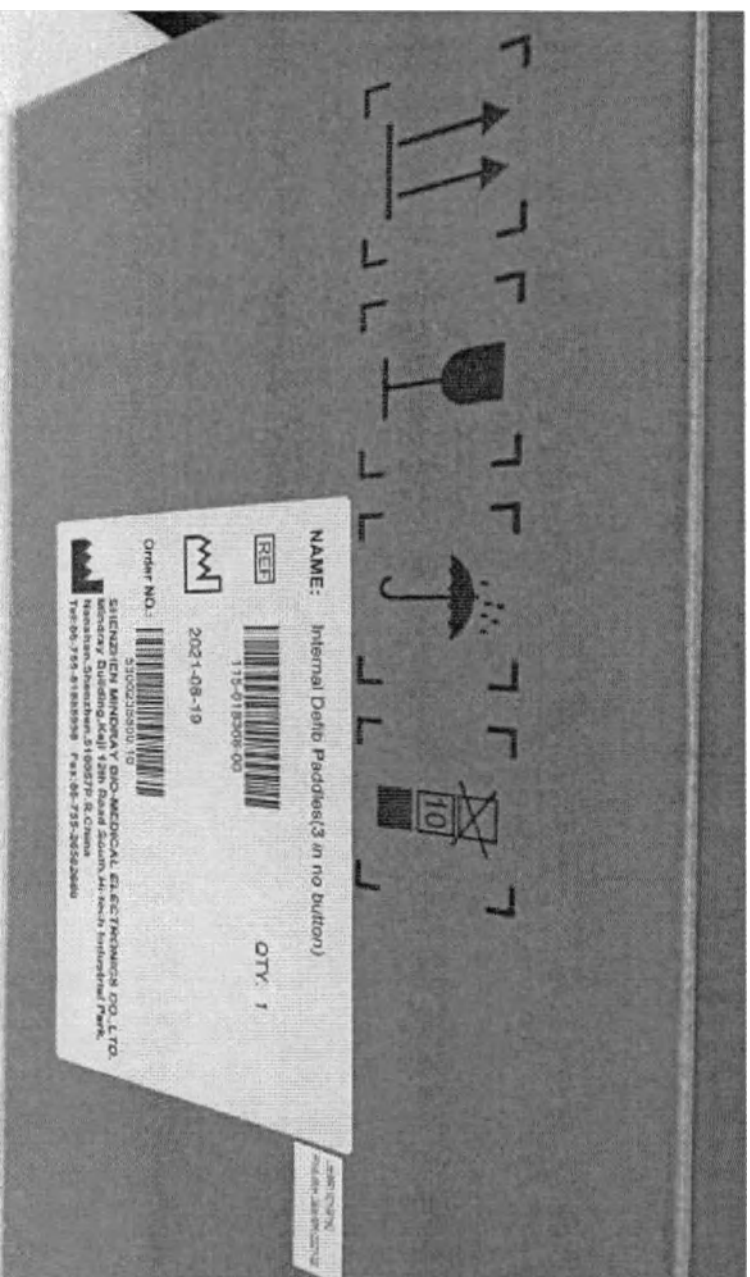



电极片电缆

Pads cable

电极片电缆(配装50 Ohm 测试负载)

pads cable with 50 Ohm load

MR670

Qty(数量): 1

P/N

115-006578-00

LOT

92179585



2020-12-29



Ce

Rx Only

Made in China

“其他内容详见说明书”

使用期限：三年

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

深圳市福田区香蜜湖街道香蜜湖社区香蜜湖十二路

迈瑞大厦1-4楼 邮编：518057

Telephone: +86-755-8122 8998 Fax: +86-755-2658 2680

SHEENZHEN MINORAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Minoray Building, No. 12th Road South, Minoray Tech Industrial Park,

Shenzhen, Guangdong, 518057, P. R. China

Representative: International Trading Corp. (Gansu, Europe)


EC REP


El. No. 814 80 20537, Munich, Germany




041507002 000100

Электроды ЭКГ, модель EMG-SN10-20×20

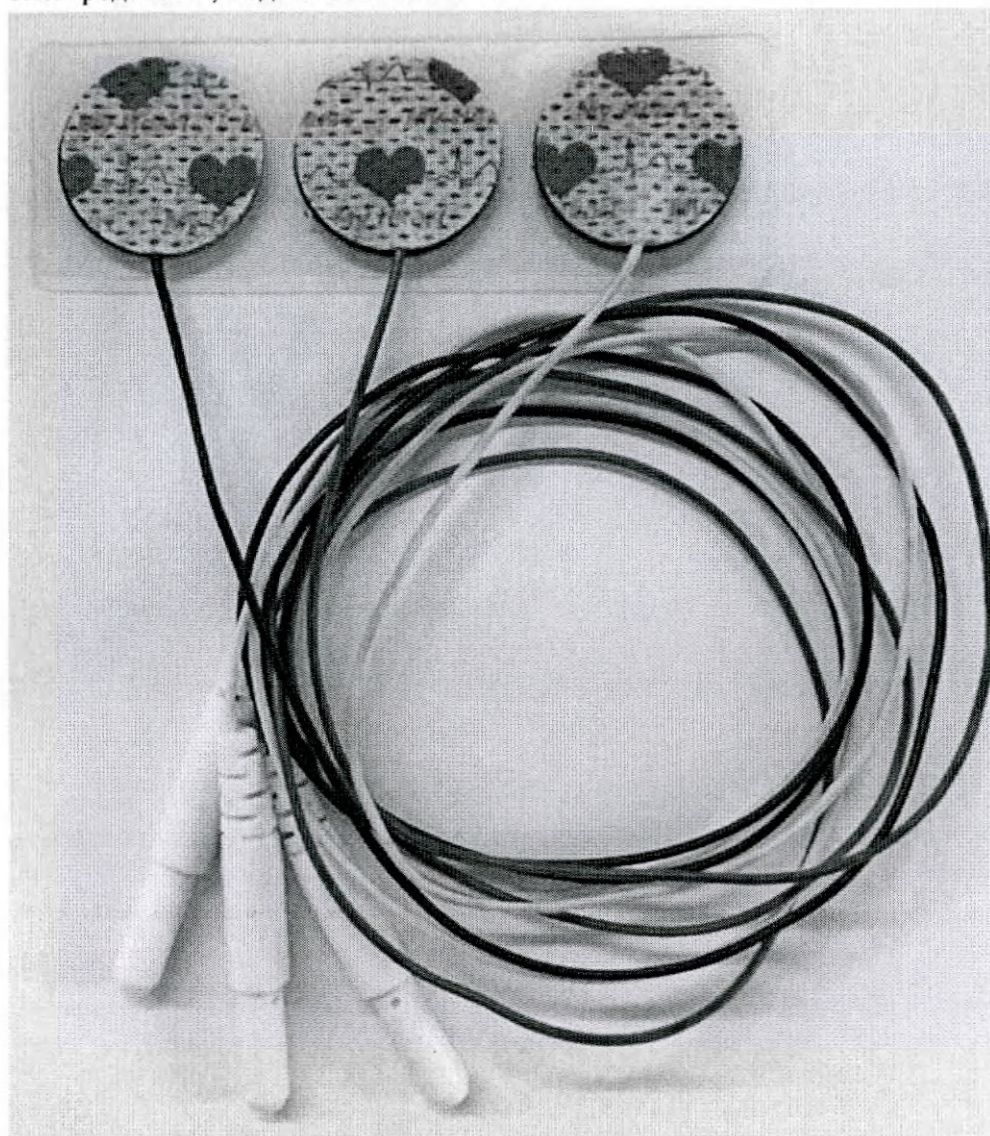

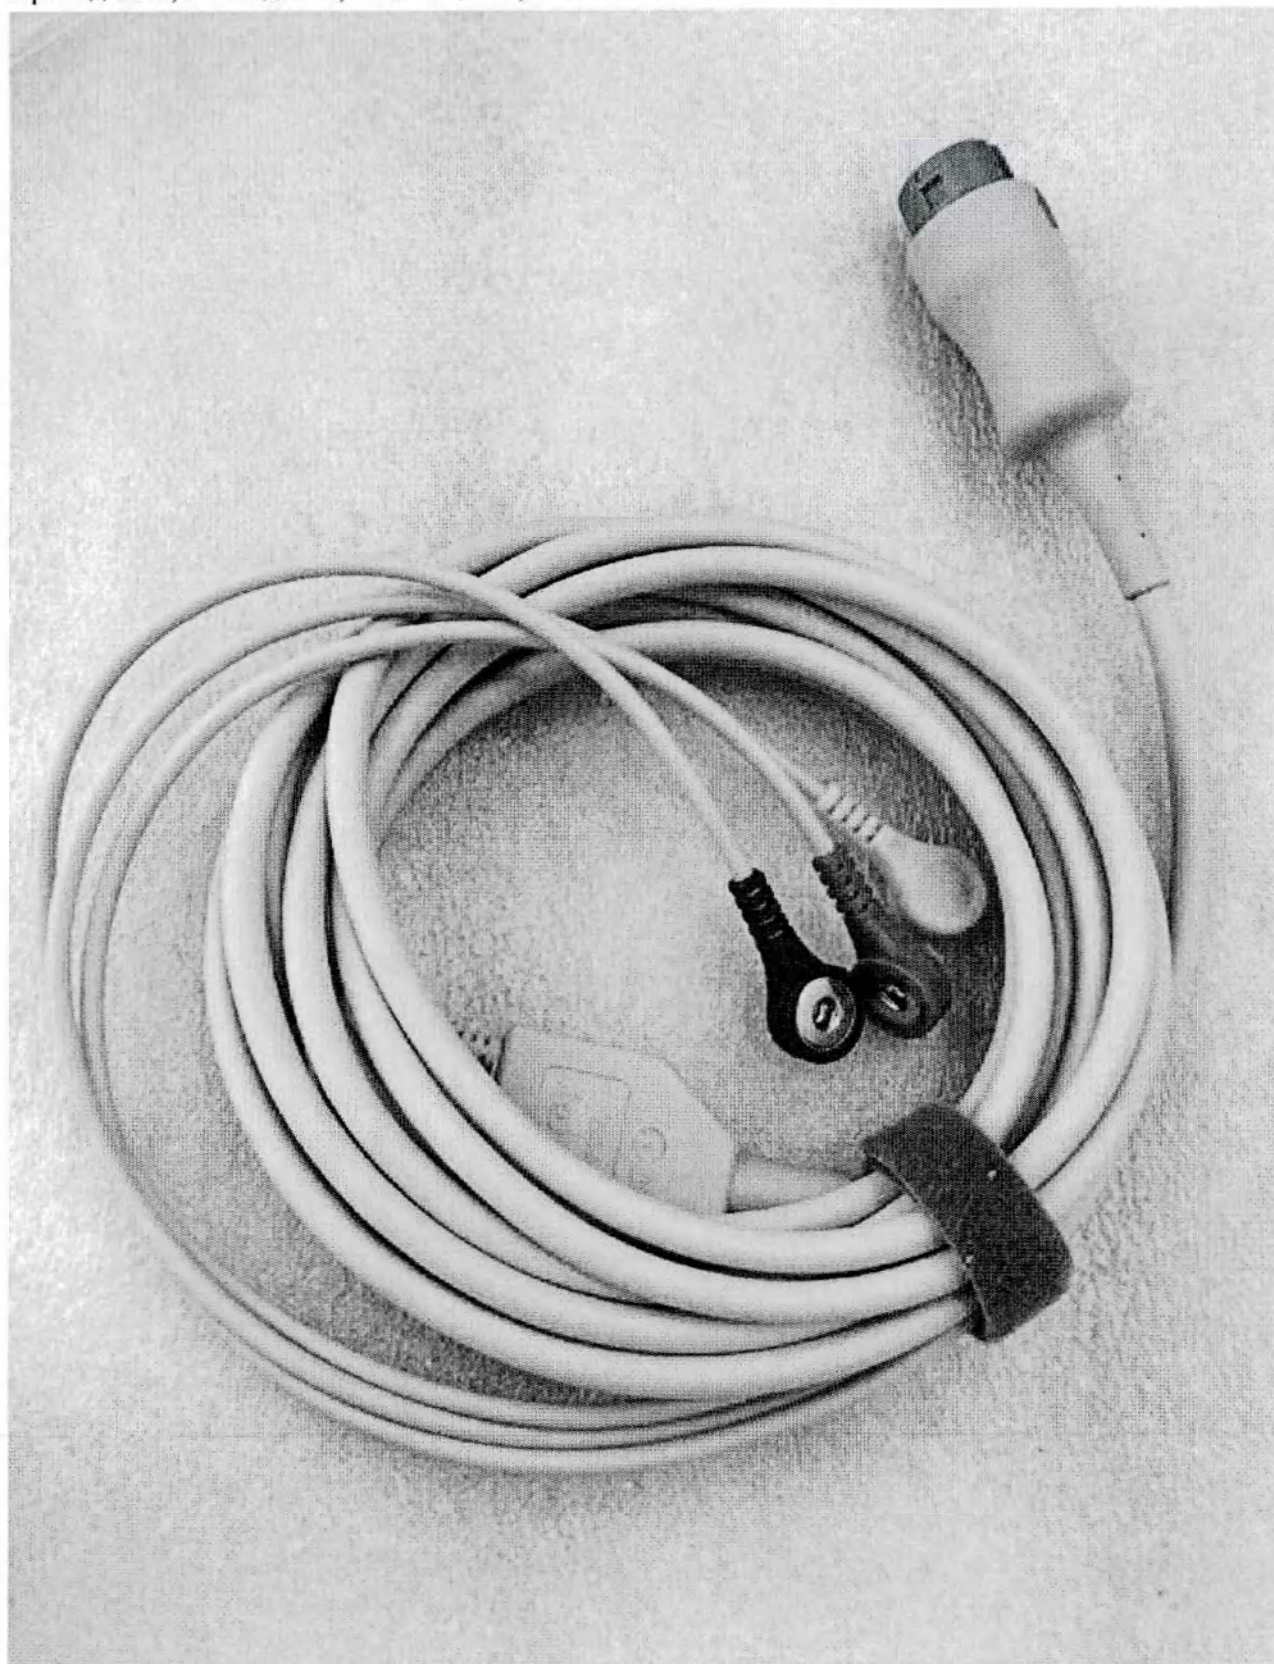

Провод ЭКГ, 3 отведения, тип зажим, модель EA6232A

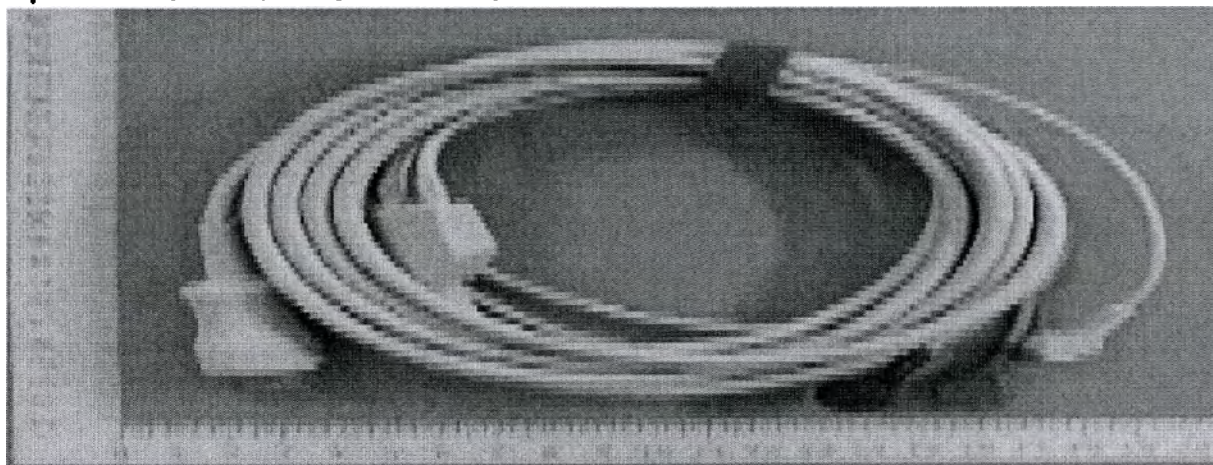

0000000000000000

PIN

1. The first step is to identify the problem. This involves understanding the symptoms and the context in which they are occurring.

107

92189319

B

2021-07-19

07106941904055077

10,92189316411210716

香港經濟貿易：粵港經貿2012-2013

Copyright © 2014 by John Wiley & Sons, Inc.

[illegible]

中国科学院图书馆藏

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

² These investigations are supported by NSF Grant DMR-90-15500.

1



Rx Only



44-38861-2420

備註事項：三經 加時內錄及...

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

地址：深圳市福田区高新技术产业园
邮编：518000
电话：0755-26666666
传真：0755-26666666
网址：www.163.com

TEL: 011-80-735 0188 8092 FAX: 011-80-735 0188 8093

SHENZHEN MINGRAY BIO MEDICAL RESEARCH CO., LTD.

Ministry Building, 1270 Broad Street, High Level, B.C.

Phosphon, Sinterstoff, 218057 P. R. China

EC REP
Shanghai International Trading Corp.
Eiffelstraße 10, 20537 Hamburg, Germany

ET 2014

三

PDI Sant Cloth* Plus Germicidal

180075

210

Провод ЭКГ, 5 отведений тип зашелка, модель EA6252B







使用说明

心电导联线

ECG Cable

12针5导一体式心电电缆 IEC 夹子式

12Pin 5-Lead ECG Cable, IEC, Clip

EA6252A

Qty.(数量): 1

P/N



040-000962-00

LOT



92187902



2021-07-27



(01)06944904037288



(10)92187902(11)210727

备案凭证编号: 粤深械备20170118号

生产备案凭证编号: 粤深食药监械生产备20140003号

1. 本导联线符合YY0828-2011《心电监护仪电缆和导联线》标准的要求。
2. 本导联线是重复性使用的。

1. This leadwire meets the requirements of the standard, ECG TRUNK CABLES and PATIENT LEADWIRES (ANSI/AAMI EC53)
2. This leadwire is intended for MULTI-PATIENT USE.



Rx Only

使用期限: 三年 “其他内容详见说明书”

备案人/生产企业名称:

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

住所: 深圳市南山区高新技术产业园科技南十二路迈瑞大厦1-4层 邮编: 518057

生产地址: 深圳市光明新区南环大道1203号

Tel(电话): +86-755-8188 8998 Fax(传真): +86-755-2658 2680




SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,

Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

Made in China




Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



047-023879-0012.D

ECG Leadwire
心电导联线

SINGLE USE
一次性使用

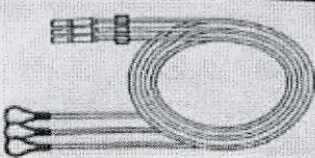

☒ IEC
☐ AHA

Rx Only

1. 本导联线符合YY0828-2011《心电监护仪电缆和导联线》标准的要求。
 2. 本导联线是一次性使用的。

1. This leadwire meets the requirements of the standard, ECG TRUNK CABLES and PATIENT LEADWIRES (ANSI/AAMI EC53).
 2. This leadwire is intended for SINGLE USE.



32290821422
940-003847 10(2.1)

mindray

EL6312B

Qty (数量) 1

3导联线 一次性 IEC 按钮式
3-Lead Leadsset, Disposable, IEC, Snap

P/N 
040-000147-00

LOT 
92191095

 2021-08-03  2022-08-03


(01)089449040398

(10)92191095(11)210803(17)230803


备案凭证编号：粤深械备20170118号
生产备案凭证编号：粤深食药监械生产备20140003号
其他内容详见说明书
备案人/生产企业名称

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司


住所：深圳市南山区高新技术产业园科苑南路十二路迈瑞大厦1-4层 邮编：518057
生产地址：深圳市光明新区南环路1203号
Tel: +86-755-8188-8998 Fax: +86-755-2658-2680

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, High Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China Made in China



 Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Erfestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

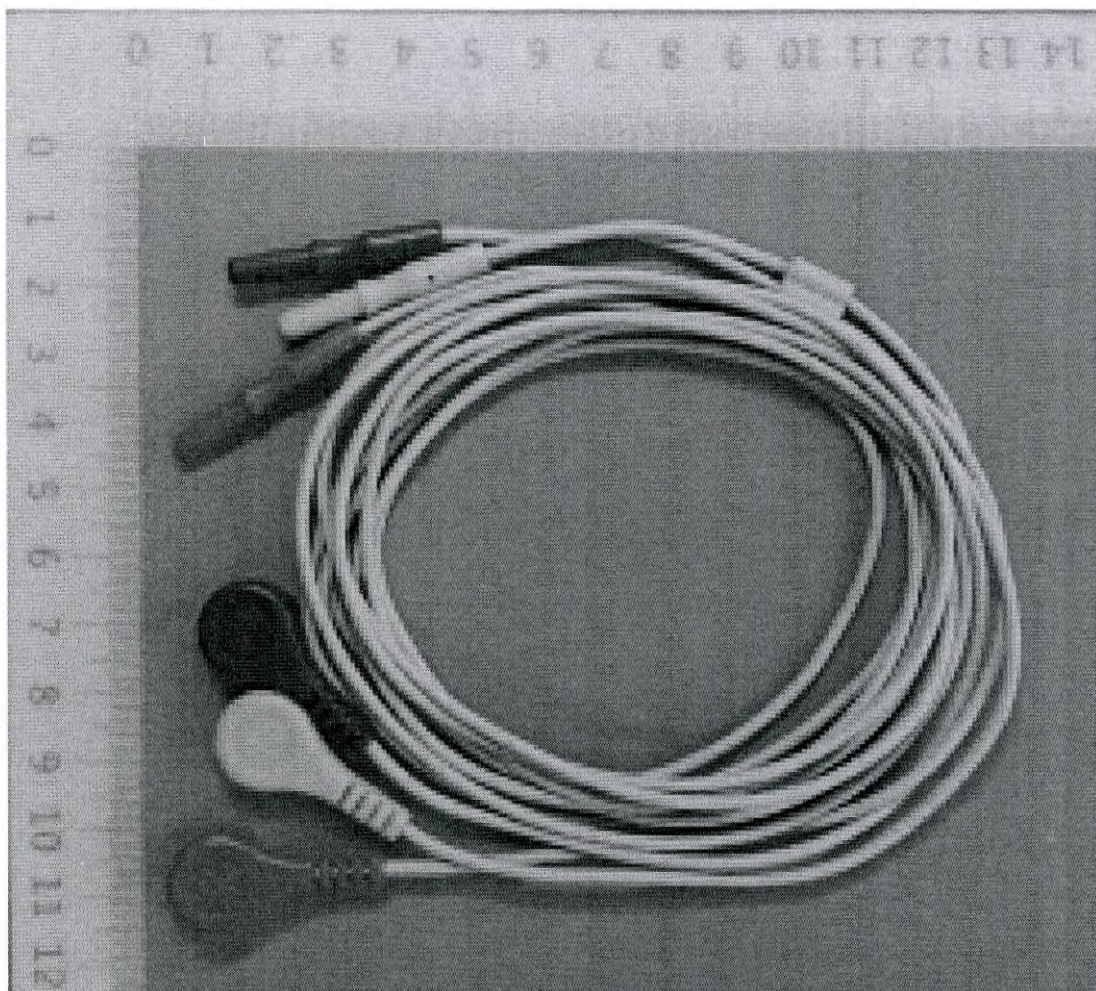

Провода ЭКГ, 3 отведения, длинные с защелкой, ИЕС, одноразовые для новорожденных и грудных детей, модель EL6312A

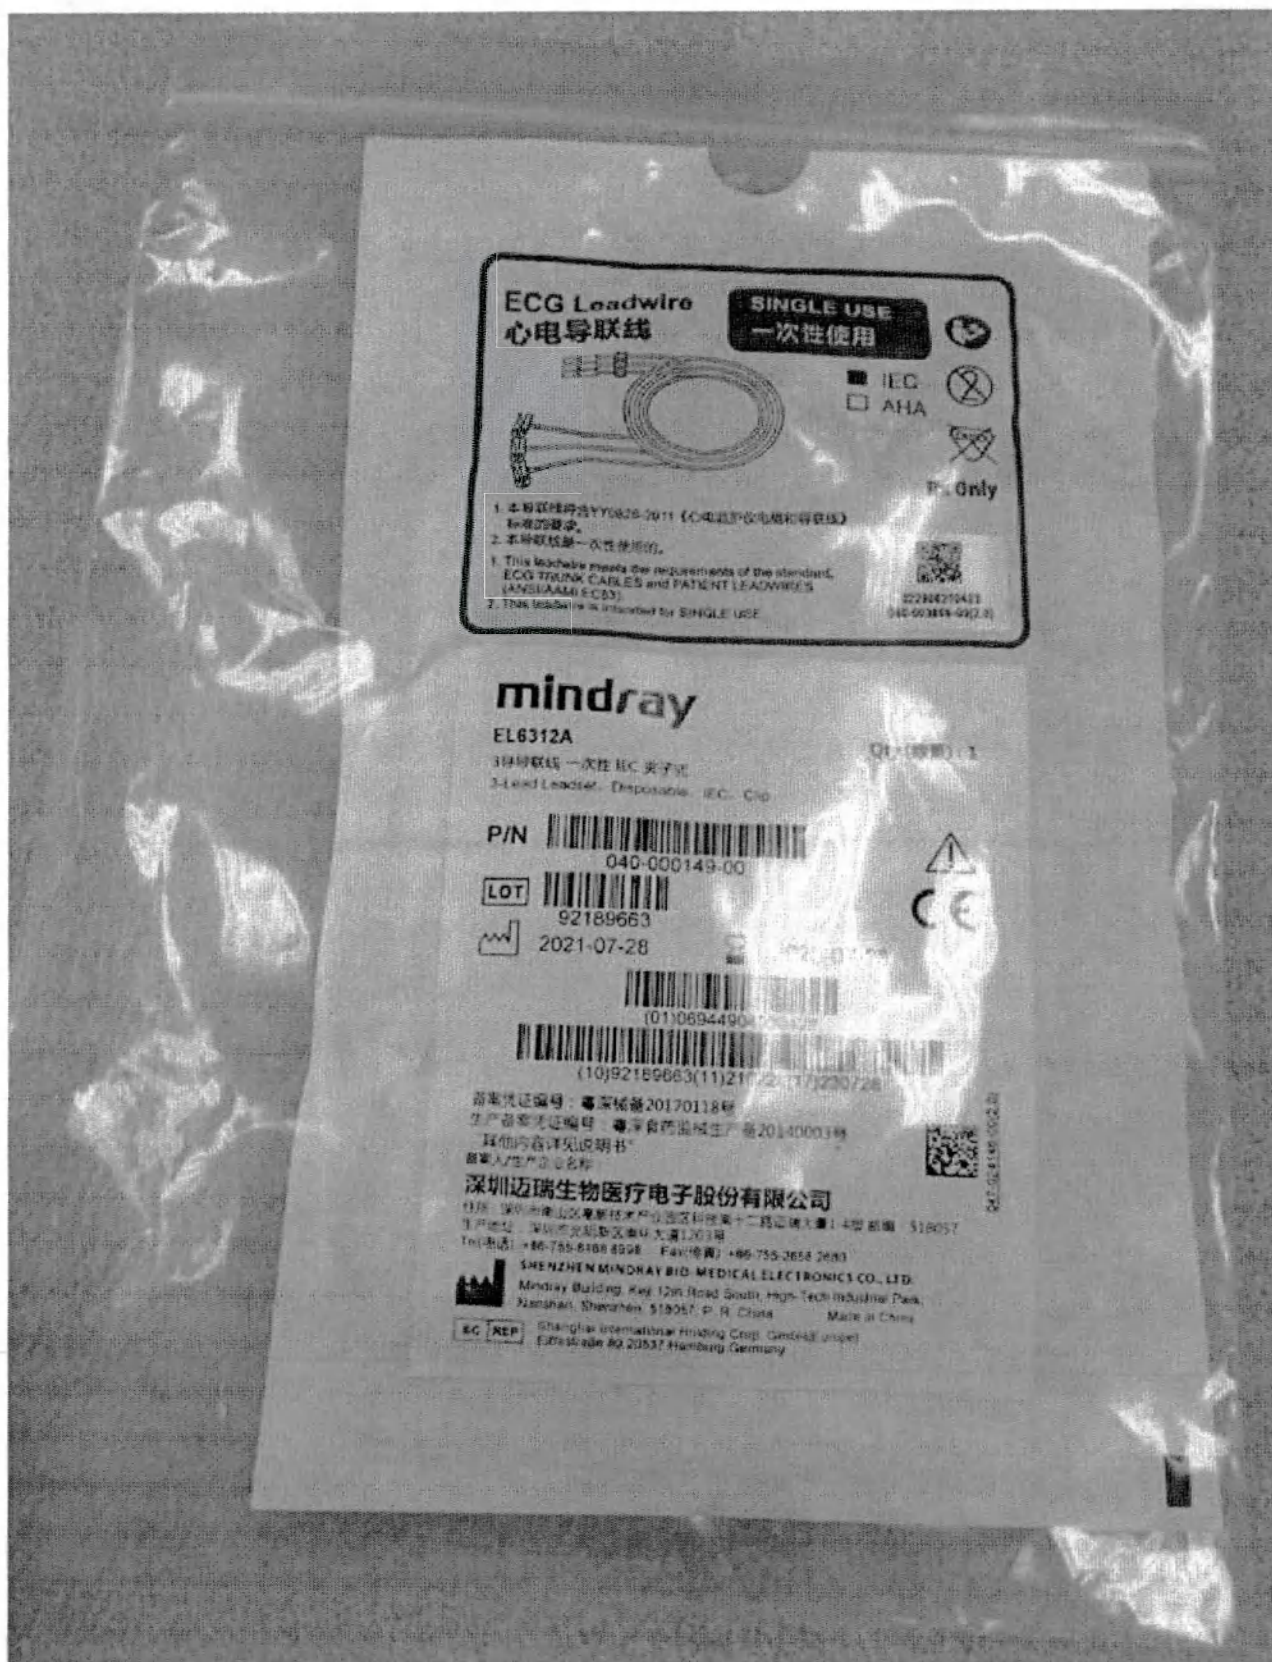

Датчик SpO2, взрослый, адгезивный, одноразовый, модель 521A

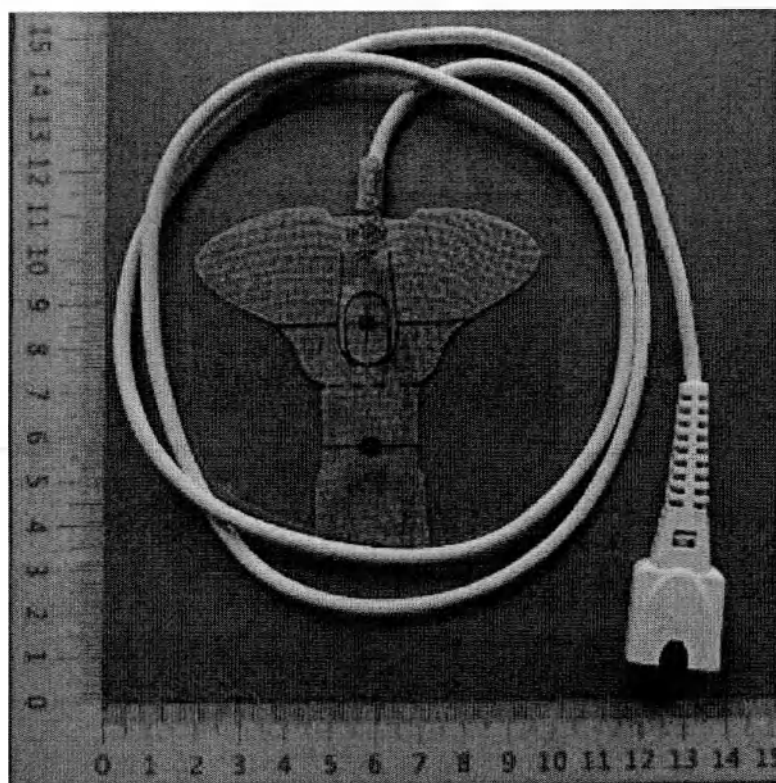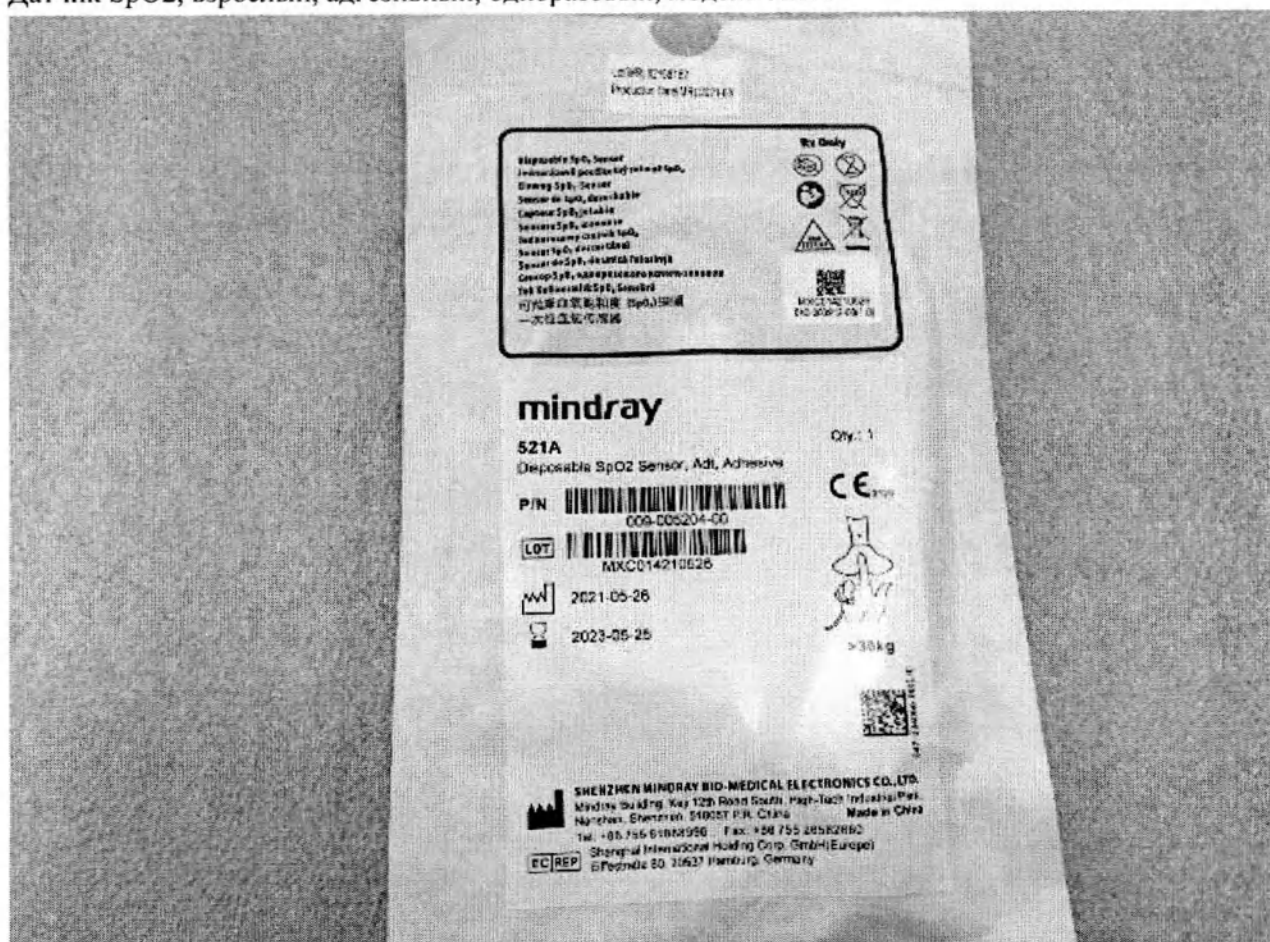

mindray

521A

Disposable SpO2 Sensor, Adt. Adhesive

Qty. : 1

P/N



009-005204-00

LOT



11918697



2019-06-05



2021-06-04

CE 0123



>30kg



(01)06944904050652



(10)11918697(11)190605(17)210604



047-024278-0011.D)



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Key 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China Made in China


Tel: +86 755 81888998 Fax: +86 755 26552680



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80 20537 Hamburg Germany

Датчик SpO2, детский, адгезивный, одноразовый, модель 521P



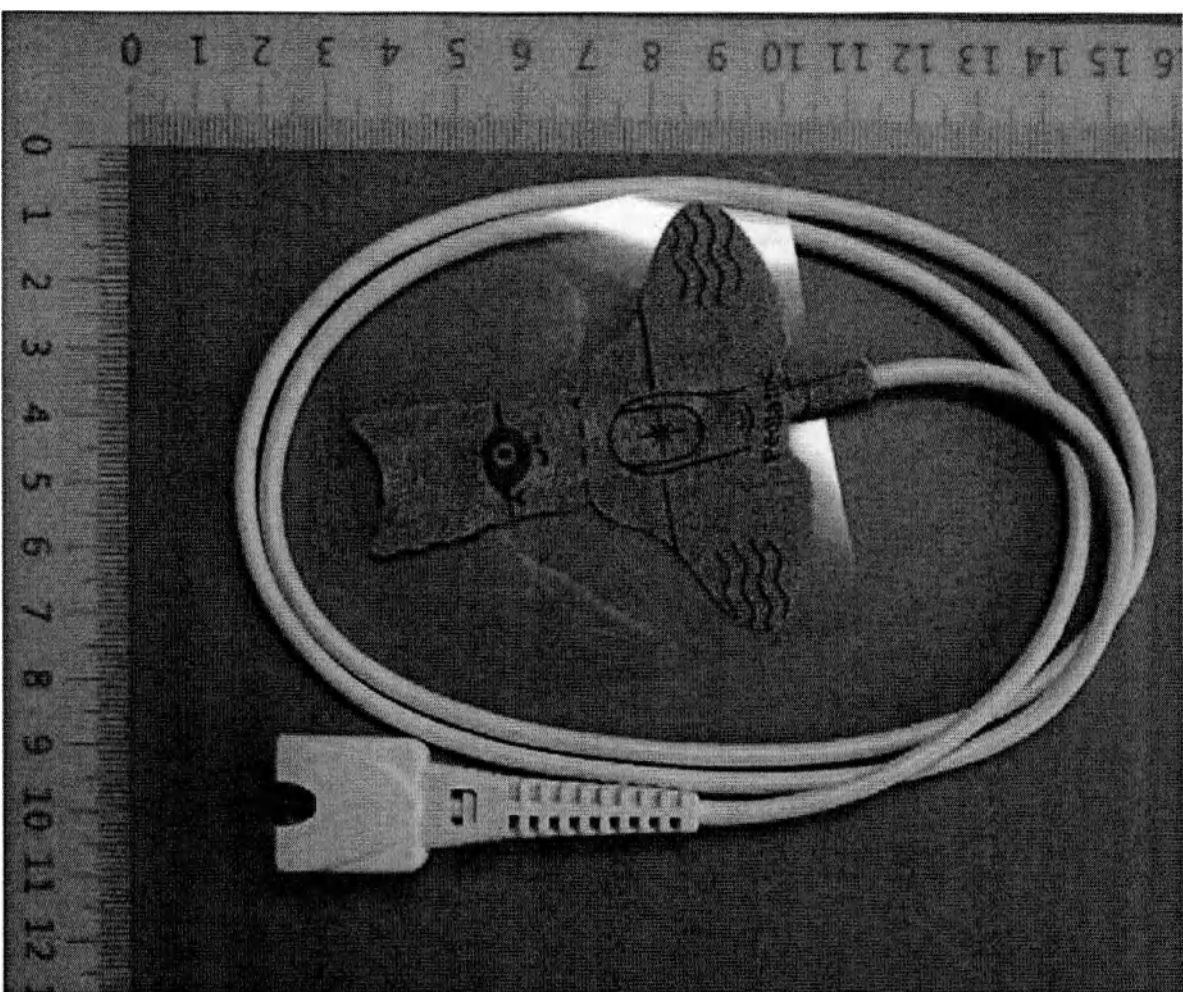

mindray

521P

Qty. : 1

Disposable SpO2 Sensor. Pdt. Adhesive

P/N



009-005205-00

CE 0123

LOT




11918698



2019-06-05



2021-06-04



10-50kg



(01)06944904050669



(10)11918698(11)190605(17)210604



047-024779-00(2.0)



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.


Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057 P. R. China Made in China

Tel: +86 755 81888998 Fax: +86 755 26582880

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Датчик SpO₂, детский маленький, адгезивный, одноразовый, модель 521I

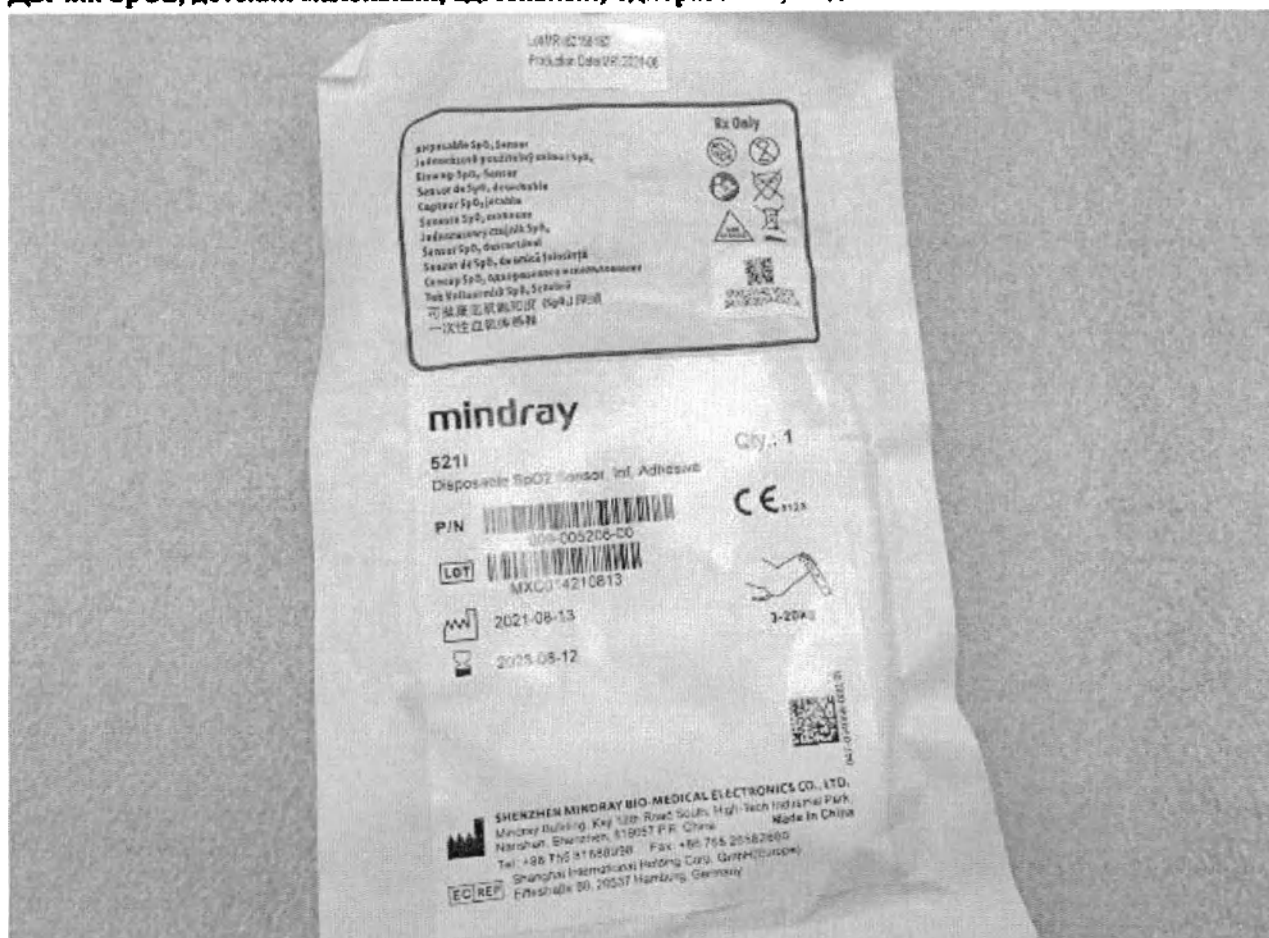

mindray

521I

Qty. : 1

Disposable SpO2 Sensor. Inf. Adhesive

P/N



009-005206-00

CE 0123

LOT



11918699



2019-06-05



2021-06-04



3-20kg



(01)06944904050676



(10)11918699(11)190605(17)210604



047-024280-00(2-0)



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.


Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park
Nanshan, Shenzhen, 518057 P. R. China Made in China

Tel: +86 755 81888998 Fax: +86 755 26582680

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Датчик SpO₂, взрослый/неонатальный, адгезивный, одноразовый, модель 521N

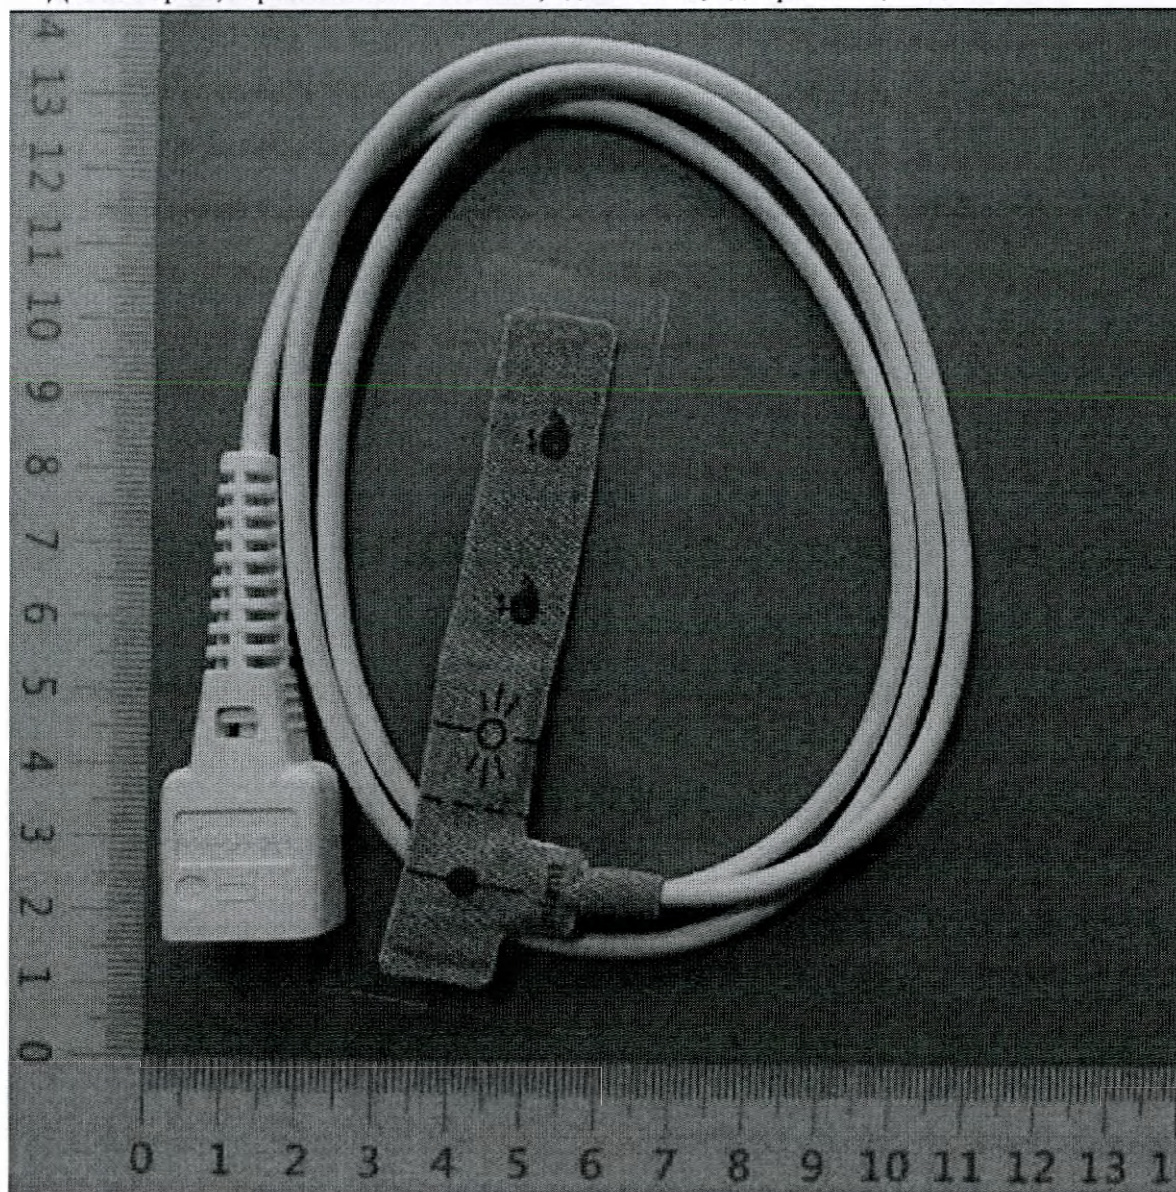

Disposable SpO₂ Sensor
 Jednorazové použitelný snímač SpO₂
 Einweg-SpO₂-Sensor
 Sensor de SpO₂ desechable
 Capteur SpO₂ jetable
 Sensoru SpO₂ monouso
 Jednorazowy czujnik SpO₂
 Sensor SpO₂ descartável
 Senzor de SpO₂ de unică folosință
 Sensor SpO₂ одноразового использования
 Tek Kullanımlık SpO₂ Sensörü
 可拋棄血氧飽和度 (SpO₂) 探頭
 一次性血氧传感器

Rx Only



MXC014210729
 043-003915-00(1/1)

mindray

521N

Qty.: 1

Disposable SpO₂ Sensor, Neo/Adt, Adhesive

P/N



009-005207-00

LOT



MXC014210729



2021-07-29



2023-07-28



<3kg



>30kg



047-034059-00(1/0)




SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
 Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
 Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R. China
Made in China

Tel: +86 755 81888998 Fax: +86 755 26582680

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
 Eiffelstraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Датчик SpO₂, взрослый, многоцветный, напалечный, модель 512FLH

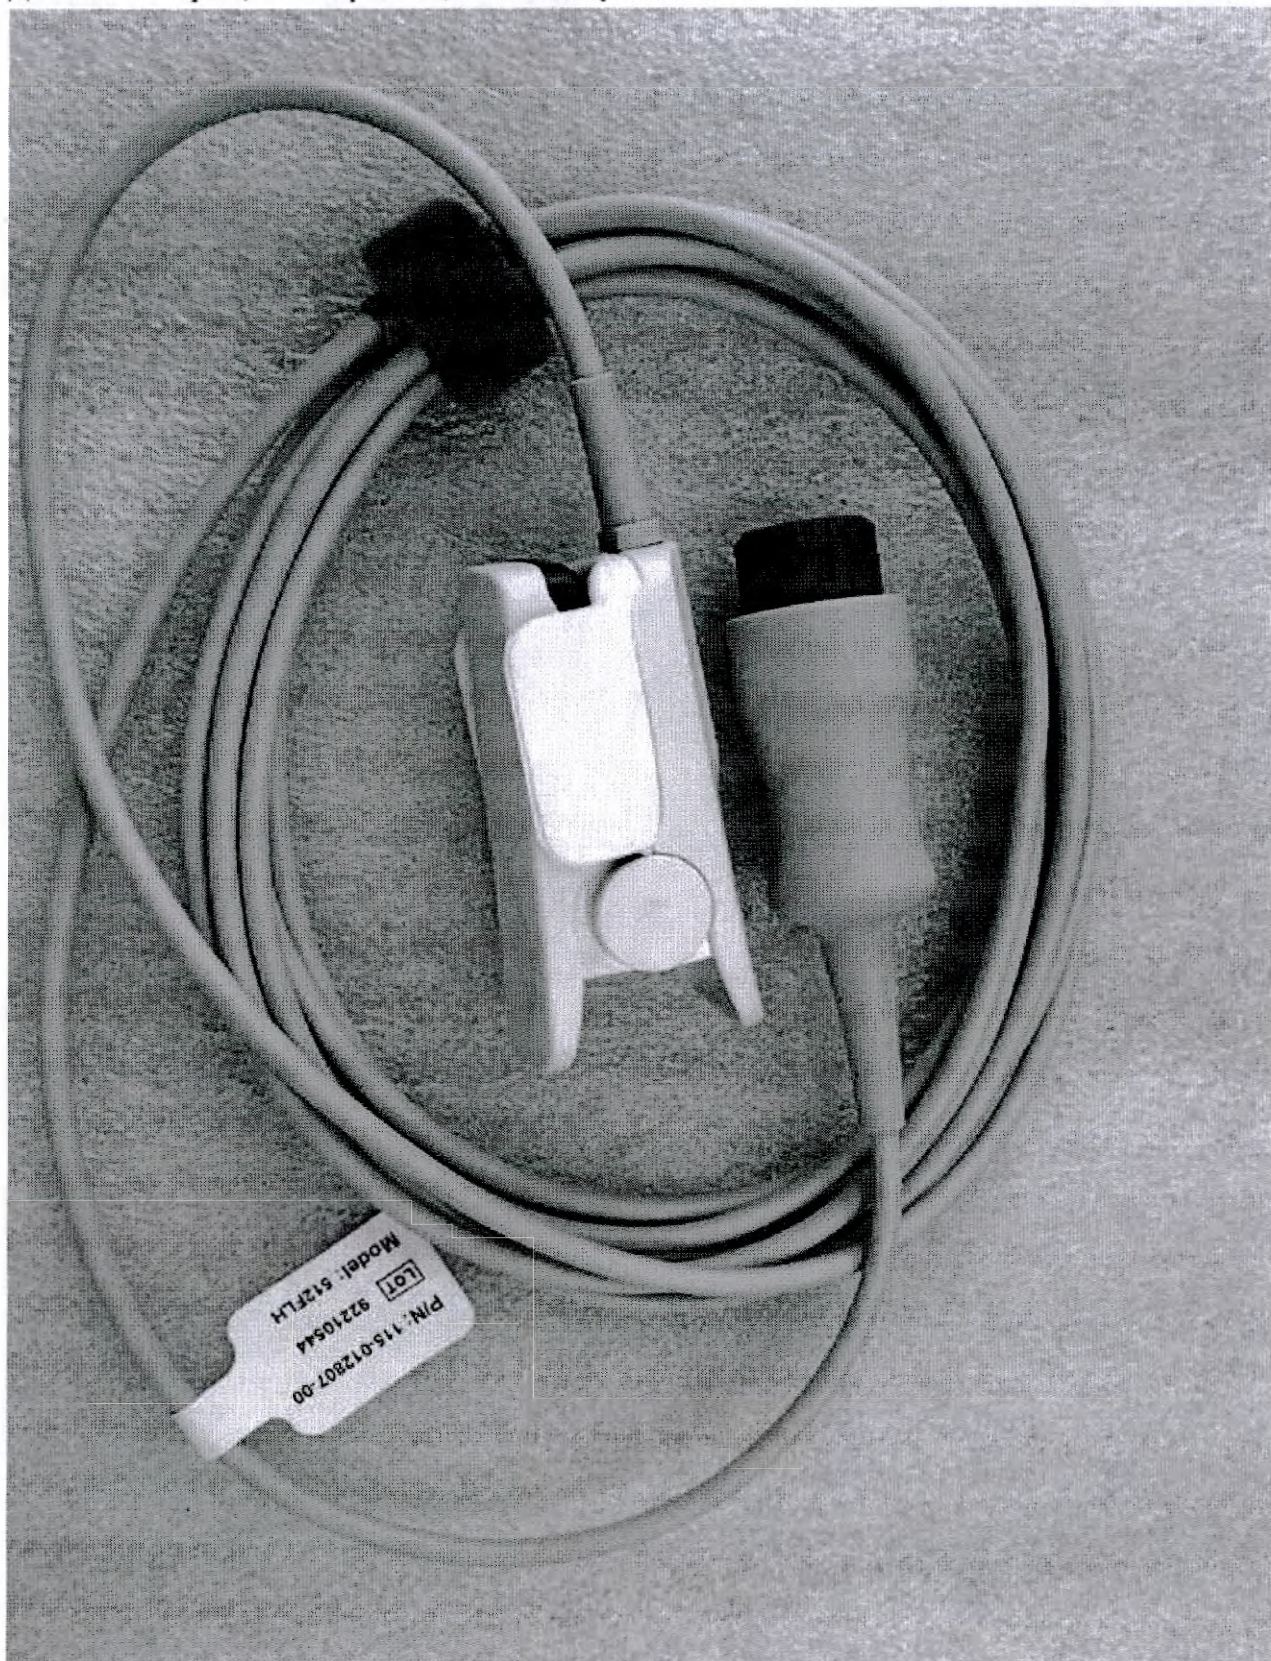



血氧传感器

SpO2 Sensor

血氧传感器/成人、指夹式、重约1g、一体式、7H1

Reusable SpO2 Sensor, Adt, Finger-Clip, 7P

512FLH

P/N



115-012807-00

LOT



92210544



2021-08-02

Qty (数量): 1

mind

Medtronic

1. PROXIMITY

Allegre T22

CIDEX® OF

Clorox Disinfect

Clorox H

Wipes

Clorox H

Peroxide

Diverse

Hydrog

ISOPO

Matrix CavCide 1™

Wetrex CavWipes™

PDI San Cloth AF3 Germicidal


Disposable Wipe

PDI San Cloth Bleach Germicidal


Disposable Wipe

PDI San Cloth Germicidal

Disposable Wipe



0123



Rx Only



047 029804-00(1 0)

注册人/生产企业名称:

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

住所: 深圳市福田区香蜜湖街道香蜜湖社区香蜜湖一路1201号

生产地址: 深圳市福田区香蜜湖街道香蜜湖社区香蜜湖一路1201号

电话: +86-755-8188 8998 Fax: +86-755-2658 2000

SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.


Ministry Building, New 12th Road South, High Tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen 518057, P. R. China

Shanghai International Medical Equipment Corporation, 1000 Century Avenue East, Shanghai 200120, P. R. China


EC REP

2021-08-02

Датчик SpO2, неонатальный, многоцветный, на ногу, модель 518BLH

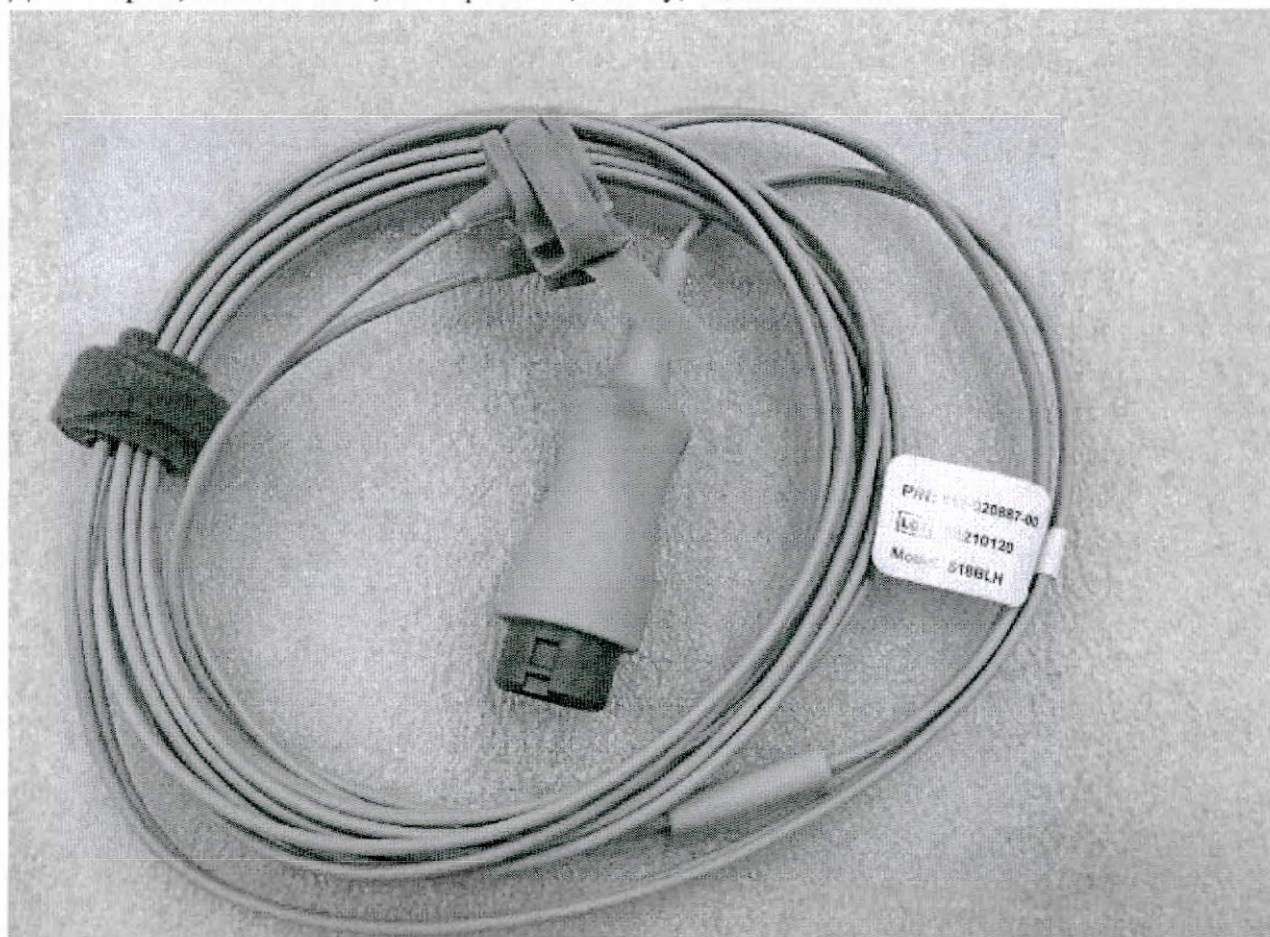


Фиксатор для датчика SpO2, модель 518C

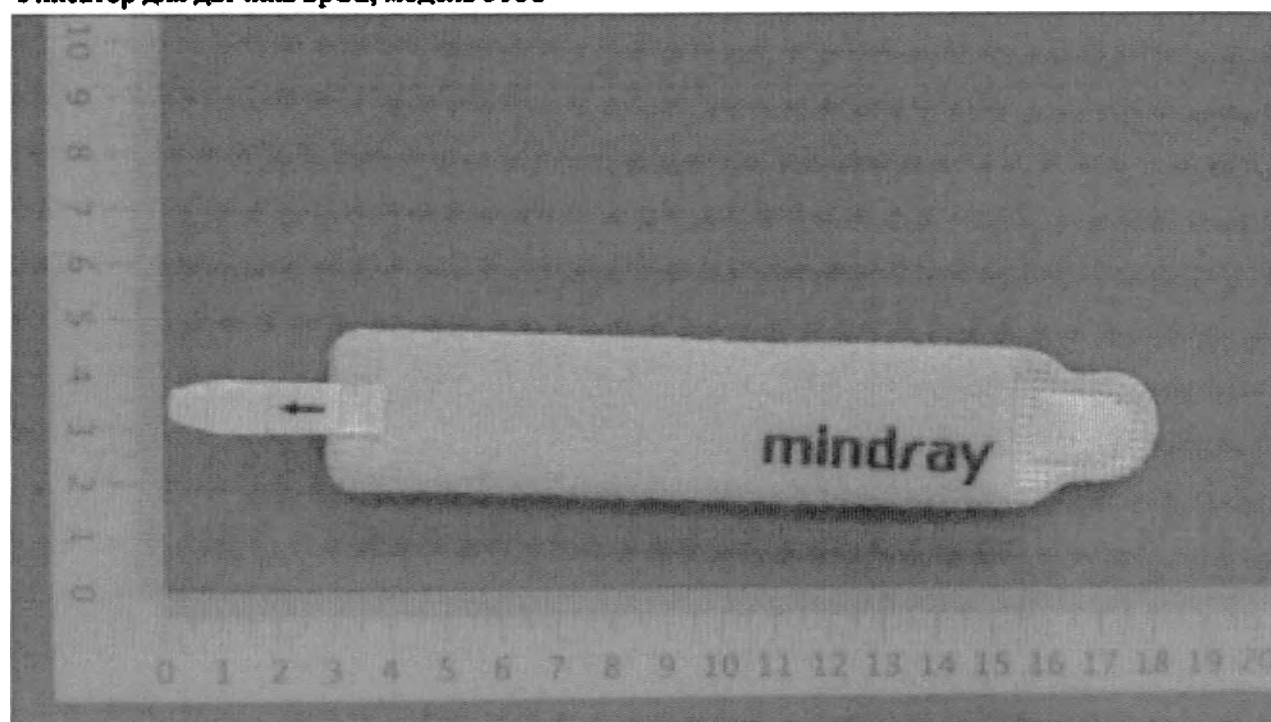


Датчик SpO2 взрослый, одноразовый, модель 520A



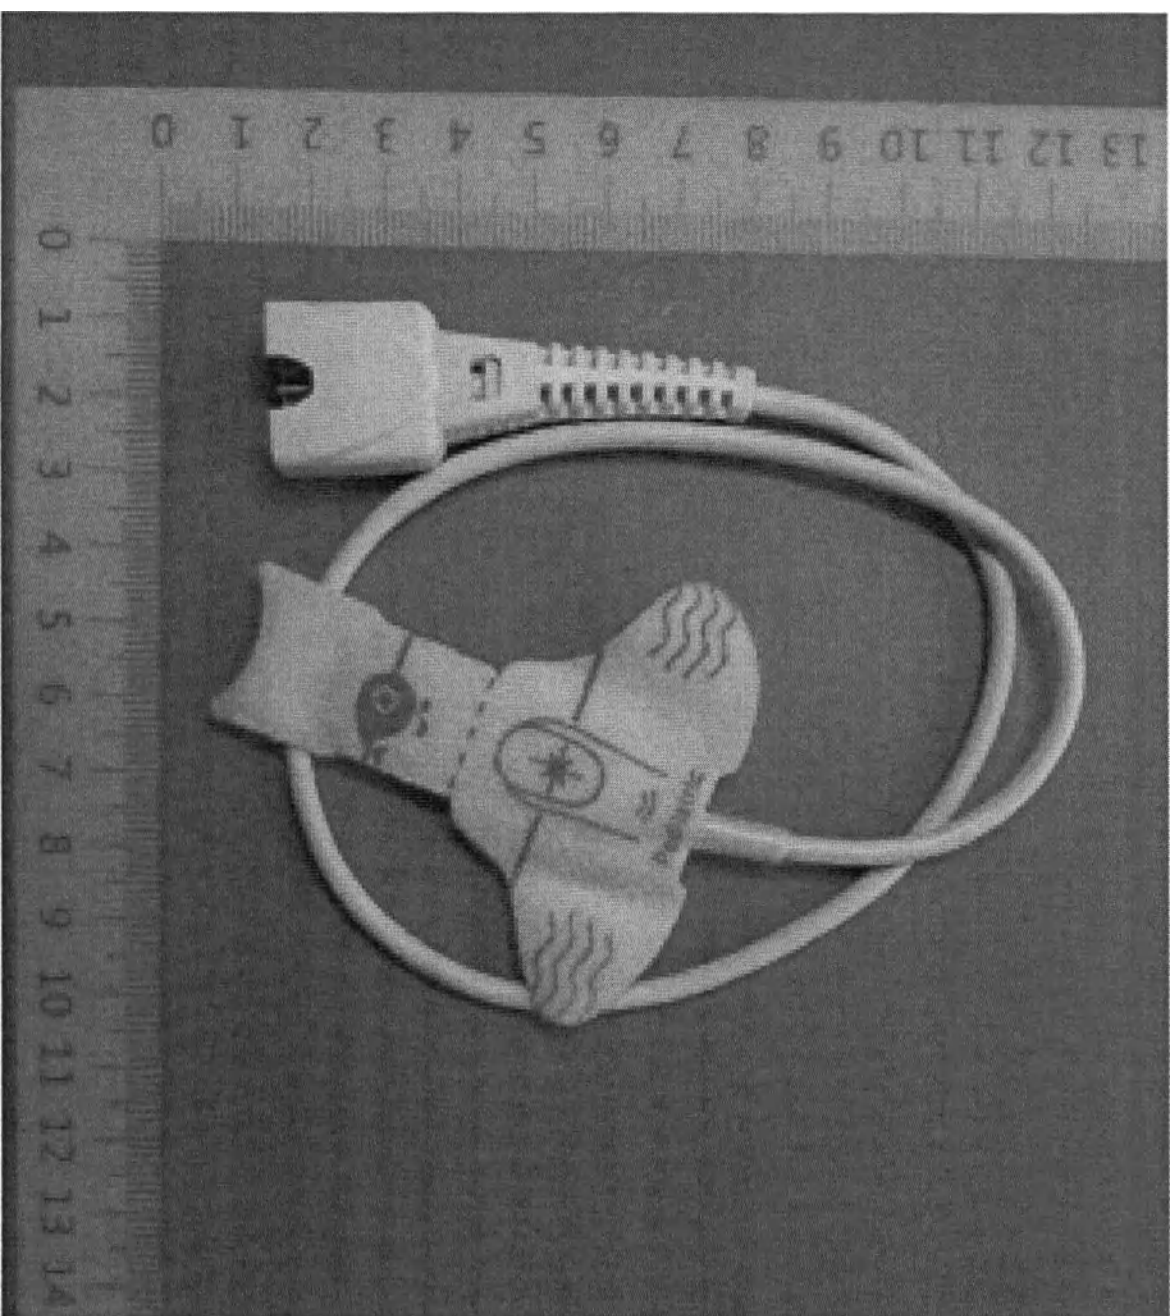

Датчик SpO₂ детский, одноразовый, модель 520P

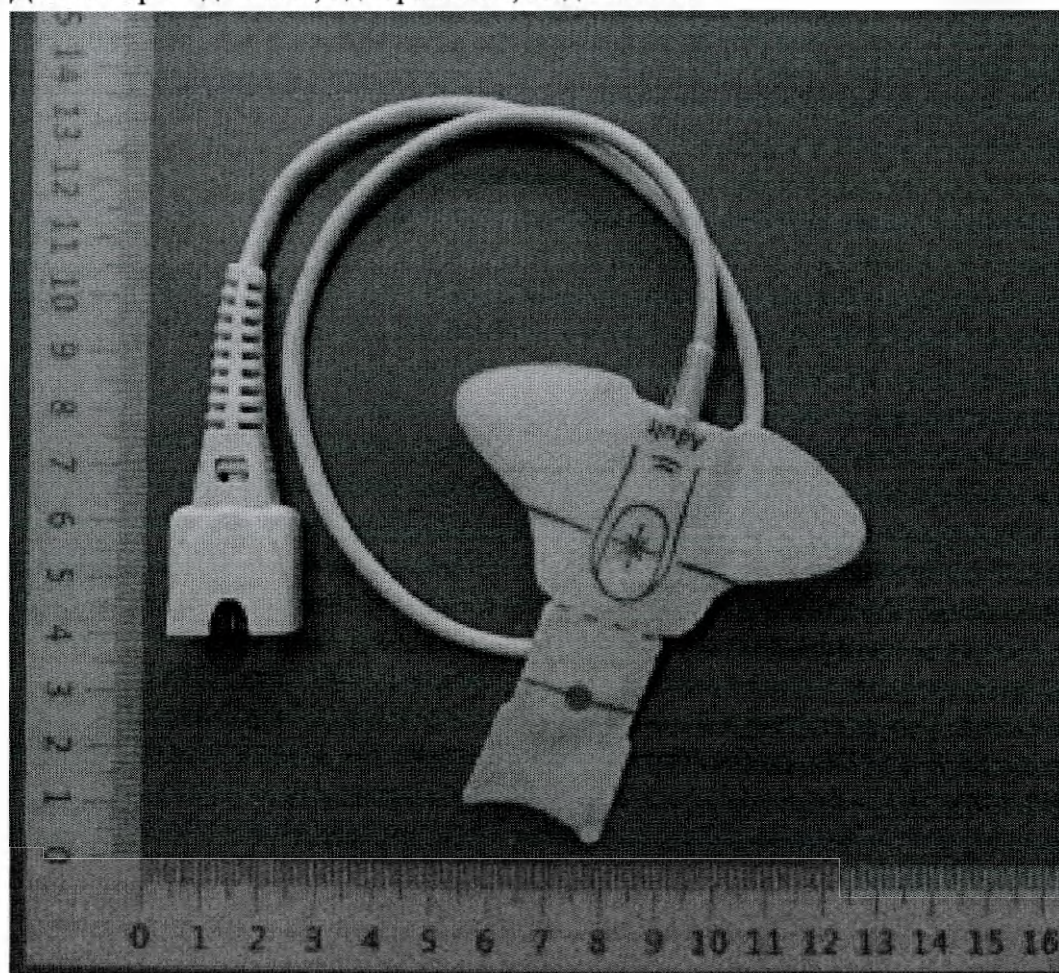

Disposable SpO₂ Sensor
 Jednorázové použité senzory SpO₂
 Einweg-SpO₂ Sensor
 Sensor de SpO₂ desechable
 Capteur SpO₂ jetable
 Sensor SpO₂ monousa
 Jednorazowy czujnik SpO₂
 Sensor SpO₂ descartável
 Senzor de SpO₂ de unică folosință
 Сенсор SpO₂ однократного использования
 Tek Kullanımlık SpO₂ Sensörü
 可拋棄血氧飽和度 (SpO₂) 探頭
 一次性血氧传感器

Rx Only



MXC014200421
 040-003908-00(1 0)

mindray

520P

Disposable SpO₂ Sensor, Pdt, Non-adhesive

Qty.: 1

P/N



009-005201-00

LOT



MXC014200421




2020-04-21



2022-04-20

CE 0123



10-50kg



047 034067 00(1 0)



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
 Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R. China

Made in China

Tel: +86 755 81888998 Fax: +86 755 26582680




Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)

Eiffelstraße 80, 20537 Hamburg, Germany

Датчик SpO2 детский маленький, одноразовый, модель 520I



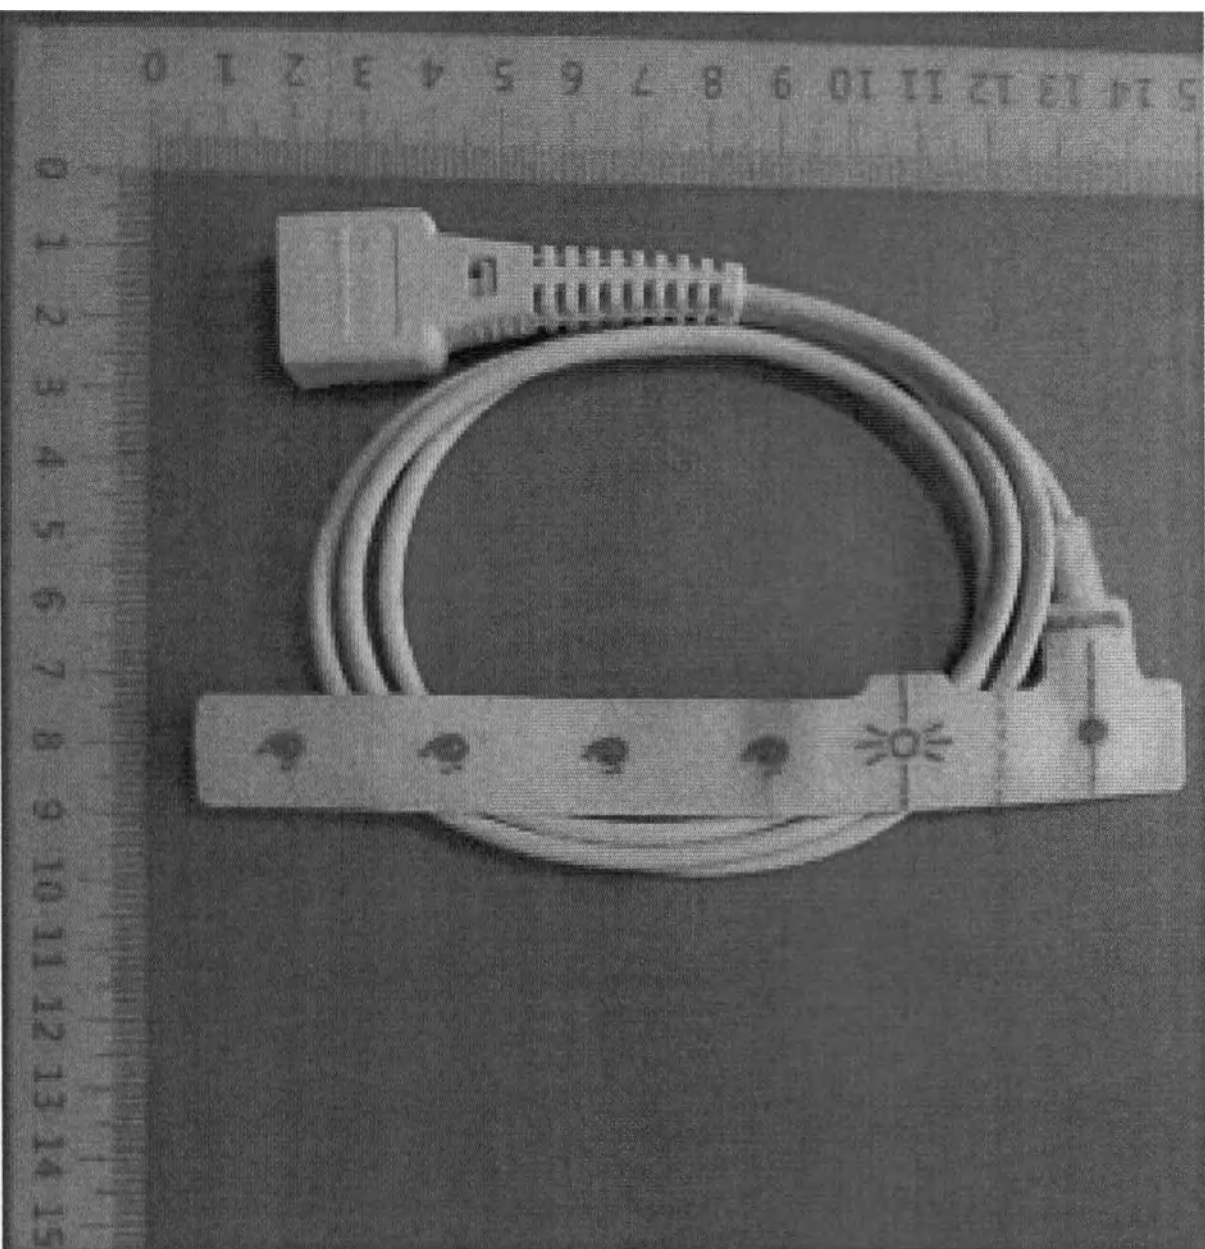

mindray

520I

Qty. : 1

Disposable SpO2 Sensor. Inf. Non-adhesive

P/N



009-005202-00

CE 0123

LOT



11918695



2019-06-05



2021-06-04



3-20kg



(01)06944904050638



047-524789-0812.9



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building Key 12th Road South High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China Made in China


Tel. +86 755 81888998 Fax. +86 755 28522680



Shanghai International Holding Corp GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



Манжета одноразовая, детская маленькая, модель CM1501

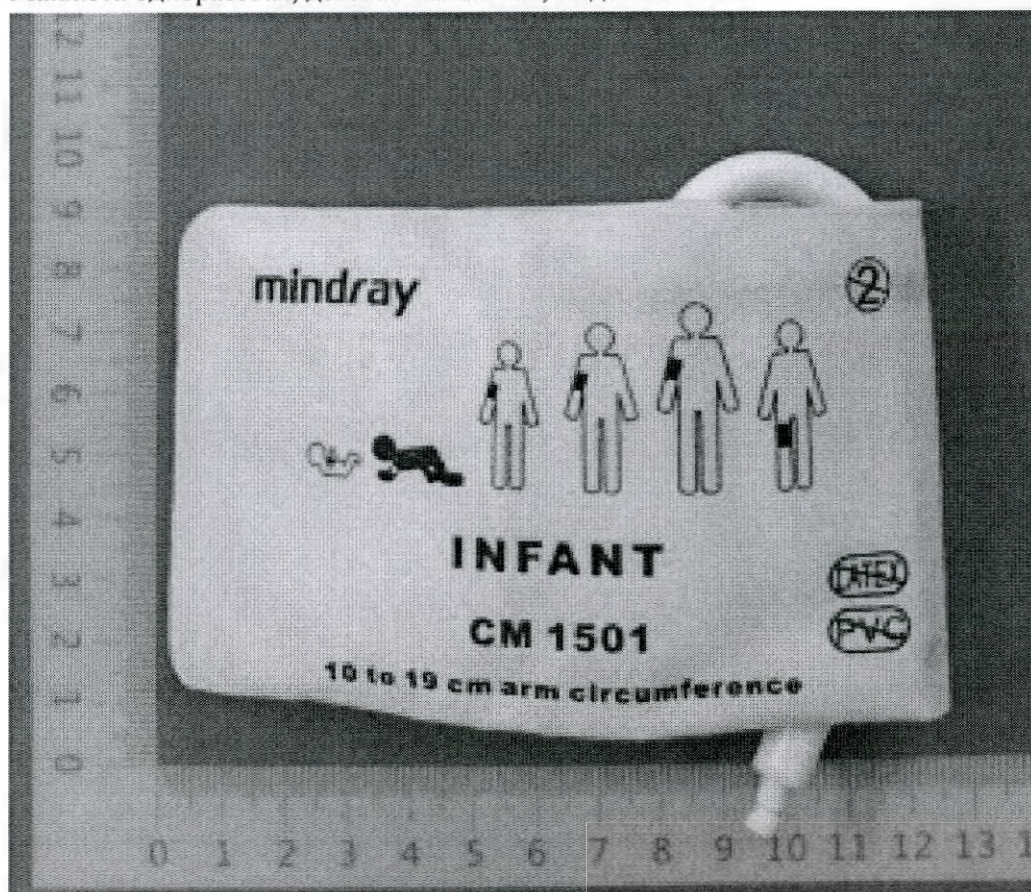

血压袖套
NIBP Cuff

单病人婴儿血压袖套成品(CM1501)
Disposable infant blood cuff (CM1501)

CM1501

Qty.(数量): 1

P/N



115-054841-00

LOT



91320728



2021-07-20



2023-07-20



(01)06936415903954



(10)91320728(11)210720(17)230720

备案凭证编号: 粤深械备20170119号

生产备案凭证编号: 粤深食药监械生产备20140003号

其他内容详见说明书



Rx Only

备案人/生产企业名称:

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

住所: 深圳市南山区高新技术产业园科技南十二路迈瑞大厦1-4楼 邮编: 518057

生产地址: 深圳市光明新区南环大道1203号

联系电话: +86-755-8188 8998 Fax(传真): +86-755-2658 2680

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial
Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China. Made in China



EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Elifstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany



047-02-02-002 0

Манжета одноразовая, детская, модель CM1502



血压袖套

NIBP Cuff

单病人小儿血压袖套成品(CM1502)

Disposable child blood cuff(CM1502)

CM1502

Qty.(数量):1

P/N



115-054842-00

LOT



91320427



2021-05-27



2023-05-27



(01)06936415903961



(10)91320427(11)210527(17)230527

备案凭证编号: 粤深械备20170119号

生产备案凭证编号: 粤深食药监械生产备20140003号

"其他内容详见说明书"



Rx Only

备案人/生产企业名称:

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

住所: 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层 邮编: 518057

生产地址: 深圳市光明新区南环大道1203号

Tel(电话): +86-755-8188 8998 Fax(传真): +86-755-2658 2680



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

Made in China

EC REP

Shanghai International Holding Corp GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



047-024272-00(2/0)

Манжета одноразовая, взрослая, модель CM1503





血压袖套

NIH P. Cuff

单人/成人血压袖套成品(CM1503)

Disposable adult blood cuff(CM1503)

CM1503

Qty.(数量): 1

P/N


115-054843-00

LOT

91320054

2021-05-06

2023-05-06




(10)91320054(1)210506(1)7230506

(01)06930415903978

患者追溯编号: 见说明书

生产追溯编号: 见说明书

其他内容详见说明书



CE

Rx Only

制造商/生产企业名称:

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

地址: 深圳市福田区梅林街道办梅林社区梅兰路1-4号 邮编: 518057

生产地址: 深圳市宝安区西乡街道西乡社区西乡大道1201号

联系电话: +86 755-8168 8998 传真: +86 755-2653 2860

SHENZHEN MINIRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Miniray Building, Kuo 12th Road South, High-Tech Industrial

Park, Nanpuan, Shenzhen, 518057, P. R. China, Made in China

Shenzhen Miniray Medical Device Co., Ltd. (Europe)

Unterstraße 30 20537 Hamburg Germany




EC REP



047-024272-0002-01

Манжета одноразовая, взрослая большая, модель CM1504

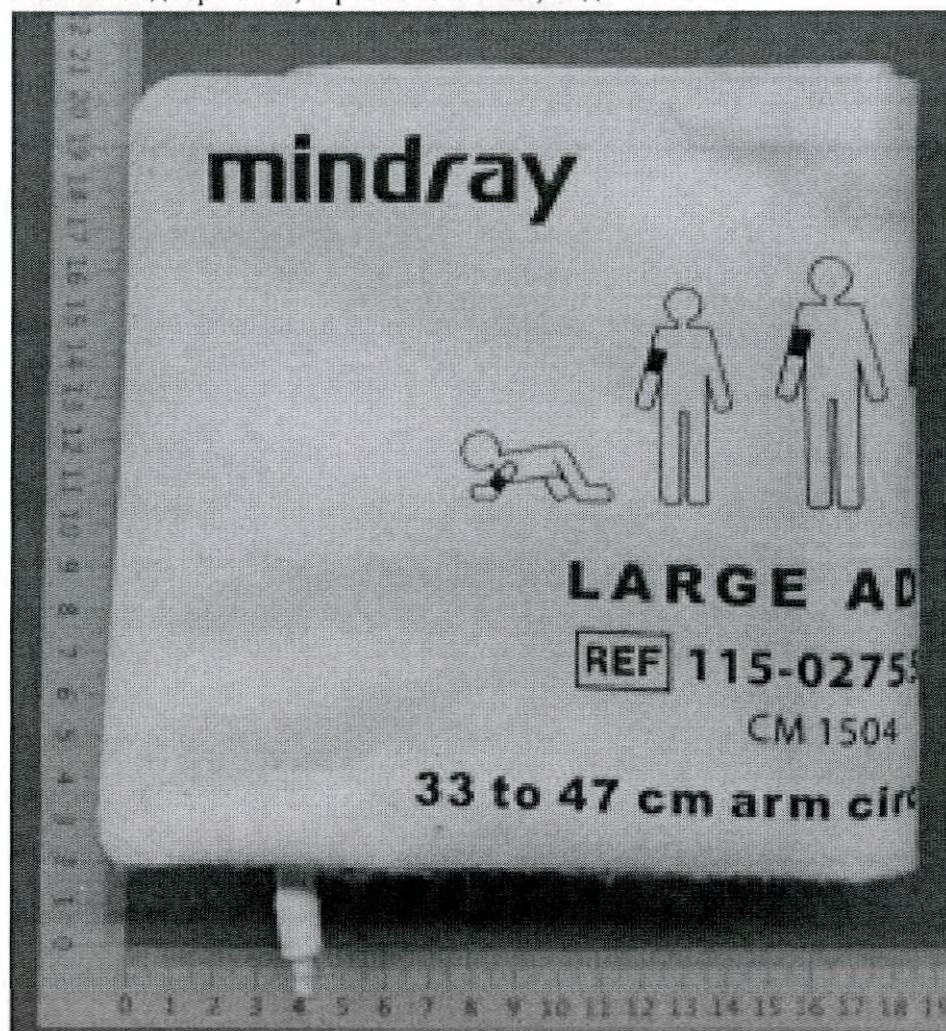

血压袖套
NIBP Cuff

单病人大成人血压袖套组件(CM1504)
Disposable L-Adult Blood Cuff(CM1504)

CM1504

Qty. (数量) :

P/N 115-054844-00

LOT 91319701

2021-02-08

2023-02-08

(01)06936415903985
(10)91319701(11)210206(17)230208

备案凭证编号: 粤深备证201701119号
生产备案凭证编号: 粤深备证20140203号
“其他内容详见说明书”

CE Rx Only

备案人/生产企业名称:

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

(住所: 深圳市福田区高新技术产业园南区科苑路十二路迈瑞大厦1-4层 邮编: 518057)

生产地址: 深圳市福田区梅林街道1203号

Tel(电话): +86-755-8188 8908 Fax(传真): +86-755-2558 2050

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Key 12th Road South, High-Tech Industrial Park,


Nanshan, Shenzhen 518057, P. R. China Made in China

EC REP


Shanghai International Hiking Corp. GmbH(Europe)

Elfenstraße 80, 20037 Hamburg, Germany



Манжета одноразовая, набедренная, модель CM1505

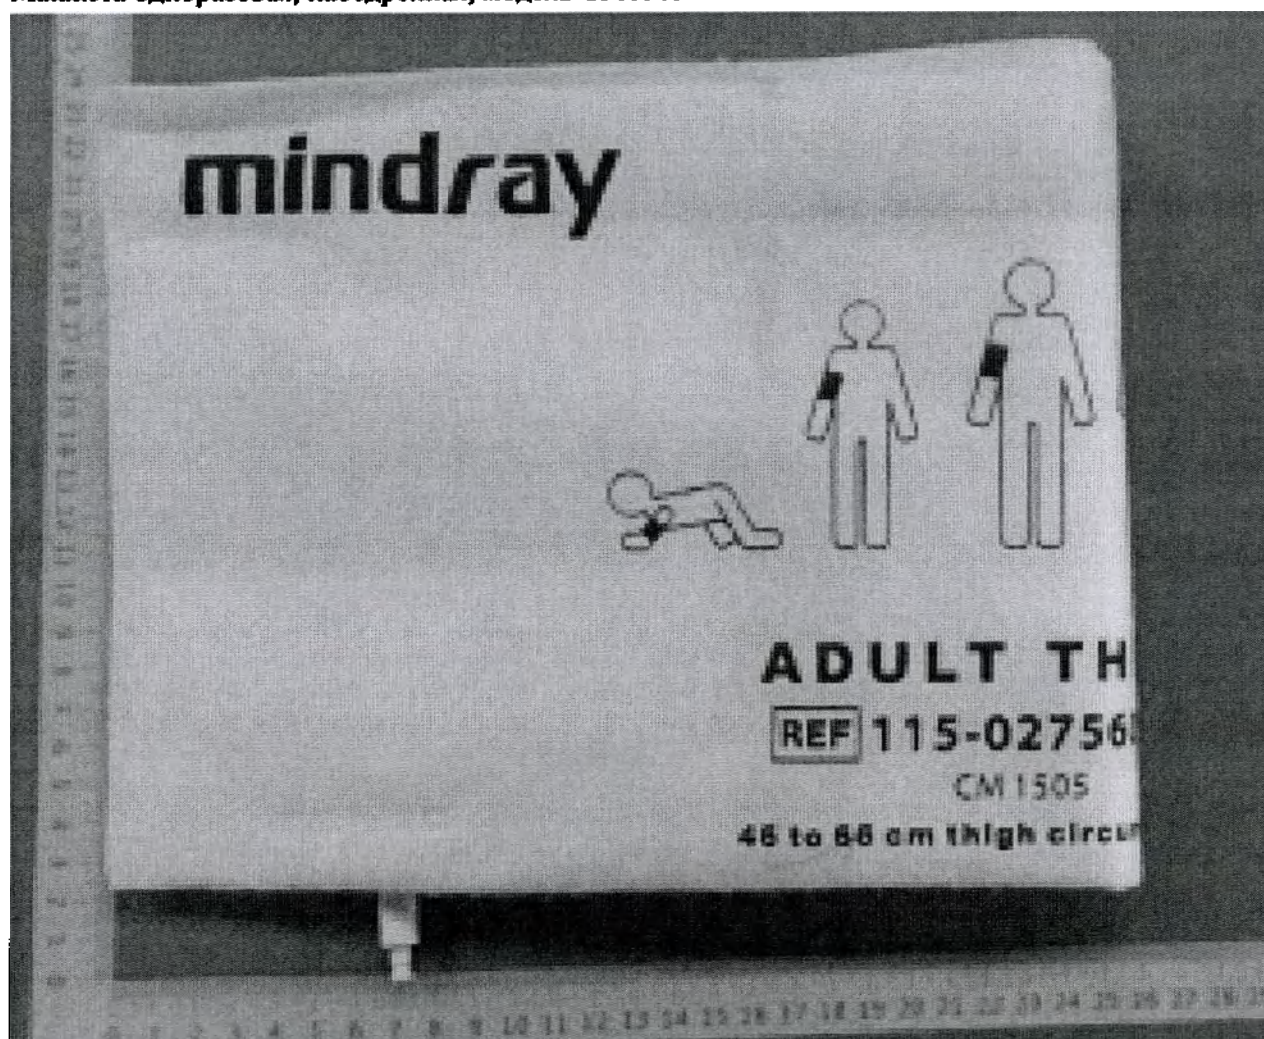


1.35. Манжета одноразовая, неонатальная, размером 3,1-5,7 см, модель CM1500A

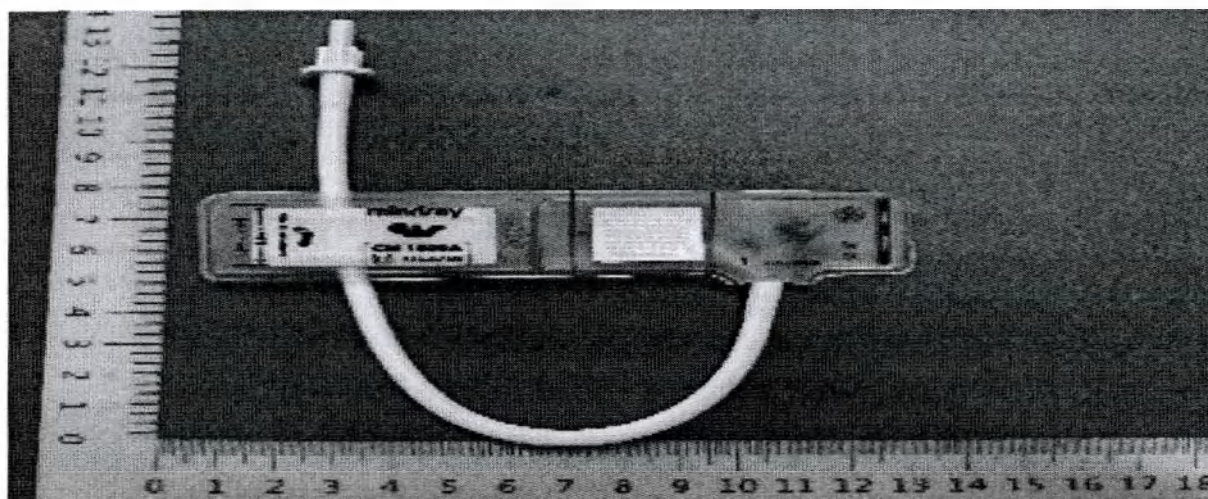

1.36. Манжета одноразовая, неонатальная, размером 4,3-8,0 см, модель CM1500B

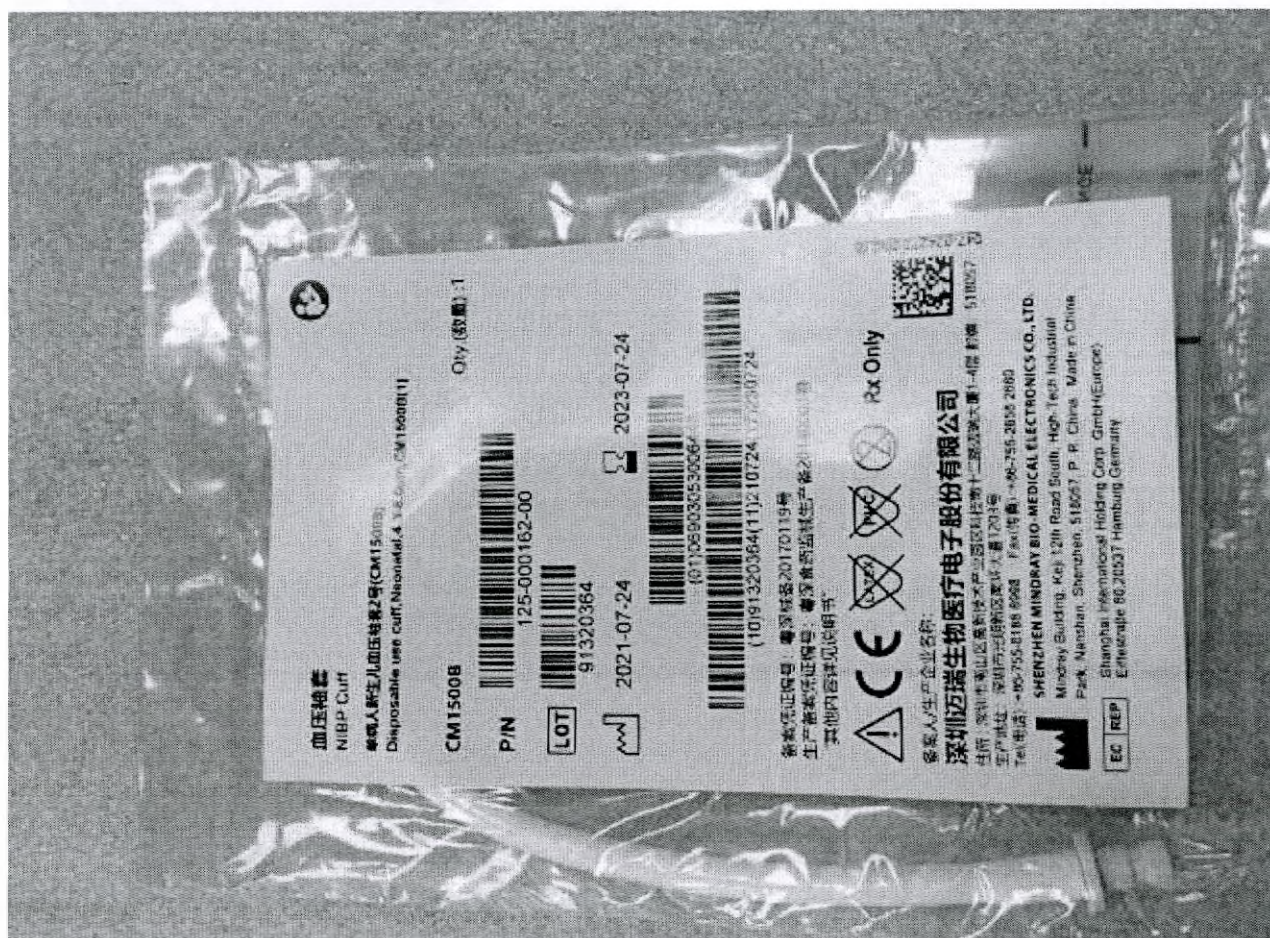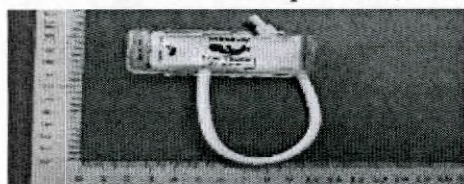

1.37. Манжета одноразовая, неонатальная, размером 5,8-10,9 см, модель CM1500C) - не более 1000 шт. (при необходимости).

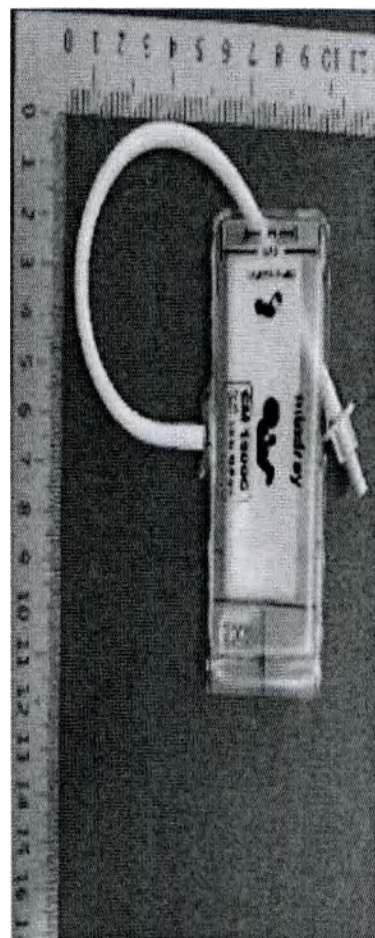



City (設廠) : 1

125-000163-00

125-000163-00

91320365

UN:

2021-07-26



2023-07-26

(01)06903053006453

(10)91320365(11)210726(17)230726

(10) 91320365 (11) 210726 (17) 230726

最新第三版 臺灣版 2017.01.19

牛已留家无口病，确诊为留家生产猪20140003号

其他方药详见说明书。



Rx Only



047-024272-00(2.0)

需要人/生产企业名称:

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

生产地址 深圳市宝安区沙井镇大壆1203号
T: 0755-8390 6066

三戸地区 茨城県水戸市水戸区水戸1203番

Tel (电话) +86-755-8100 8000 Fax (传真)

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS

41000000 Building Kaei 13th Road South Park Tech. Institute, Daejeon

County Building, 1001 2nd Road South, High-Tech Industrial Park
Nashville, Tennessee 37203 & P. O. Box 110000, Nashville, Tennessee 37211


FASTSCAN, Shenzhen 518057 P. R. China
Fax: +86 755 2666 6666


EC REP	Shanghai International Holding Corp. GmbH/Europäische Metallwerke AG, 20087 Hamburg, Germany
--------	--


Entscheidungs 60.20537 Hamburg Germany

NAME


Манжета одноразовая, неонатальная, размером 7,1- 13,1 см, модель

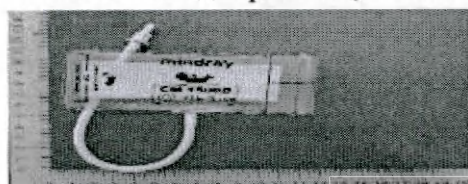

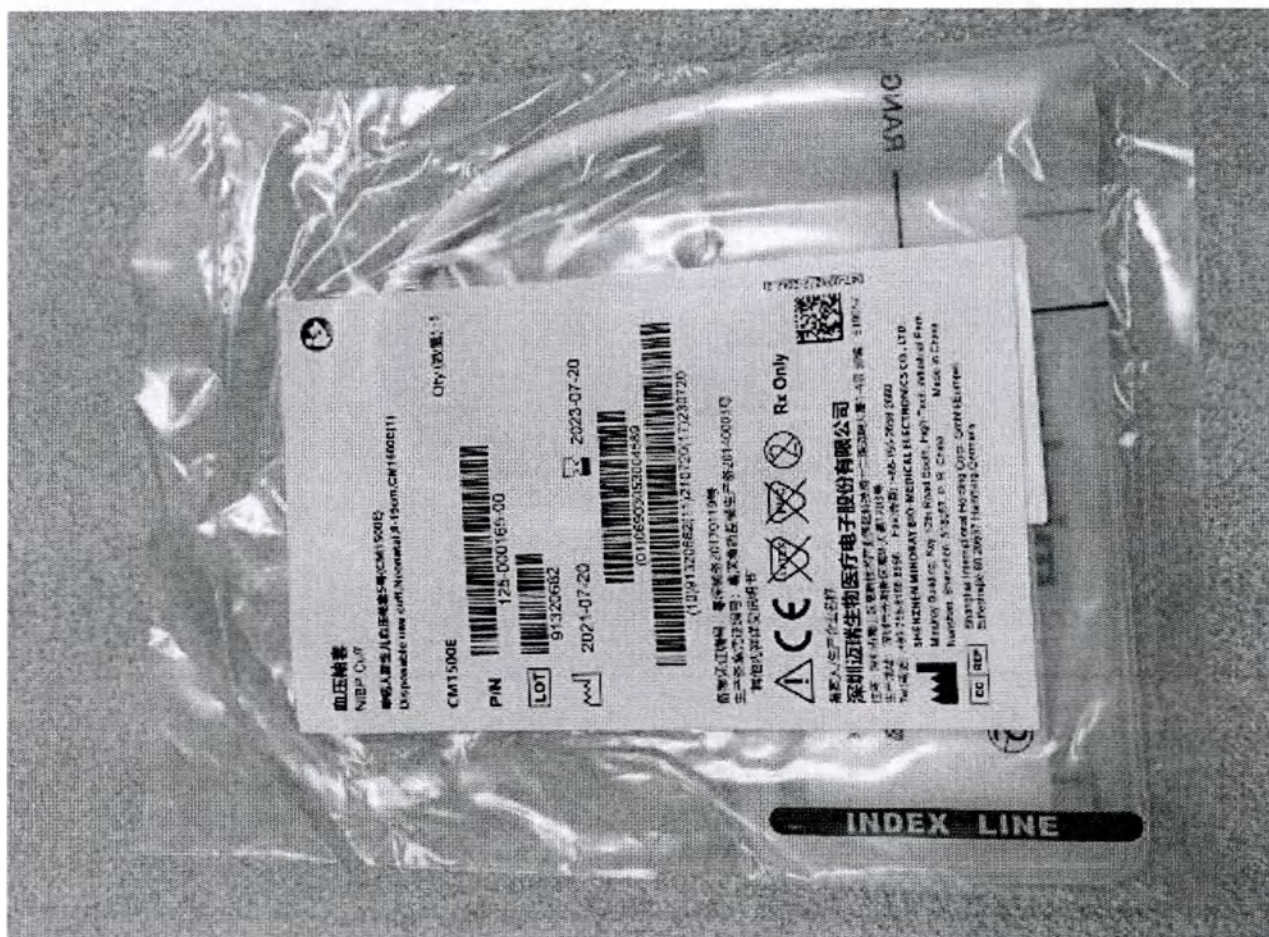


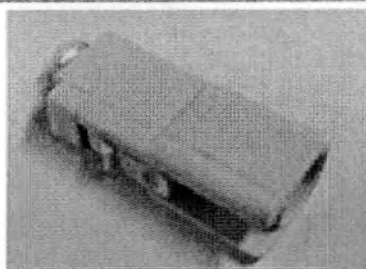


Внешние электроды для автоматической наружной дефибрилляции АНД, одноразовые, для взрослых и детей, модель MR62

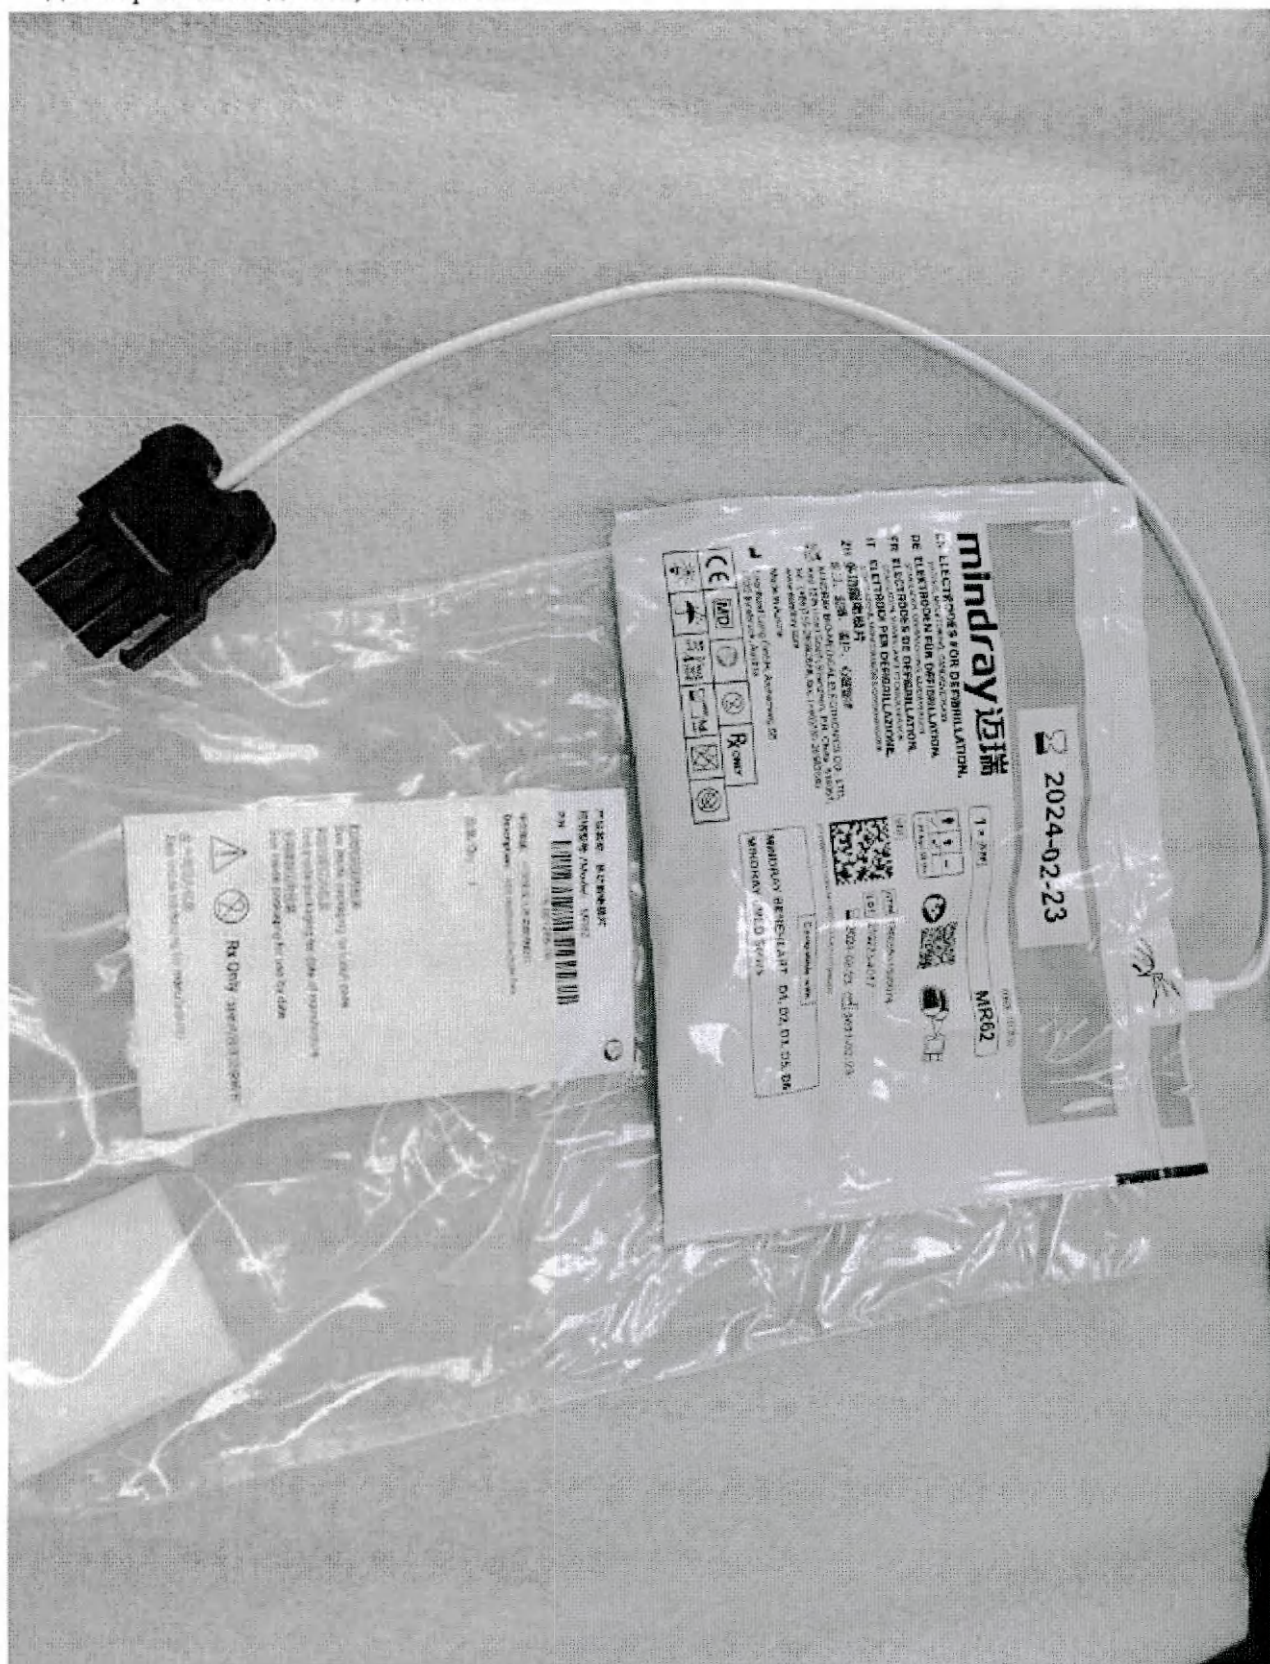


Внешние электроды для автоматической наружной дефибрилляции АНД, одноразовые, для детей, модель MR63

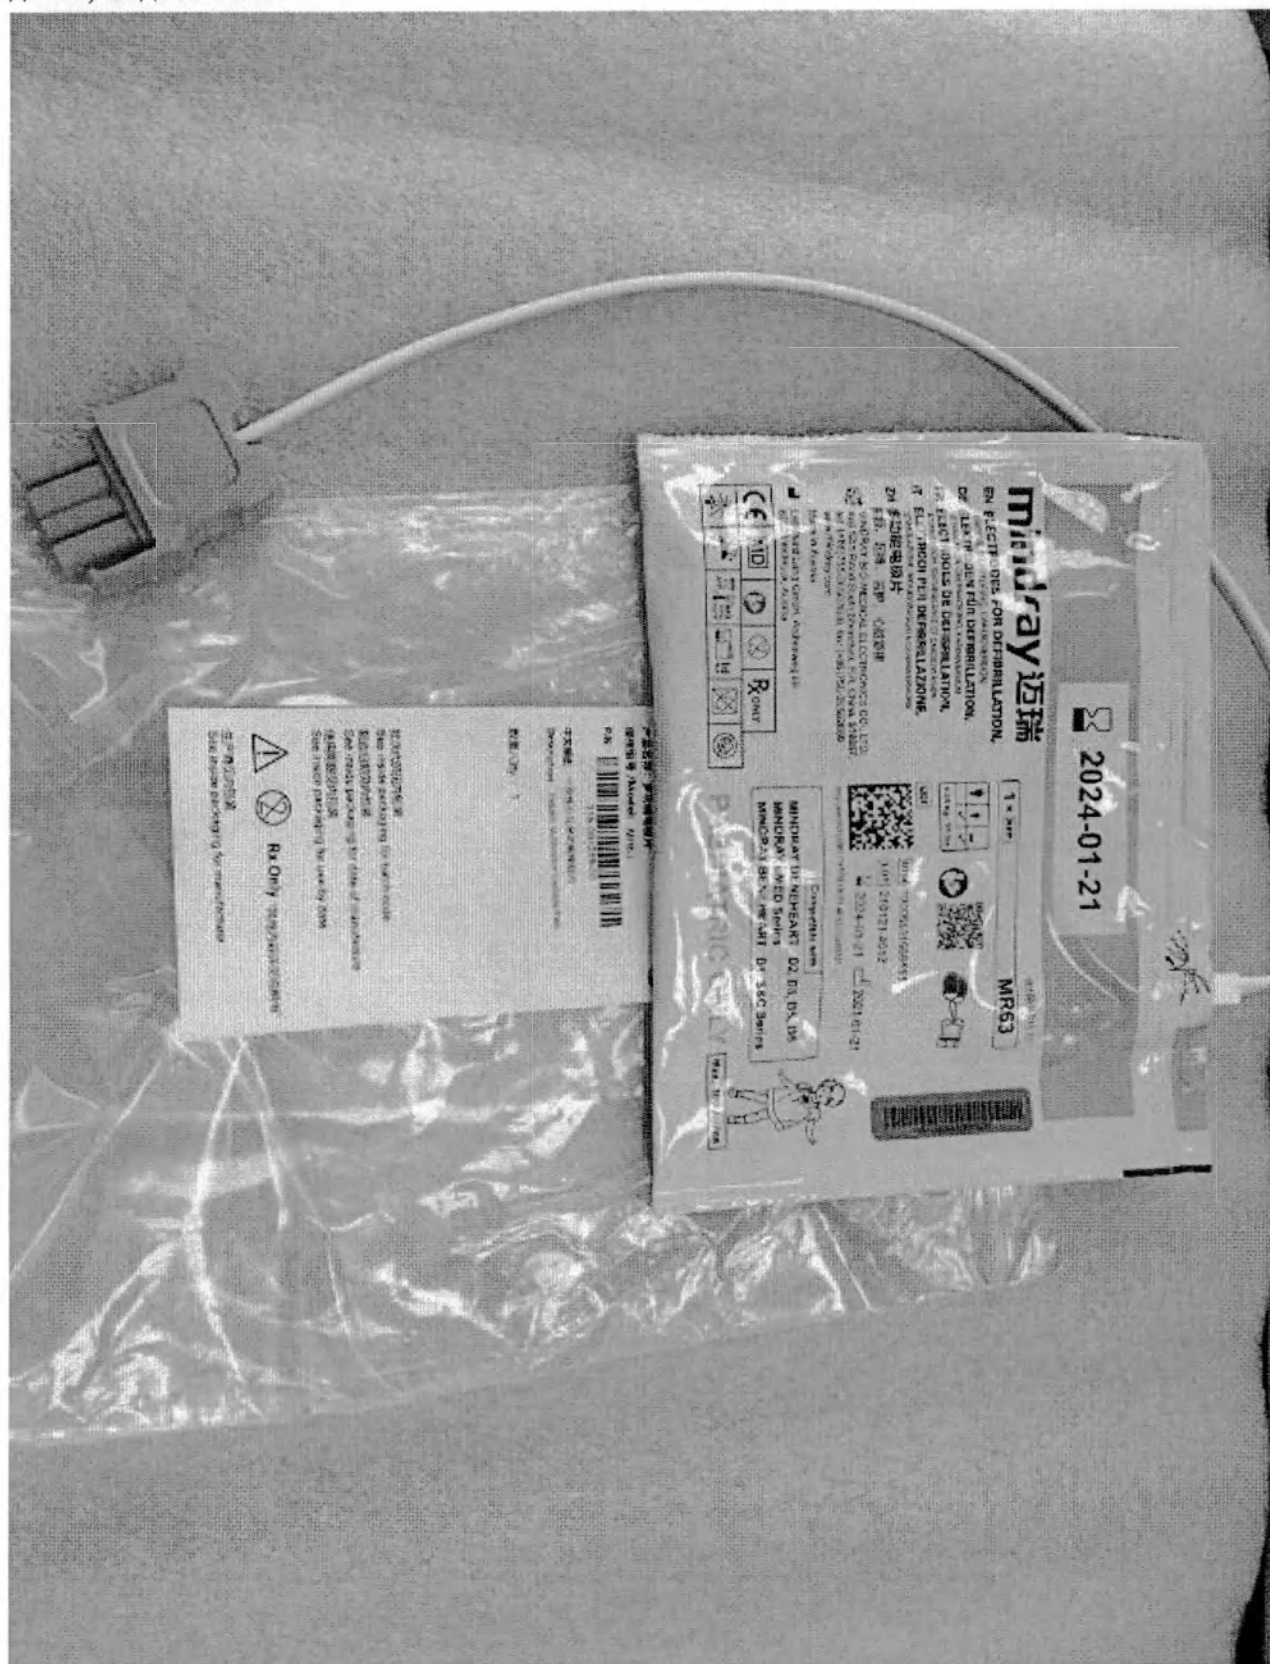


Манжета многоцветная, неонатальная, с коннектором, модель CM1200

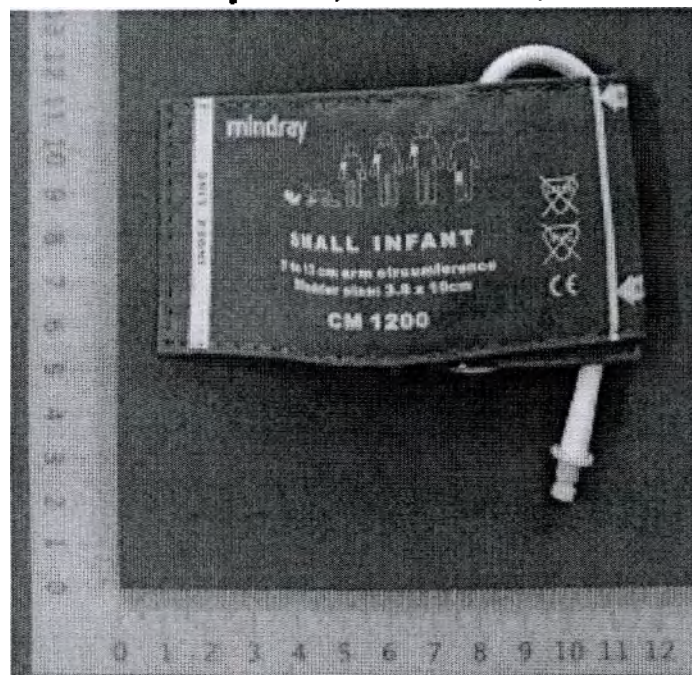


Манжетка многоразовая, детская, с коннектором, модель CM1202 – не более 100 шт. (при необходимости).


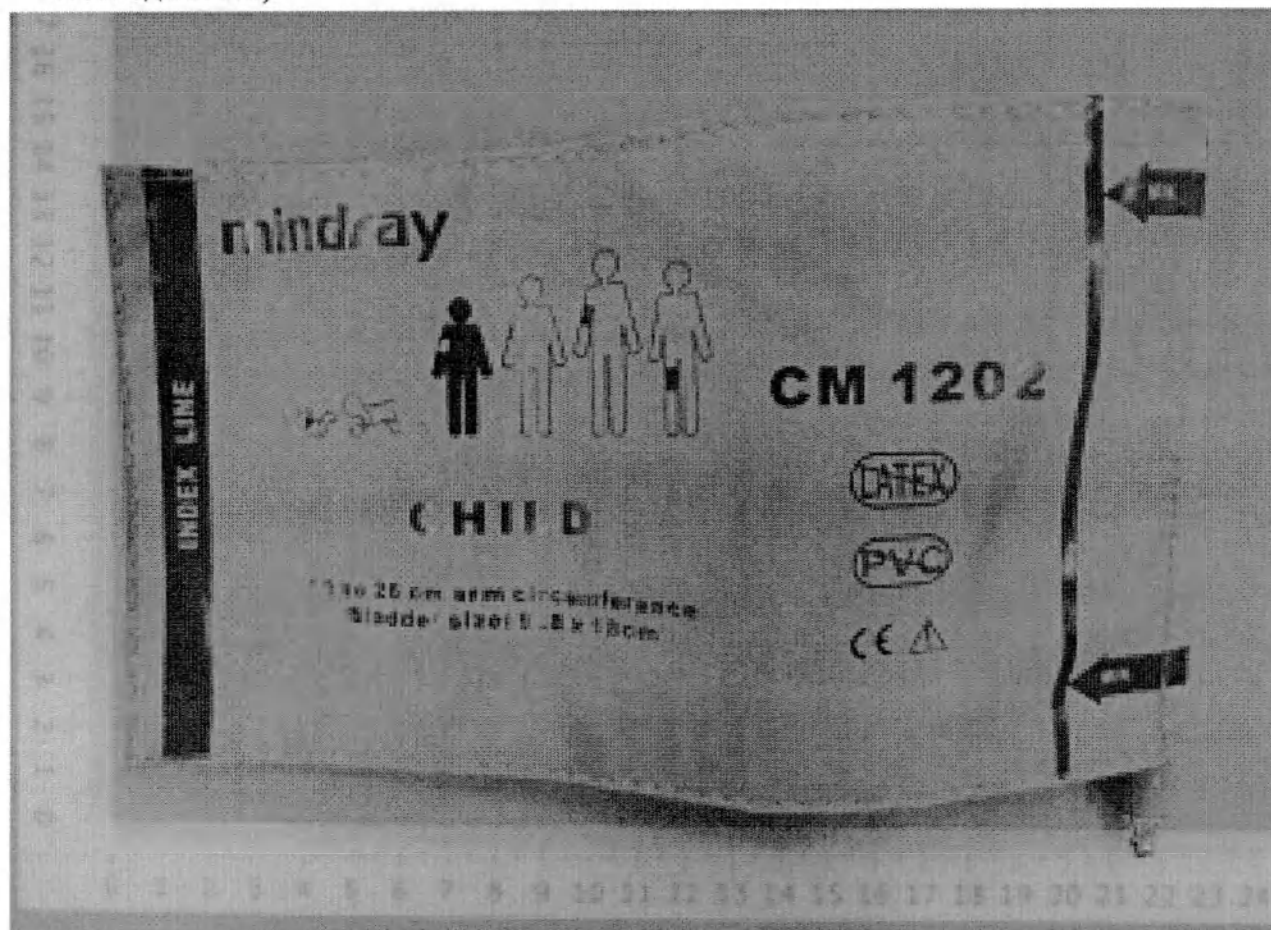


Манжетка многоразовая, взрослая, с коннектором, 25-35 см, модель CM1203

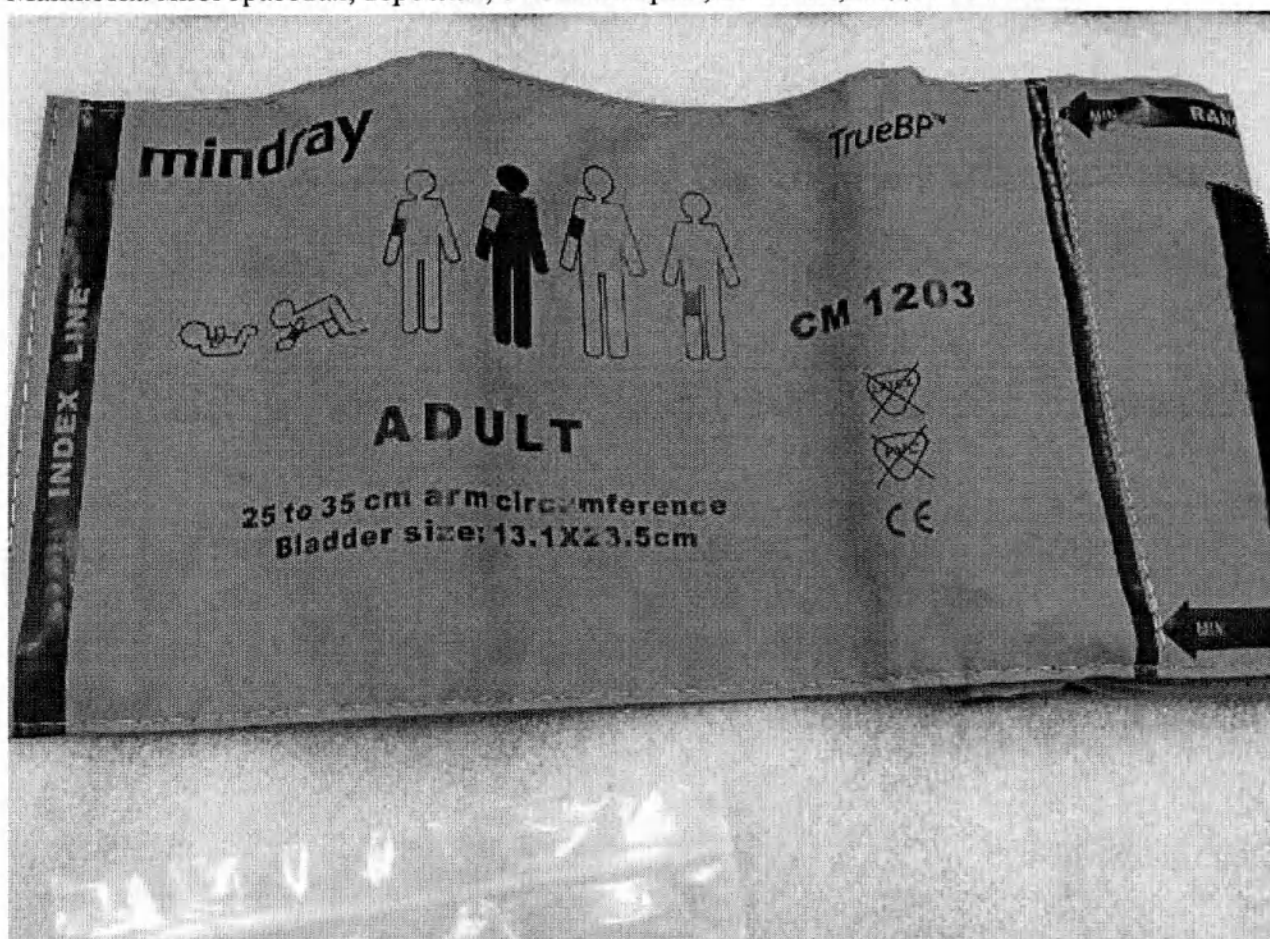


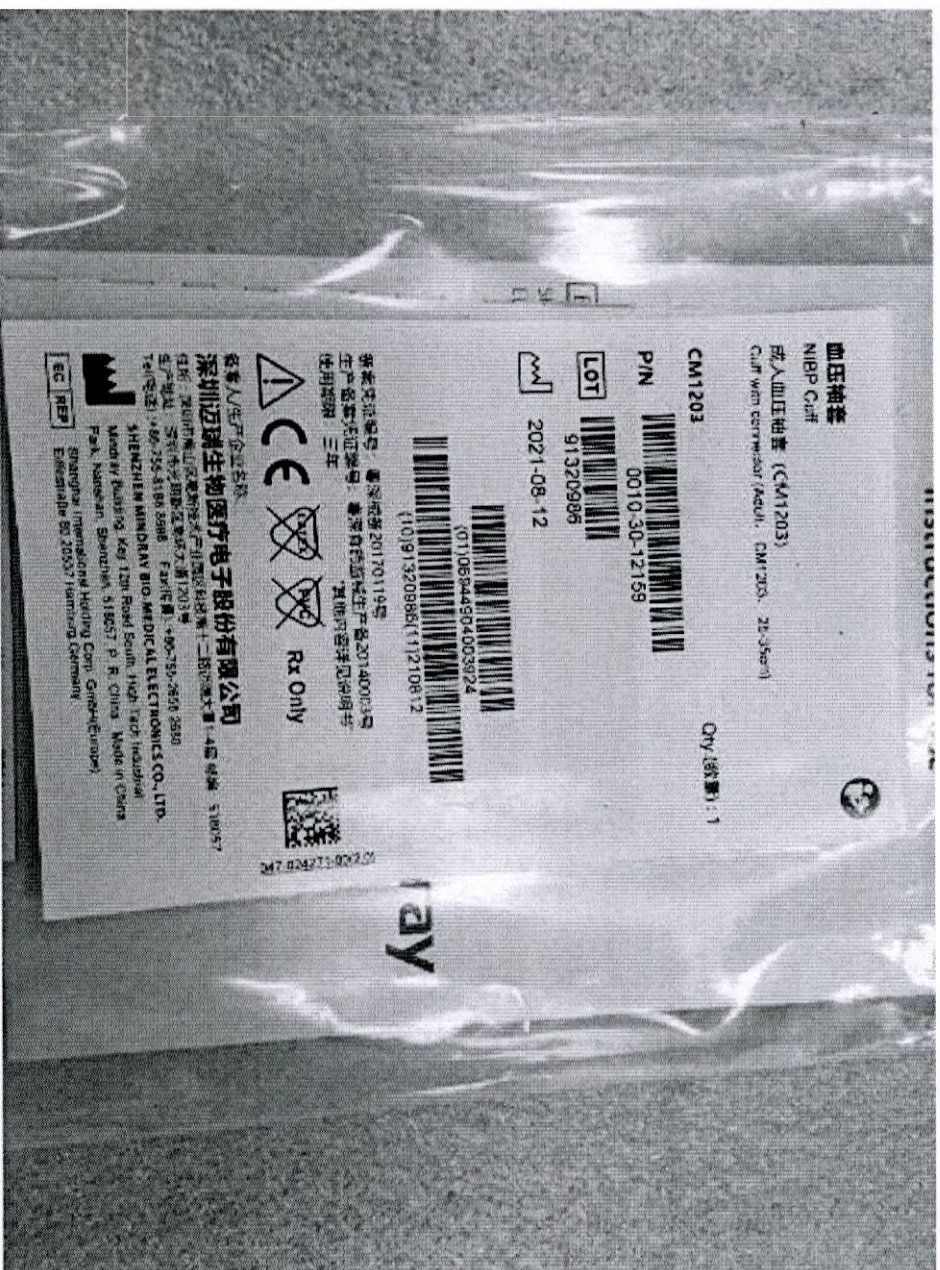

Комплект электродов внутренних, многоразовых, размером 1 дюйм с кнопкой, модель MR6501

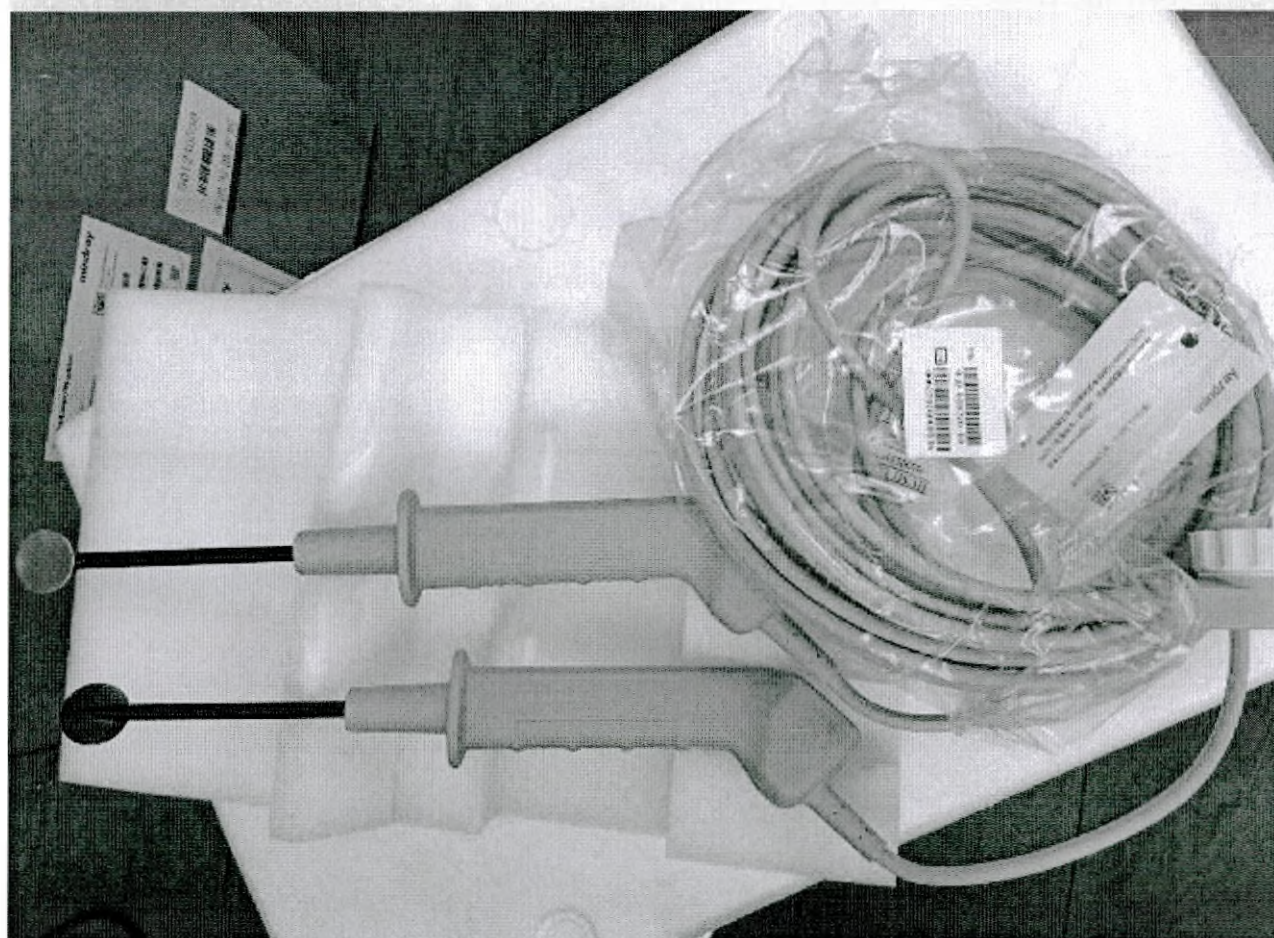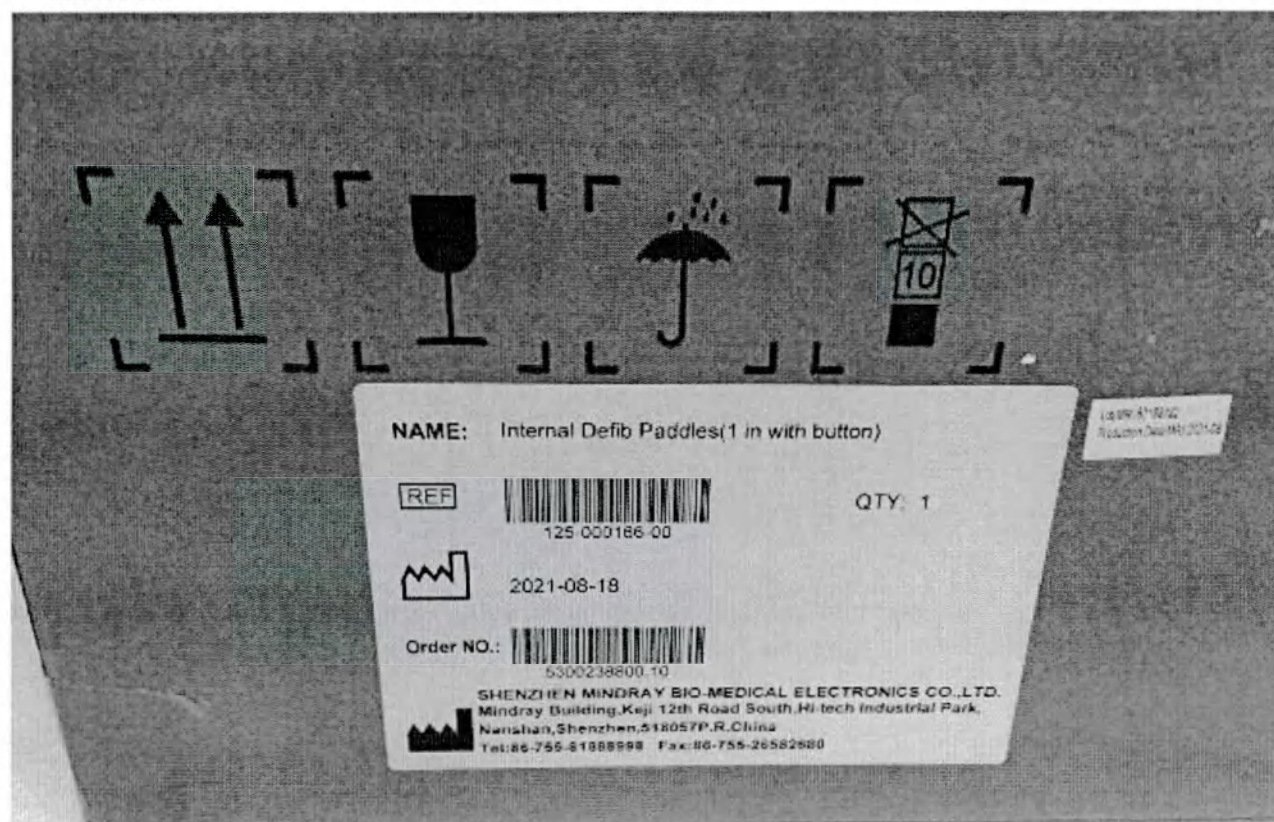

Комплект электродов внутренних, многоразовых, размером 2 дюйма с кнопкой, модель MR6502

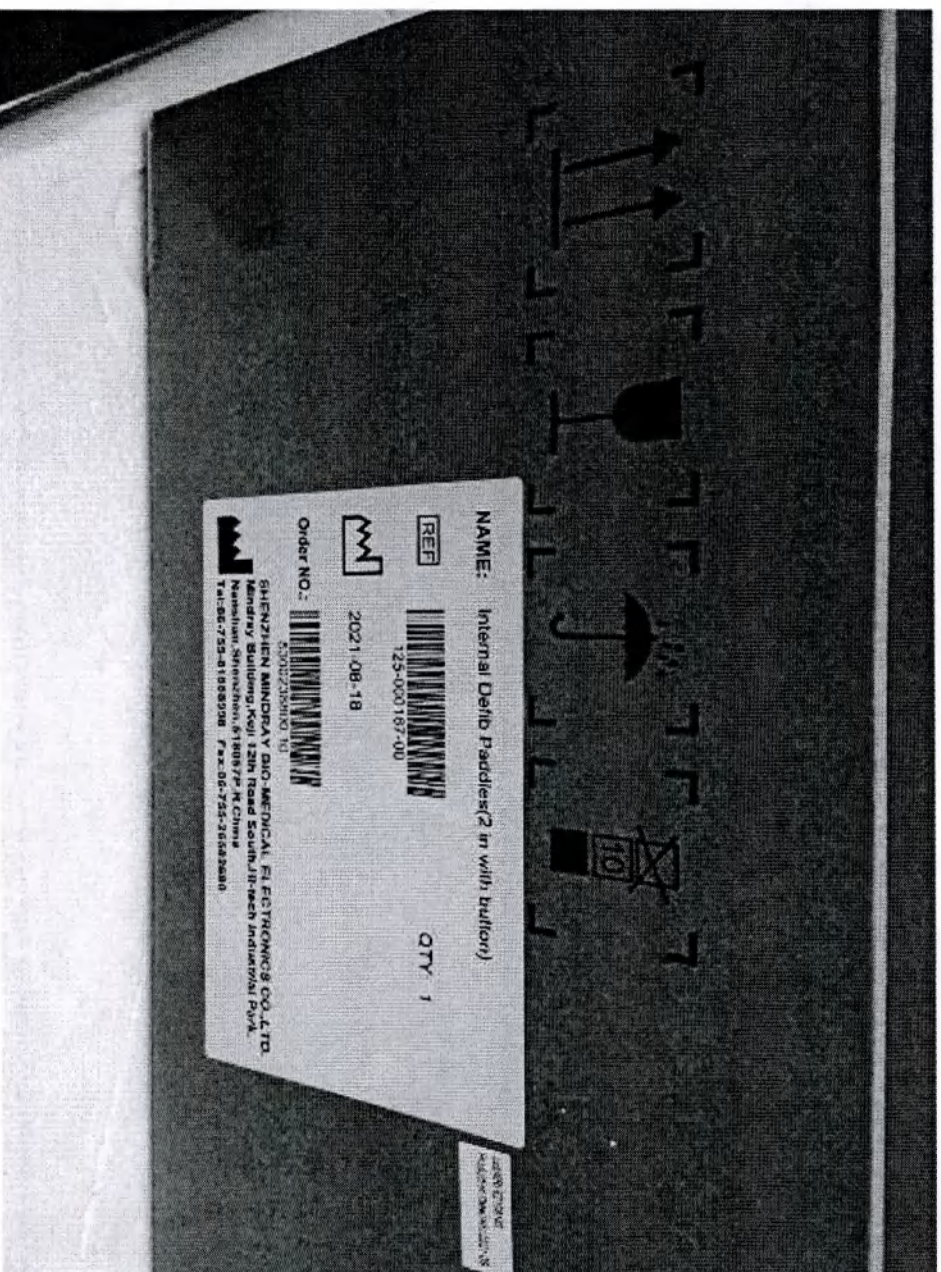

NAME: Internal Defib Paddles(2 in with button)

REF



QTY: 1

125-000187-00



2021.08-18

Order NO.:




C012735010 10



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO.,LTD.
Mindray Building,Kouji 12th Road South,Ji-Peeh Industrial Park,
Nanshan Shenzhen, 518057P.R.China
Tel:86-755-81888998 Fax:86-755-36622880




Комплект электродов внутренних, многоразовых, размером 3 дюйма с кнопкой, модель MR6503

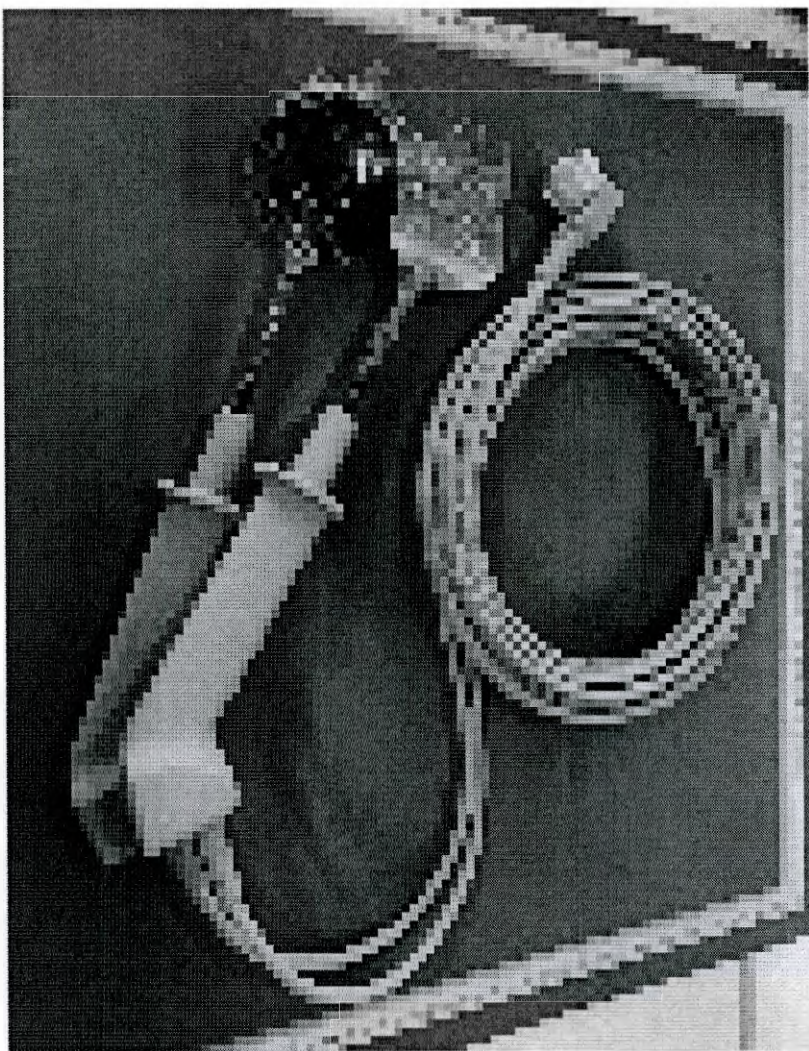

1.49. Одноразовая линия FilterLine забора пробы газа для воздуховода, длинная, с увлажнителем, для новорожденных и грудных детей, для интубированных пациентов, модель MVPHL

4m/13ft

Extended Duration

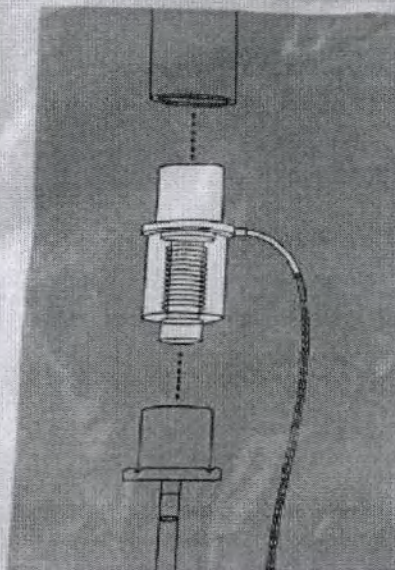

REF MVDHNL

Nachruf auf Richard G. Felt, den legendären "Hacker" der CIA, der die Identifizierung von Kriminellen, Terroristen, Kollaborateuren und anderen Bedrohungen für die Sicherheit der USA ermöglichte. Felt war ein wichtiger Akteur in der "Church and Manson"-Affäre und der "Watergate"-Affäre.




© 2015 Medtronic. Made in China.
Medtronic Medical 1847 Ltd., Hawthorne St,
PO Box 95025, Auckland 1177407, New Zealand
Medtronic Medical AG, Im Zähringerhof 11, 6452 Pfaffenloren, The Netherlands
BIC: 56110




0120884521761992

1.50. Одноразовая линия FilterLine забора пробы газа для воздуховода, длинная, с увлажнителем, взрослая/детская, для интубированных пациентов , модель MVAIHL


Medtronic
Microstream™ Advance
Adult-Pediatric Intubated CO2
Filter Line
© 1997

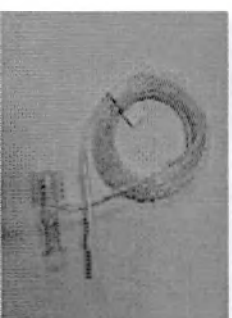


[illegible]


[illegible]


Одноразовая линия FilterLine забора пробы газа для воздуховода, с увлажнителем, взрослая/детская, для интубированных пациентов, модель MVAIH - не более 200 шт. (при необходимости).

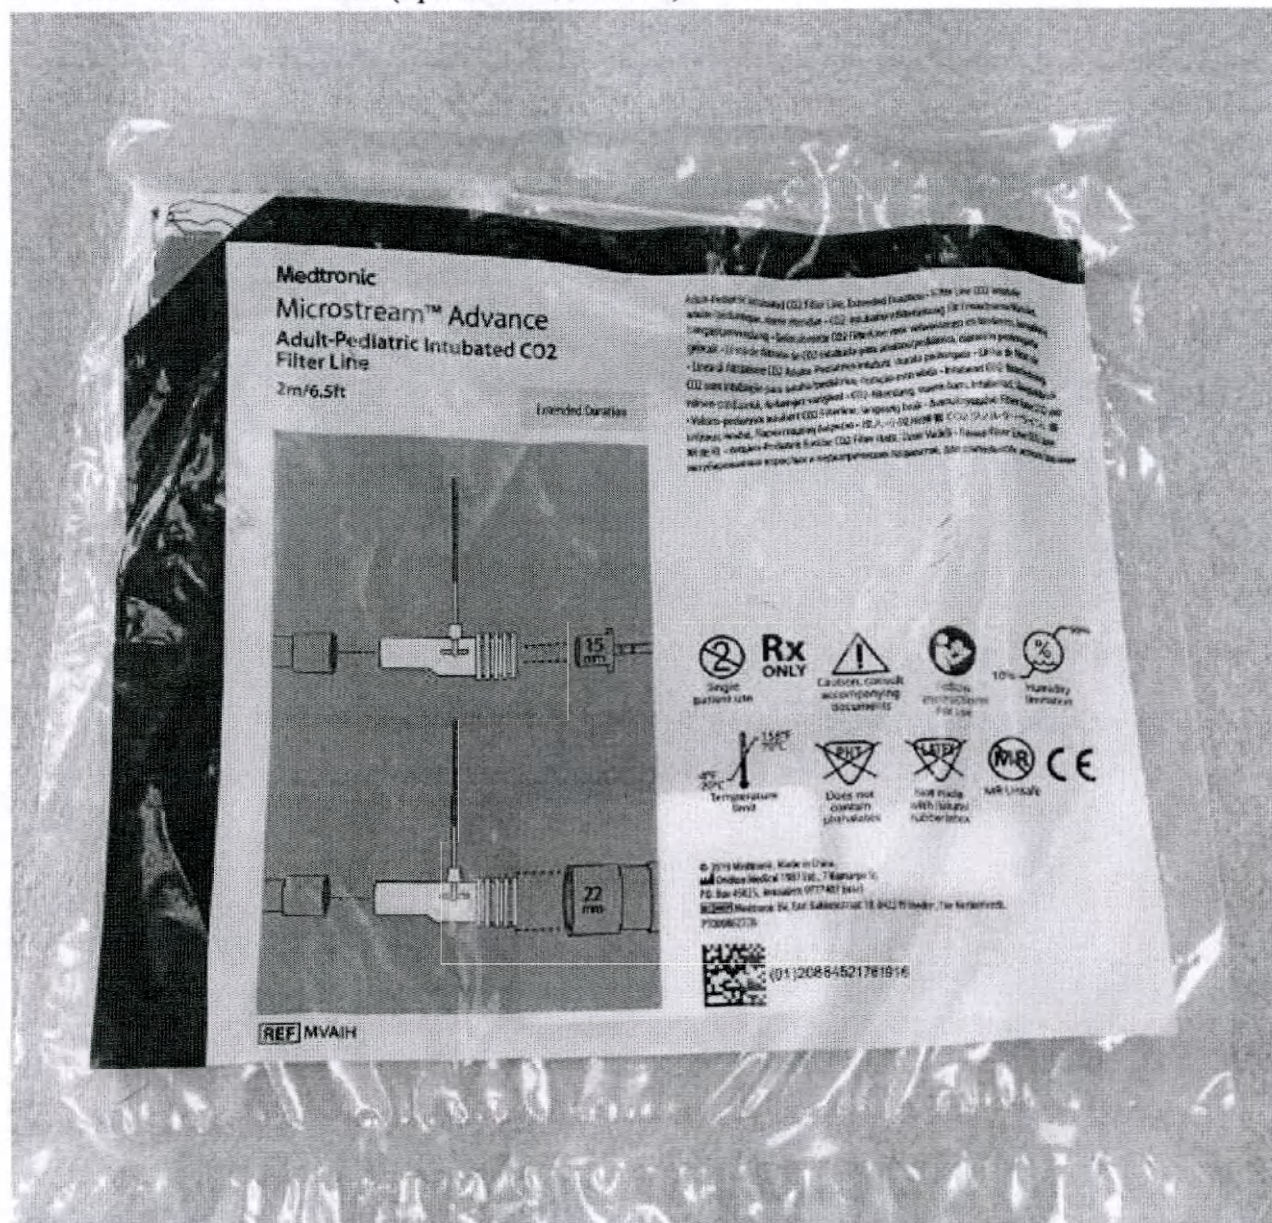

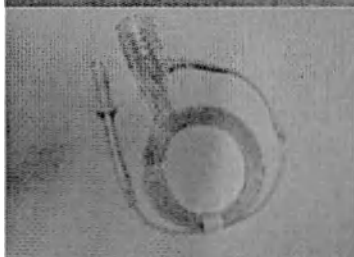

Одноразовая линия FilterLine забора пробы газа для
воздуховода, взрослая/детская, для интубированных пациентов , модель MVAI

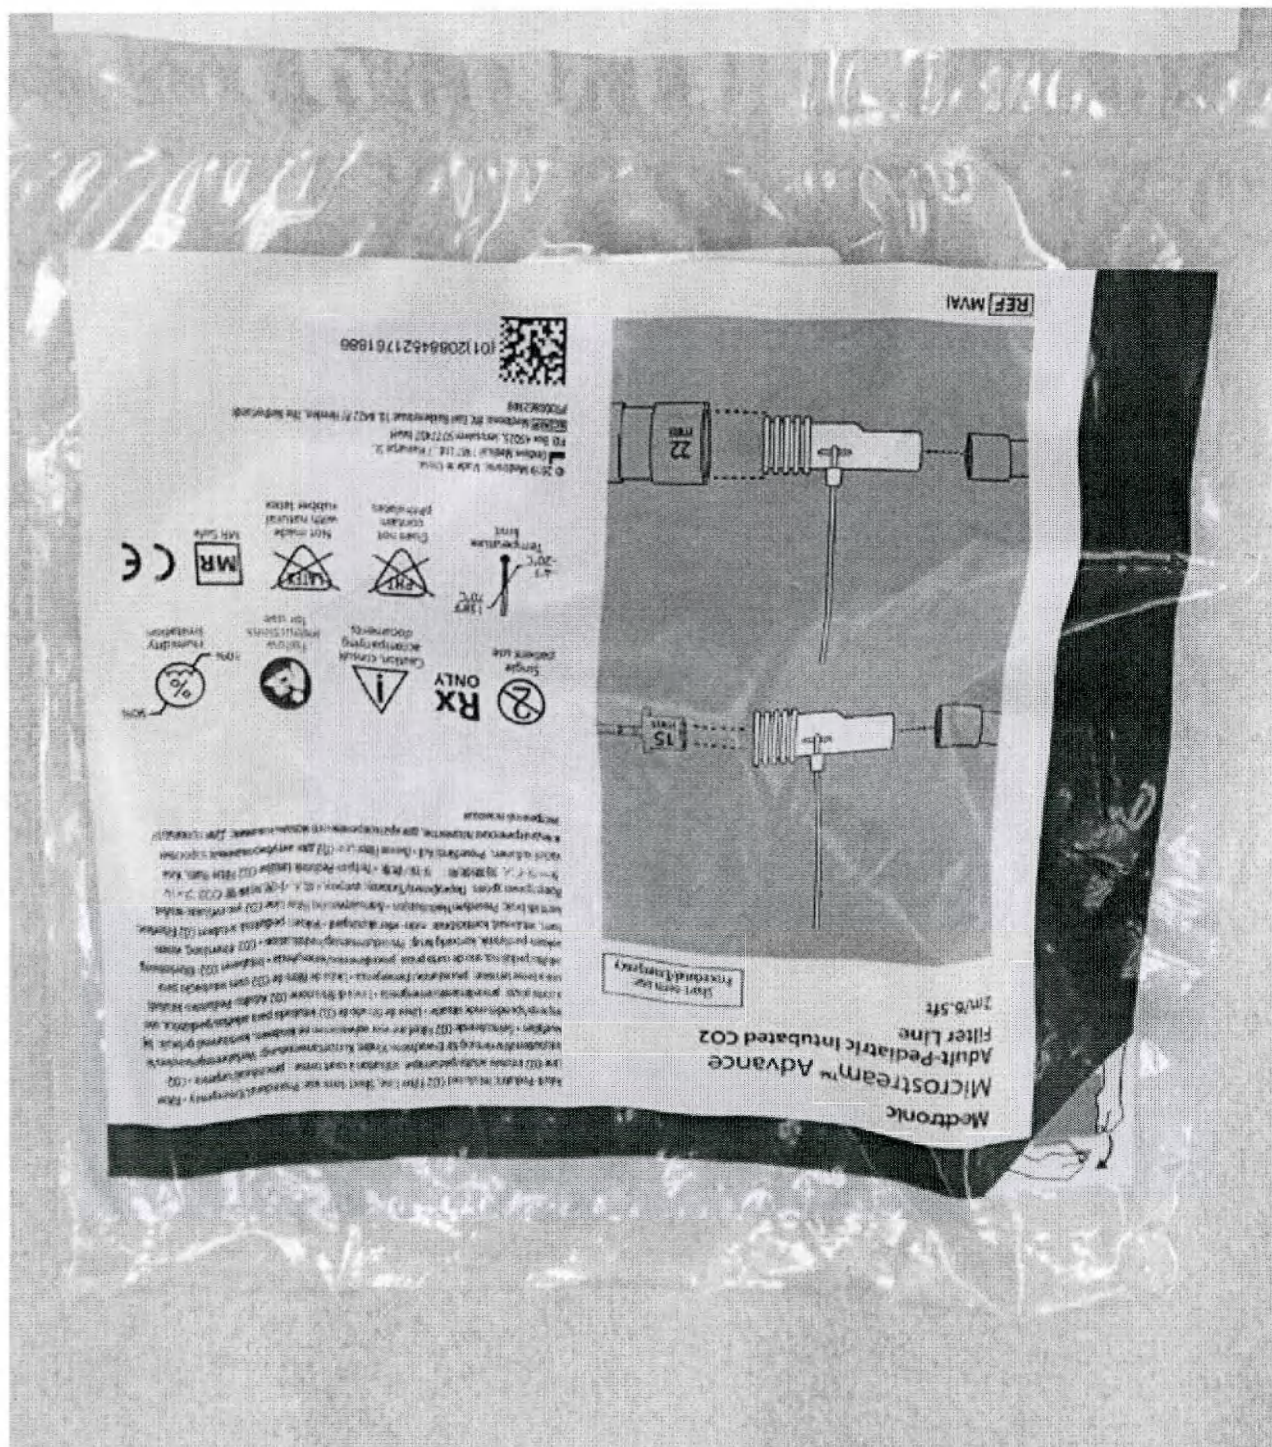

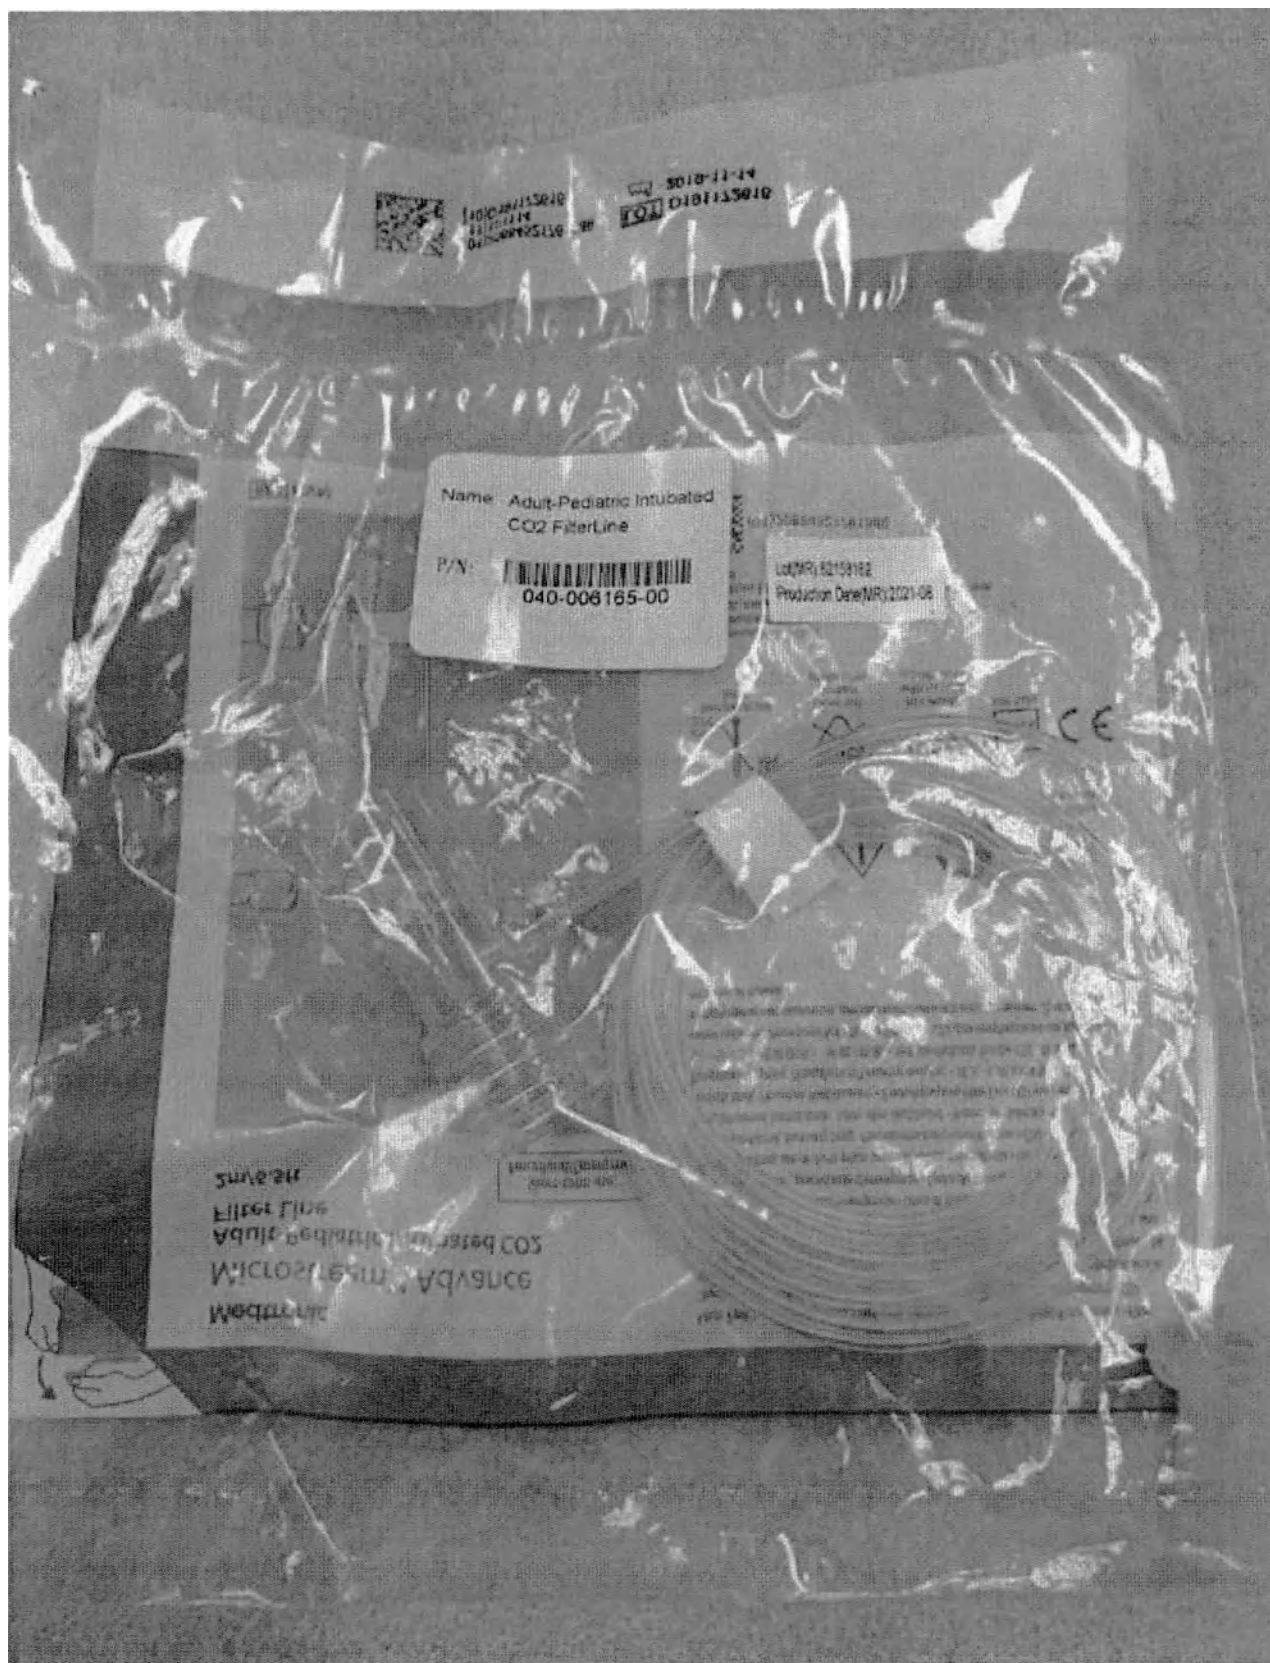

Одноразовая линия забора пробы газа FilterLine, назальная, детская ,модель MVPN

$2\pi \nu / 6.5 \text{ ft}$

REF MVPN

 Single patient use
 Caution, consult accompanying documentation
 Follow instructions for use
 Humidity limitation

MR MR Safe

~~Latex~~ Made entirely with natural rubber latex


~~PHT~~ DEHP Does not contain DEHP

© 2010 Macmillan, a division of
 Gordon and Breach Publishers Ltd., 7th Floor, 20
 P.O. Box 45023, Vancouver V6T 4E1, Canada
 5500 Macmillan Way, Suite 100, Vancouver, BC
 V6X 3A5, Canada



00120254521771765



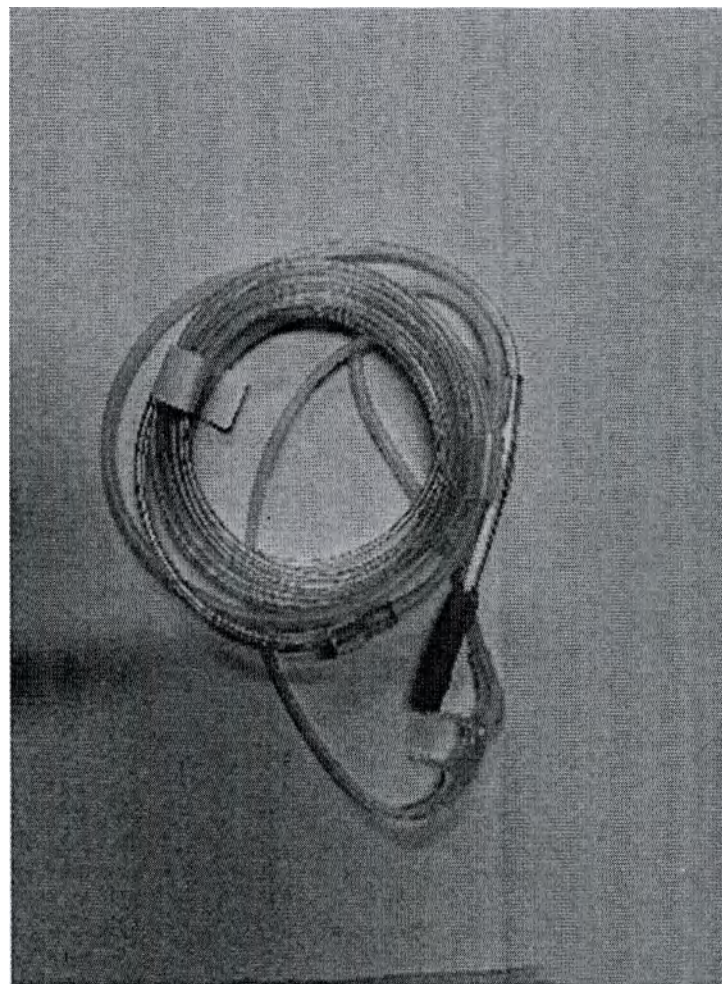




Одноразовая линия забора пробы газа FilterLine, назальная, взрослая , модель MVANH

2m/6.5ft

Lorenzo C. Duranton

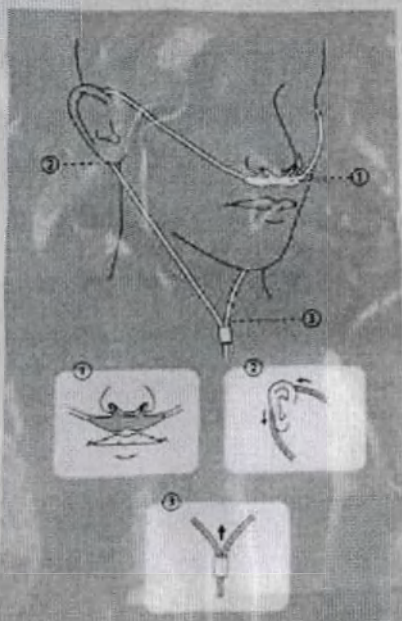

REF MIVANH


48151 Nasa (C2) Peter Lin, Edmond Perle, 1978 (C2) Nasa, 1980
 48152 (C2) 48151/1978 (C2) 48151/1978 (C2) 48151/1978 (C2) 48151/1978 (C2)
 48153 (C2) 48151/1978 (C2) 48151/1978 (C2) 48151/1978 (C2) 48151/1978 (C2)
 48154 (C2) 48151/1978 (C2) 48151/1978 (C2) 48151/1978 (C2) 48151/1978 (C2)
 48155 (C2) 48151/1978 (C2) 48151/1978 (C2) 48151/1978 (C2) 48151/1978 (C2)
 48156 (C2) 48151/1978 (C2) 48151/1978 (C2) 48151/1978 (C2) 48151/1978 (C2)
 48157 (C2) 48151/1978 (C2) 48151/1978 (C2) 48151/1978 (C2) 48151/1978 (C2)
 48158 (C2) 48151/1978 (C2) 48151/1978 (C2) 48151/1978 (C2) 48151/1978 (C2)
 48159 (C2) 48151/1978 (C2) 48151/1978 (C2) 48151/1978 (C2) 48151/1978 (C2)
 48160 (C2) 48151/1978 (C2) 48151/1978 (C2) 48151/1978 (C2) 48151/1978 (C2)

Rx
ONLY

ST-279 Microphone, Made in China.
 Includes handset, 1960 US, 7 mhz range.
 P.O. Box 48025, Indianapolis 46276-0250
ST-280 Microphone, Bk. East Brunswick NJ. 08827 Ft. Worth, The Netherlands.
 FTX000017403




(01)20984521761770

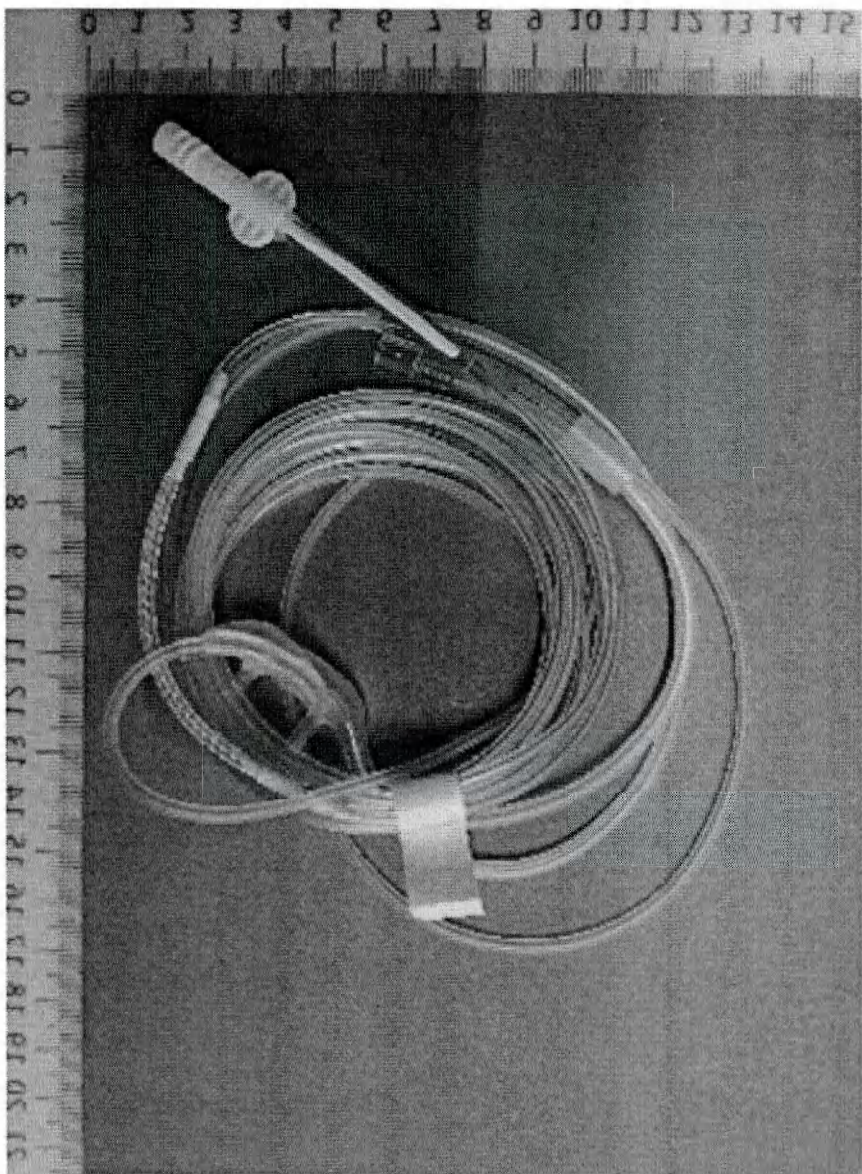






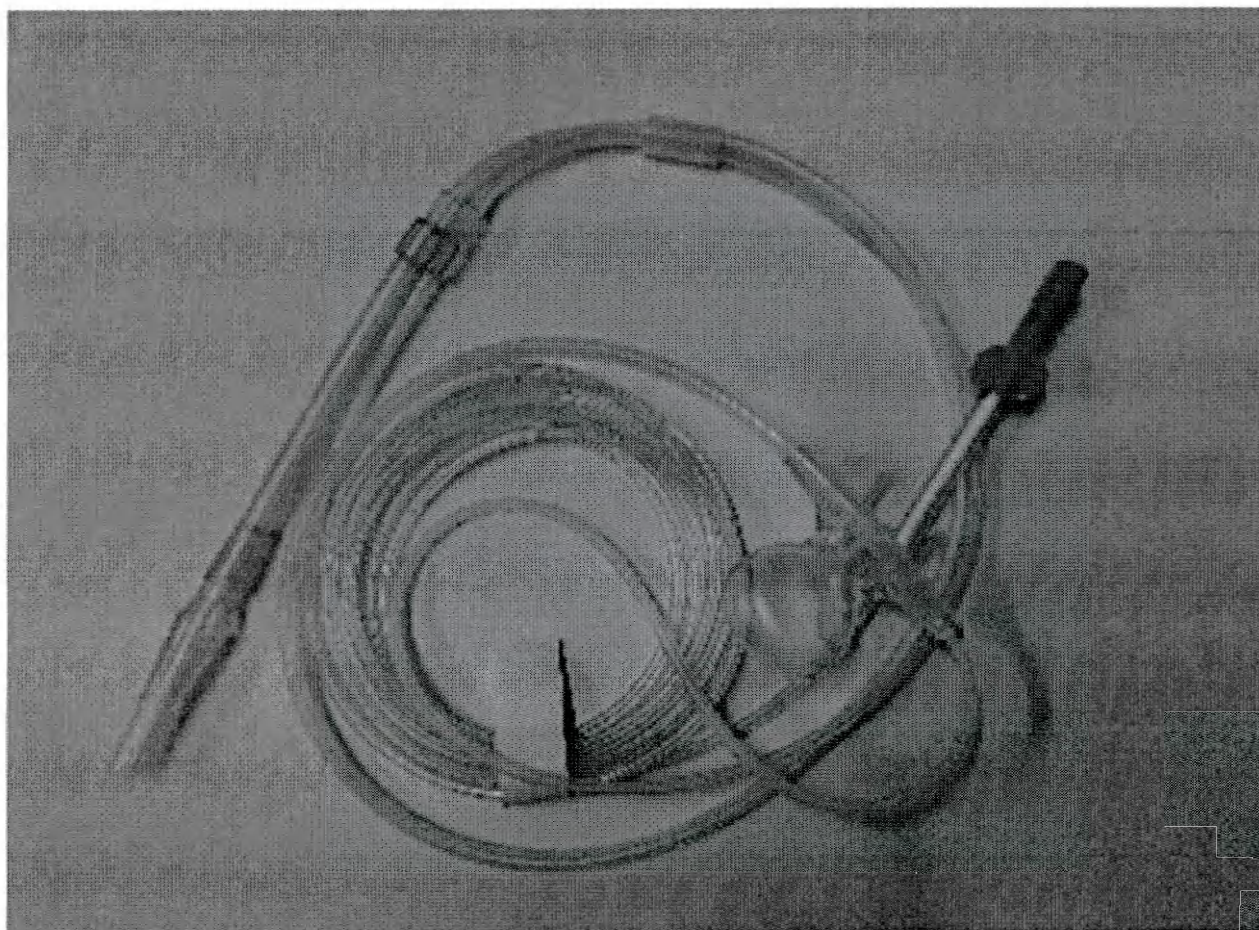

Одноразовая линия забора пробы газа орально-назальная FilterLine, детская, модель MVP

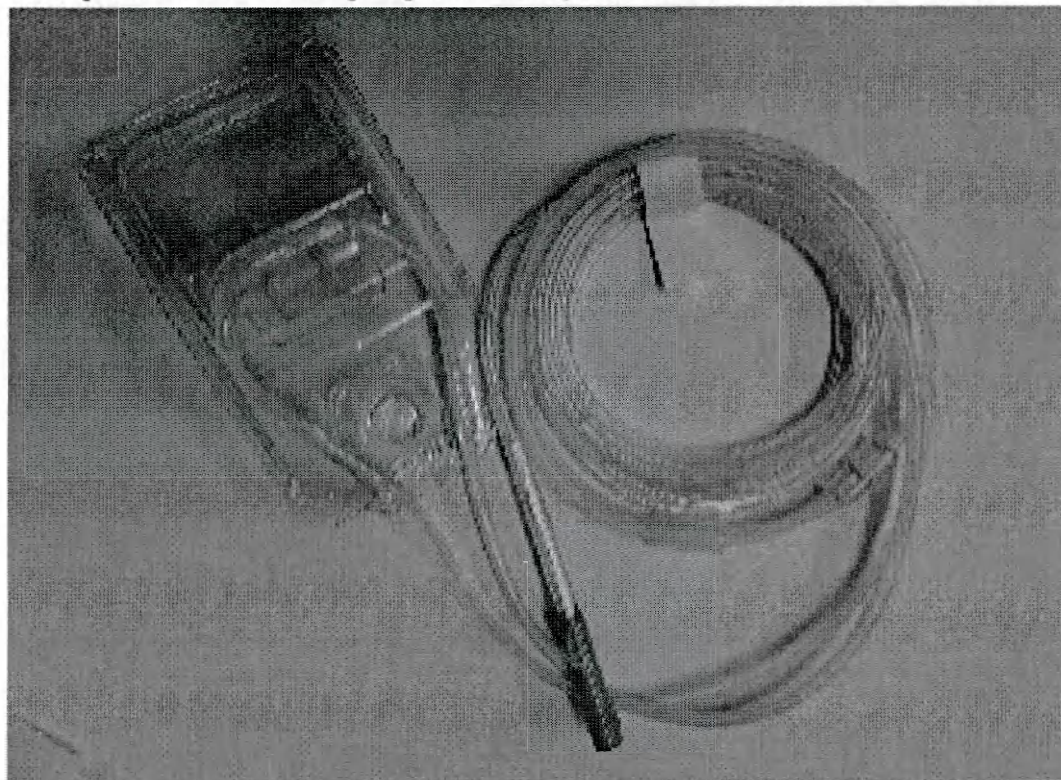

2m/6.5ft

Share with us
Personal Testimony



© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 101–107



Document Value



4



CHINA



Author's address: *Department of Computer Science, University of Toronto, 270 Spadina Avenue, Toronto, Ontario, Canada M5S 2E4*



100




100




101120884571761633

© 1997 Elsevier. All rights reserved.
Printed in the USA. All rights reserved.
0950-2688/97/\$12.00 + 0.00
0950-2688/97/\$12.00 + 0.00


[illegible]

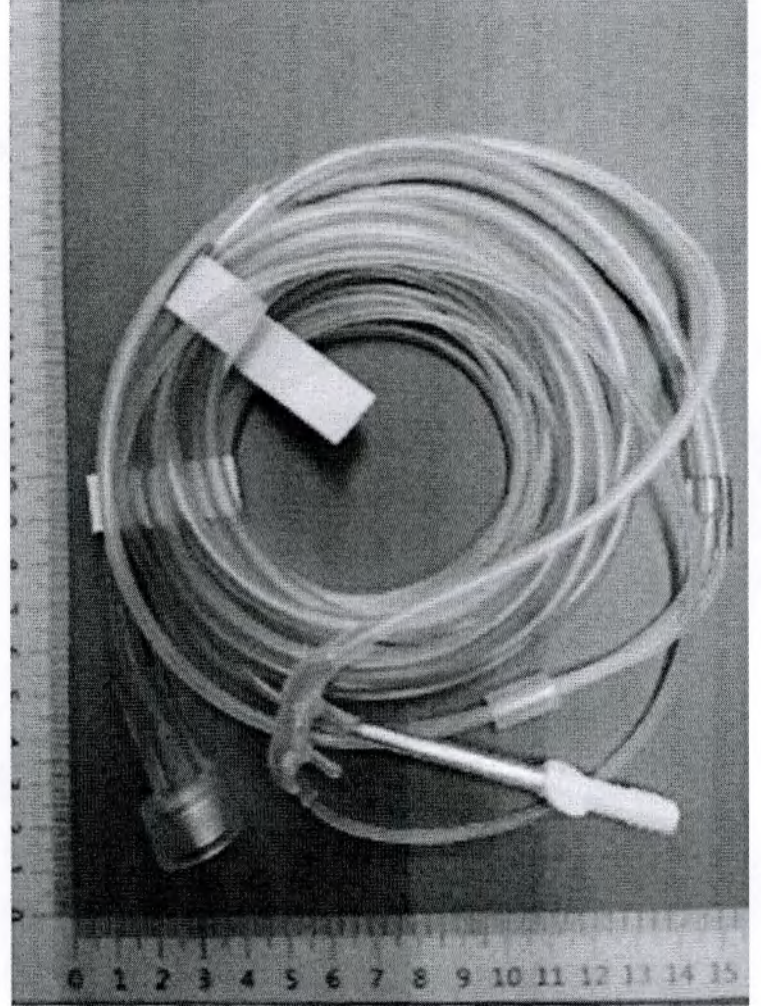

[illegible]

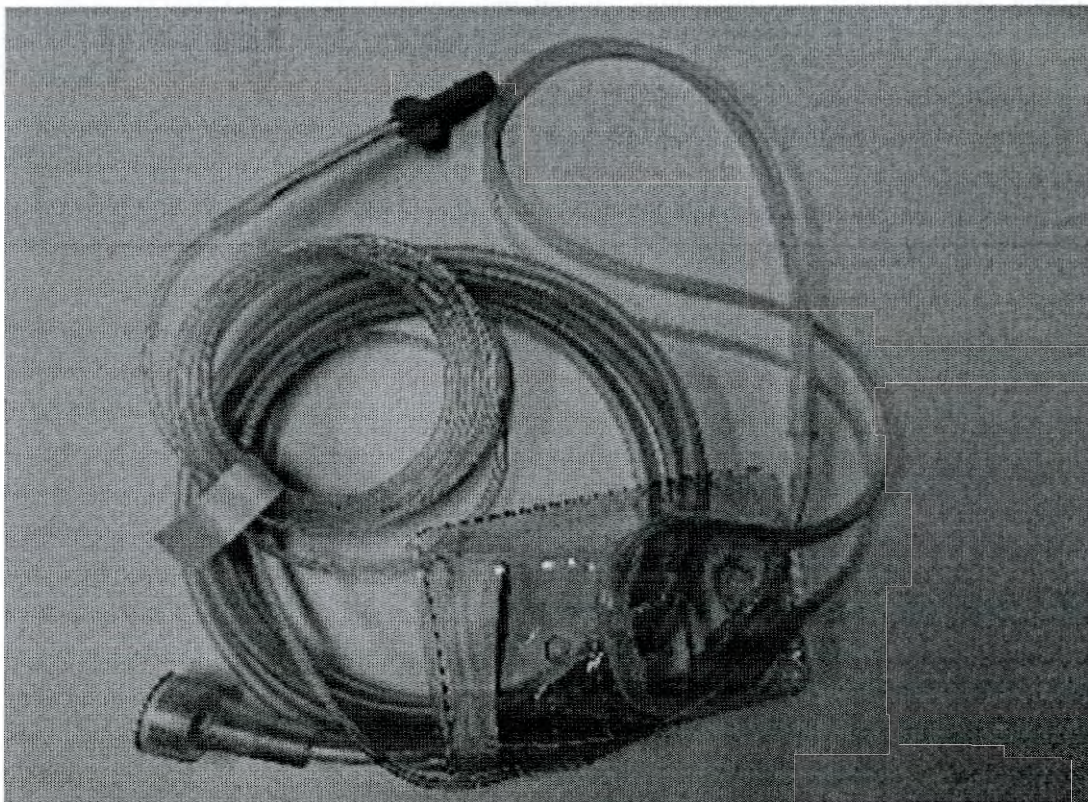


Одноразовая линия забора пробы газа орально-назальная с O2 коннектором FilterLine, взрослая, модель MVAO

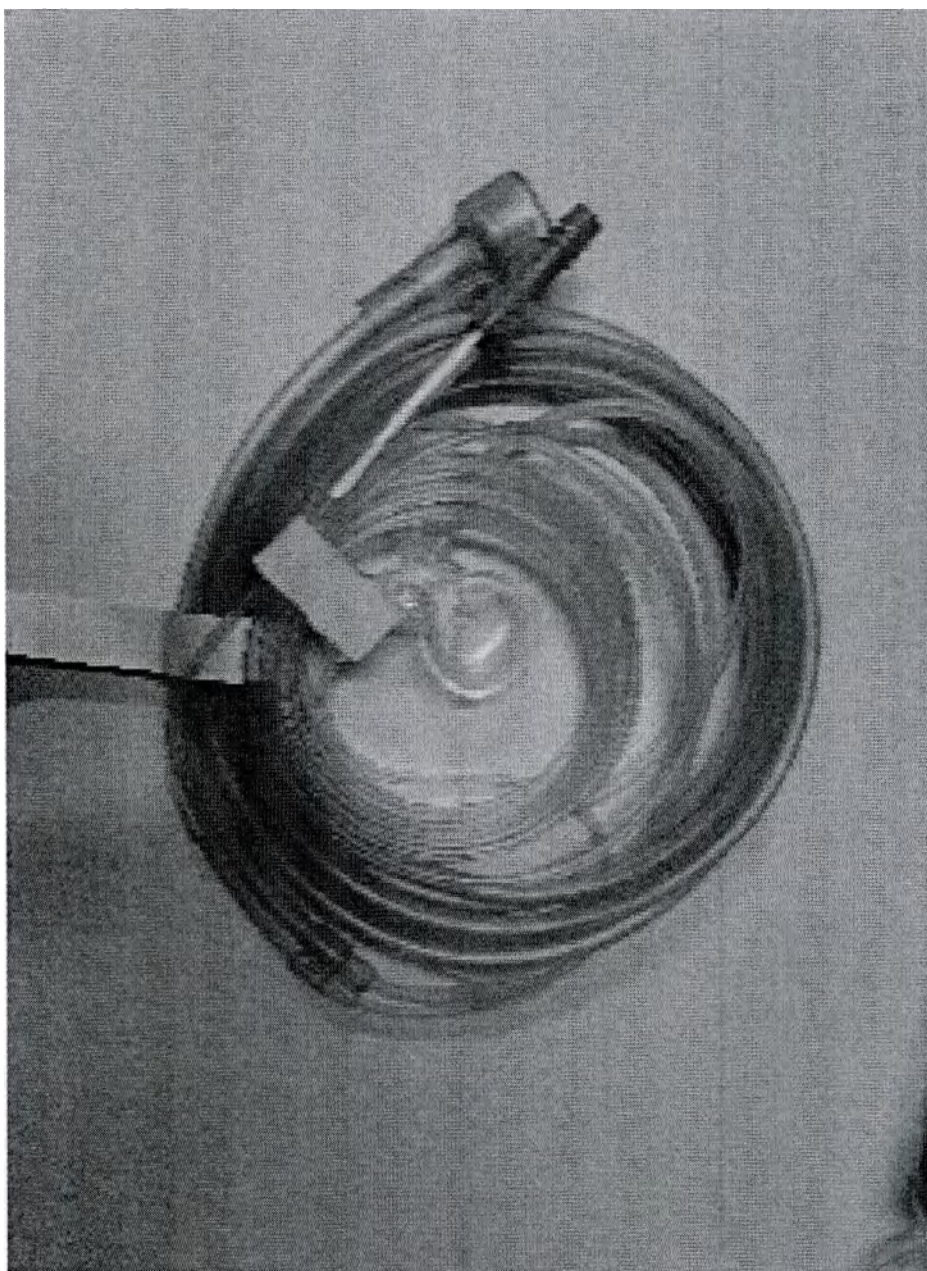

2m/6.5ft

Short-term and
Financial Emergency

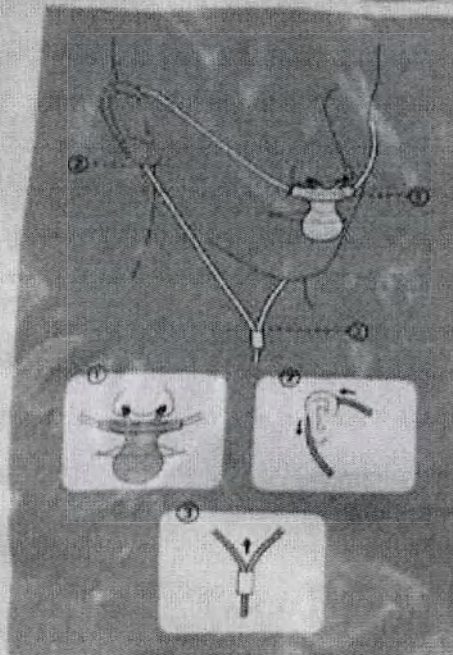

REF MVAO

[illegible]

Single platform use

Rx
ONLY

...
...
...
...



Patient



CONCLUSION



1. **Background**
 2. **Methods**
 3. **Results**
 4. **Conclusions**
 5. **References**



Doses will
contain
phthalates



Best made
with natural
rubber latex



1998




© 2014 Medtronic Medical Electronics
and Covidien Medical Products Ltd., a Hanger Inc.
P.O. Box 45025, Jerusalem 9773401 Israel
02-5222000 Medtronic B.V. Ltd. Eindhoven 55 1411 JS Eindhoven, The Netherlands
P200000621158

C€0482




(01)20884521761596



2m/6.5ft

Extended Duration

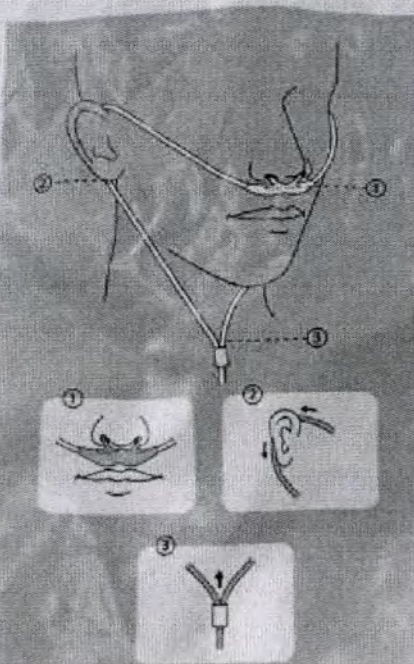

REF MVFNOH

[illegible]

Single
patient use

Rx
ONLY

Caution: consult
accompanying
documents



Follow
Instructions



Harvest
Institution

Temperature
Time

DEHP
Does not
contain
DEHP



Not made
with natural
rubber latex



HR Unique




Fire retardant

© 2015 Medtronic. Made in China.
 On-line Medical 1992 Ltd, 7 Harnage St
 PO Box 40235, Jerusalem 9777487 Israel
 05222 Medtronic BV, Eil Eekhoutstraat 10, 1402 JE Soester, The Netherlands
 77200901236




(01)20884521761898

CE0482






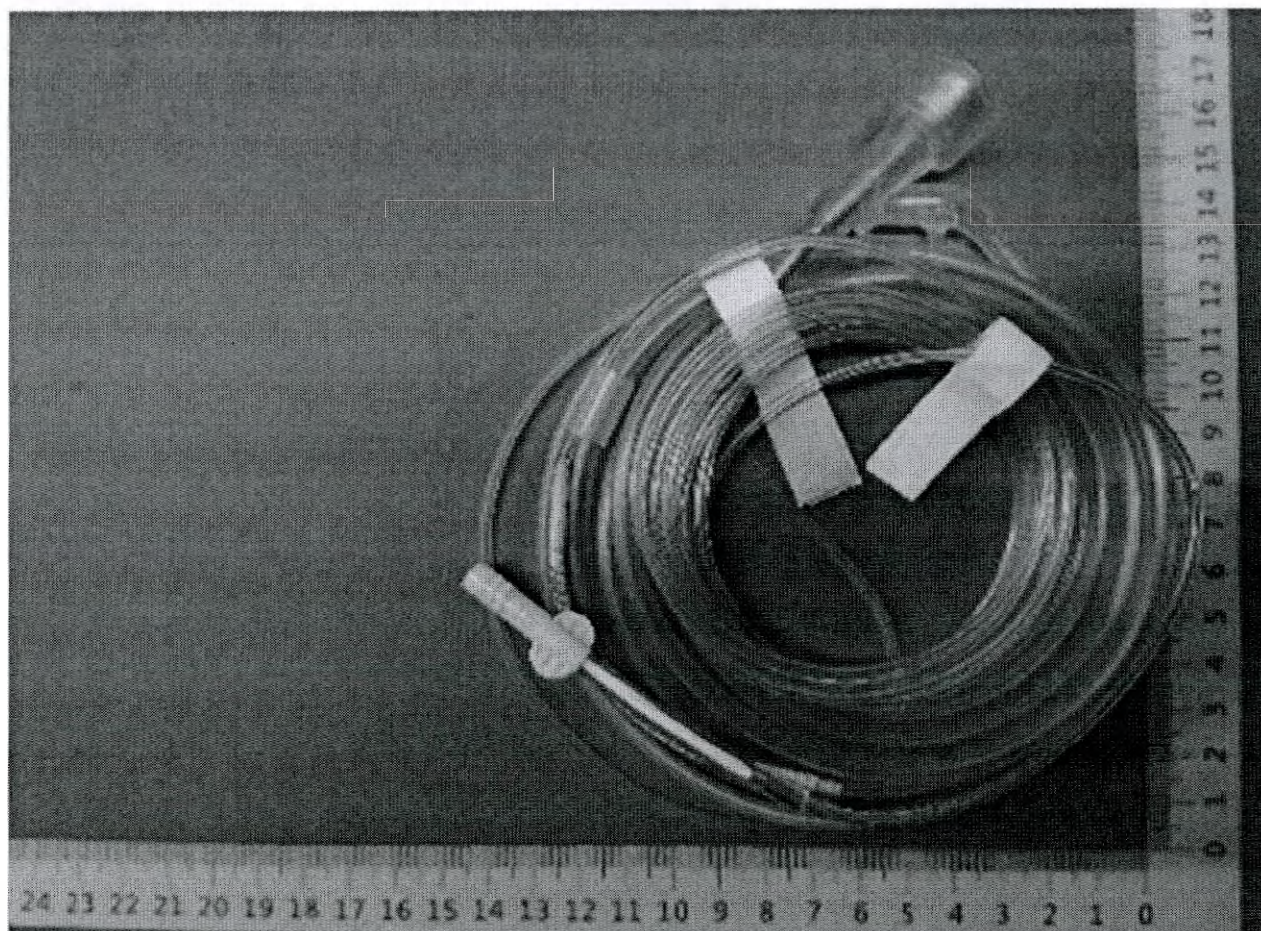

Одноразовая линия забора пробы газа назальная FilterLine H, для детей и новорожденных, модель MVINH-

2mm/6.5ft

Hand of Deceit

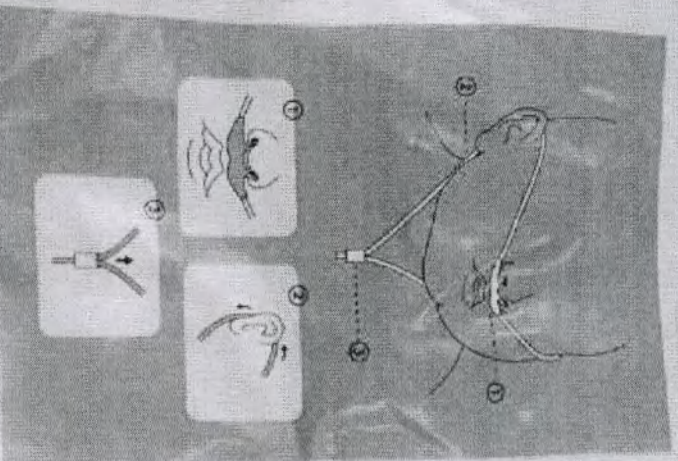

REF MVINH



1007605 012024 411



(01)20884521761787

© 2010 Westpac, Suite P Data
 Acquisition, Inc. 6021 1st, Hampshire, IL
 61834-0005, 800.667.5771 ext 1001
 2010 Westpac, Suite P Data, The Westpac Data
 770060000

[illegible]

Rx ONLY



Caution: consult
accompanying
documents.




Fellow
Instructor
for Use


100

~~DEHP~~
Not in bags
with DEHP


[illegible]

CE

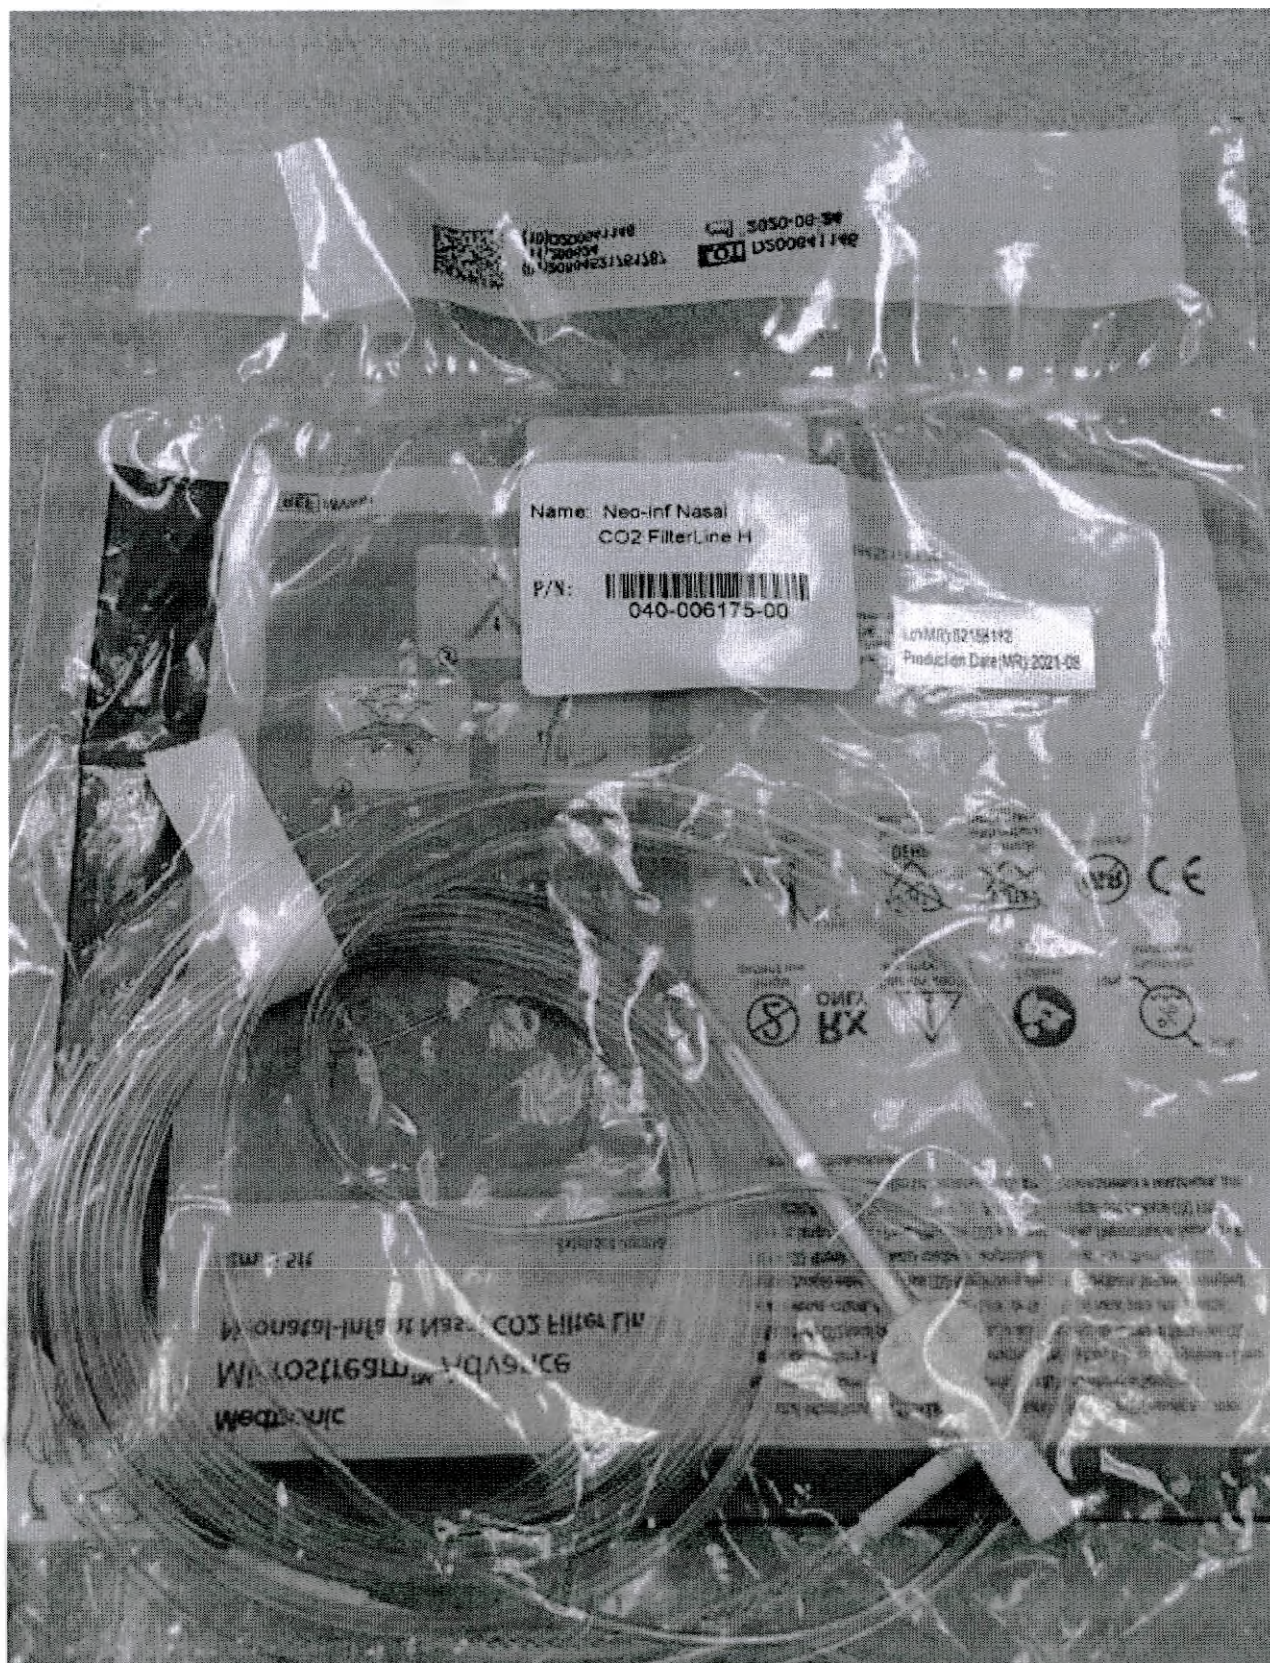

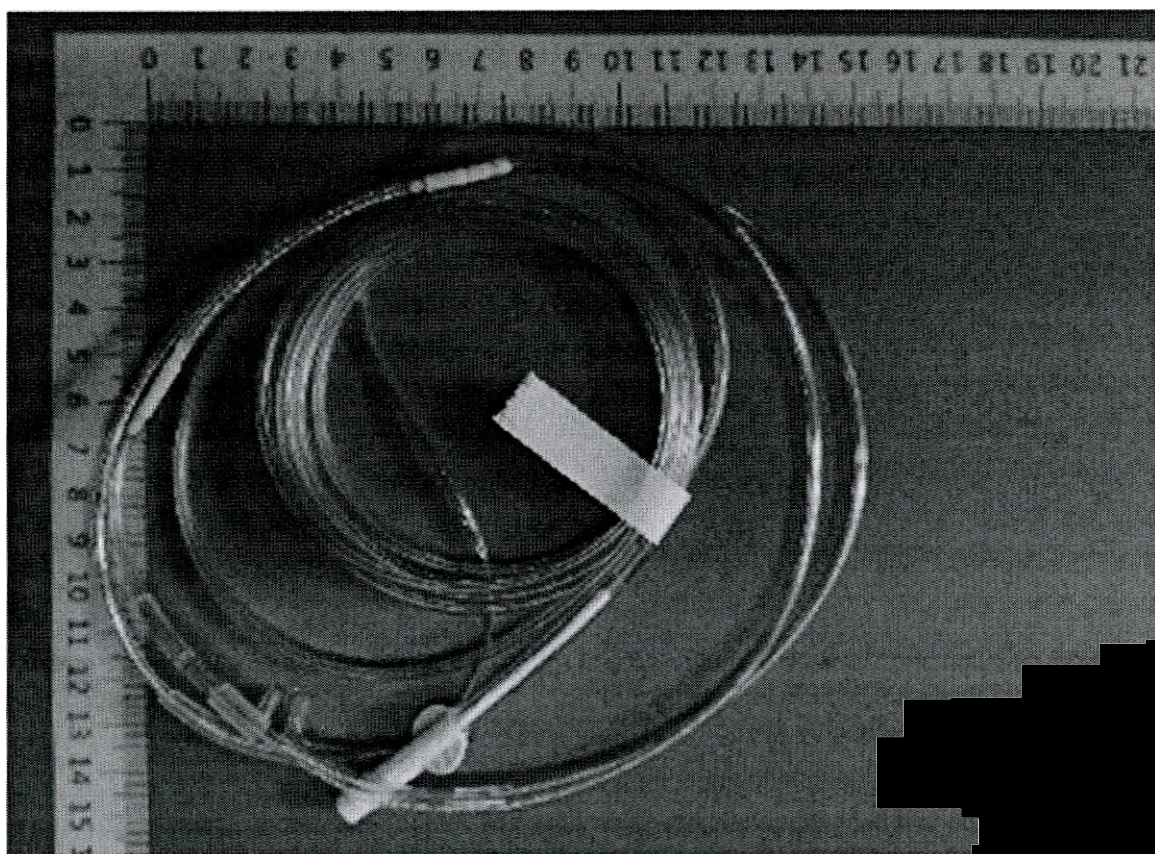


[illegible]

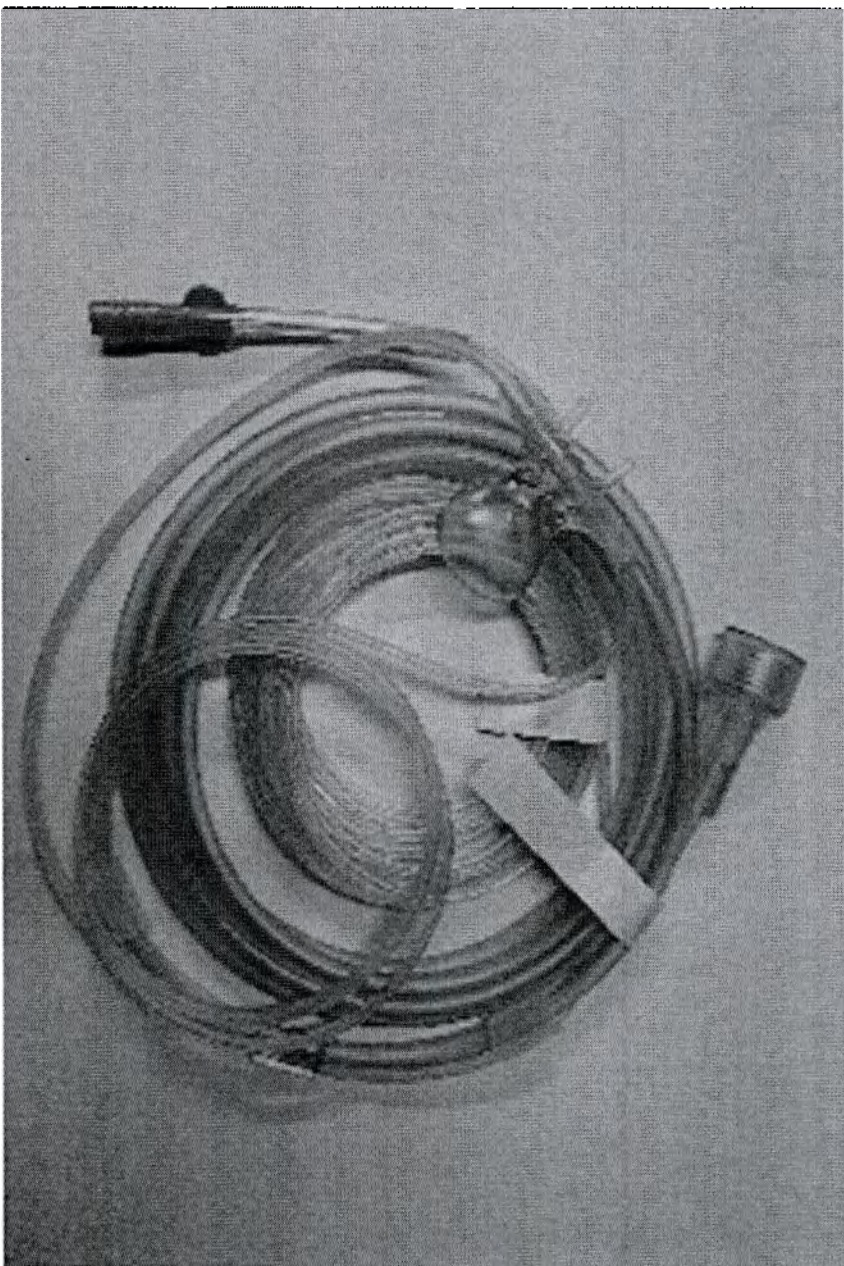

Одноразовая линия забора пробы газа назальная, детская с O2 коннектором, длинная, модель MVPOL



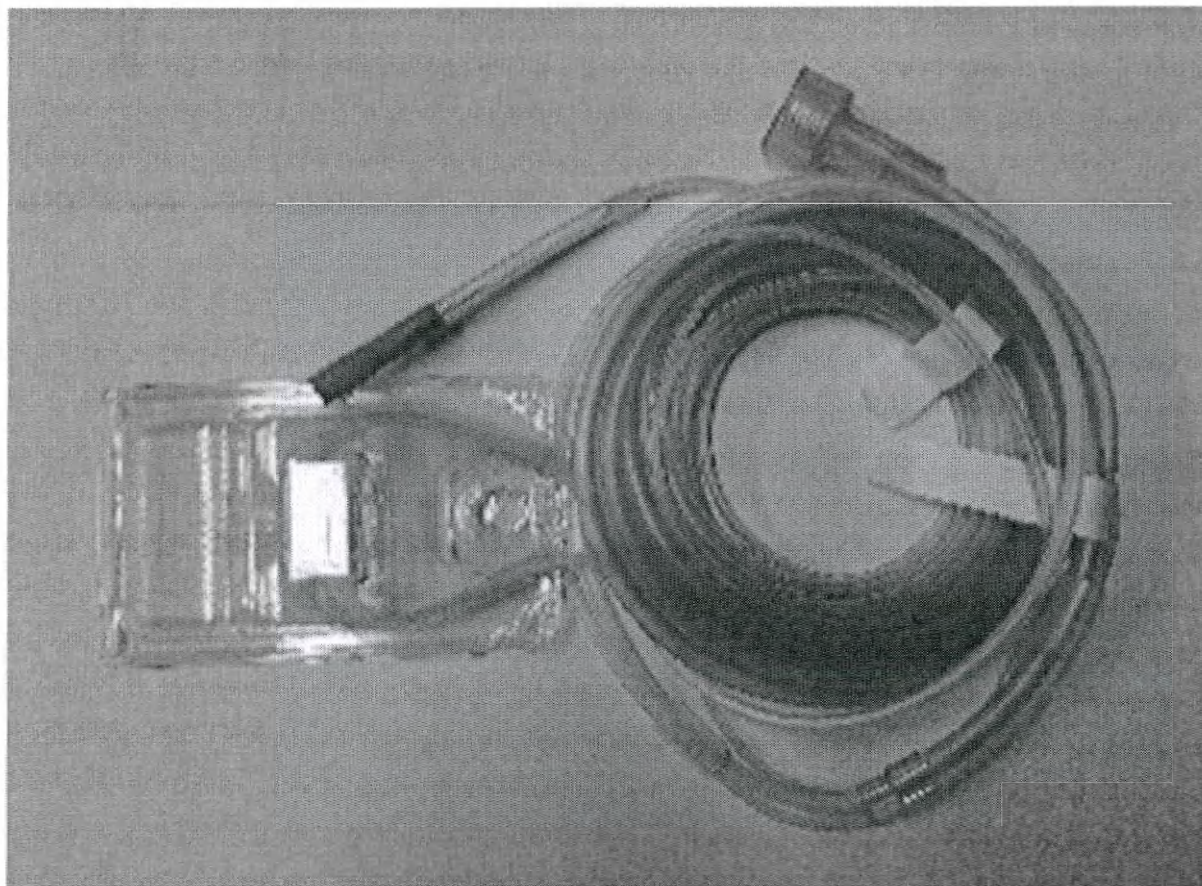

1. Устройство для контрольного тестирования 50 Ом , модель MR6905 – 1 шт.



Name	ACCESSORIES	Order No.	
			21210321.100
Model			
	2019-08-05		
	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R. China		
	Tel: 86-755-26582888		Fax: 86-755-26582680


3. Кабель заземления – 1 шт.



Кабель аналогового выхода – 1 шт.




Кабель синхронизации с дефибриллятором -1 шт.

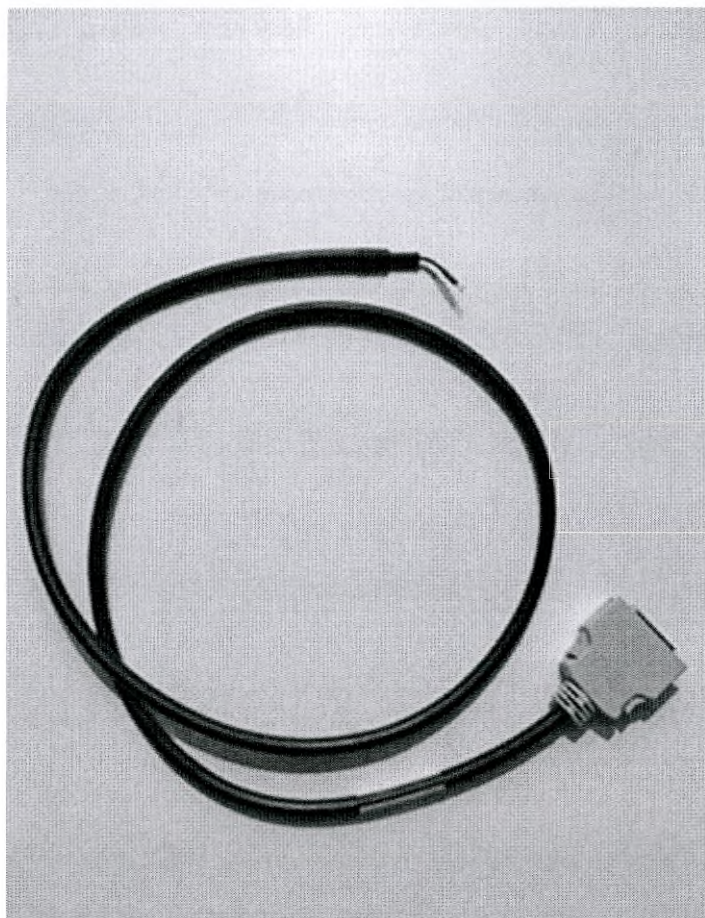

Сумка для принадлежностей ЭКГ



Термобумага

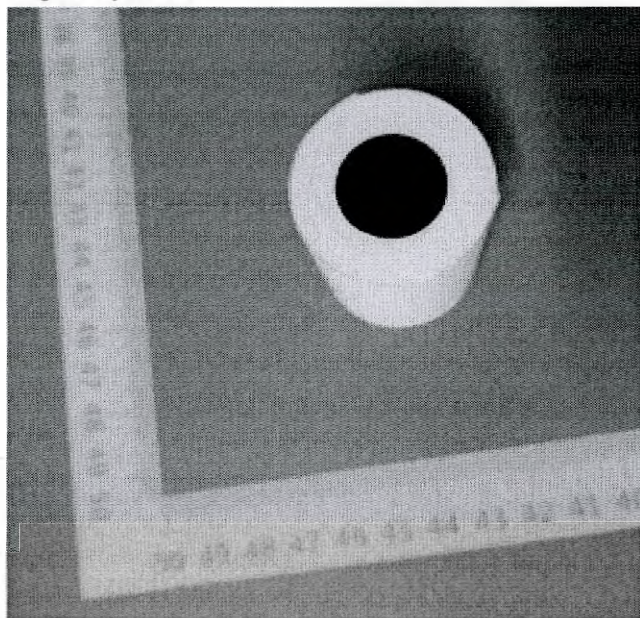



по доверенности от 24.05.22г
СЫСОЕВ Н.В.
руководитель отдела
регистрации

все правильно,
продумано 134 листа