

PHILIPS

Руководитель по нормативному
регулированию ООО "ФИЛИПС"

Горкуша Д.В.


«22» декабря 2022 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

«Система рентгенодиагностическая CombiDiagnost R90 с принадлежностями»


I. Состав:

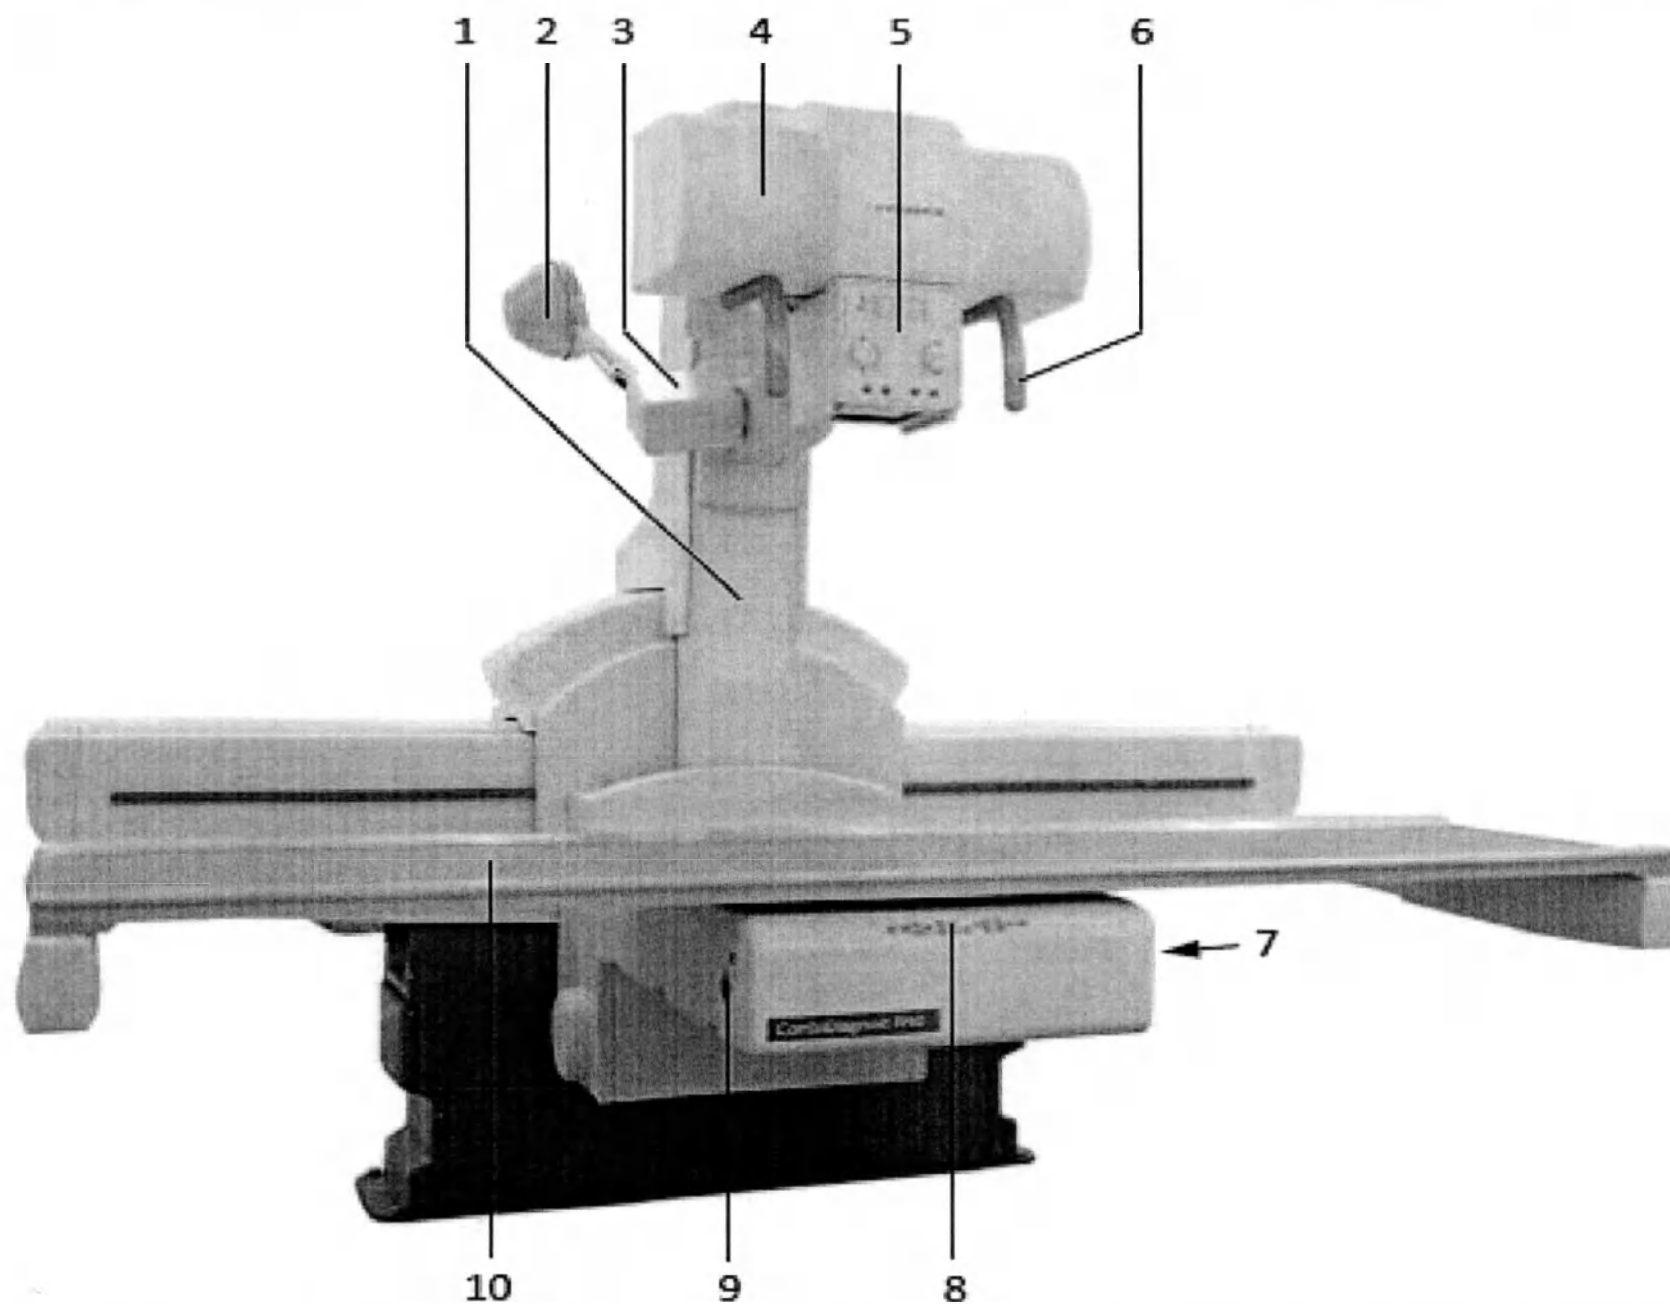


1. Базовый модуль (1 – Стойка, включающая блок рентгеновского излучателя и фиксированный детектор; 2- Компрессионный конус; 3 – Компрессор; 4 – Блок рентгеновского излучателя; 5 – Коллиматор; 6 – Ручки для вращения вручную блок рентгеновского излучателя; 7 - Включение/выключение панели управления столом; 9 – Кнопки экстренного останова с обеих сторон; 10 – Дека стола).

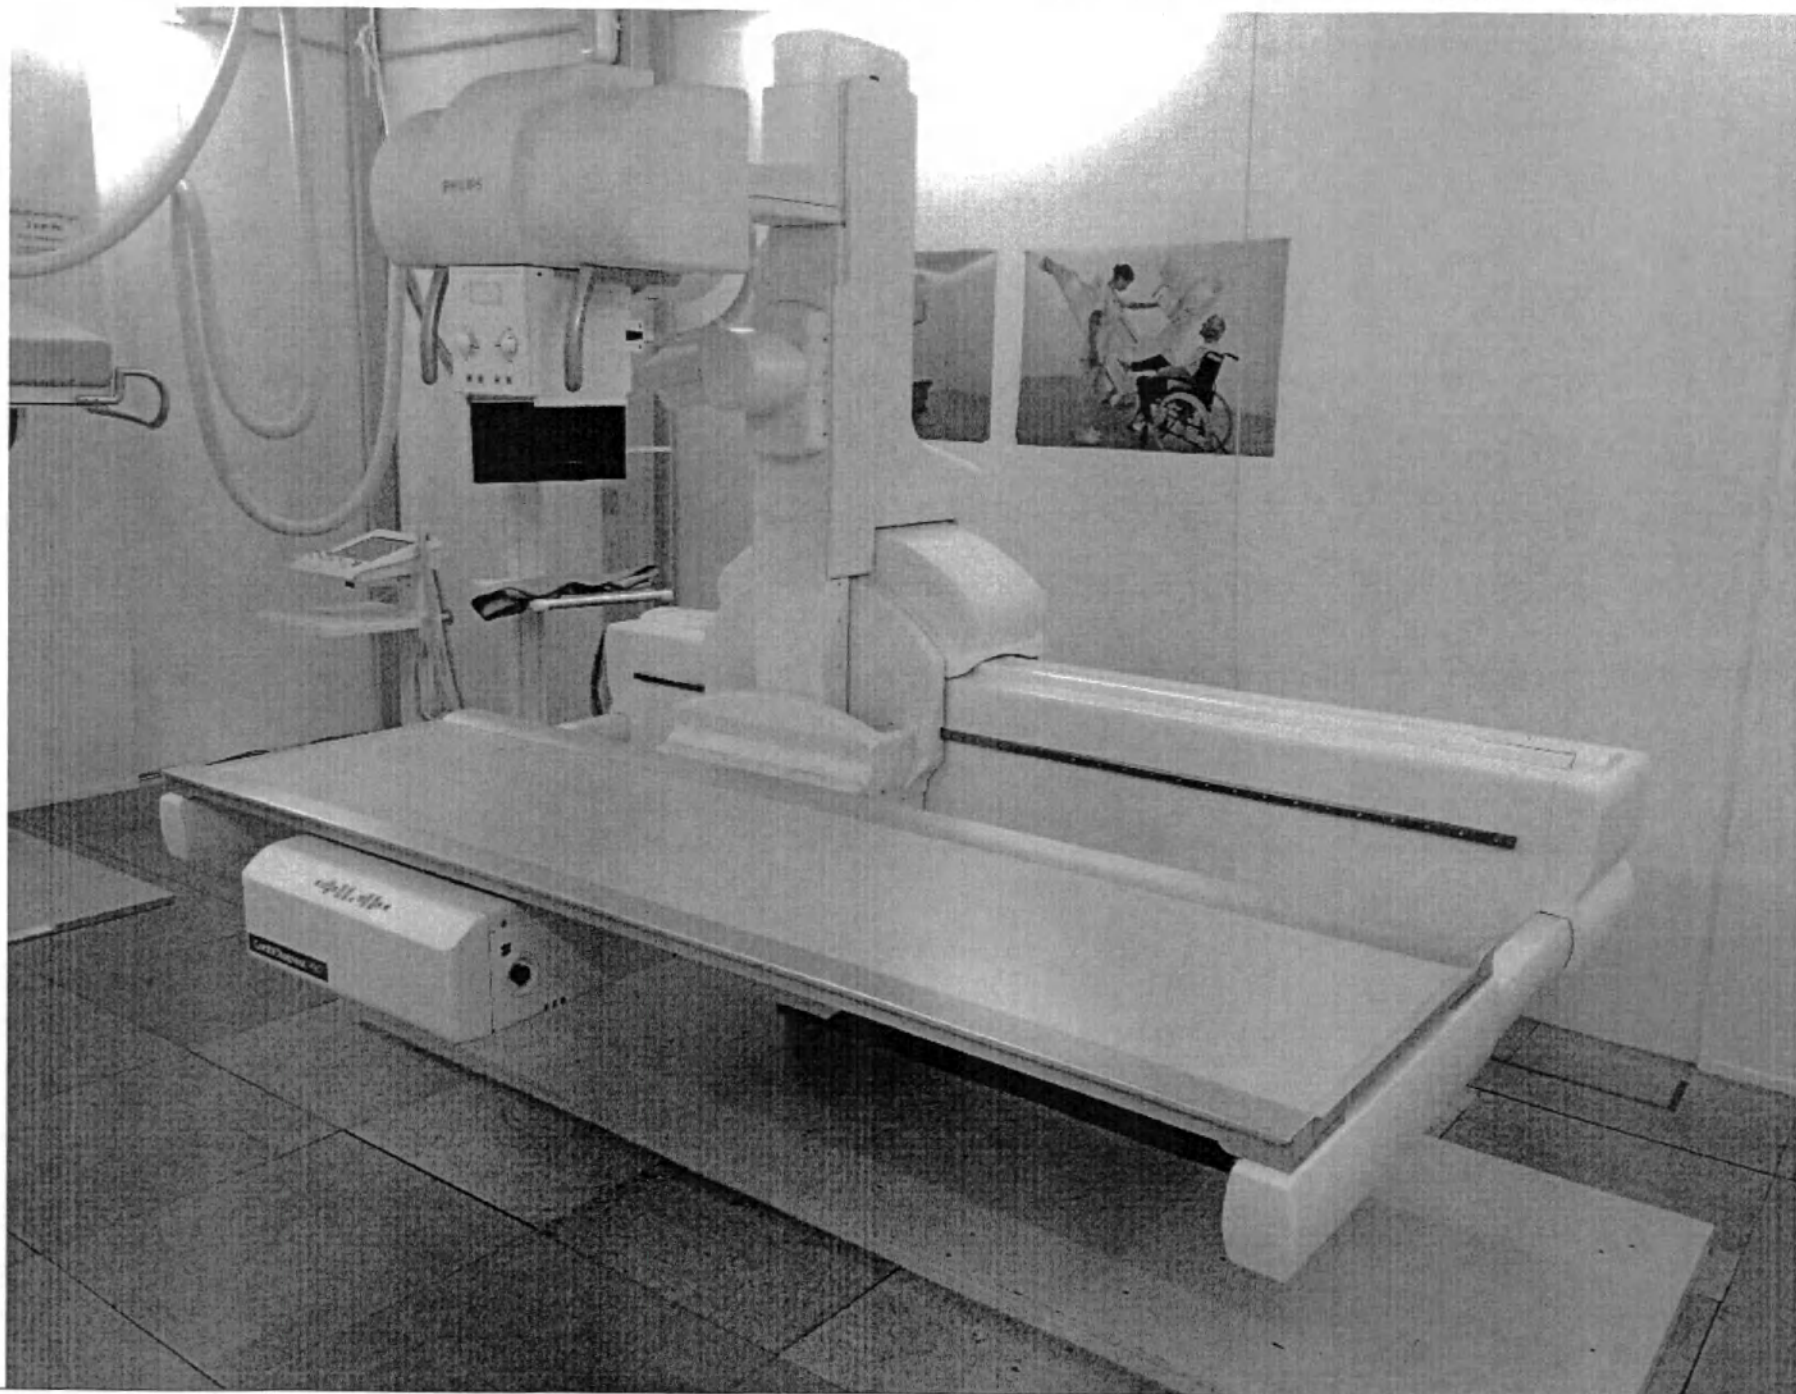


1.1 Стол, в составе: 1.1.1. Дека стола. 1.1.2. Рукоятки для стола

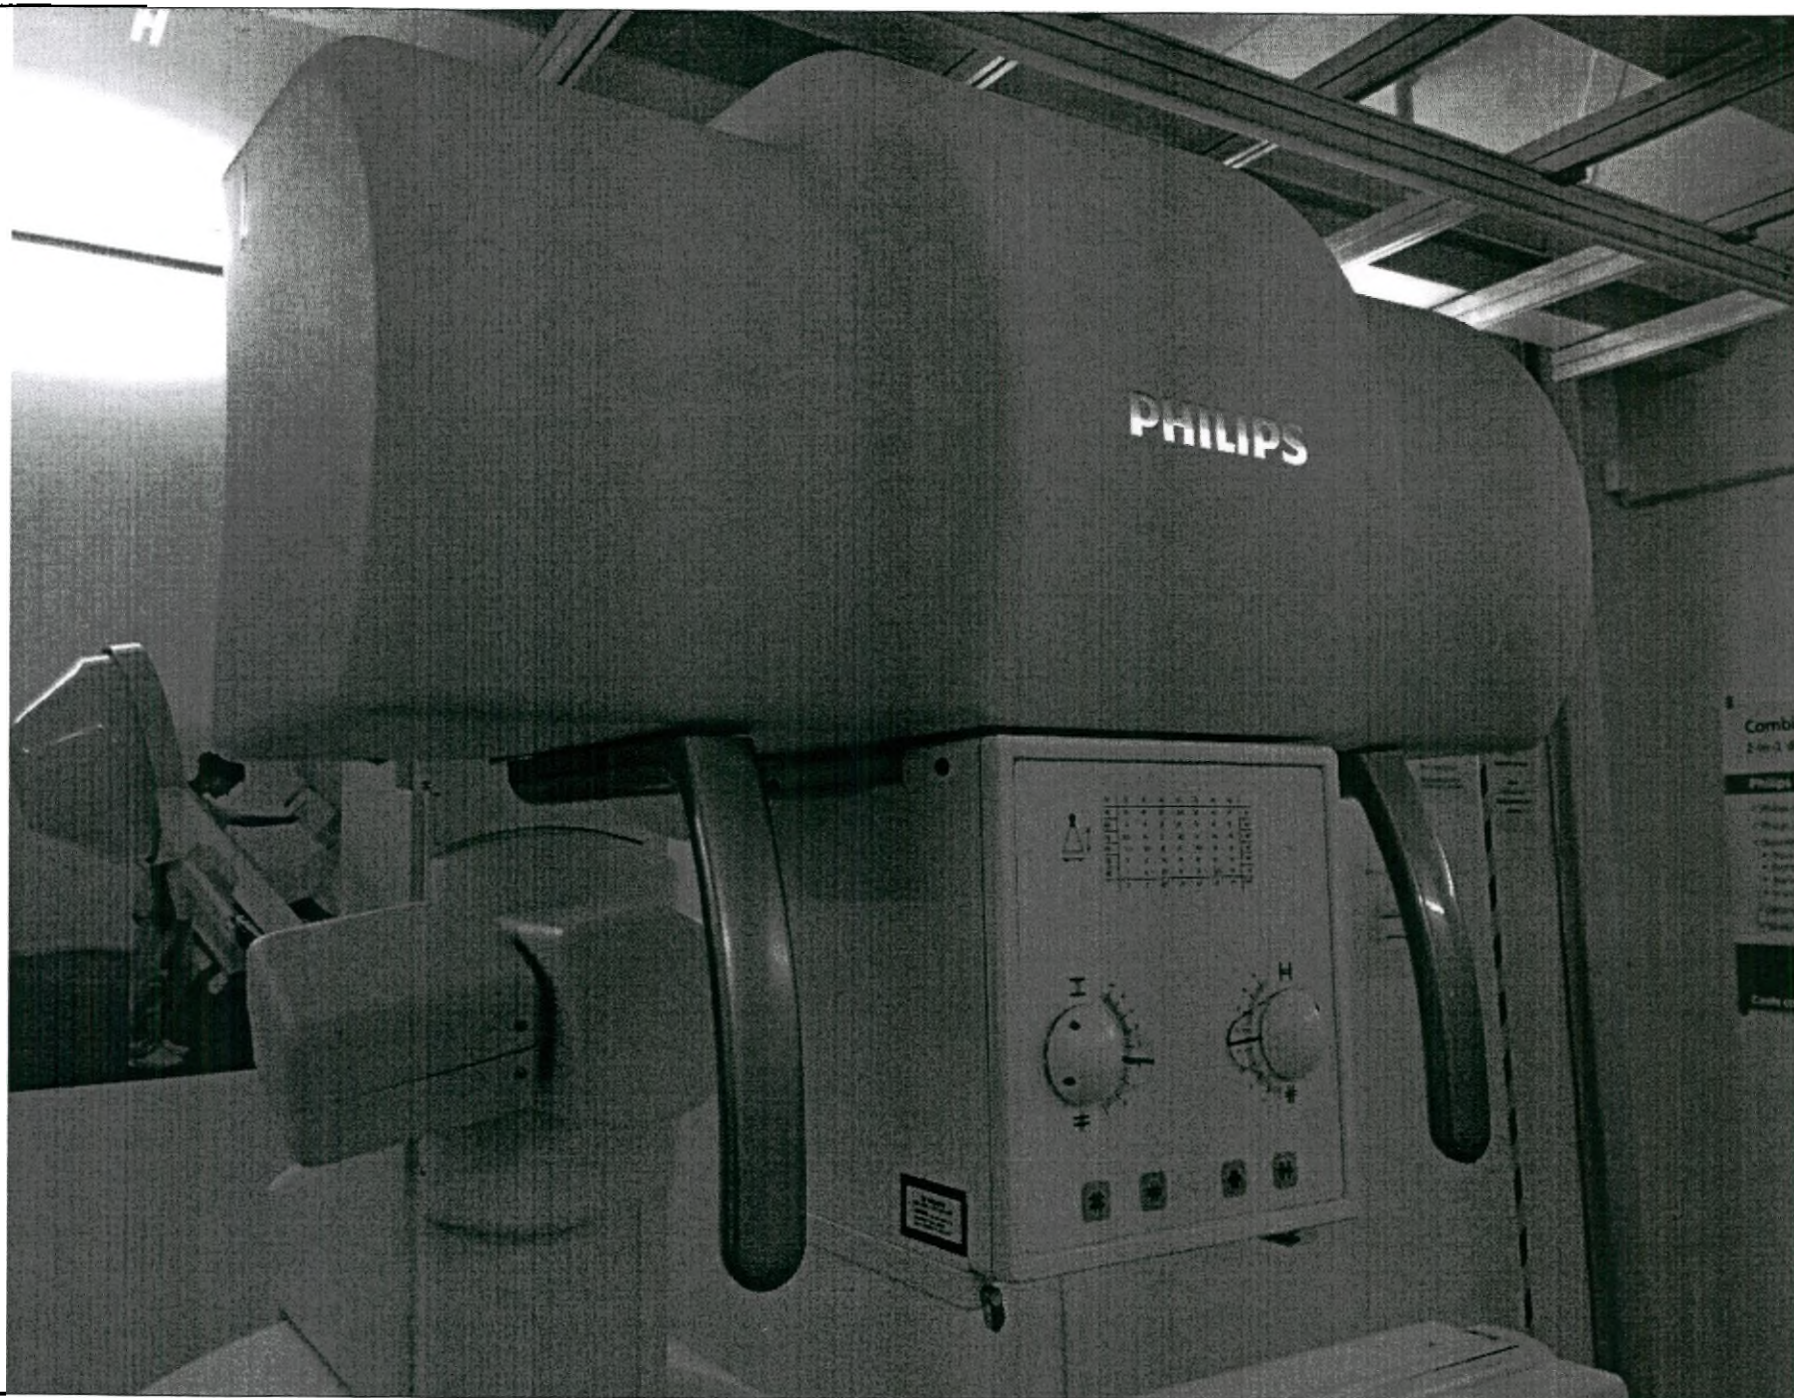

1.2 Блок рентгеновского излучателя с Рентгеновской трубкой (SRO 33100 ROT380 или SRM 0608 ROT GS 505).

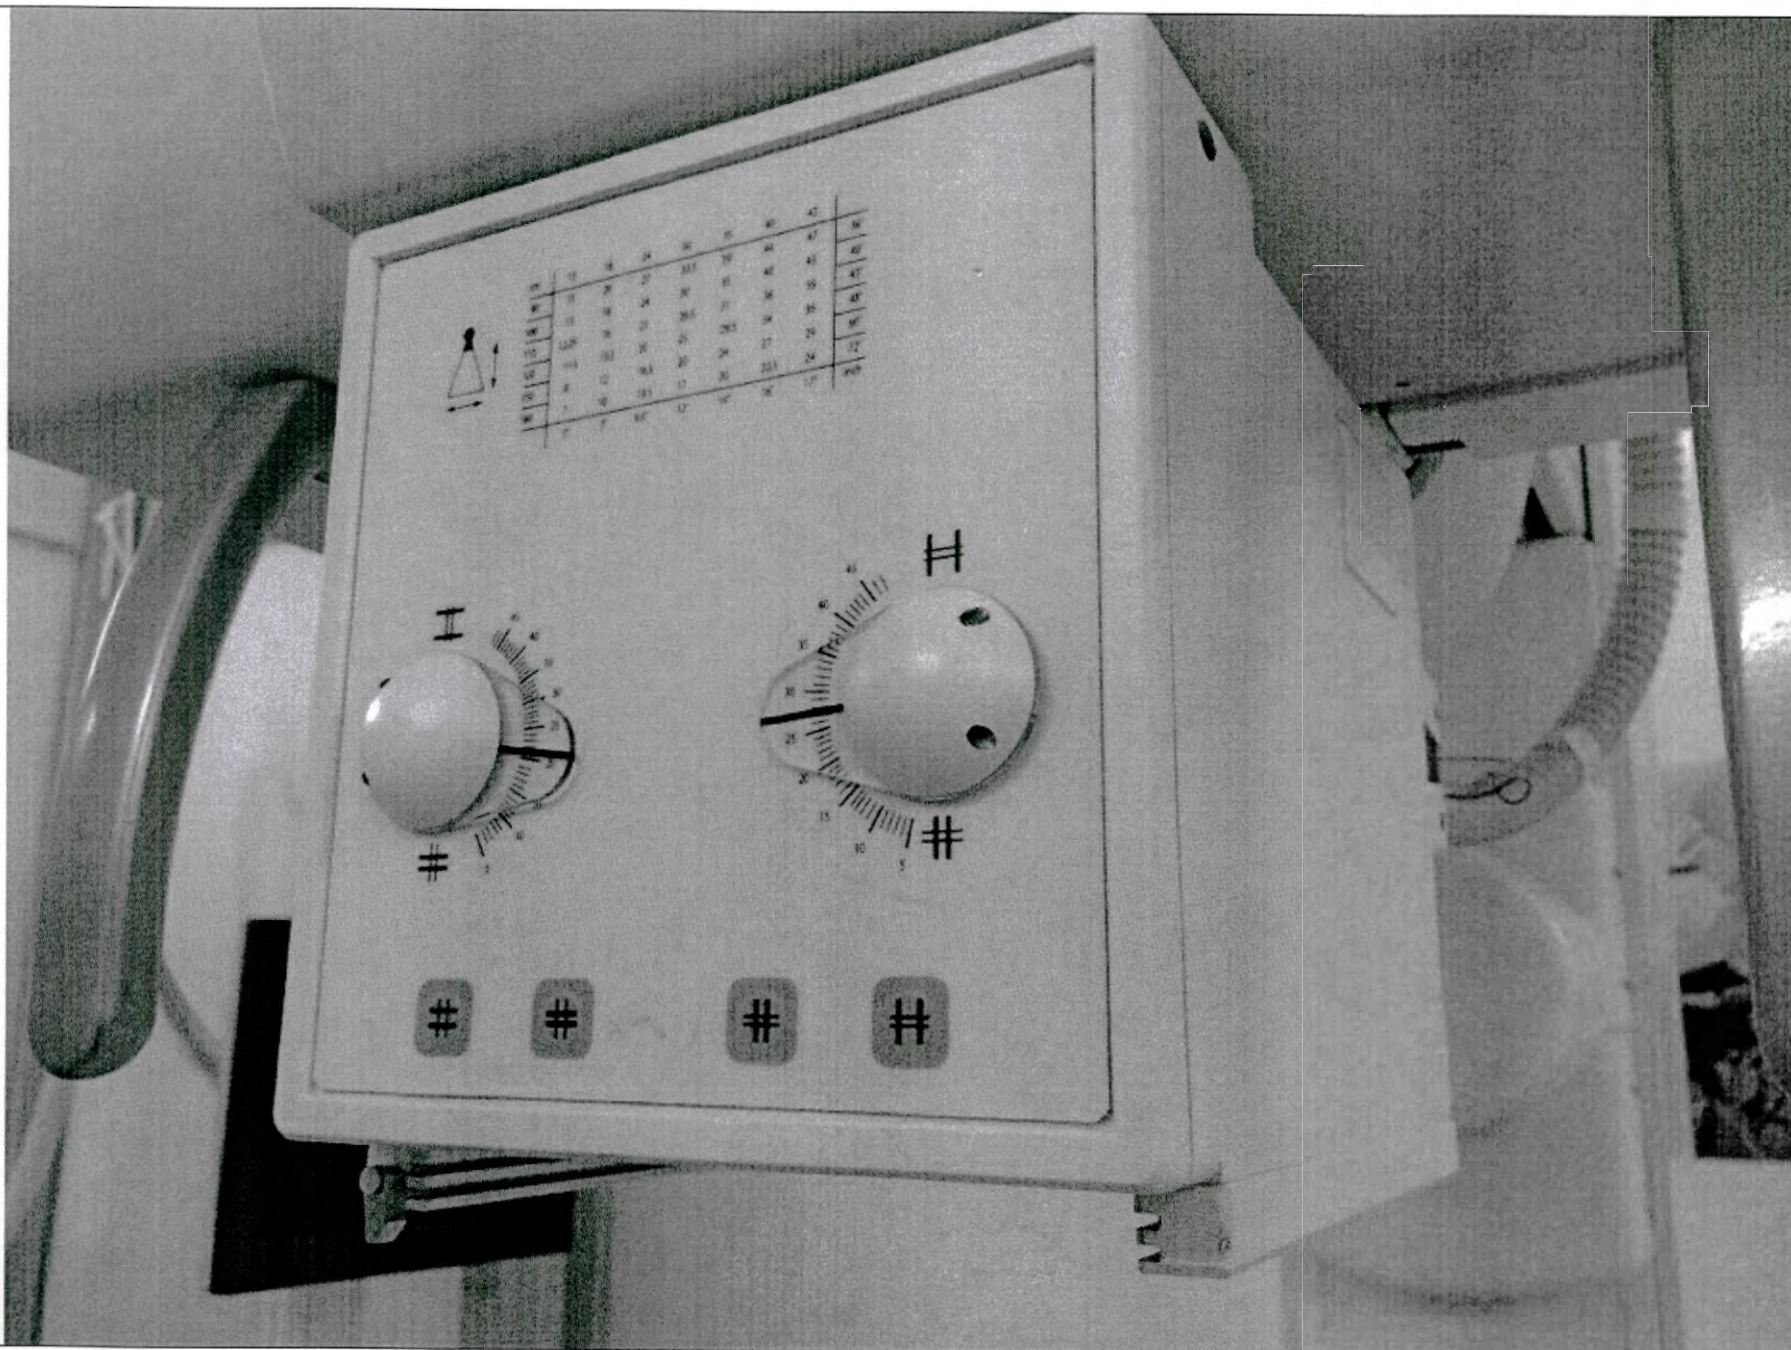

1.3 Коллиматор.

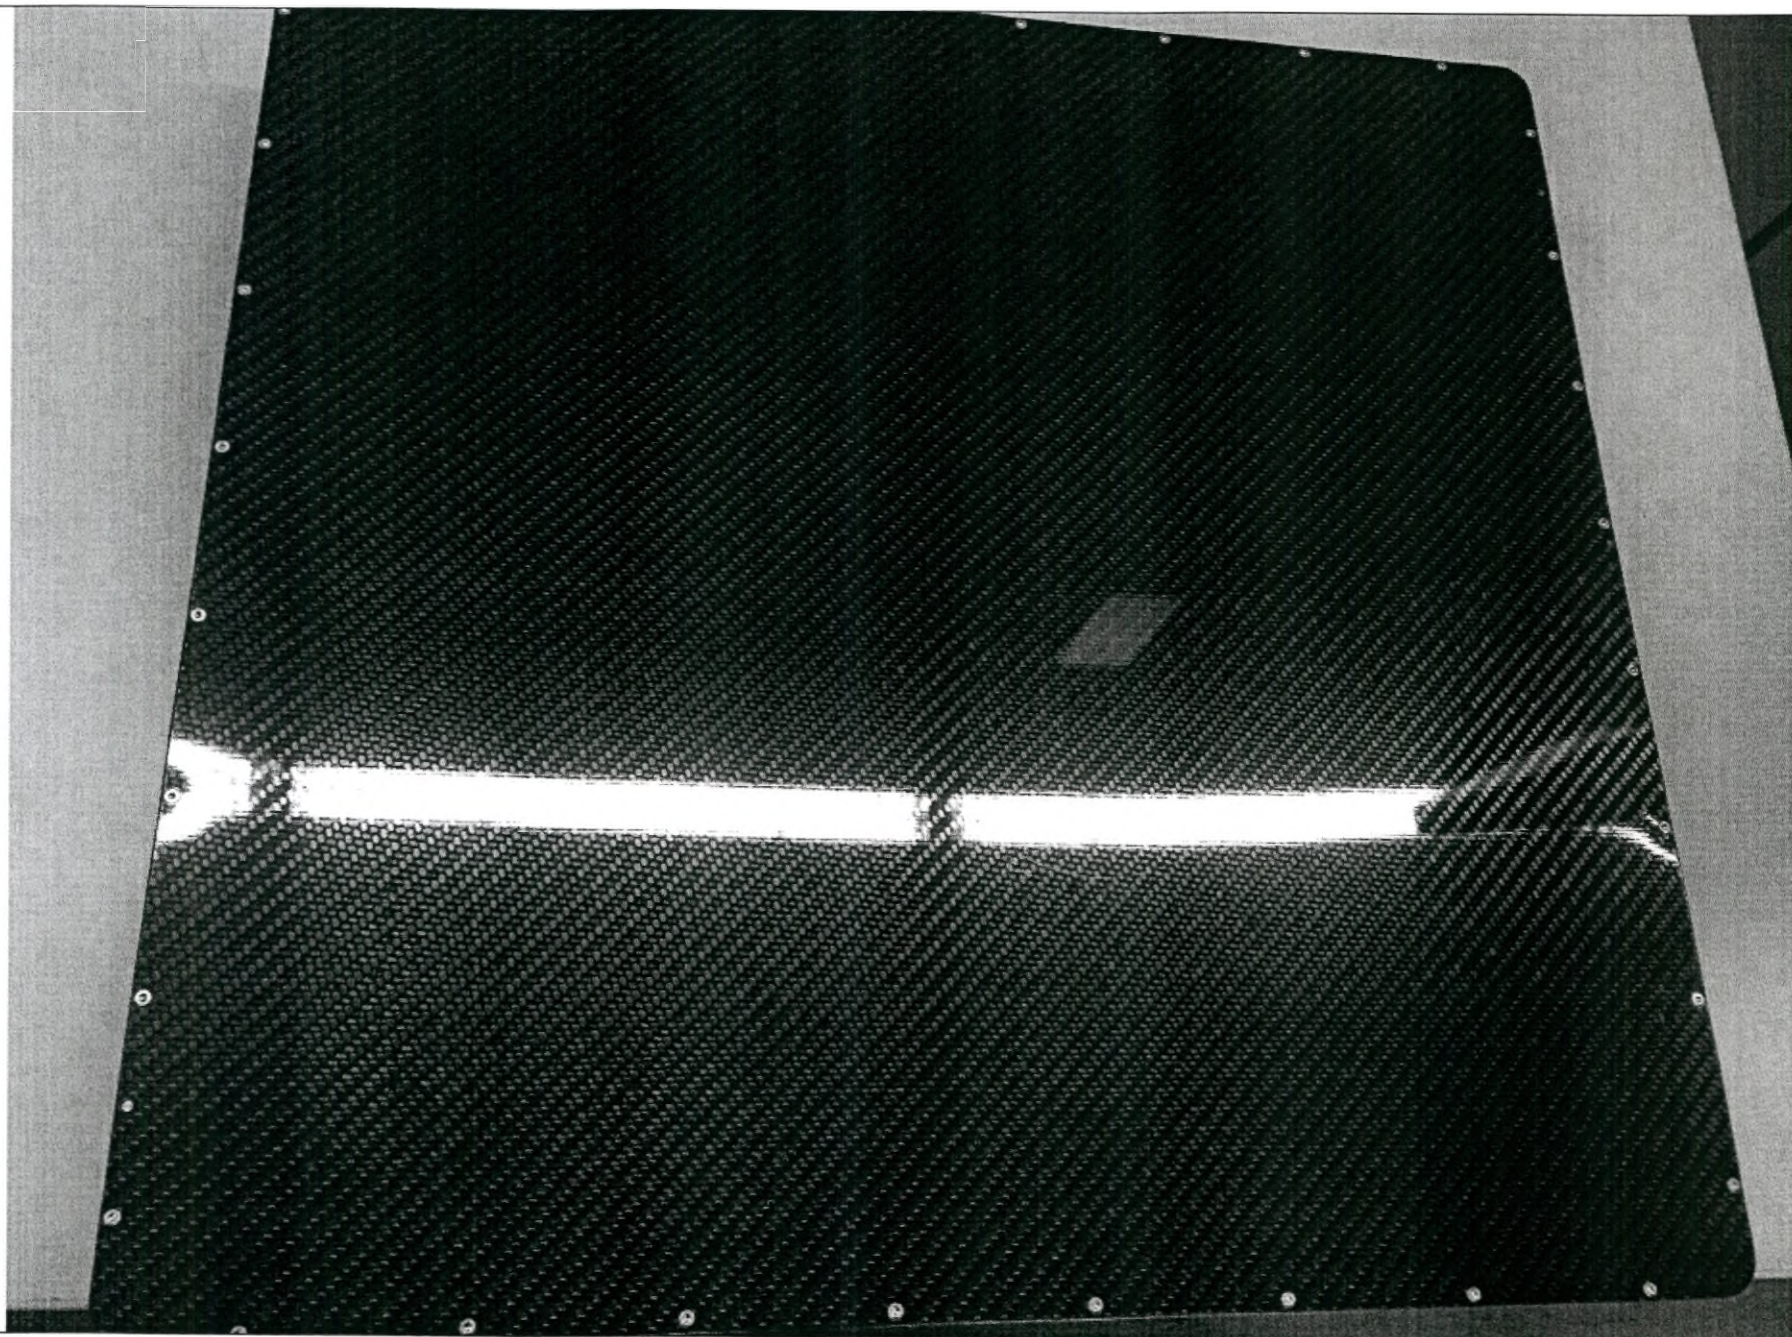

1.4 Детектор.

PHILIPS Patient list | ISAP | System

General | Export queue | Print queue | DICOM CD | Portable Detector | Quality assurance | Settings | Administration

Session

System ID: RT_System
 Model: EasyDiagnost|Ivra
 Host name: DIMC1
 Ad. uid: Ileva
 IP address: 172.1.16.50
 MAC address: 0003050dcb61b
 Version: S.B.0022.1.7.1.7
 Workgroup status: SIBUR
 Name [Name]: 2048

Workgroup data

License status

License status	Report date
ECCOM_Plan	01-jul-2013
ECCOM_Media	01-jul-2013
ECCOM_Export	01-jul-2013
ECCOM_Software_Report	01-jul-2013
RTS_WebManagement	01-jul-2013
RTS_QuickReview	01-jul-2013

Service access

Enable service access: ☐ **Modality mode:** Diagnostic

Enable distance: ☐ **Service tool:**

Modality only: ☐ **Report date:** 22 January 2013

Service access

Enable service access: ☐ **Modality mode:** Diagnostic


Enable distance: ☐ **Service tool:**

Modality only: ☐ **Report date:** 22 January 2013


License status

License status	Report date
ECCOM_Plan	01-jul-2013
ECCOM_Media	01-jul-2013
ECCOM_Export	01-jul-2013
ECCOM_Software_Report	01-jul-2013
RTS_WebManagement	01-jul-2013
RTS_QuickReview	01-jul-2013

[elevaRT_System] RT web tool version

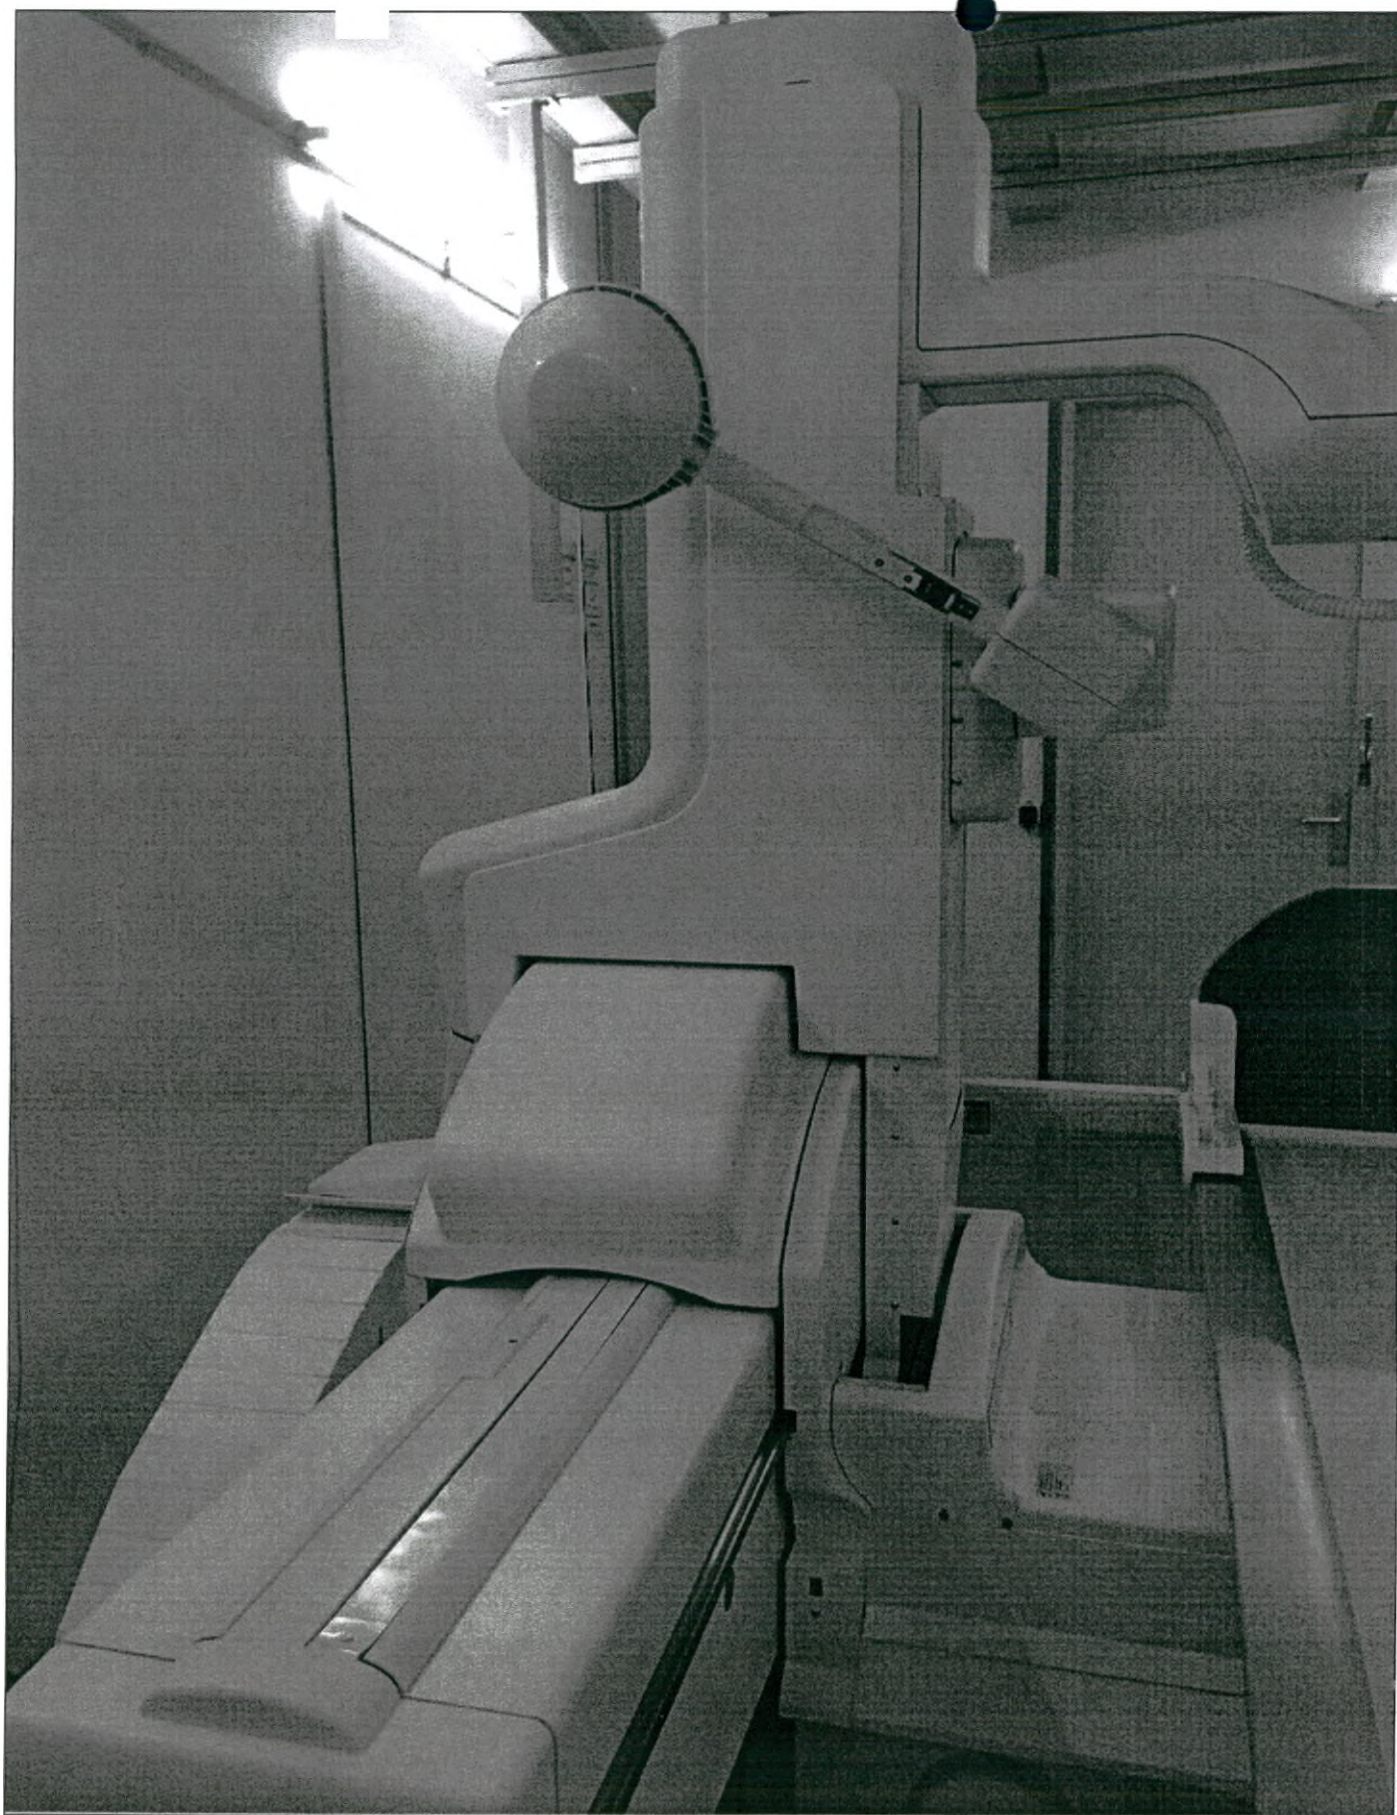


1.6 Стойка для блока рентгеновского излучателя и встроенного цифрового детектора.

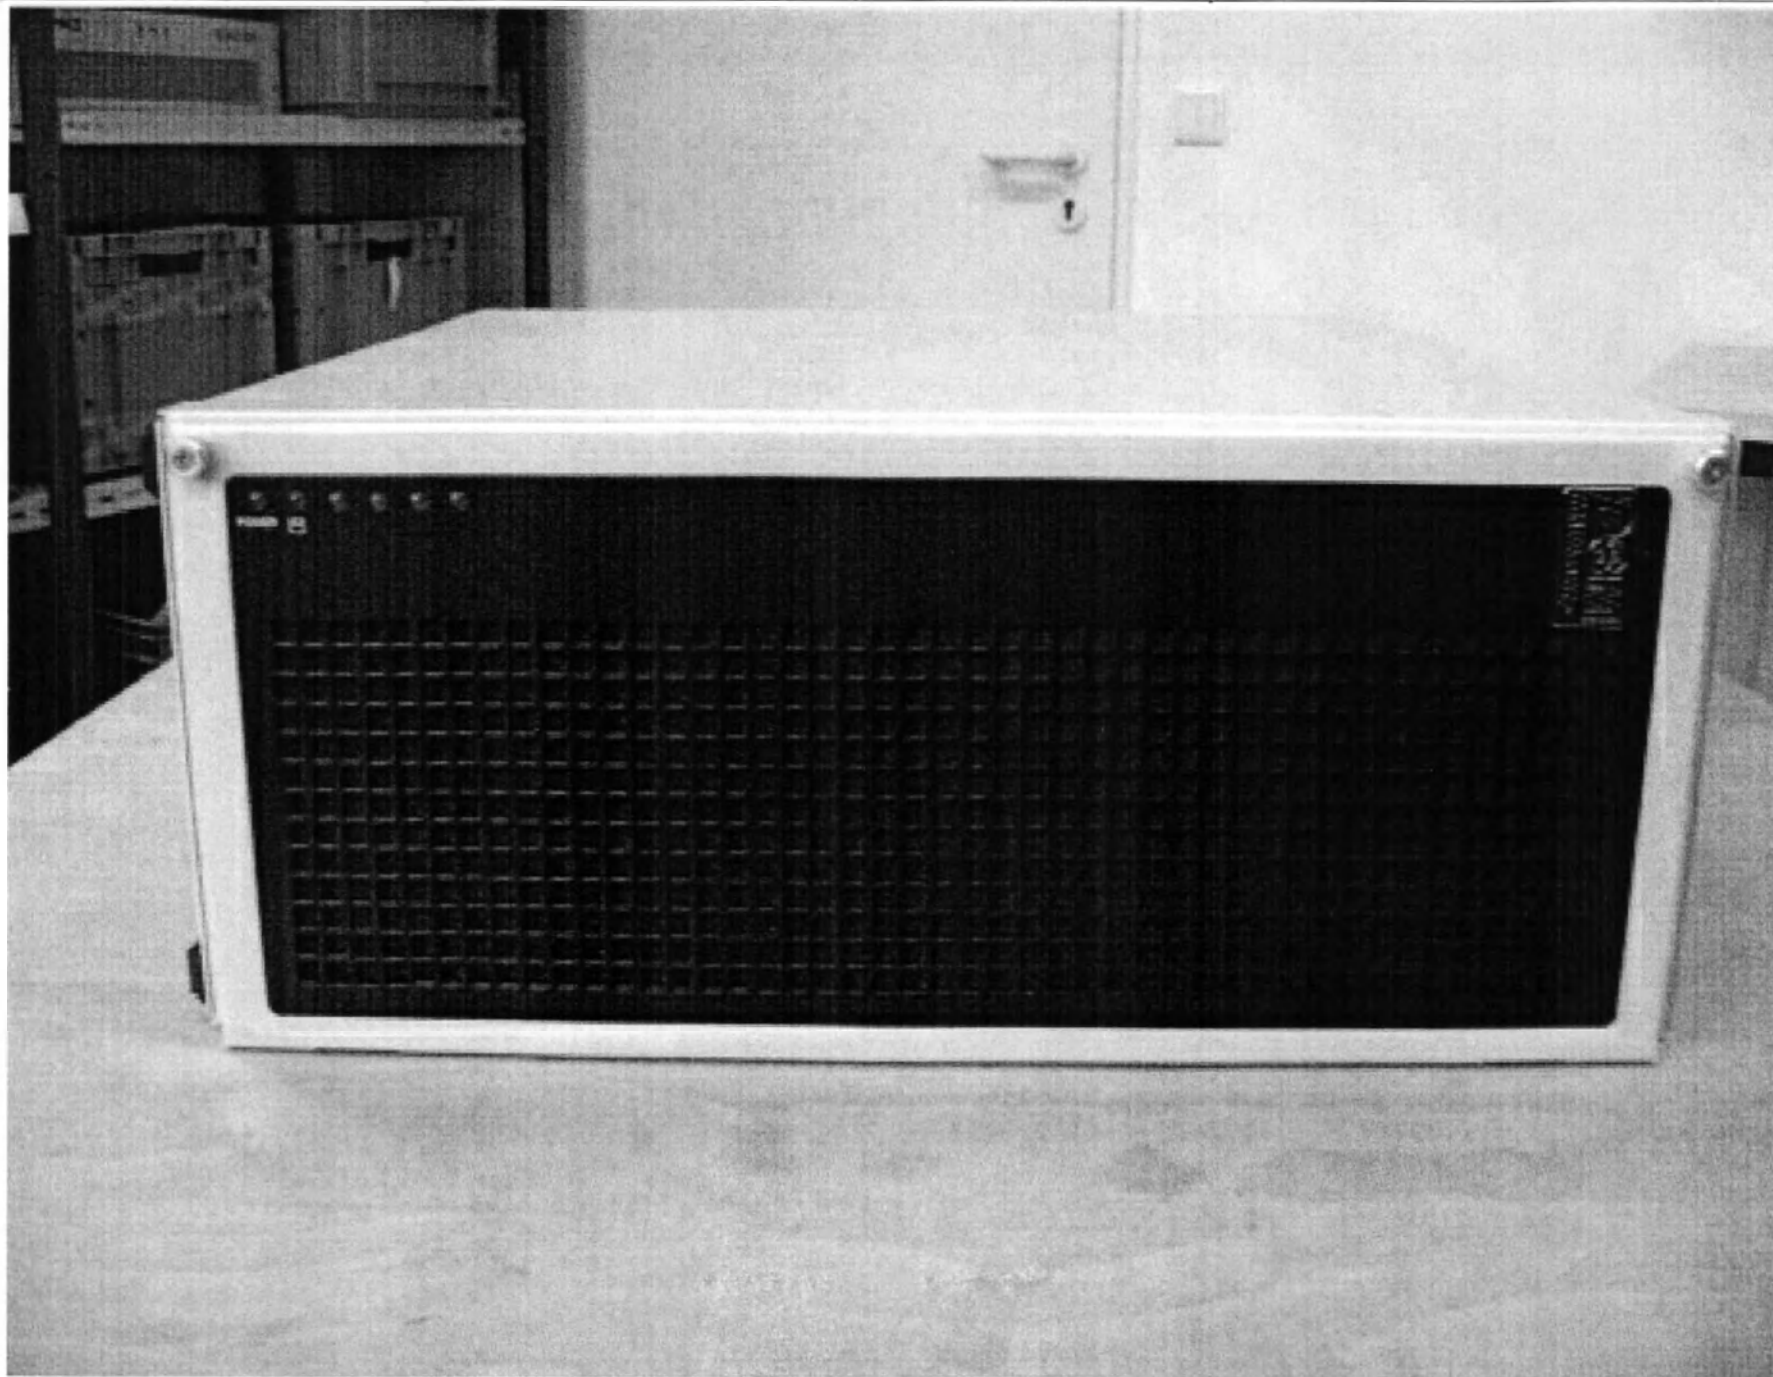


2. Рабочая станция Eleva Workspot в составе:

2.1 Системный блок с предустановленным программным обеспечением.

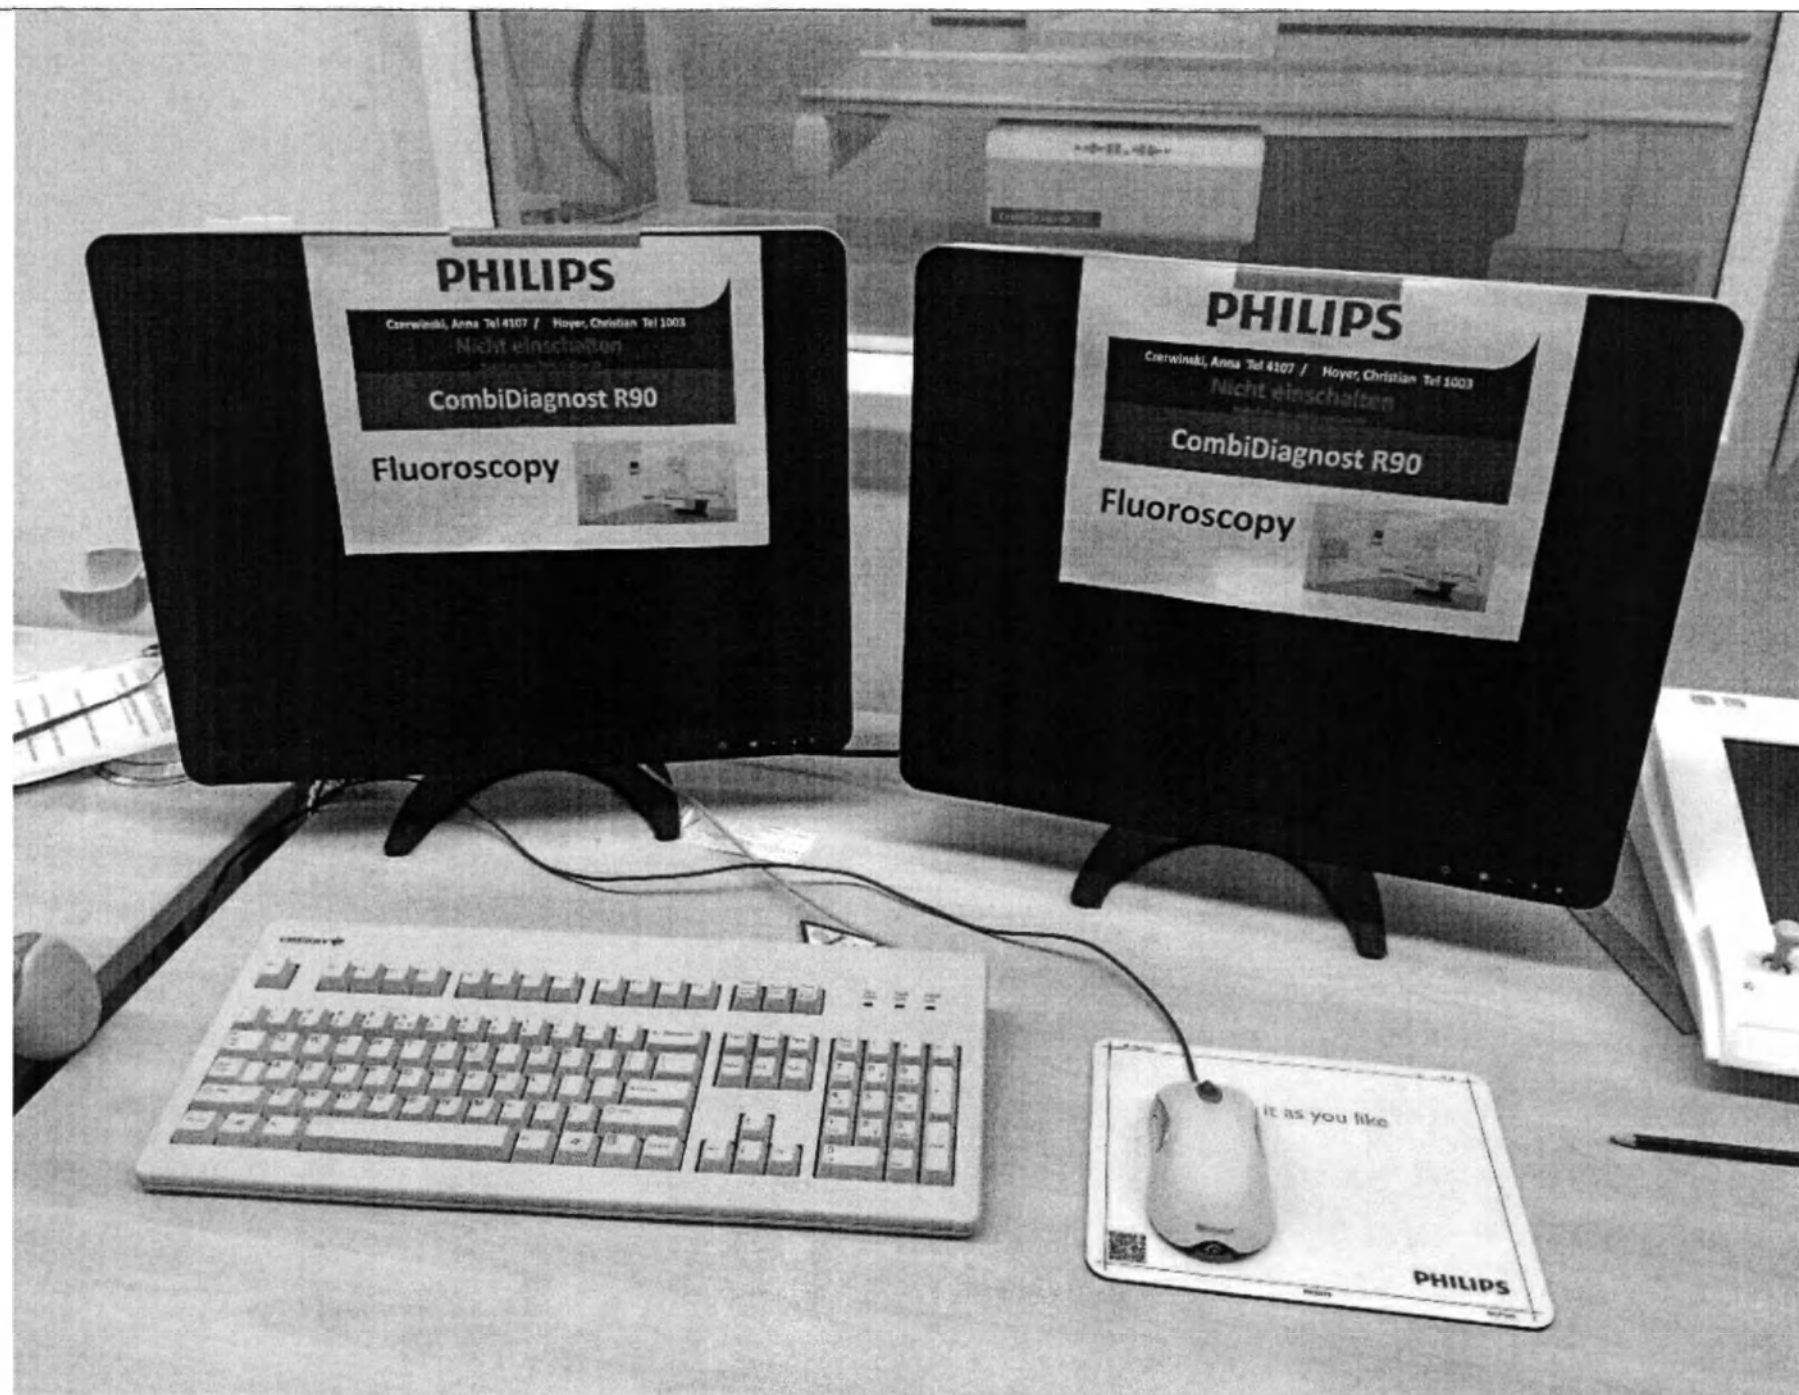


2.2 Монитор с сенсорным экраном.

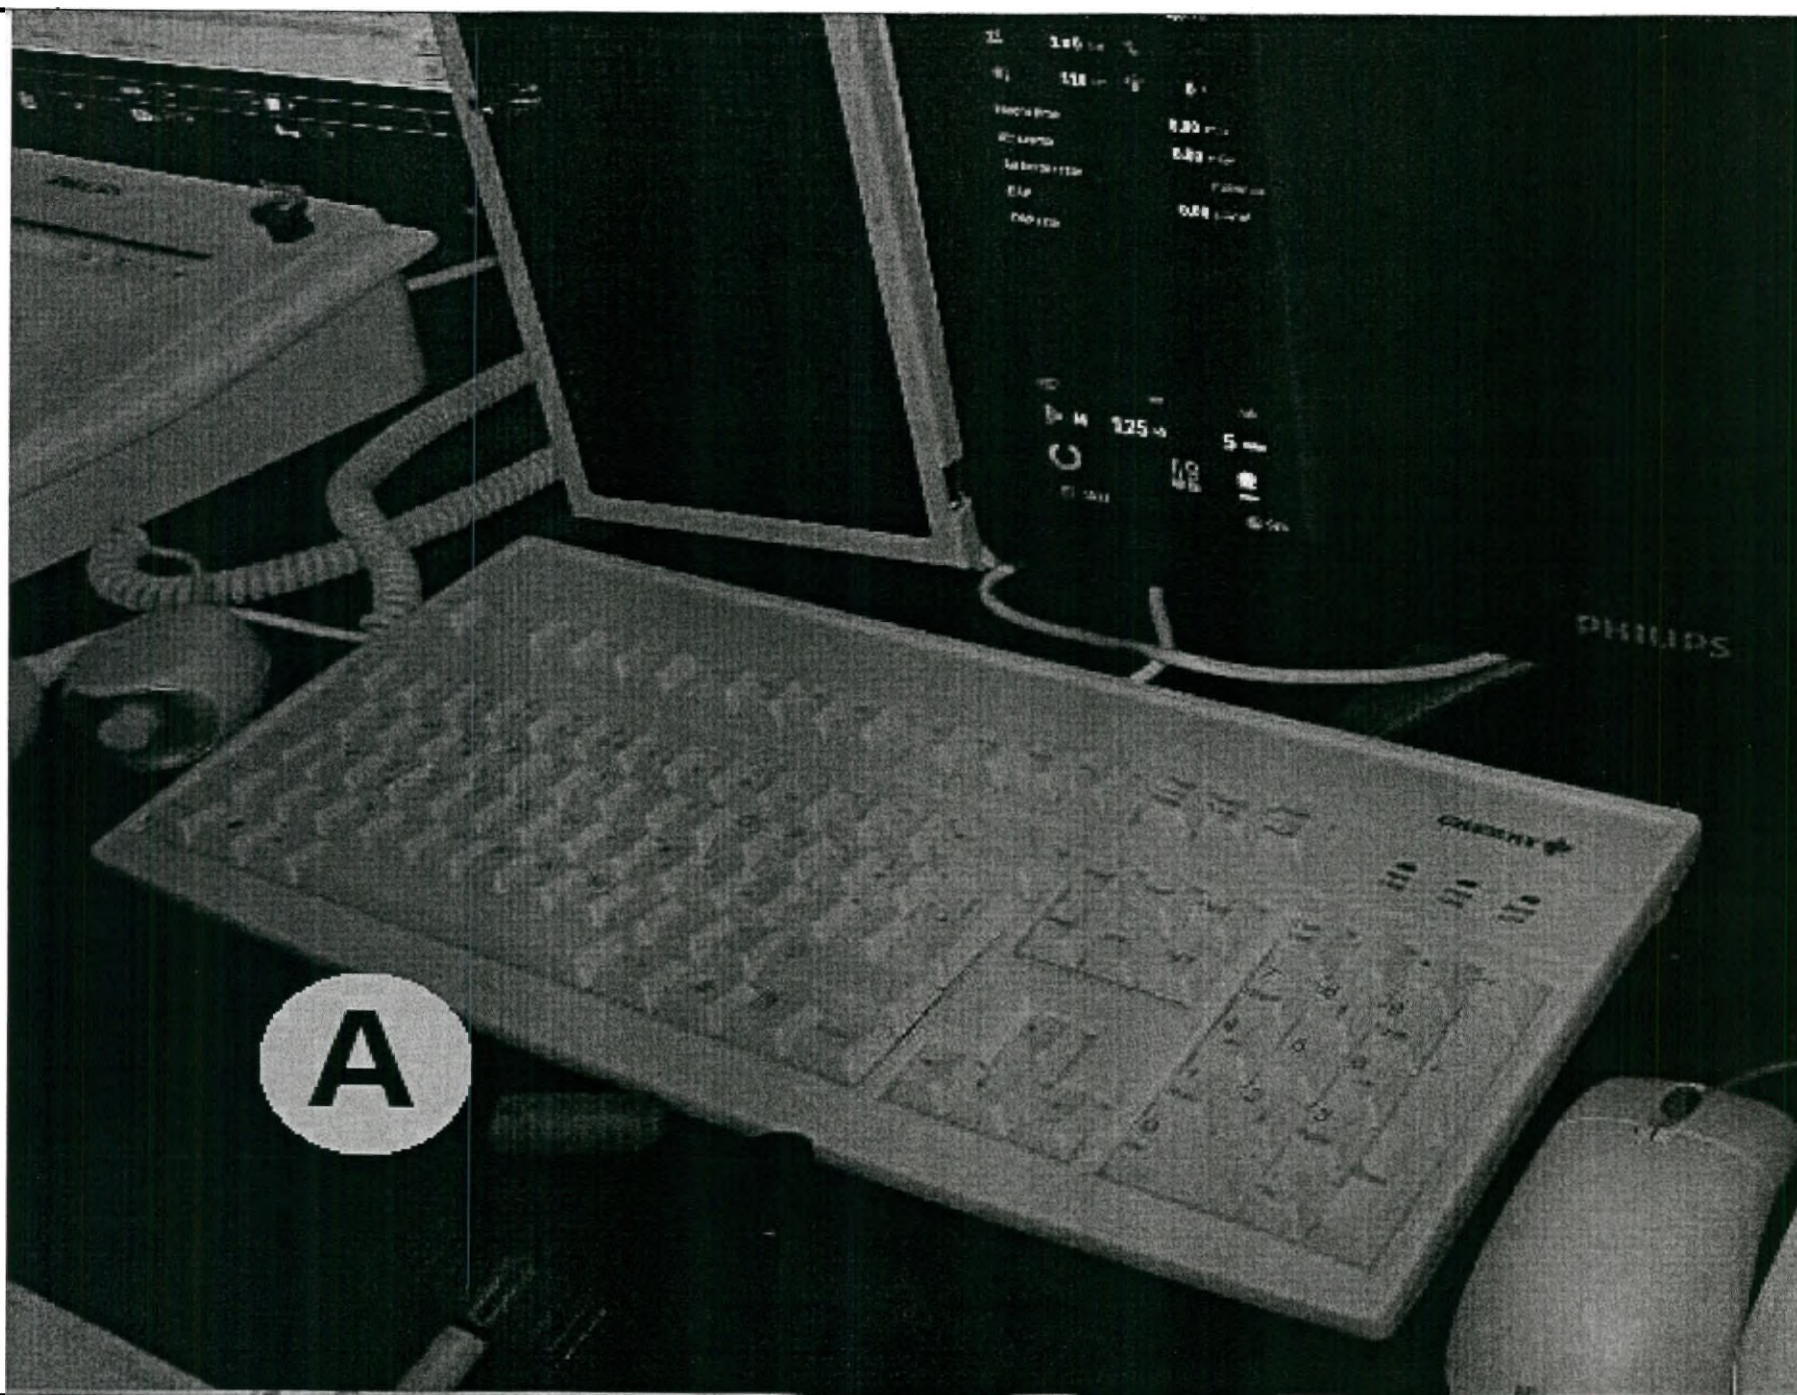


2.3 Клавиатура (Обозначена символом А)




2.4 Мышь (Обозначена символом В)

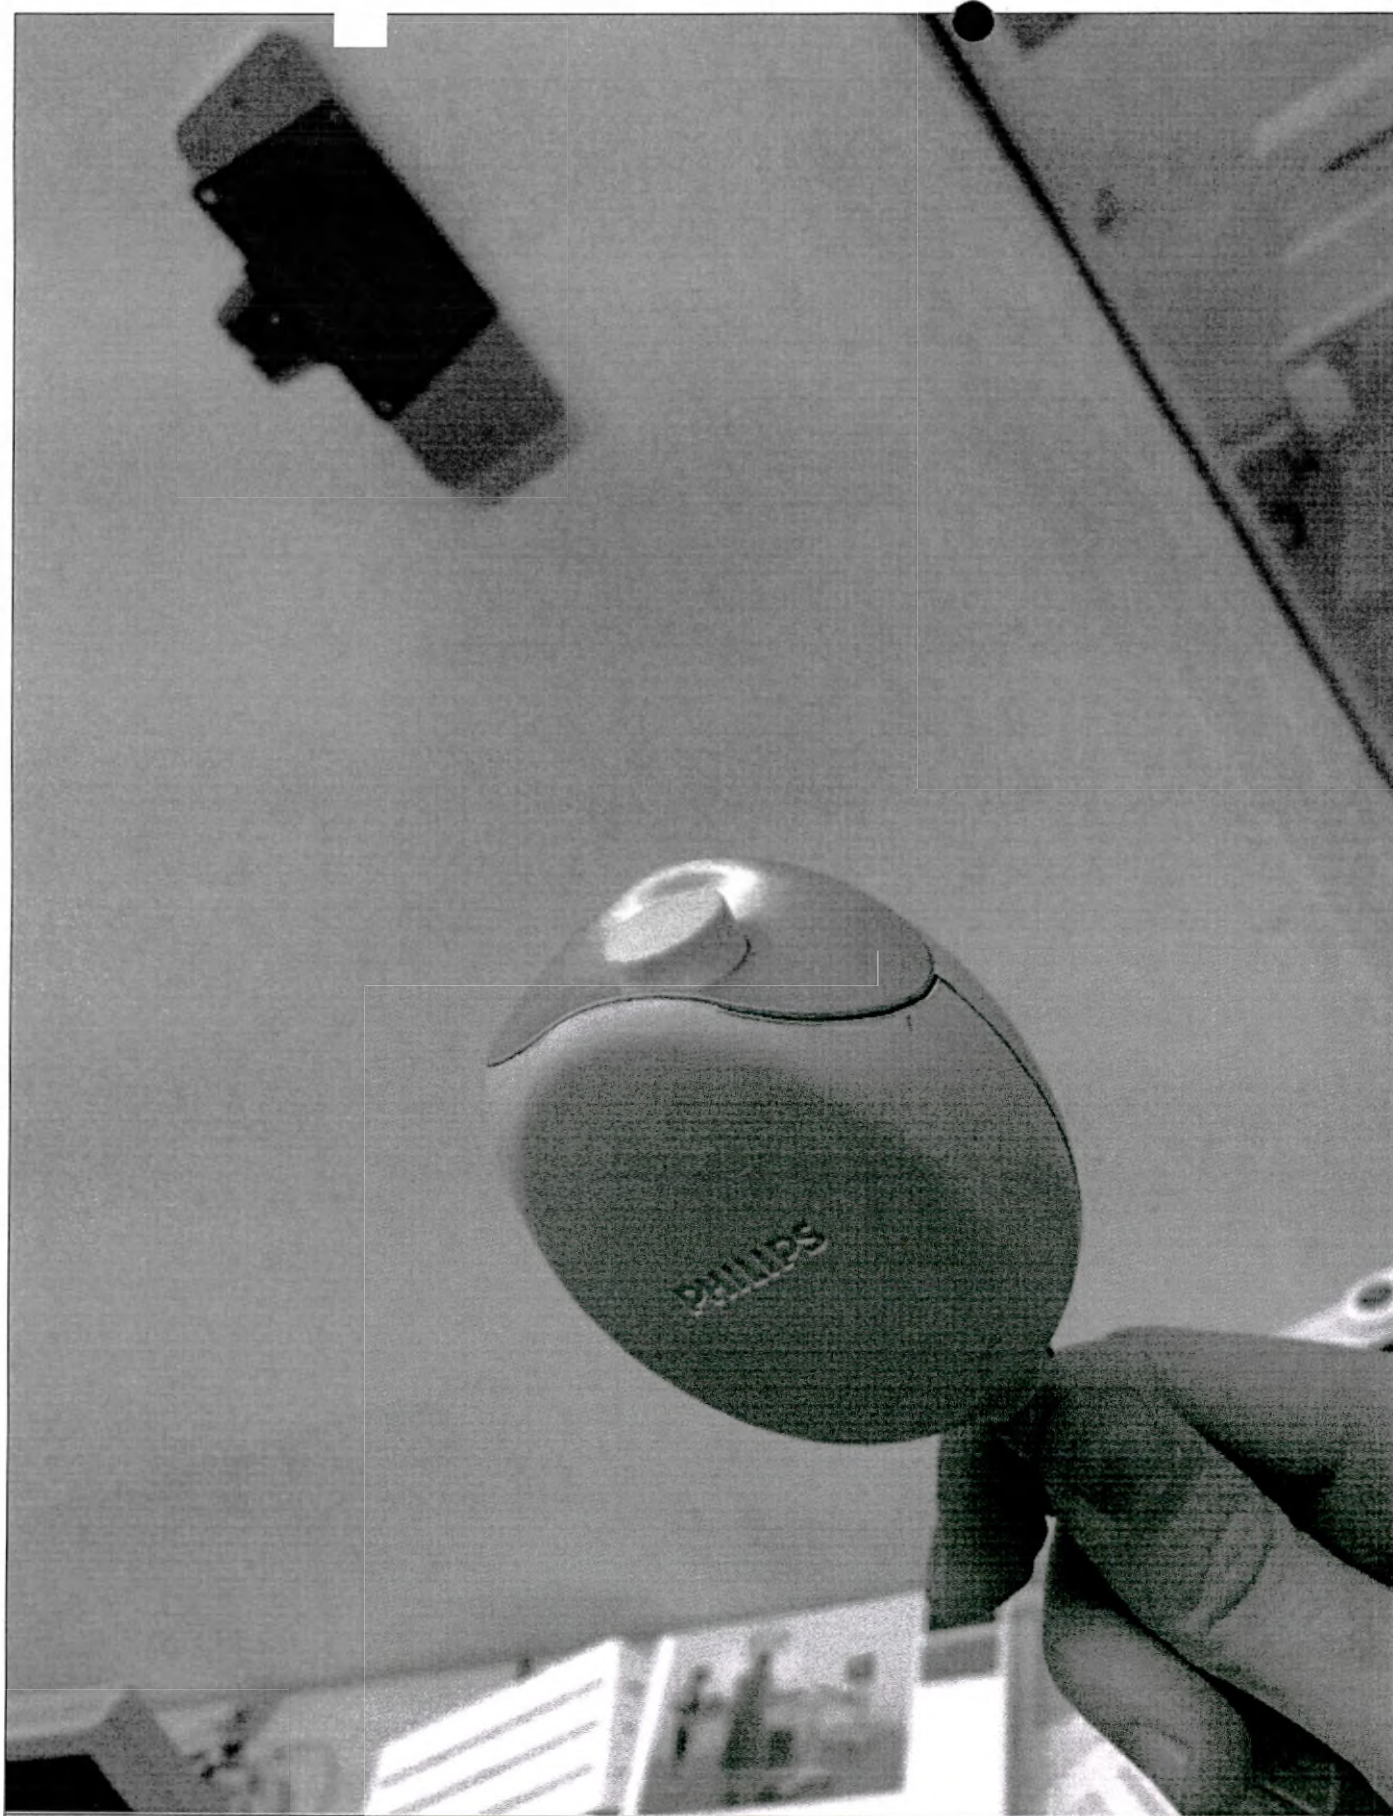

2.5 Переключатель экспозиции ручной.

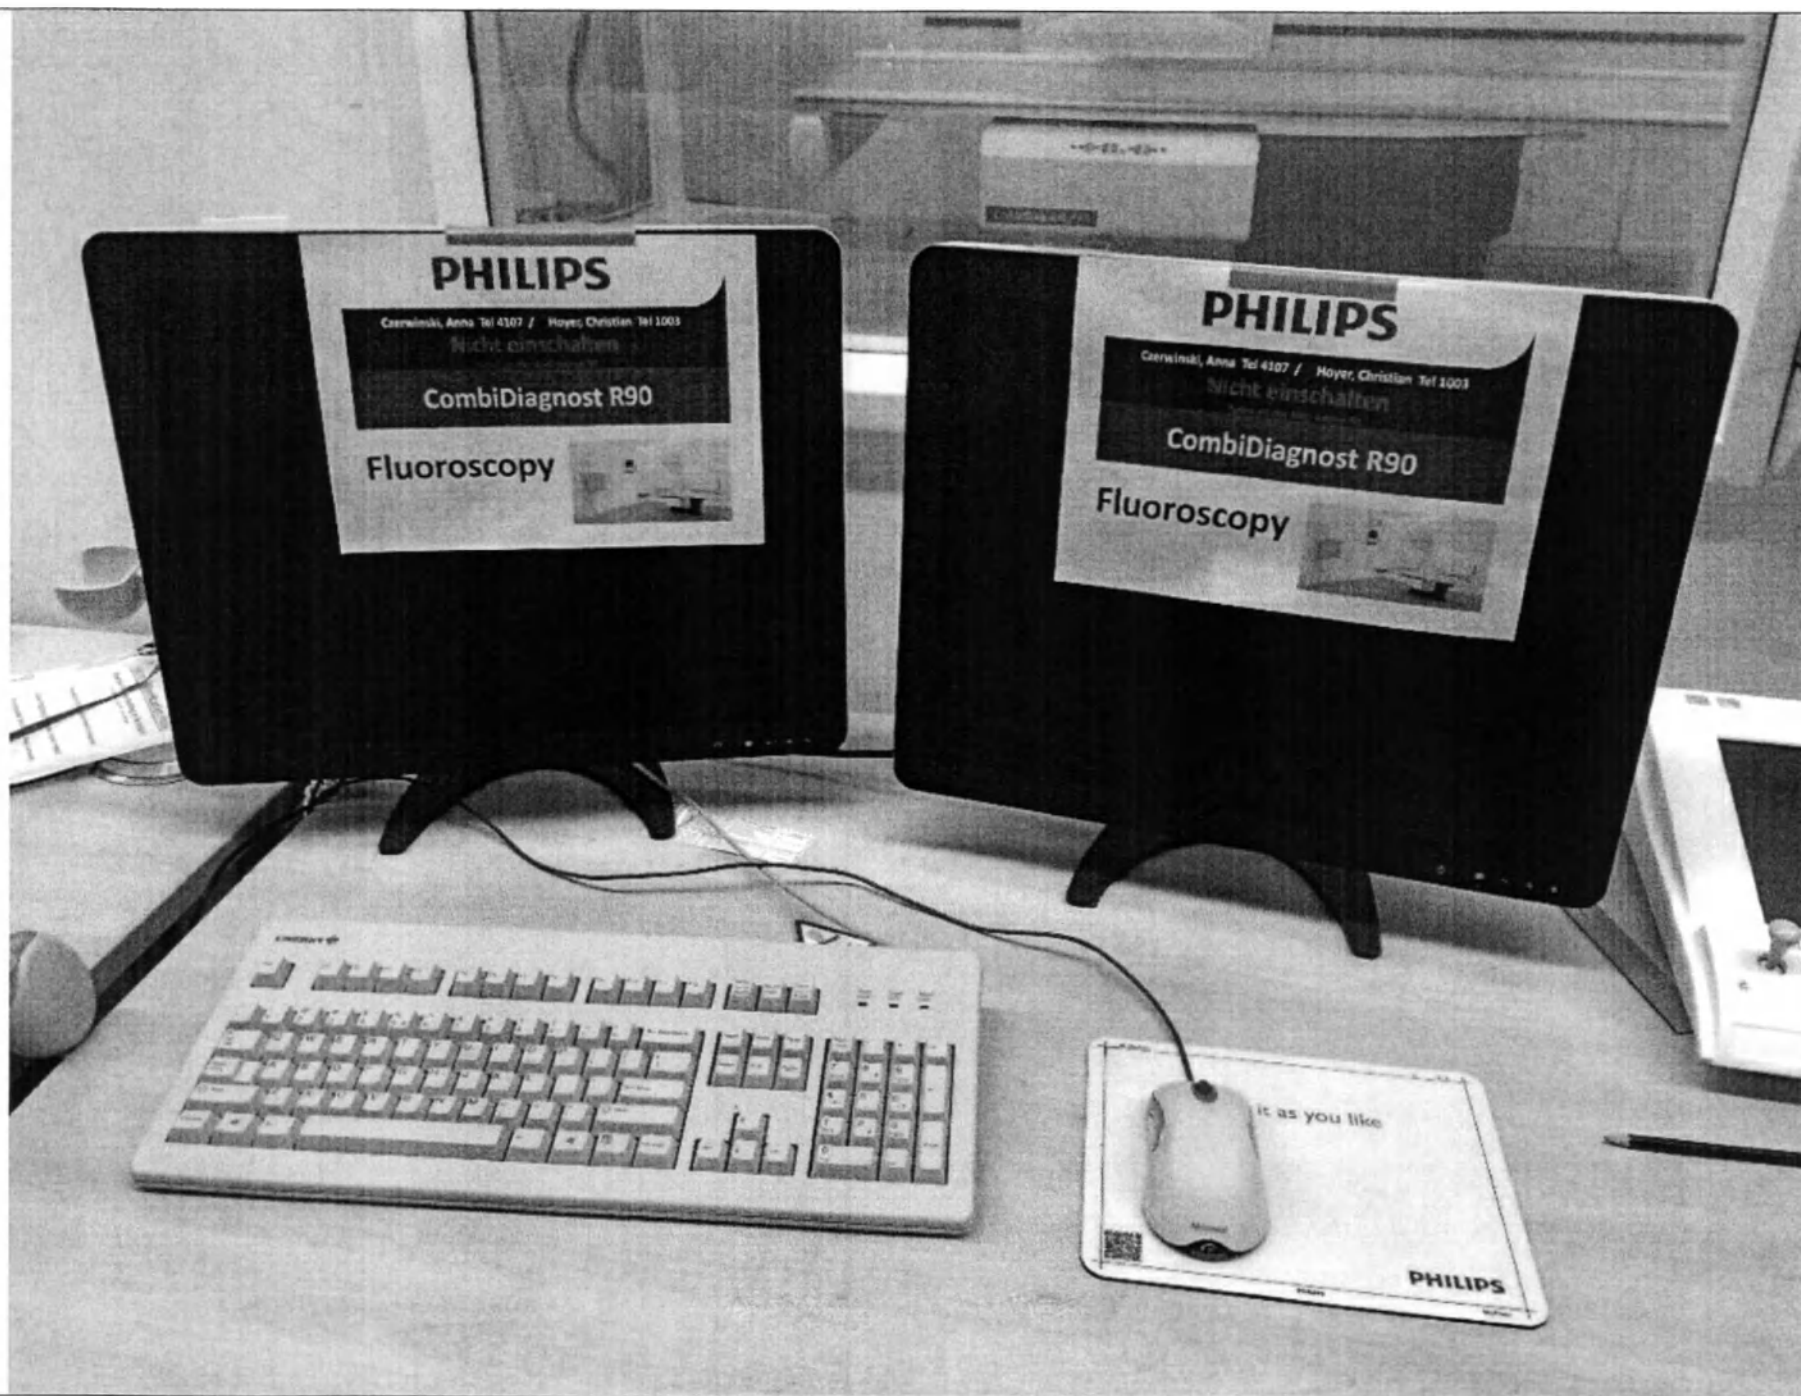


2.6 PC – монитор (справа).

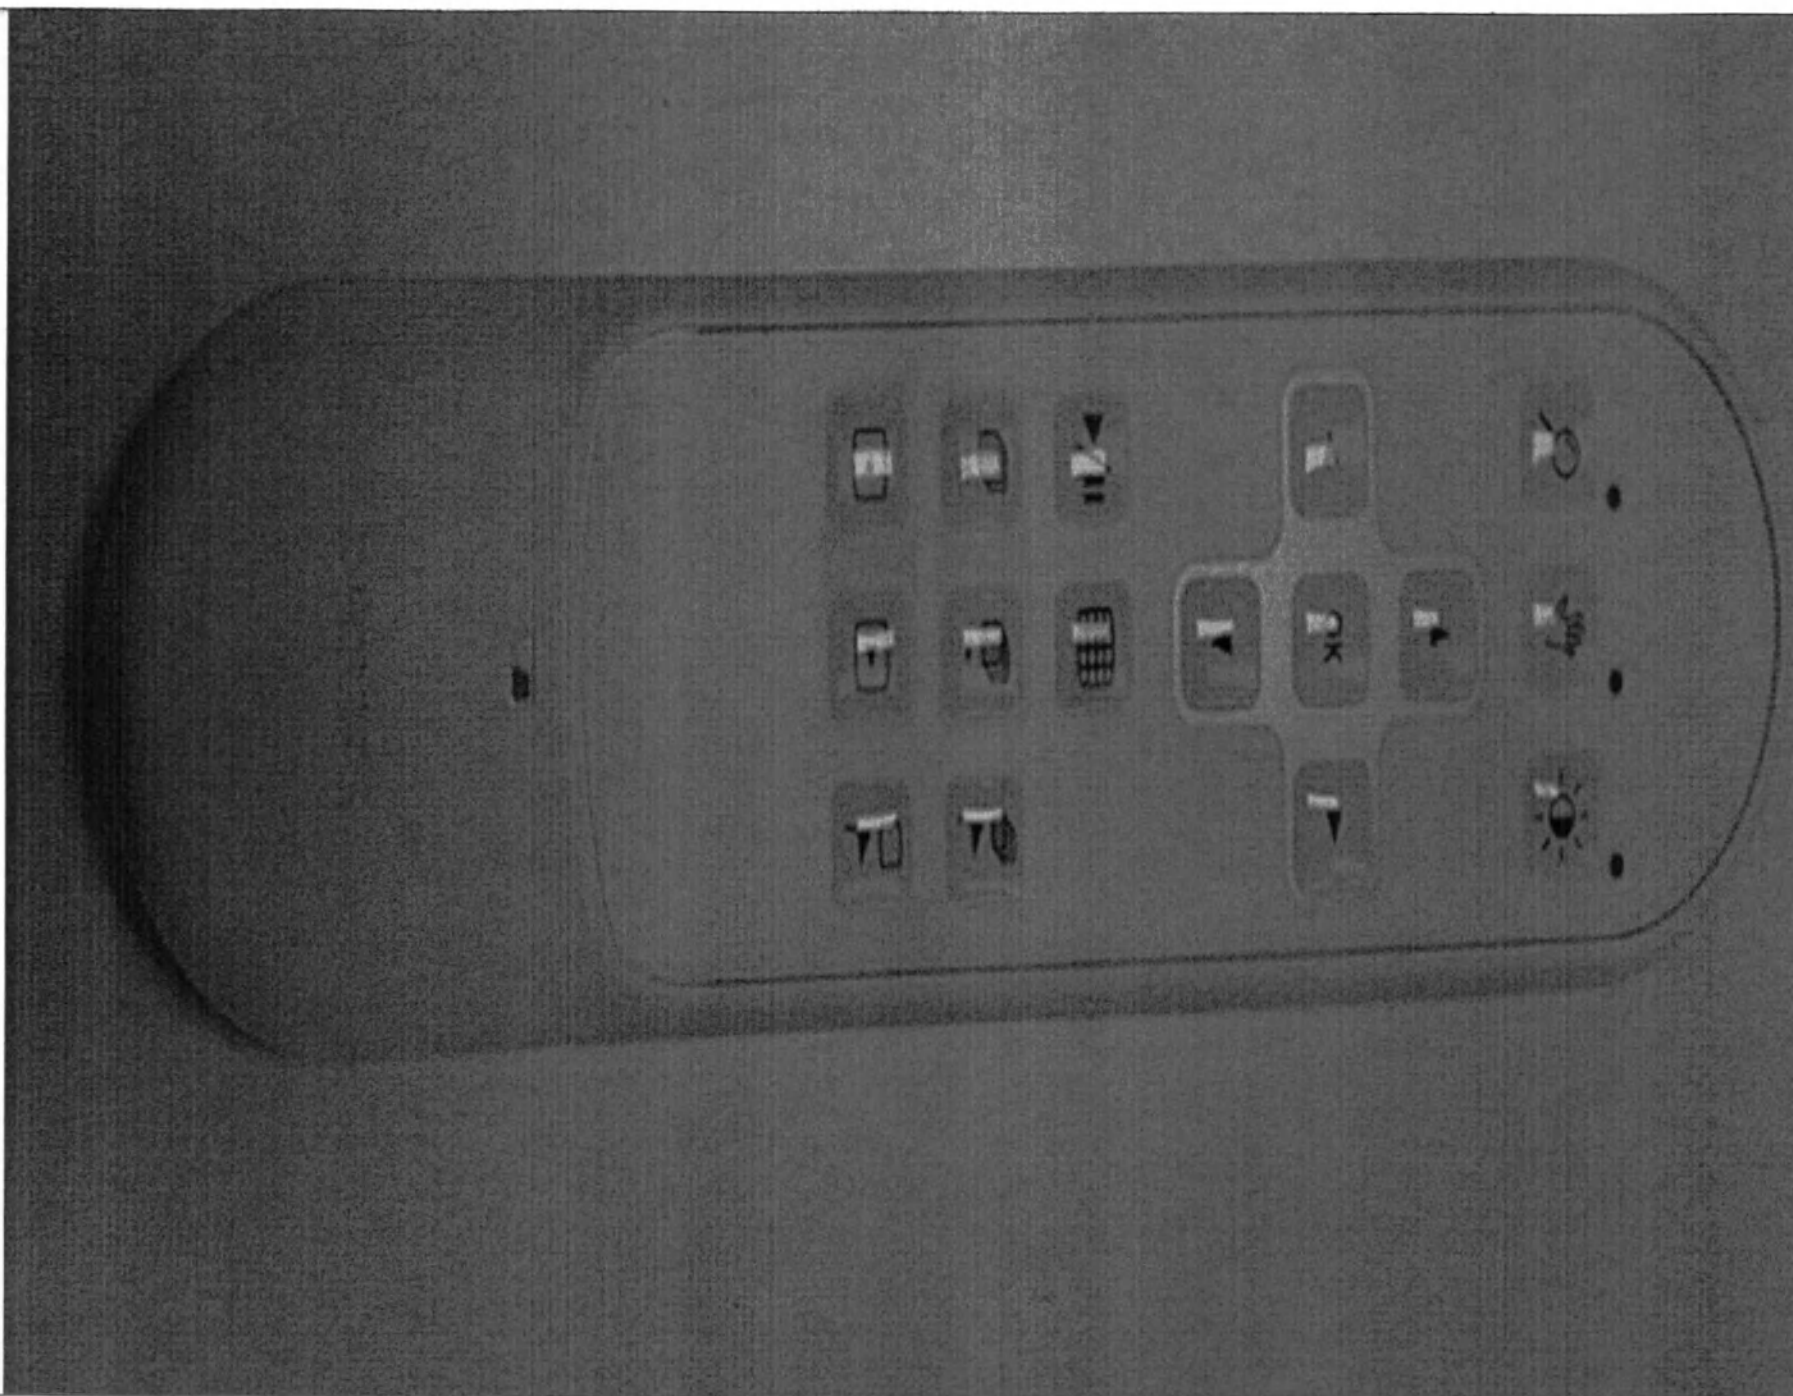


2.7 Пульт дистанционного управления для средства просмотра ВЧ-изображений




3. Рентгеновский генератор Velara 65 кВт или Velara 80 кВт.

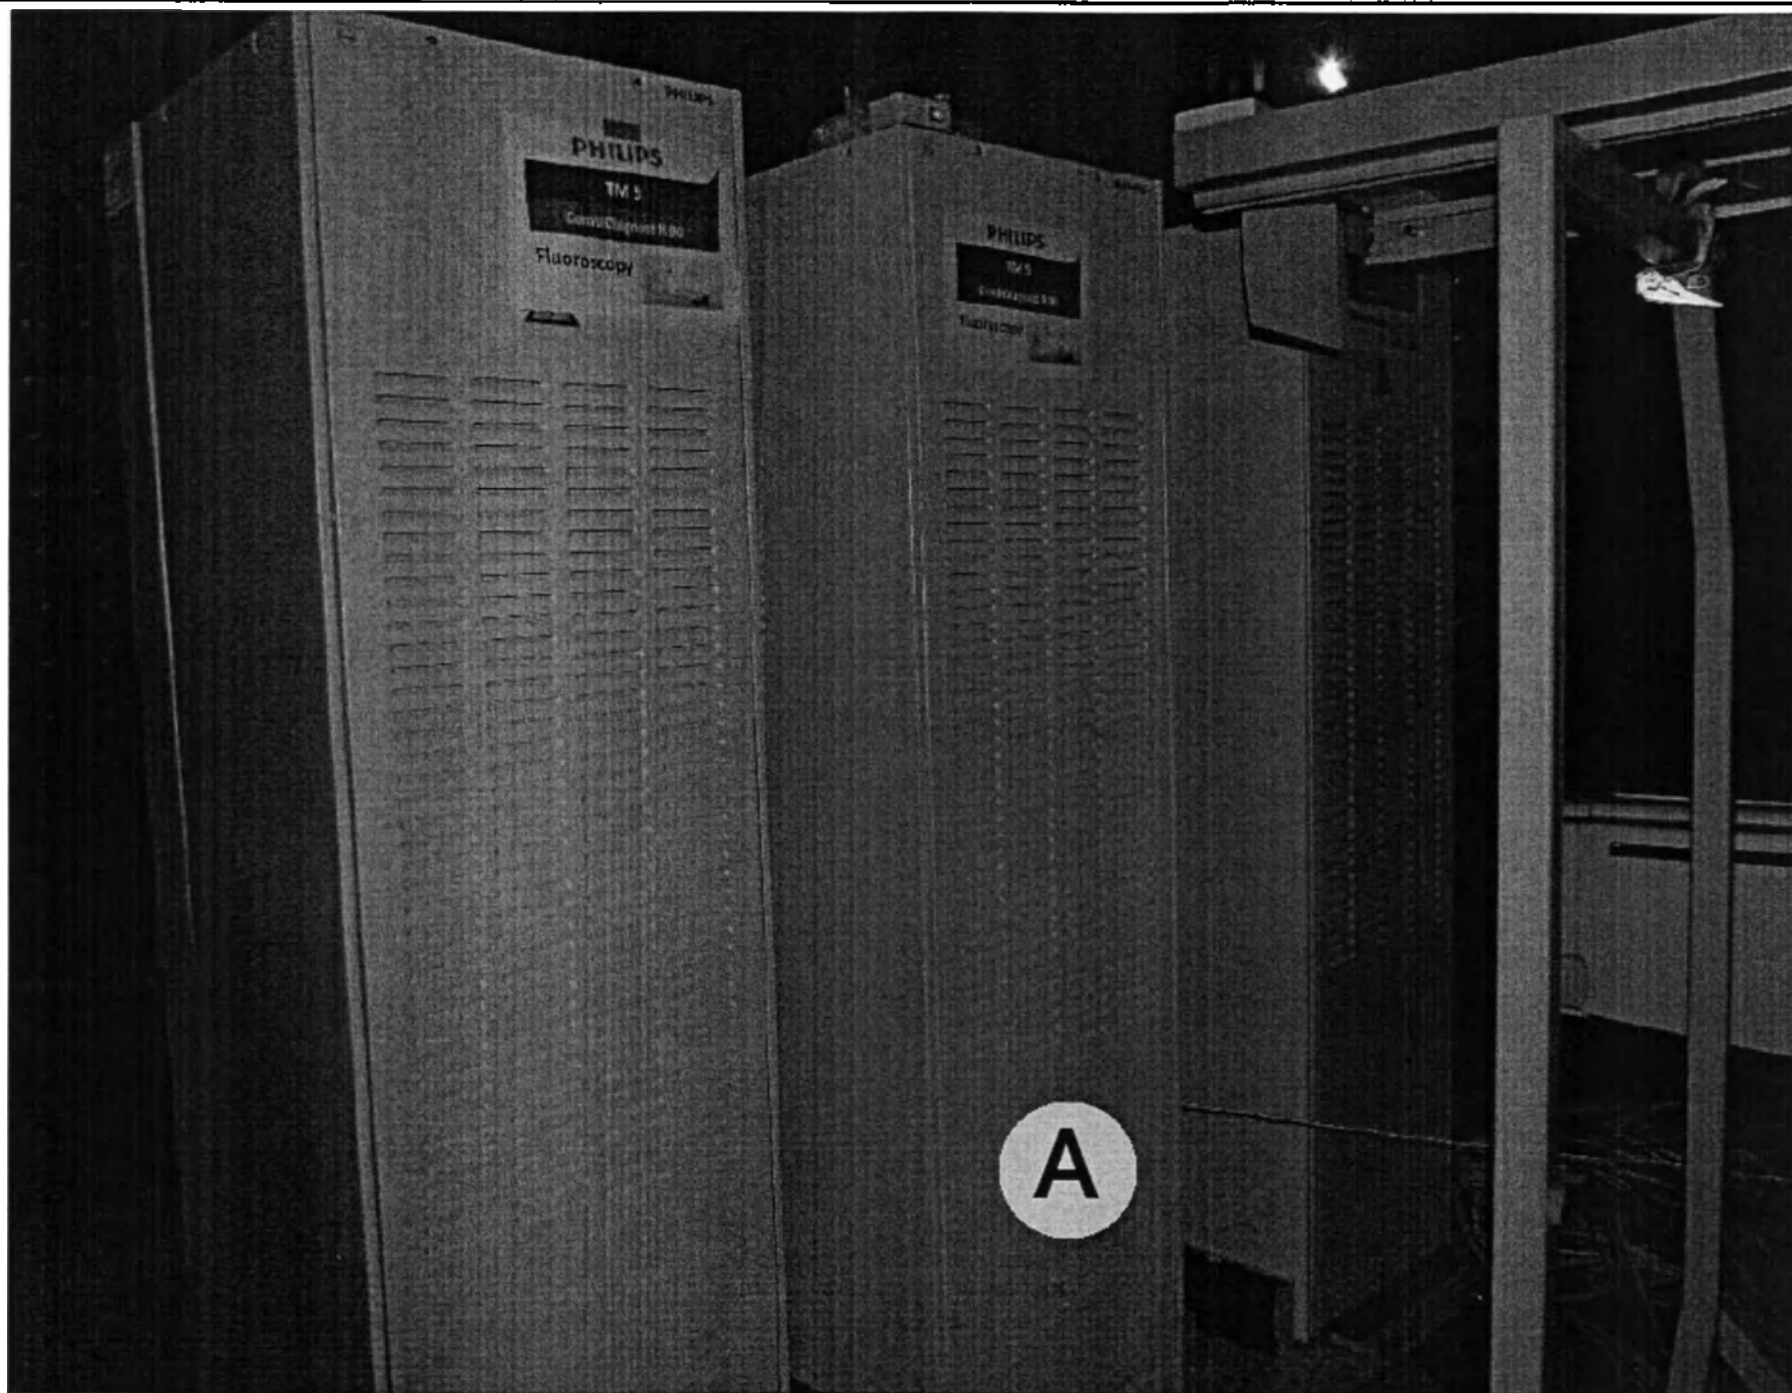


4. Модуль управления генератором M-Cabinet.

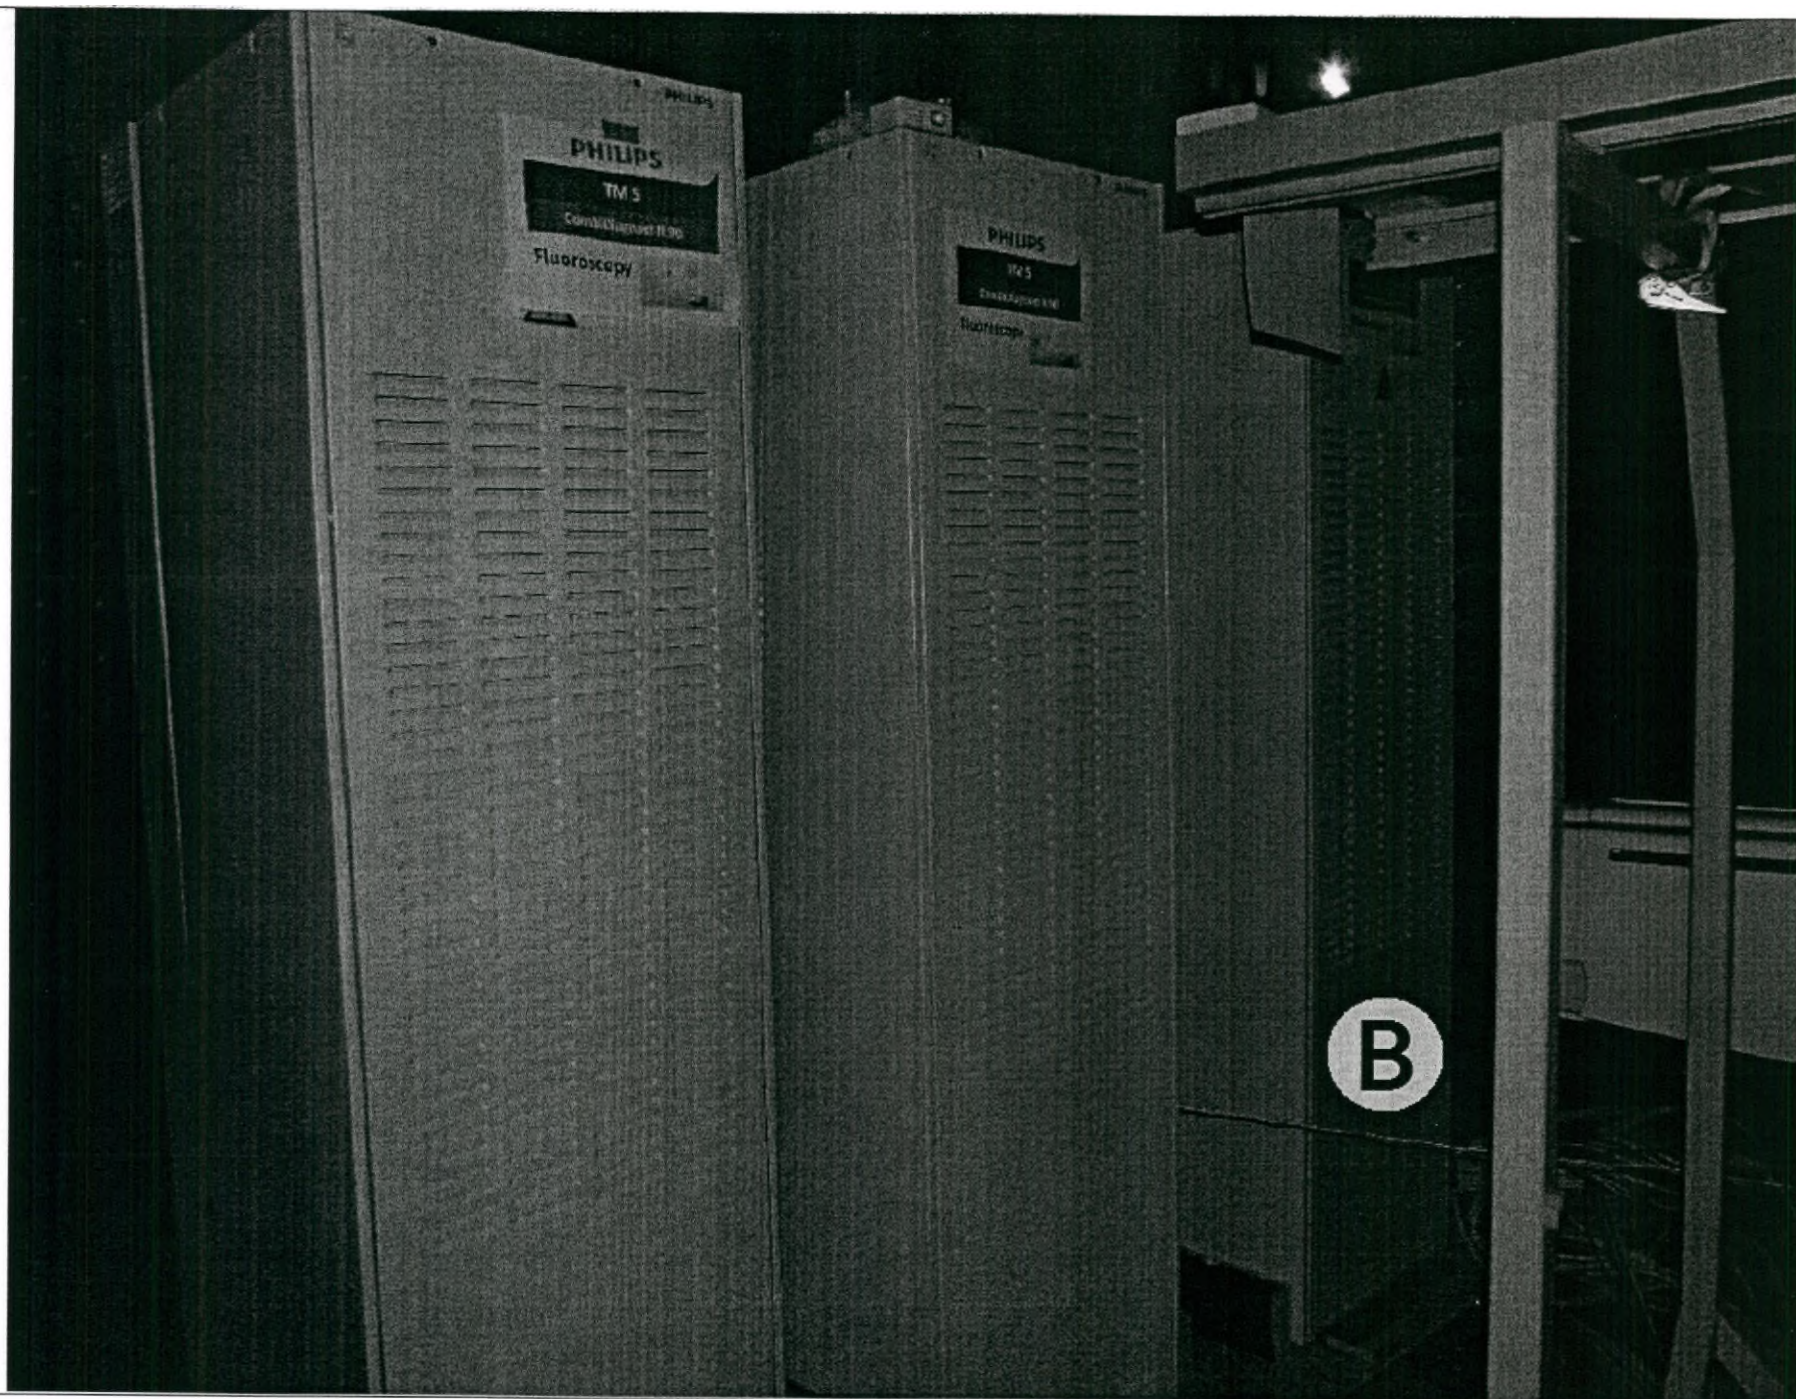


5. Модуль управления генератором R-Cabinet.

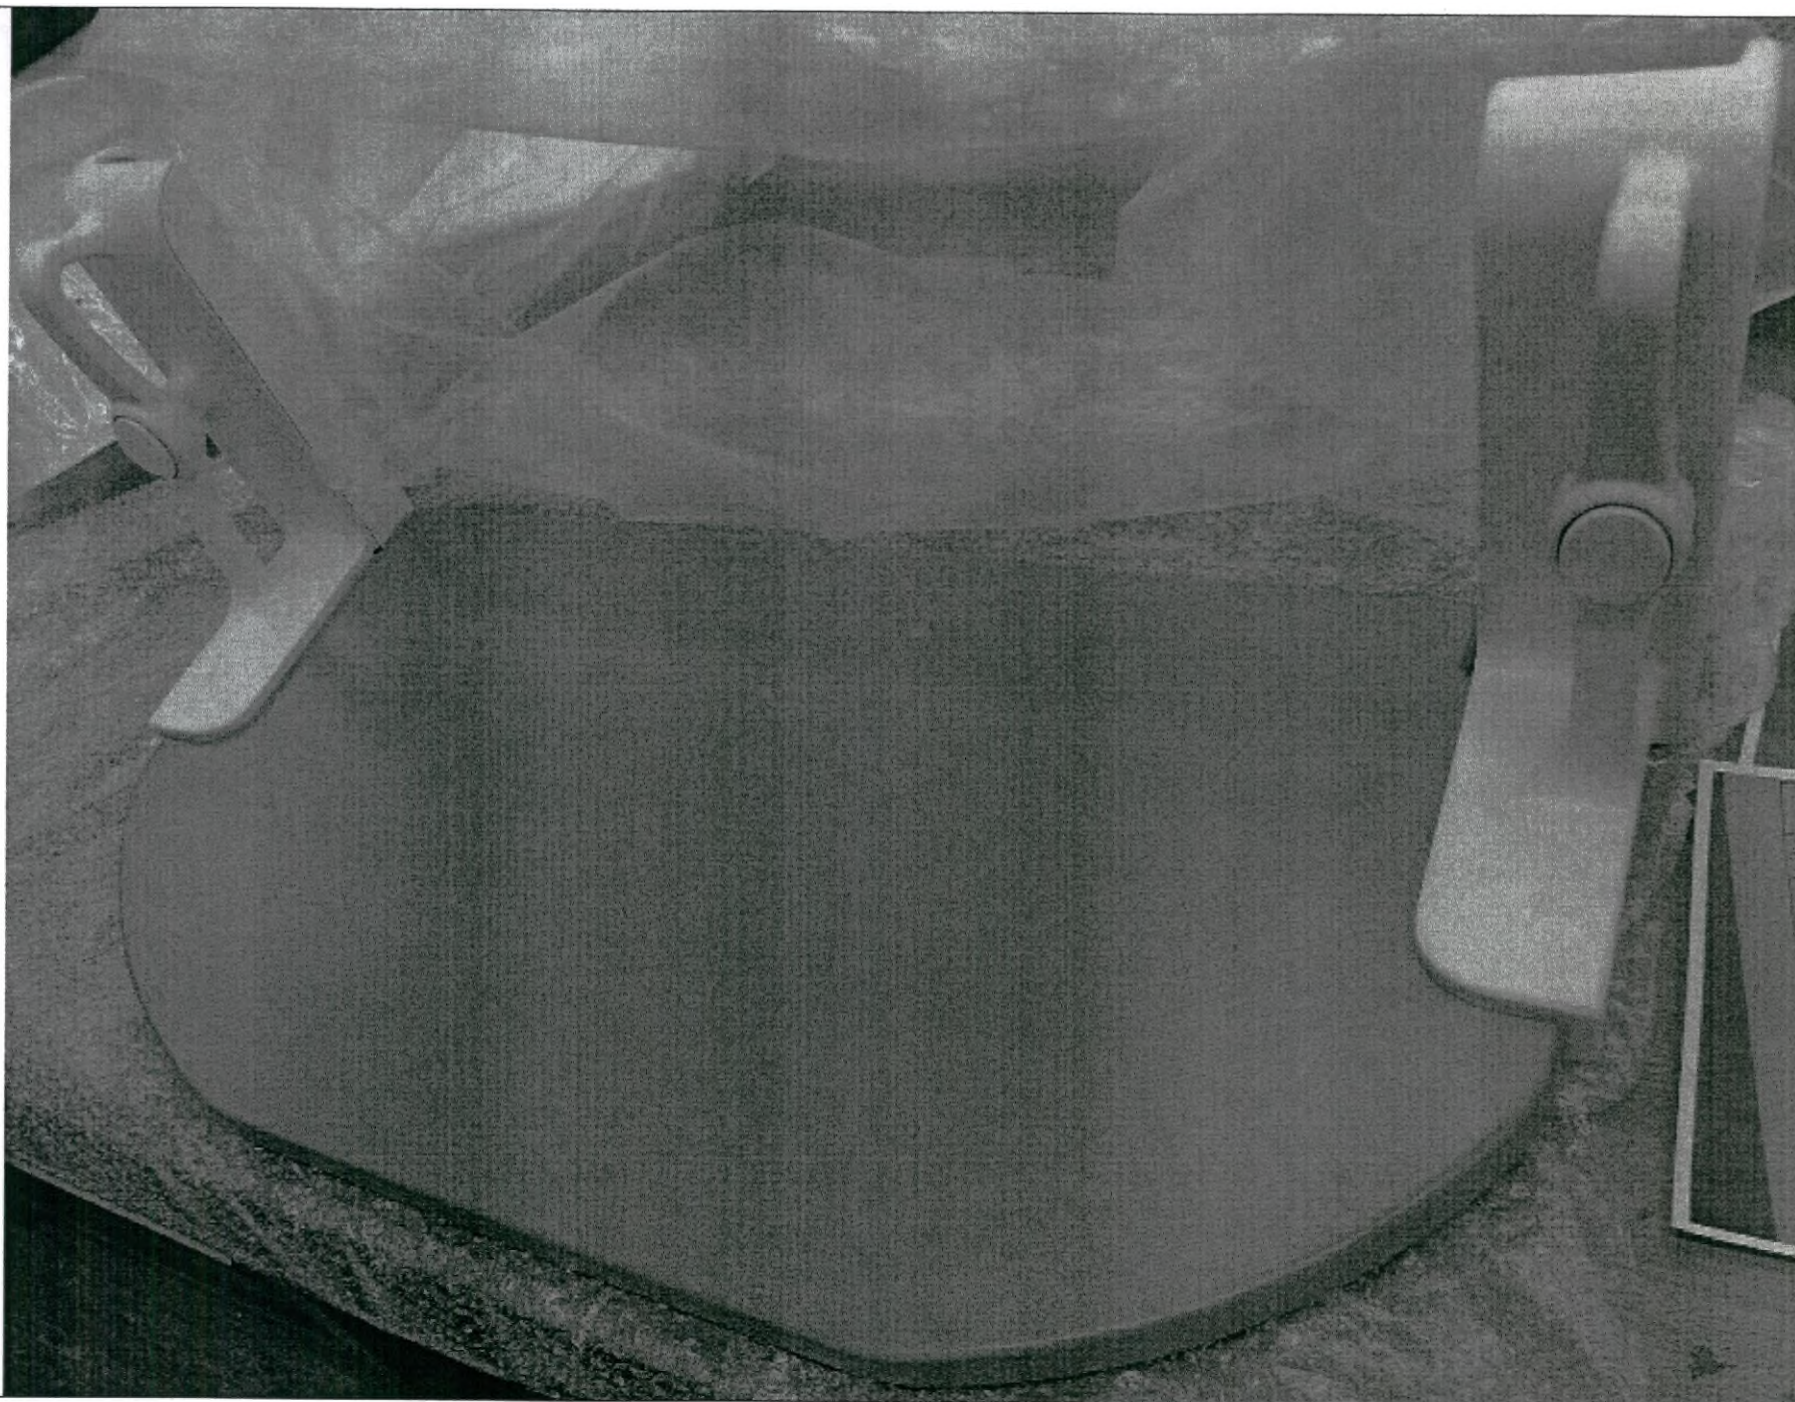


6. Подставка для ног.

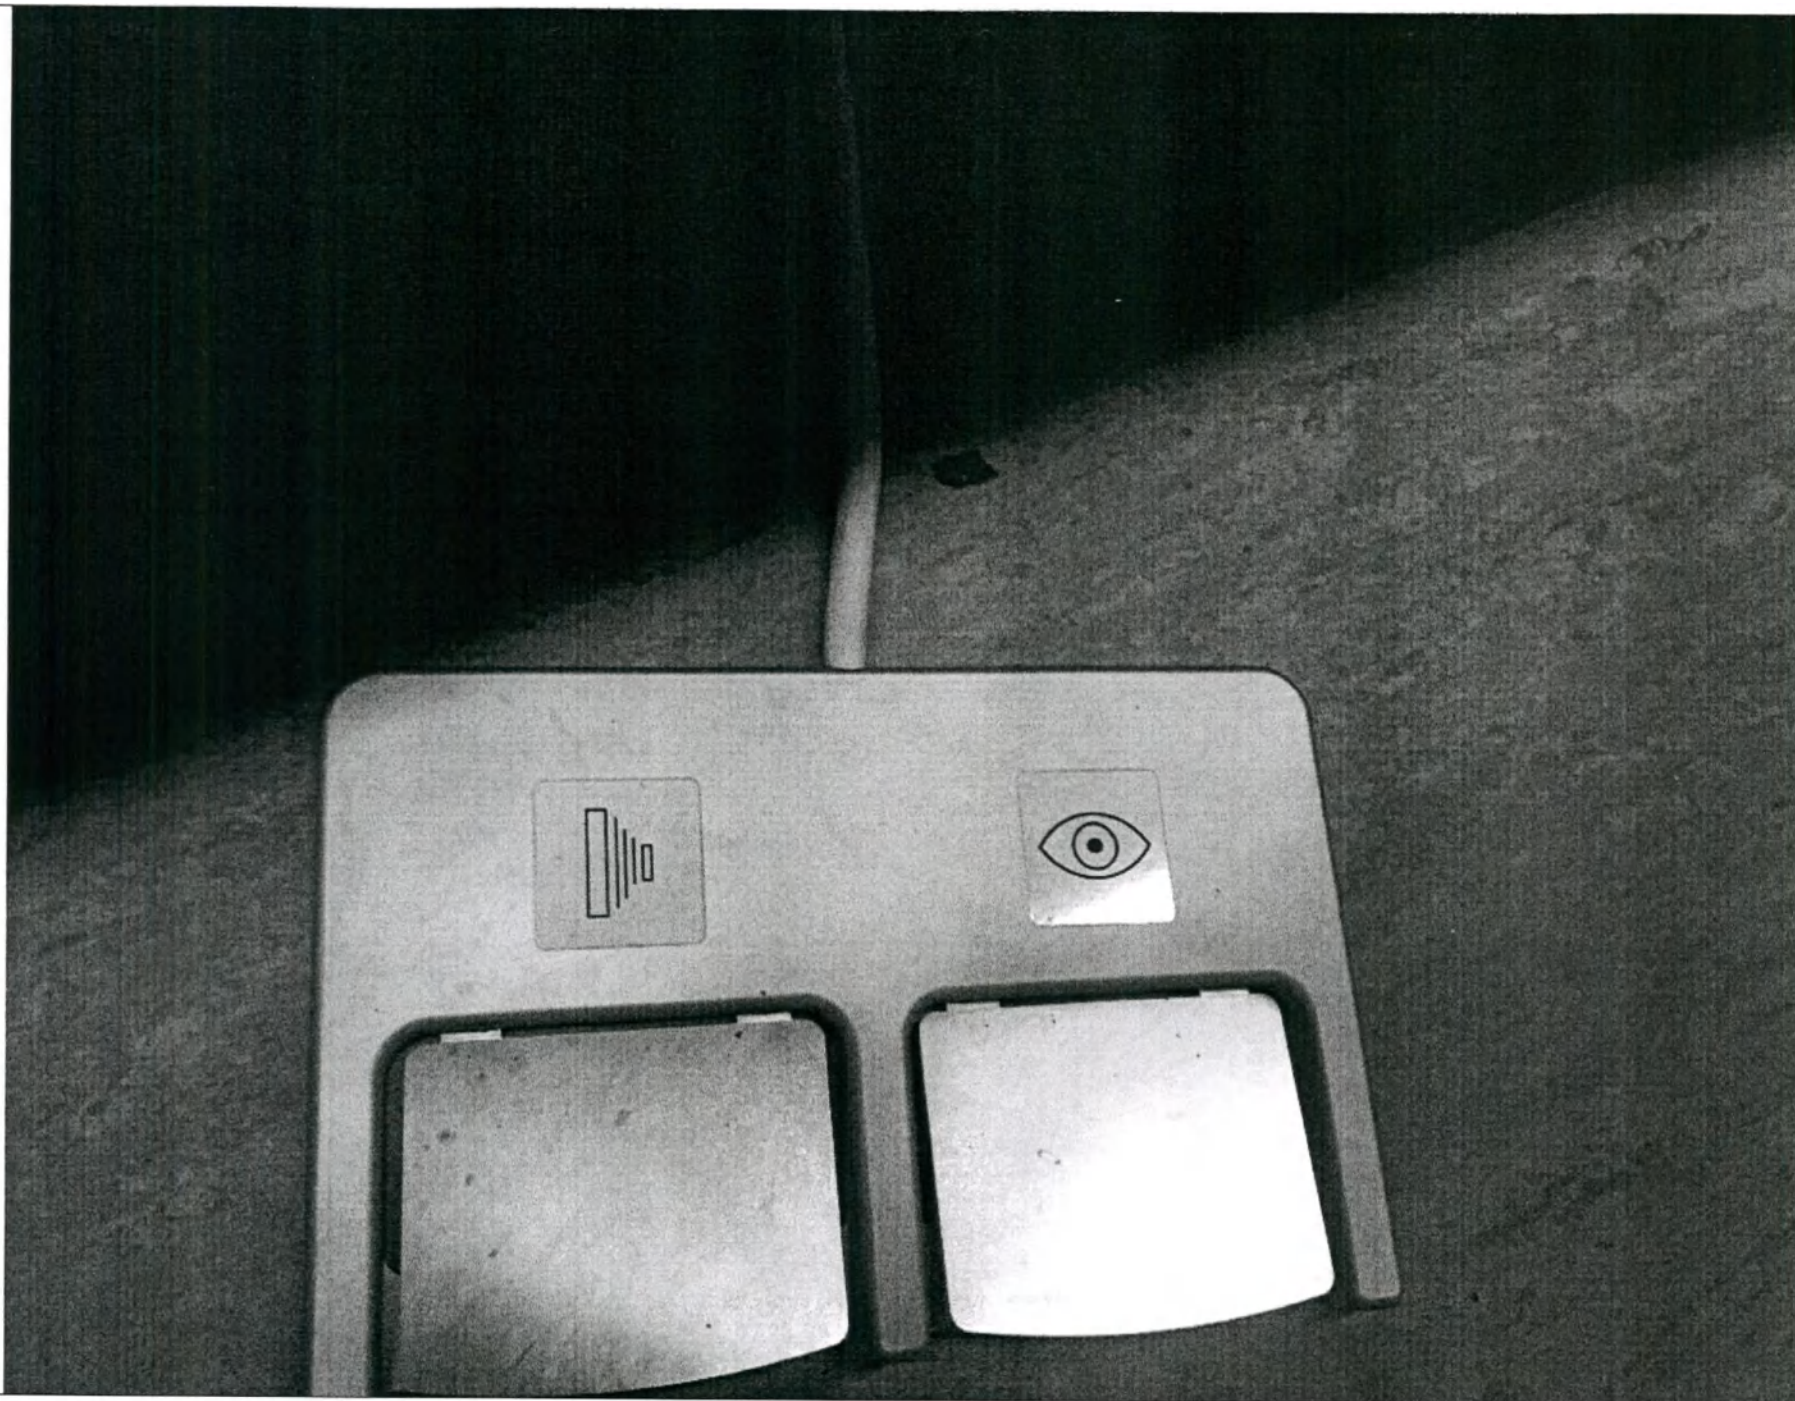


7. Педаль.

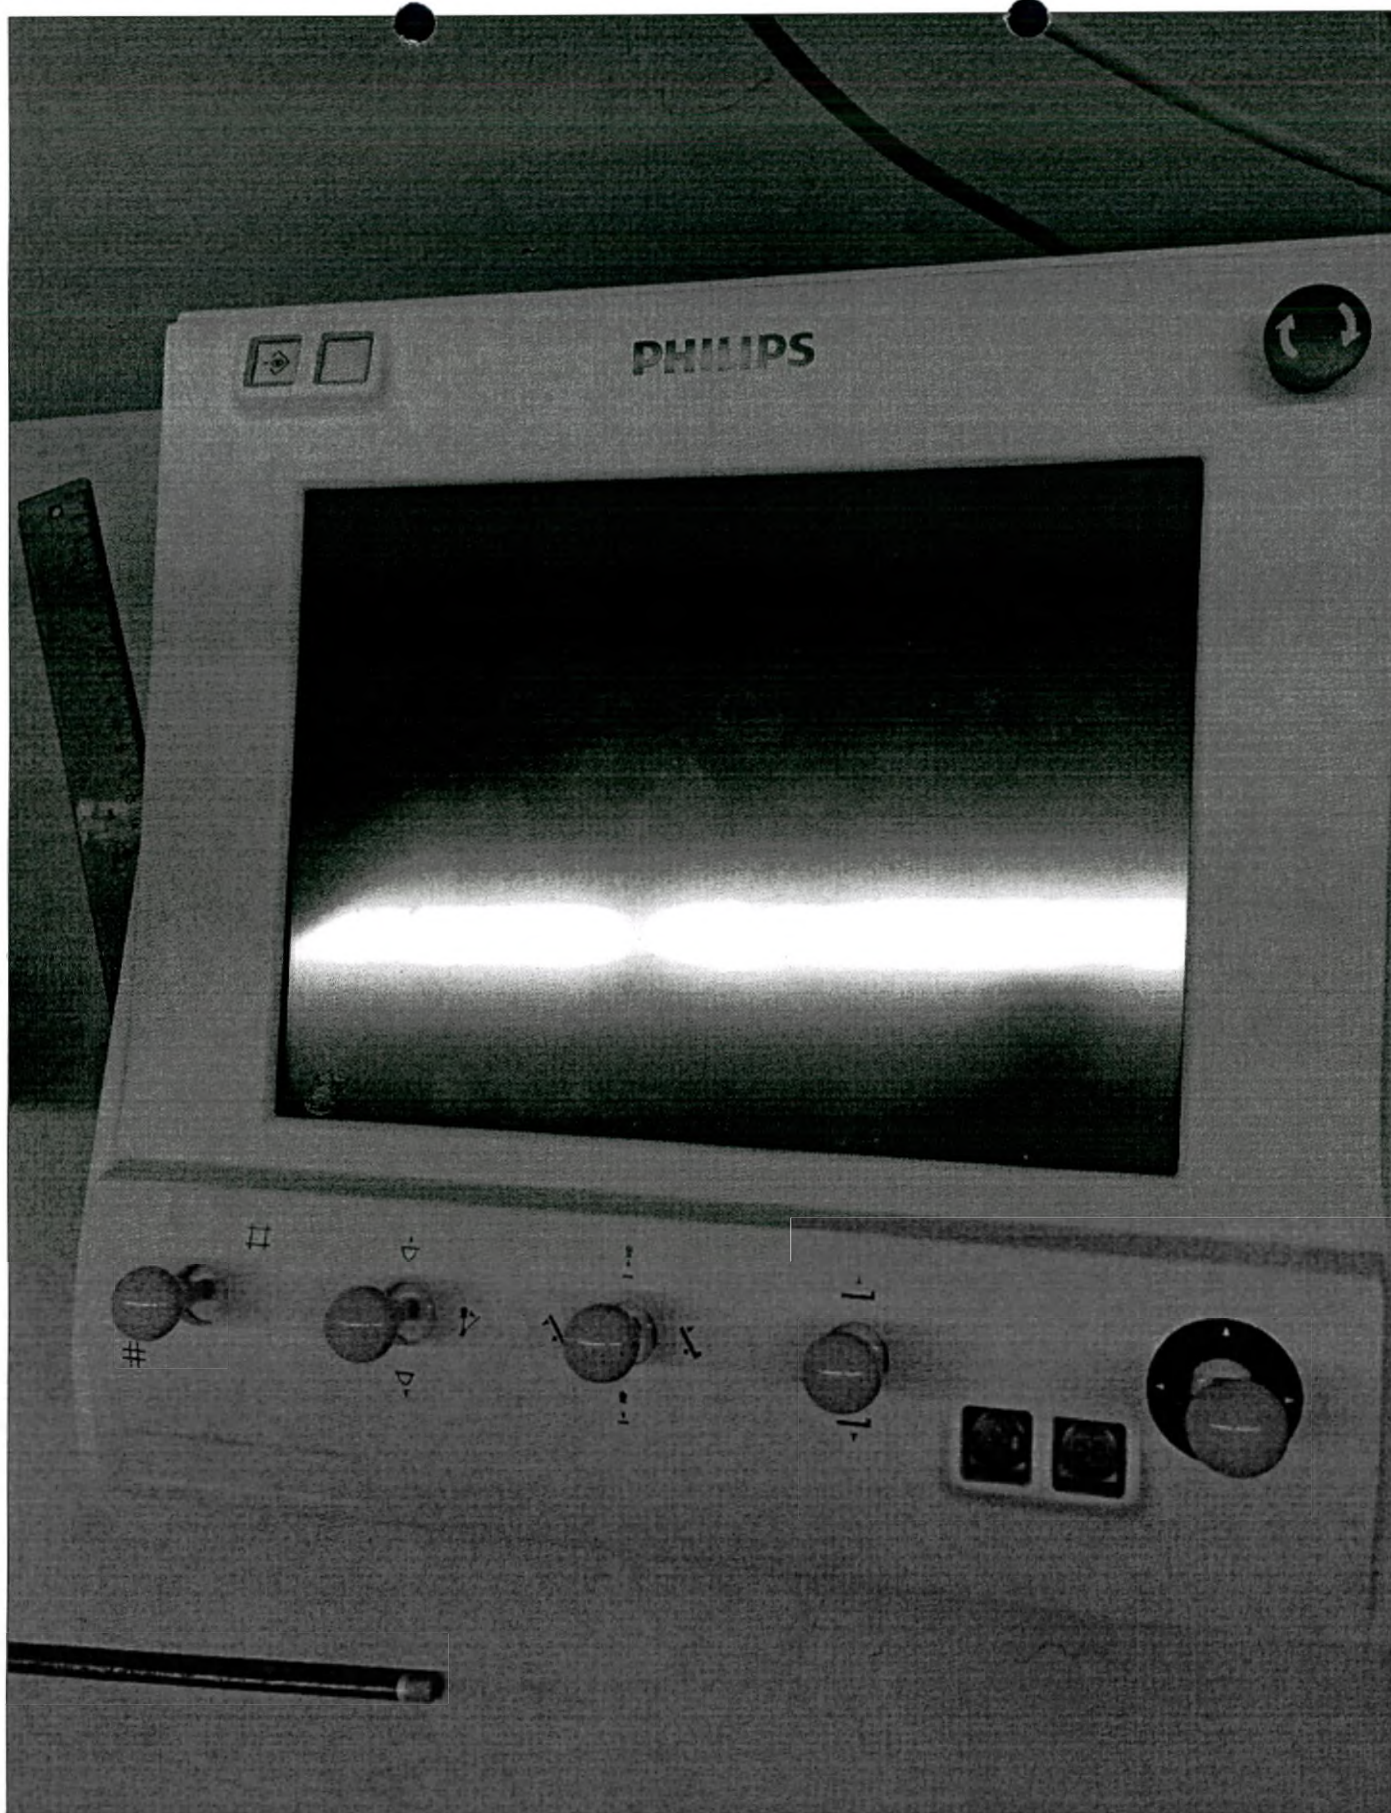

8. Пульт управления.

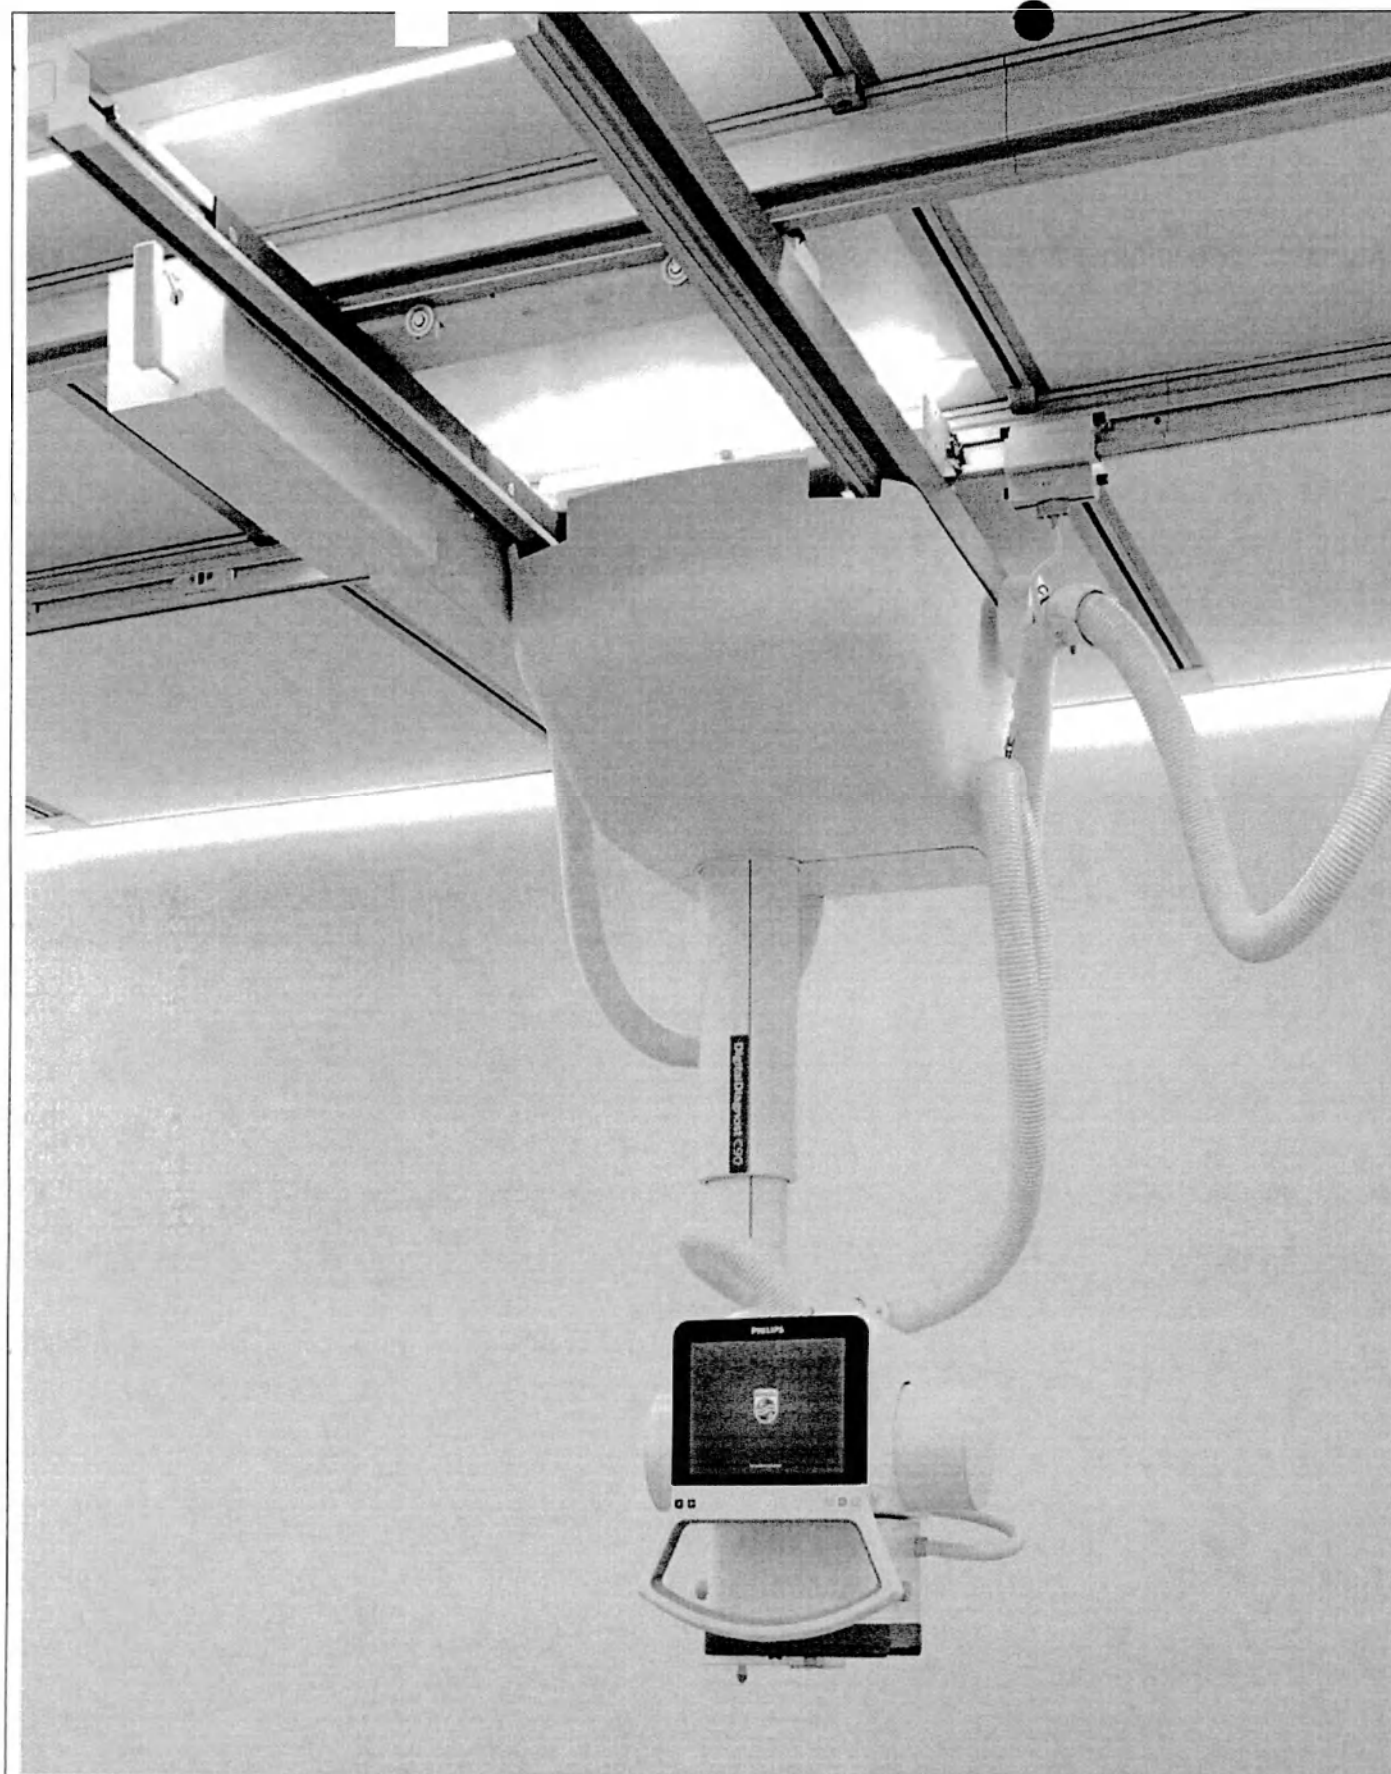


9. Потолочный подвес CSM3 (при необходимости), в составе: 9.1. Направляющие рельсы. 9.2. Блок потолочного подвеса с телескопической стойкой. 9.3. Блок рентгеновского излучателя SRO 33100 ROT380 (для CSM). 9.4. Коллиматор Ralco.

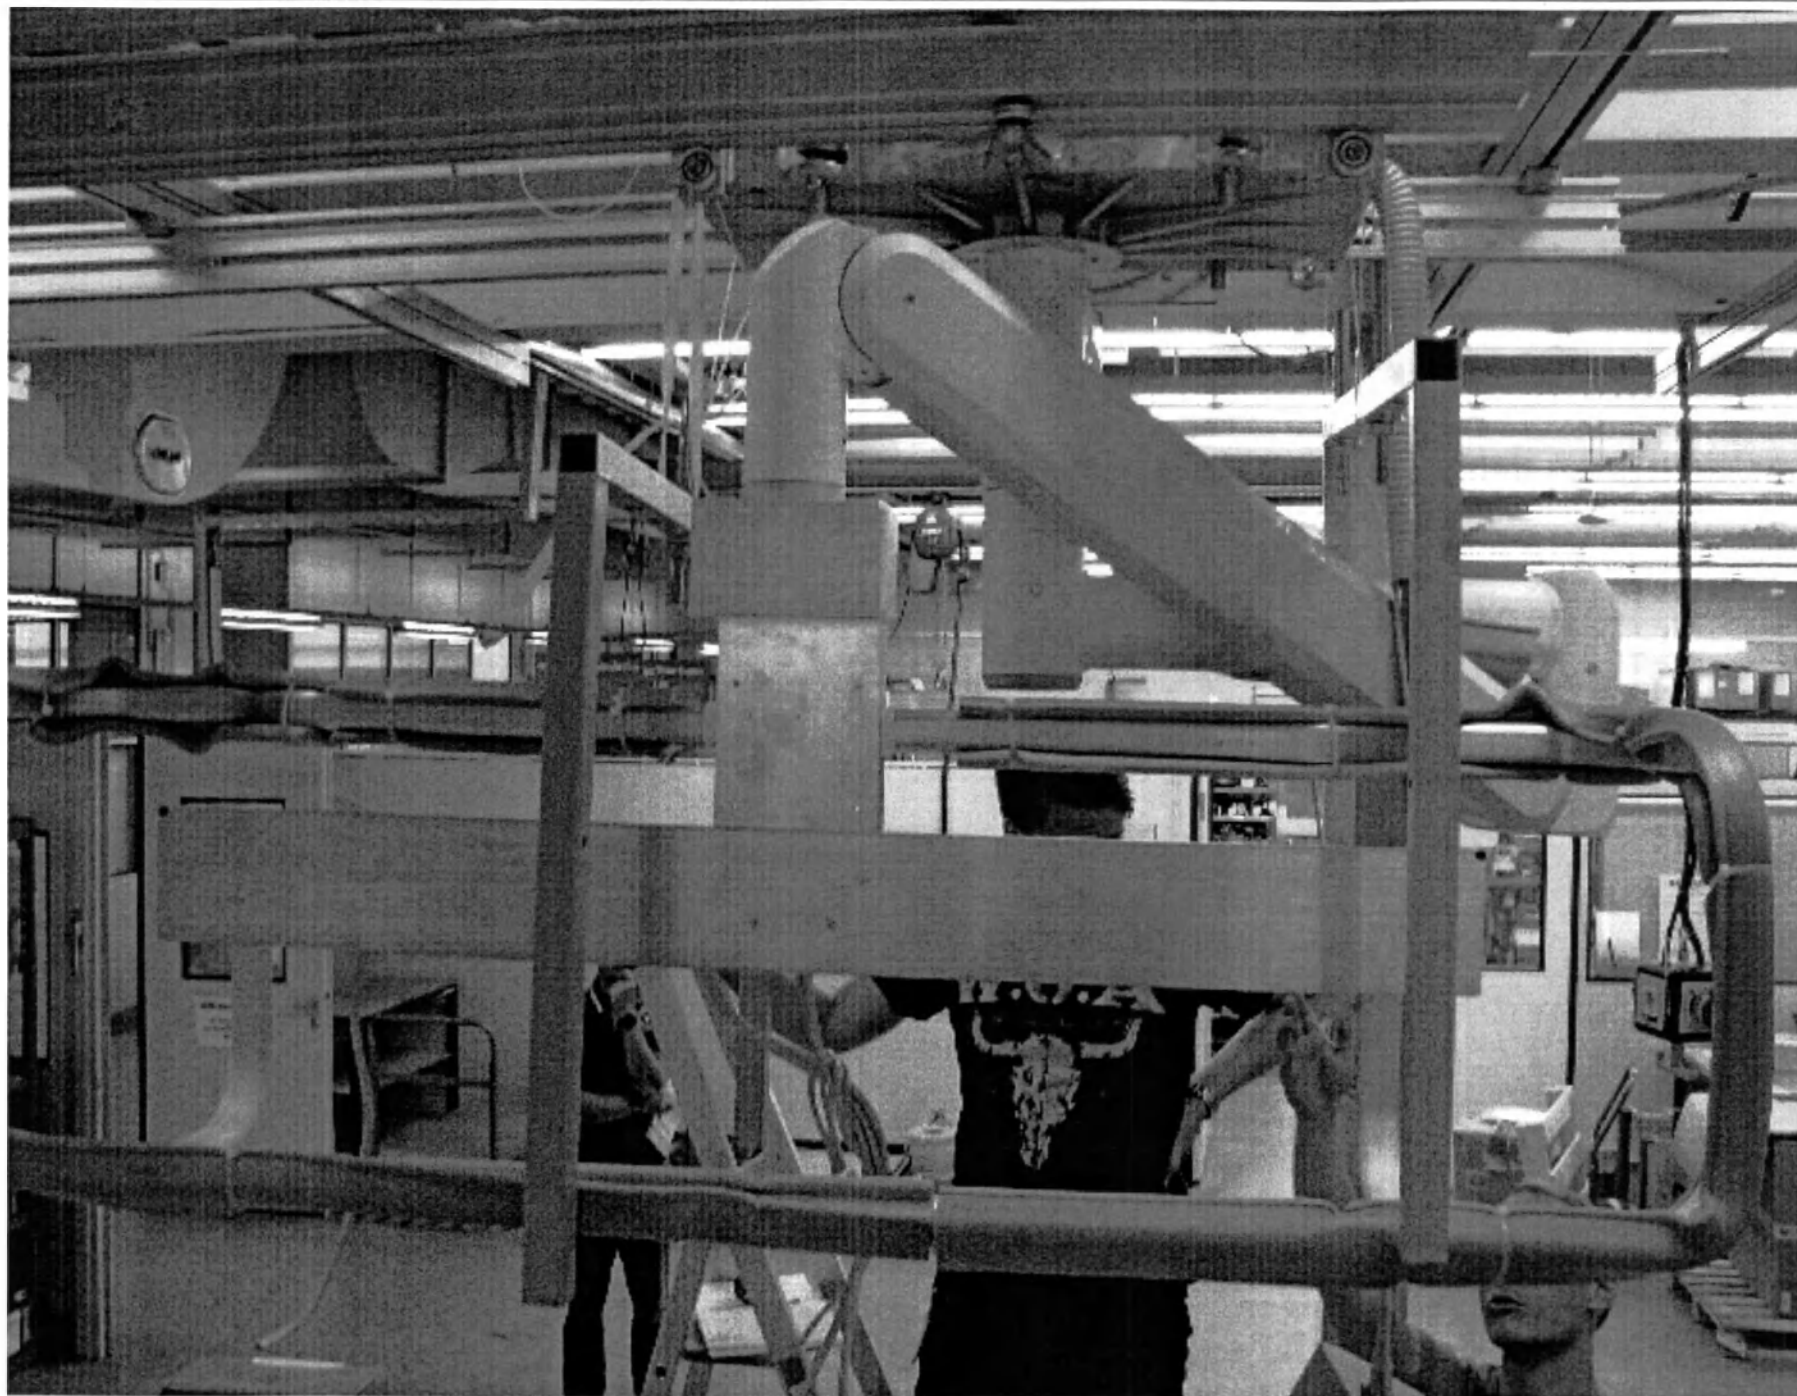


10. Потолочный подвес для мониторов (при необходимости) в вариантах исполнения: для одного, для двух или трех мониторов.




11. Тележка для ближнего управления.

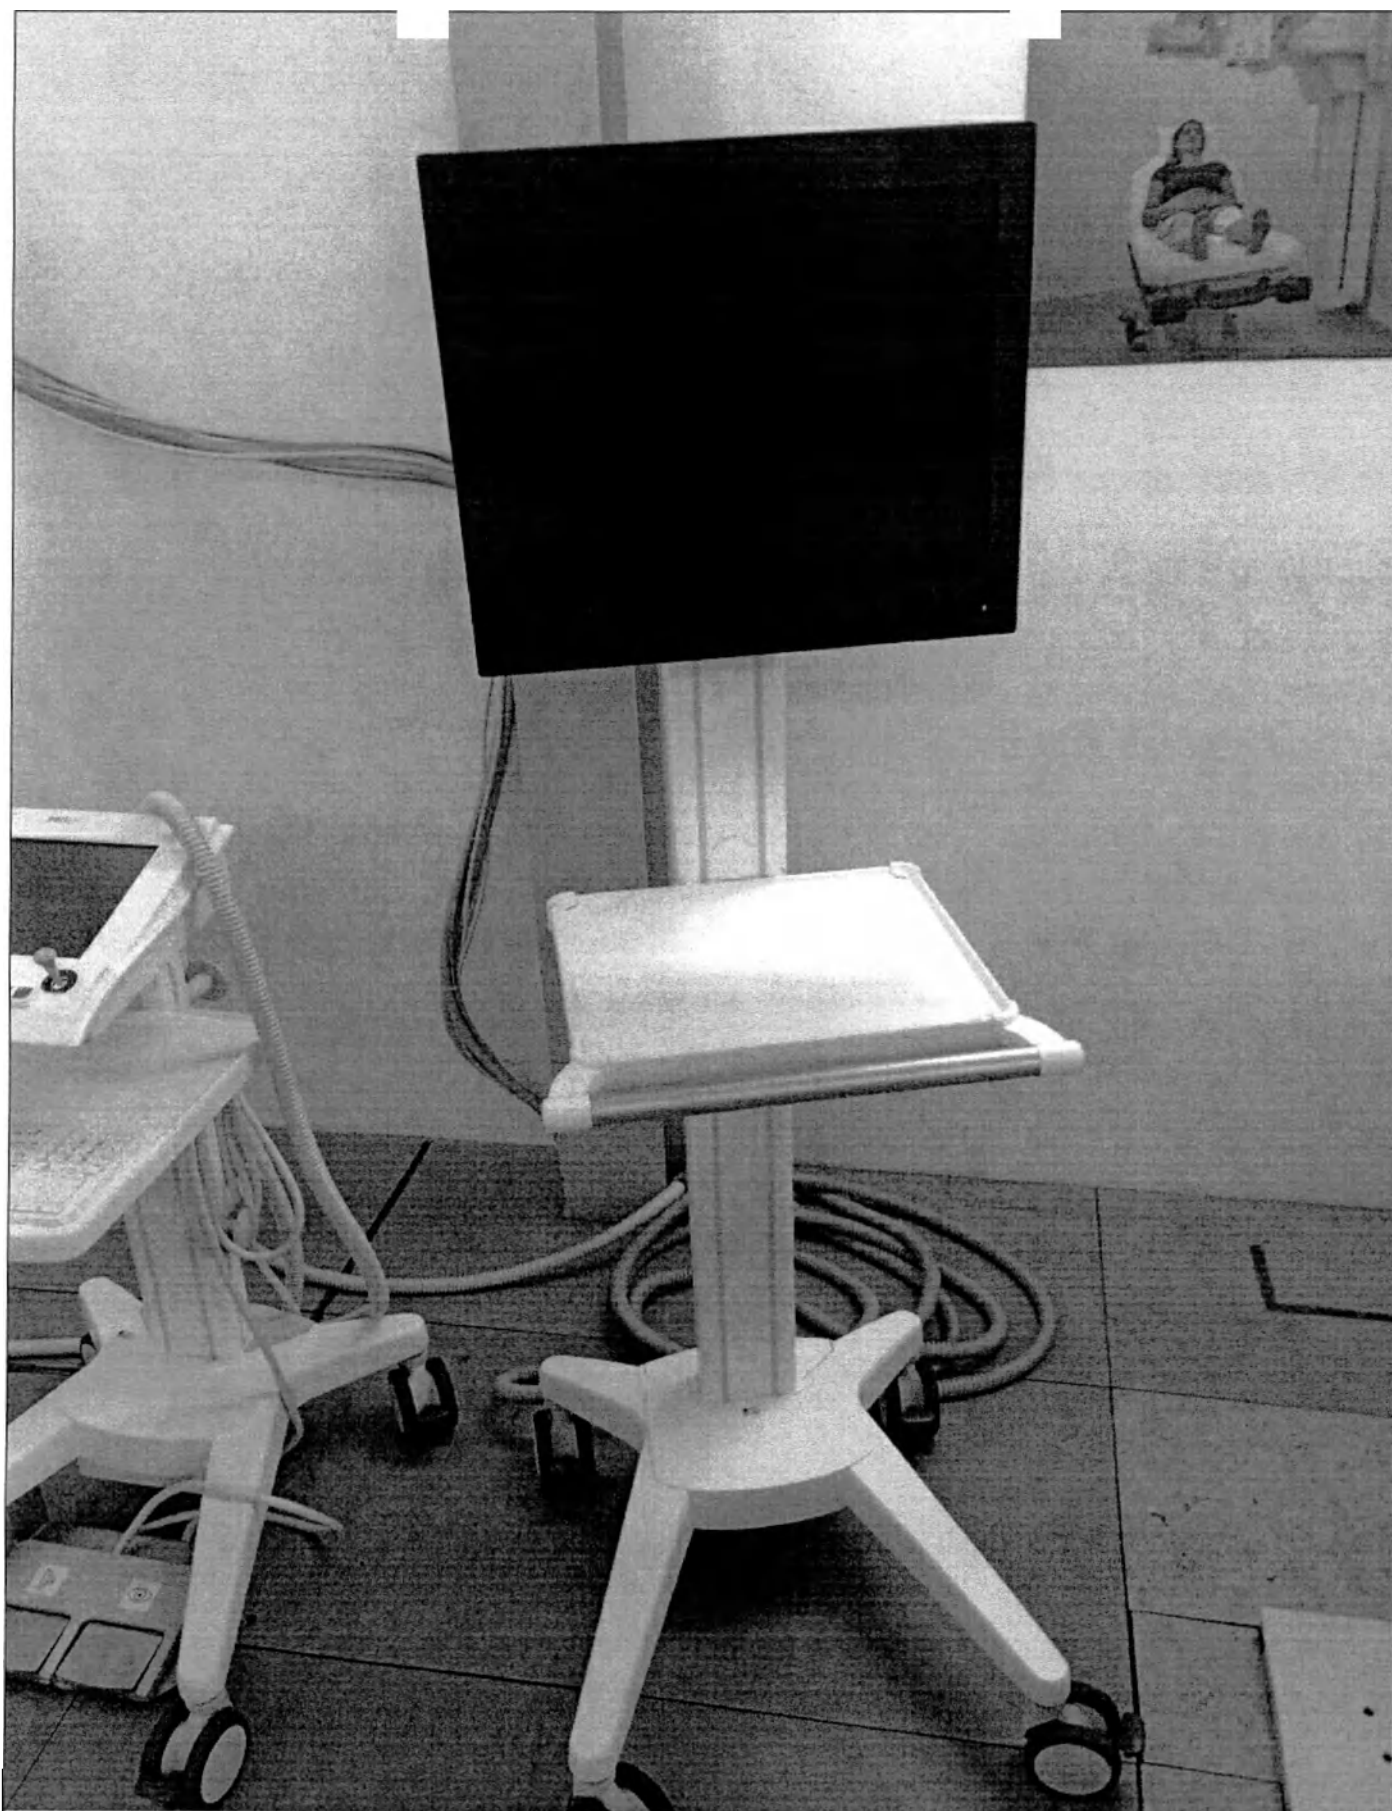


12. Тележка для монитора (при необходимости), в вариантах исполнения: для одного монитора или для двух мониторов.

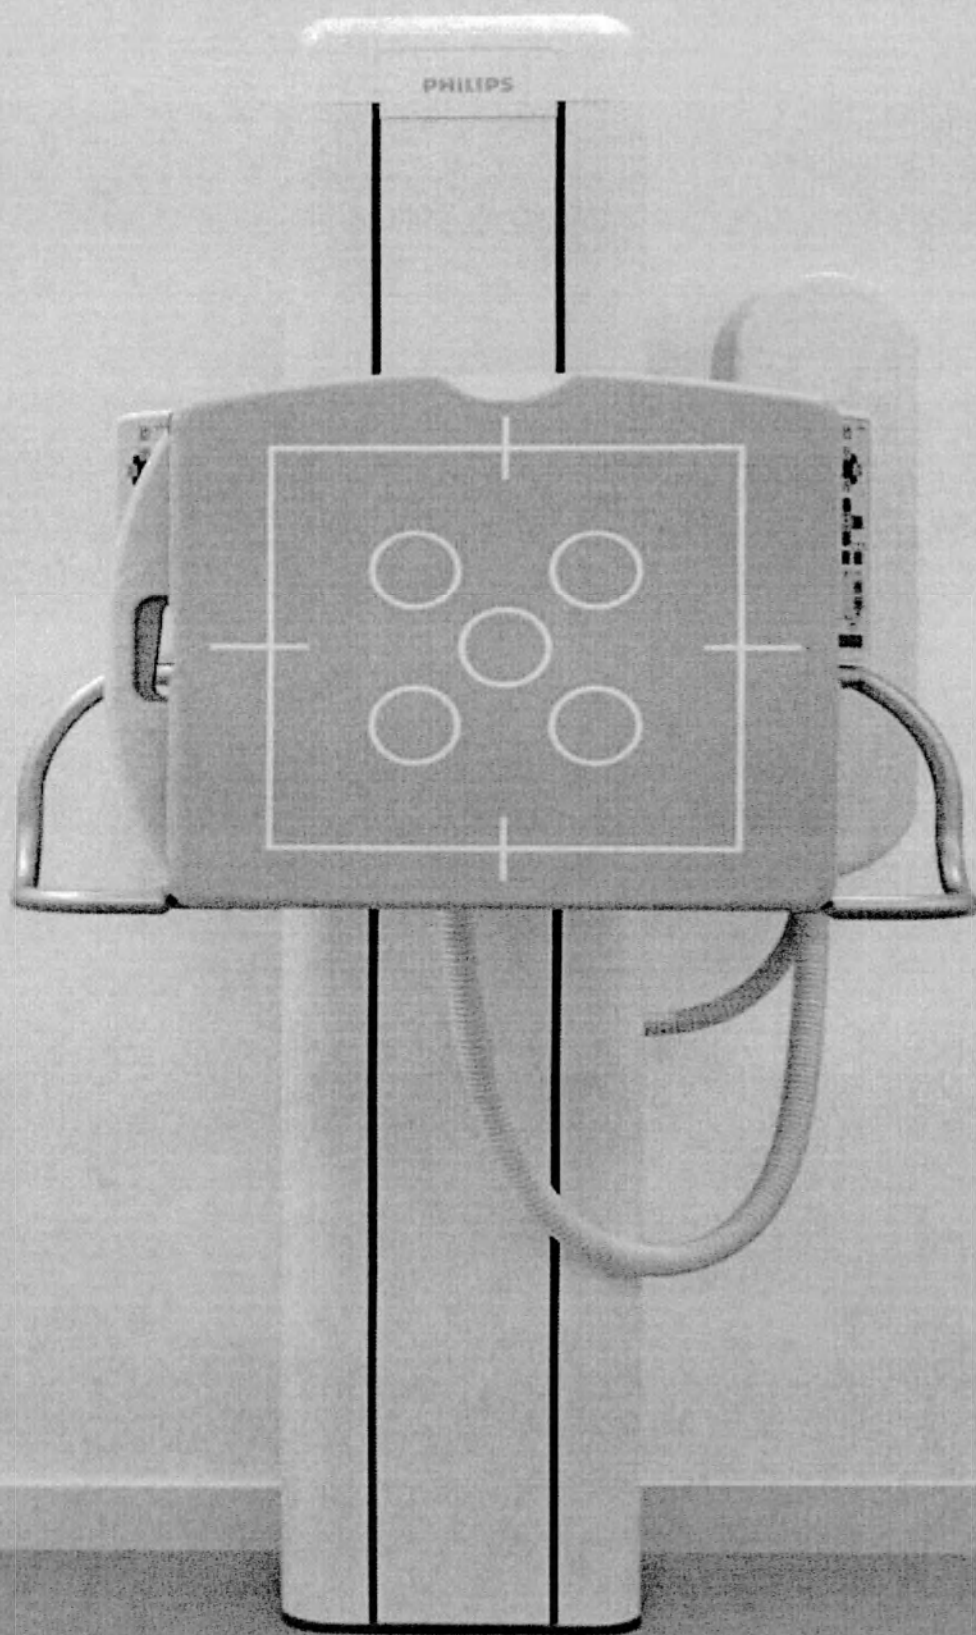


13. Вертикальная стойка VS (при необходимости) в вариантах исполнения: с фиксированным детектором или с лотком для беспроводного детектора.

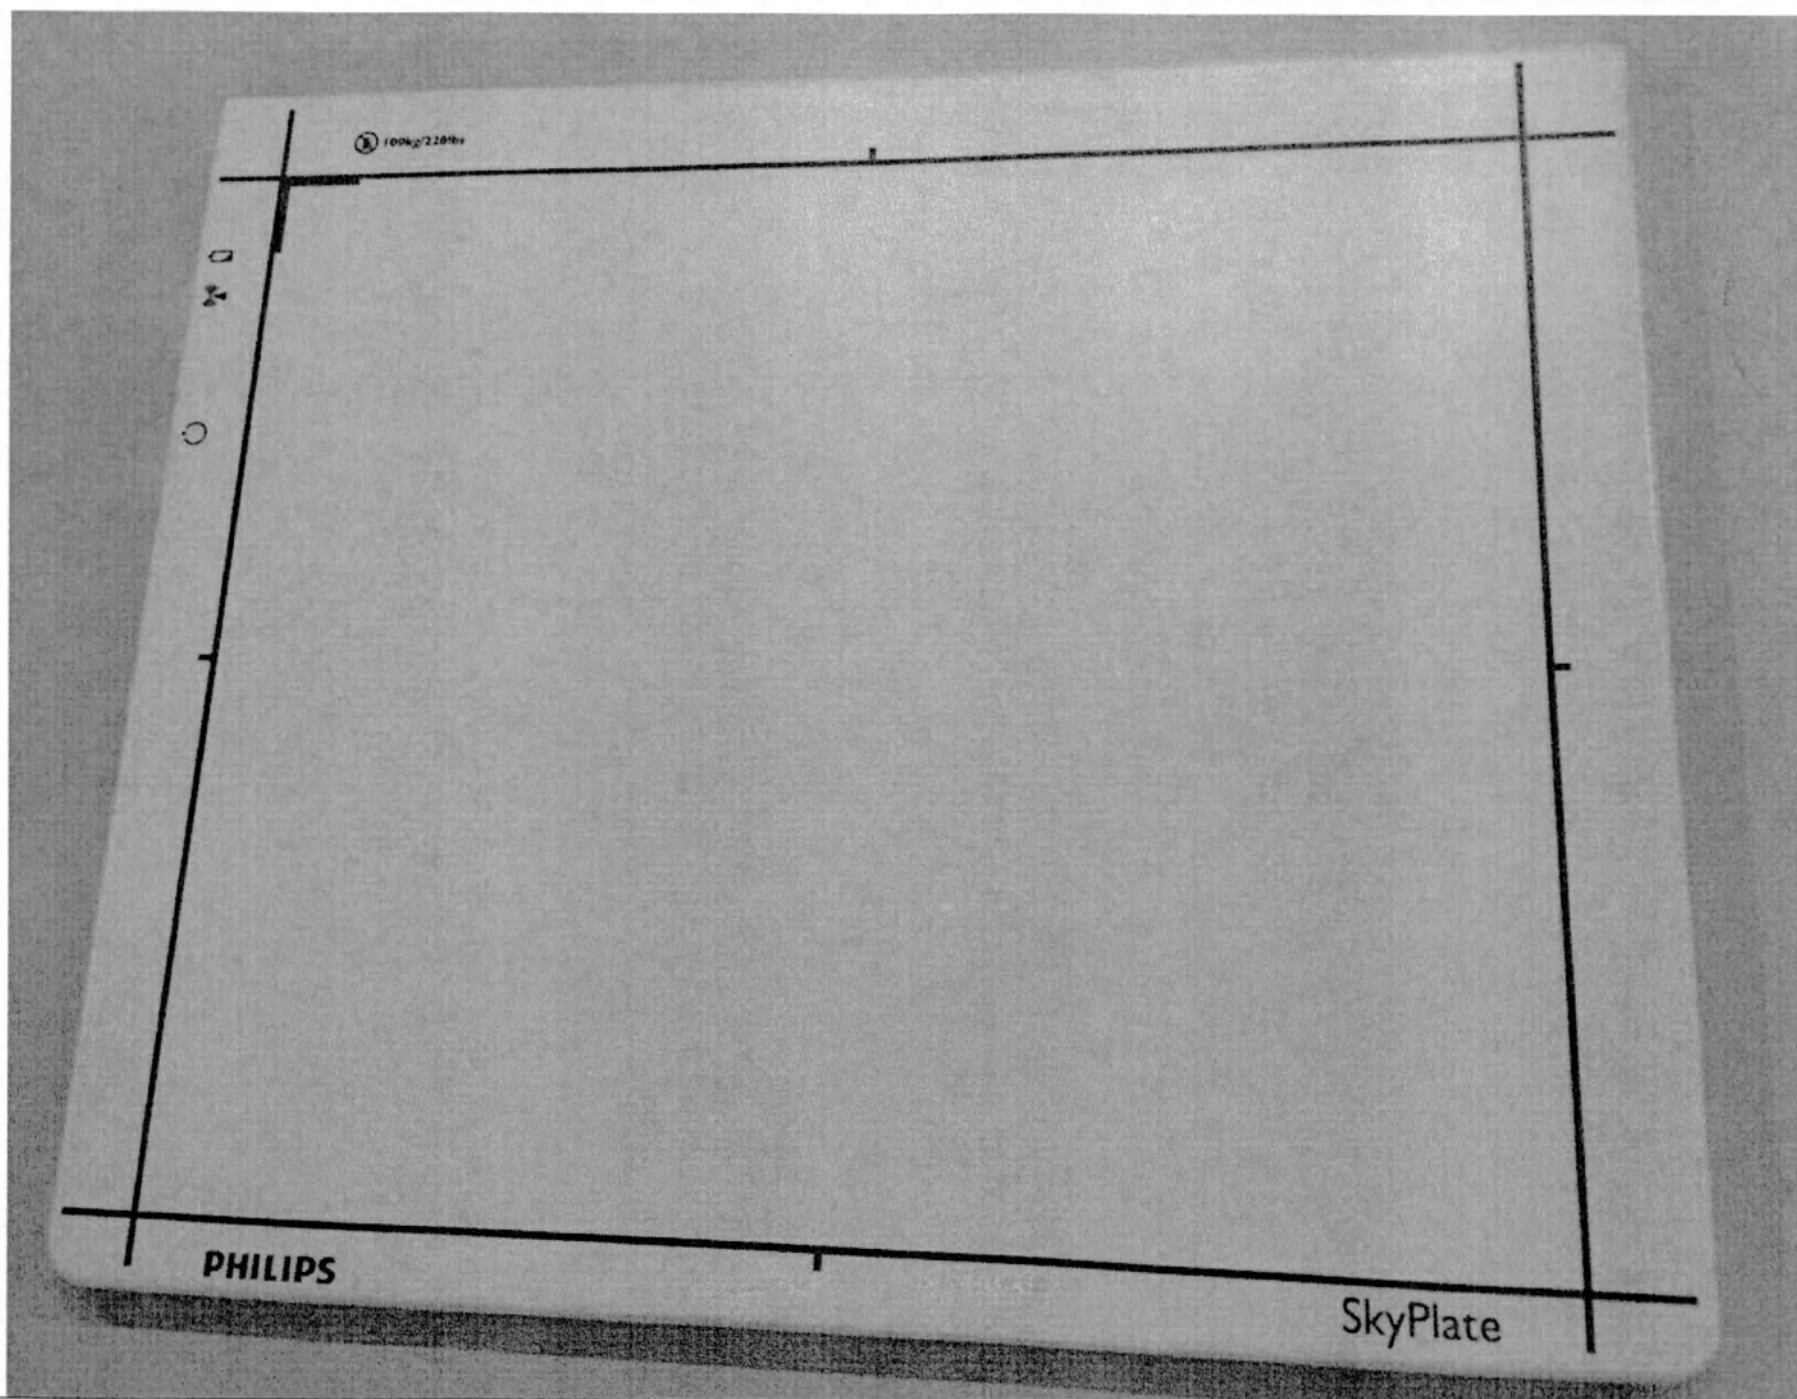

14. Малый детектор SkyPlate размером 24x30 см.

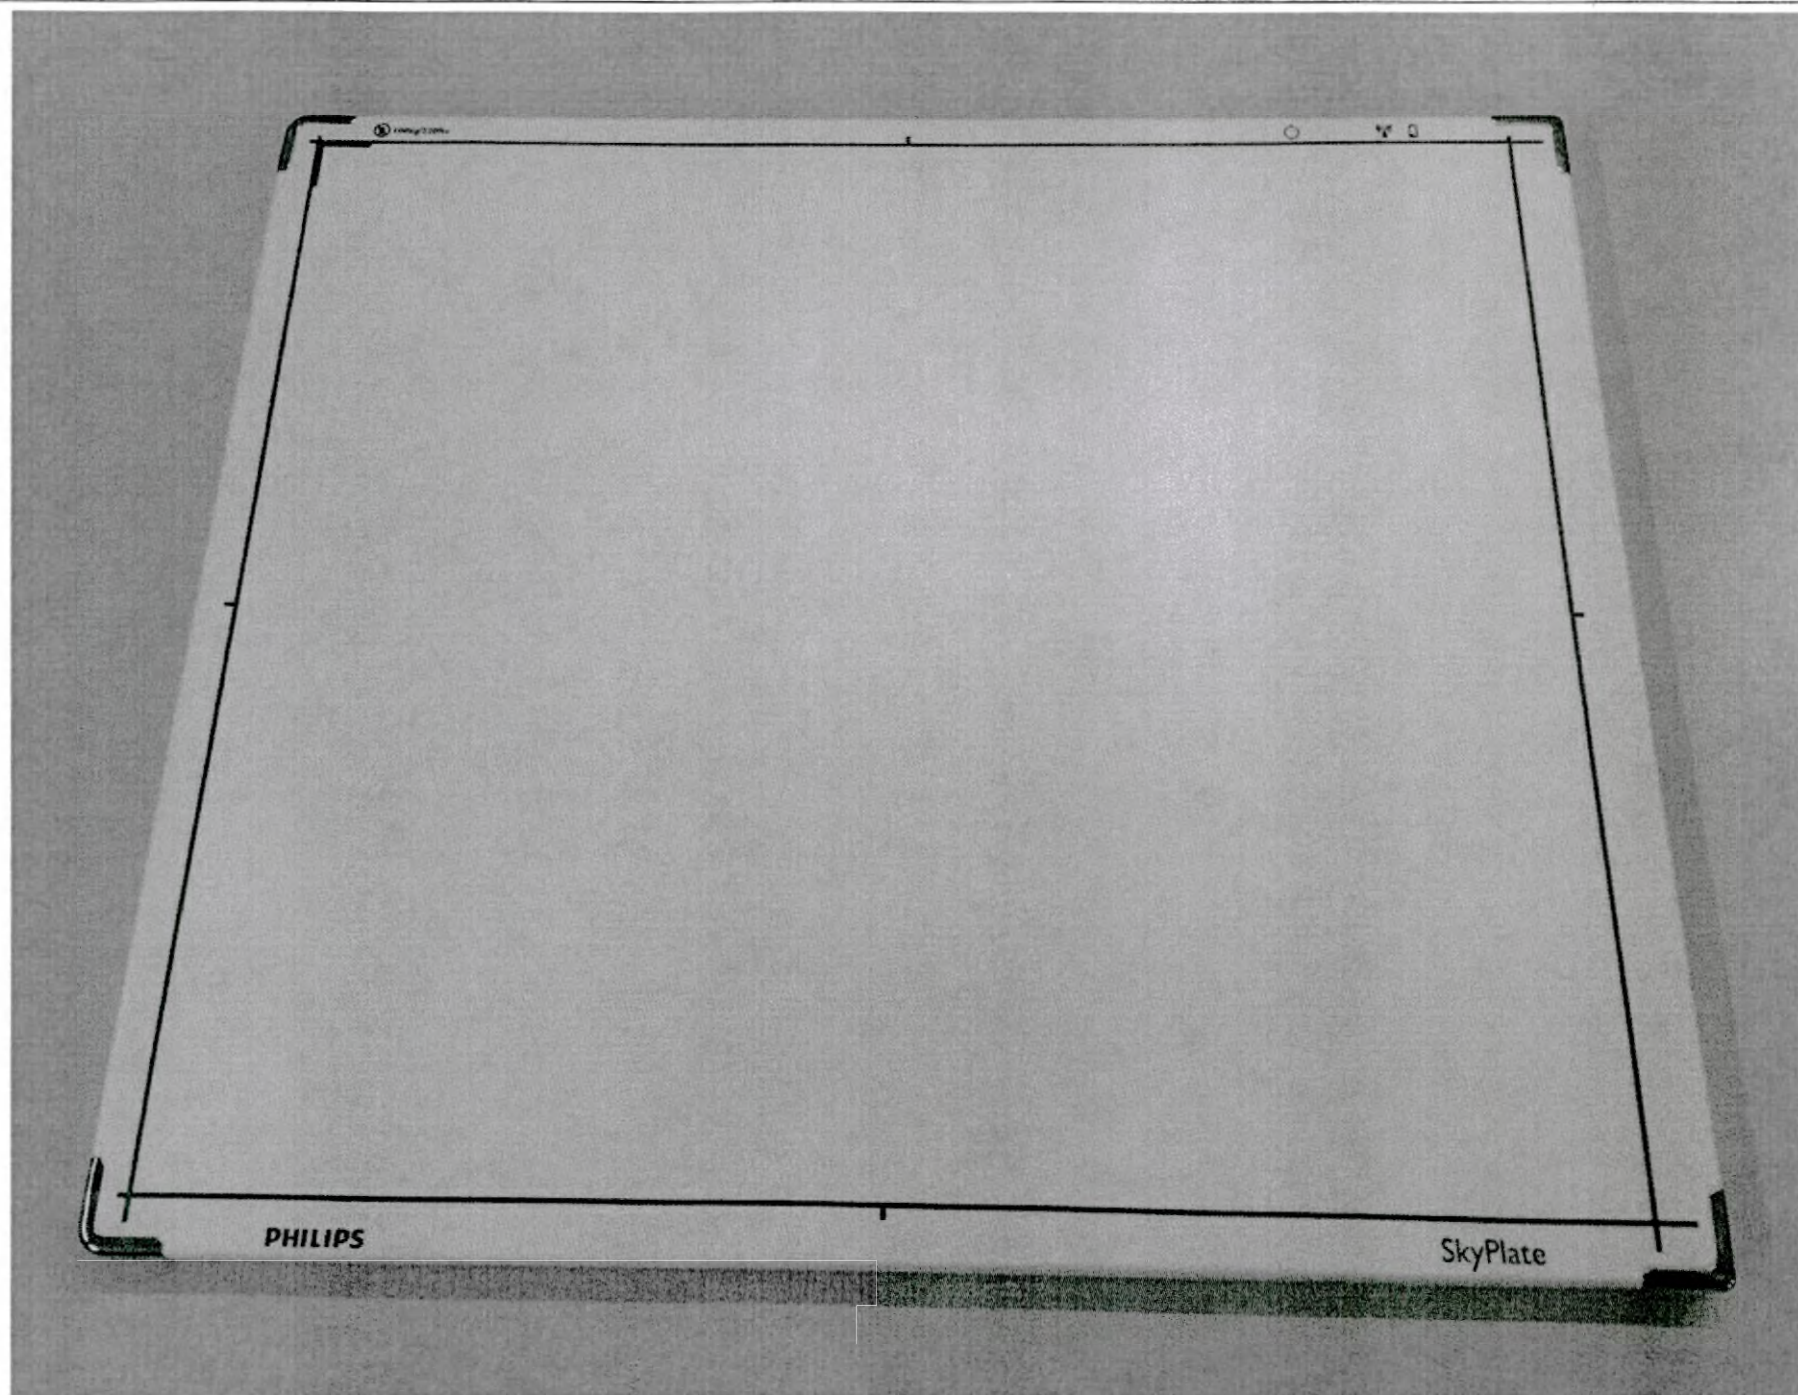

15. Большой детектор SkyPlate размером 35x43 см

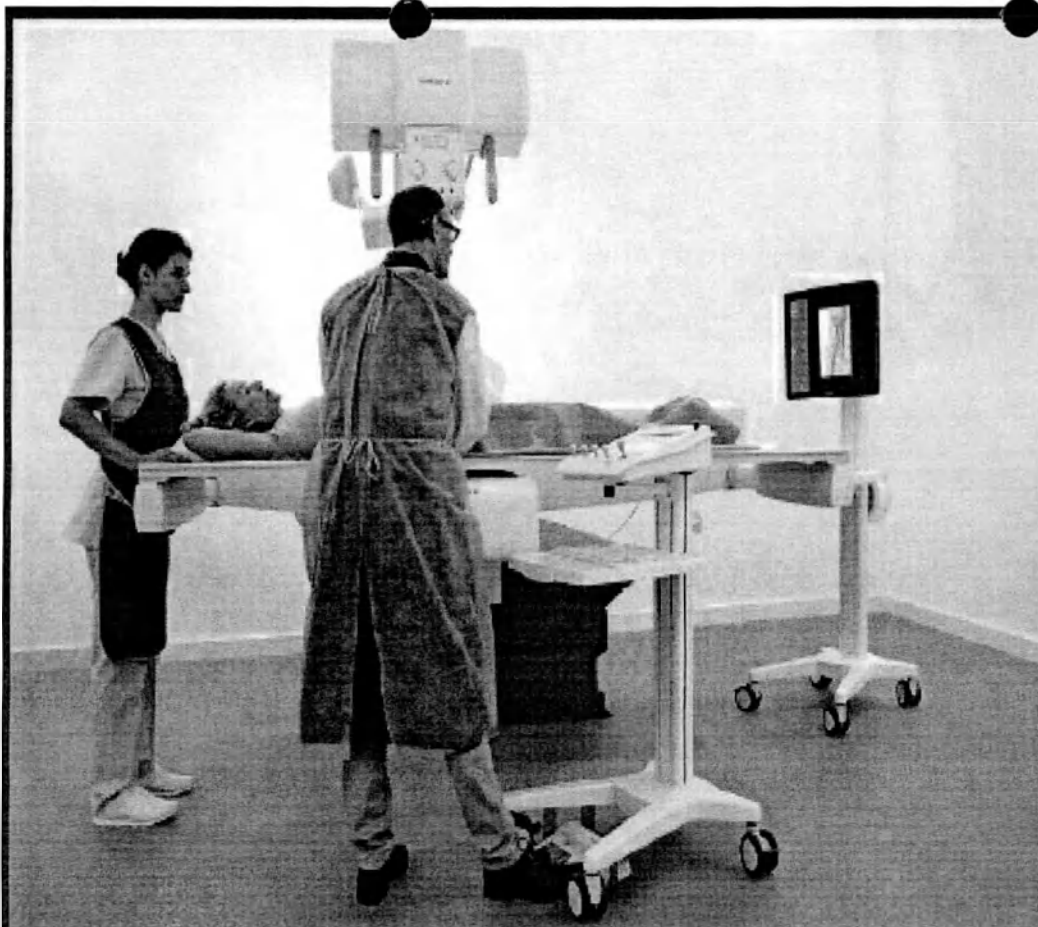

Руководство по
эксплуатации

Русский


CombiDiagnost R90

Версия 1.1

PHILIPS

16.a Эксплуатационная документация CombiDiagnost R90 на электронном и/или бумажном носителе.


4510 5657 80942 AA / R90 * JUNE 2010 - 4-1023

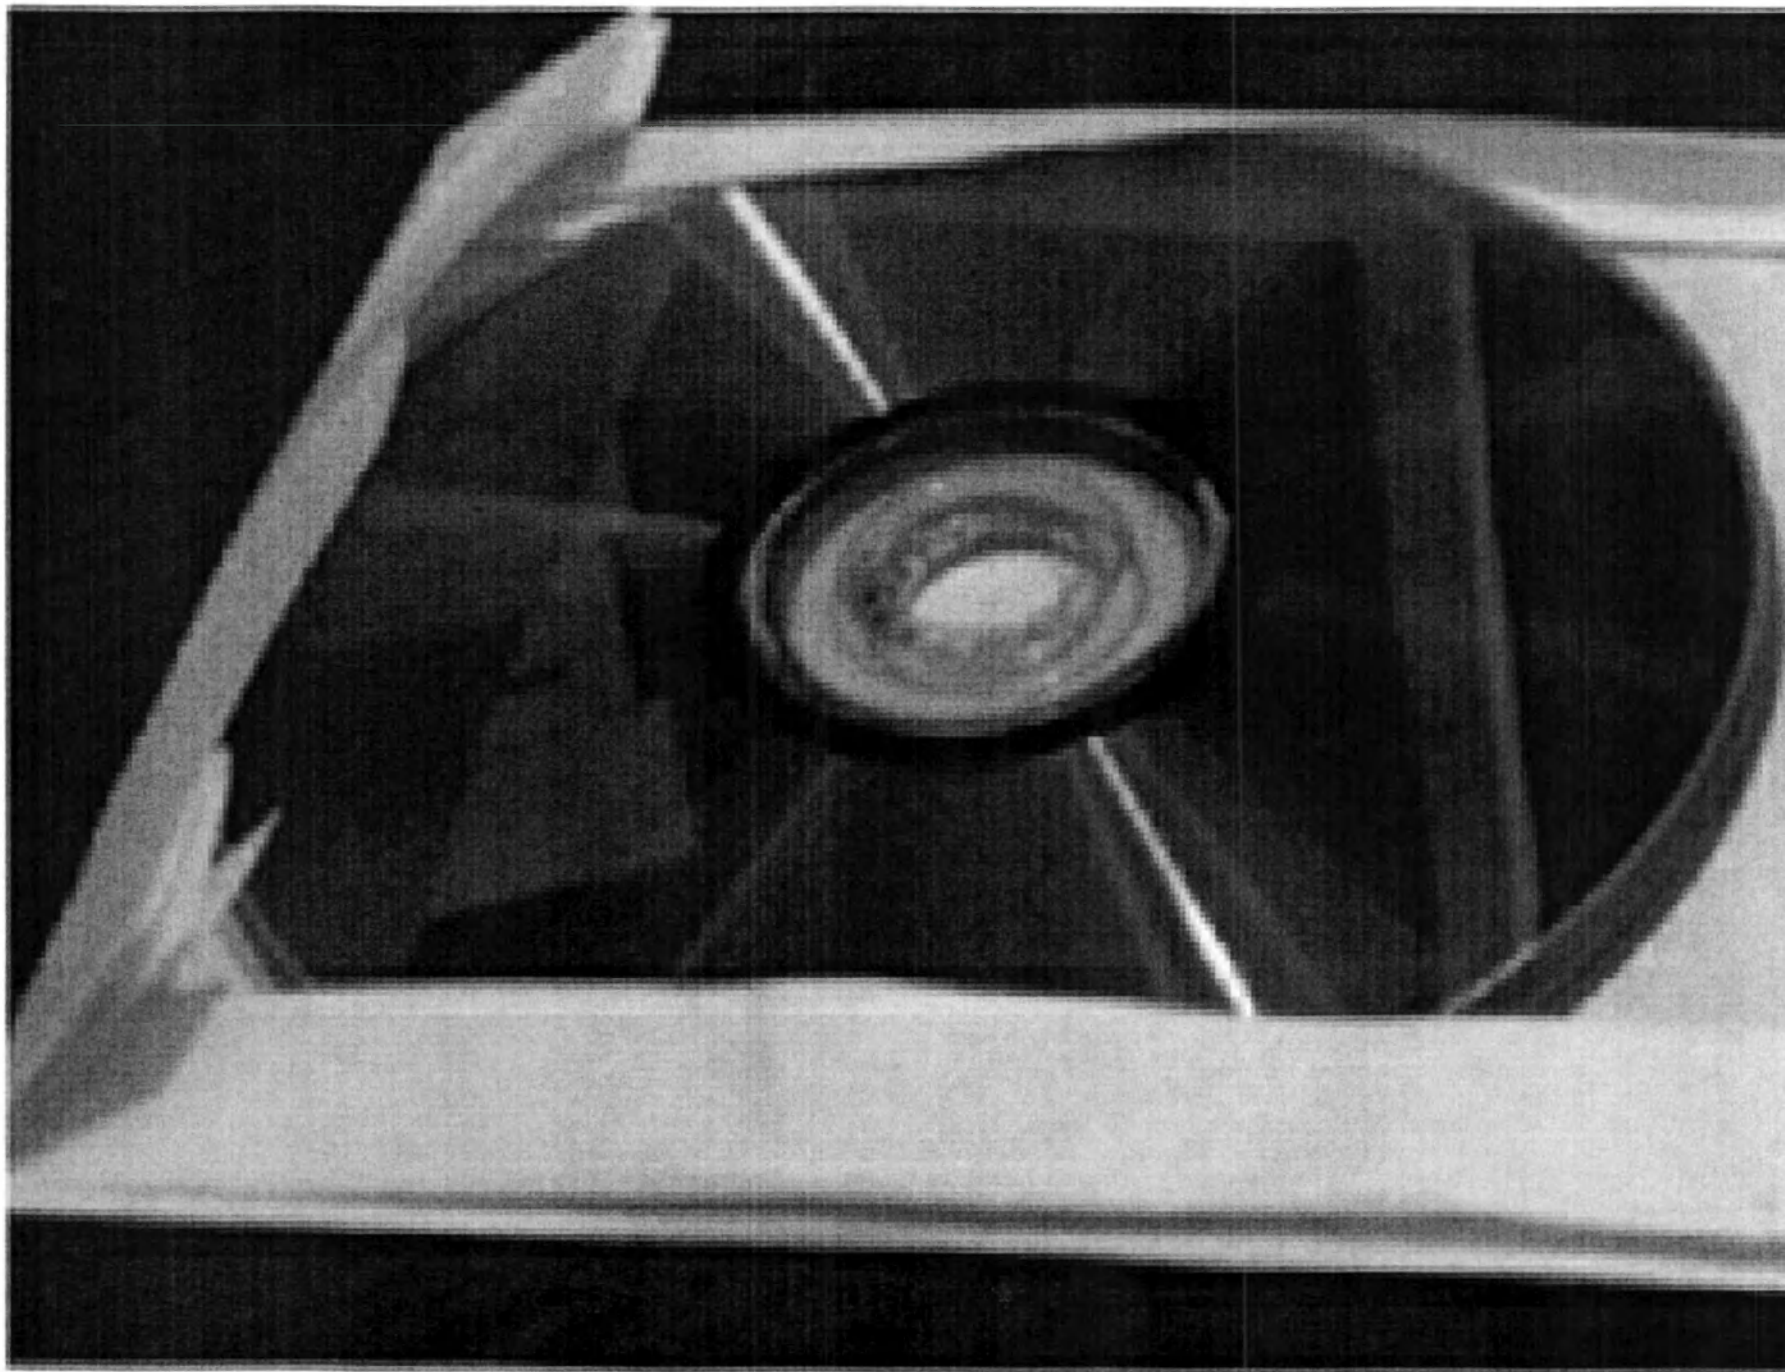


17.а Программное обеспечение «Сшивка» на ПЗУ, CD/DVD дисках, флеш-картах, USB-флеш-накопителях, виртуальном носителе



17.6 Программное обеспечение «Сшивка» на ПЗУ, CD/DVD дисках, флеш-картах, USB-флеш-накопителях, виртуальном носителе

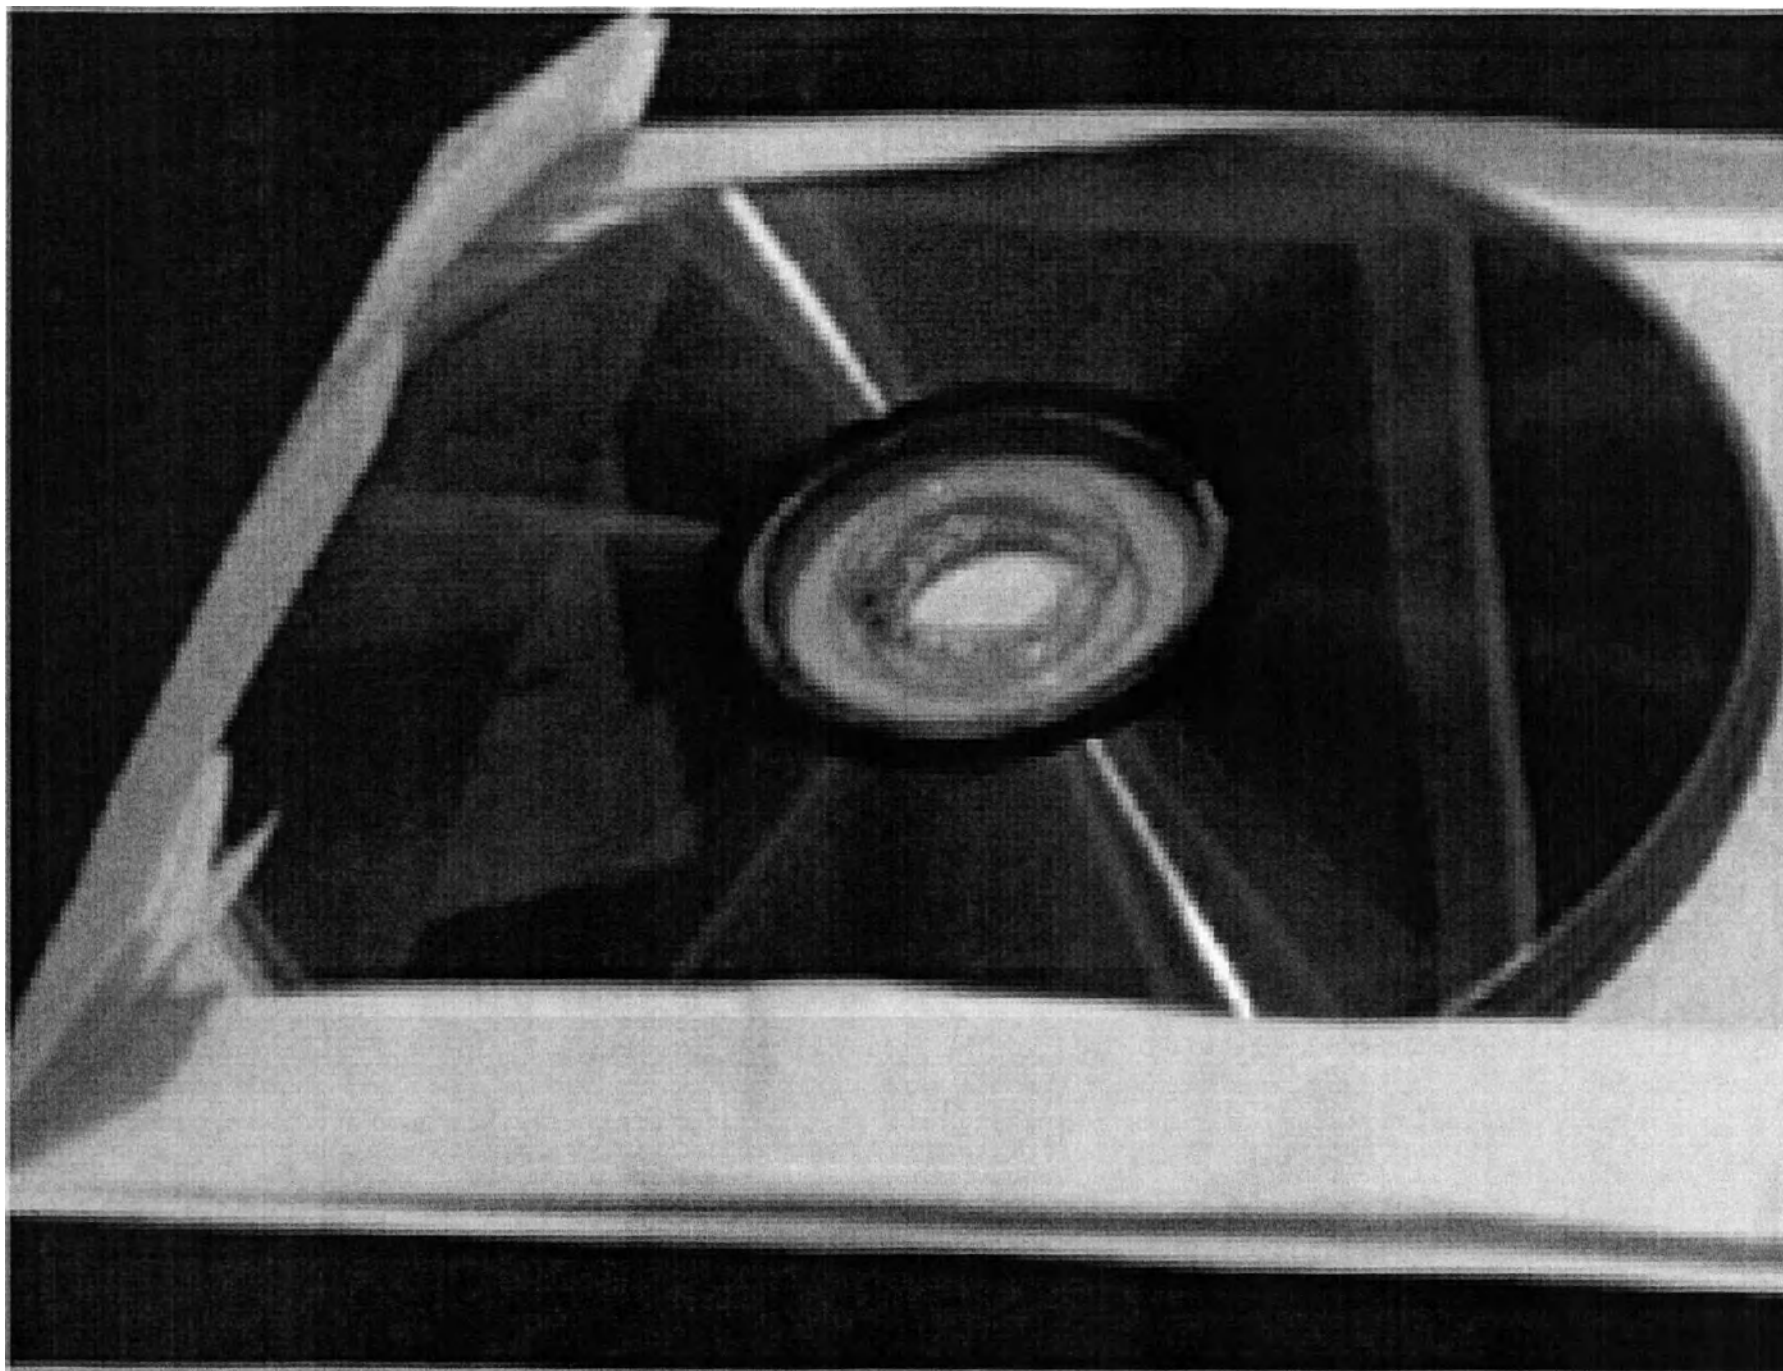


18.а Программное обеспечение «SkyFlow» на ПЗУ, CD/DVD дисках, флеш-картах, USB-флеш-накопителях, виртуальном носителе

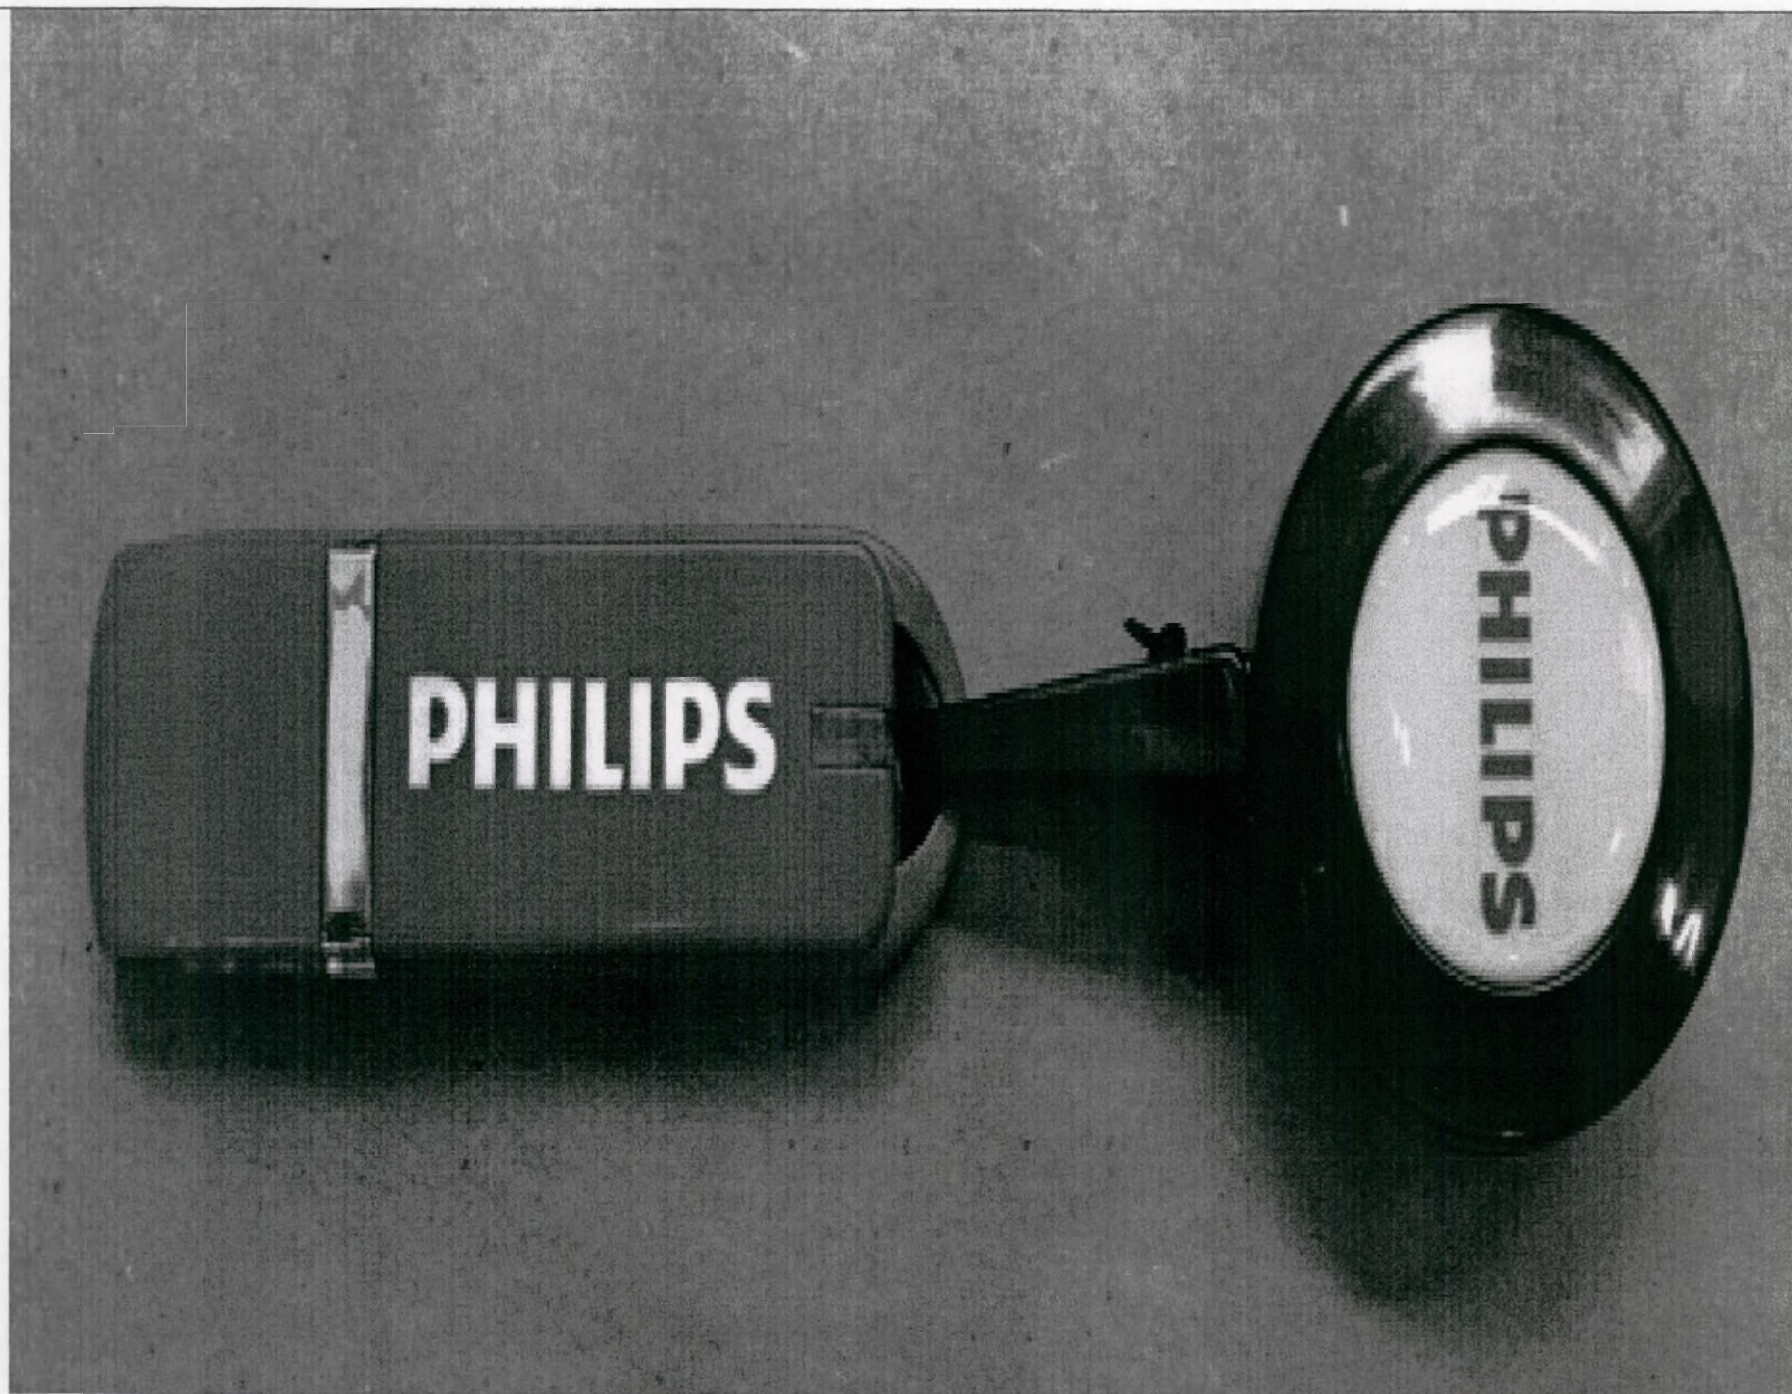

18.6 Программное обеспечение «SkyFlow» на ПЗУ, CD/DVD дисках, флеш-картах, USB-флеш-накопителях, виртуальном носителе




19.а Программное обеспечение «Bone Suppression (Подавление костей)» на ПЗУ, CD/DVD дисках, флеш-картах, USB-флеш-накопителях, виртуальном носителе

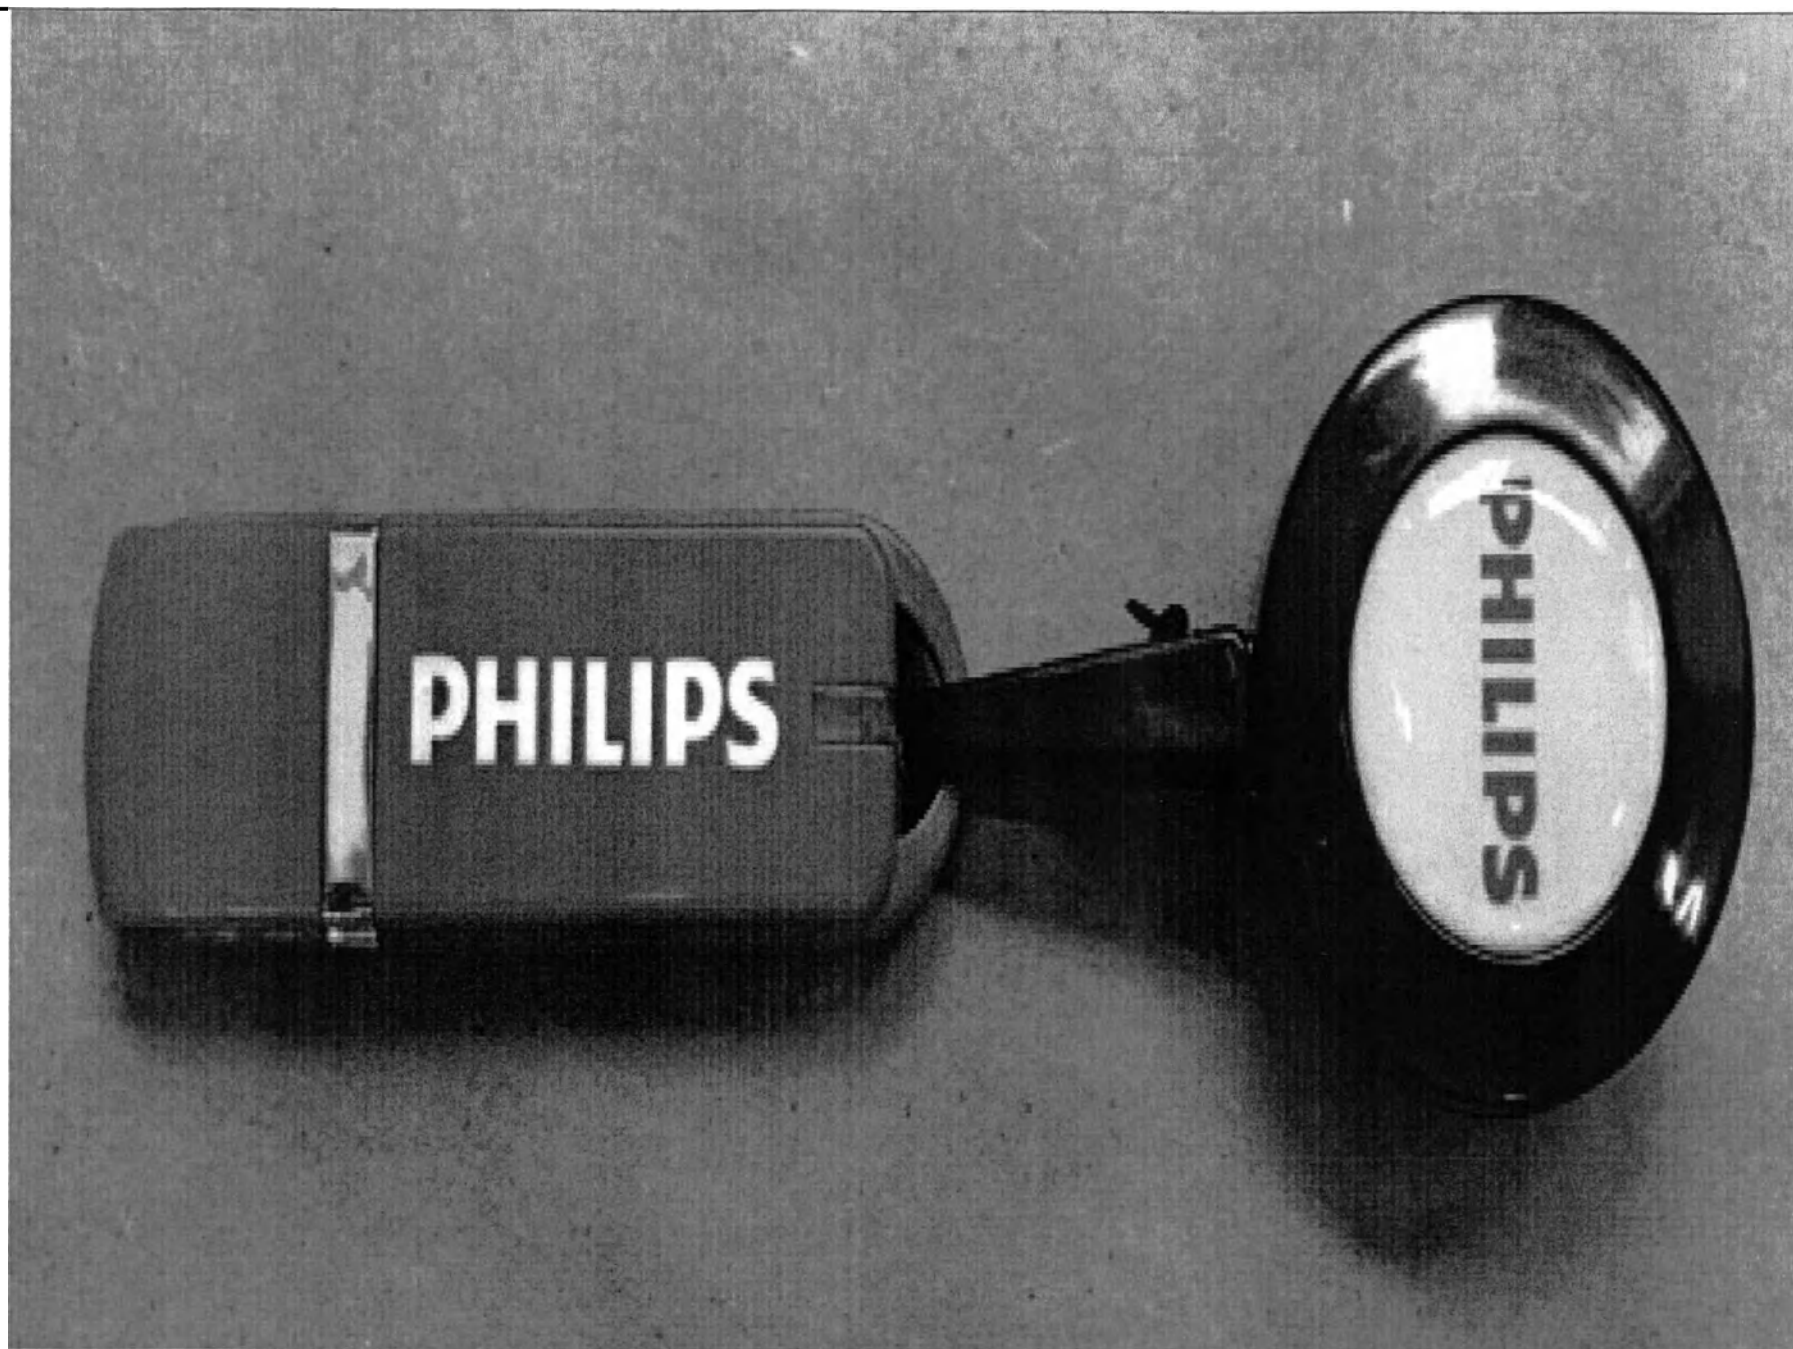


19.6 Программное обеспечение «Bone Suppression (Подавление костей)» на ПЗУ, CD/DVD дисках, флеш-картах, USB-флеш-накопителях, виртуальном носителе



20.а Программное обеспечение «Инструмент проверки качества (QA Tool)» на ПЗУ, CD/DVD дисках, флеш-картах, USB-флеш-накопителях, виртуальном носителе

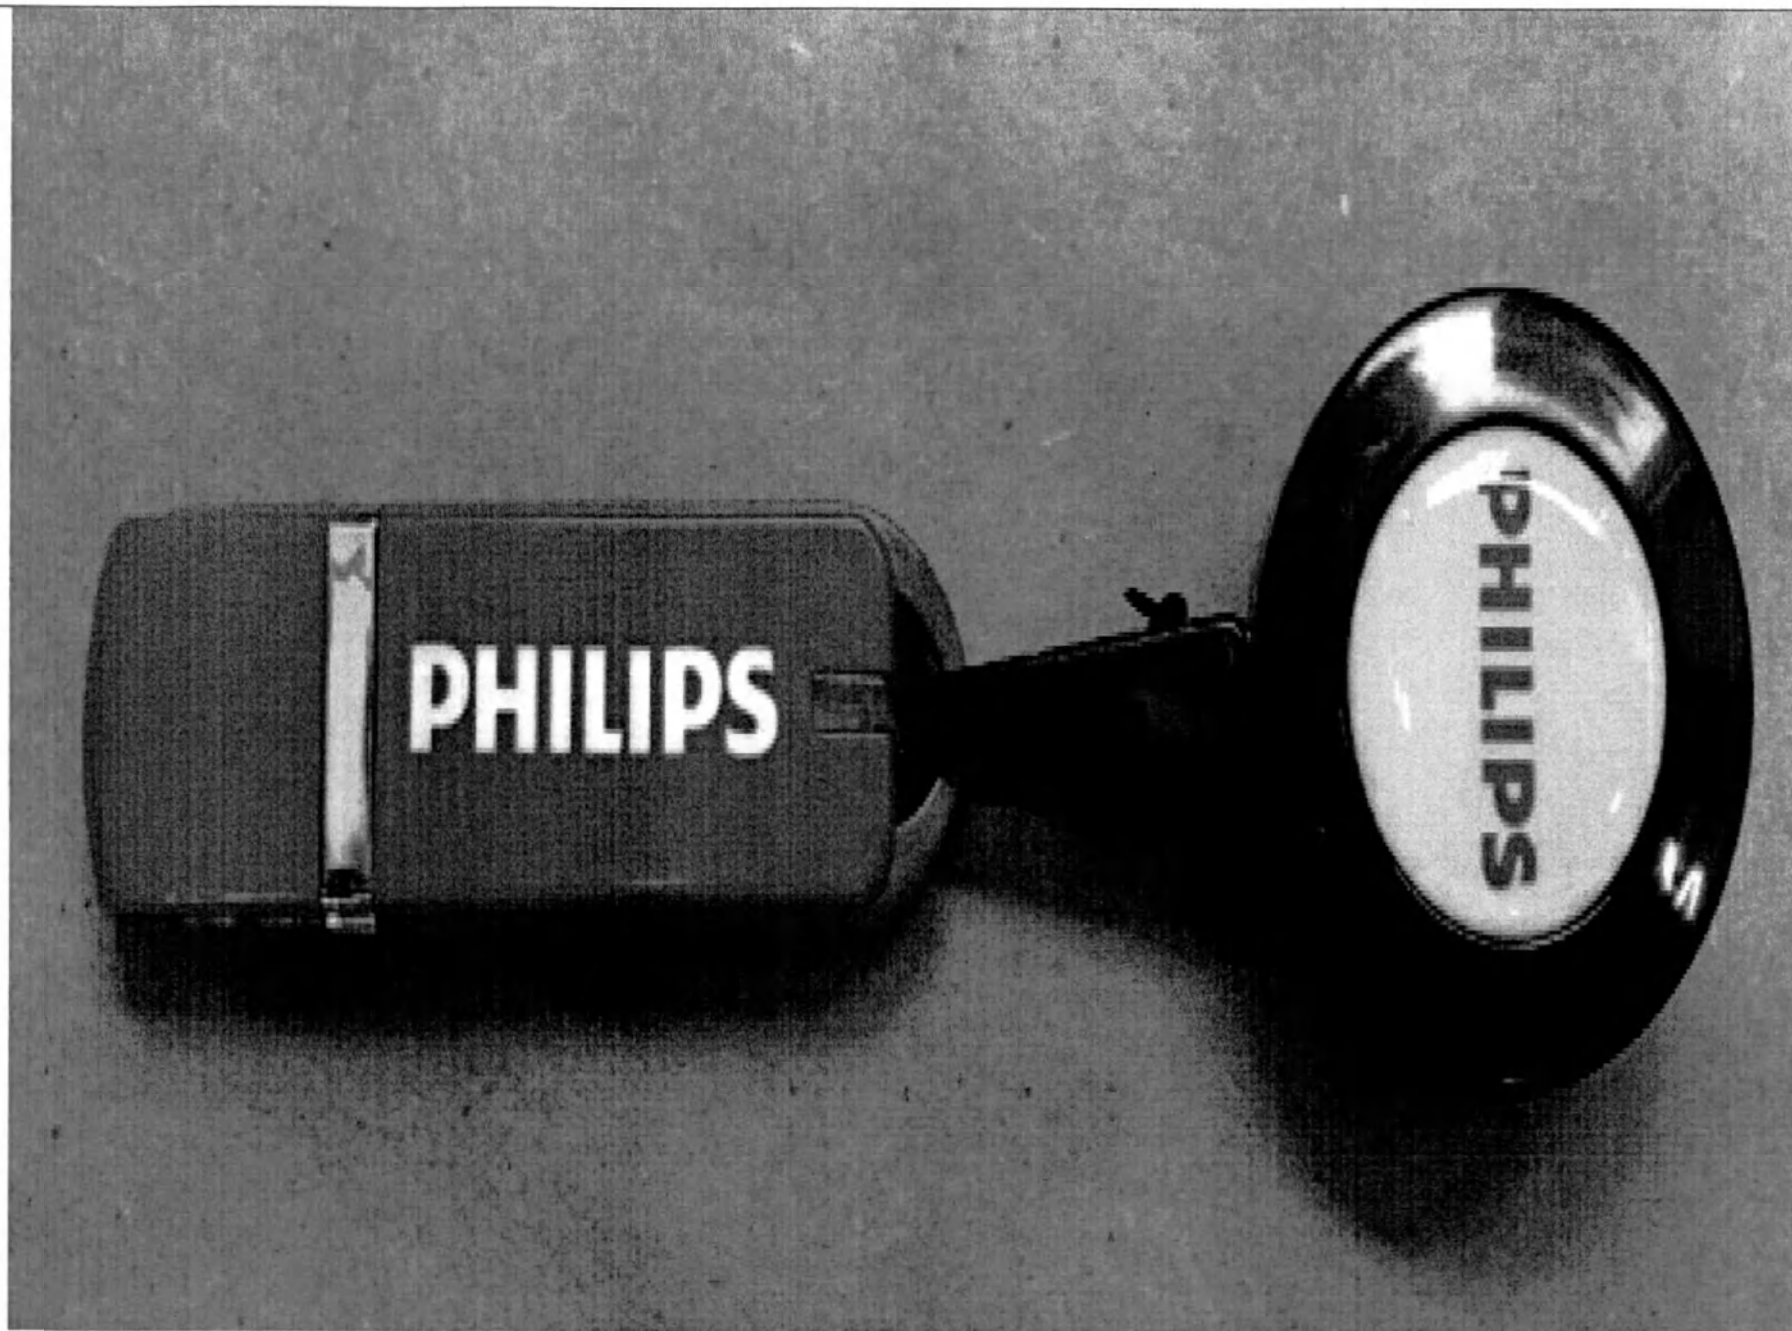


20.6 Программное обеспечение «Инструмент проверки качества (QA Tool)» на ПЗУ, CD/DVD дисках, флеш-картах, USB-флеш-накопителях, виртуальном носителе

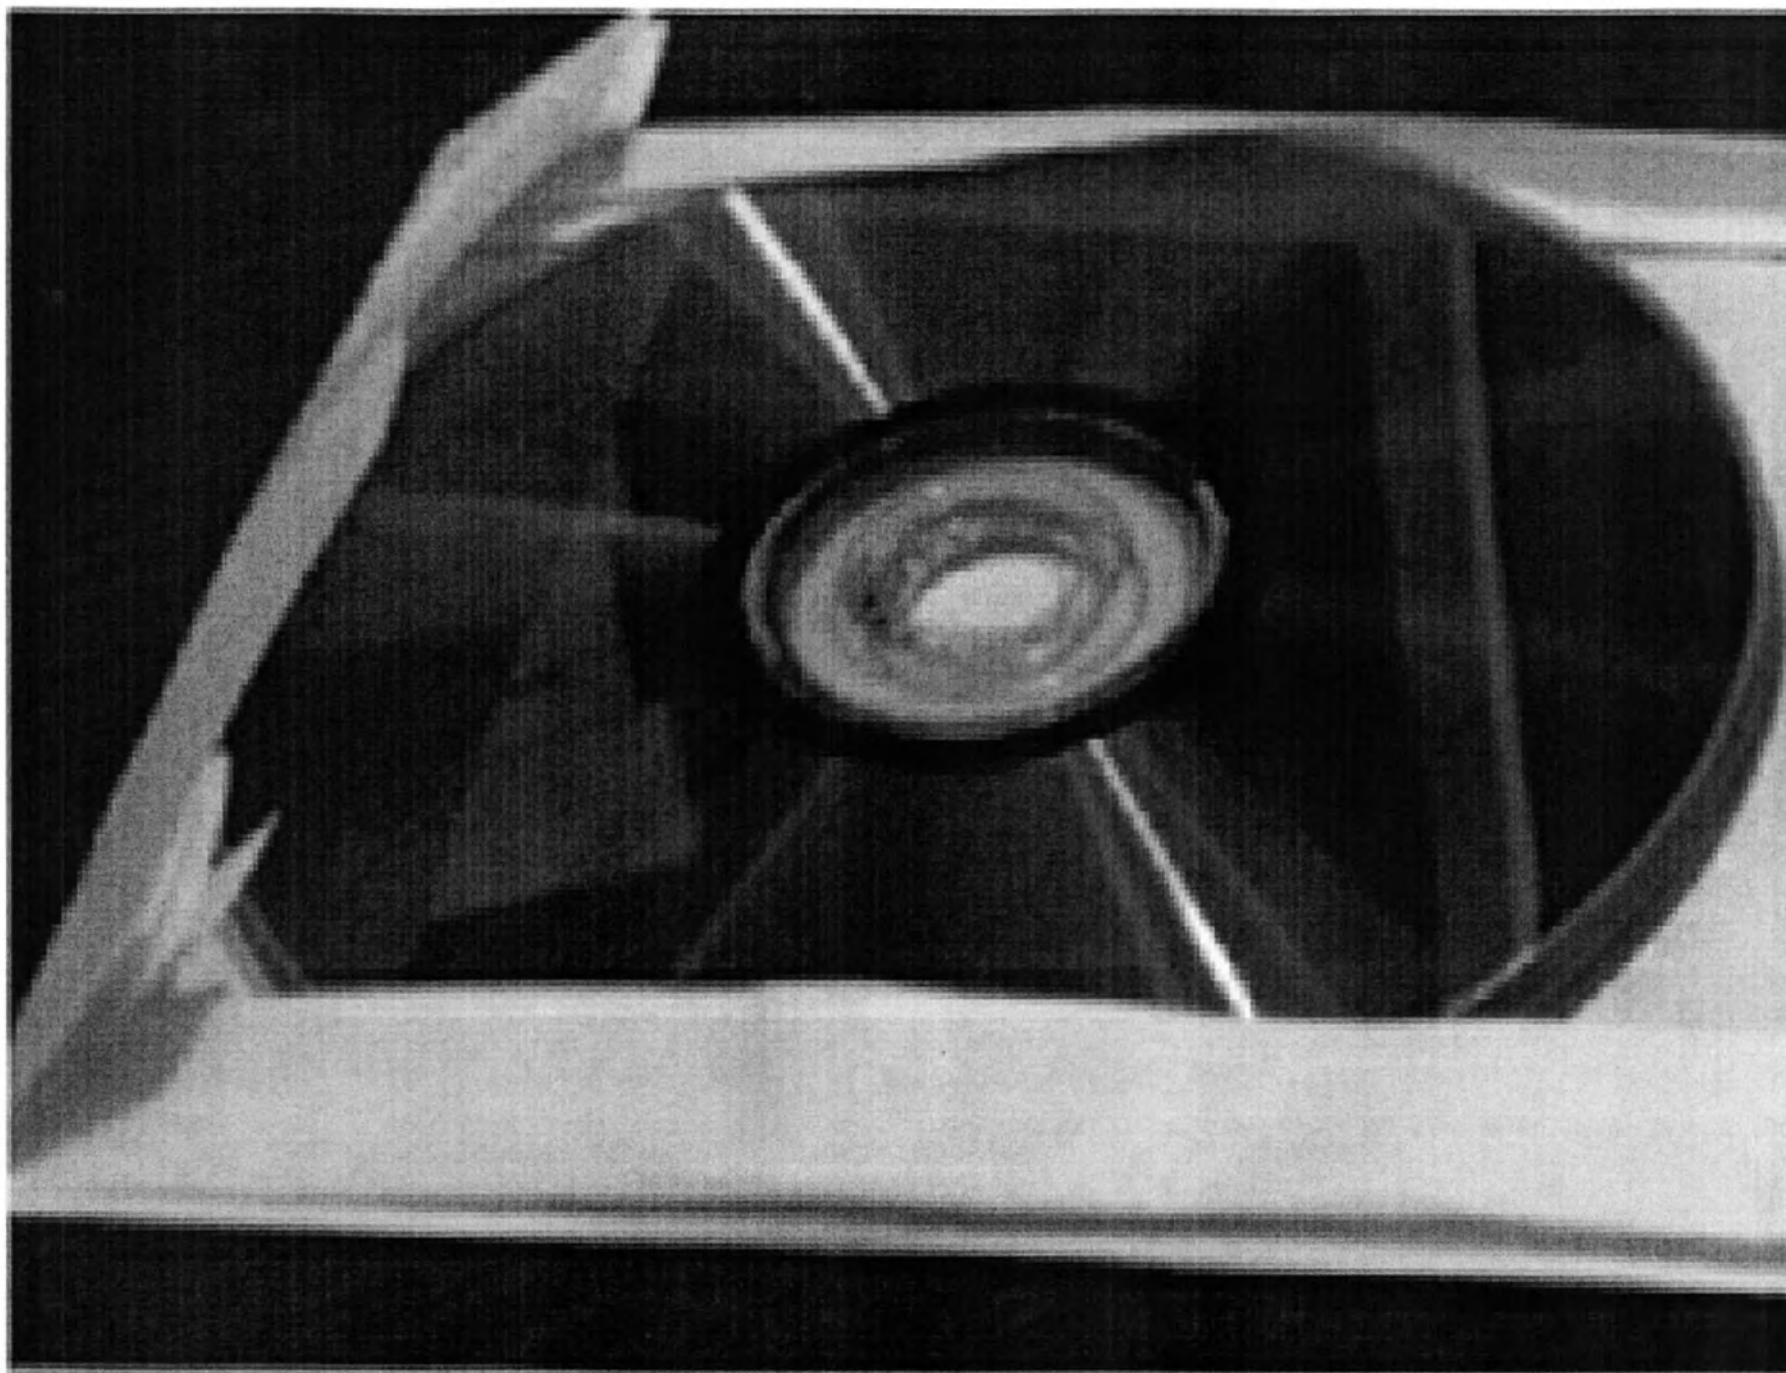

21.а Программное обеспечение «mShield» на ПЗУ, CD/DVD дисках, флеш-картах, USB-флеш-накопителях, виртуальном носителе



21.6 Программное обеспечение «mShield» на ПЗУ, CD/DVD дисках, флеш-картах, USB-флеш-накопителях, виртуальном носителе

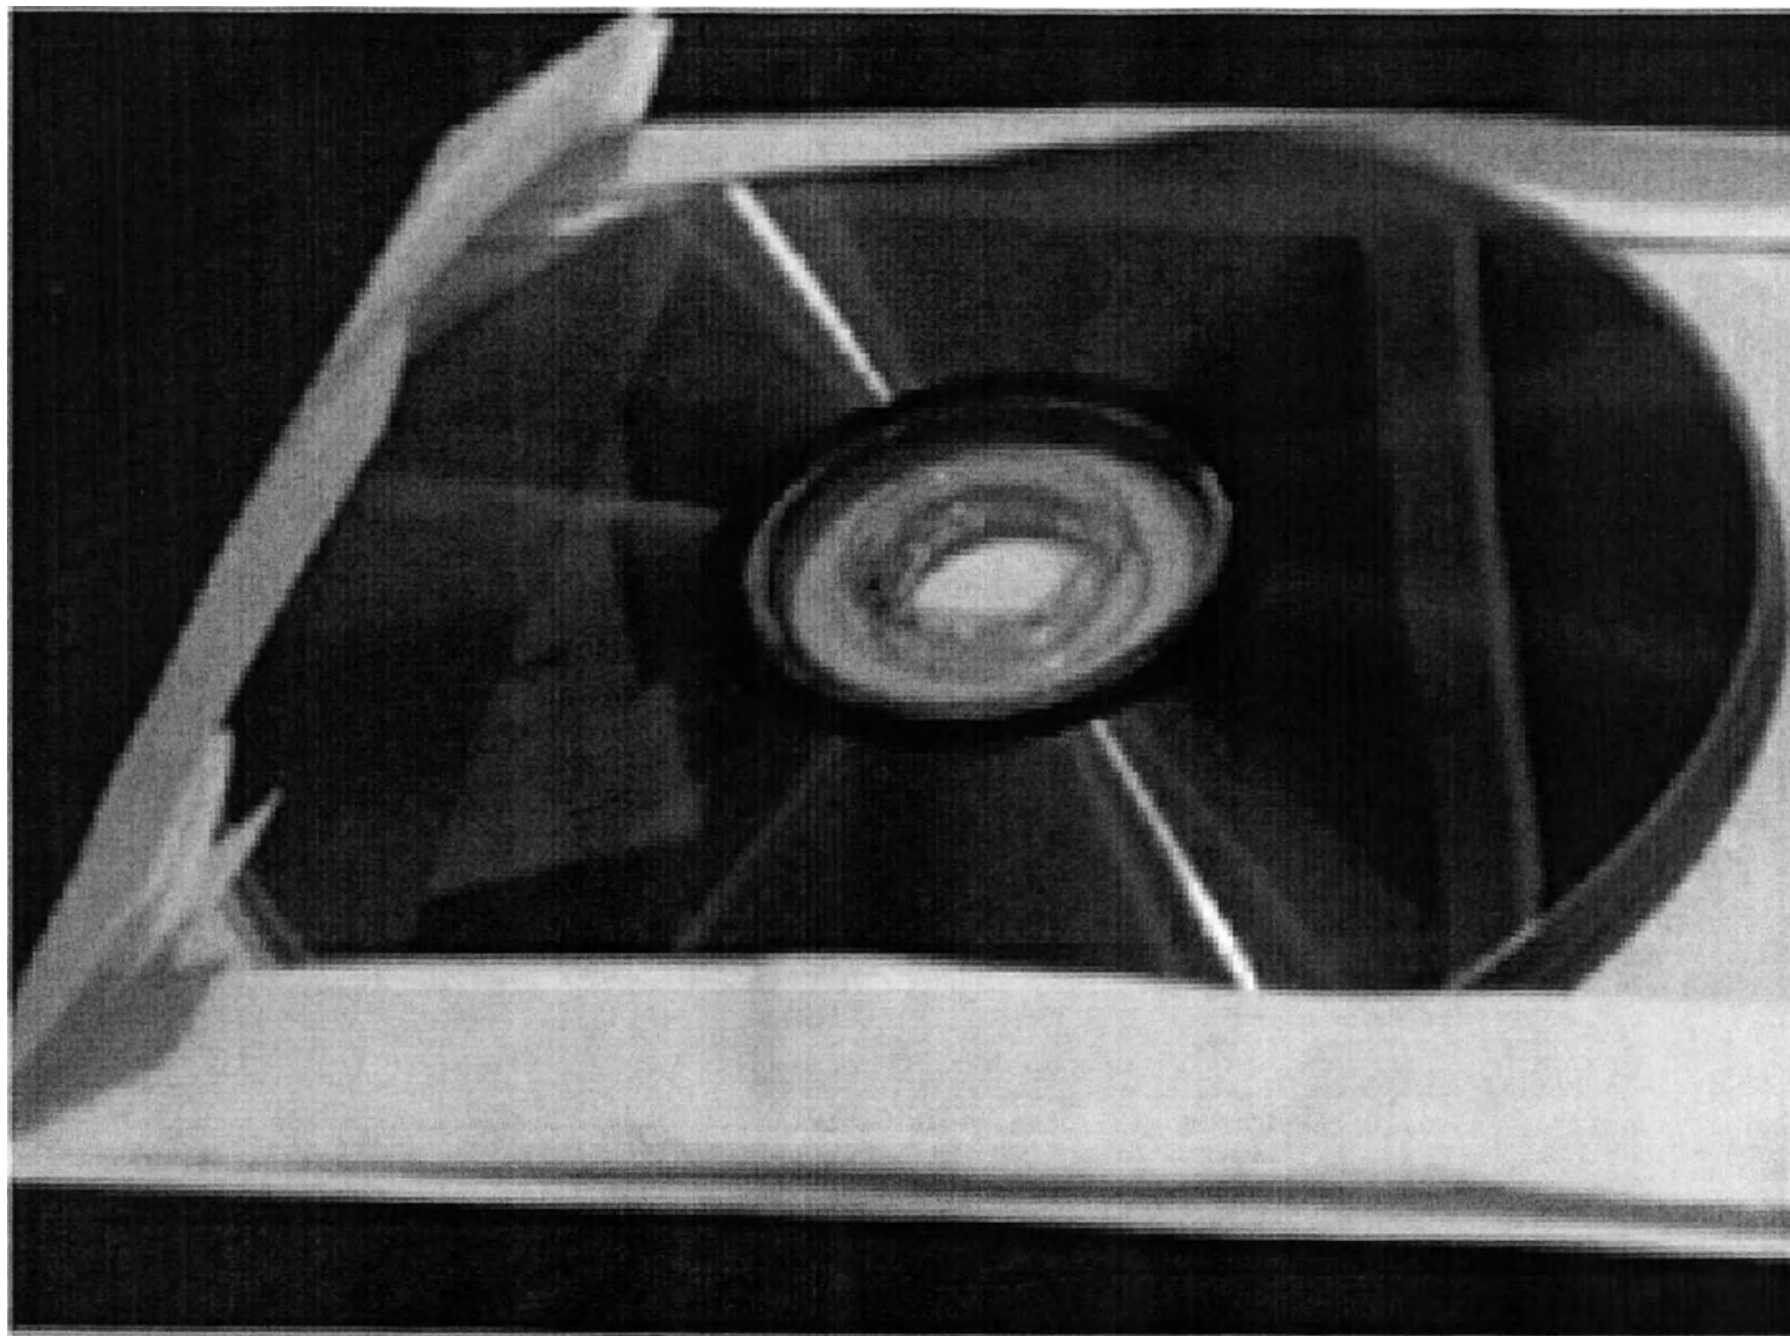


21.а Программное обеспечение «Программное обеспечение интерфейса АРМ лаборанта» на ПЗУ, CD/DVD дисках, флеш-картах, USB-флеш-накопителях, виртуальном носителе




22.6 Программное обеспечение «Программное обеспечение интерфейса АРМ лаборанта» на ПЗУ, CD/DVD дисках, флеш-картах, USB-флеш-накопителях, виртуальном носителе


II. Принадлежности:

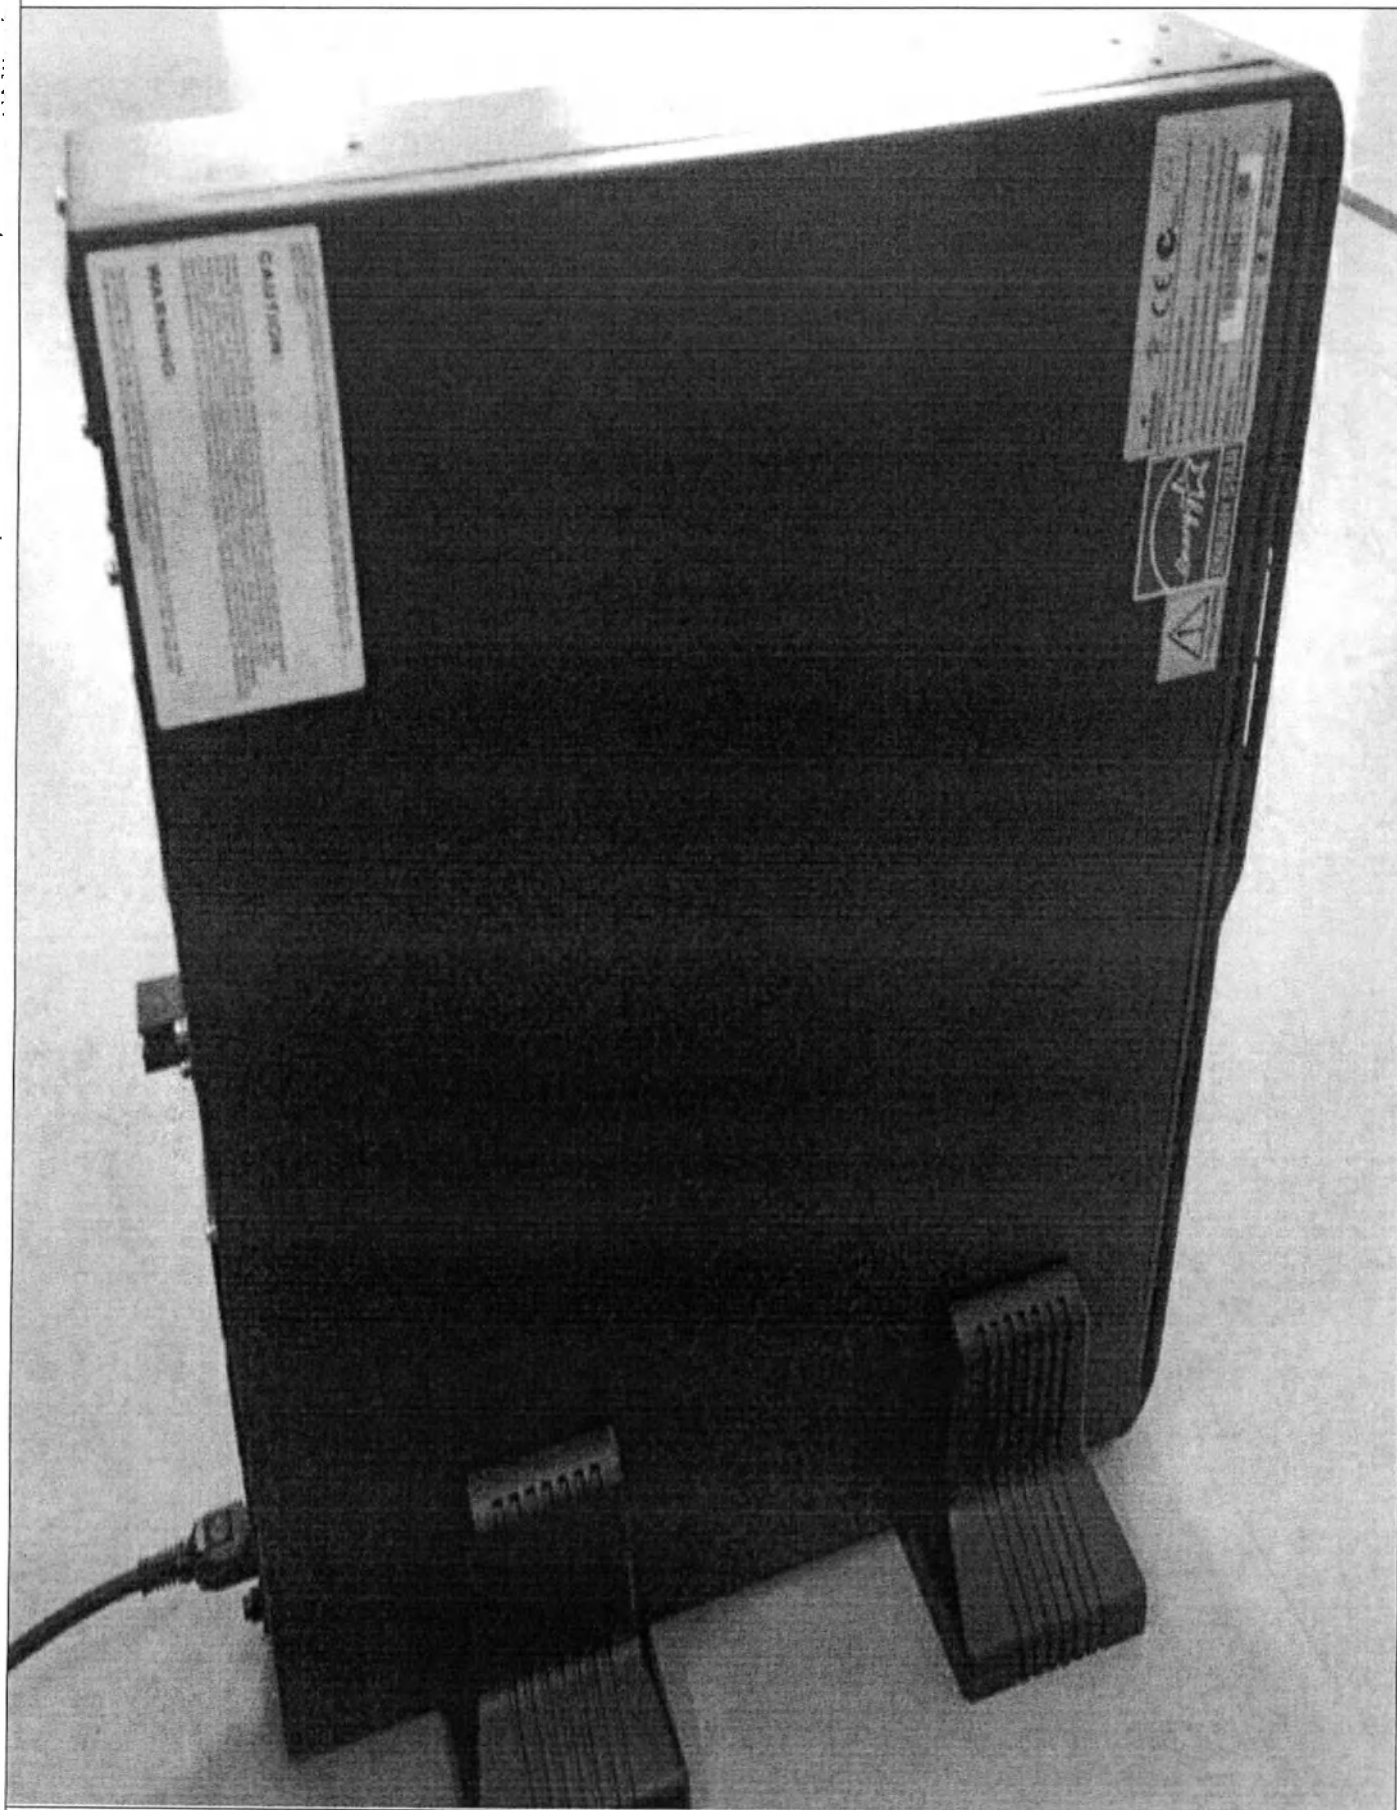


1. Источник бесперебойного питания.

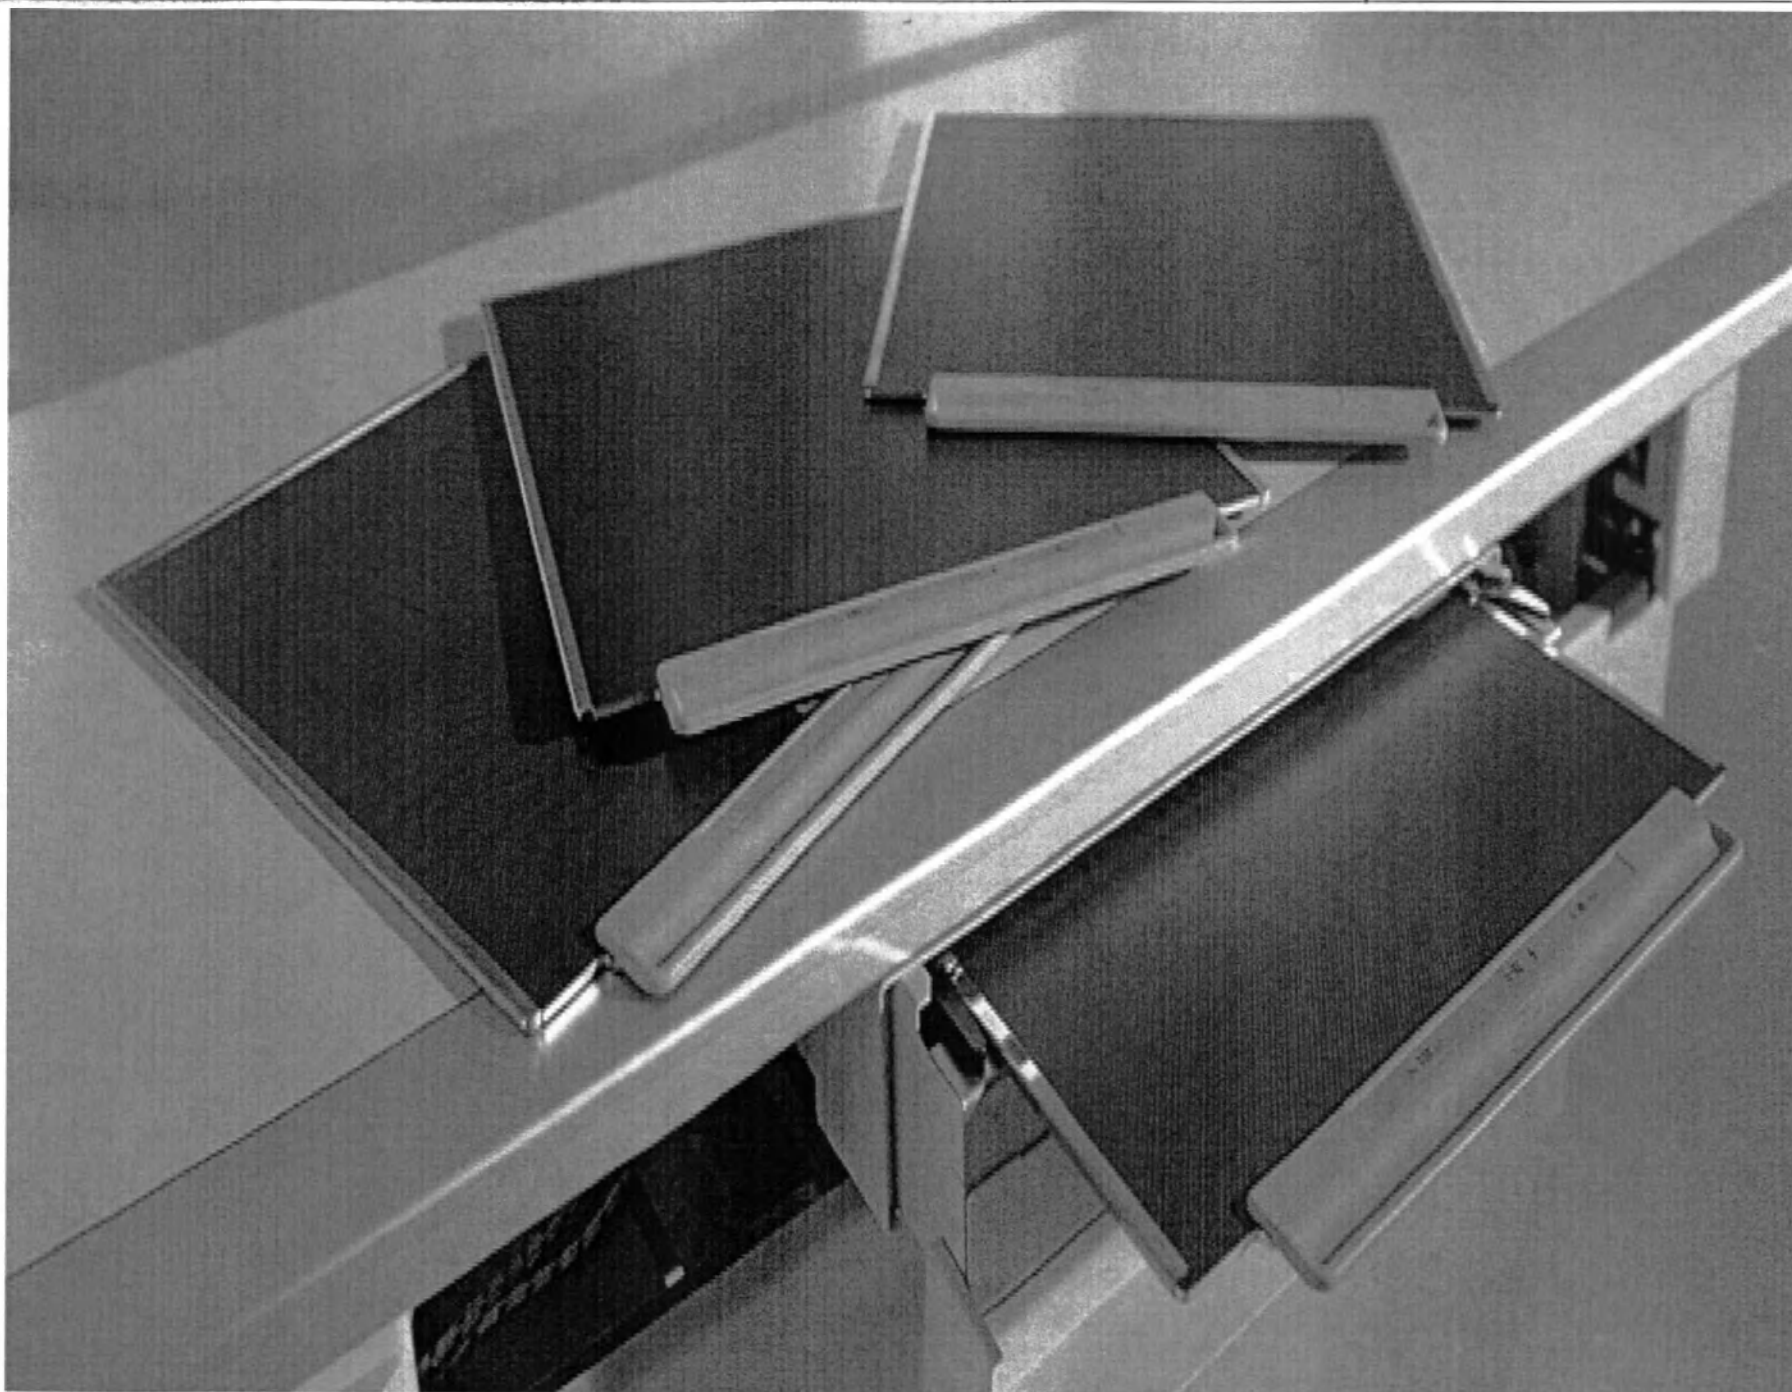


2. Решётки, отсеивающие с отношением 8 и/или с отношением 12

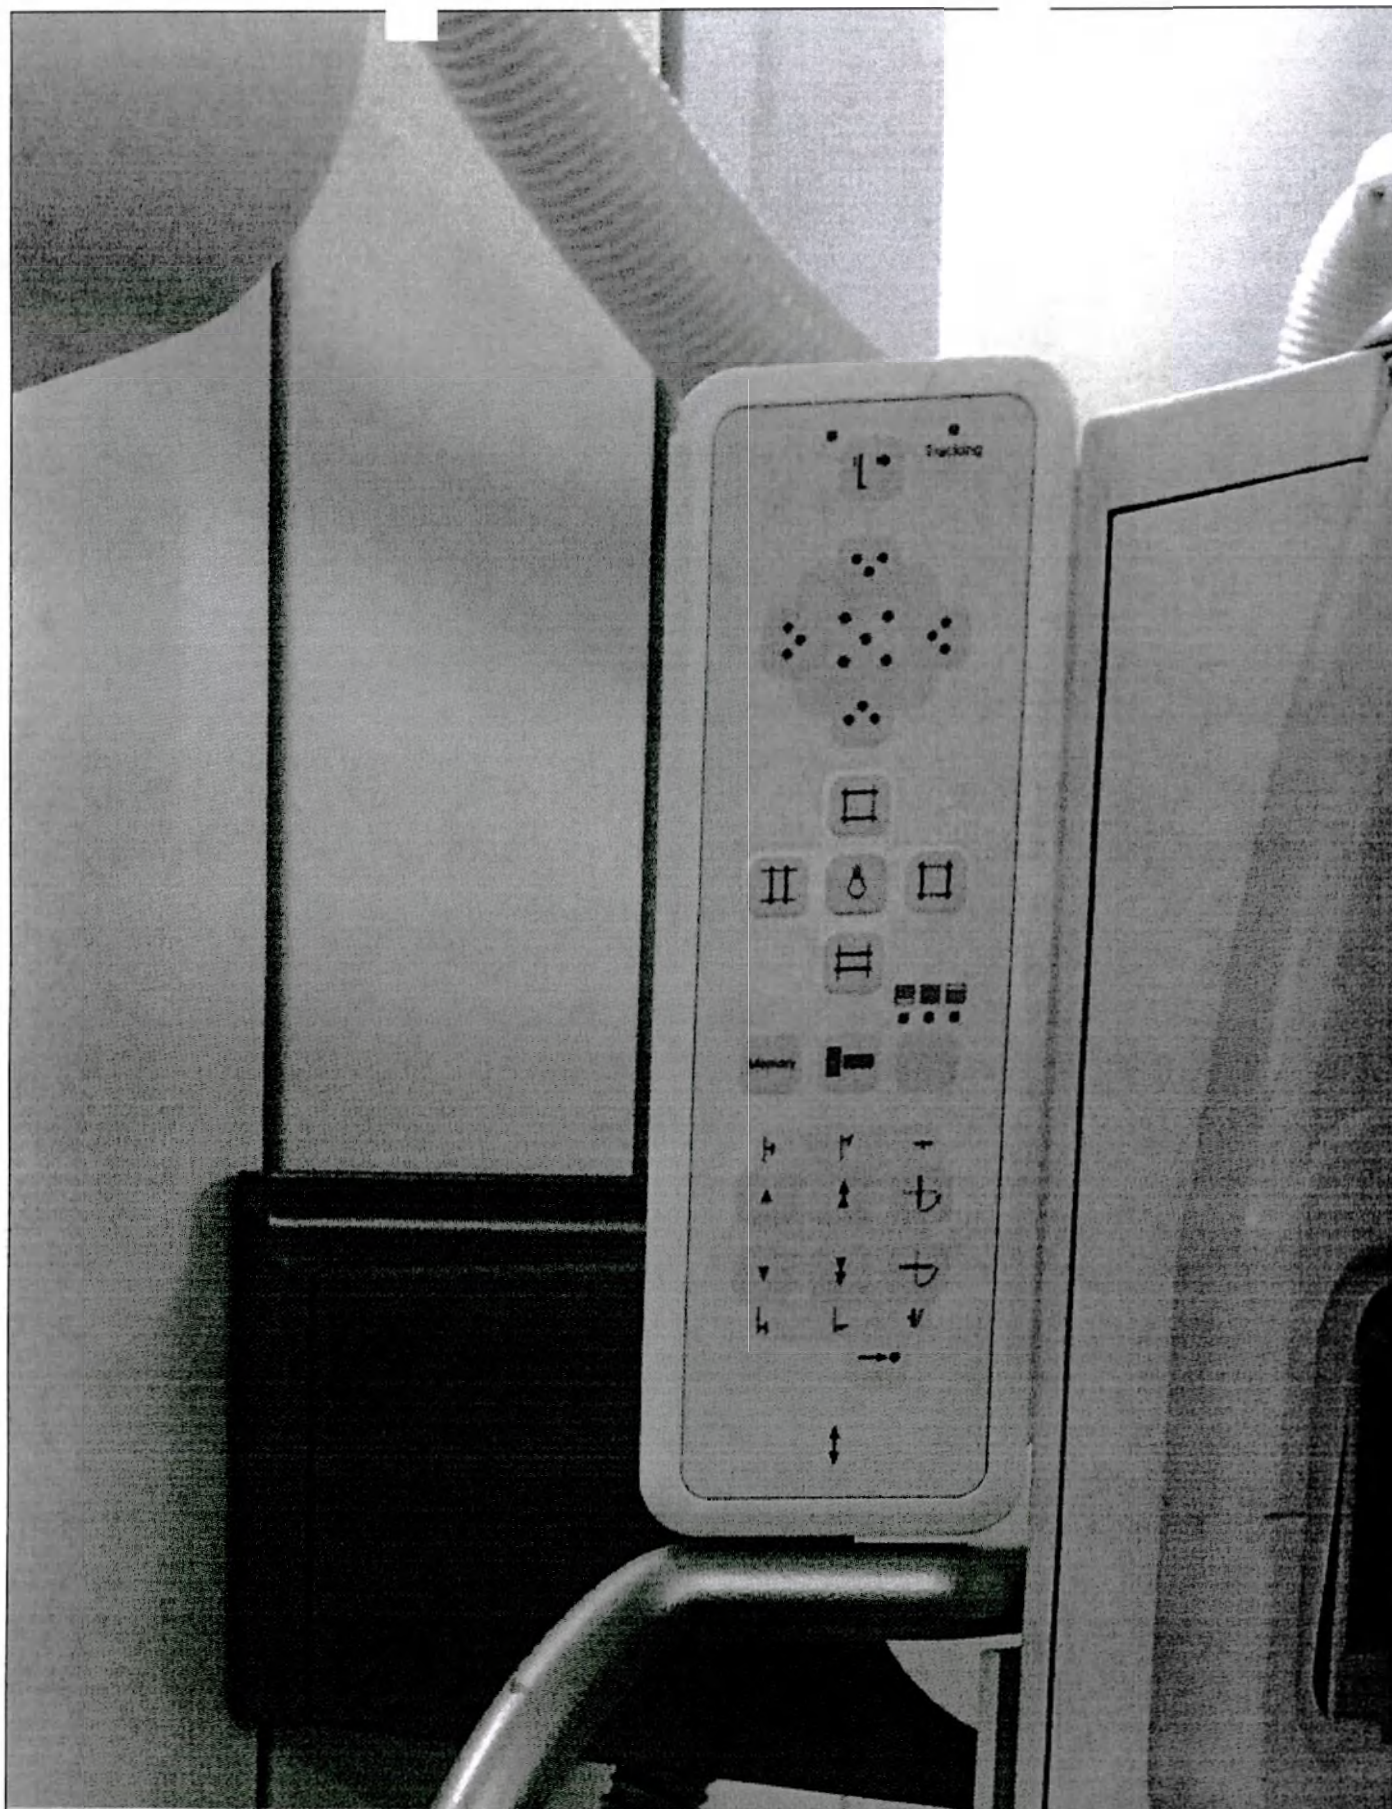


3. Пульт дистанционного управления.

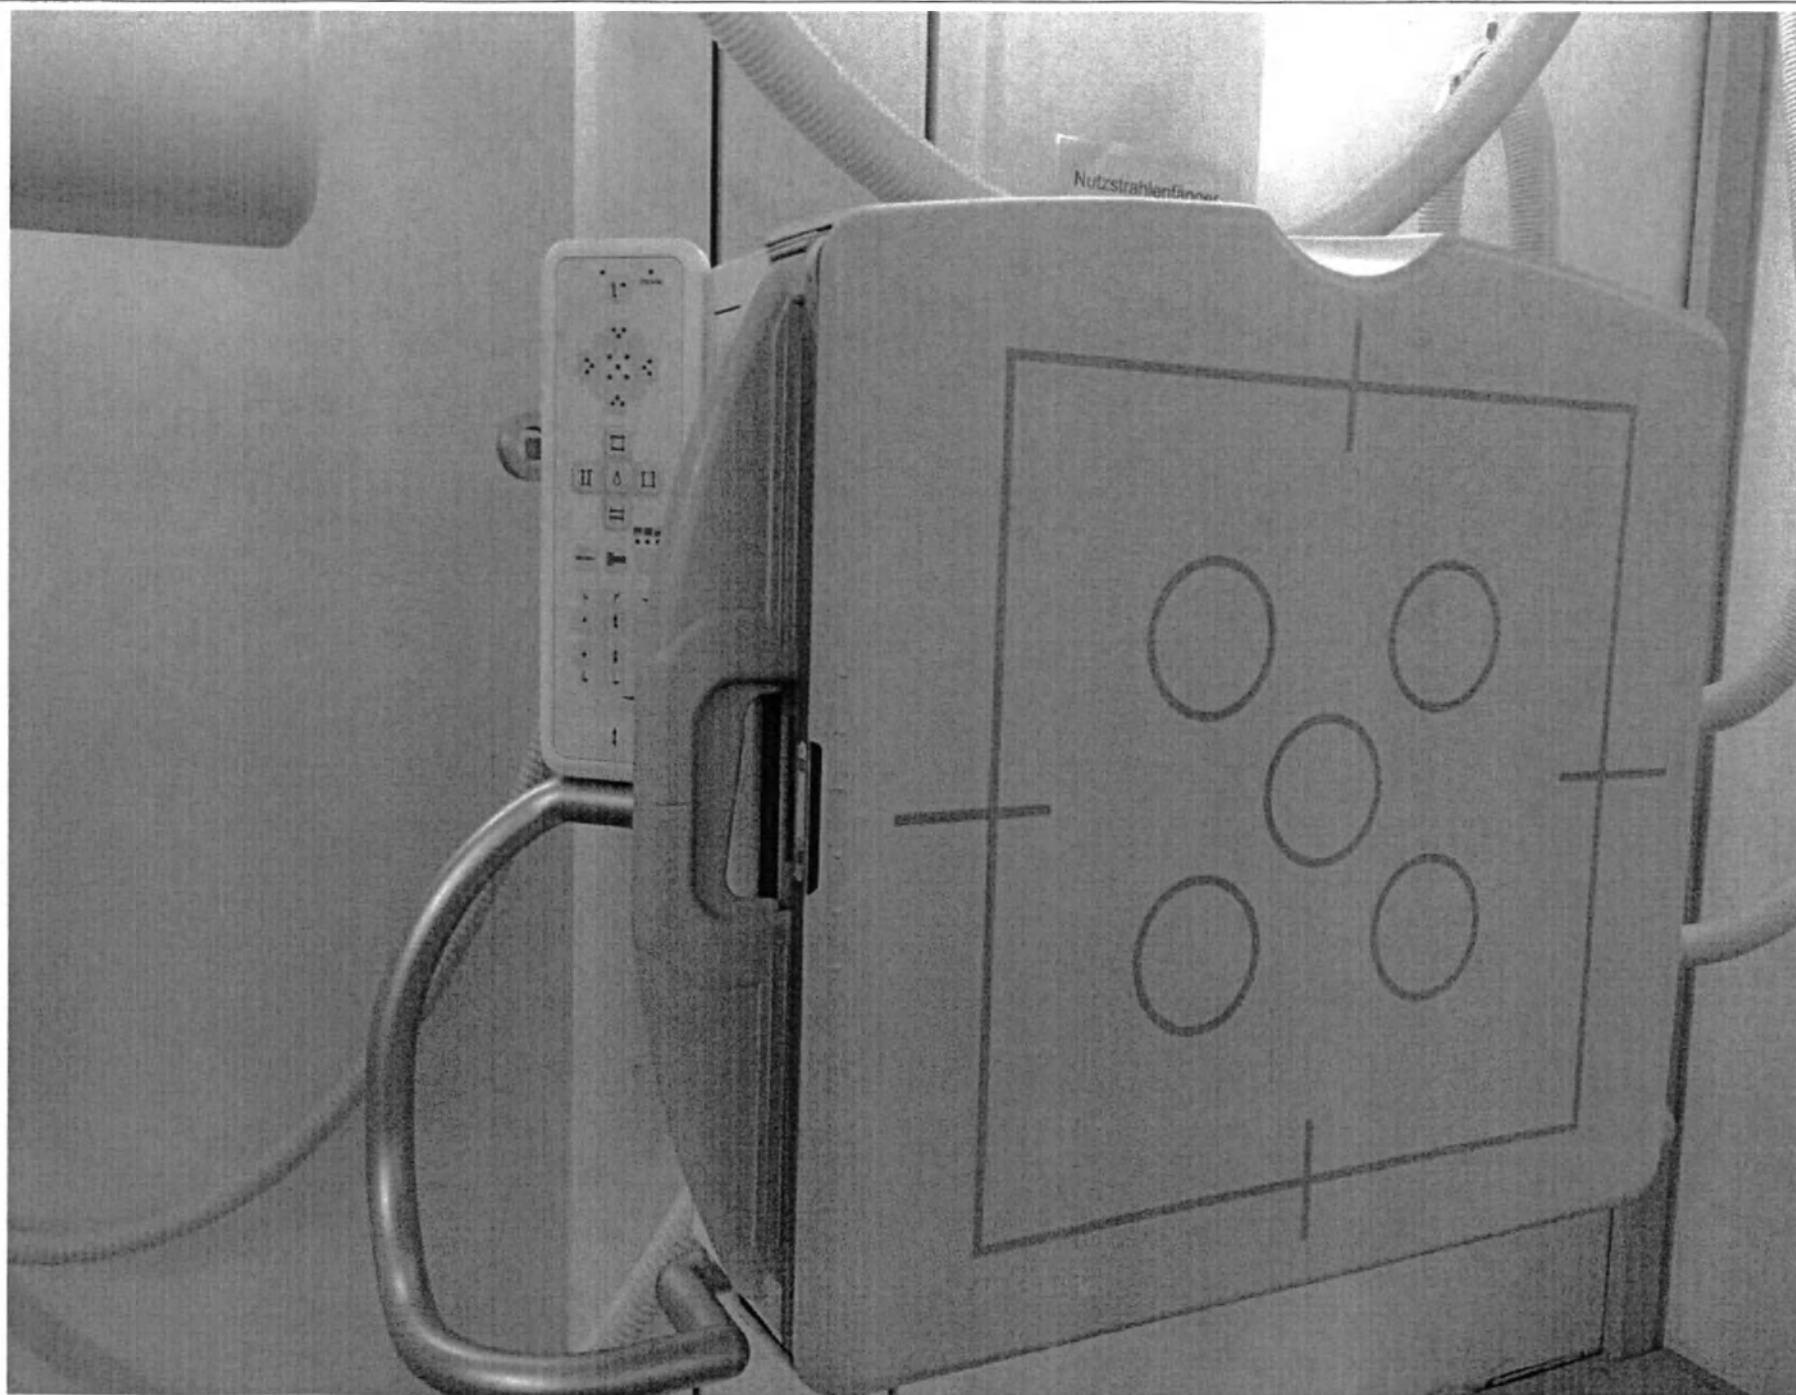

4. Лоток для детектора (только для Вертикальная стойка VS с лотком для беспроводного детектора).

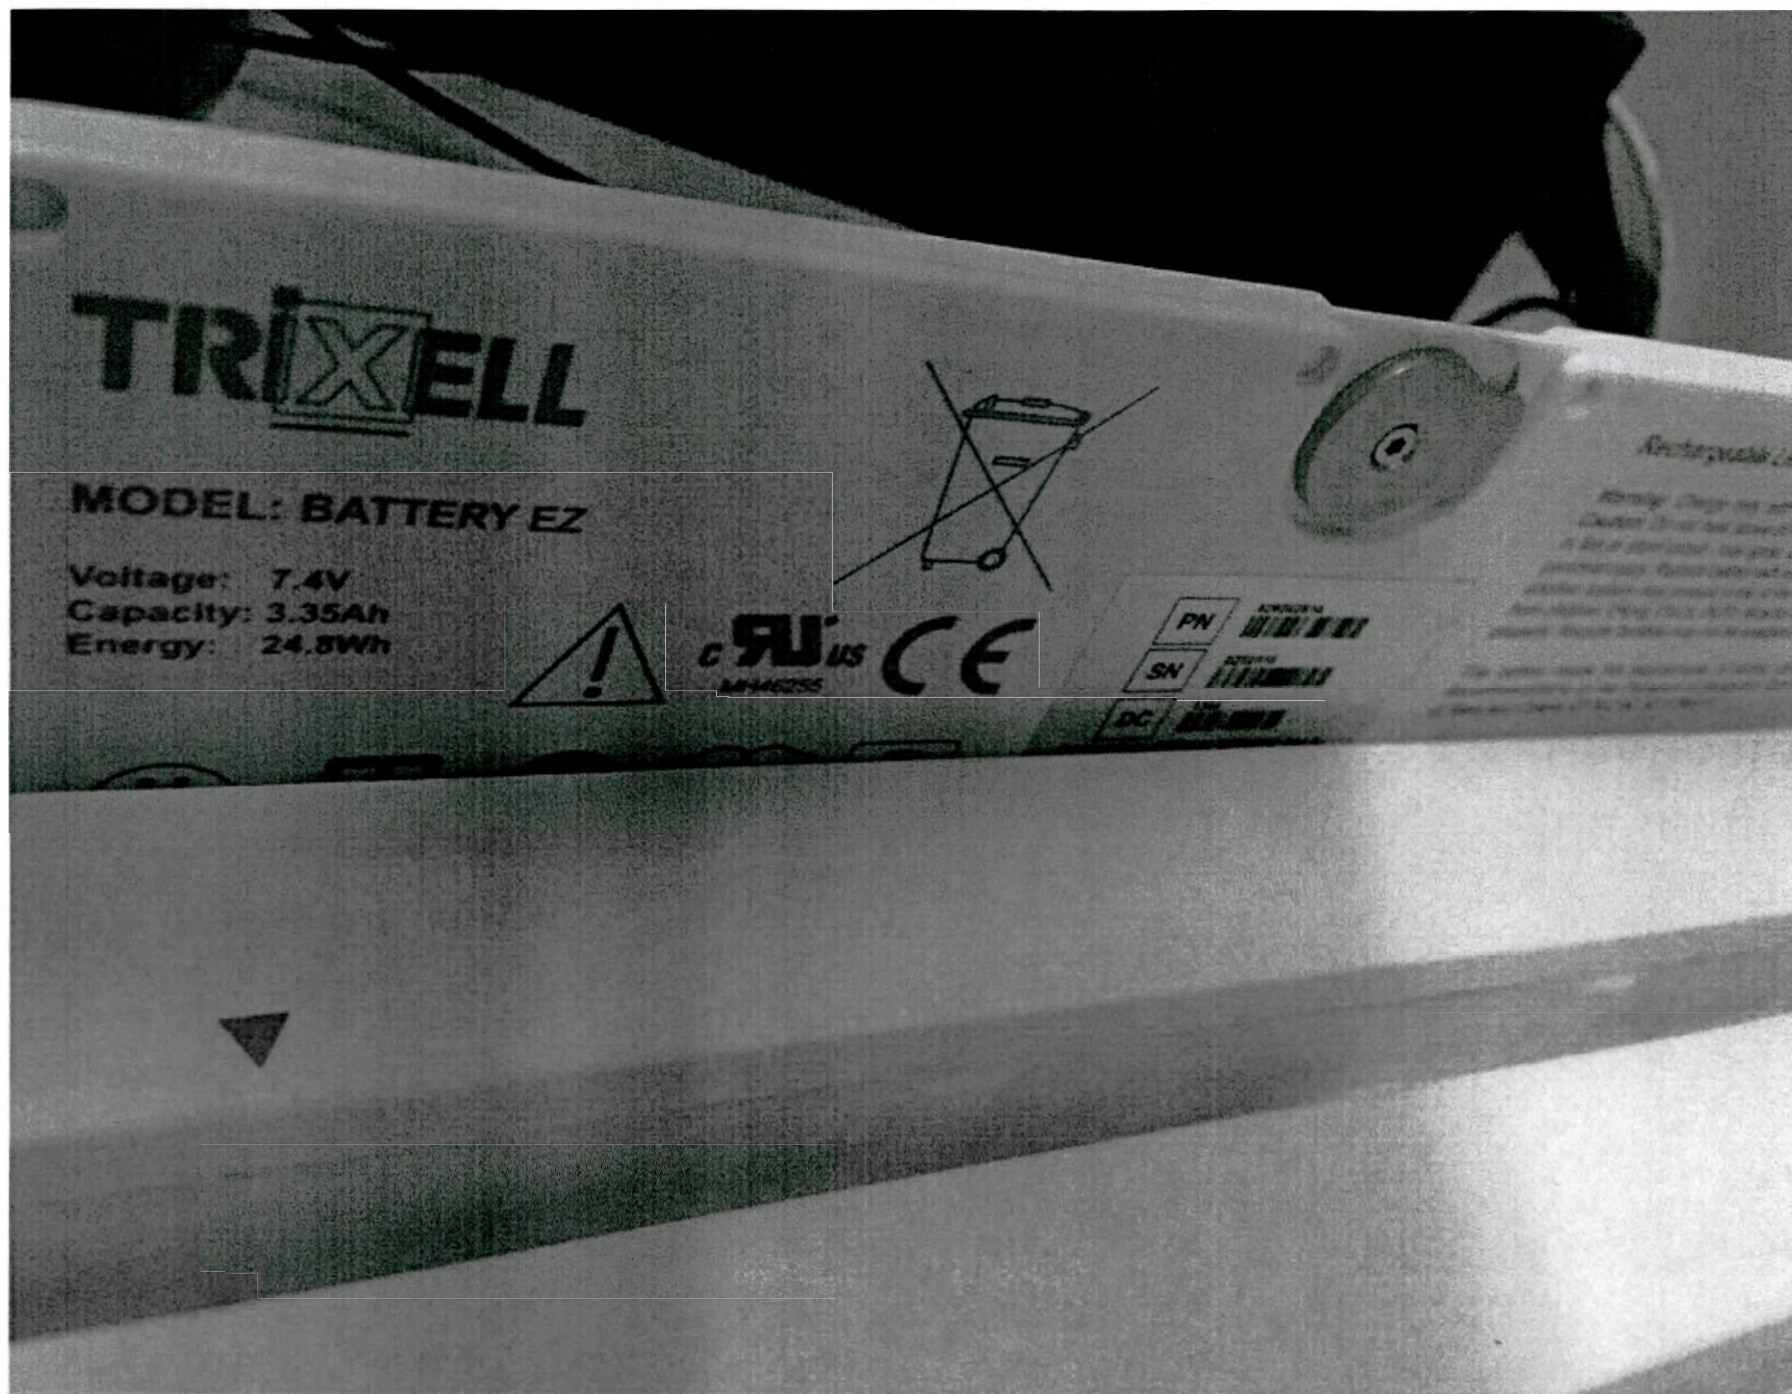

5. Аккумулятор детектора.

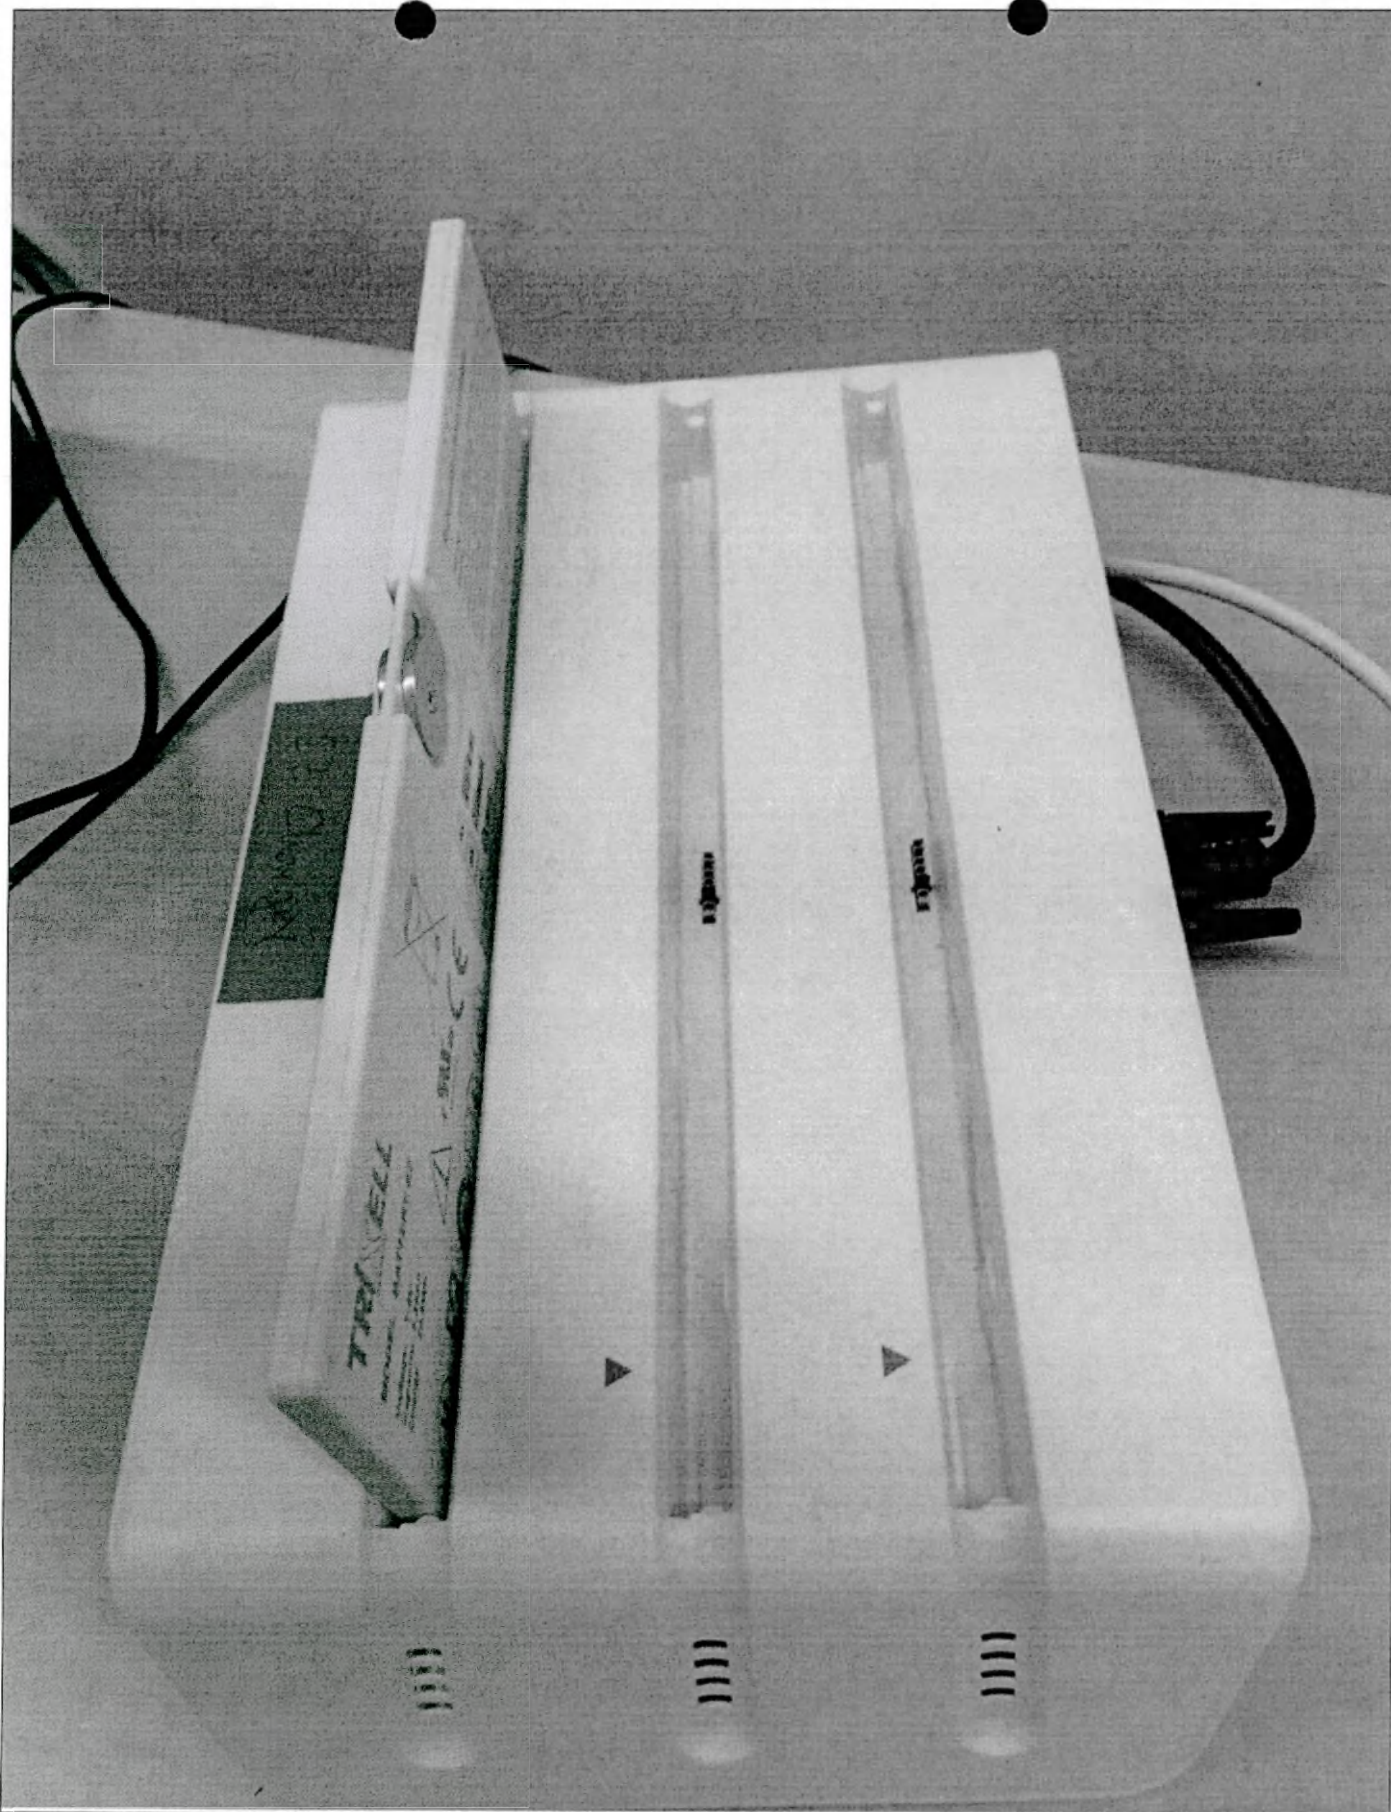

6. Зарядное устройство для аккумуляторов детектора.




7. Отсеивающая горизонтальная решетка 35x43 см.




8. Отсеивающая вертикальная решетка 35x43 см.




9. Отсеивающая вертикальная решетка 24x30 см.

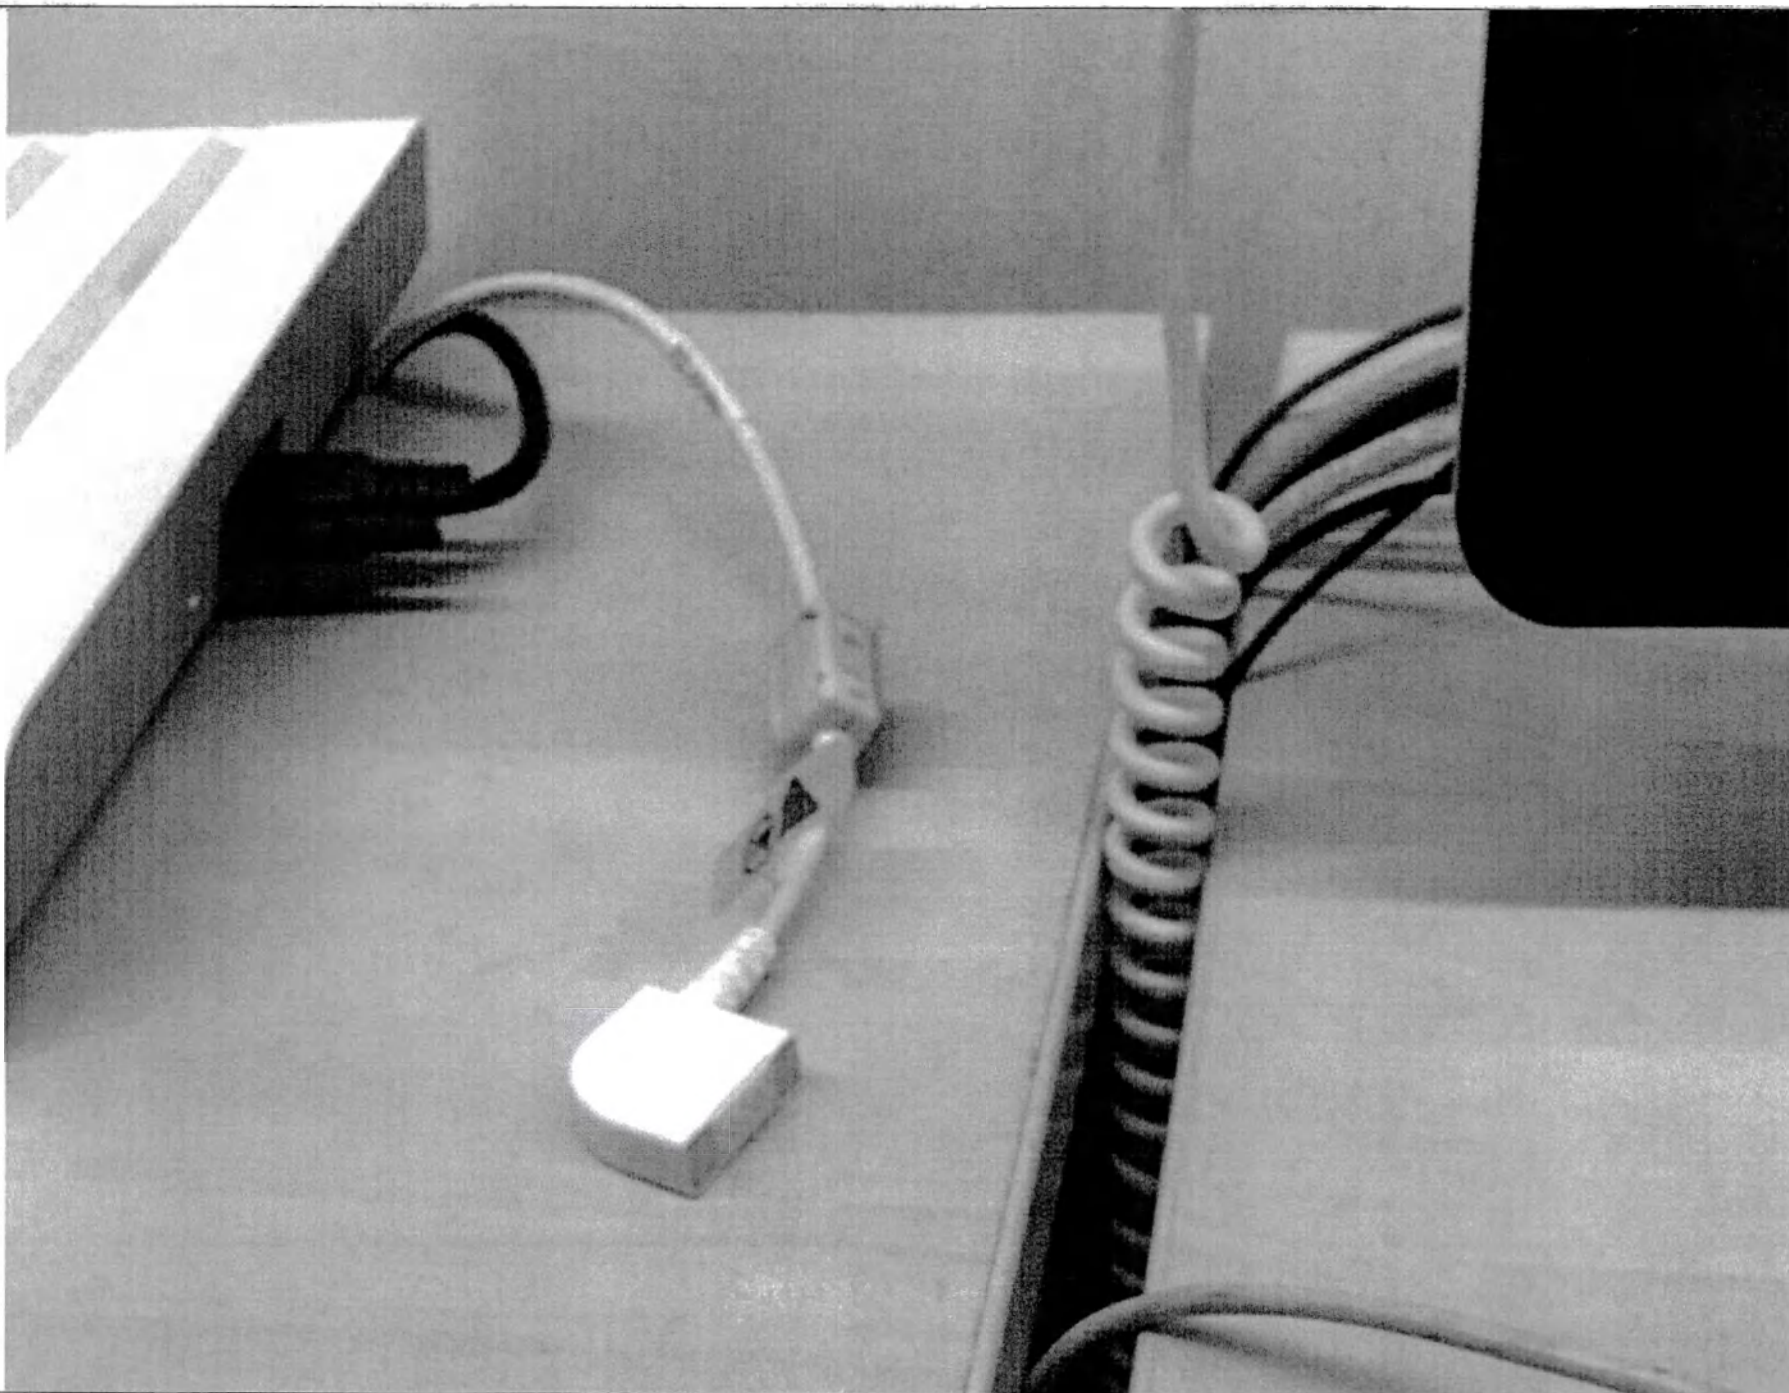


10. Резервный кабель - 2 м.

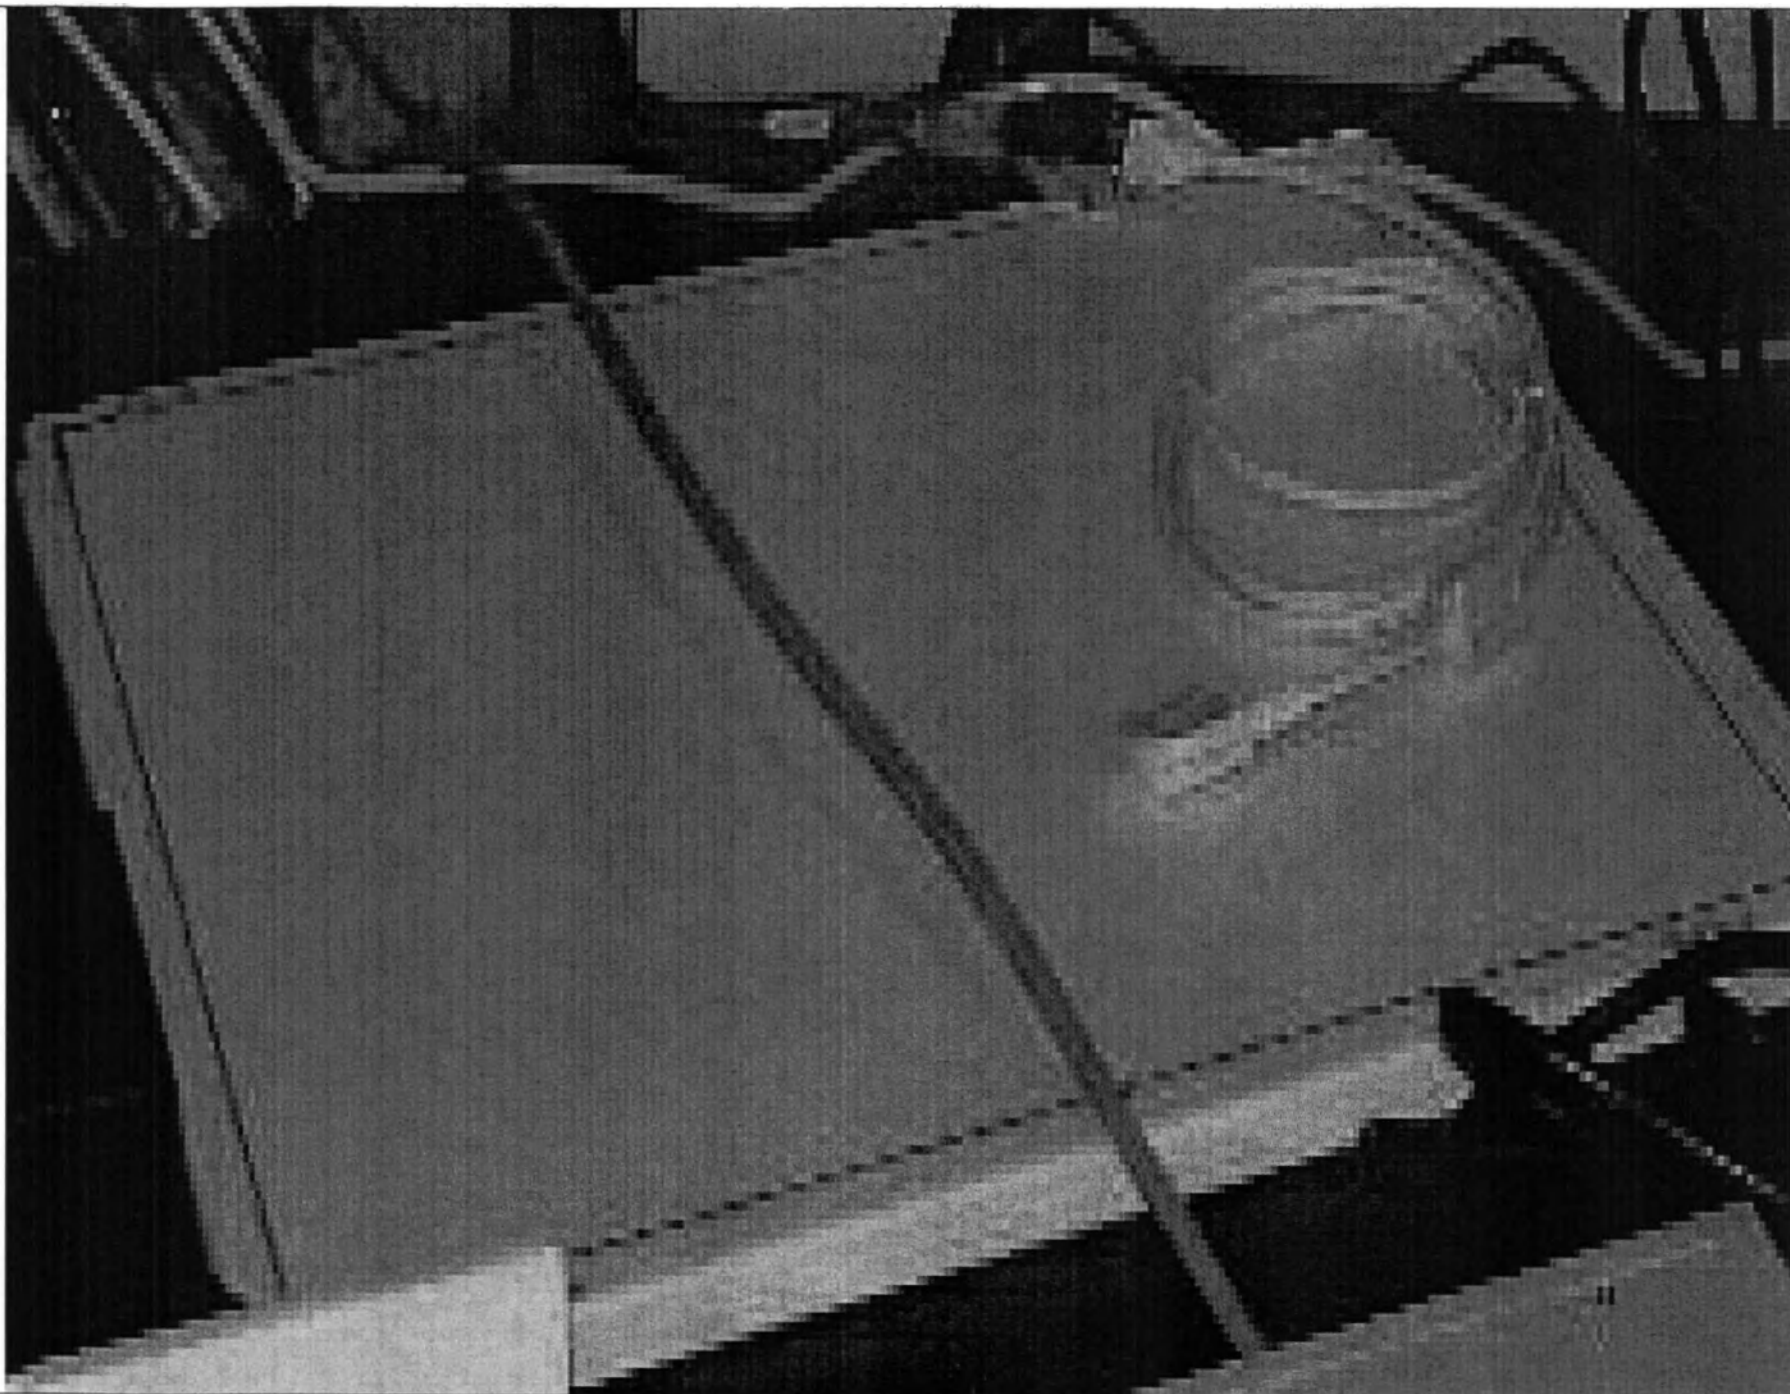


11. Длинный резервный кабель - 7 м.

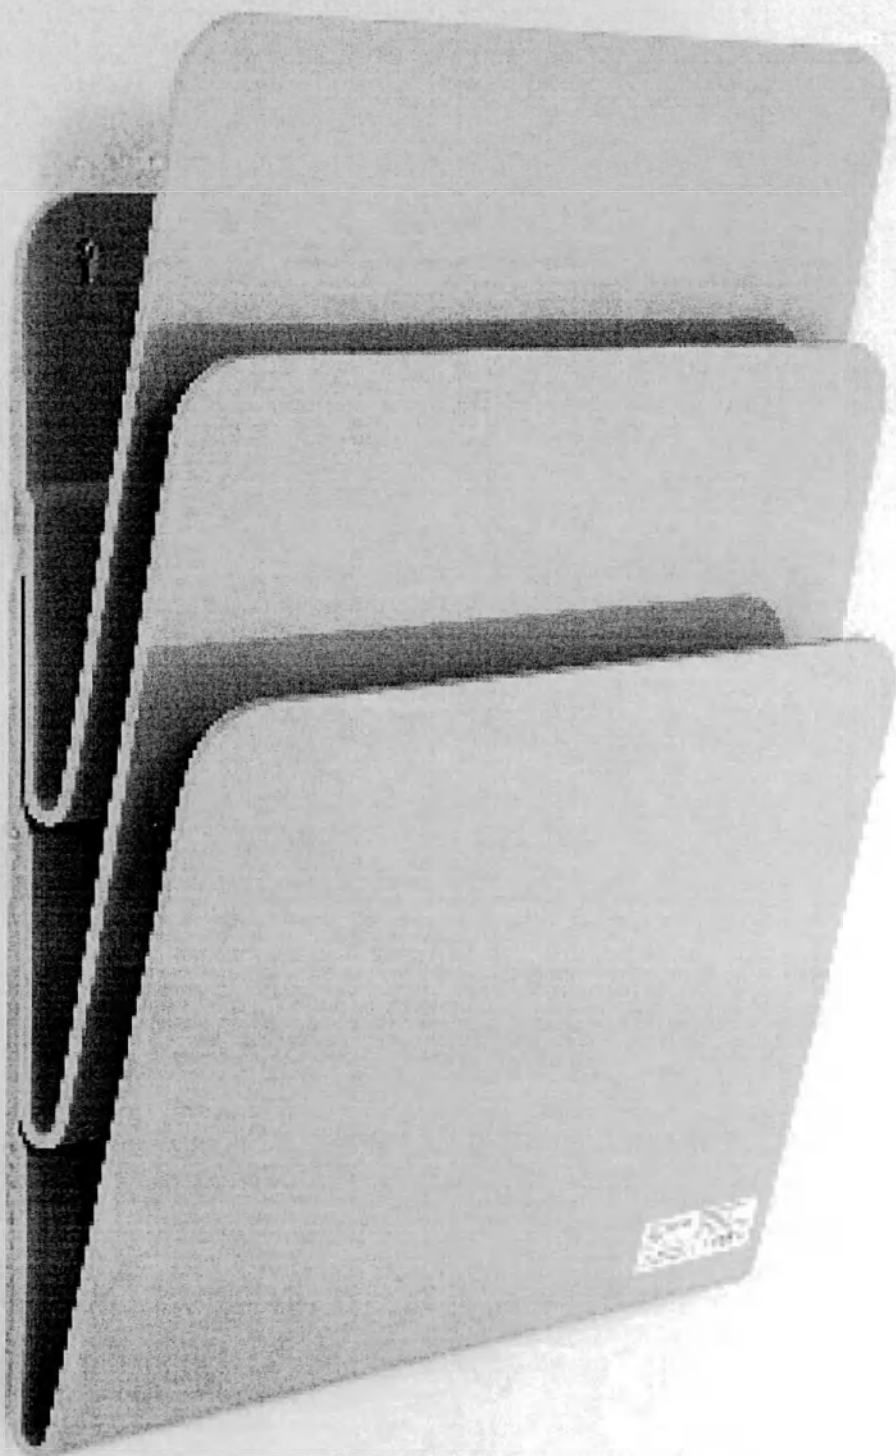


12. Блок хранения для детекторов и решеток.

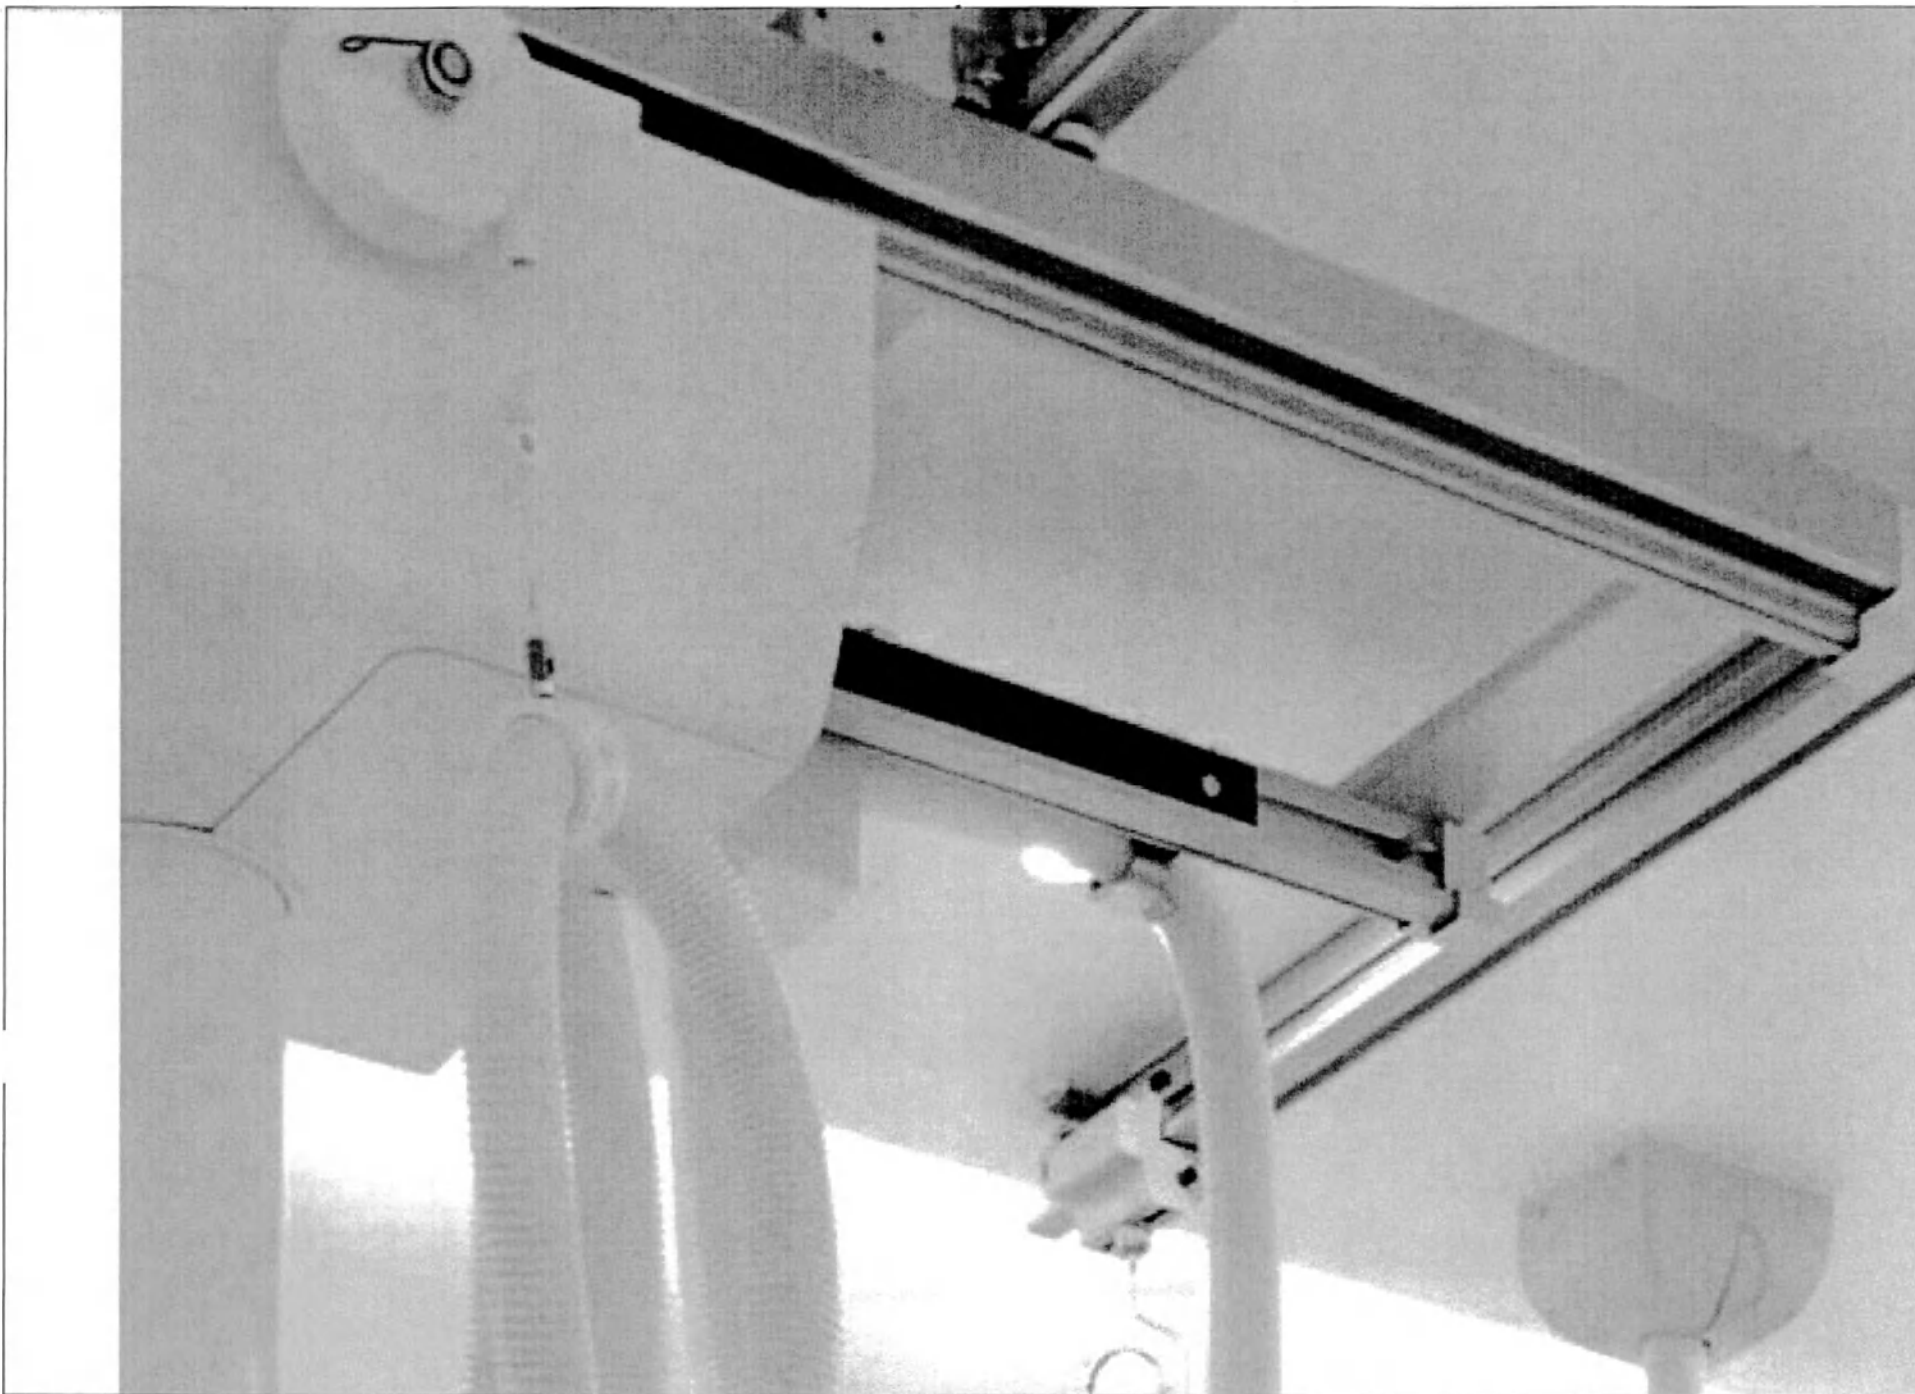


13. Рельсы для кабелепровода.

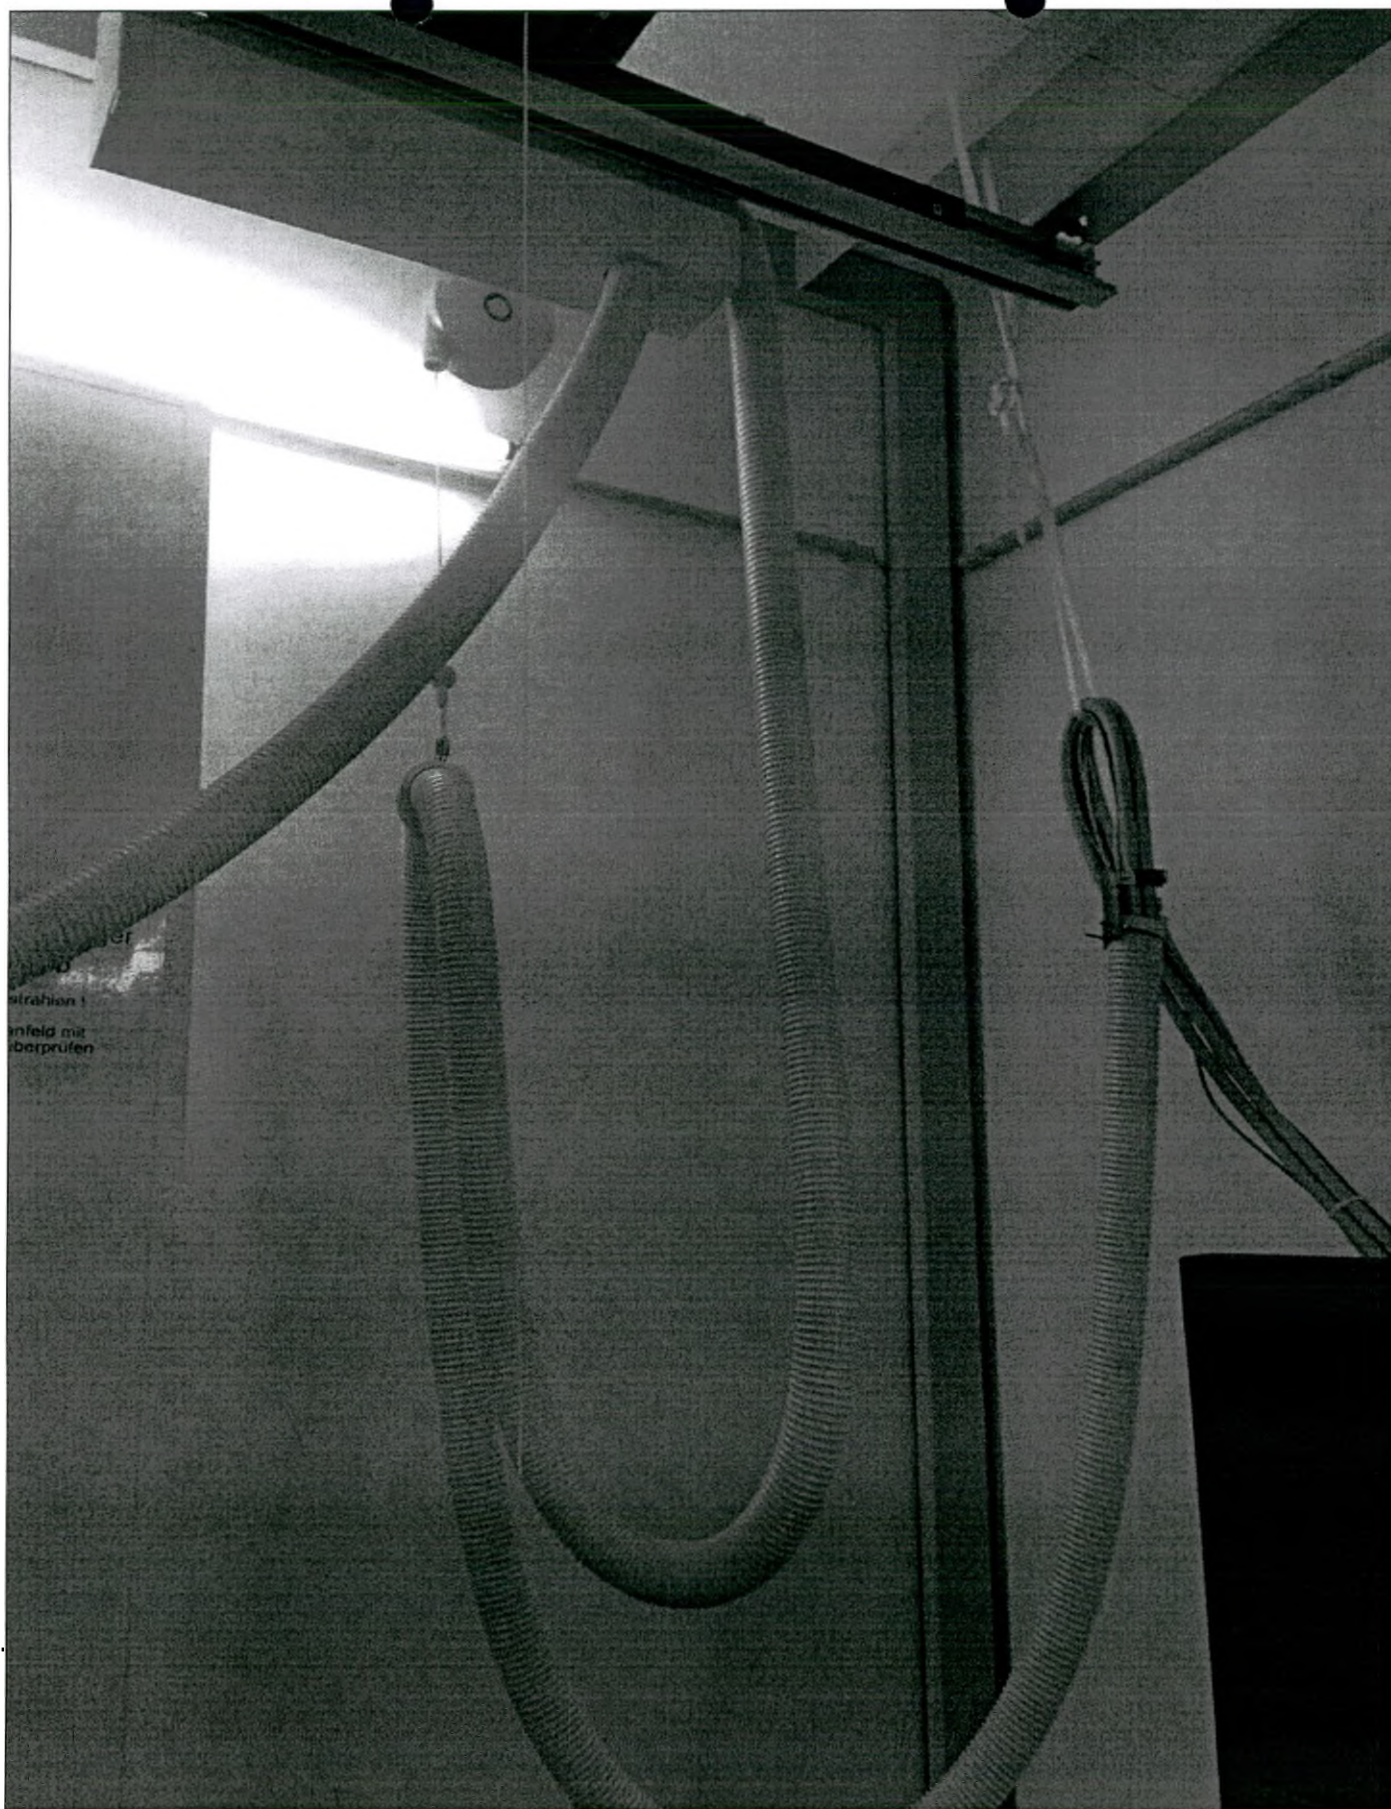


14. Кабелепровод.

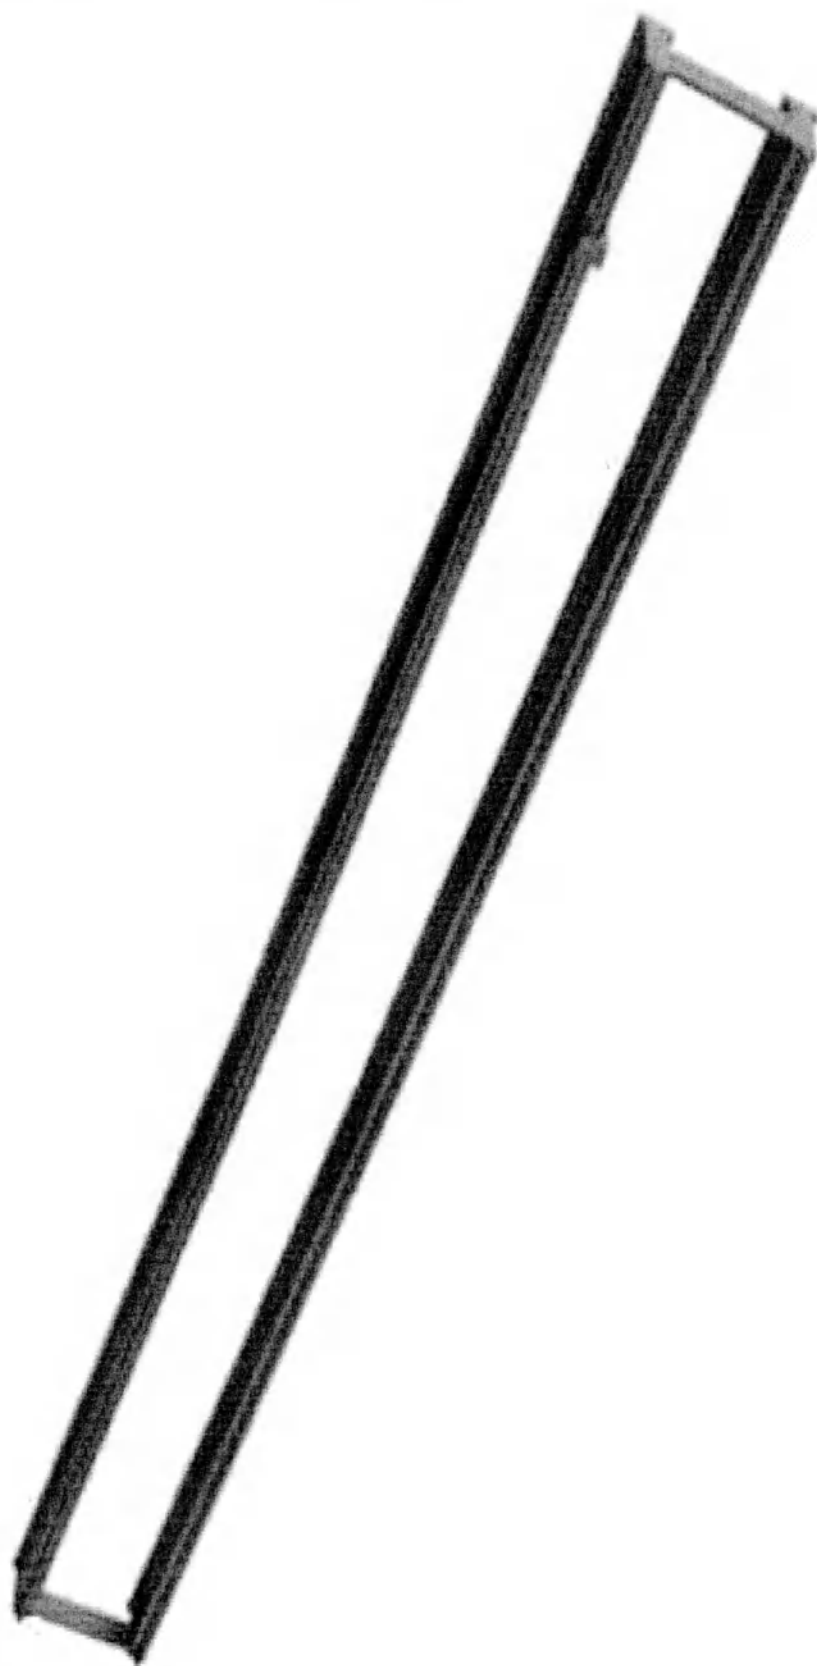


15. Удлинительная секция рельсов.

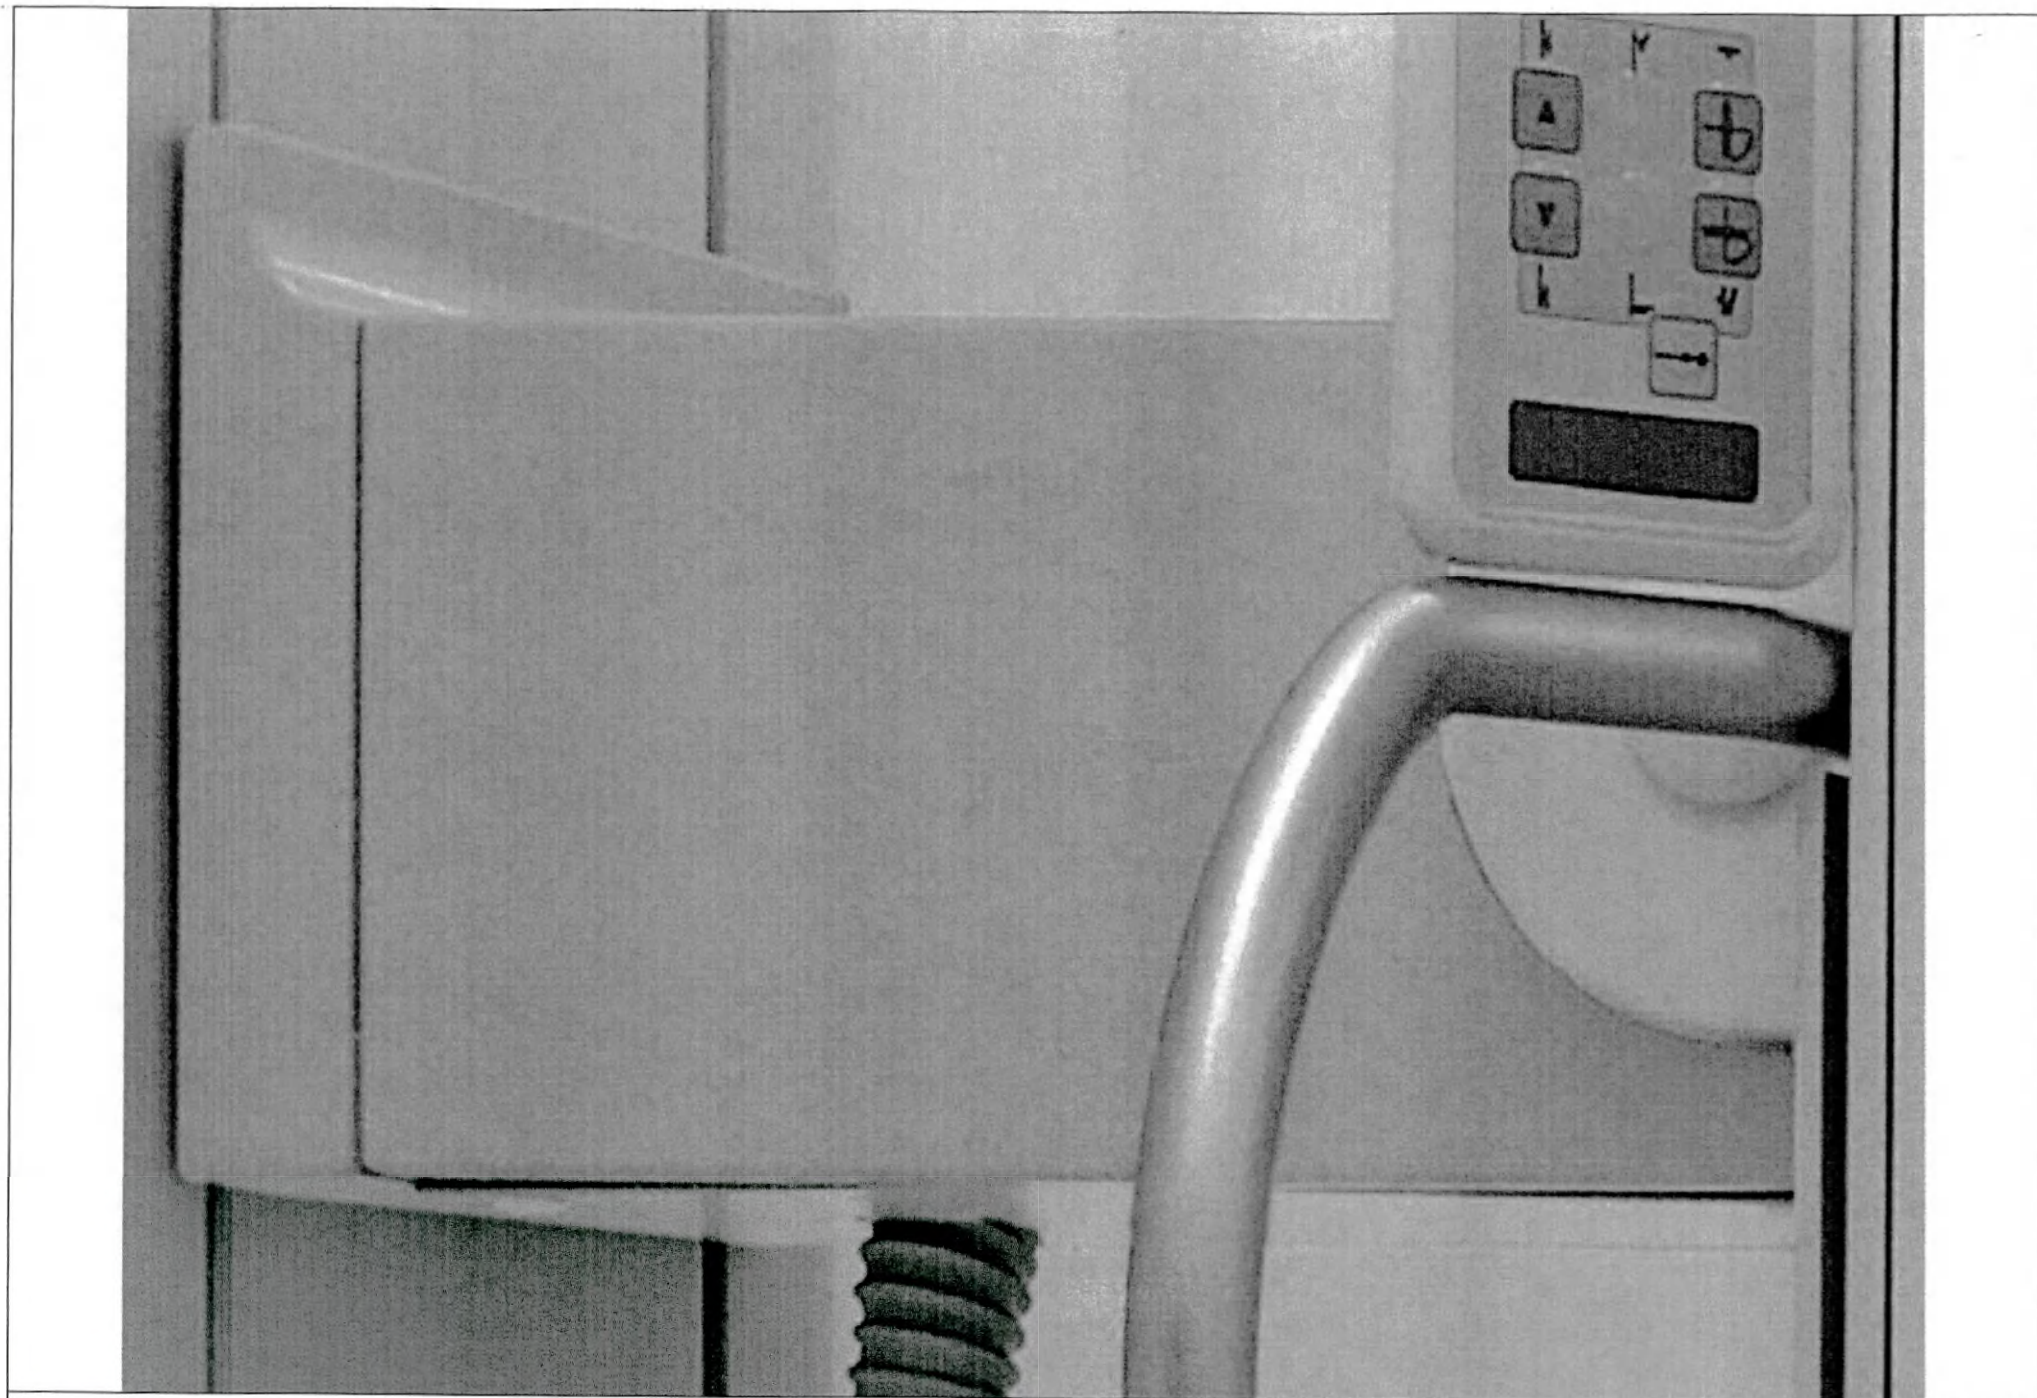


16. Спейсер.

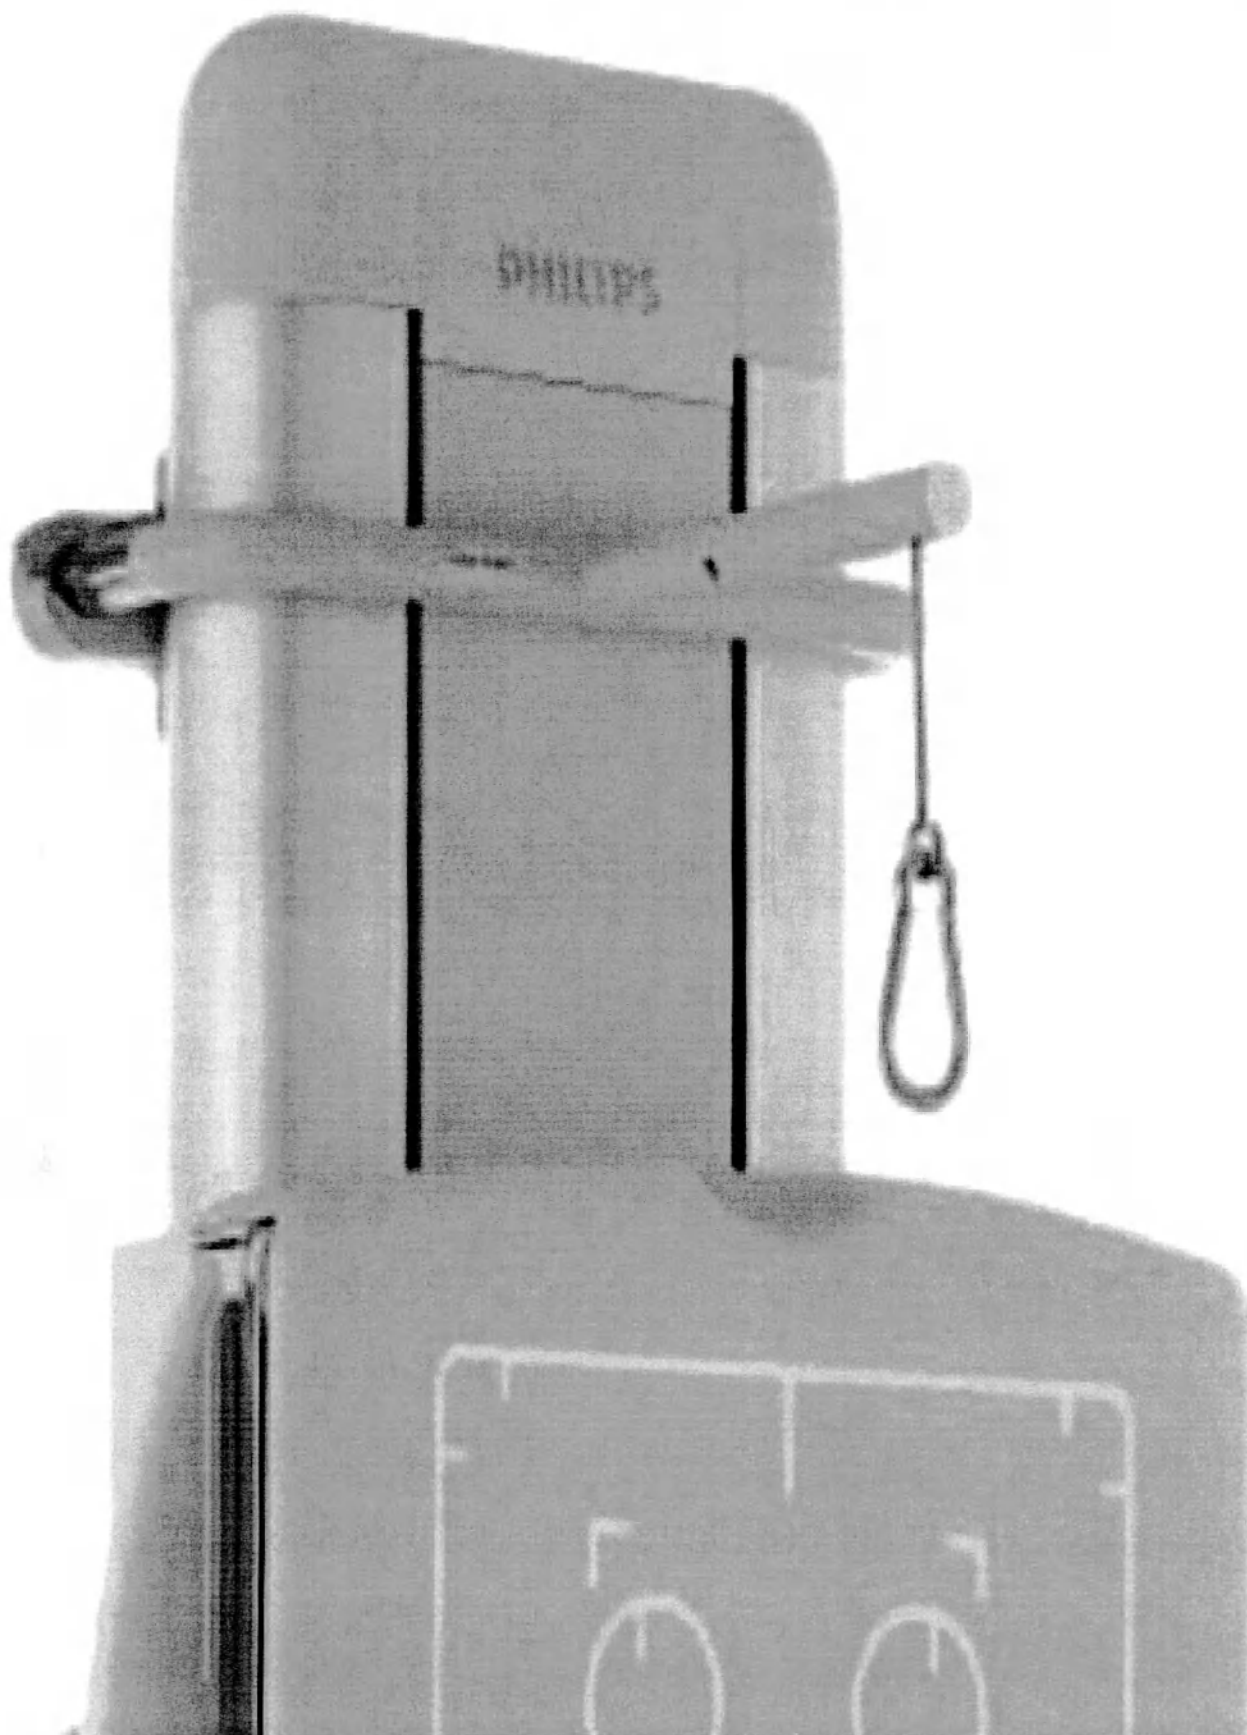


17. Держатель Babix.

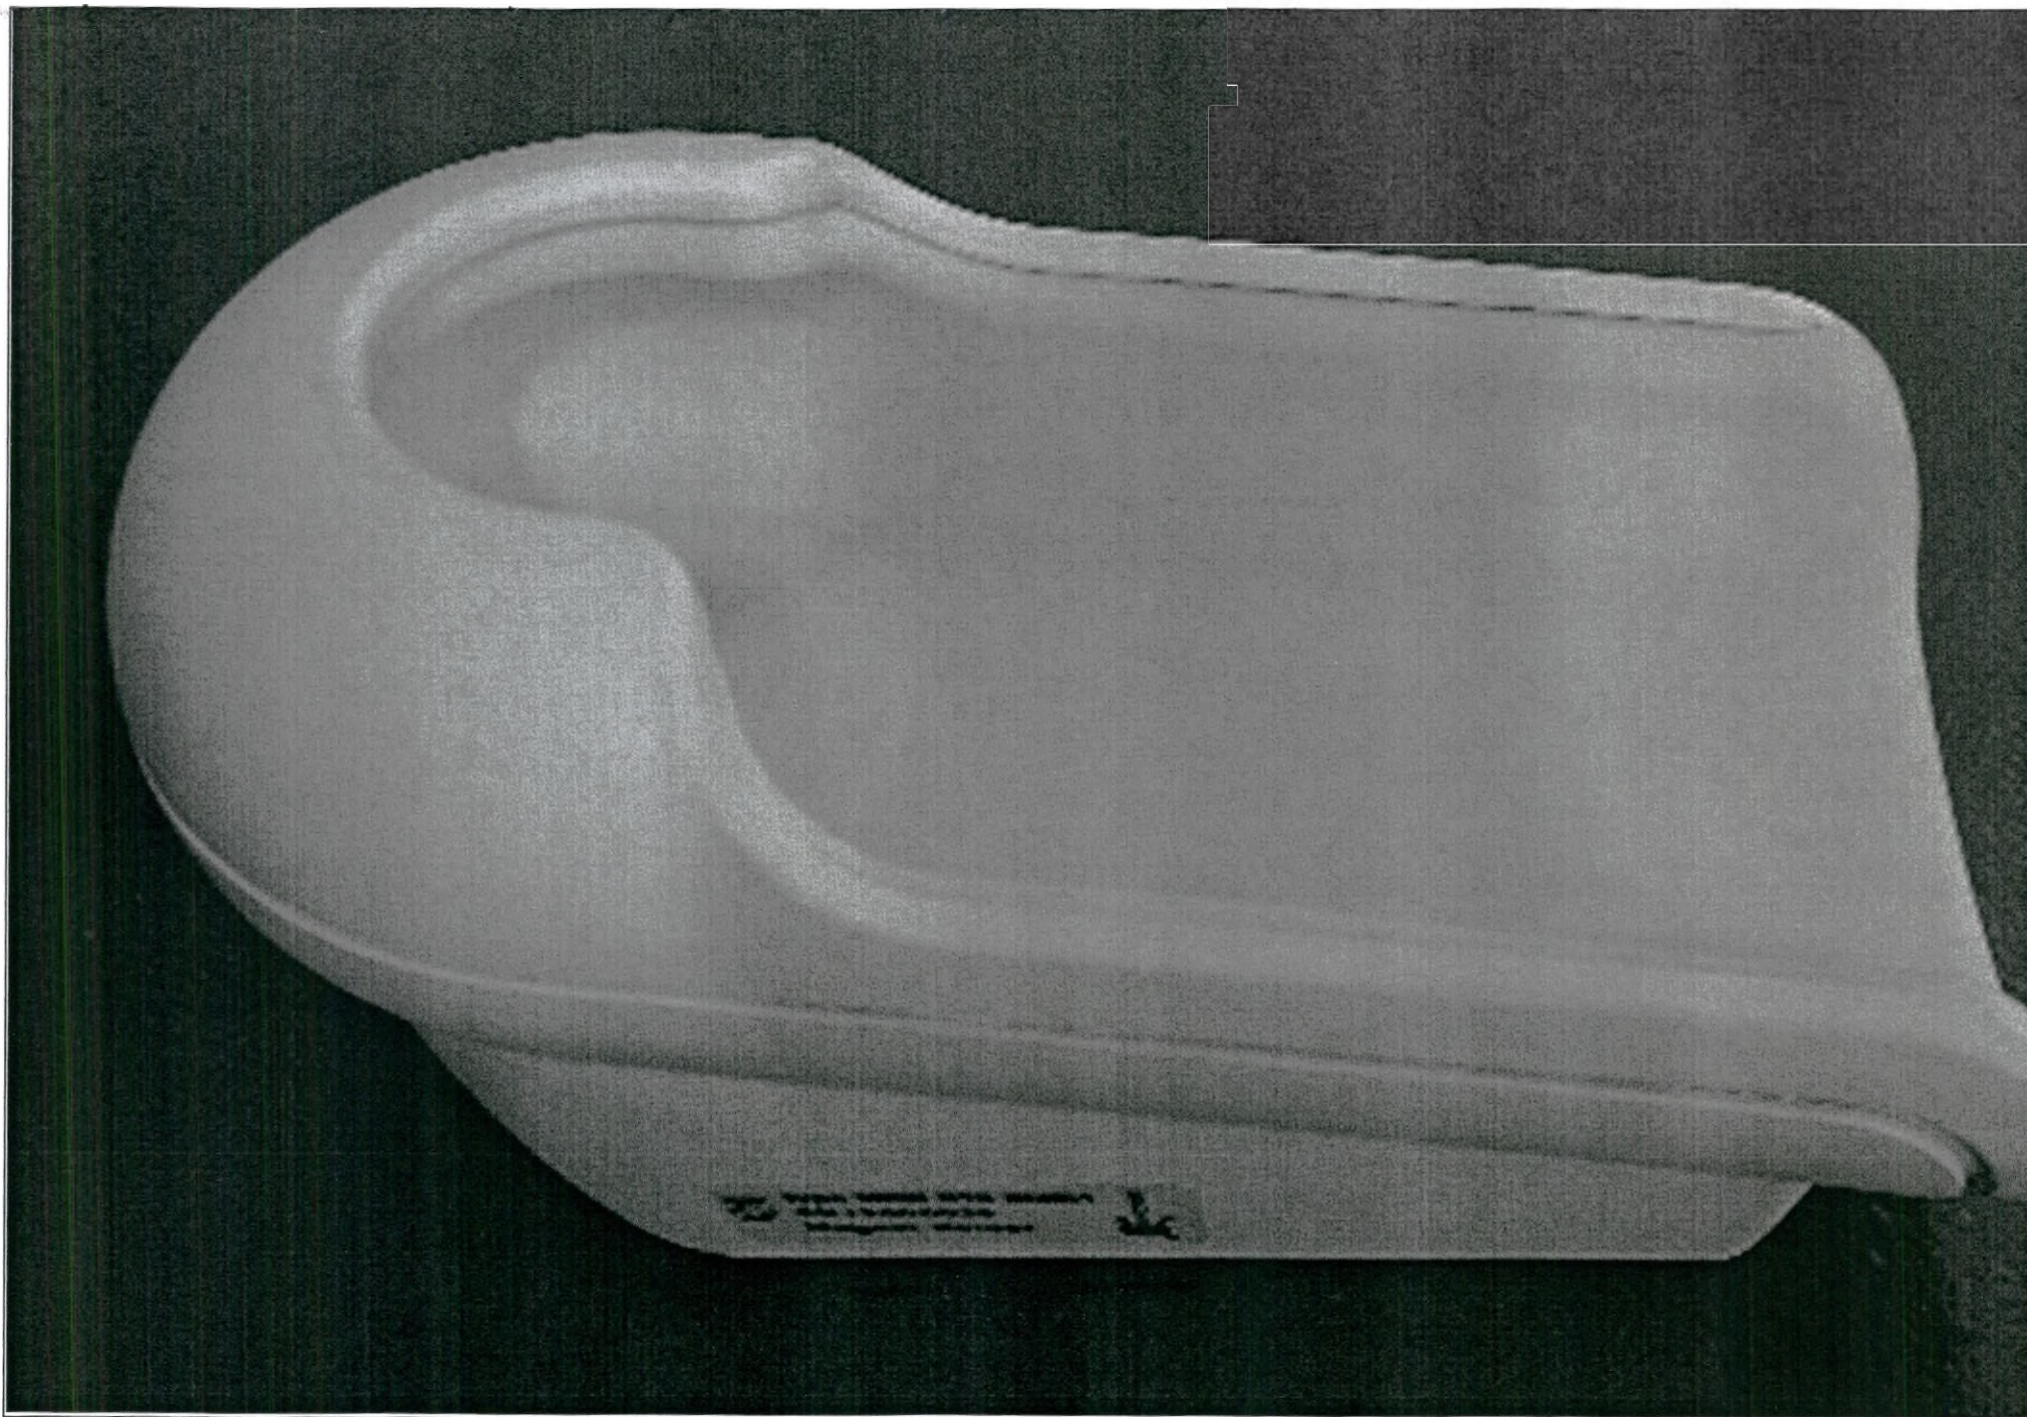


18. Магнитный держатель (для пульта дистанционного управления).

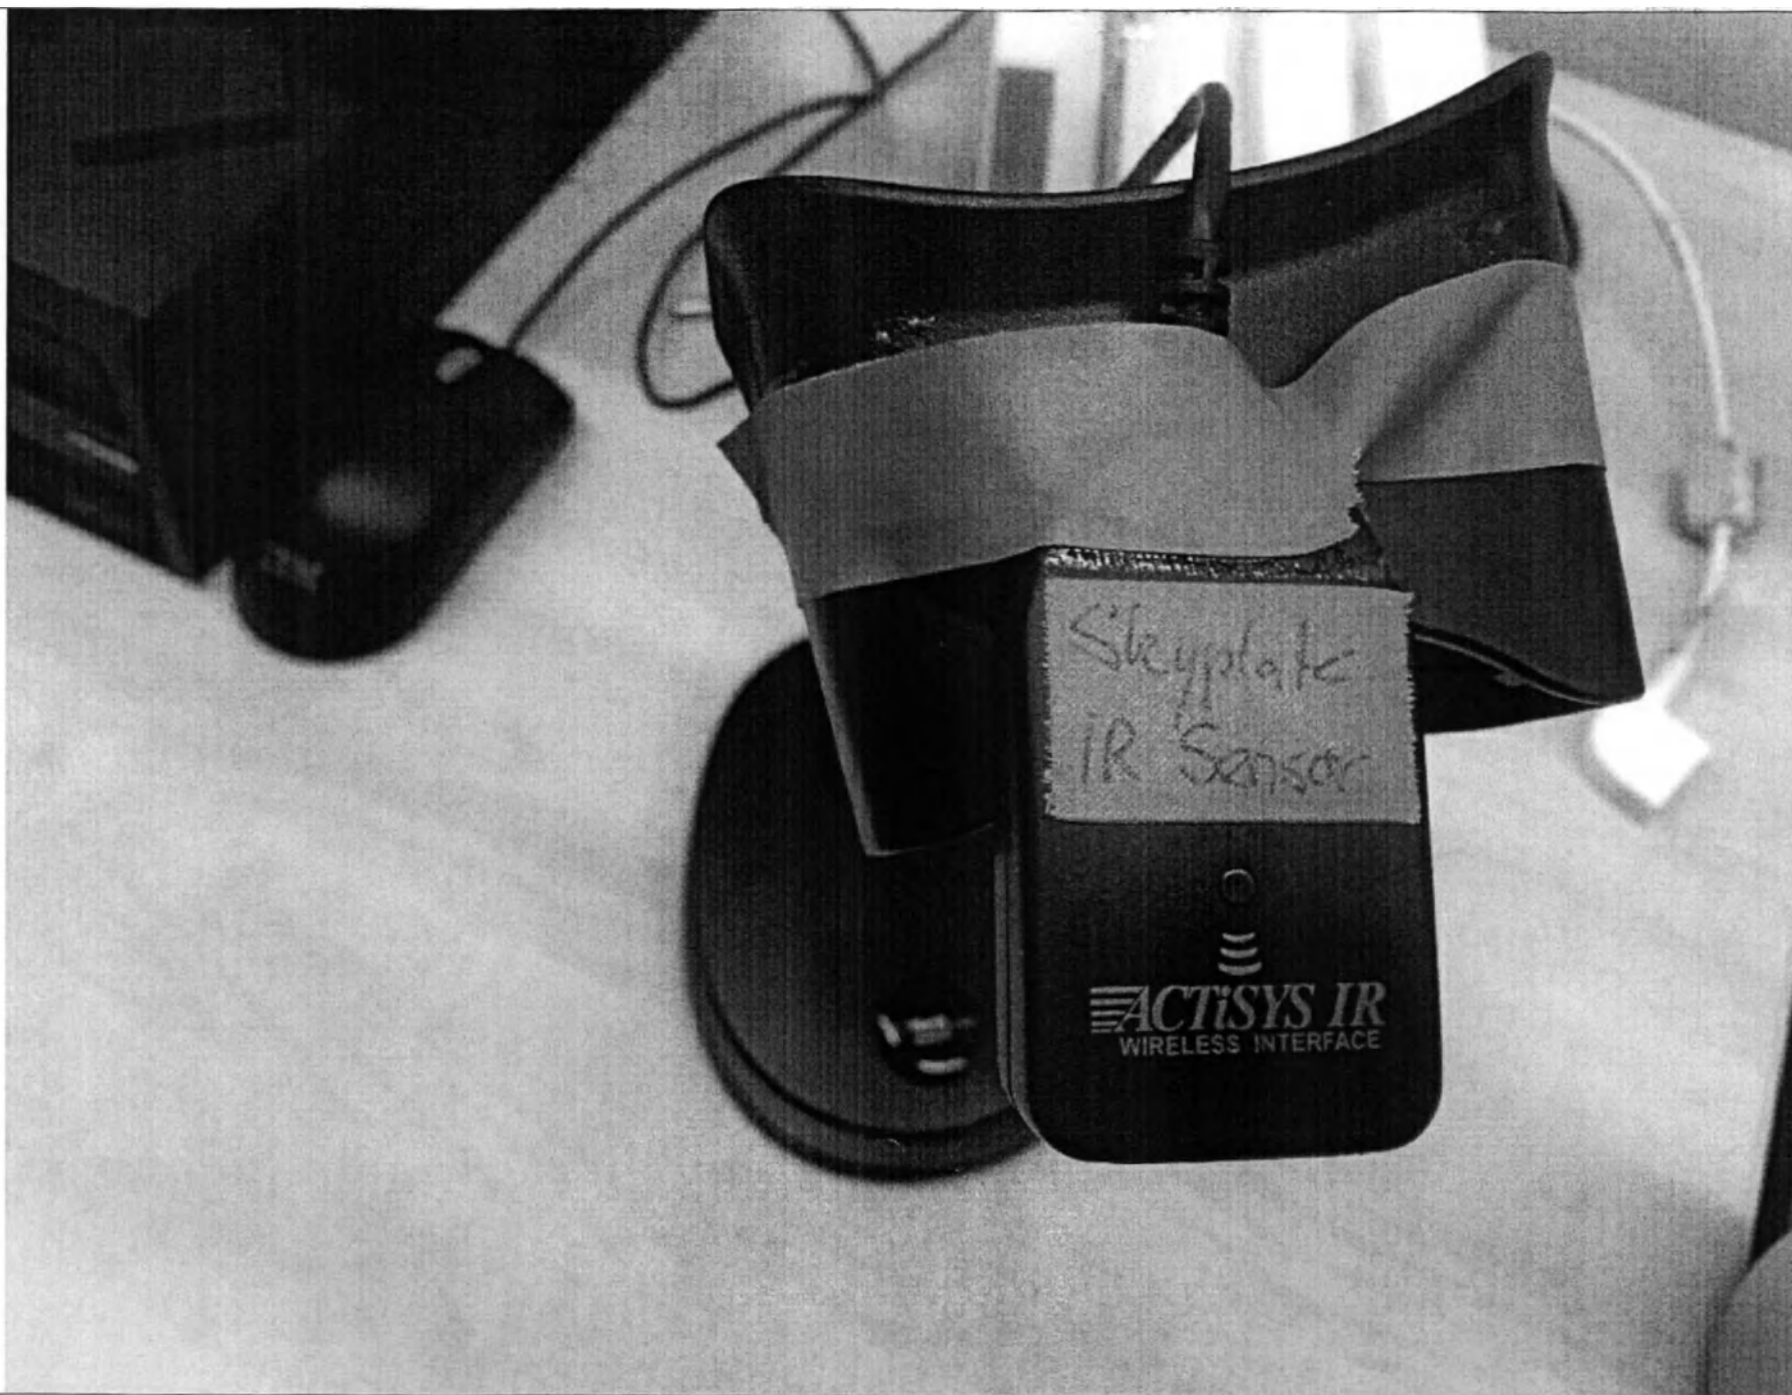


19. ИК-адаптер.

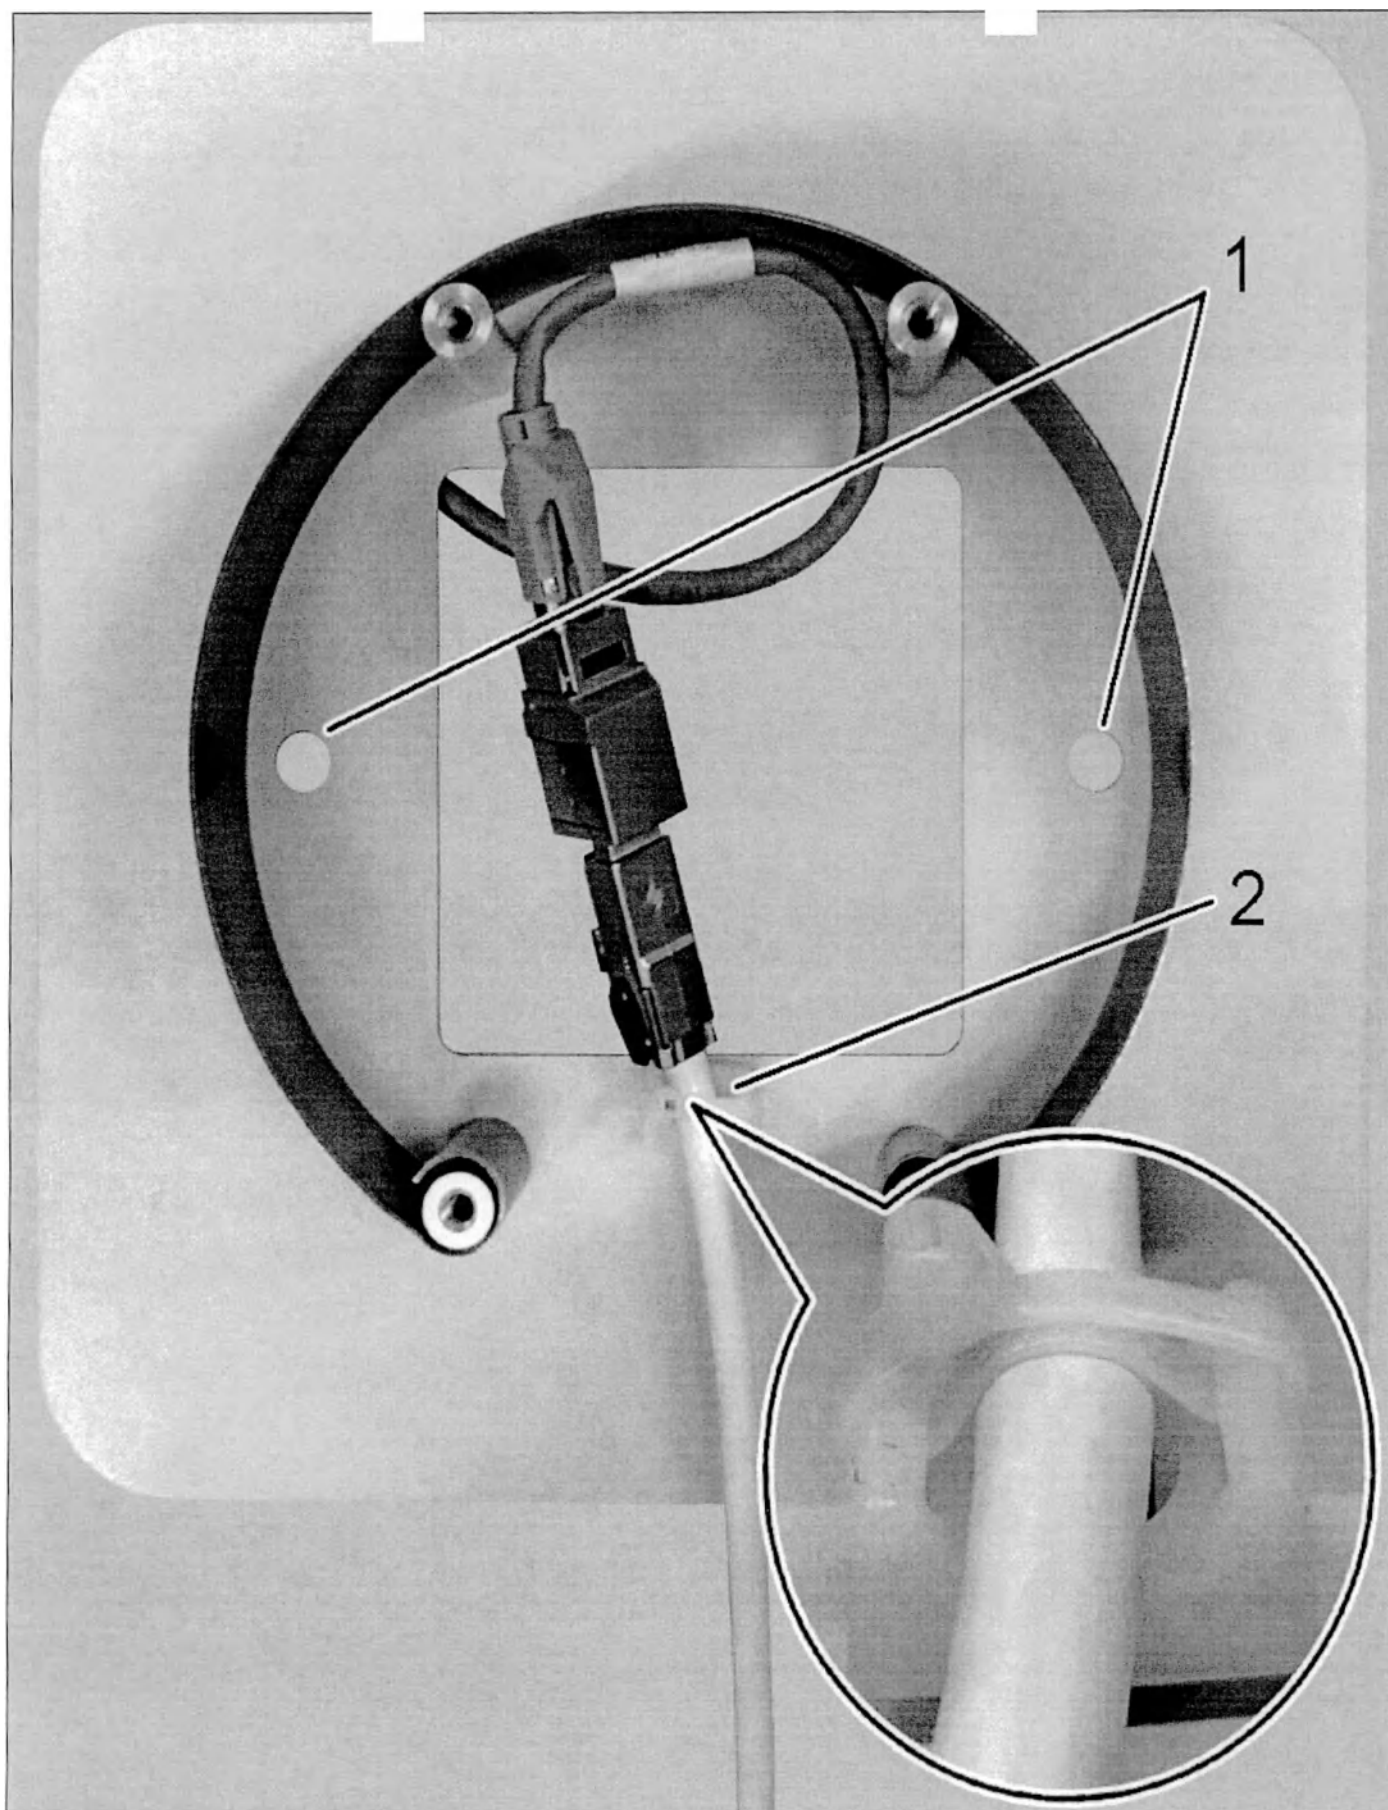

20. Держатель для резервного кабеля (1- отверстия для крепления; 2 – крепление кабеля)

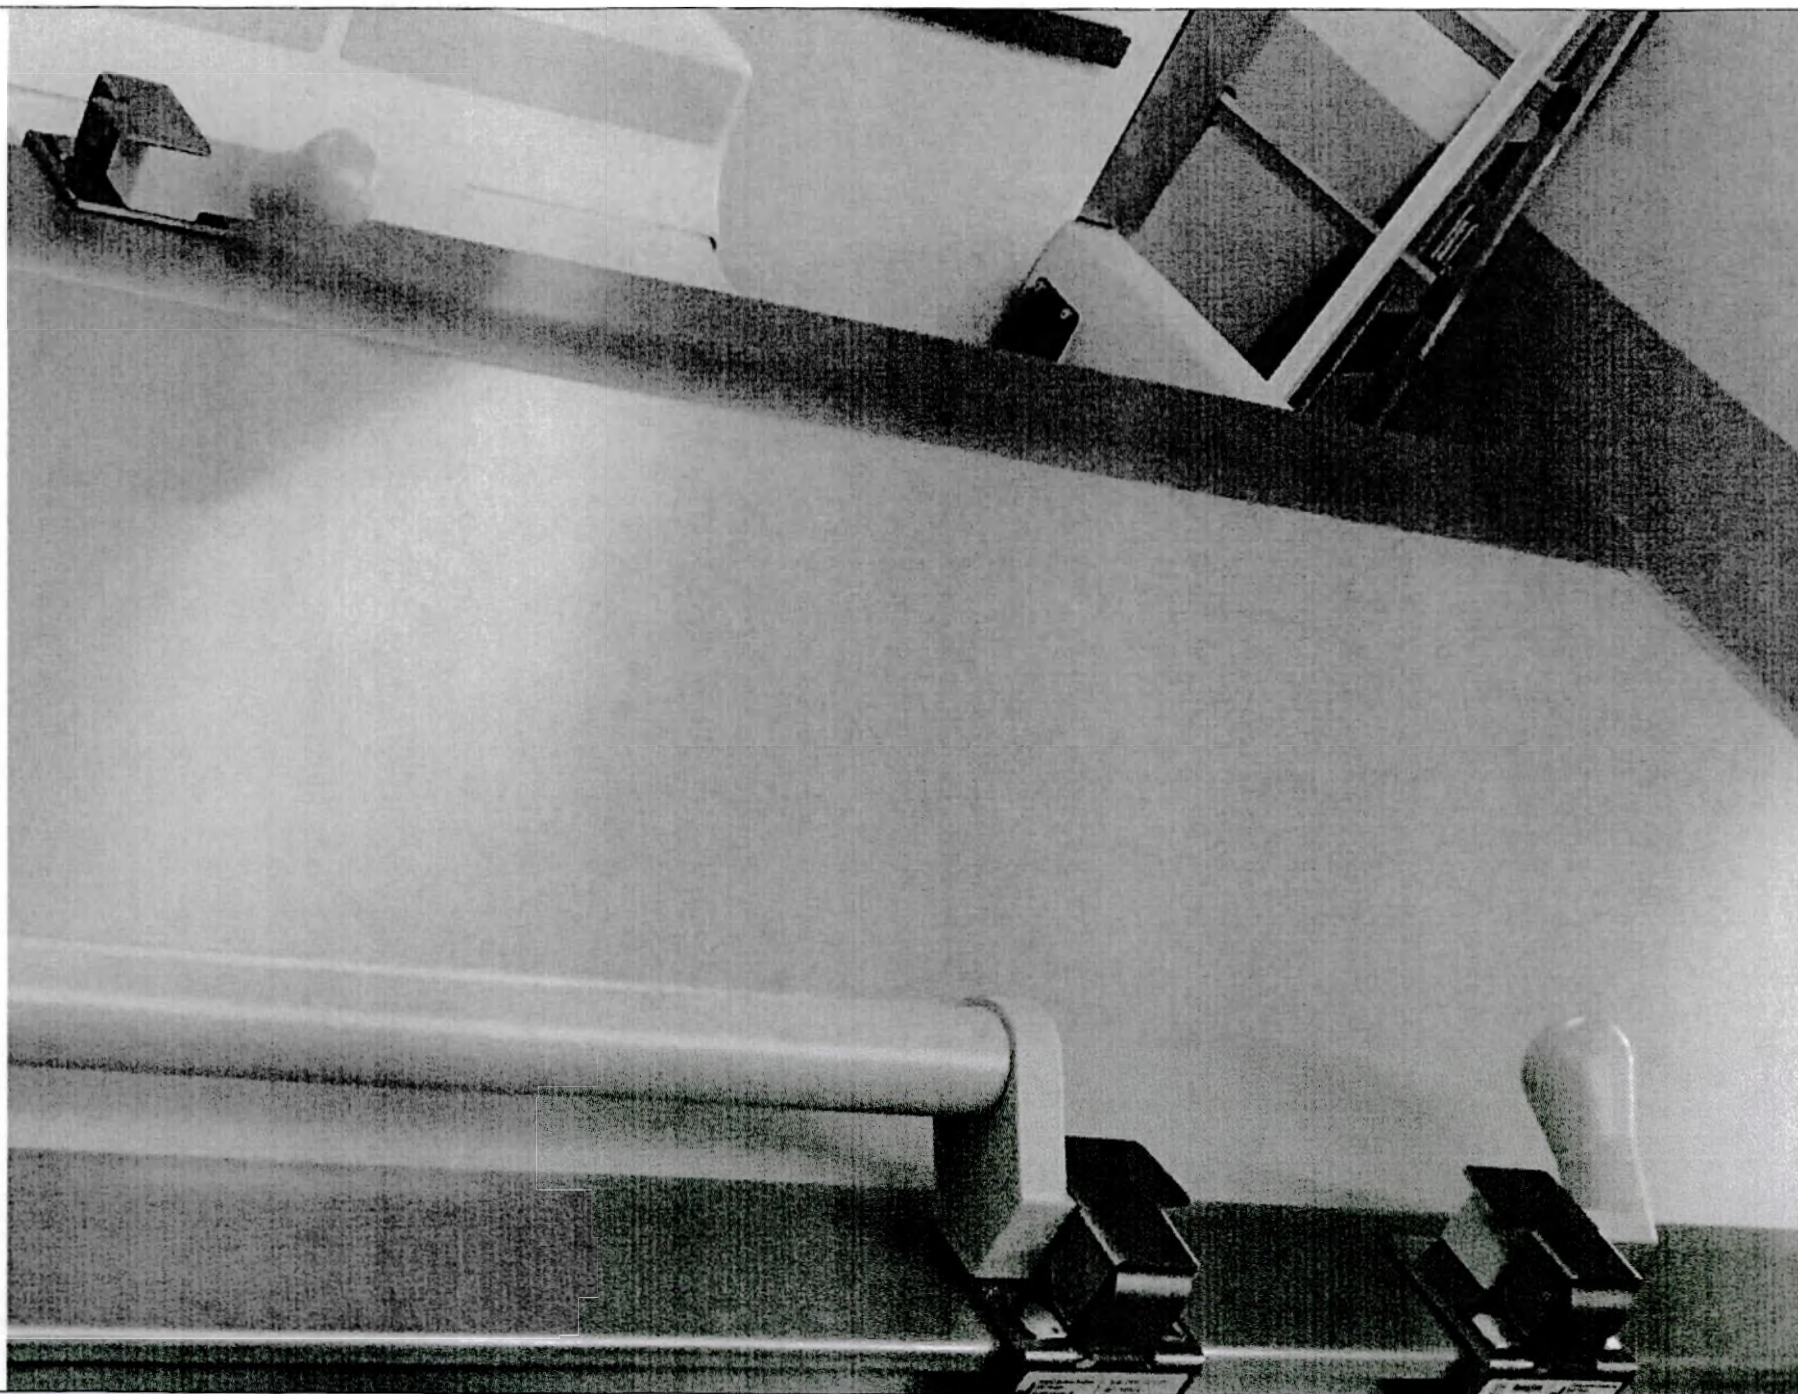


21. Ручки.

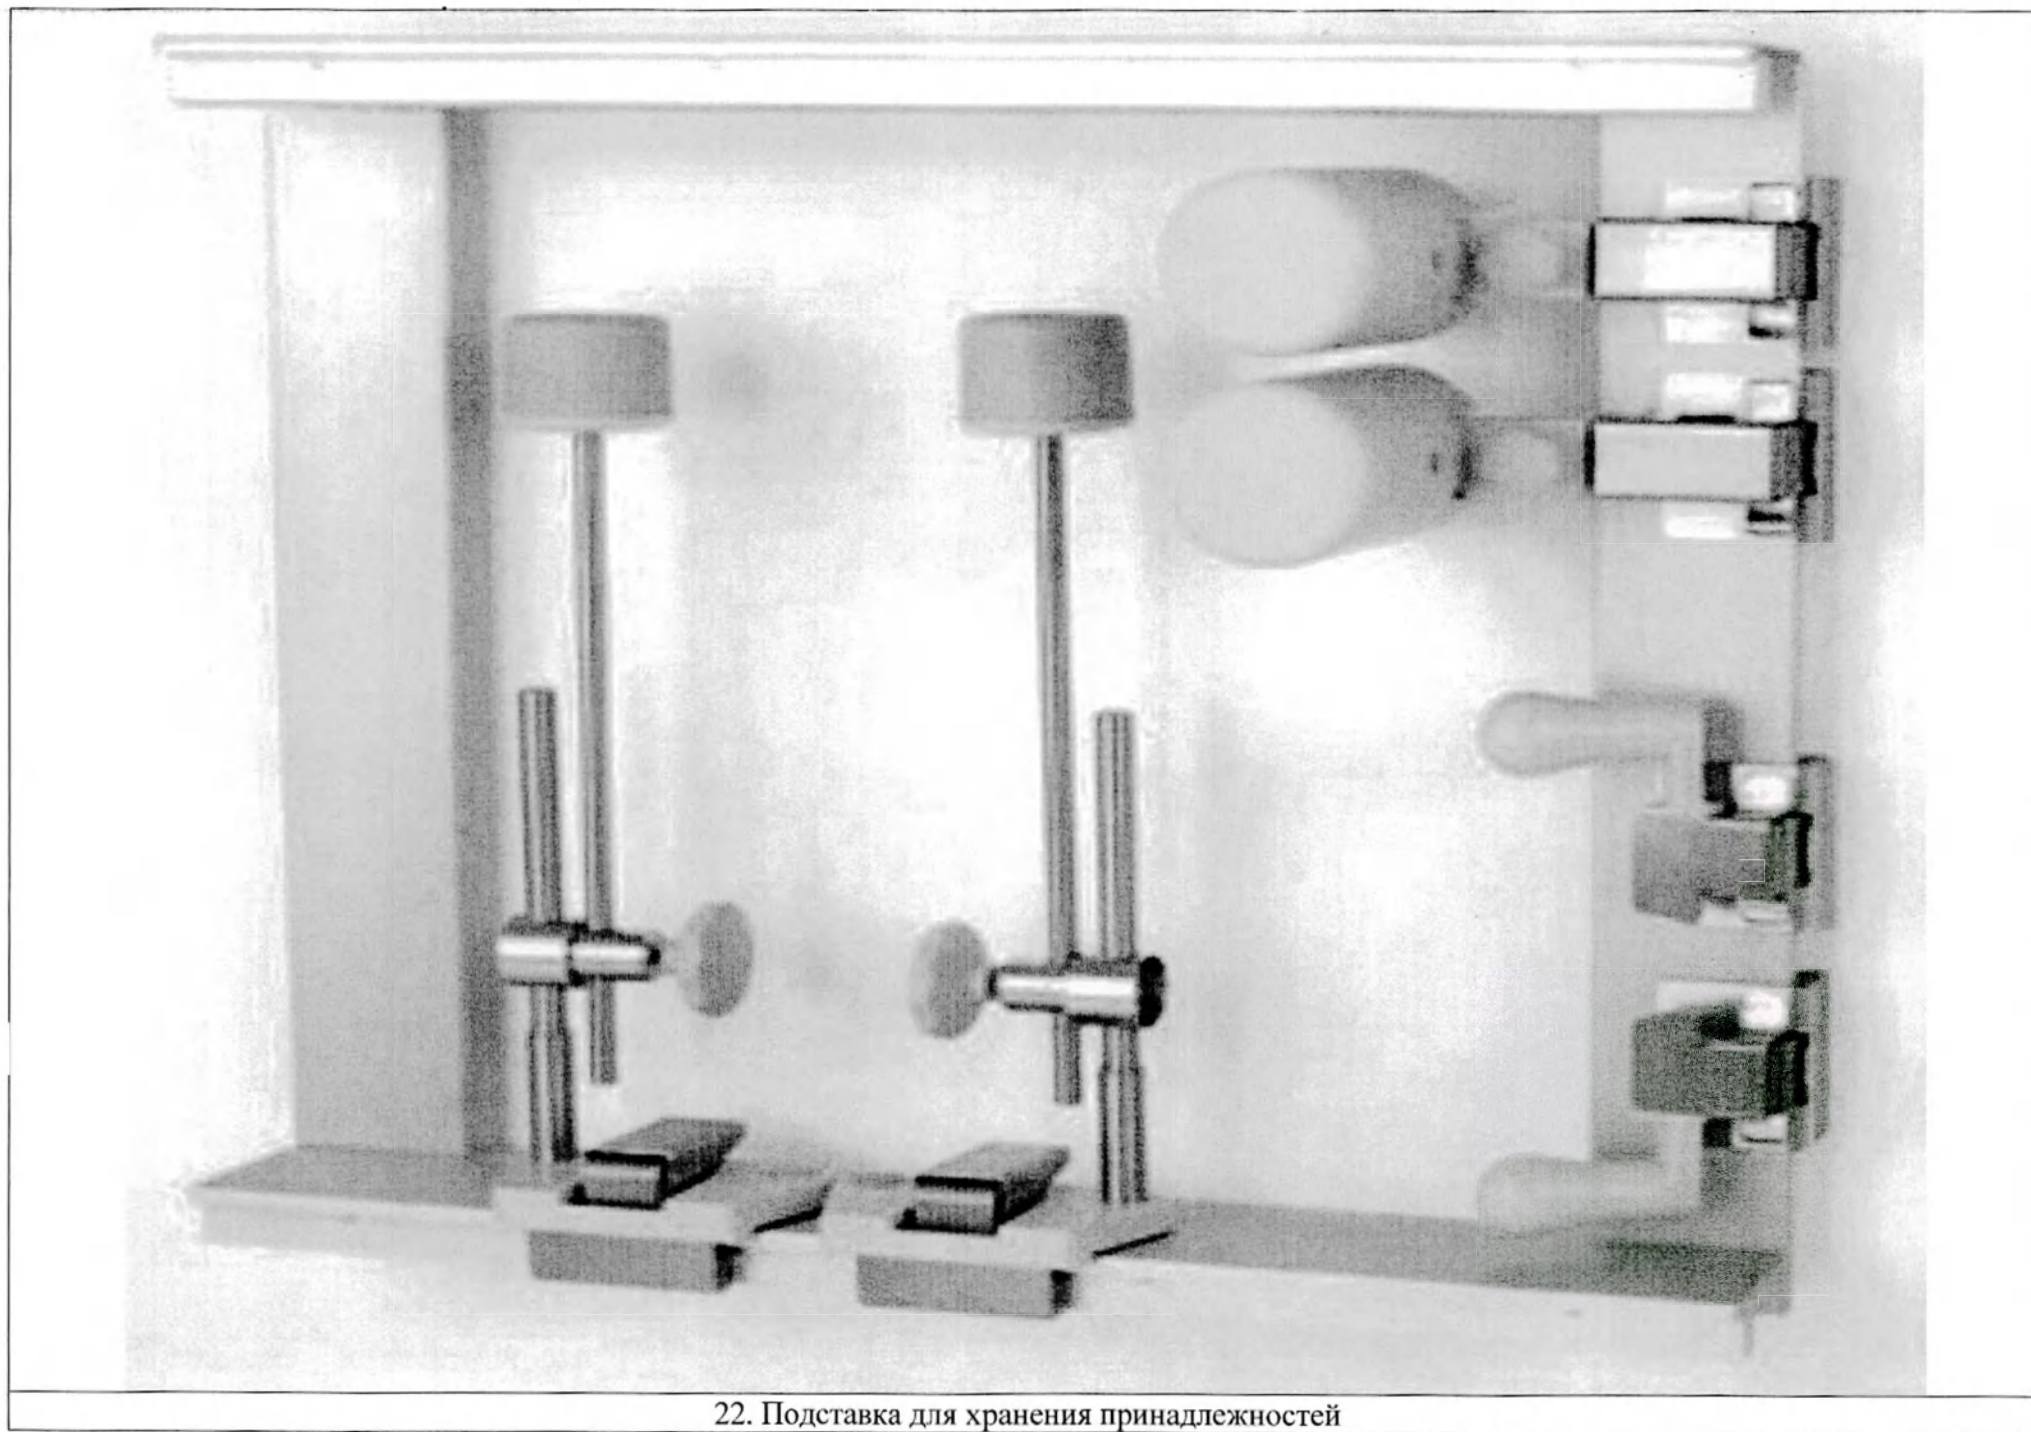


22. Подставка для хранения принадлежностей




23. Подплечники.

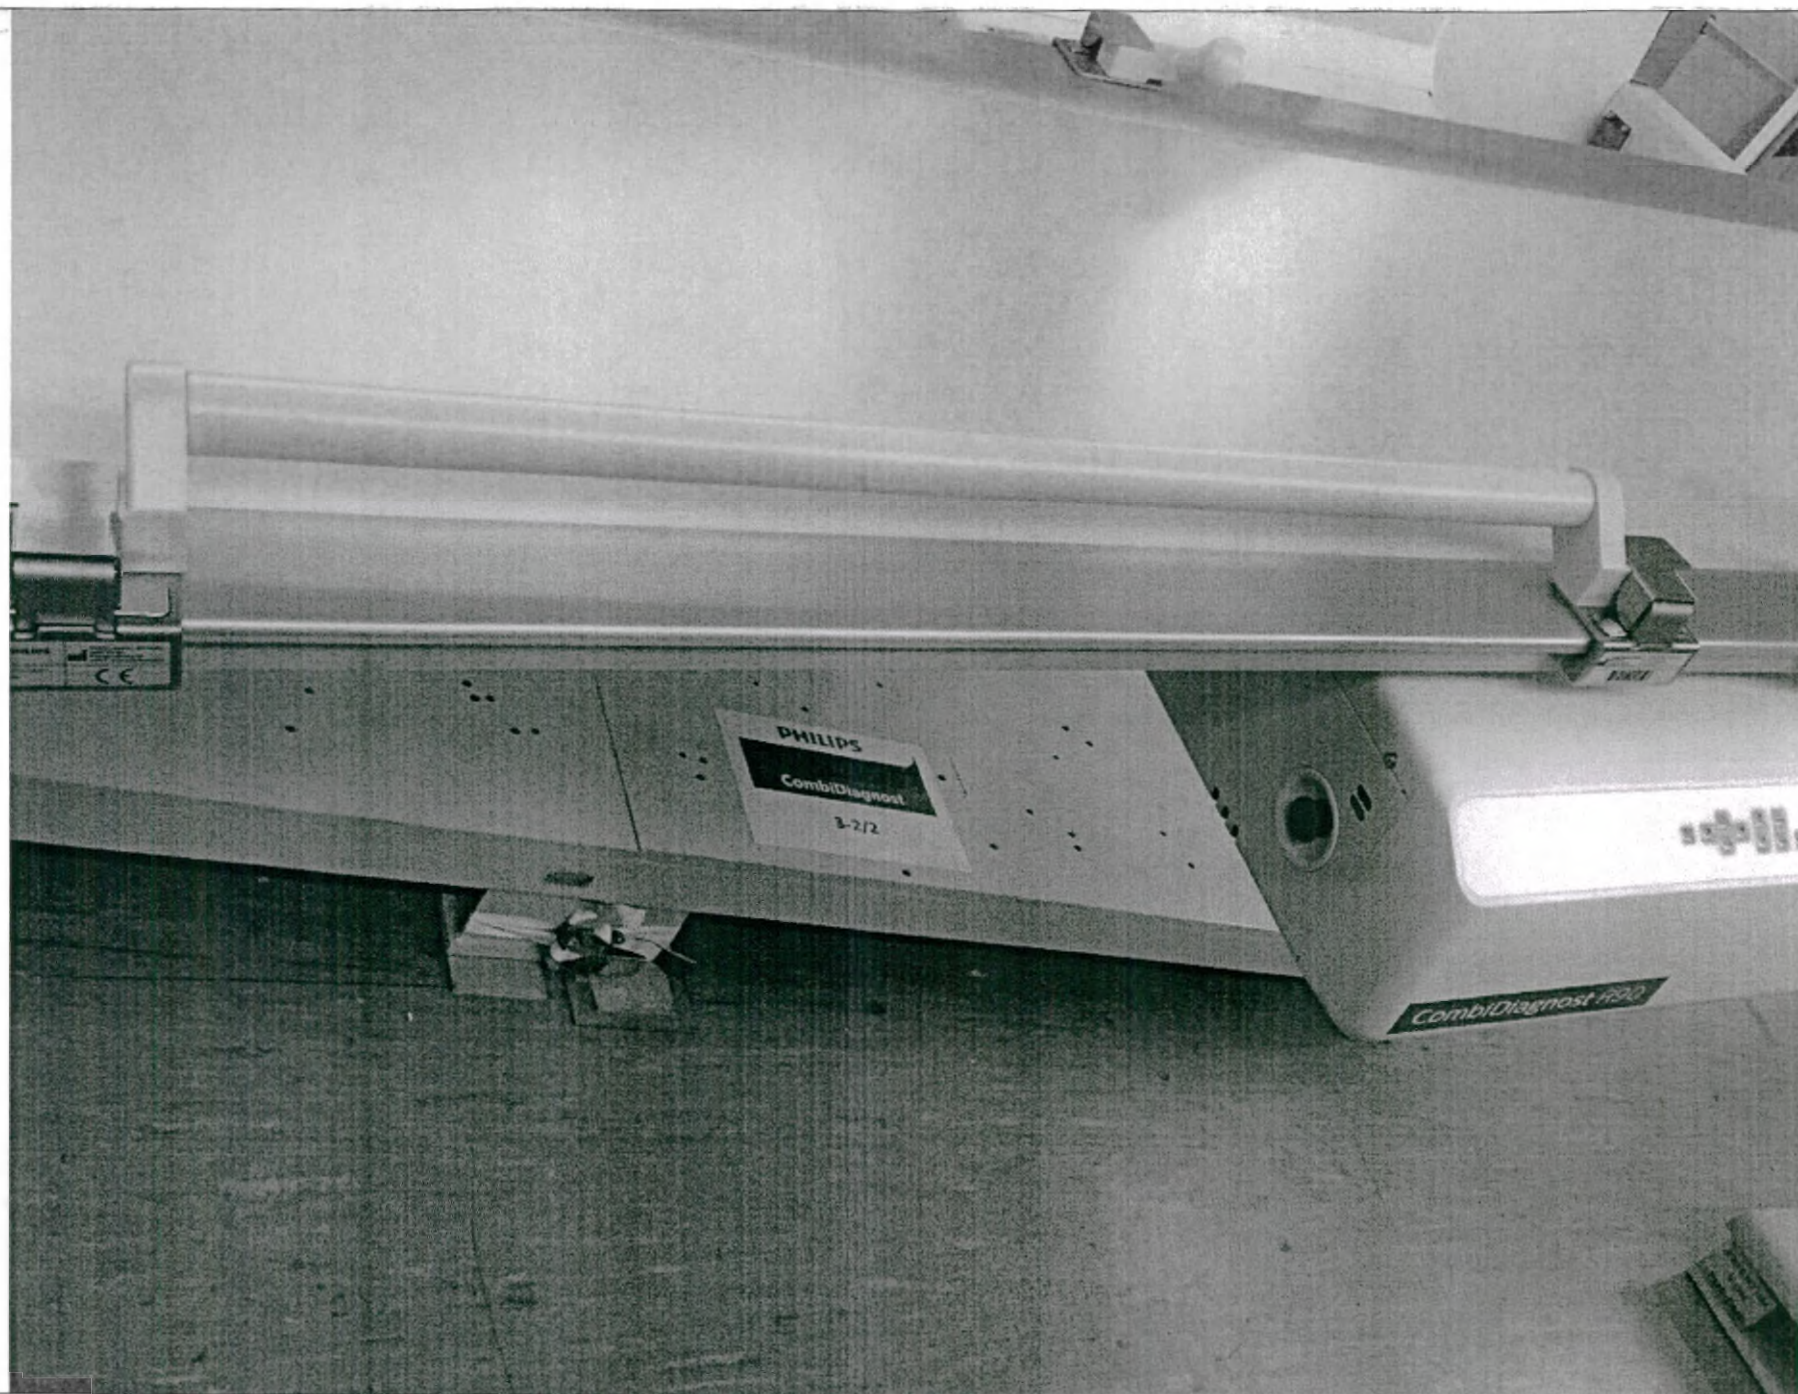

24. Боковой поручень.

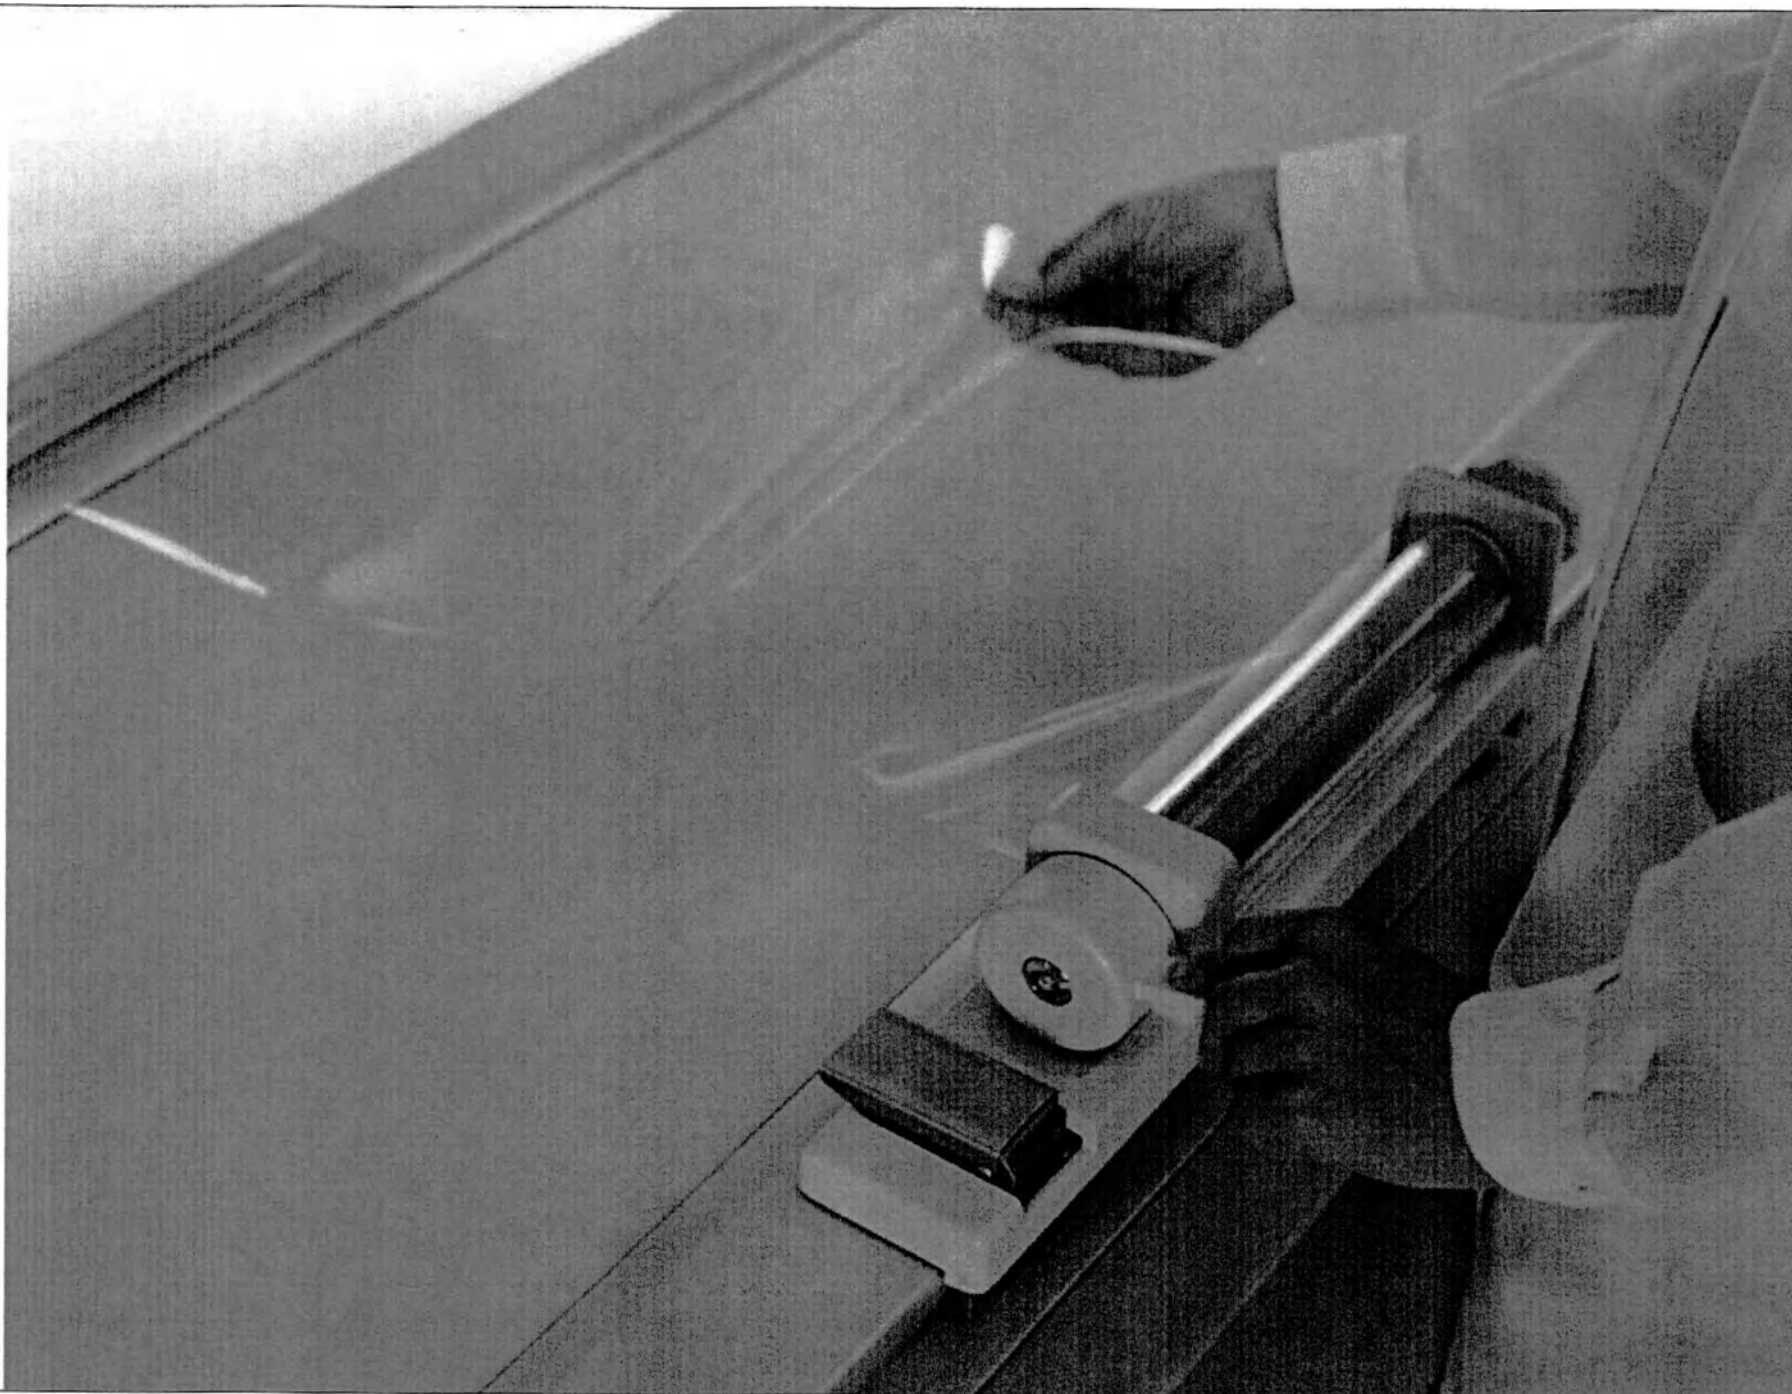

25. Компрессионная лента.

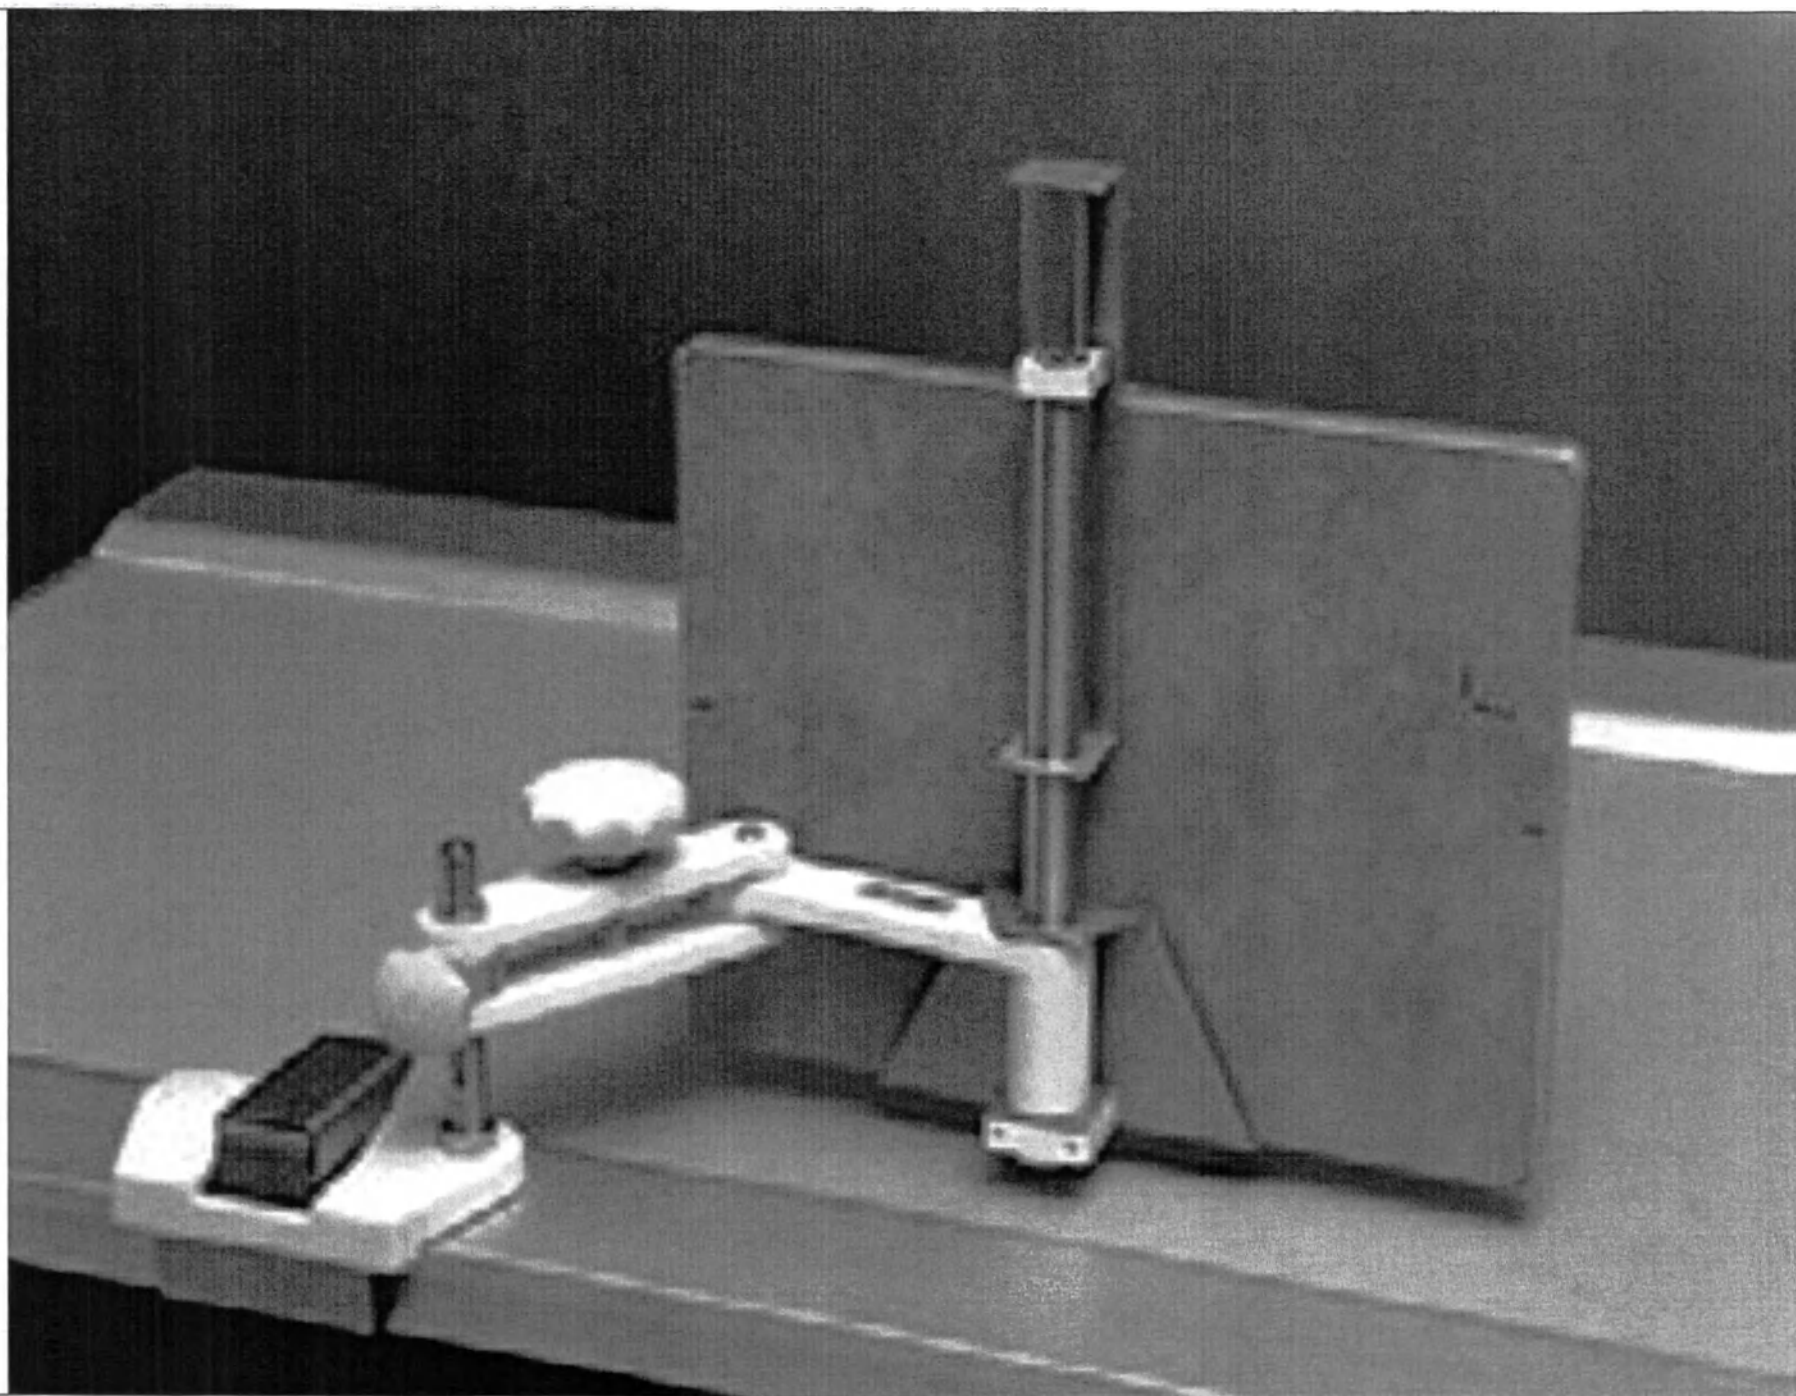

26. Регулируемый боковой держатель.




27. Штатив для бутылок с инфузионным раствором




28. Подставка под руку для катетеризации.




29. Матрац.

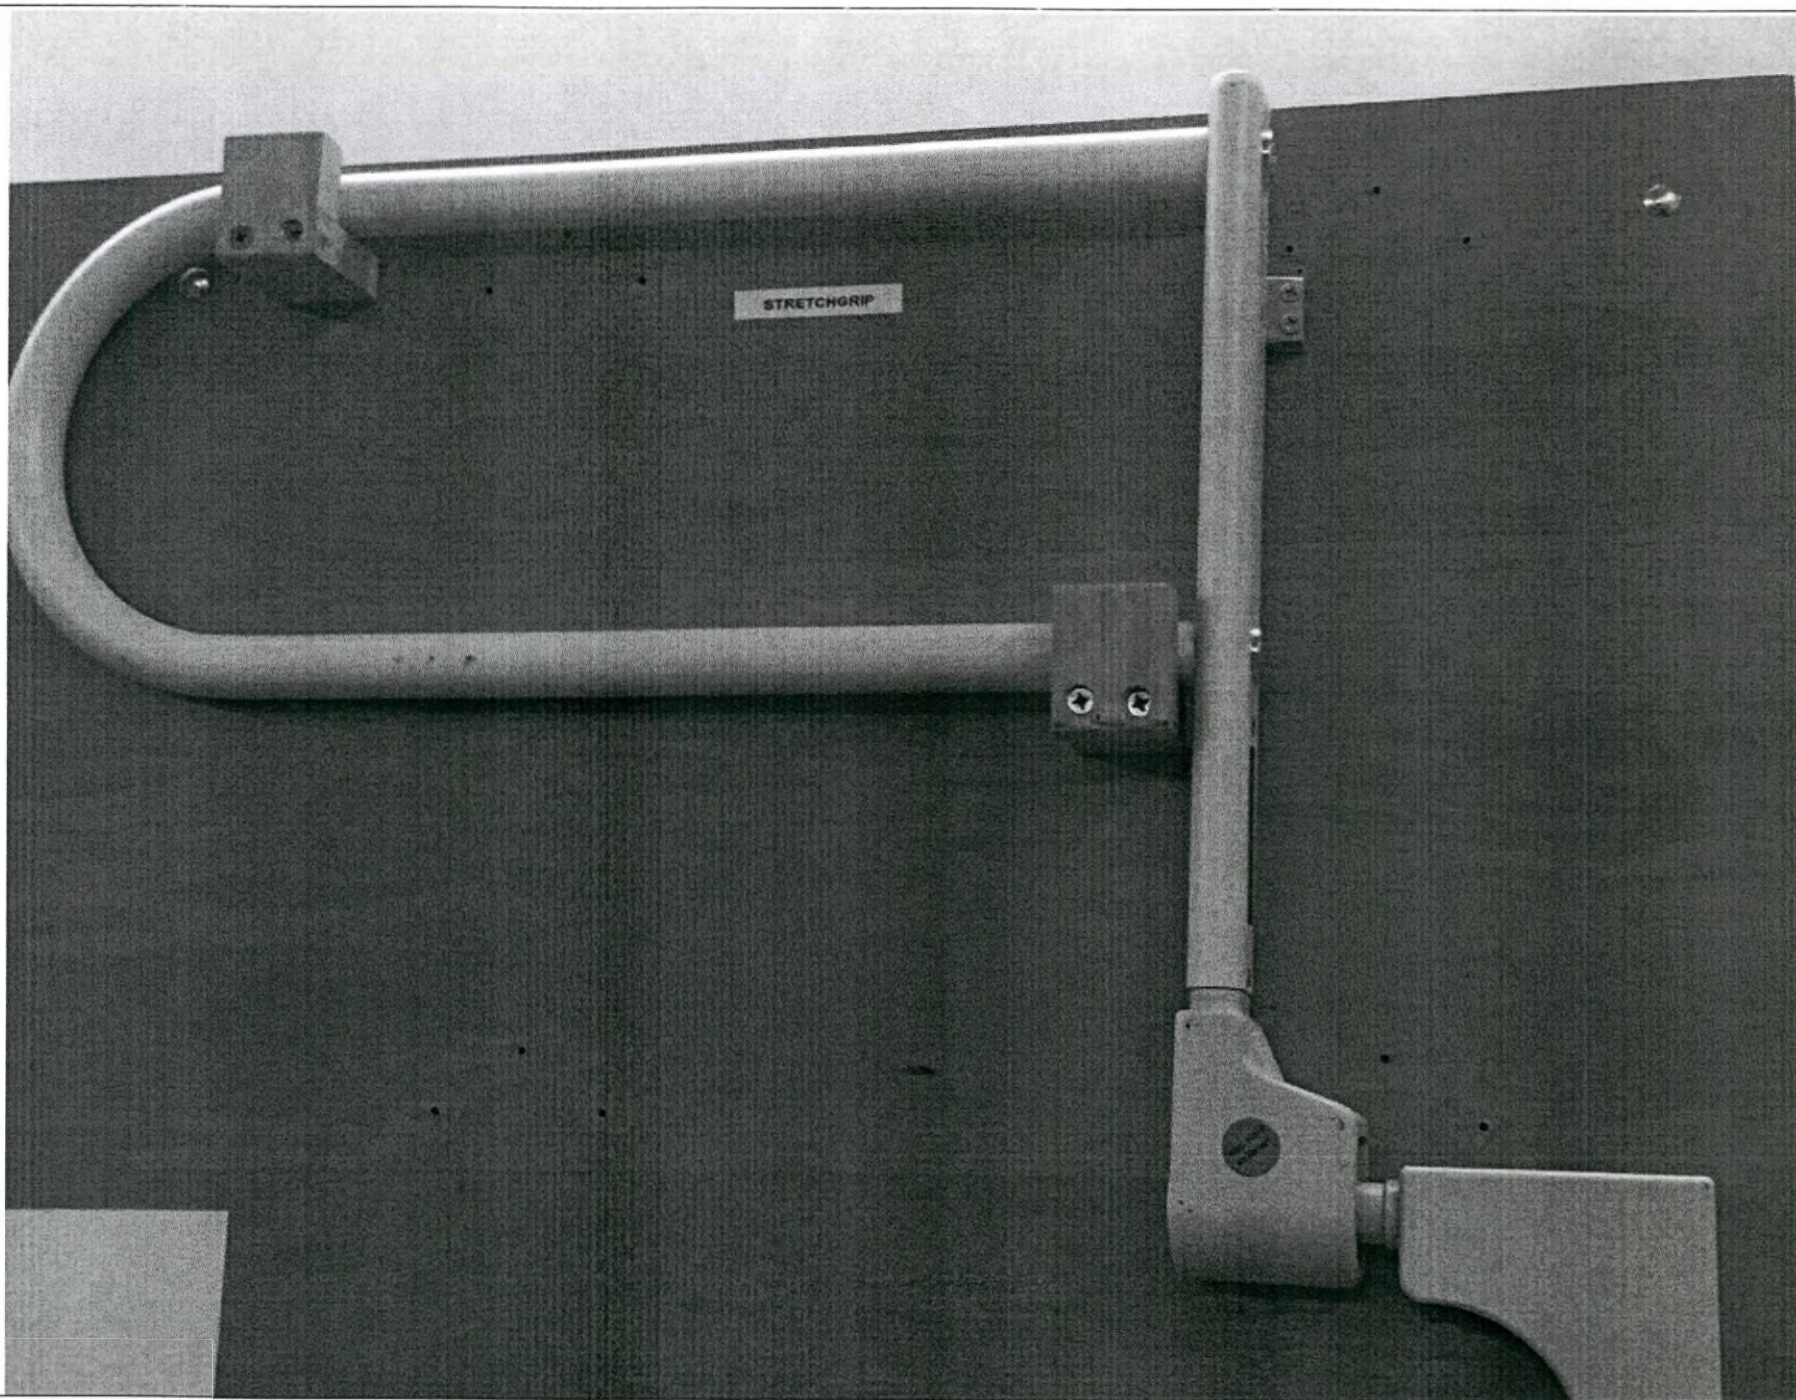


30. Выдвижная ручка стойки.

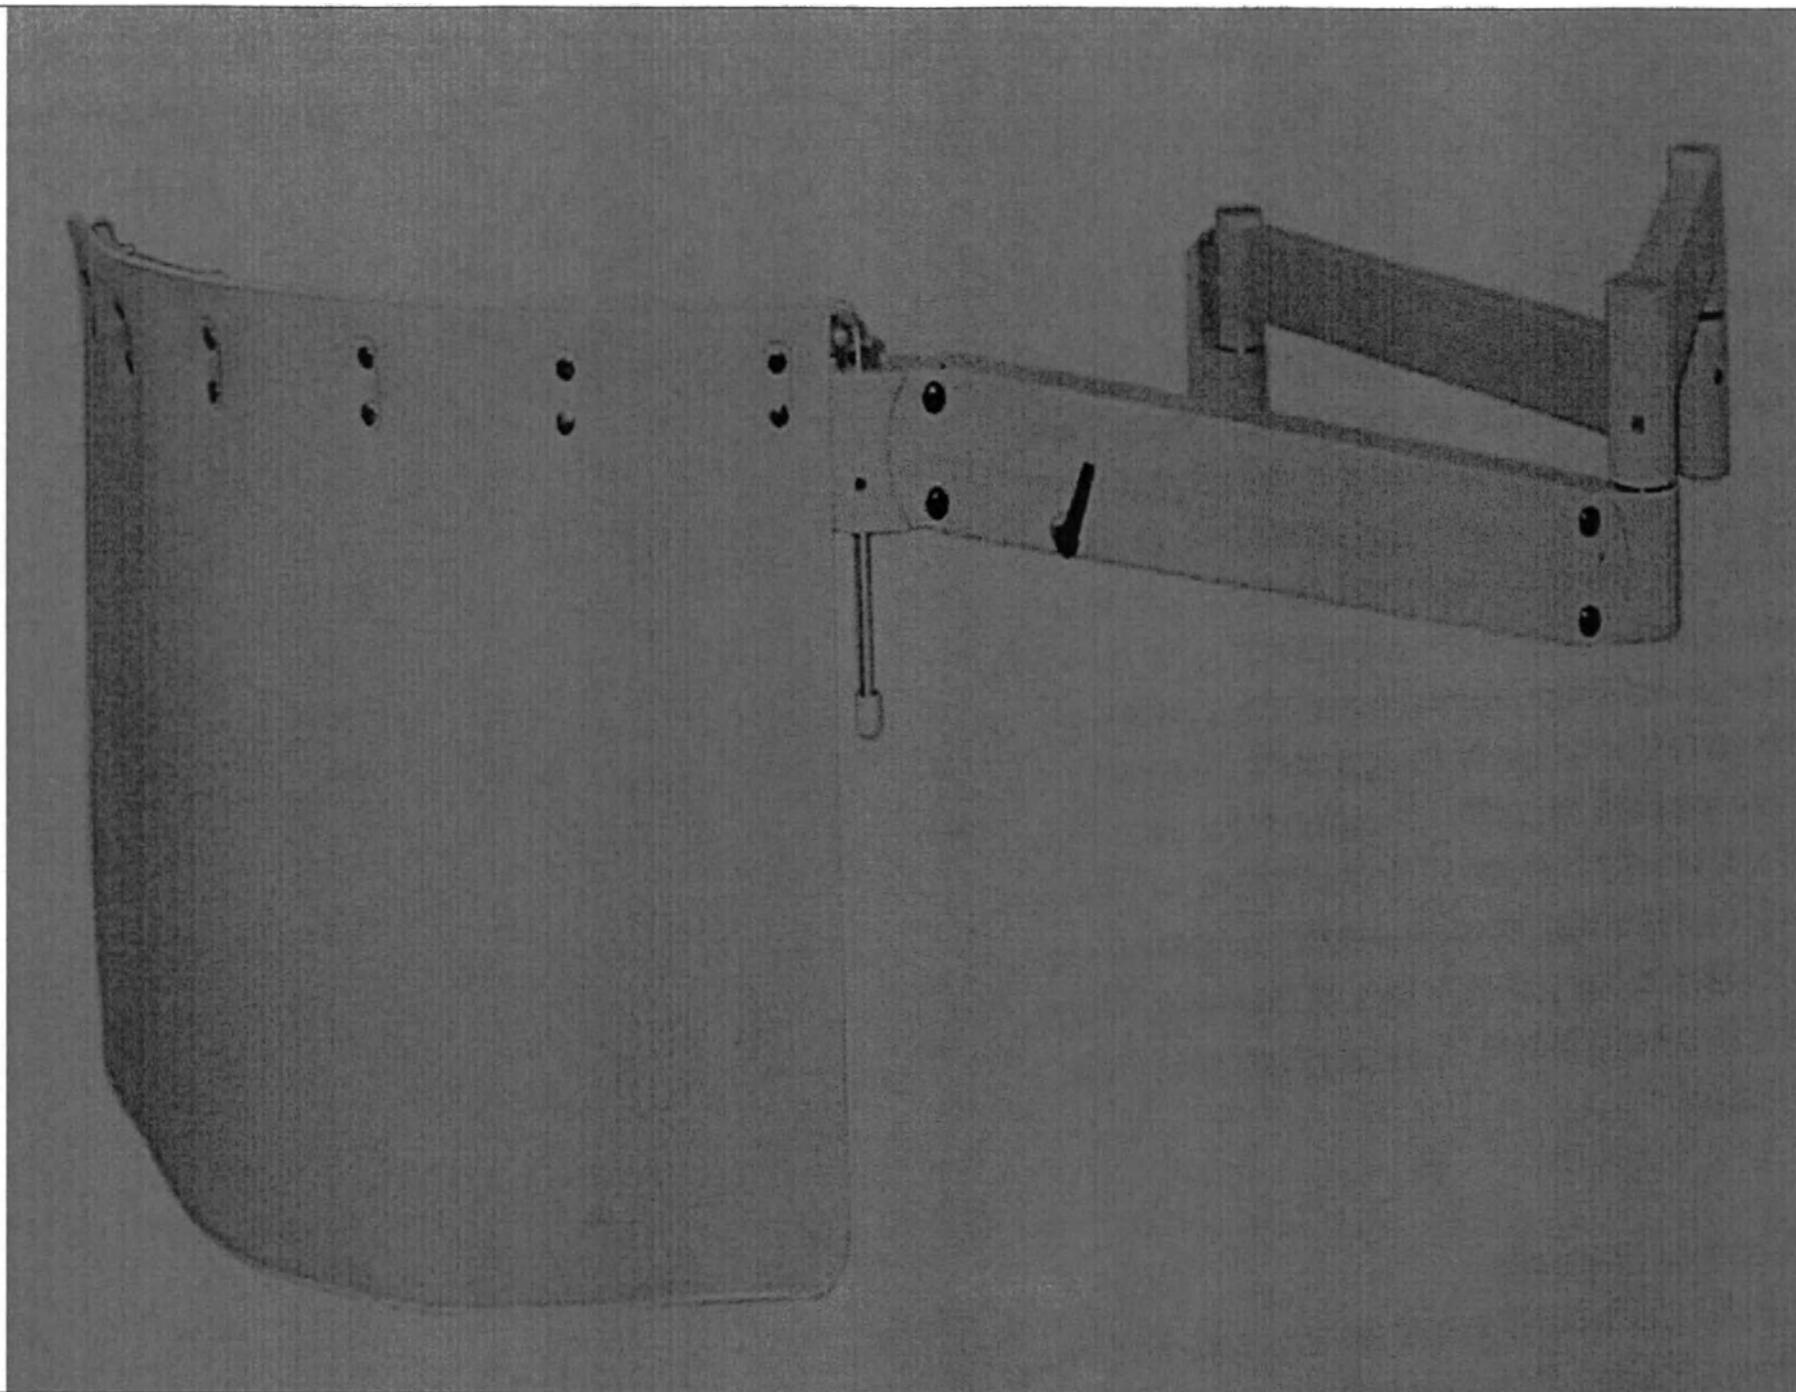


31. Свинцовый фартук для стойки.

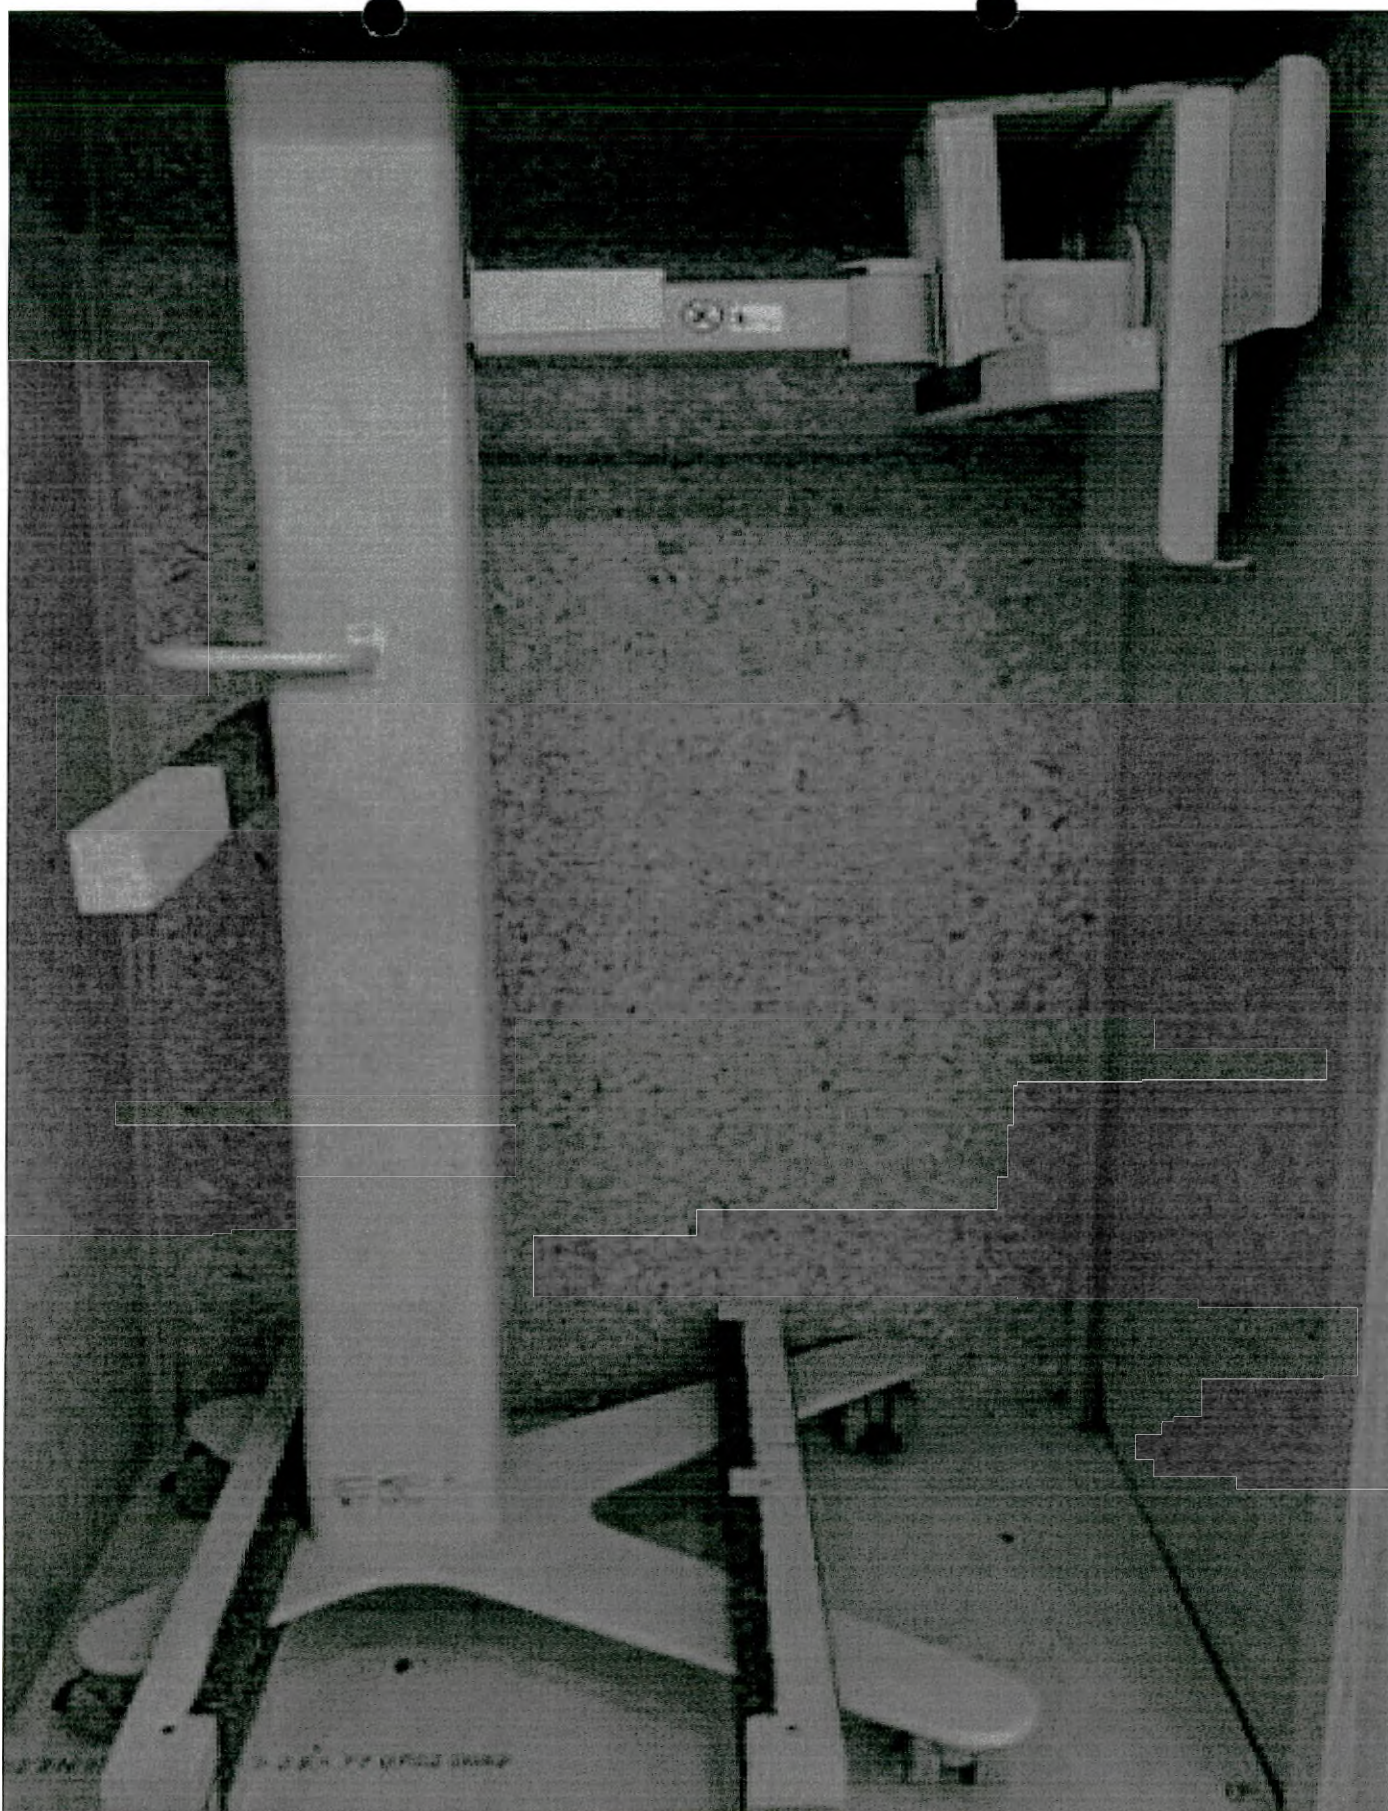

32. Мобильный держатель детектора

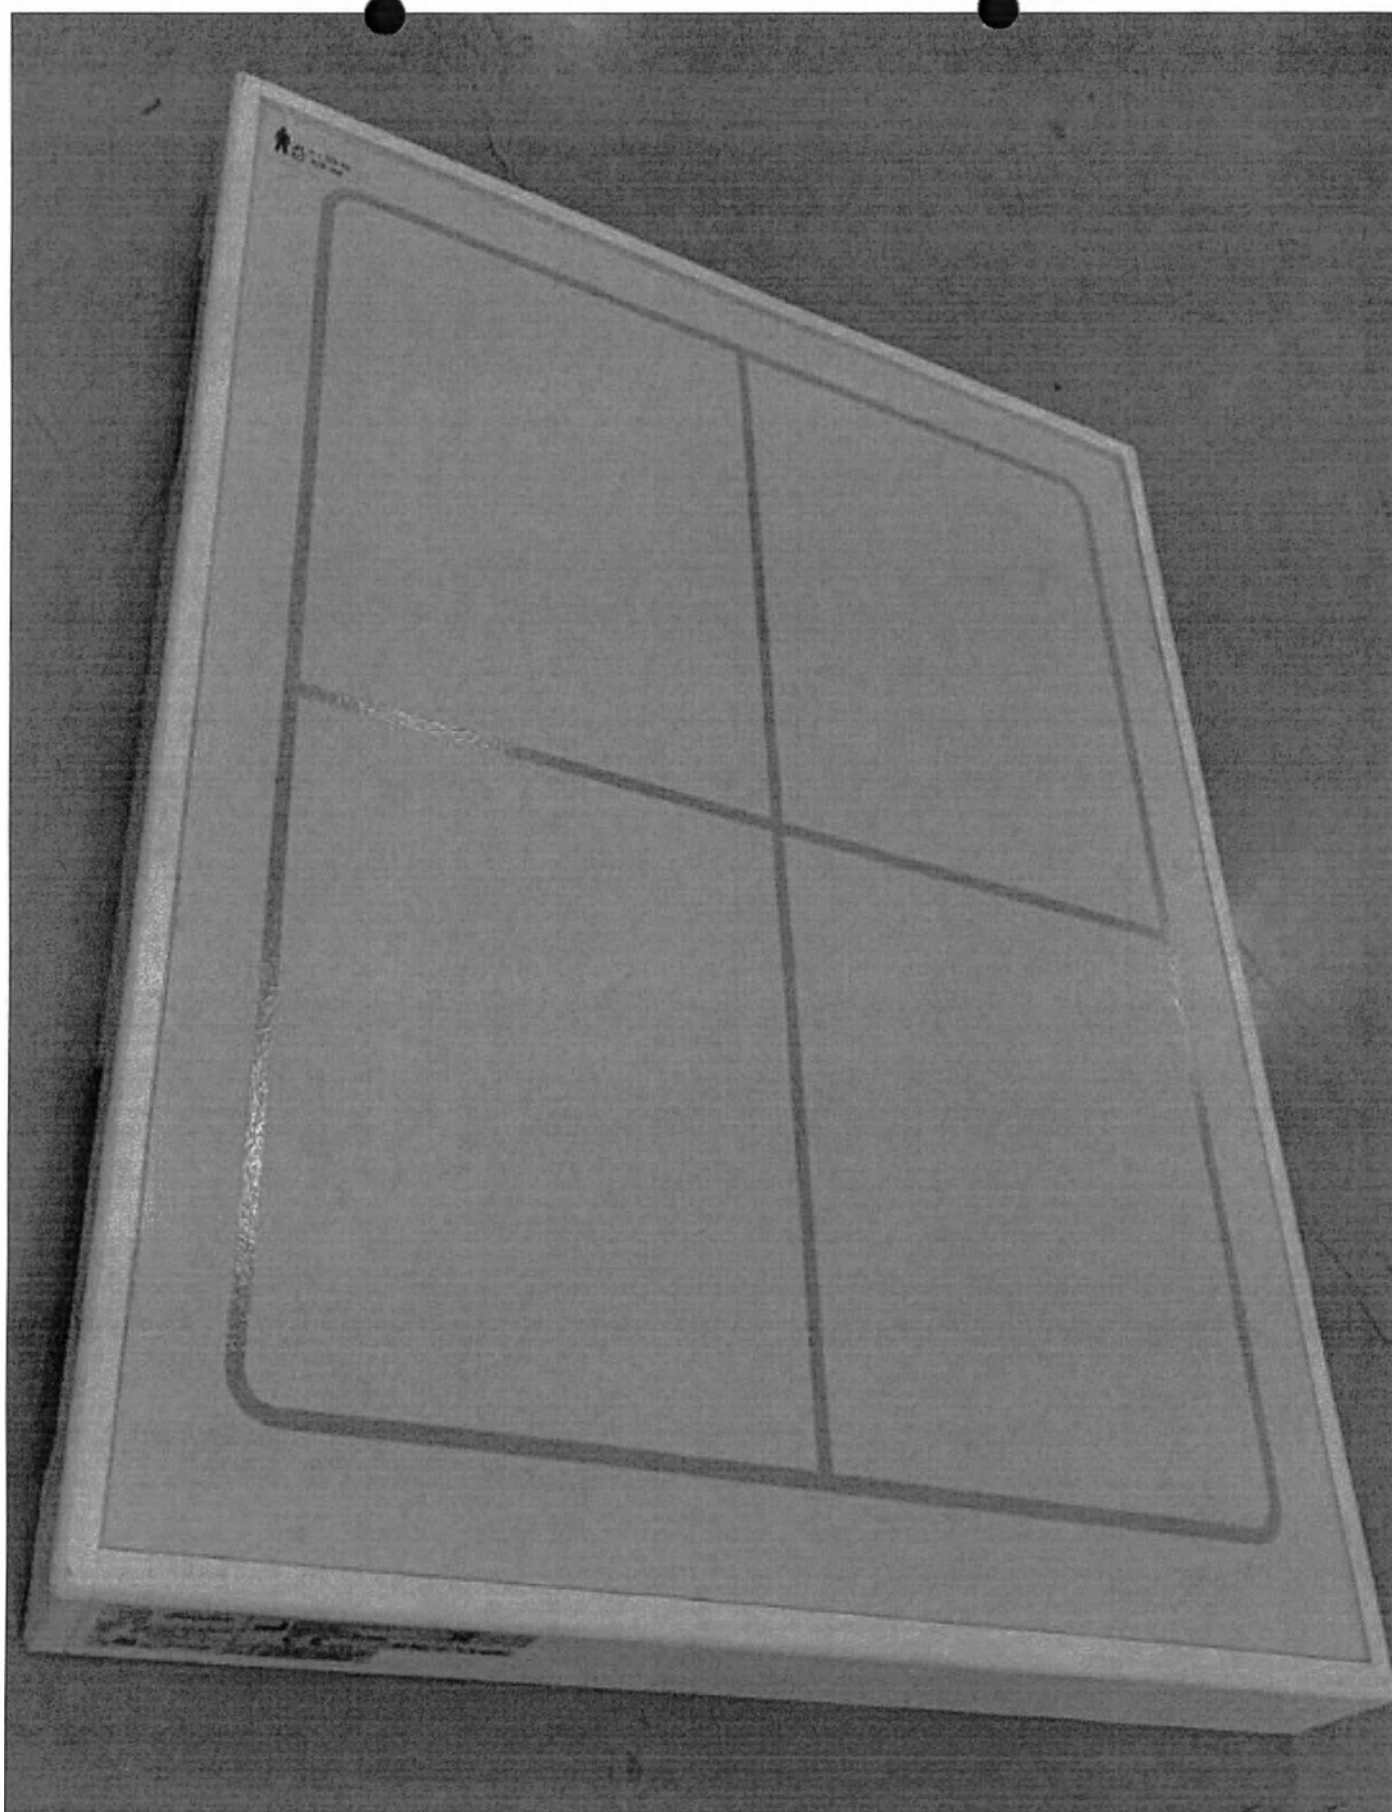

33. Защитная панель переносного детектора.

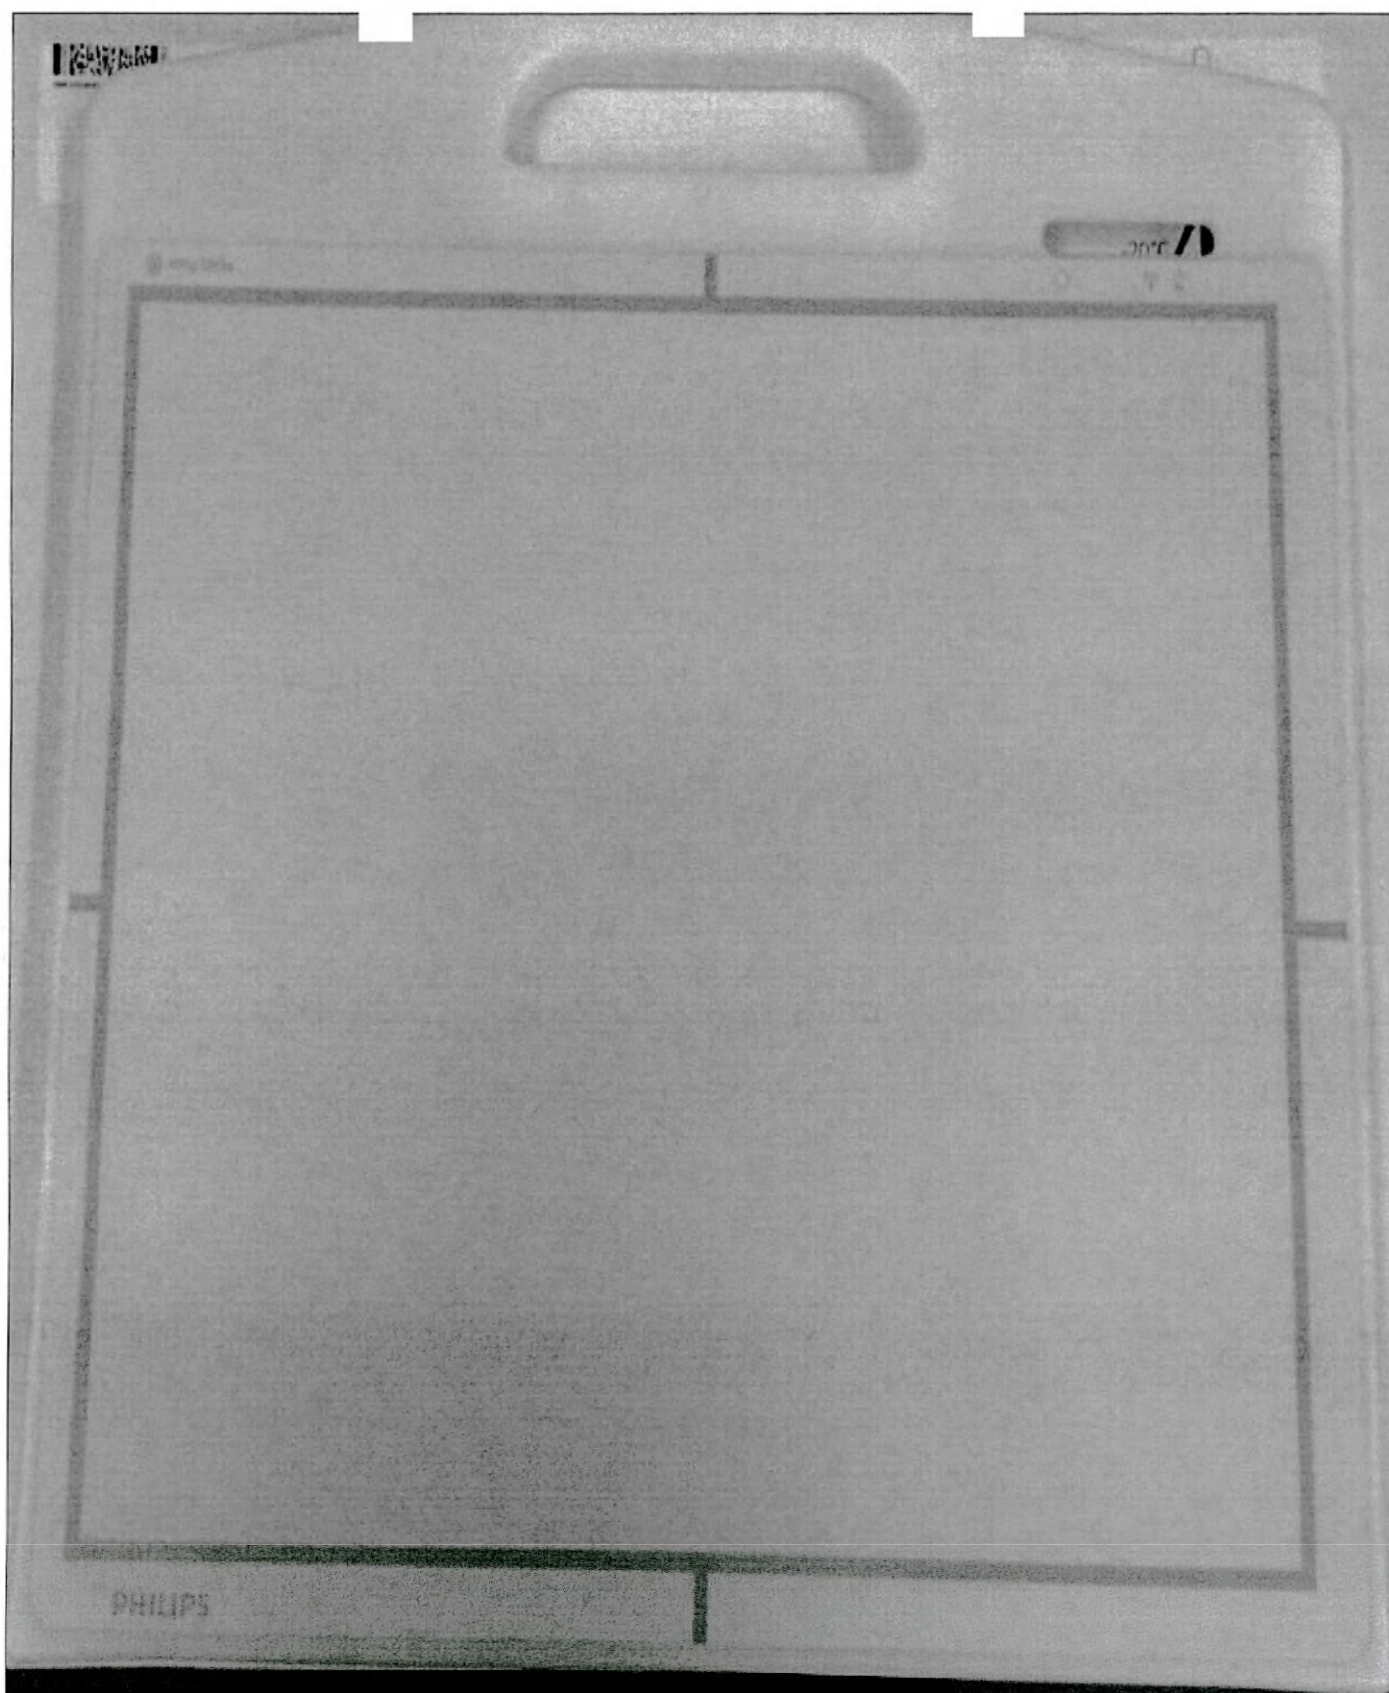


34. Рукоятка детектора.



35. Малый мешок для детектора 24x30 см



36. Большой мешок для детектора 35x43 см

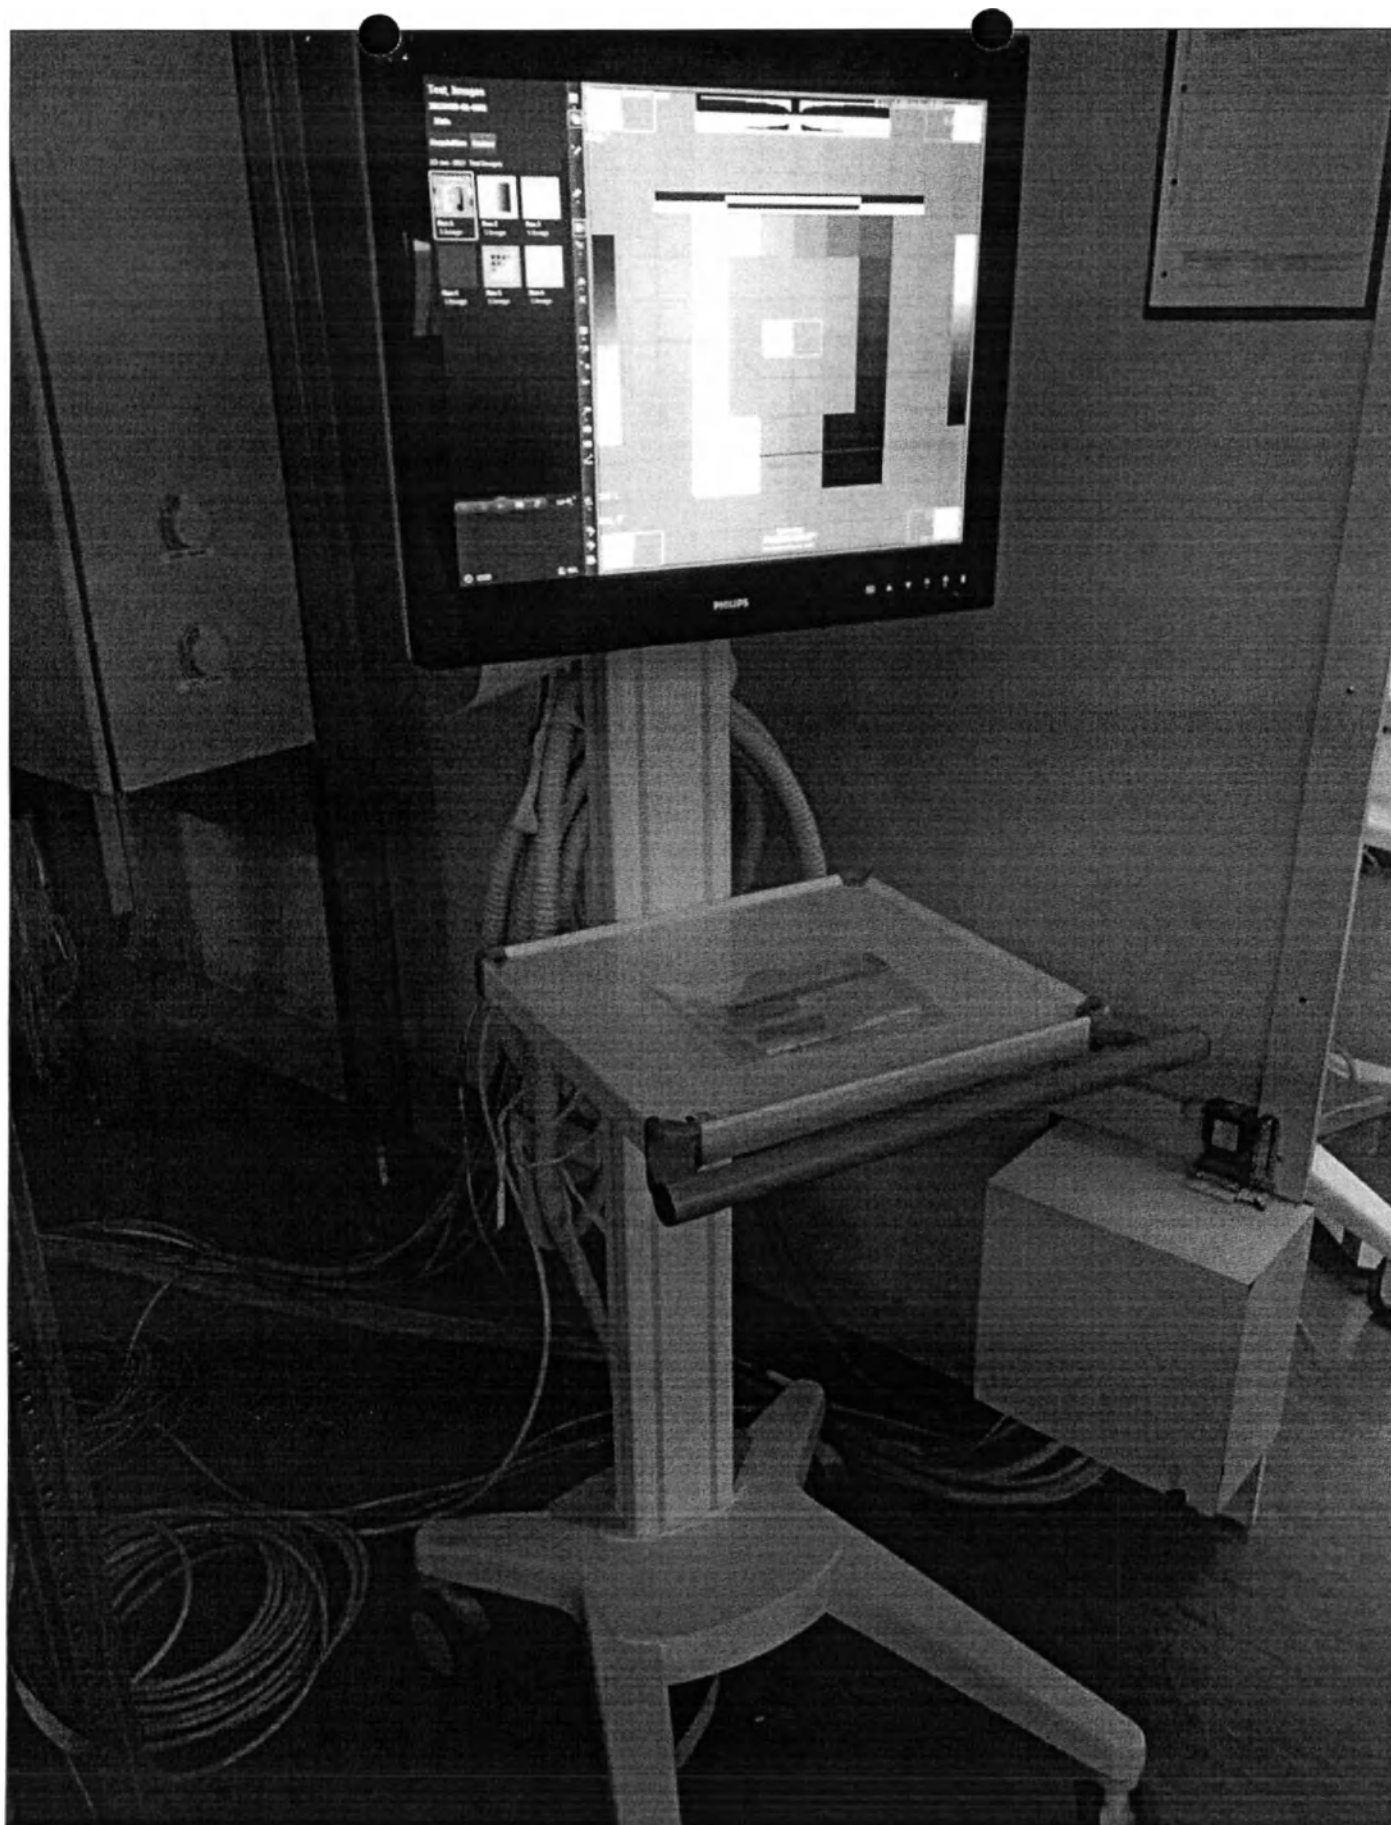



37. Монитор в помещении для исследований.




38. Опора для пациента




39. Съемная рукоятка для пациента

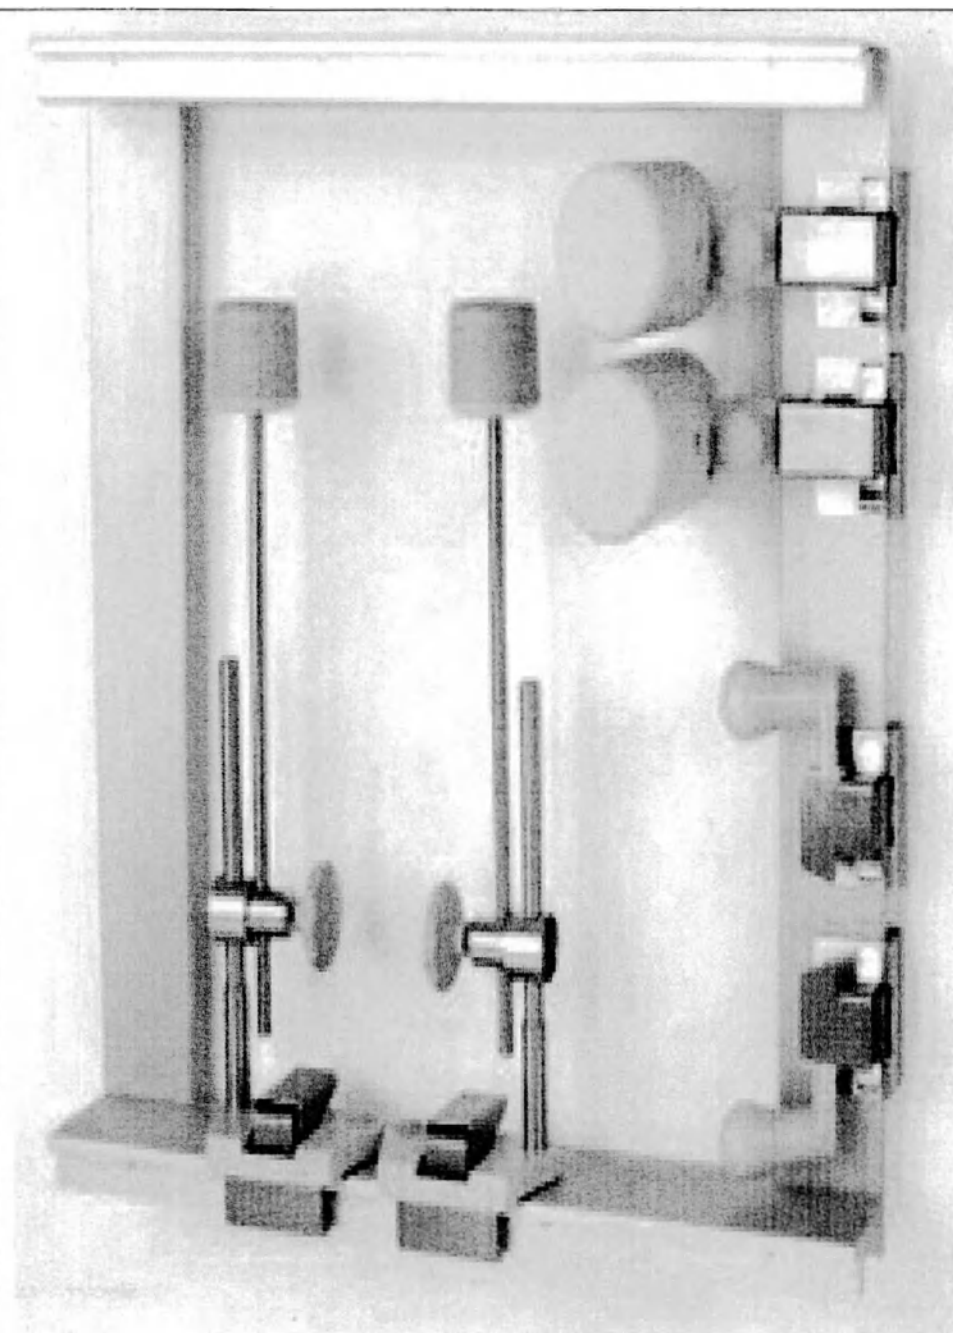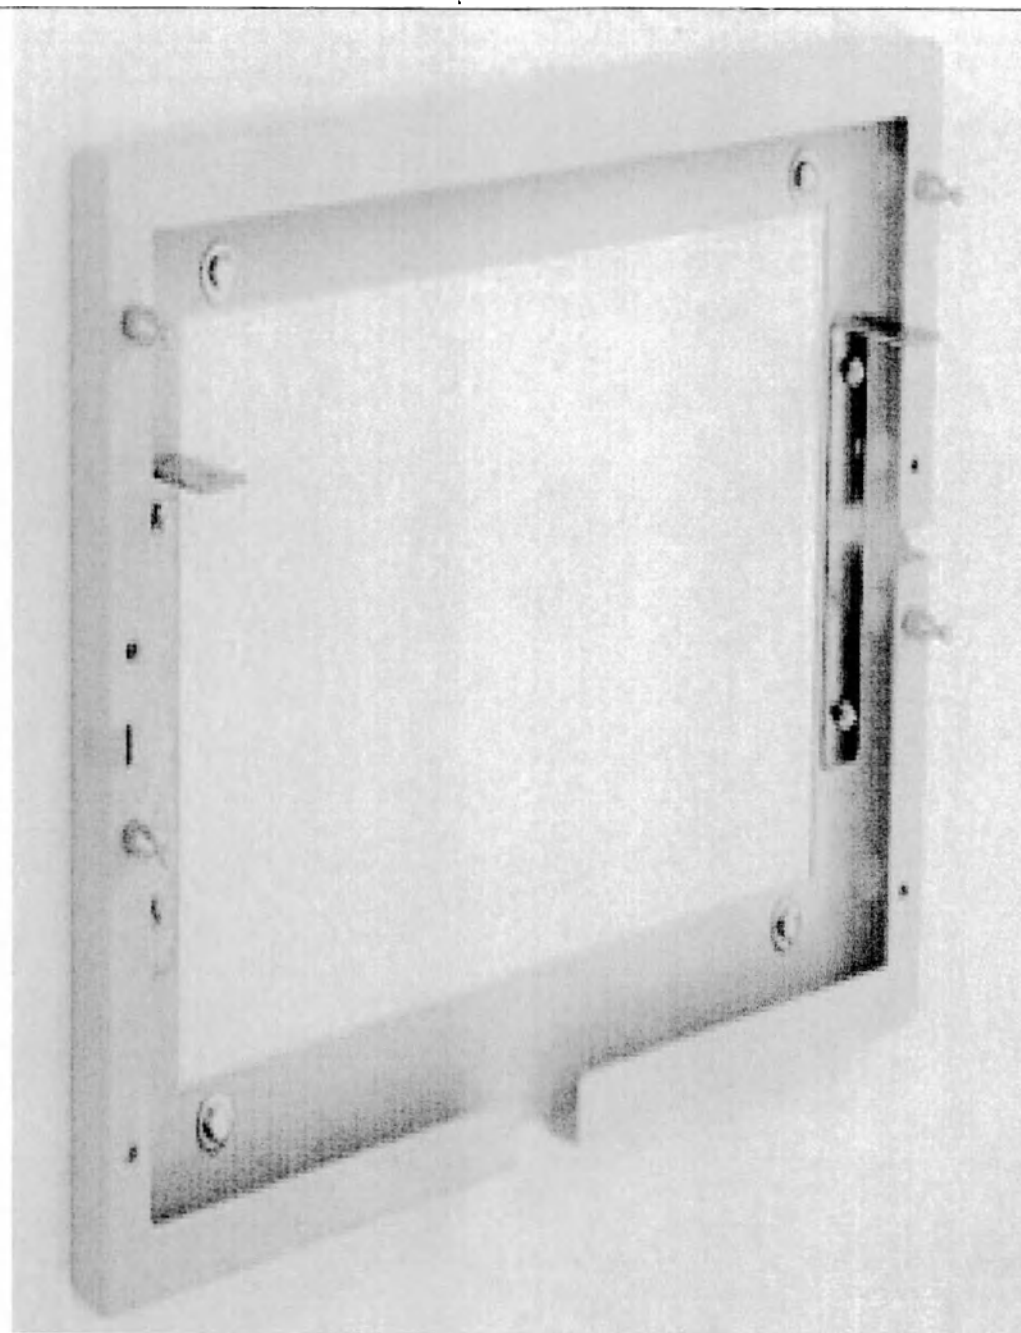


40. Регулируемые фиксаторы

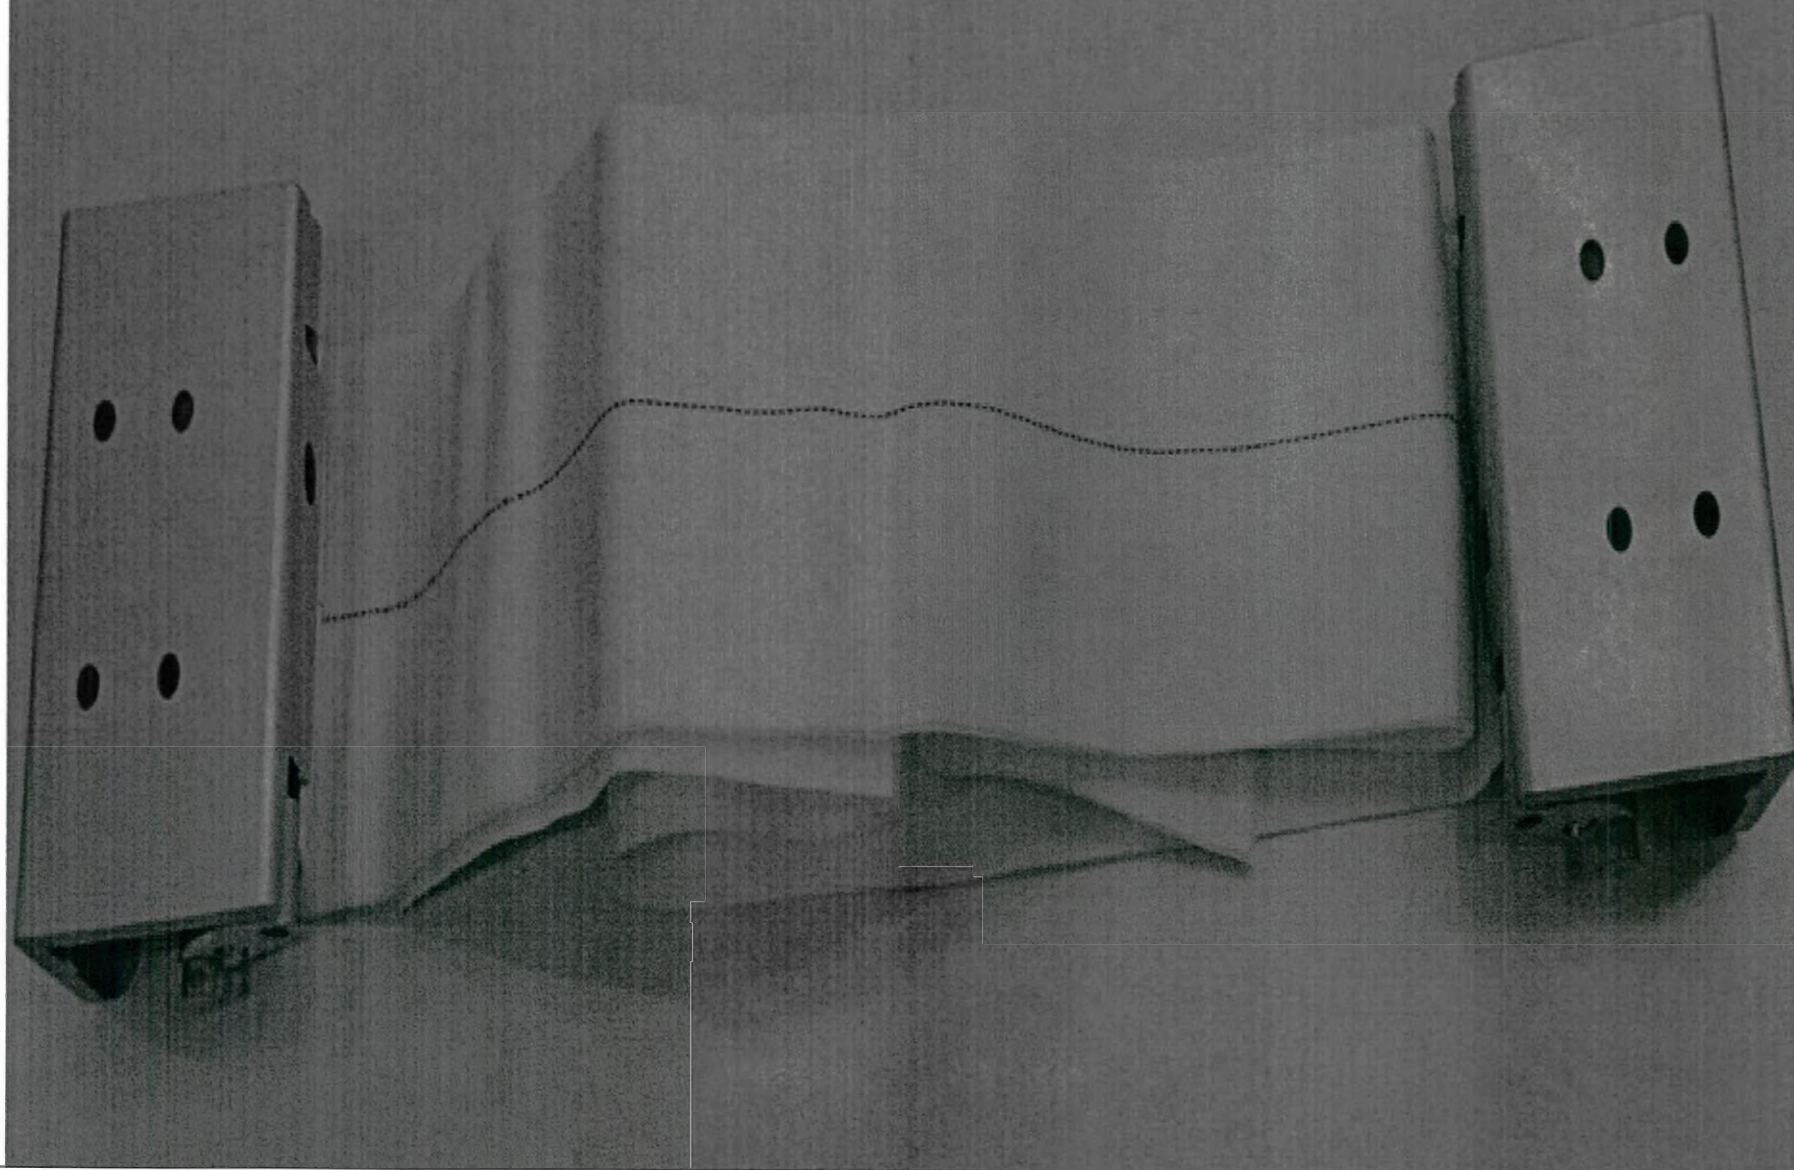


41. Устройство иммобилизации.

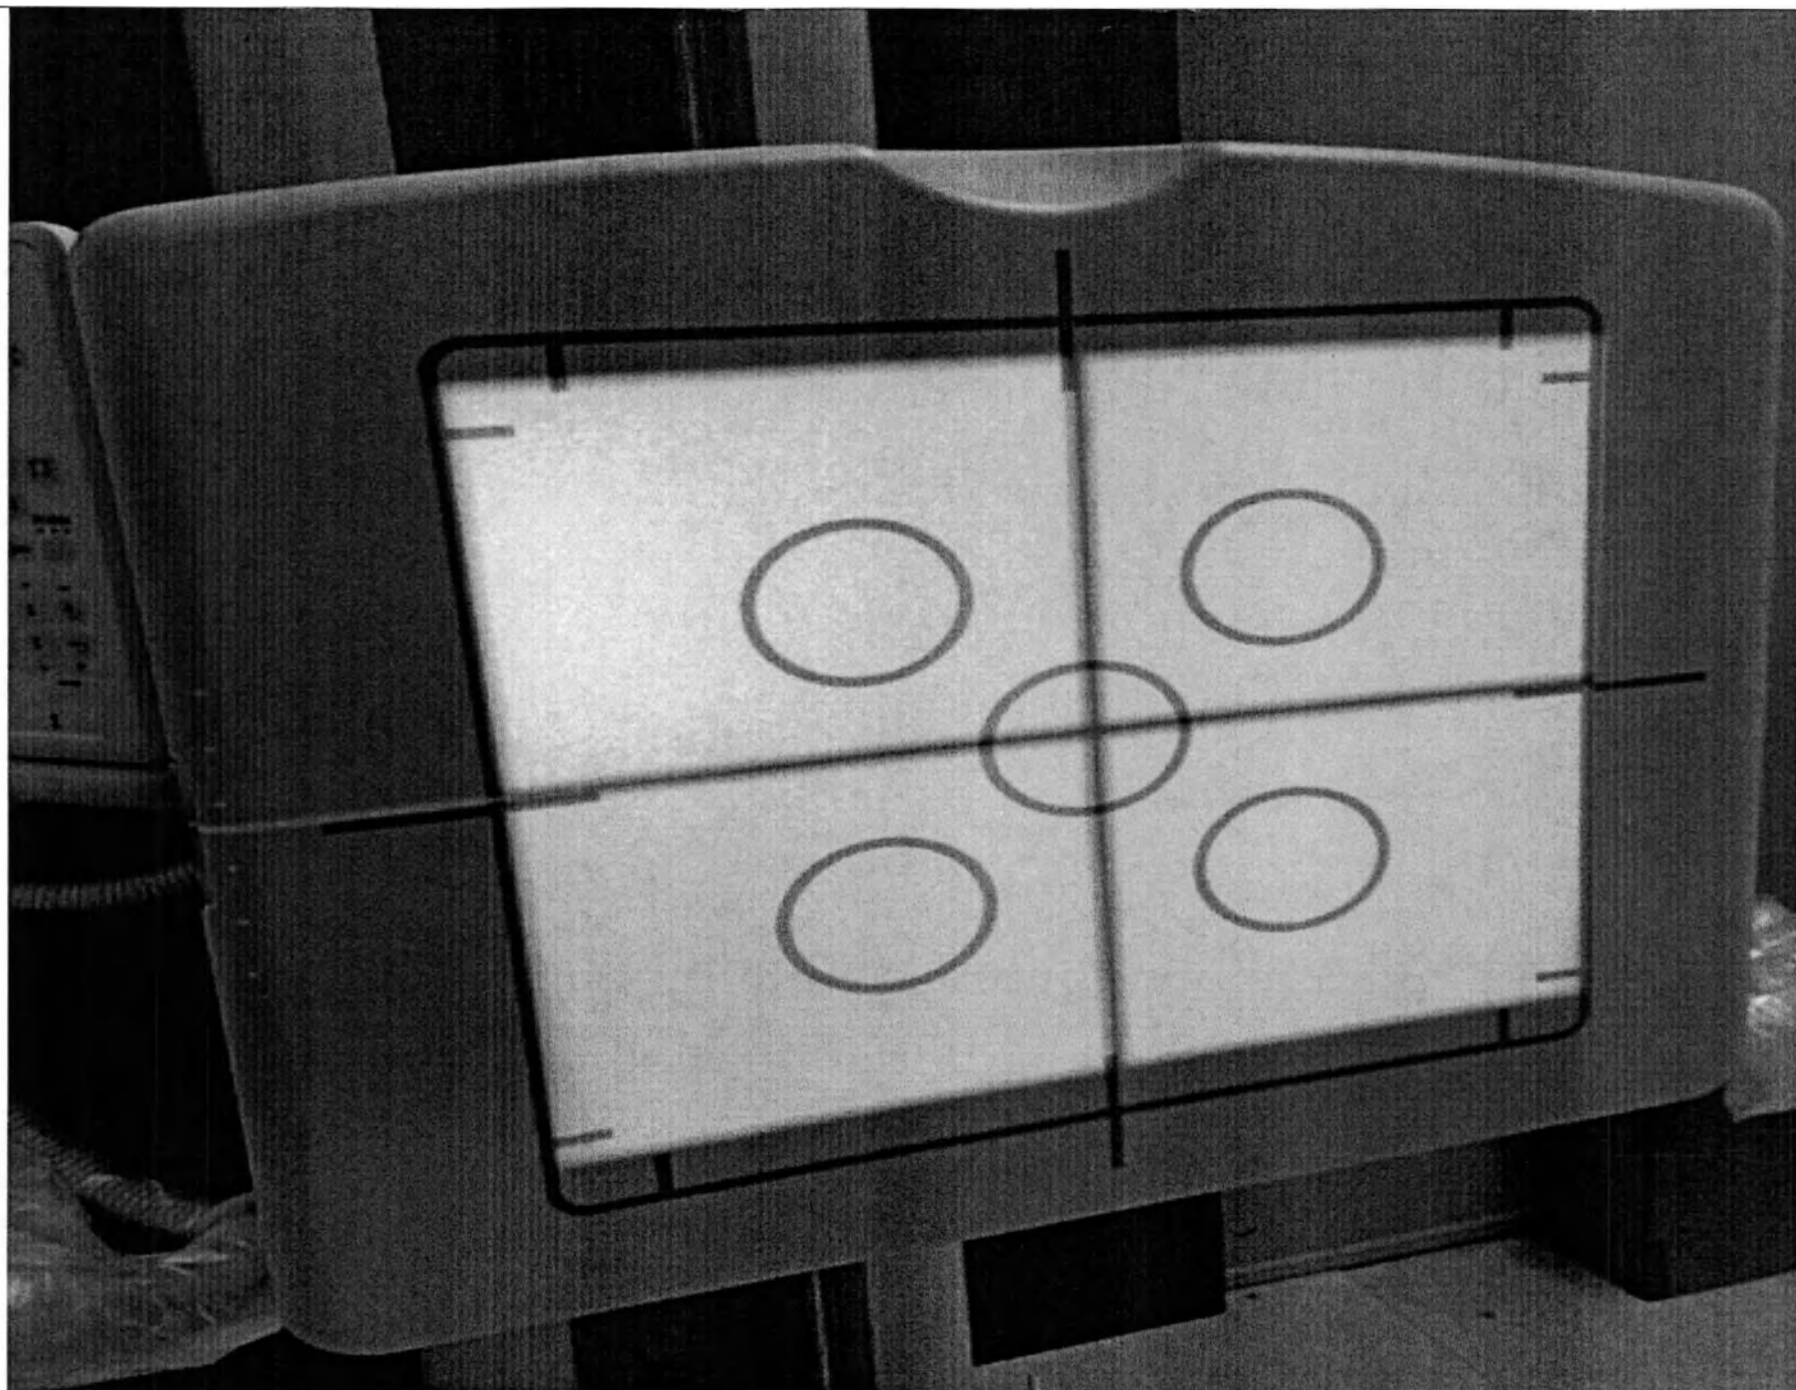


42. Устройство центрирующее

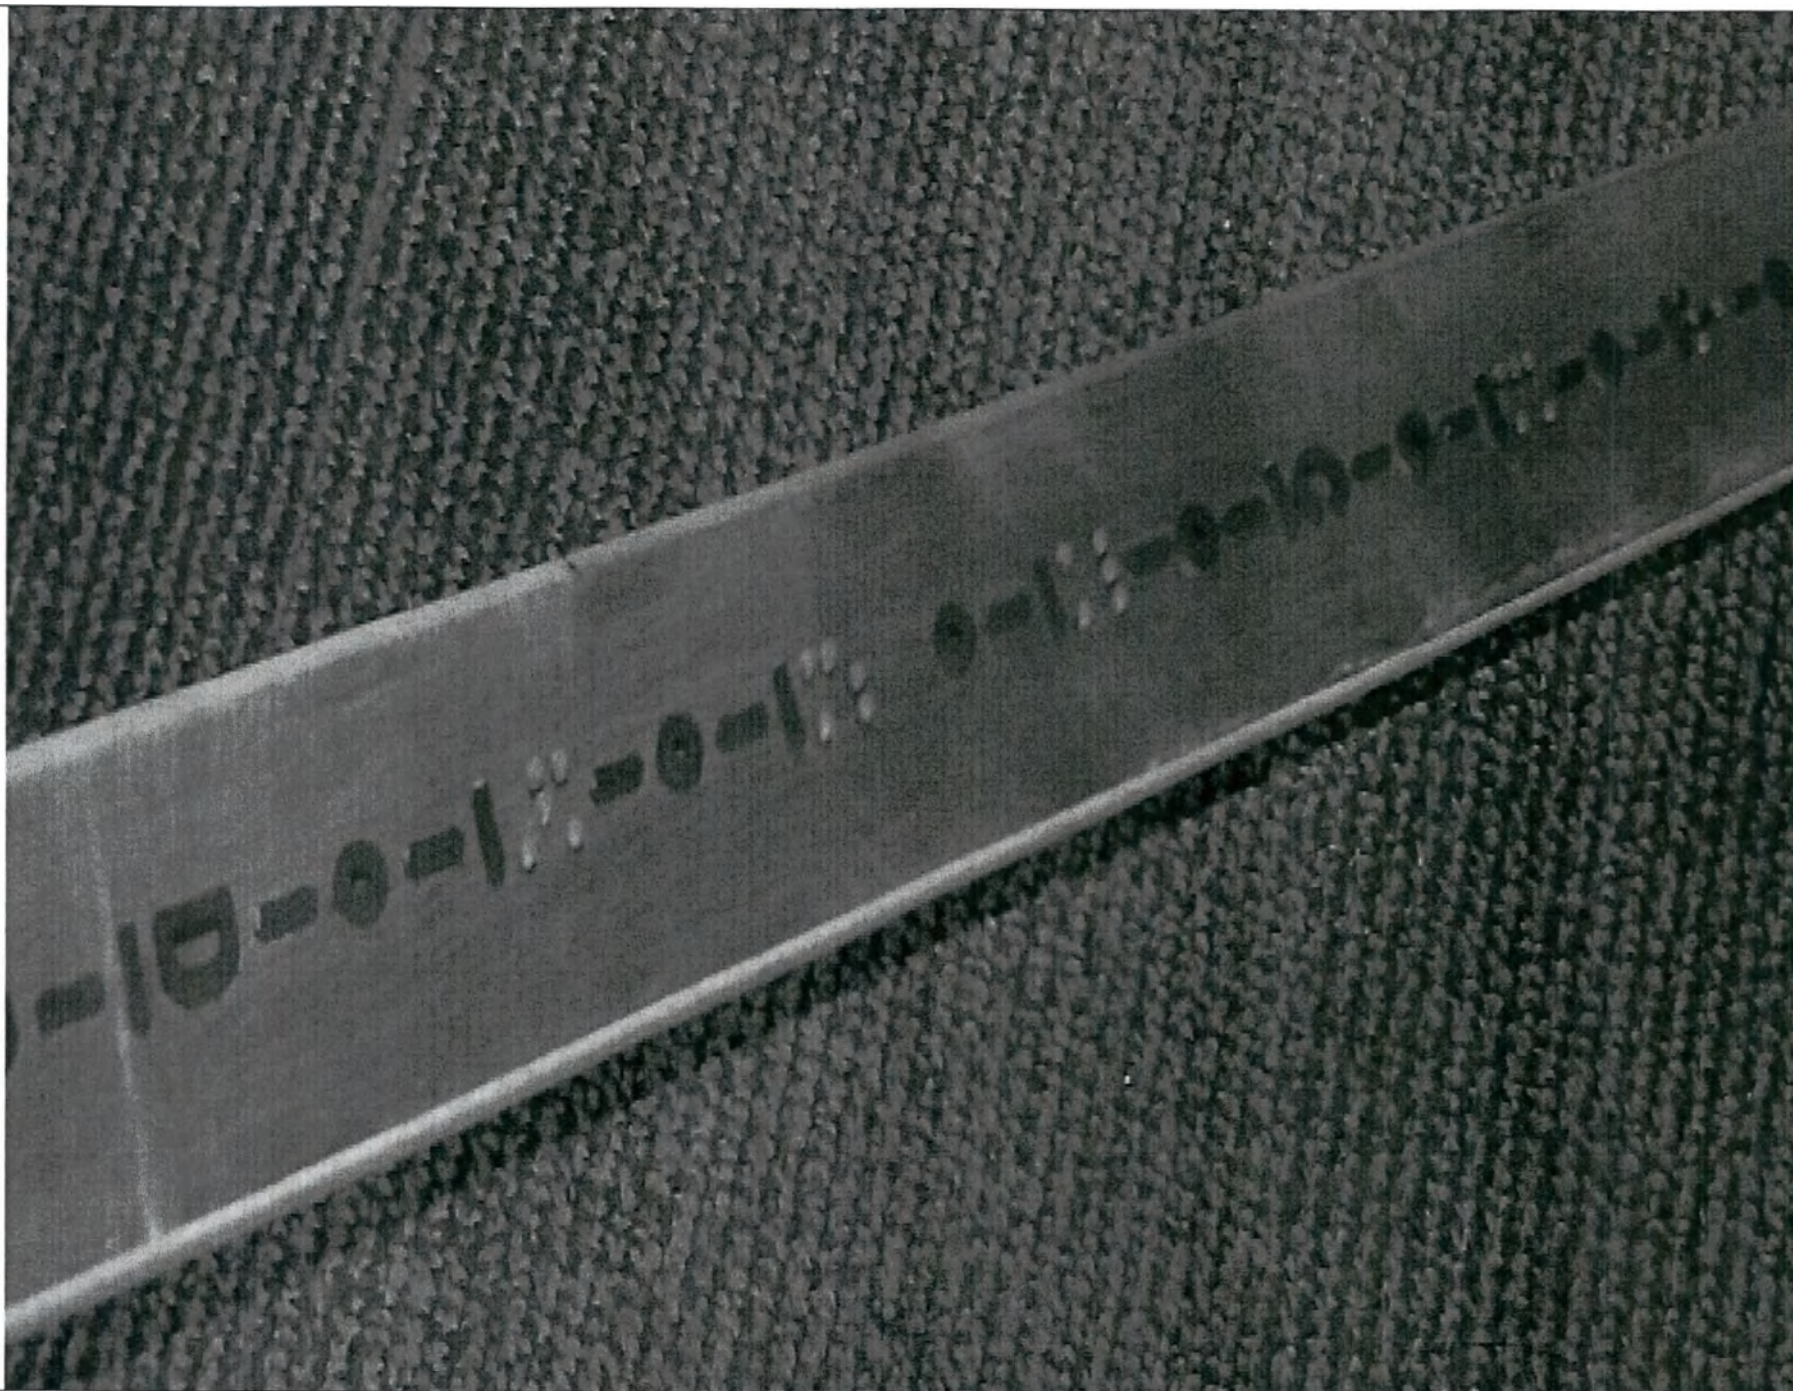


43. Линейка для сшивки.

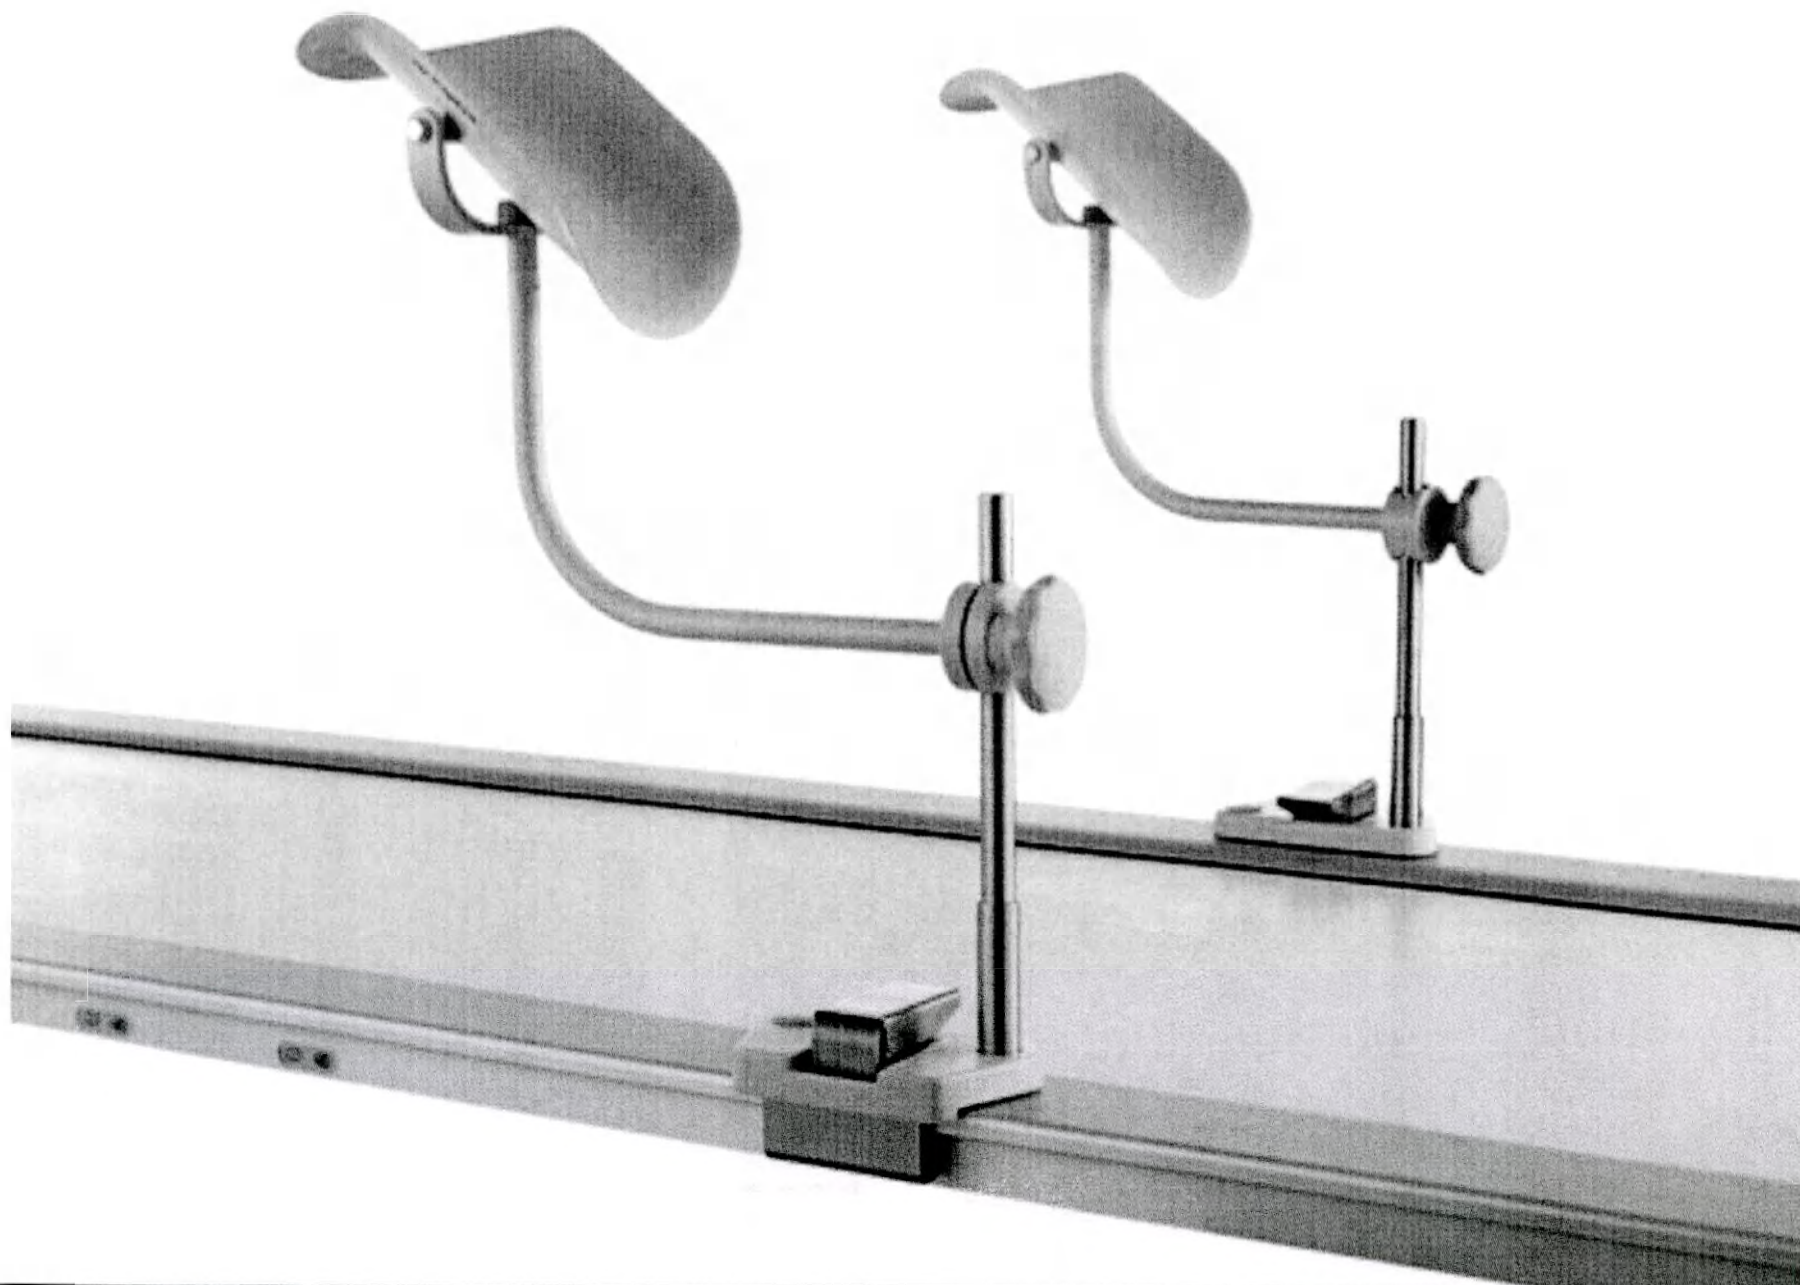

44. Подставки под голени.

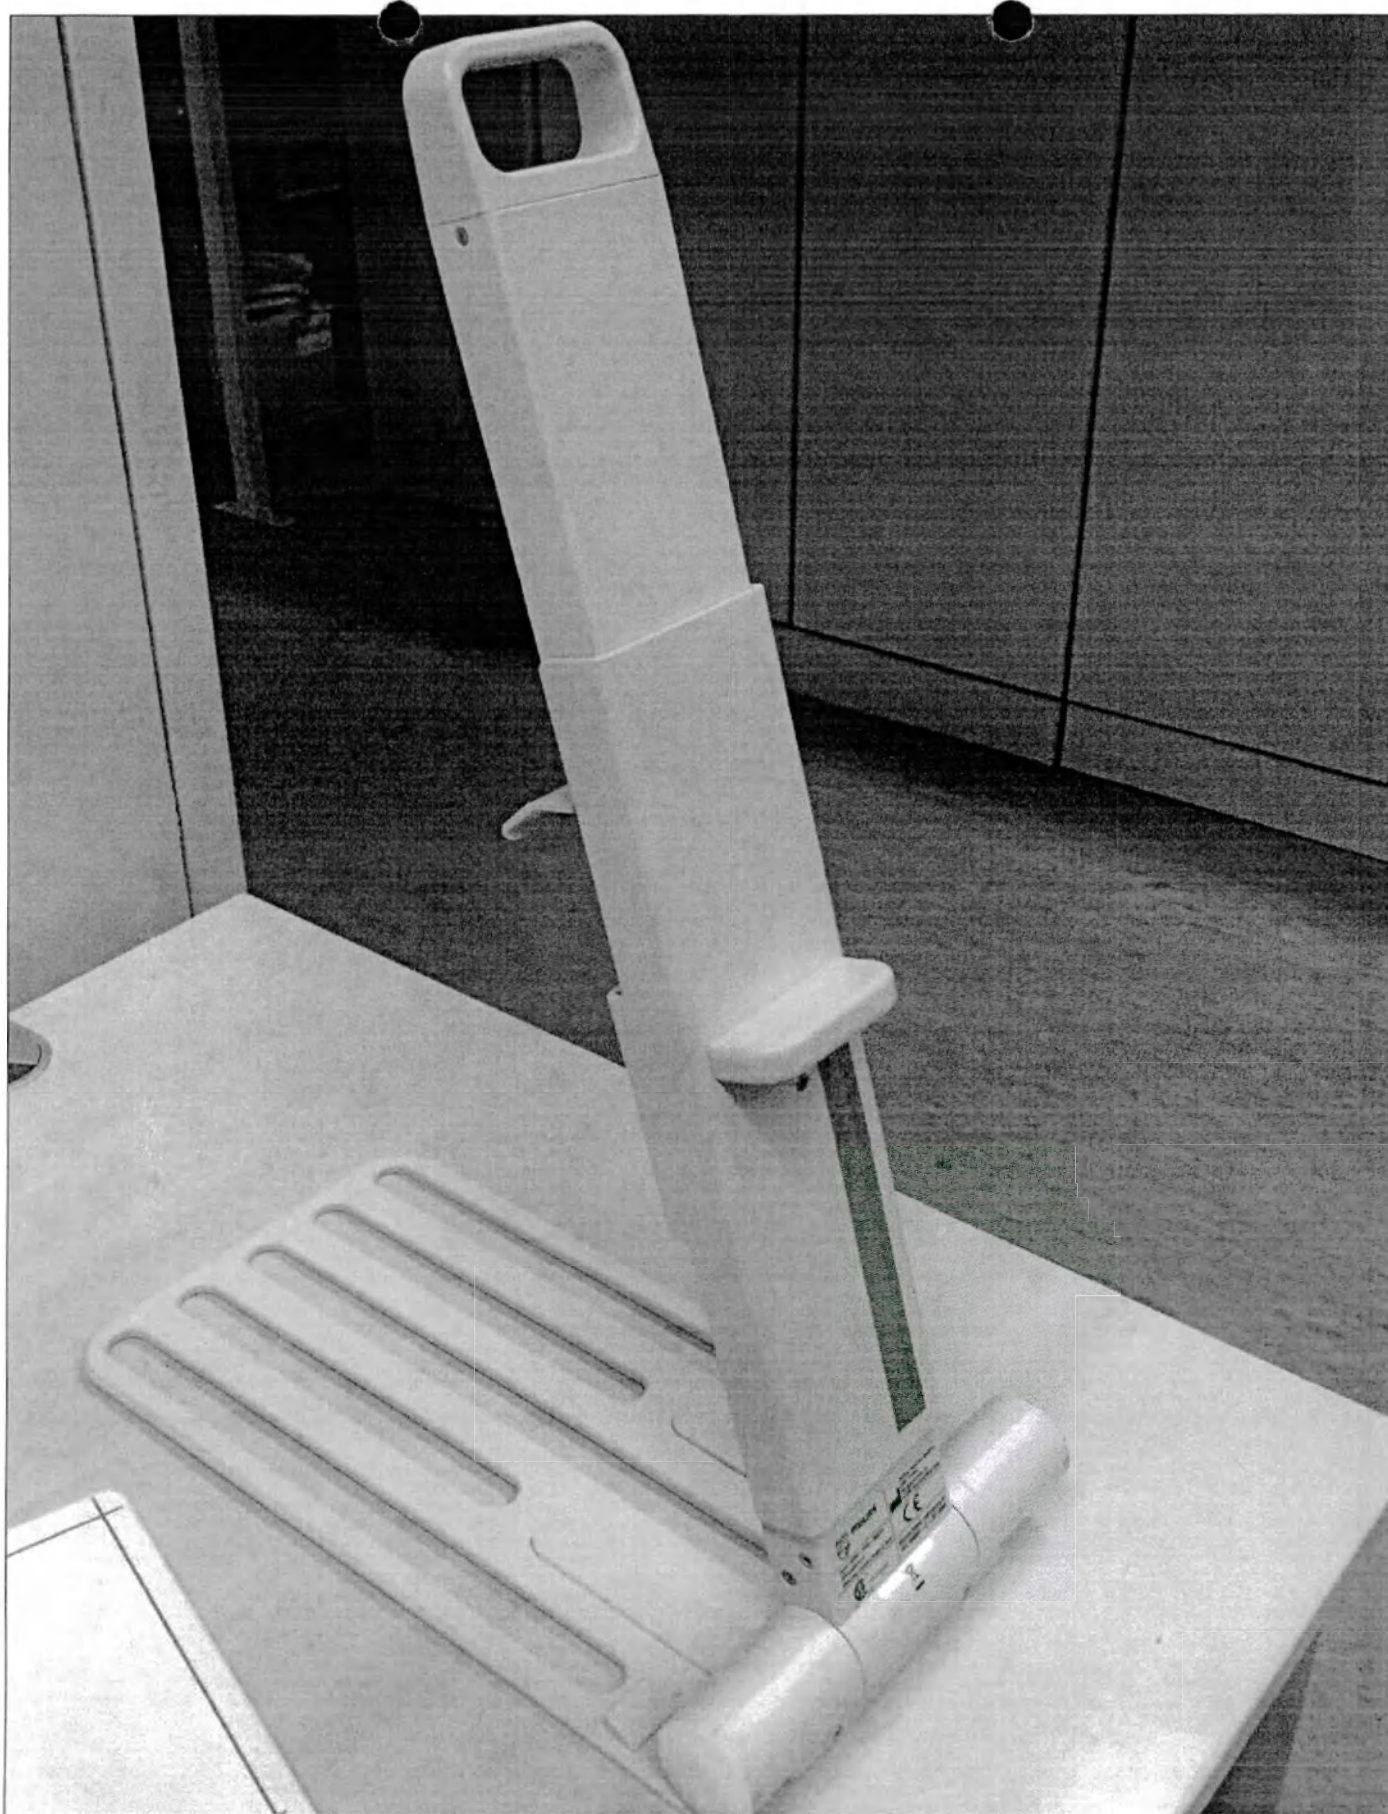


45. Держатель детектора на кровати пациента.

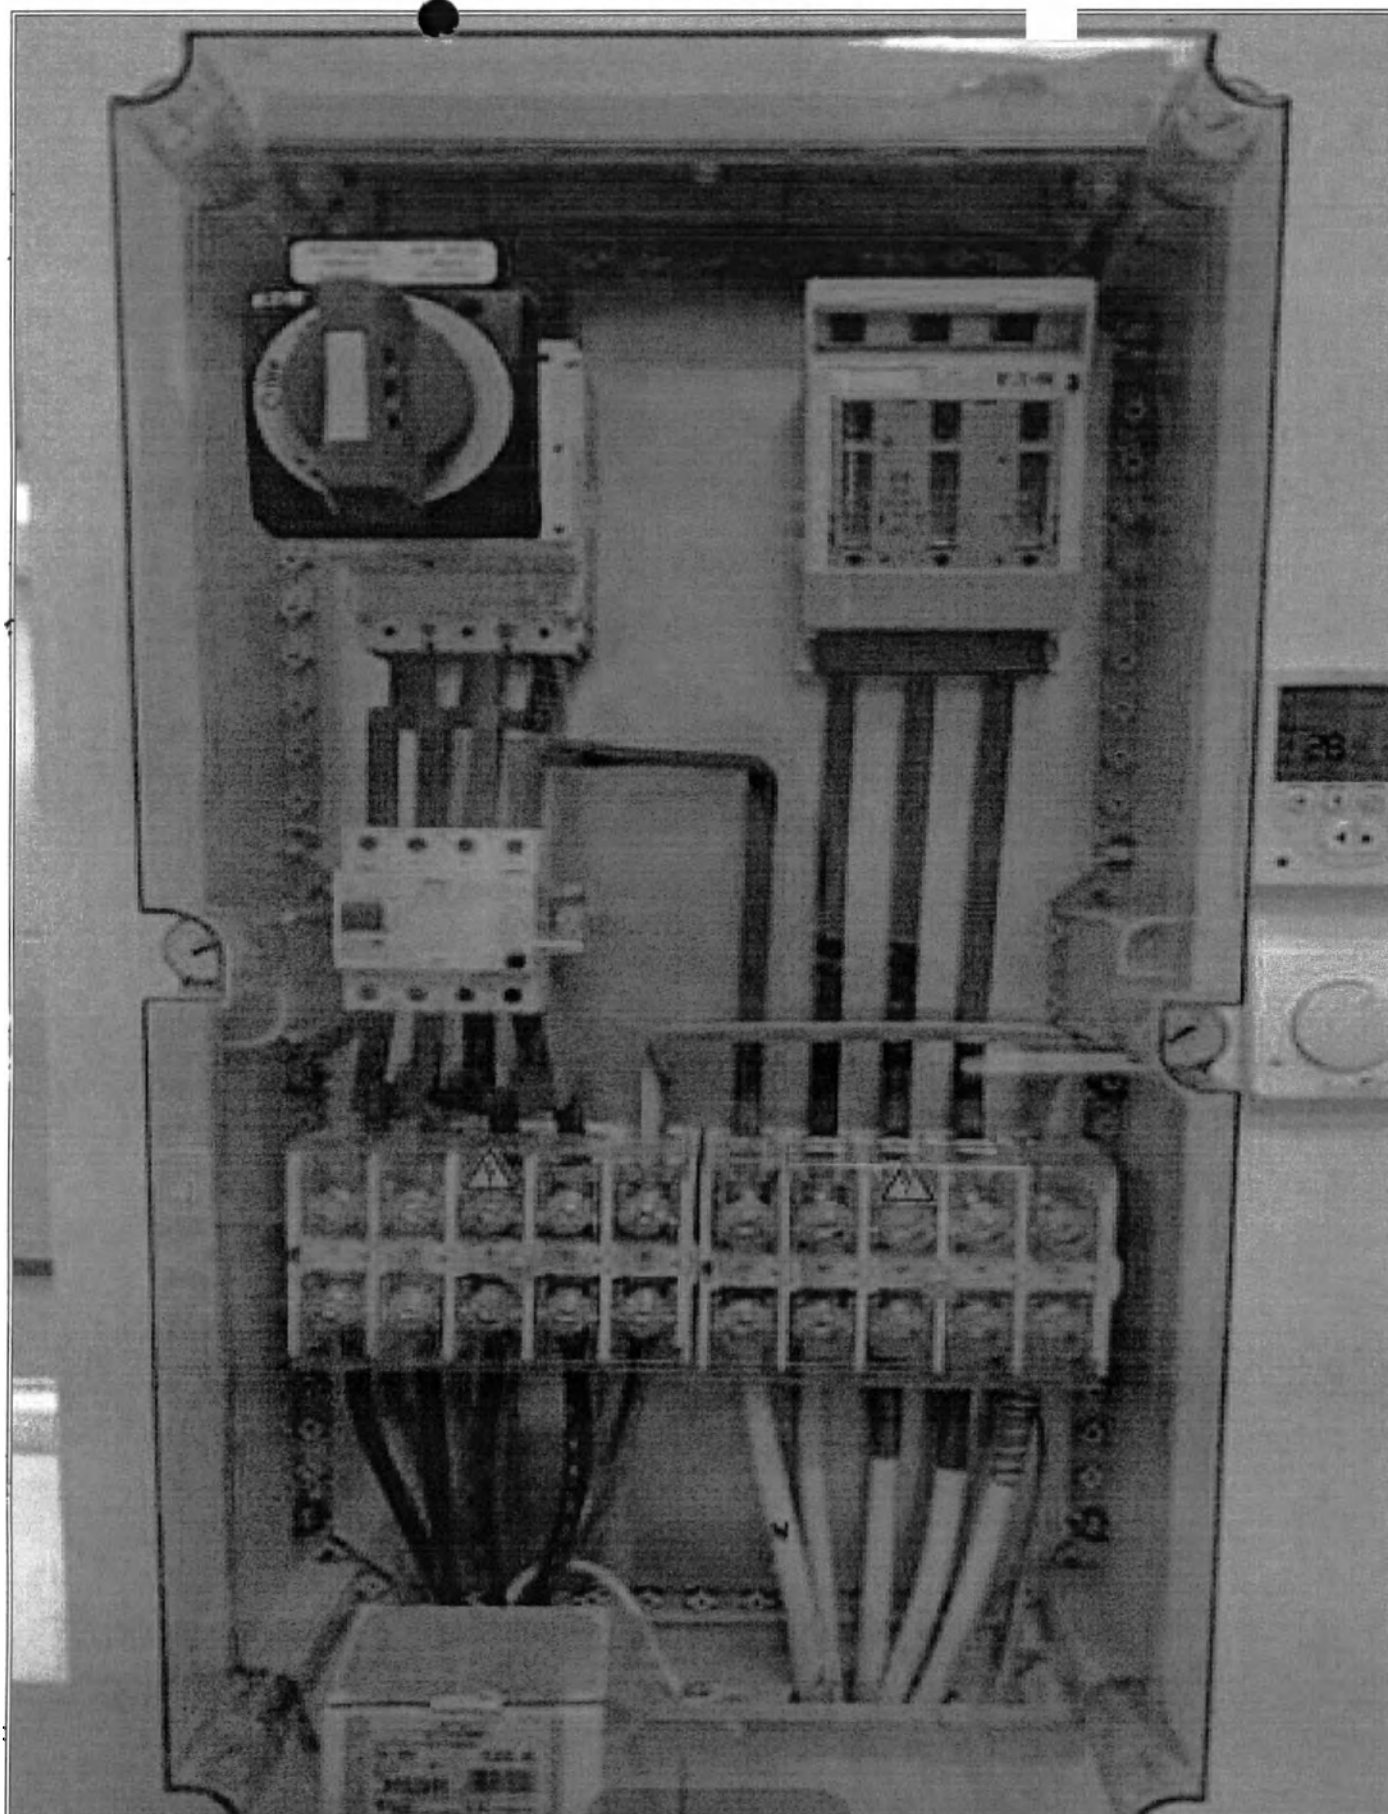

46. Рубильник включения электропитания




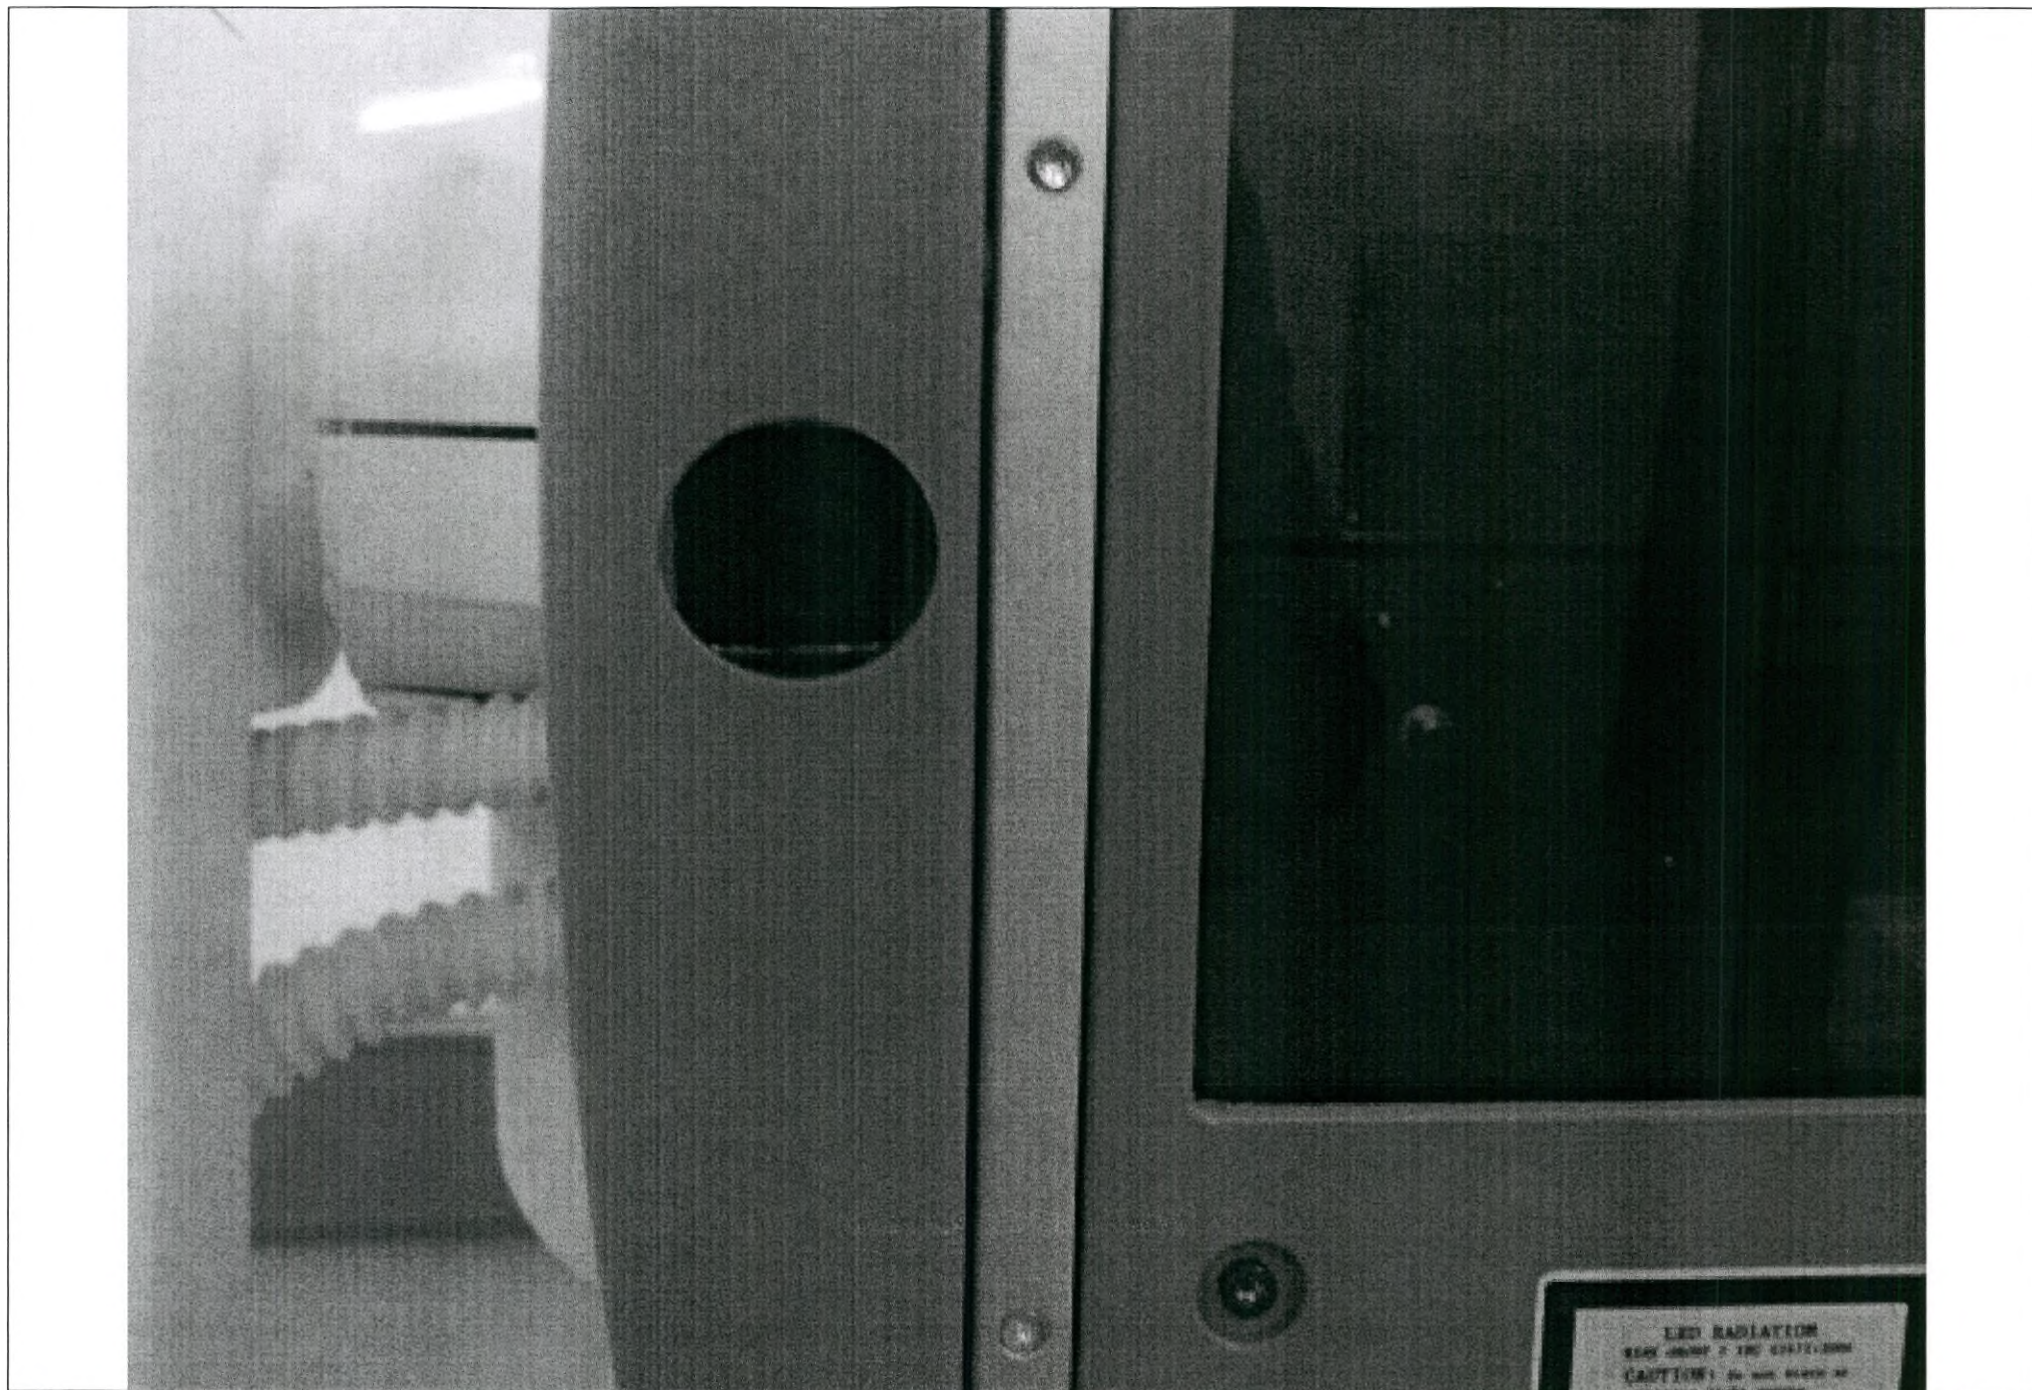







49.6 Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.

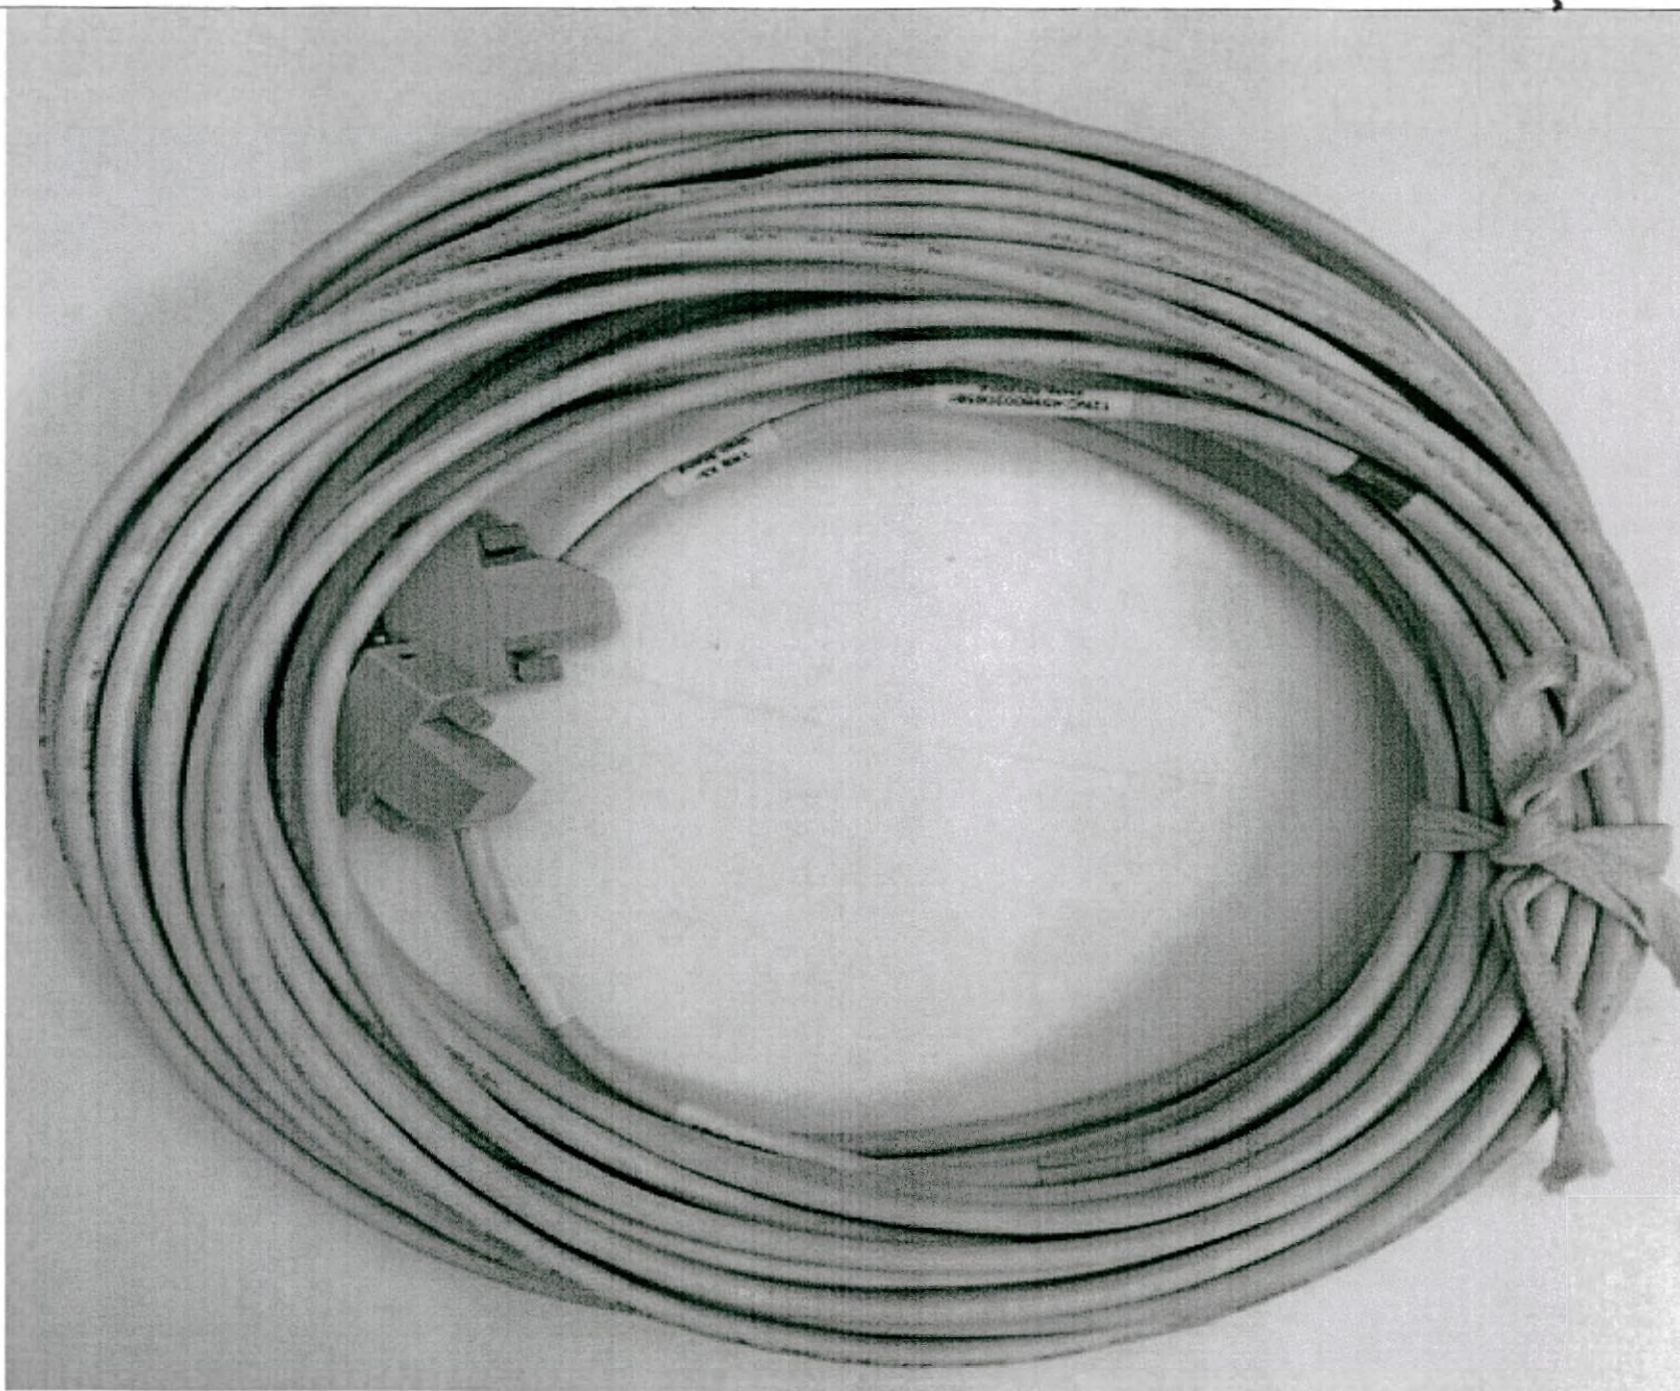


49.в Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.

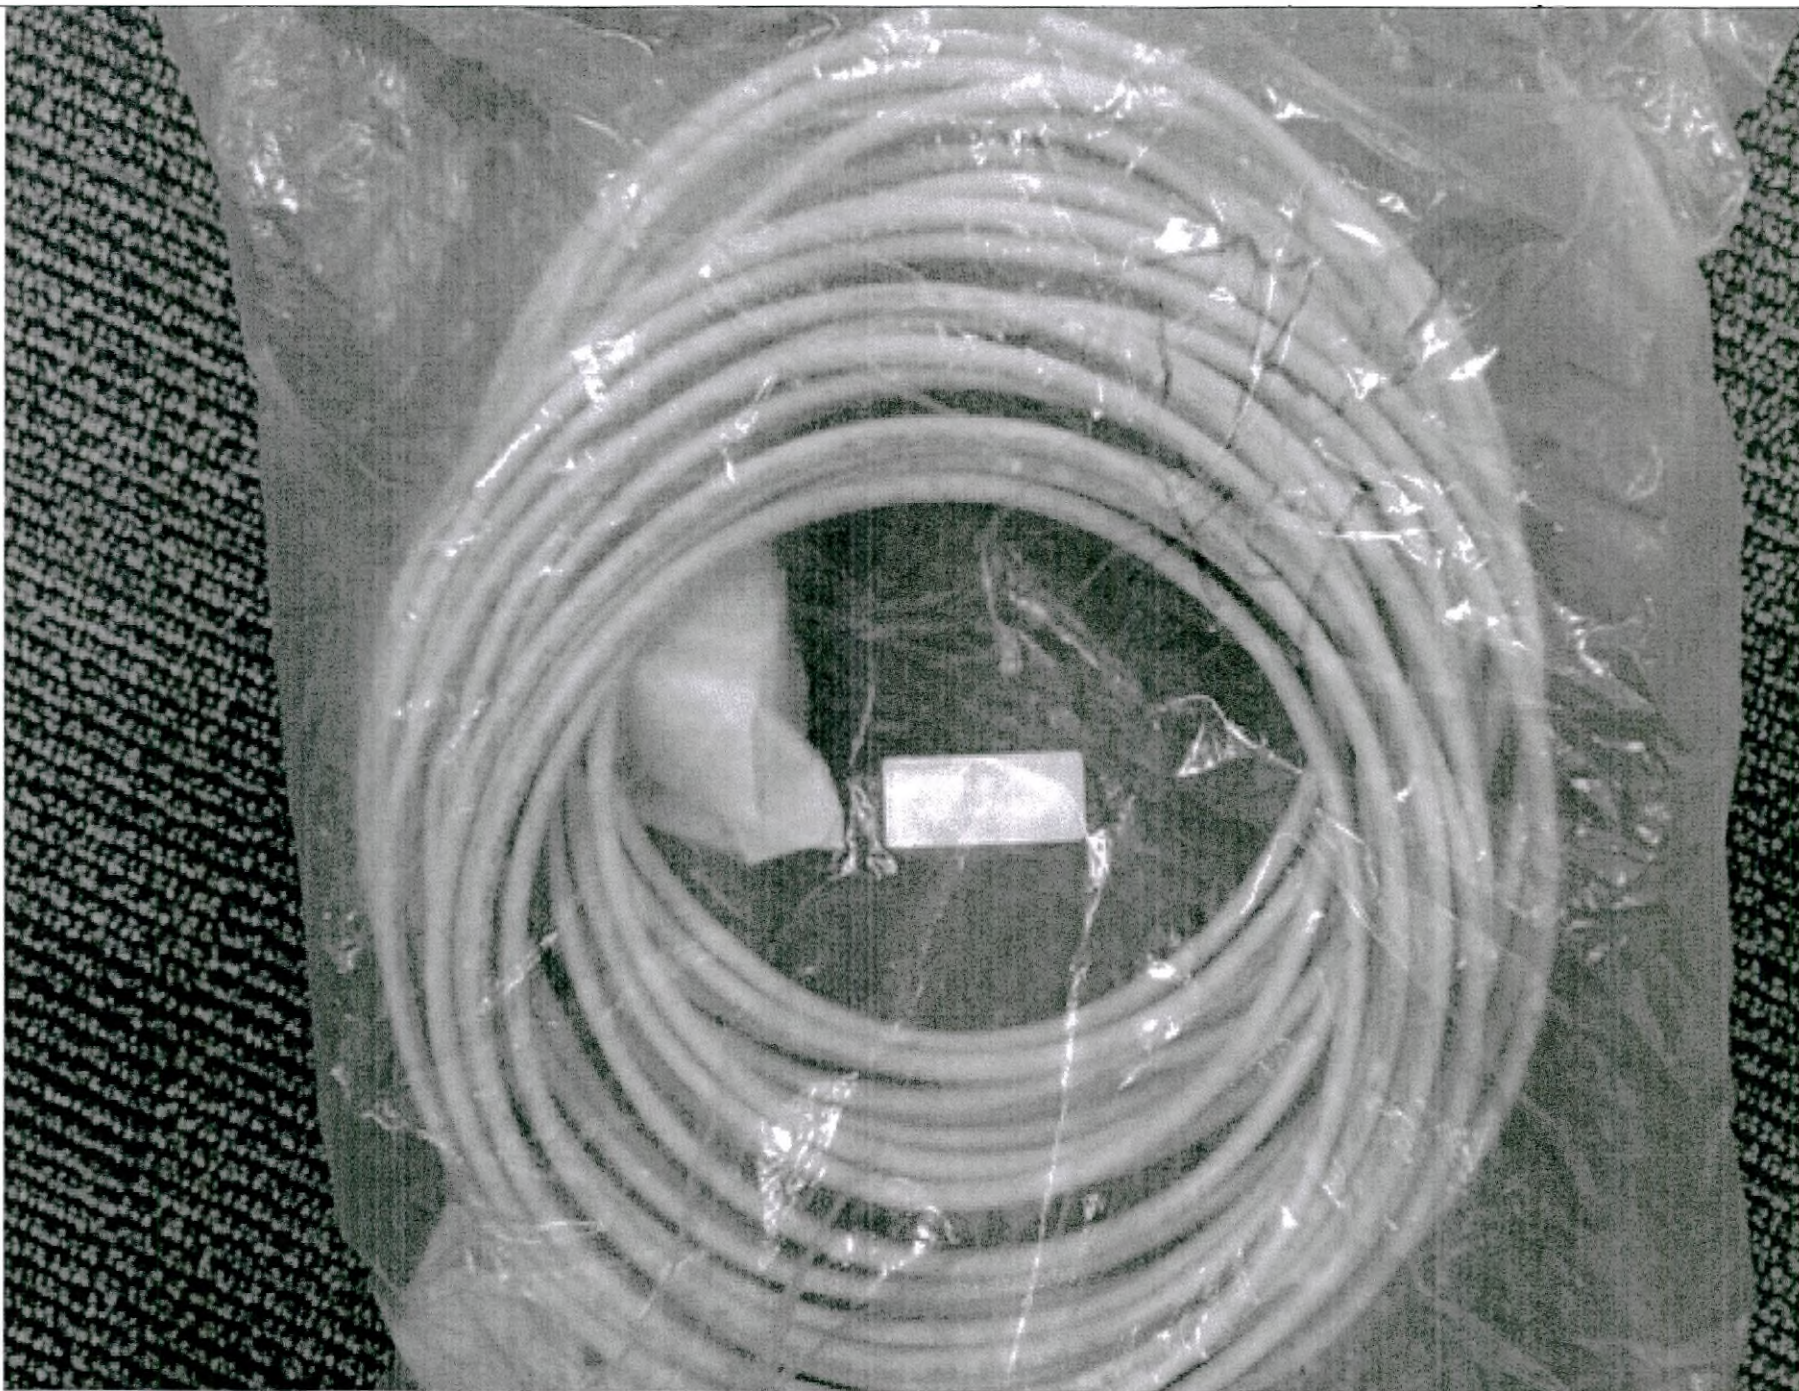


49.г Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.

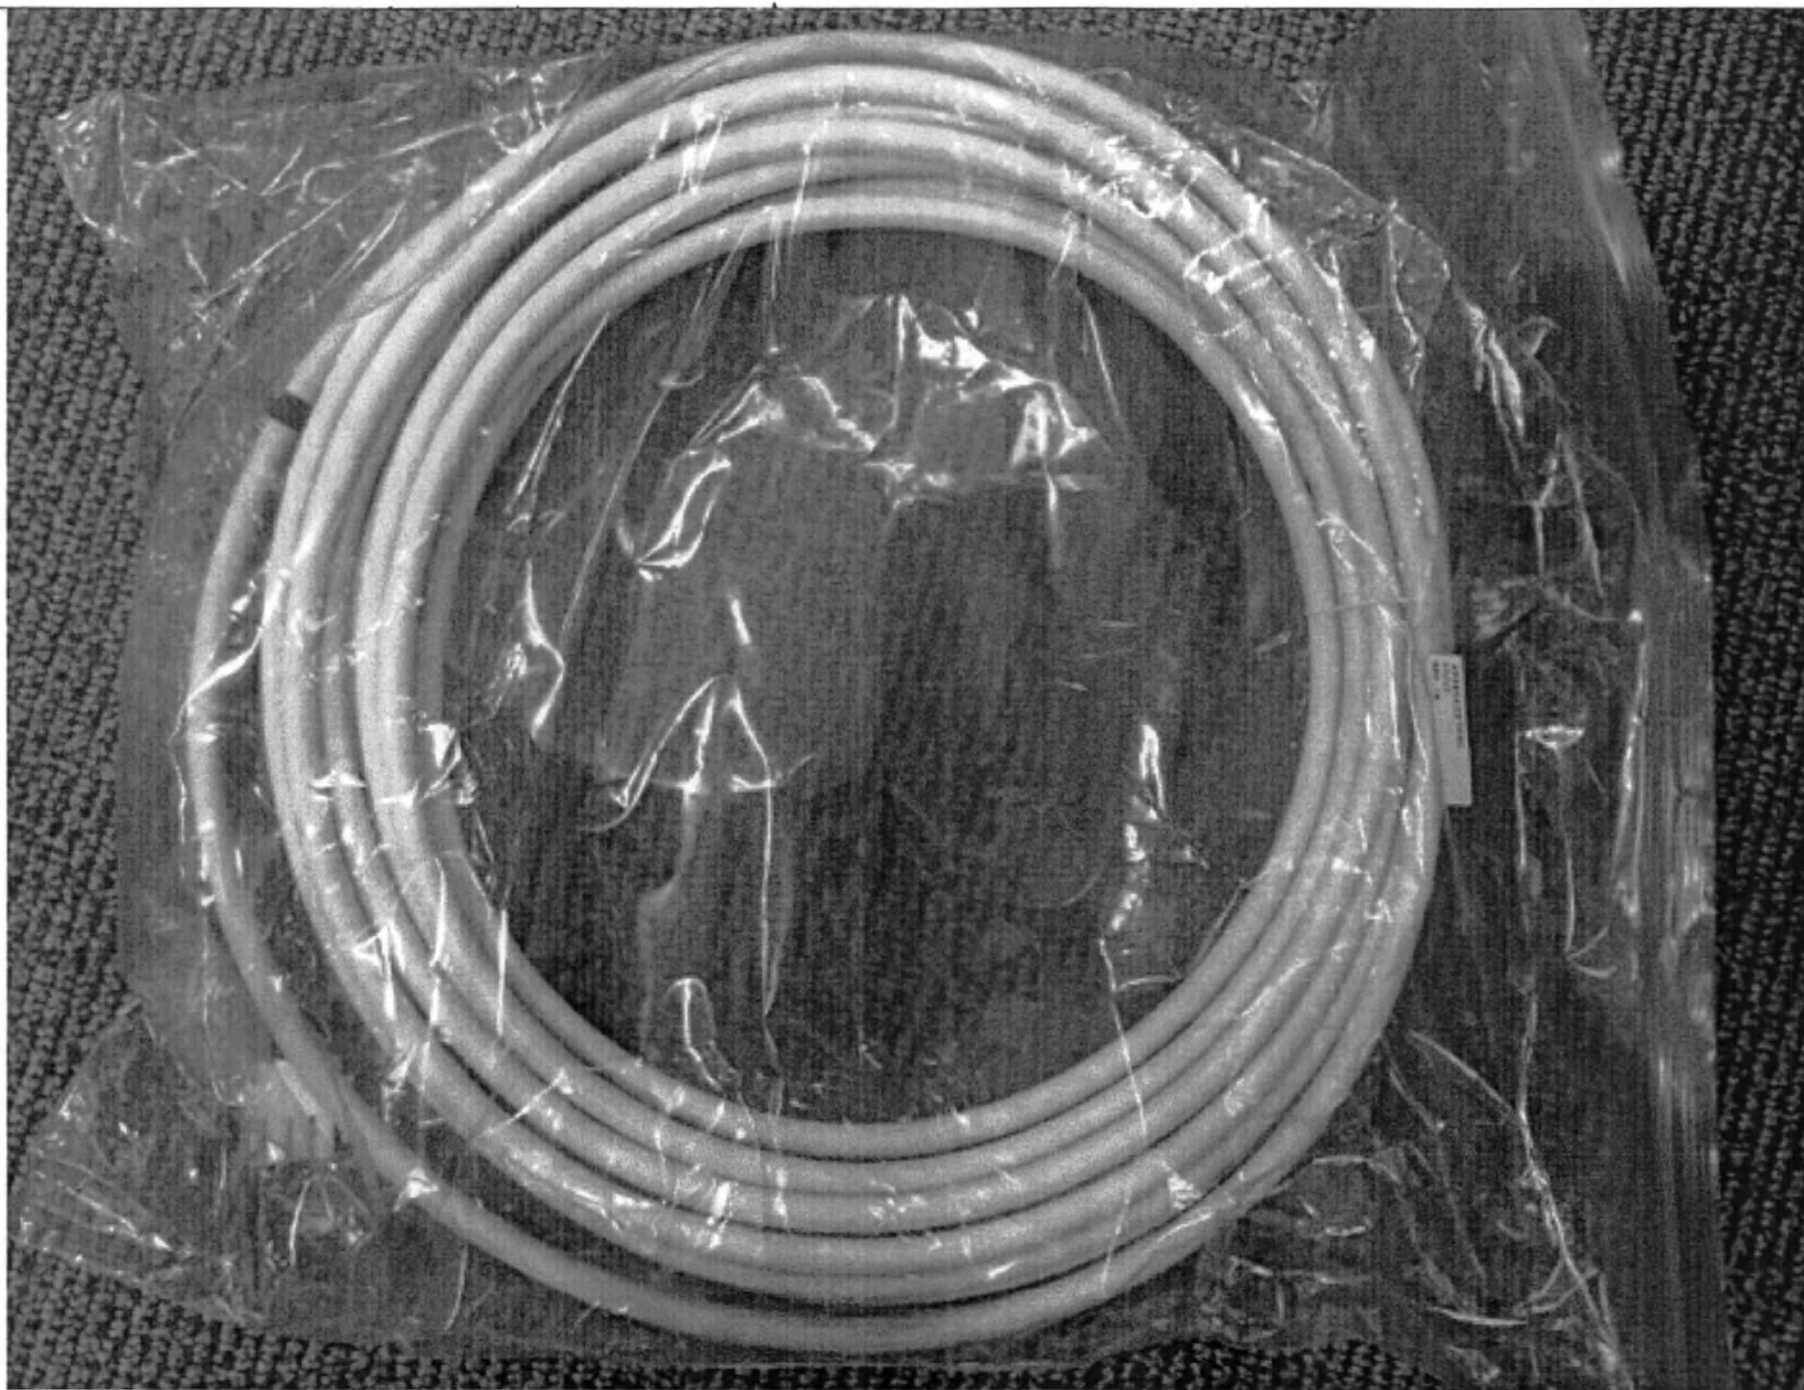


49.д Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.

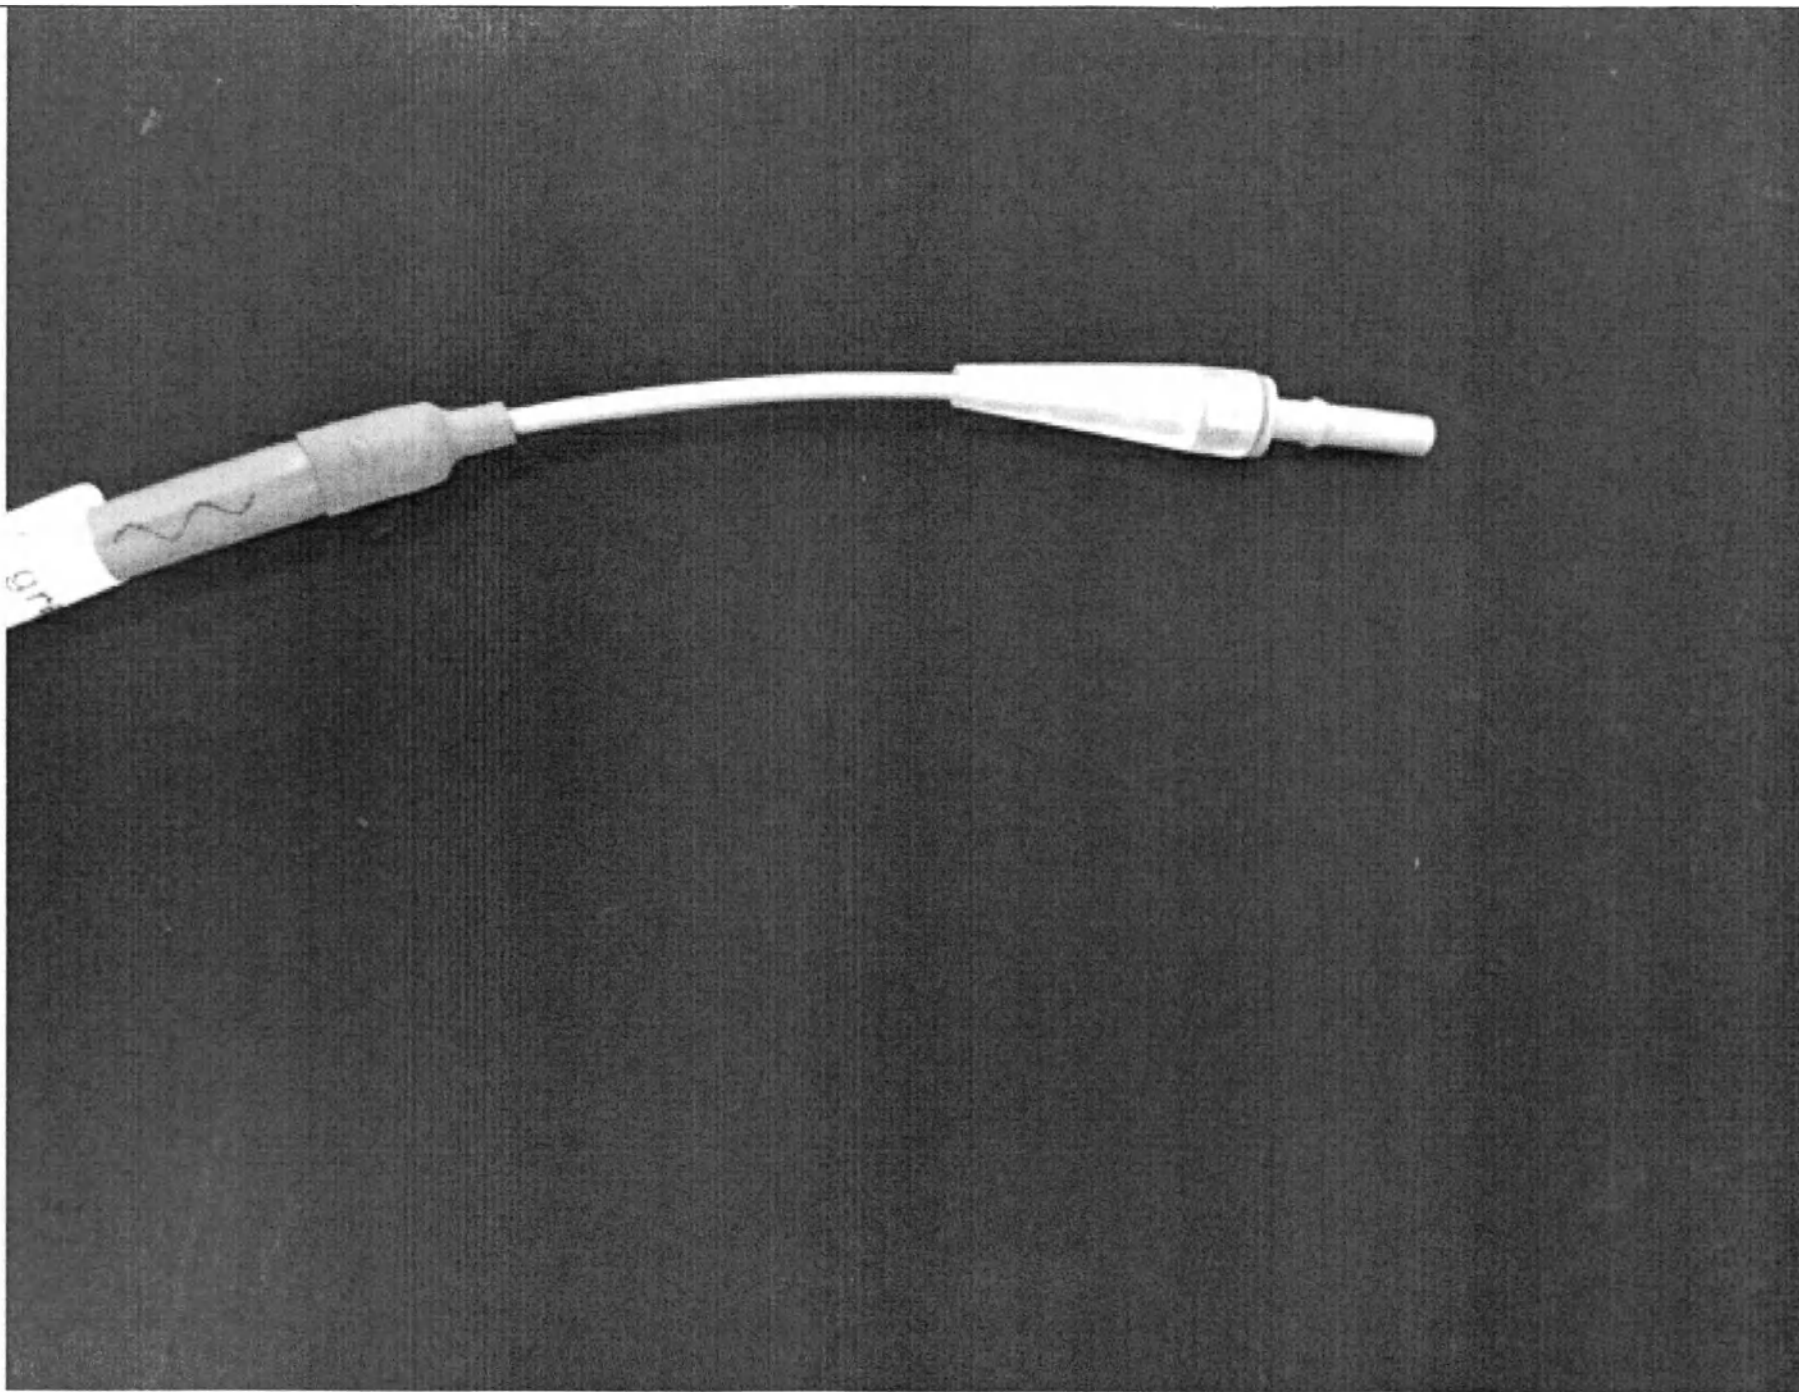


49.е Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.

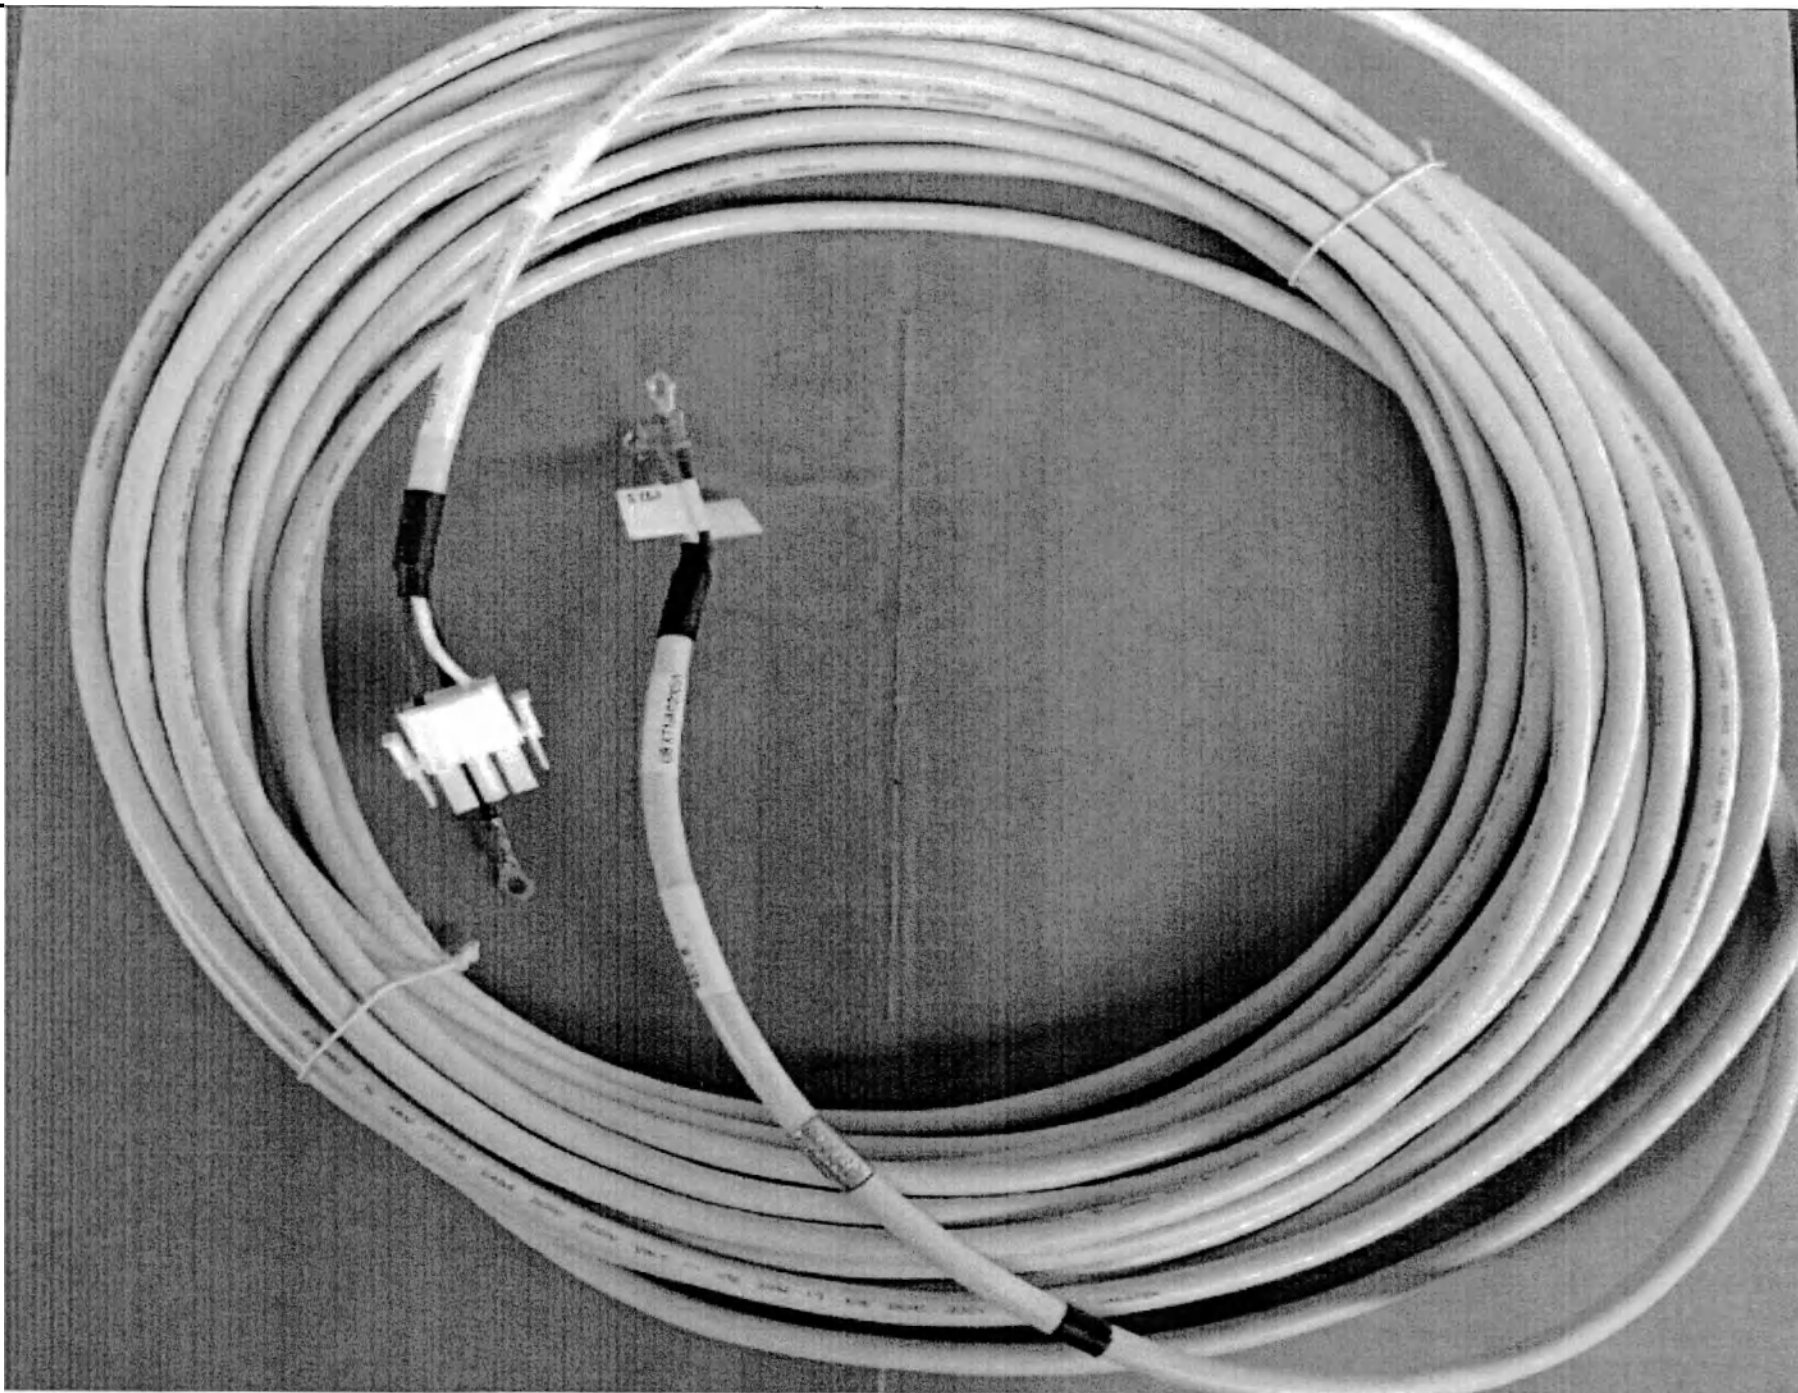


49.ж Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.

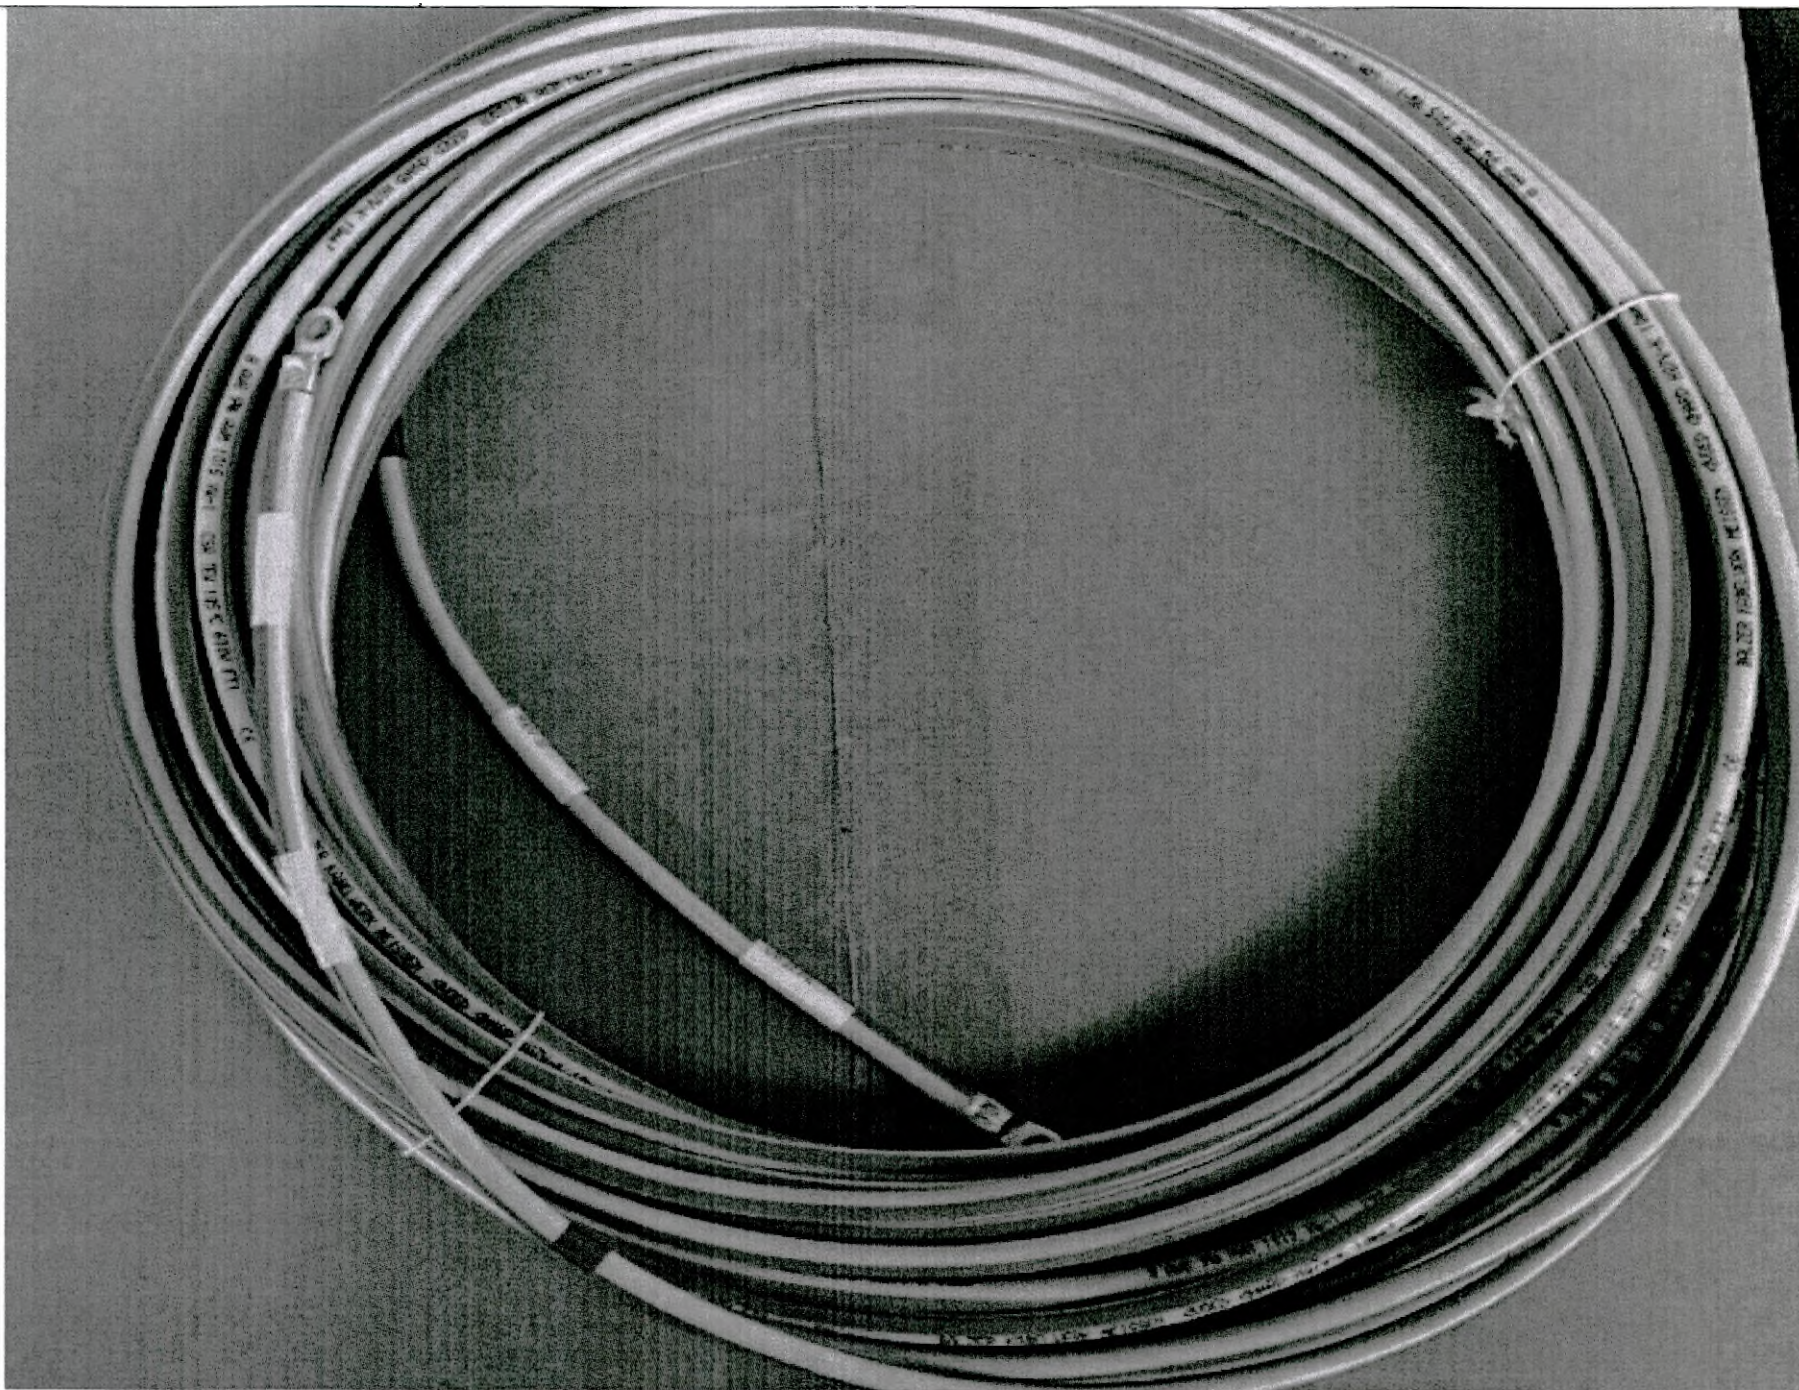


49.и Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.

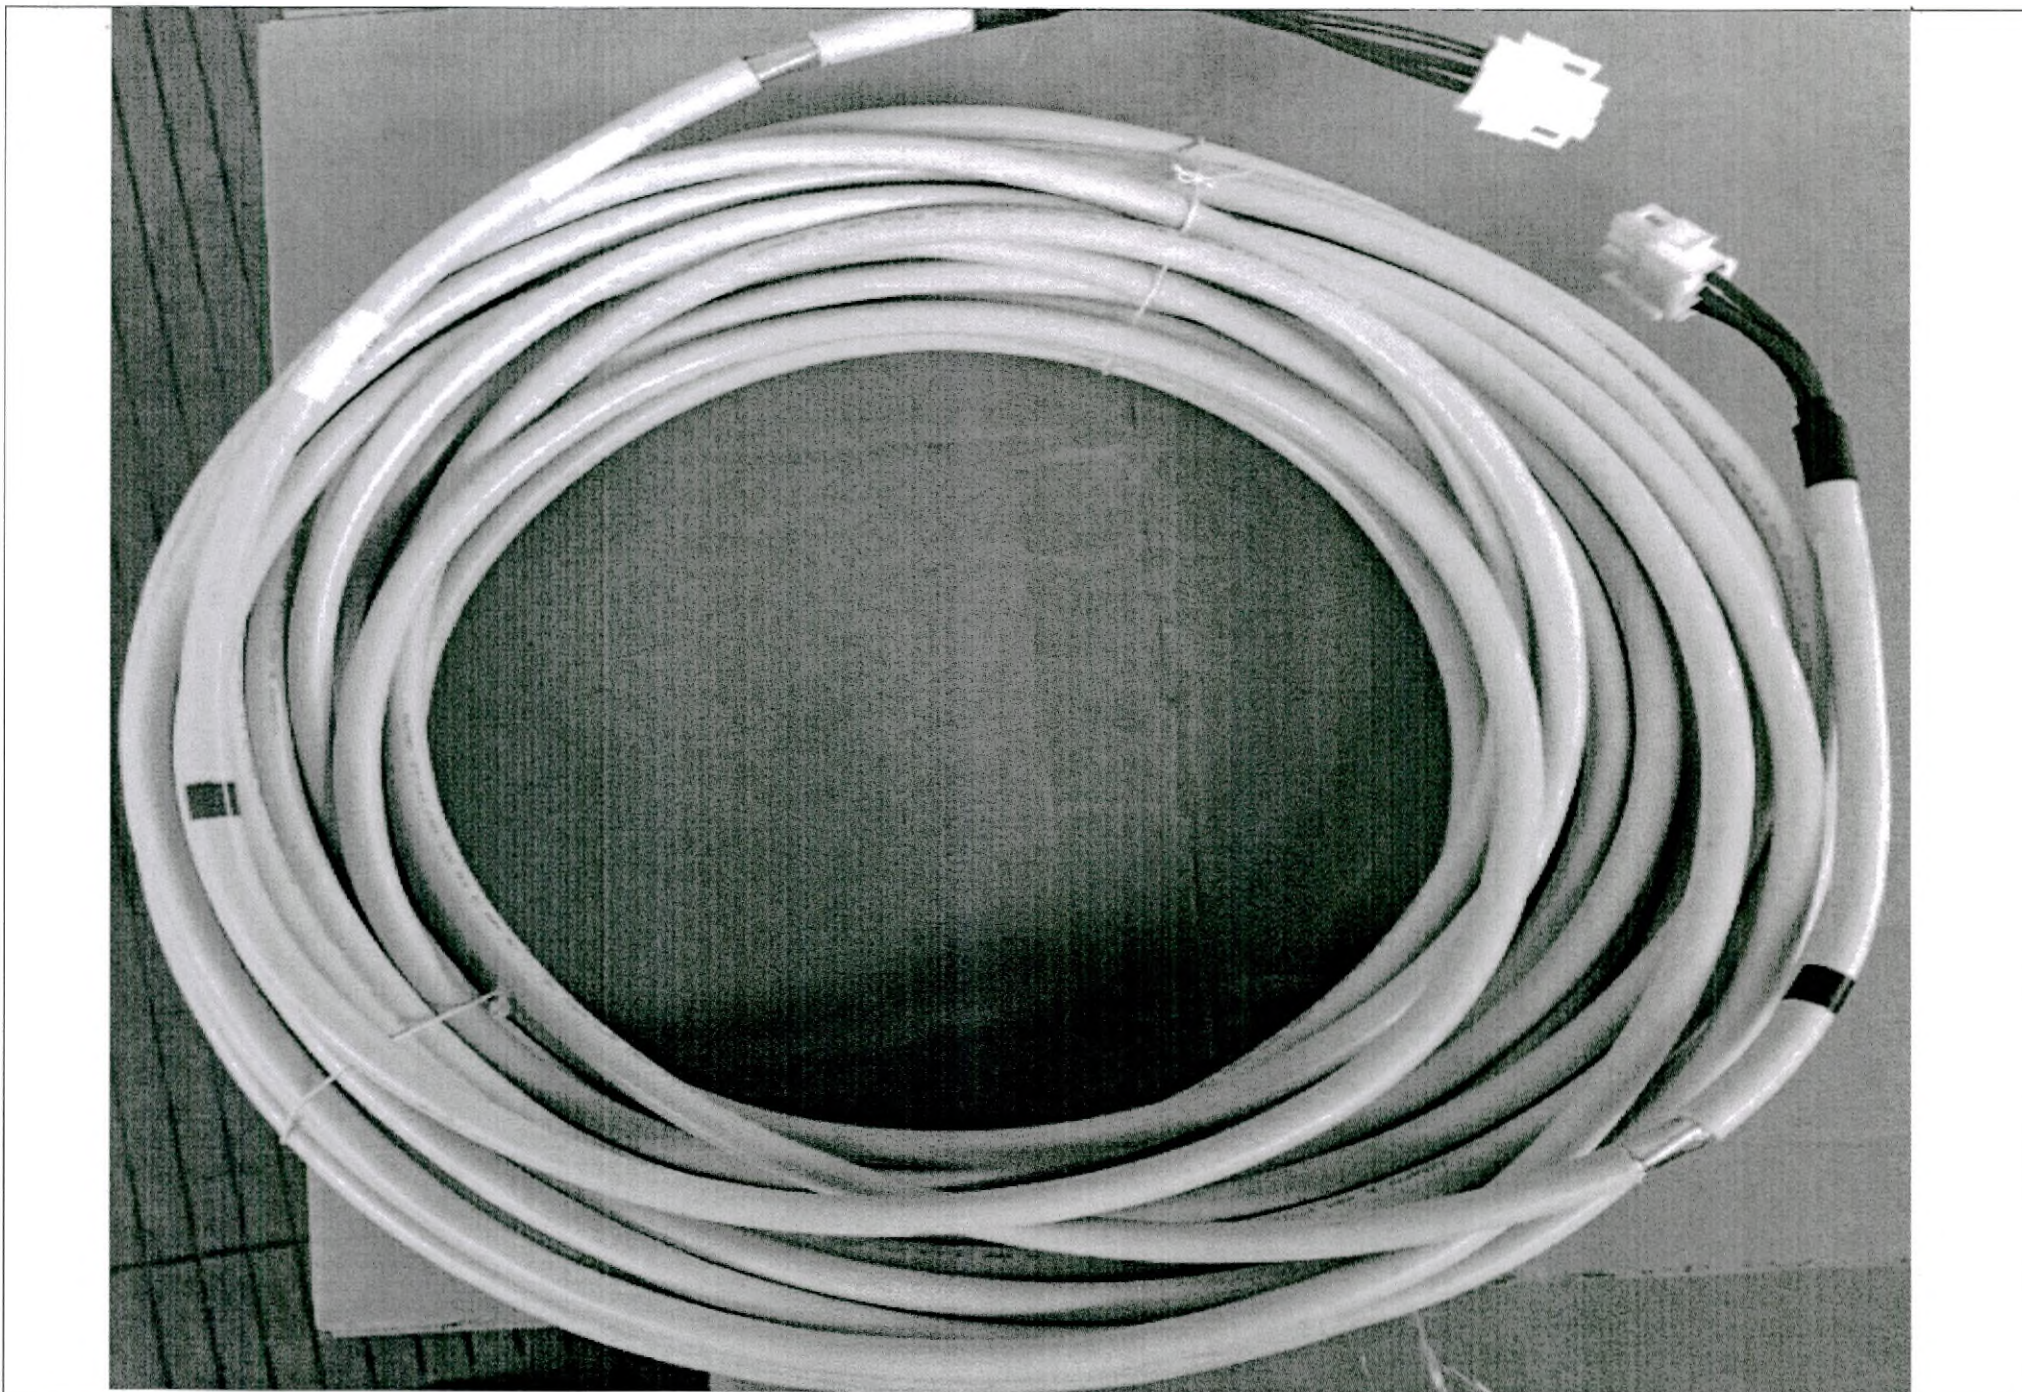


49.к Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.

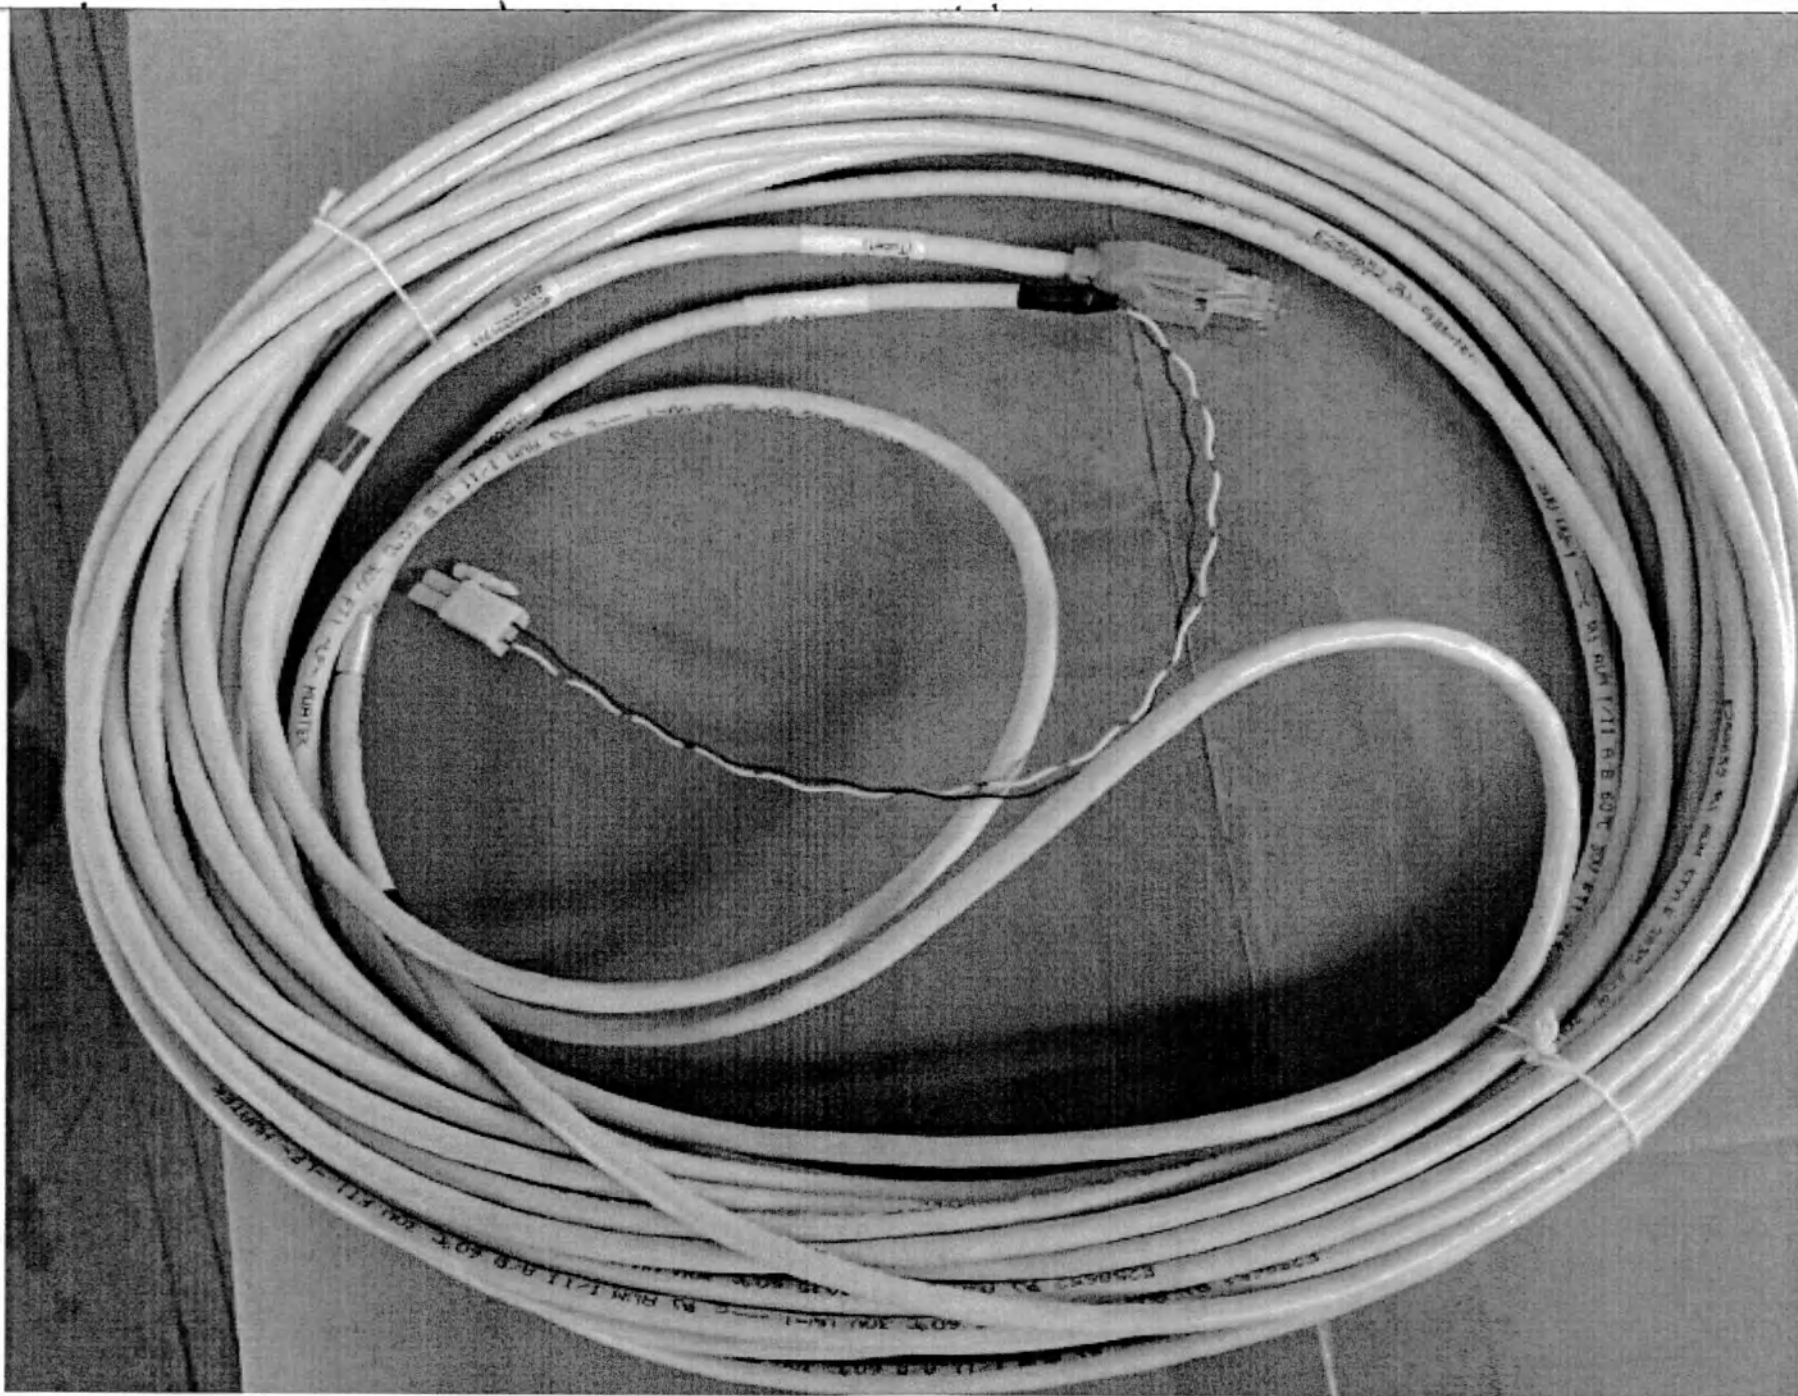


49.л Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.

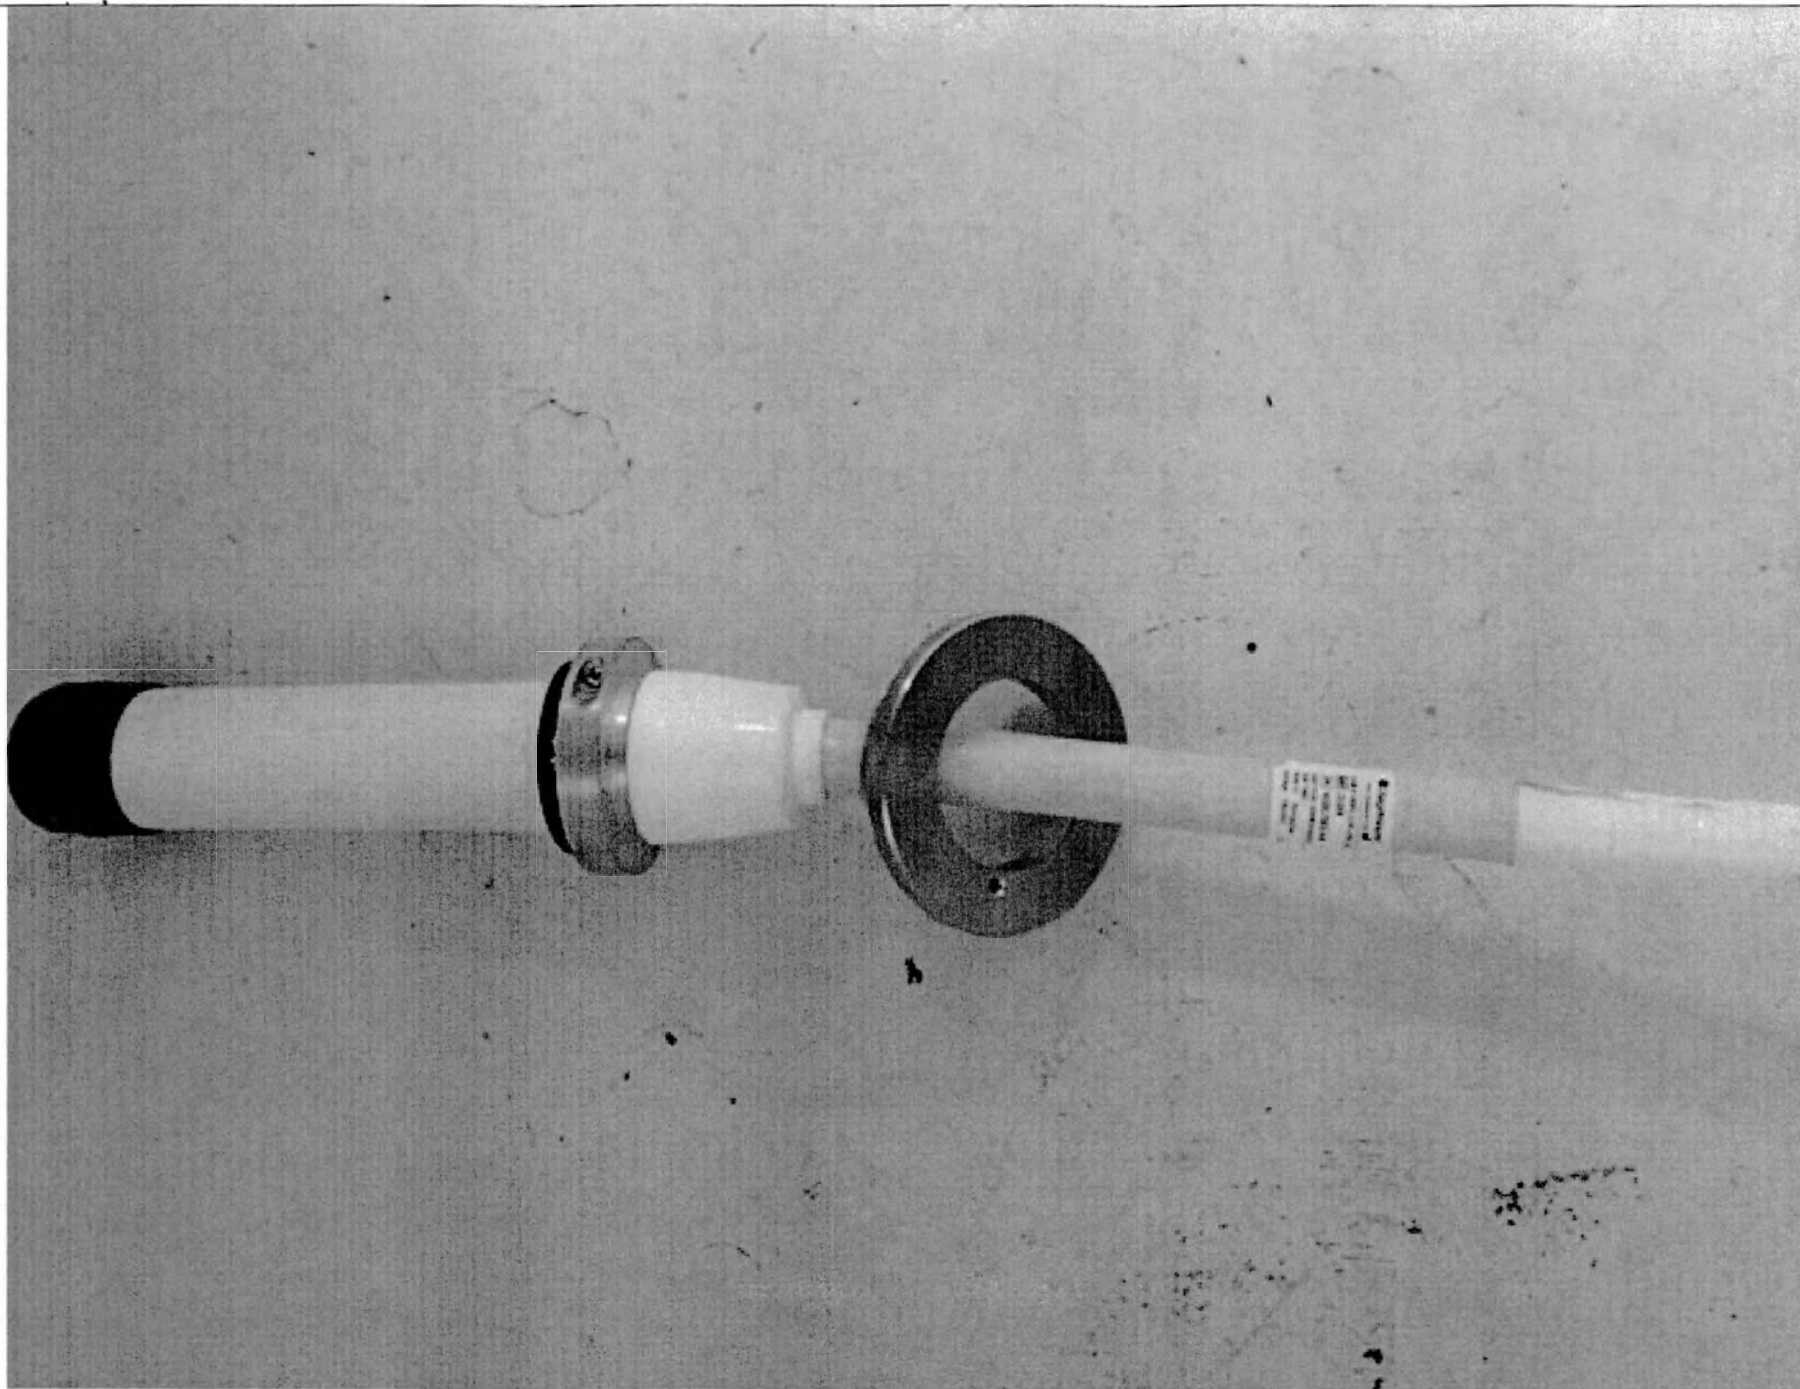


49.м Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.

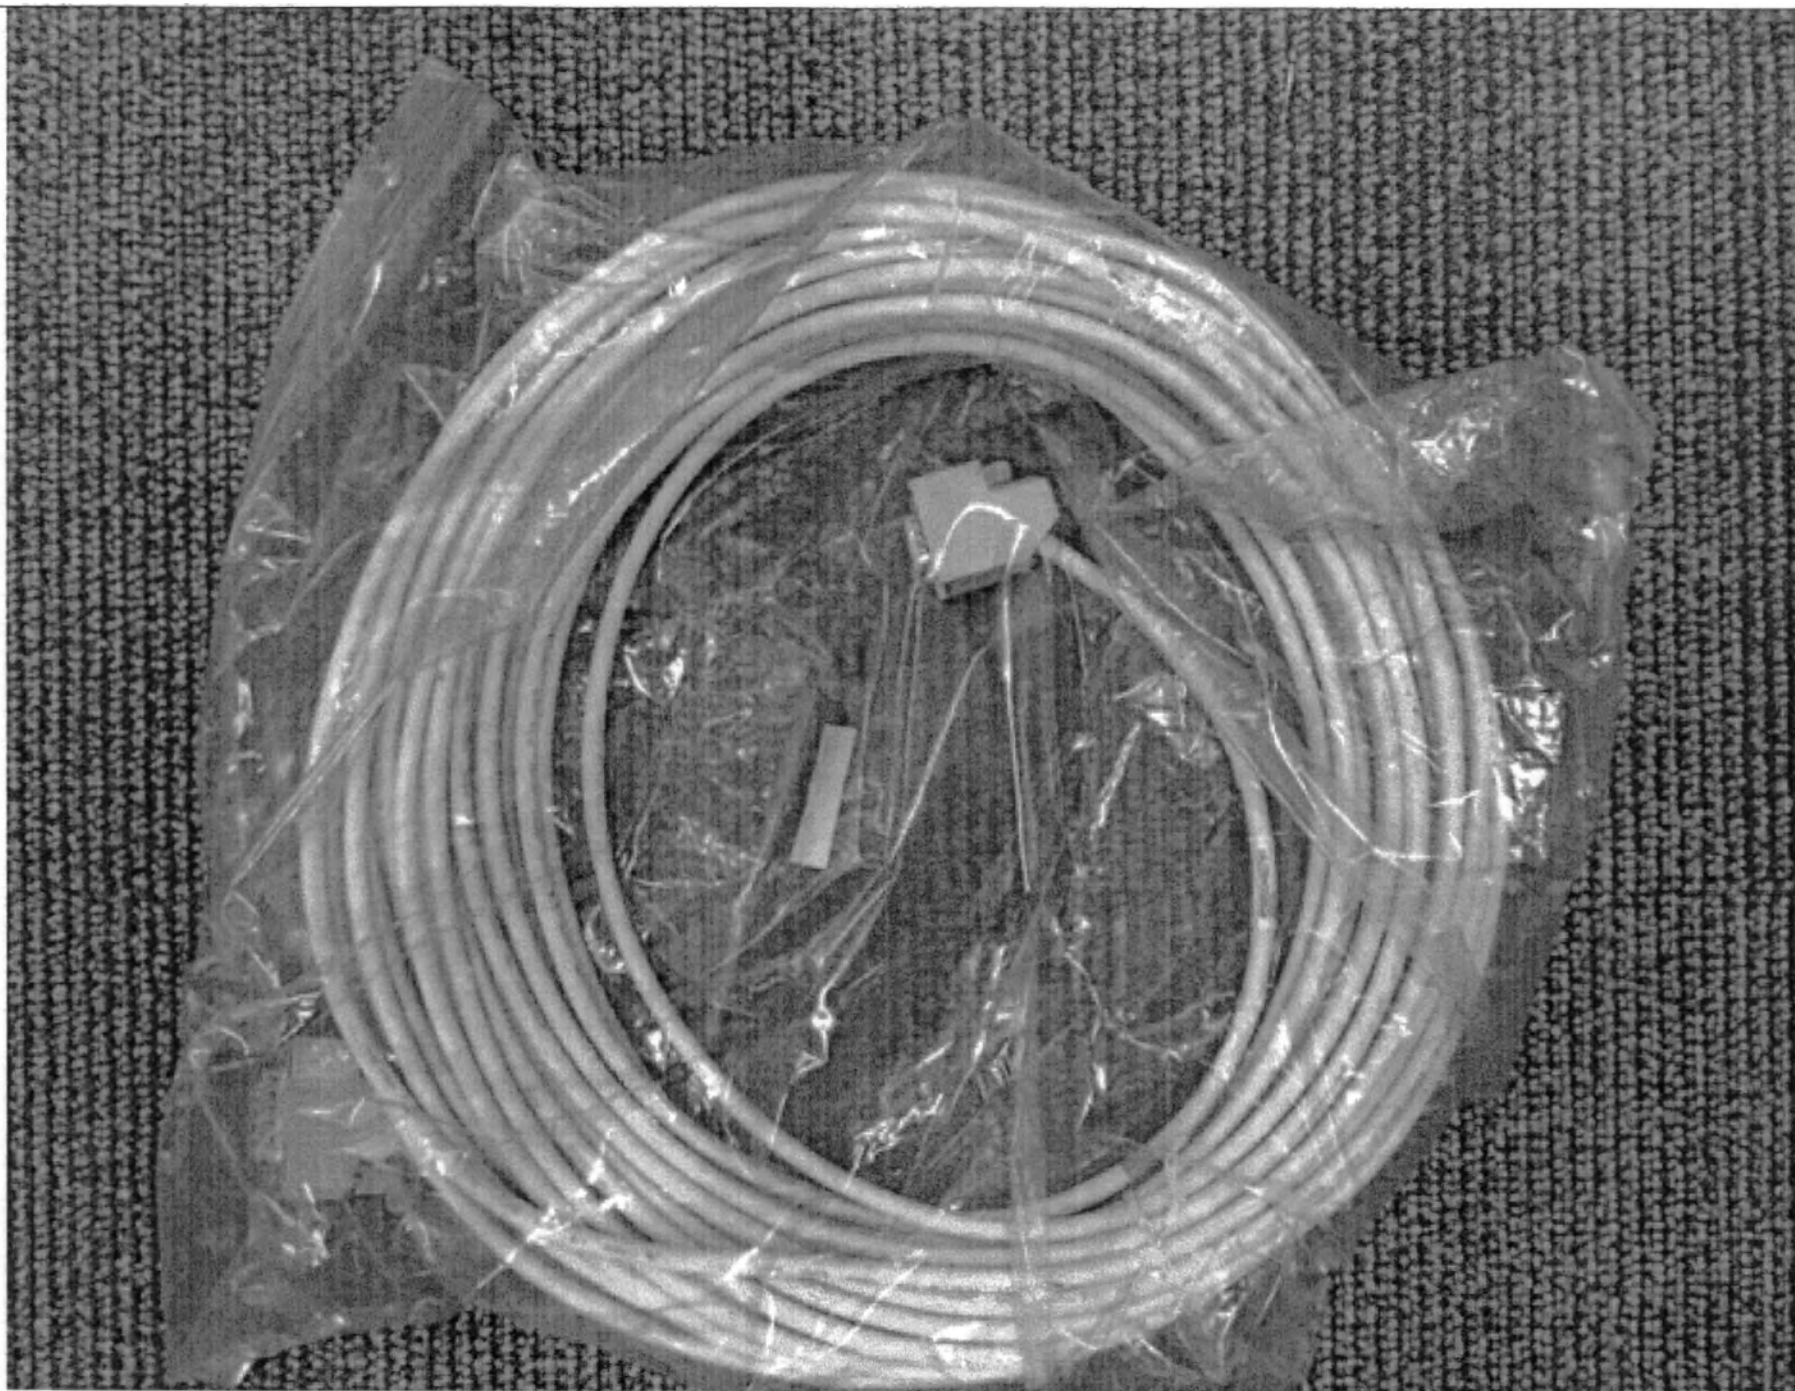

49.н Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.

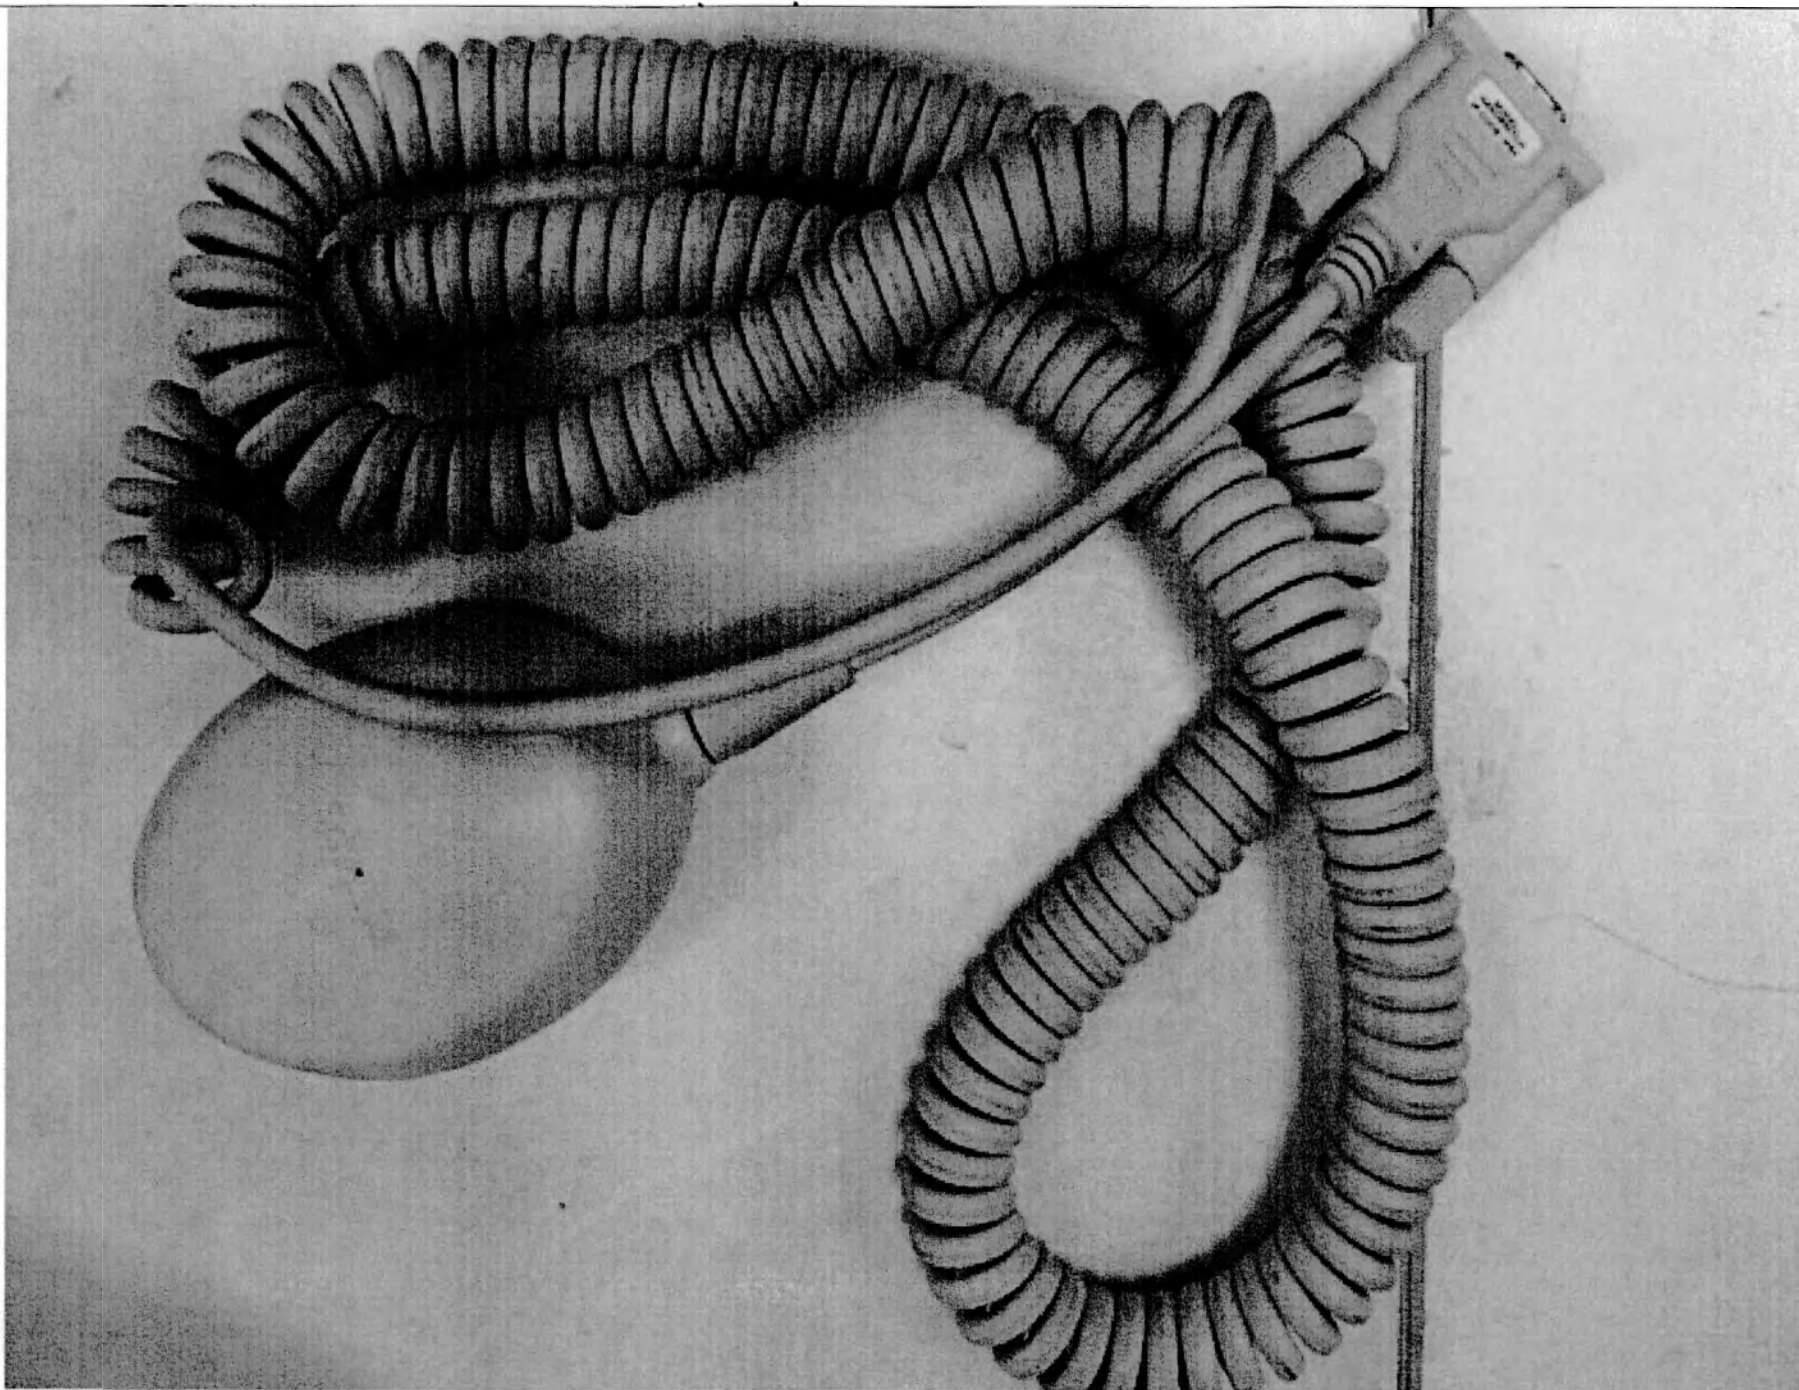


49.о Кабели силовые, управляющие, коаксиальные, высоковольтные, оптические.

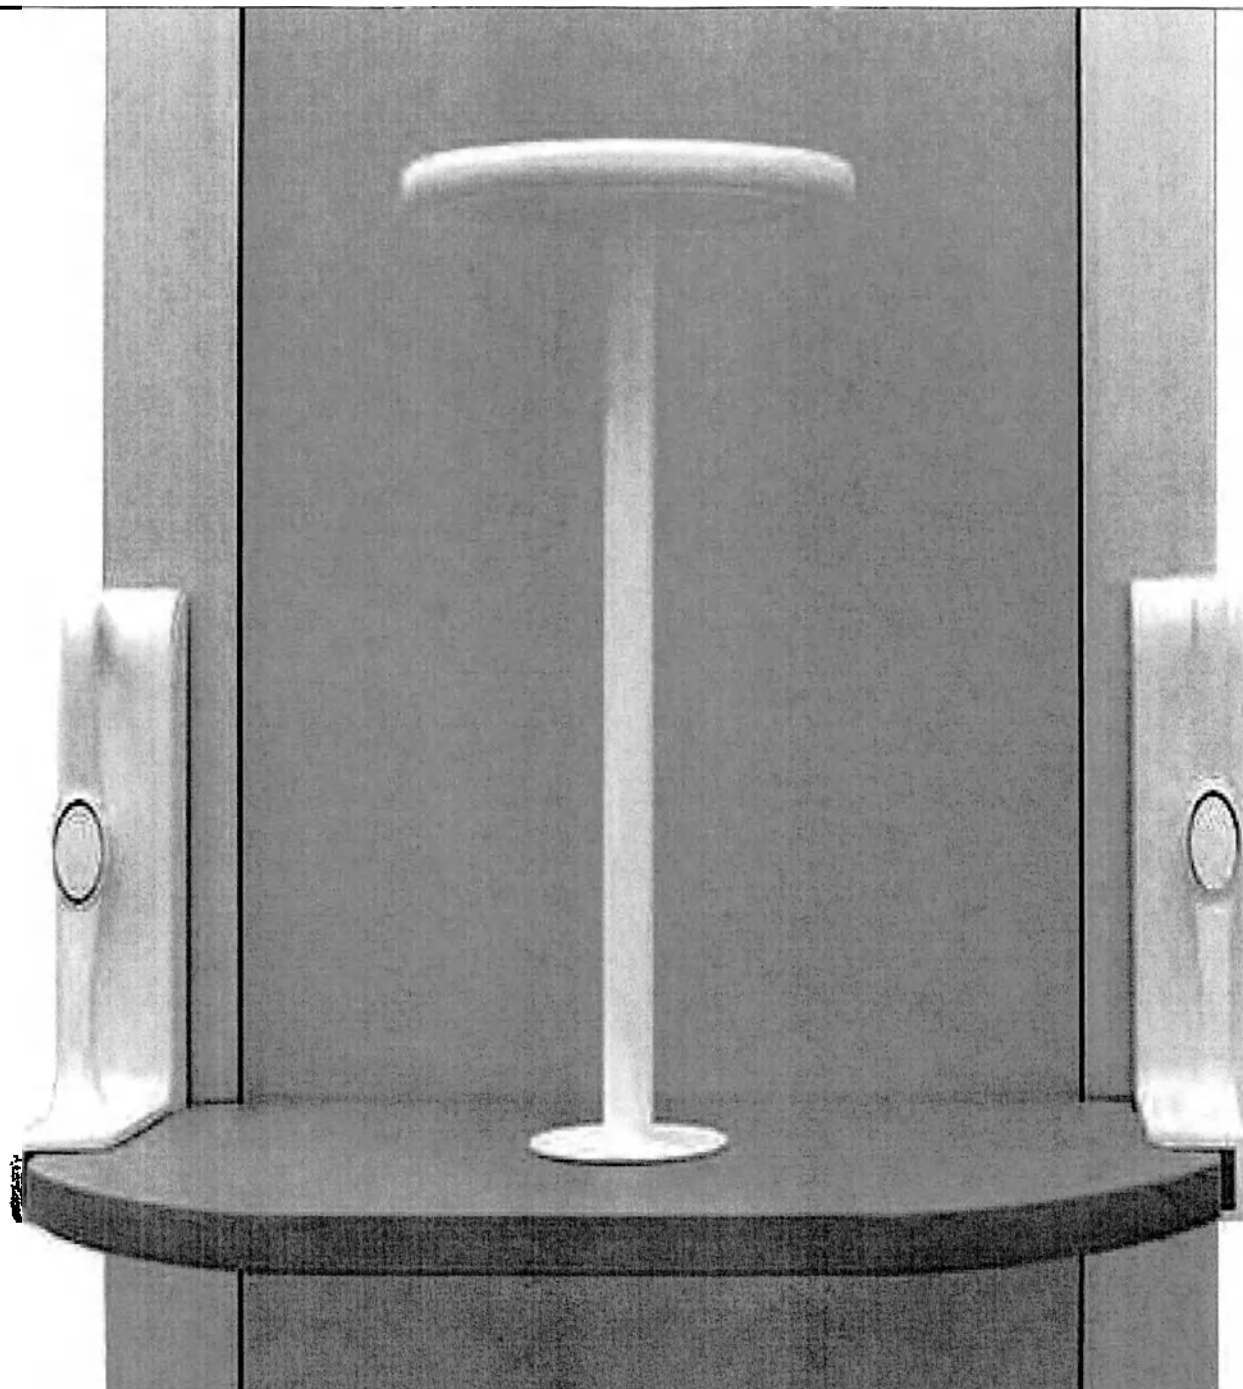


50. Вращающийся стул.




51. Подголовник.

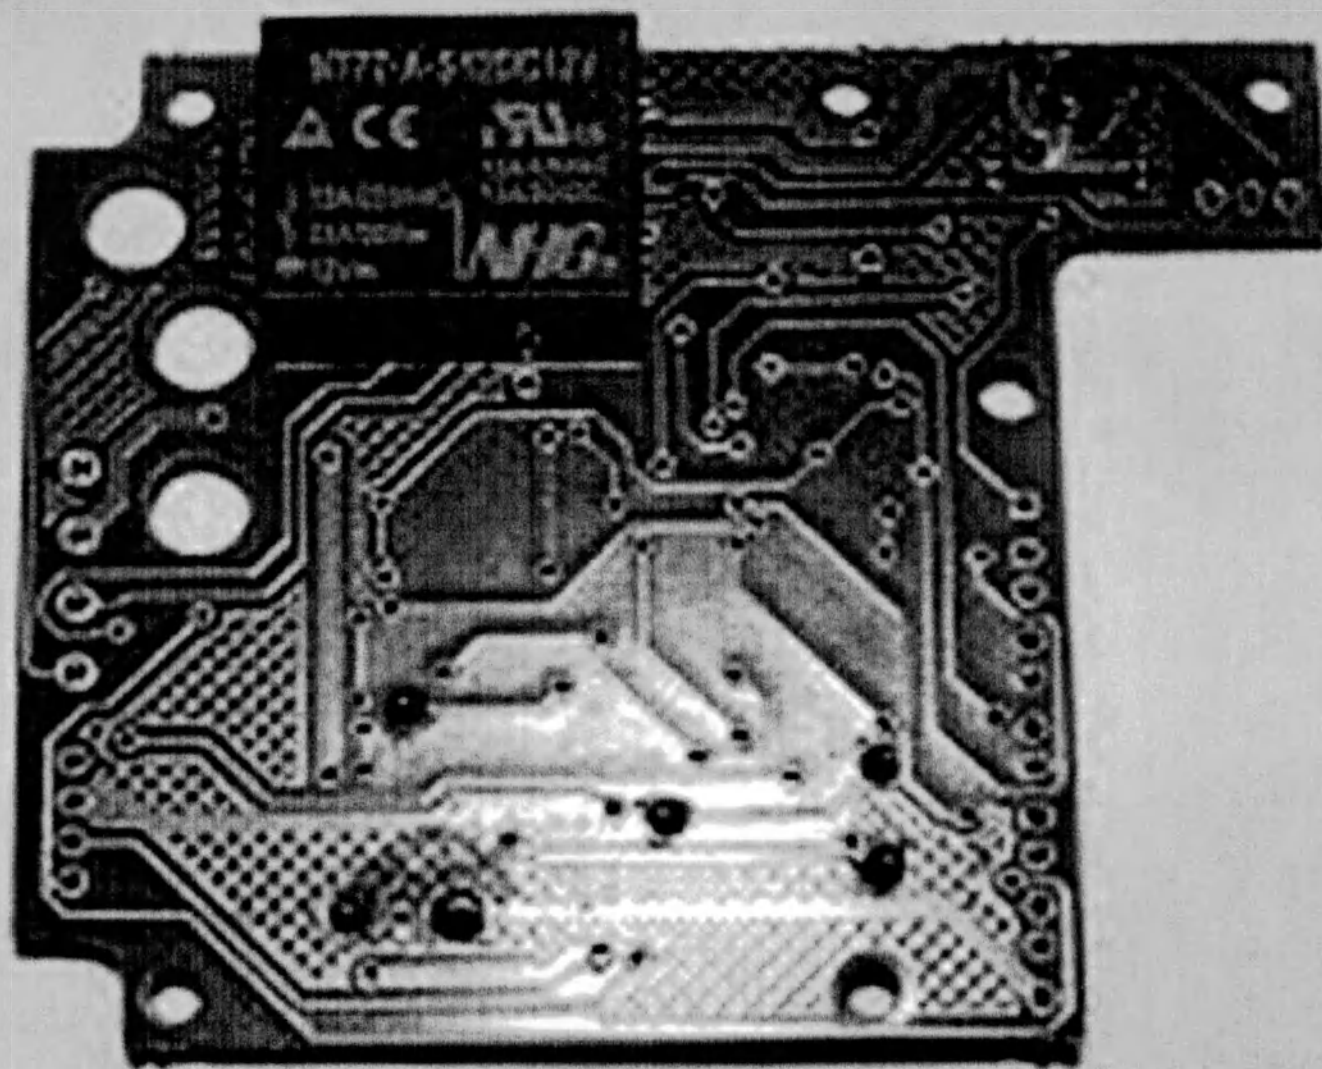


52.а Платы: контрольные, интерфейсные, индикаторные, распределительные, управляющие.

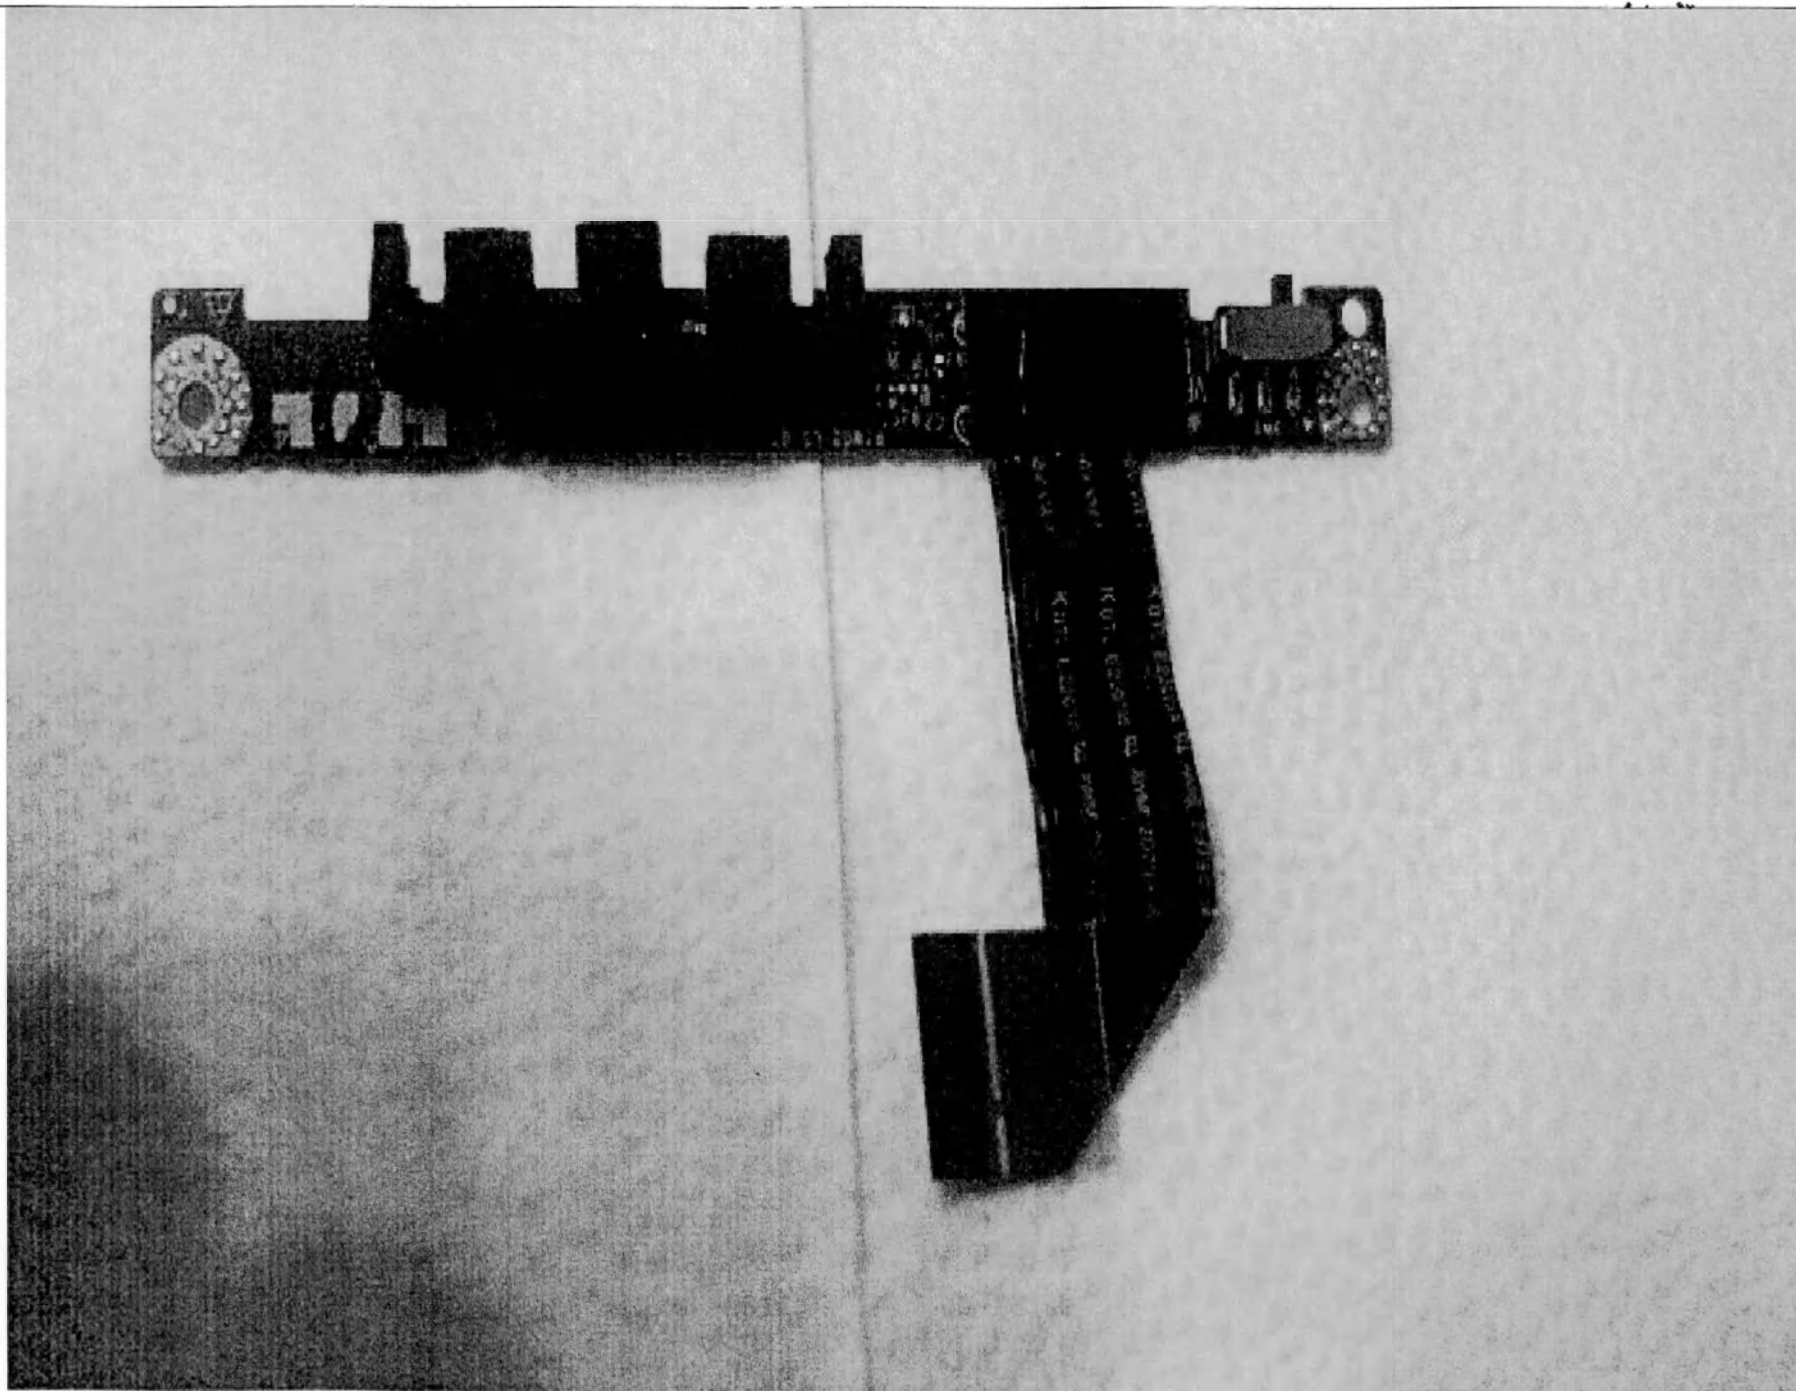

52.6 Платы: контрольные, интерфейсные, индикаторные, распределительные, управляющие.

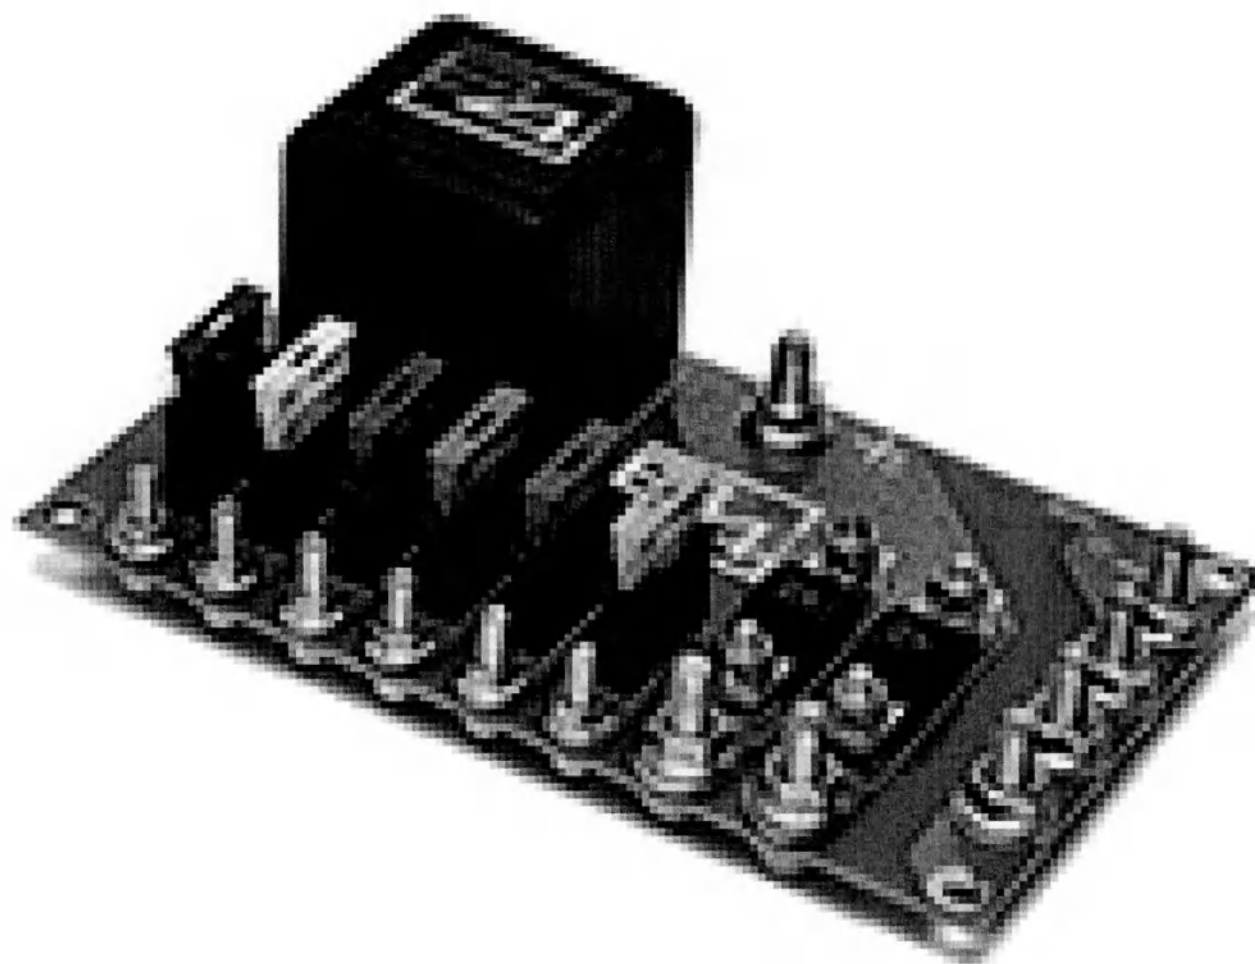

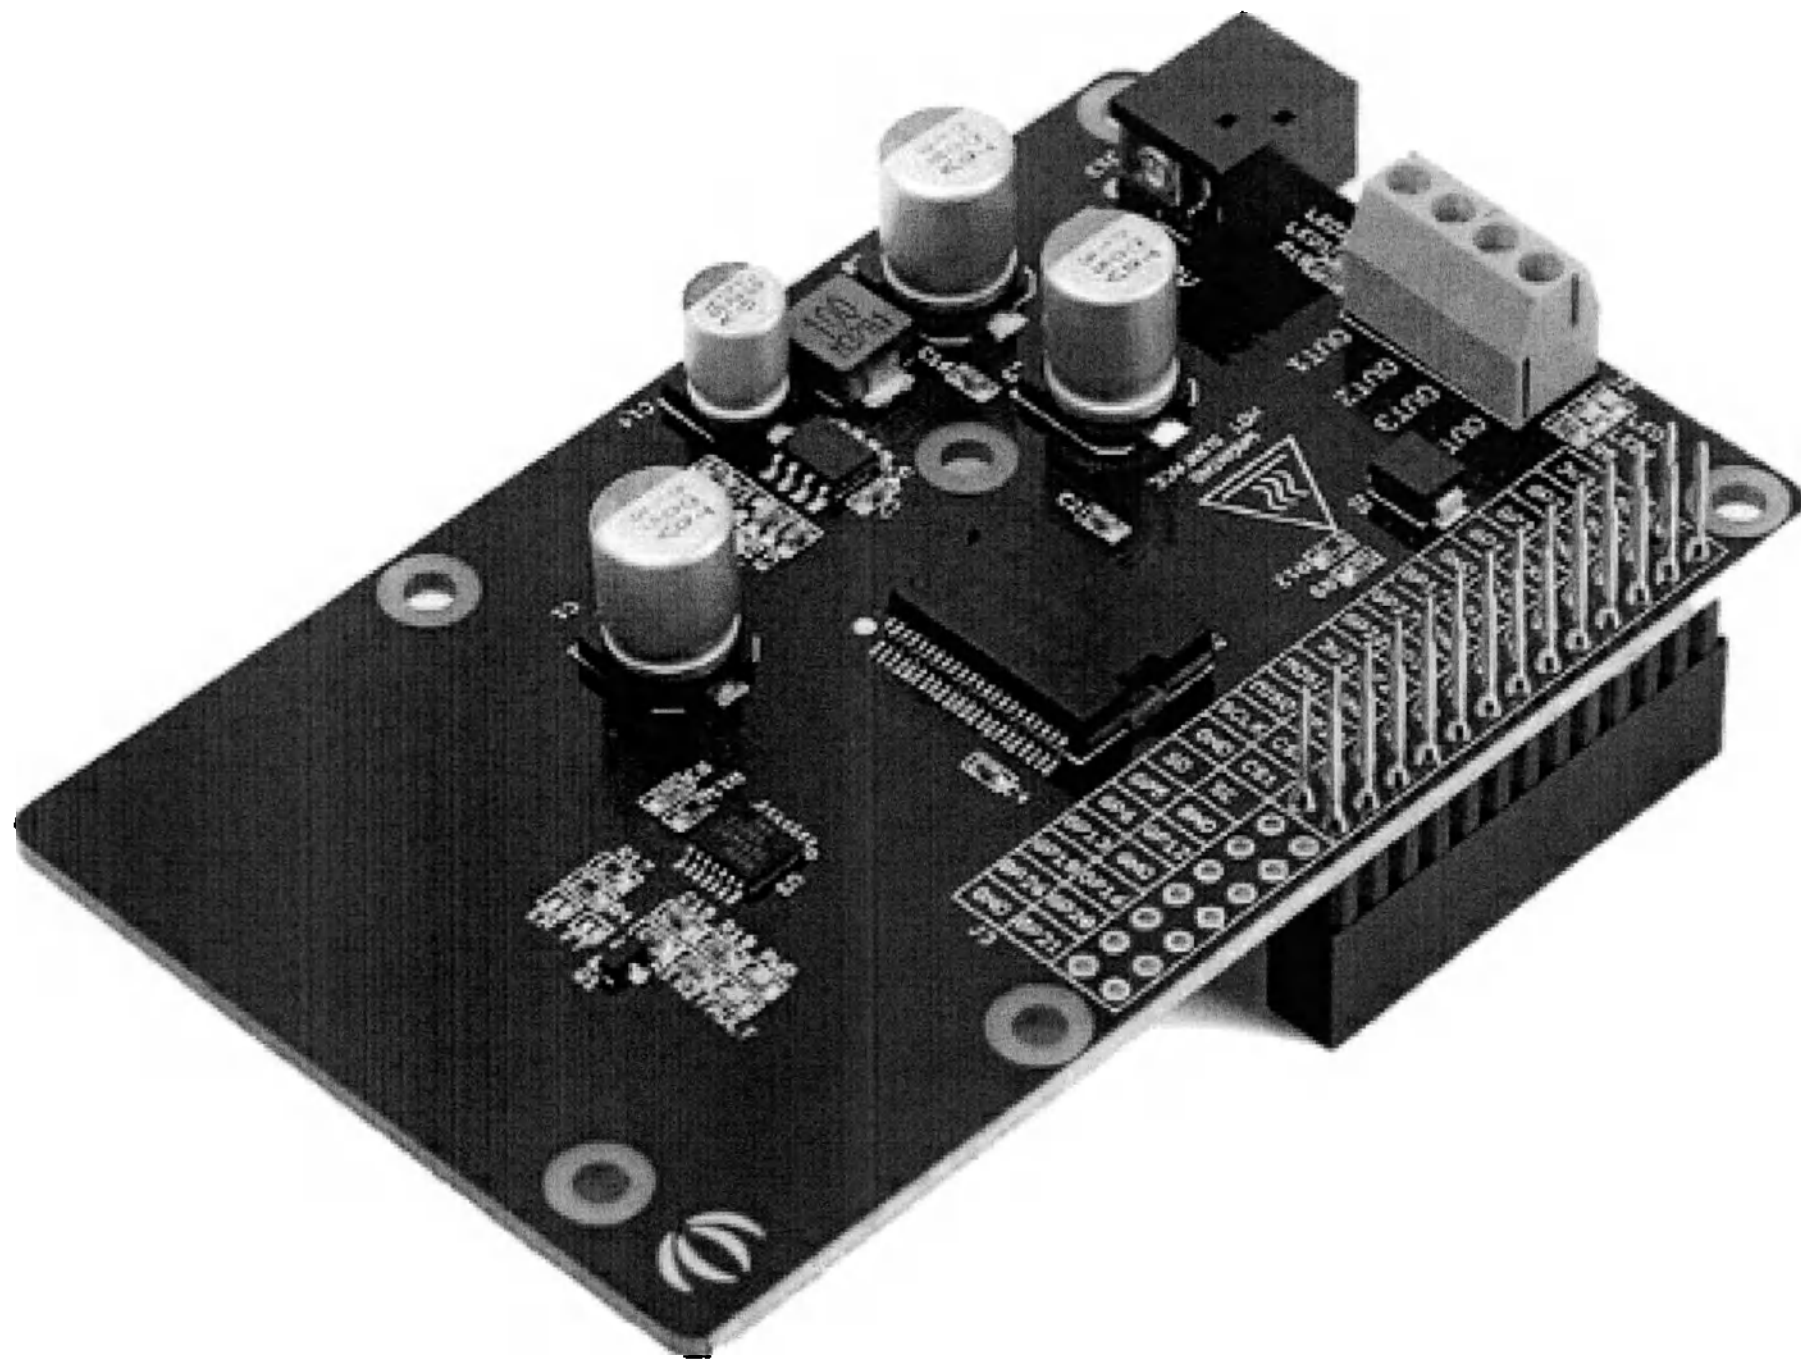

52.г Платы: контрольные, интерфейсные, индикаторные, распределительные, управляющие.



53. Точка доступа.

Упаковка:



1. Упаковка стола.



2. Упаковка блока рентгеновского излучателя.



3. Упаковка коллиматора, детектора и системного блока (транспортируется в одном ящике).



4. Упаковка генератора

Производитель: «Филипс Медикал Системс ДМС ГмбХ», Германия,
Philips Medical Systems DMC GmbH,
Röntgenstrasse 24, 22335 Hamburg,
Germany

Место производства: Philips Medical
Systems DMC GmbH, Röntgenstrasse 24,
22335 Hamburg, Germany

Медицинское Изделие:
«Система рентгенодиагностическая
CombiDiagnost R90 с принадлежностями»

Модель: CombiDiagnost R90

Серийный номер/номер партии:
см. на основной маркировке

Дата изготовления: см. на основной
маркировке

Номинальный режим работы: см. на
основной маркировке

Предупреждения и знаки опасности: см.



Регистрационное удостоверение:
№ ФСЗ 2017/6644



Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
115 листа (ов)

