

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»



Осипова В.В.\

2022 г.

«Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro антител к ВИЧ-1, включая группу О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека «мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-121-41390295-2021, в исполнениях»

Макет маркировки

2022

Комплект 1

мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА  ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Флакон-капельница с буферным раствором - 5,0 мл

 ГГГГ-ММ-ДД  LOT XXXXXX  +2°C  +30°C 

мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА

РУ № РЗН 2019/8912  ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Пипетка пастера - 1 шт

 ГГГГ-ММ-ДД  LOT XXXXXX  +2°C  +30°C 

мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА

РУ № ФСЗ 2011/09783  ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Скарификатор - 1 шт

 ГГГГ-ММ-ДД  LOT XXXXXX  +2°C  +30°C 

мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА

 ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-кассета - 1 шт

 ГГГГ-ММ-ДД  LOT XXXXXX  +2°C  +30°C 

мультиВИЧ- ИМБИАН-ИХА

Комплект №1

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro антител к ВИЧ-1, включая группу О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека
«мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА»


по ТУ 21.20.23-121-41390295-2021, в исполнении



Набор содержит:

1. Тест-кассета	1 шт		
2. Флакон-капельница с буферным раствором (5 мл)	1 шт	LOT	XXXXXX
3. Пипетка Пастера (0,25 мл) (ПУ № РЗН 2019/8912)	1 шт	REF	XX-XXX/X
4. Скарификатор (ПУ № ФСЗ 2011/09783)	1 шт		ГГГГ-ММ-ДД
5. Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи (ПУ № РЗН 2013/822)	1 шт		ГГГГ-ММ-ДД
6. Схема использования скарификатора	1 шт		
7. Инструкция по применению	1 шт		

Готово к использованию
Только для диагностики in vitro. ТУ 21.20.23-121-41390295-2021
Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77, info@imbian.ru

Комплект 2

мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Флакон-капельница с буферным раствором - 5,0 мл

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX

+30°C
+2°C IVD

мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА

РУ № РЗН 2019/8912

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Пипетка пастера - 10 шт

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

+30°C
+2°C IVD

мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА

РУ № ФСЗ 2011/09783

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Скарификатор - 10 шт

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

+30°C
+2°C IVD

мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-кассета - 1 шт

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

+30°C
+2°C IVD

мультиВИЧ- ИМБИАН-ИХА

Комплект №2

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro антител к ВИЧ-1, включая группу О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека

«мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА»

по ТУ 21.20.23-121-41390295-2021, в исполнении



Набор содержит:

1. Тест-кассета
2. Флакон-капельница с буферным раствором (5 мл)
3. Пипетка Пастера (0,25 мл)
(ПУ № РЗН 2019/8912)
4. Скарификатор (ПУ № ФСЗ 2011/09783)
5. Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи
(ПУ № РЗН 2013/822)
6. Схема использования скарификатора
7. Инструкция по применению

10 шт

2 шт

10 шт

10 шт

10 шт

1 шт

1 шт

LOT

XXXXXX

REF

XX-XXX/X




ГГГГ-ММ-ДД



ГГГГ-ММ-ДД

Готово к использованию
Только для диагностики in vitro. ТУ 21.20.23-121-41390295-2021
Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77, info@imbian.ru

Комплект 3

мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА  ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Флакон-капельница с буферным раствором - 5,0 мл

 ГГГГ-ММ-ДД  XXXXXX  +2°C  +30°C 

 ГГГГ-ММ-ДД

мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА

РУ № РЗН 2019/8912  ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Пипетка пастера - 30 шт

 ГГГГ-ММ-ДД  XXXXXX  +2°C  +30°C 

 ГГГГ-ММ-ДД

мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА

РУ № ФСЗ 2011/09783  ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Скарификатор - 30 шт

 ГГГГ-ММ-ДД  XXXXXX  +2°C  +30°C 

 ГГГГ-ММ-ДД

мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА

 ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-кассета - 1 шт

 ГГГГ-ММ-ДД  XXXXXX  +2°C  +30°C 

 ГГГГ-ММ-ДД

мультиВИЧ- ИМБИАН-ИХА

Комплект №3

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro антител к ВИЧ-1, включая группу О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека
«мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА»

по ТУ 21.20.23-121-41390295-2021, в исполнении



Набор содержит:

1. Тест-кассета
2. Флакон-капельница с буферным раствором (5 мл)
3. Пипетка Пастера (0,25 мл)
(ПУ № РЗН 2019/8912)
4. Скарификатор (ПУ № ФСЗ 2011/09783)
5. Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи
(ПУ № РЗН 2013/822)
6. Схема использования скарификатора
7. Инструкция по применению

30 шт

2 шт

30 шт

30 шт

30 шт

1 шт

1 шт

LOT

XXXXXX

REF

XX-XXX/X





ГГГГ-ММ-ДД



ГГГГ-ММ-ДД

Готово к использованию
Только для диагностики in vitro. ТУ 21.20.23-121-41390295-2021
Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77, info@imbian.ru

мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Флакон-капельница с буферным раствором - 5,0 мл

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX

+30°C
+2°C IVD

мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Микропробирка (1,8 мл) -30 шт

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

+30°C
+2°C IVD

мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА

РУ № РЗН 2019/8912

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Пипетка пастера - 30 шт

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

+30°C
+2°C IVD

мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА

РУ № ФСЗ 2011/09783

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Скарификатор - 30 шт

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

+30°C
+2°C IVD

мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-полоска - 1 шт

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

+30°C
+2°C IVD

мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА

Комплект №4

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro антител к ВИЧ-1, включая группу О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека
«мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА»

по ТУ 21.20.23-121-41390295-2021, в исполнении



Набор содержит:

- 1.Тест-полоска
- 2.Флакон-капельница с буферным раствором (5 мл)
- 3.Пипетка Пастера (0,25 мл)
(ПУ № РЗН 2019/8912)
- 4.Скарификатор (ПУ № ФСЗ 2011/09783)
- 5.Микропробирка (1,8 мл)
- 6.Подставка под микропробирки
- 7.Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи
(ПУ № РЗН 2013/822)
- 8.Схема использования скарификатора
- 9.Инструкция по применению

30 шт

2 шт

30 шт

30 шт

30 шт

2 шт

30 шт

1 шт

1 шт

LOT

XXXXXX

REF

XX-XXX/X




ГГГГ-ММ-ДД



ГГГГ-ММ-ДД

Готово к использованию
Только для диагностики in vitro. ТУ 21.20.23-121-41390295-2021
Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77, info@imbian.ru

мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Флакон-капельница с буферным раствором - 5,0 мл

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX

+2°C +30°C

IVD

мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Микропробирка (1,8 мл) - 50 шт

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

+2°C +30°C

IVD

мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА

РУ № РЗН 2019/8912

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Пипетка пастера - 50 шт

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

+2°C +30°C

IVD

мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА

РУ № ФСЗ 2011/09783

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Скарификатор - 50 шт

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

+2°C +30°C

IVD

мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-полоска - 50 шт

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

+2°C +30°C

IVD

мультиВИЧ- ИМБИАН-ИХА

Комплект №5

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro антител к ВИЧ-1, включая группу О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека
«мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА»



по ТУ 21.20.23-121-41390295-2021, в исполнении



Набор содержит:

1. Тест-полоска (в тубе полимерной) 50 шт
2. Флакон-капельница с буферным раствором (5 мл) 2 шт
3. Пипетка Пастера (0,25 мл) 50 шт
(ПУ № РЗН 2019/8912)
4. Скарификатор (ПУ № ФСЗ 2011/09783) 50 шт
5. Микропробирка (1,8 мл) 50 шт
6. Подставка под микропробирки 2 шт
7. Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи 50 шт
(ПУ № РЗН 2013/822)
8. Схема использования скарификатора 1 шт
9. Инструкция по применению 1 шт

Готово к использованию
Только для диагностики in vitro. ТУ 21.20.23-121-41390295-2021
Для профессионального применения



XXXXXX



XX-XXX/X



ГГГГ-ММ-ДД



ГГГГ-ММ-ДД

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

630559, Новосибирская обл.
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77, info@imbian.ru

мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА  ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Флакон-капельница с буферным раствором - 5,0 мл

 ГГГГ-ММ-ДД  XXXXXX  +2°C  +30°C  IVD

мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА  ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Микропробирка (1,8 мл) -100 шт

 ГГГГ-ММ-ДД  XXXXXX  +2°C  +30°C  IVD

мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА  ООО «ИМБИАН ЛАБ»

РУ № РЗН 2019/8912

Пипетка пастера - 100 шт

 ГГГГ-ММ-ДД  XXXXXX  +2°C  +30°C  IVD

мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА  ООО «ИМБИАН ЛАБ»

РУ № ФСЗ 2011/09783

Скарификатор - 100 шт

 ГГГГ-ММ-ДД  XXXXXX  +2°C  +30°C  IVD

мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА  ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Тест-полоска - 100 шт

 ГГГГ-ММ-ДД  XXXXXX  +2°C  +30°C  IVD

мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА

Комплект №6

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro антител к ВИЧ-1, включая группу О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека
«мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-121-41390295-2021, в исполнении



Набор содержит:

- 1.Тест-полоска (в тубе полимерной)
- 2.Флакон-капельница с буферным раствором (5 мл)
- 3.Пипетка Пастера (0,25 мл)
(РУ № РЗН 2019/8912)
- 4.Скарификатор (РУ № ФСЗ 2011/09783)
- 5.Микропробирка (1,8 мл)
- 6.Подставка под микропробирки
- 7.Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи
(РУ № РЗН 2013/822)
- 8.Схема использования скарификатора
- 9.Инструкция по применению

100 шт

4 шт

100 шт

100 шт

100 шт

4 шт

100 шт

1 шт

1 шт

LOT

XXXXXX

REF

XX-XXX/X



ГГГГ-ММ-ДД



ГГГГ-ММ-ДД

Готово к использованию

Только для диагностики in vitro. ТУ 21.20.23-121-41390295-2021

Для профессионального применения



100



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77, info@imbian.ru

Транспортная упаковка

мультиВИЧ- ИМБИАН-ИХА

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro антител к ВИЧ-1, включая группу О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека «мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА»

по ТУ 21.20.23-121-41390295-2021,

в исполнениях

РУ № XXX XXXX/XXXXXX

ТУ 21.20.23-121-41390295-2021

Количество
наборов

шт

Масса нетто

кг

Масса брутто

кг

Масса нетто
потребительской
упаковки

кг

LOT XXXXXX  ГГГГ-ММ-ДД

REF XX-XXX/X  ГГГГ-ММ-ДД

IVD

Imbian

Замораживать
не допускается
Допускается
транспортирование при
температуре от 2 до 30°C

+2°C  +30°C



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77; info@imbian.ru

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова



Сшито и заверено печатью 14
(сепятриадна лист)

Генеральный директор ООО «Имбиан лаб»
Осипова В.В.




УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Осипова В.В.

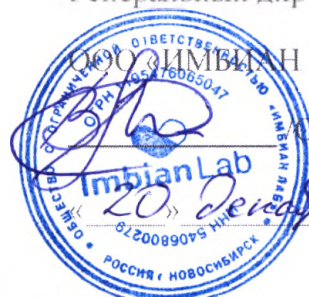


Фотографические изображения общего вида


Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro антител к ВИЧ-1, включая группу О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека «мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-121-41390295-2021, в исполнениях

В состав наборов могут входить следующие компоненты:


Тест-кассета

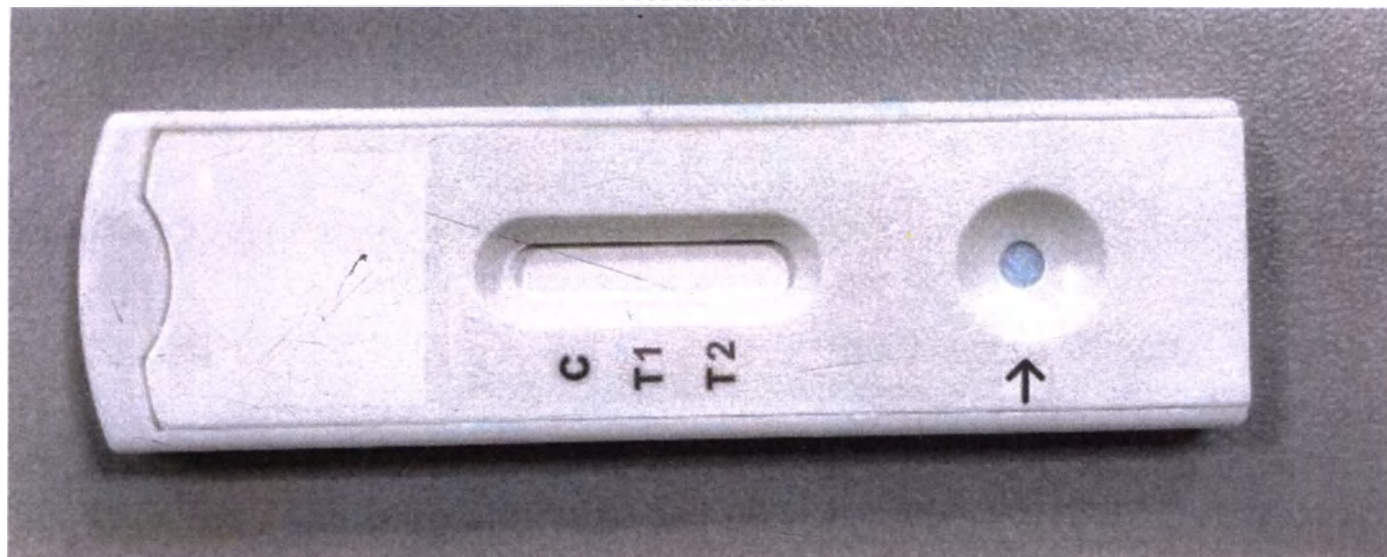

Тест-полоска

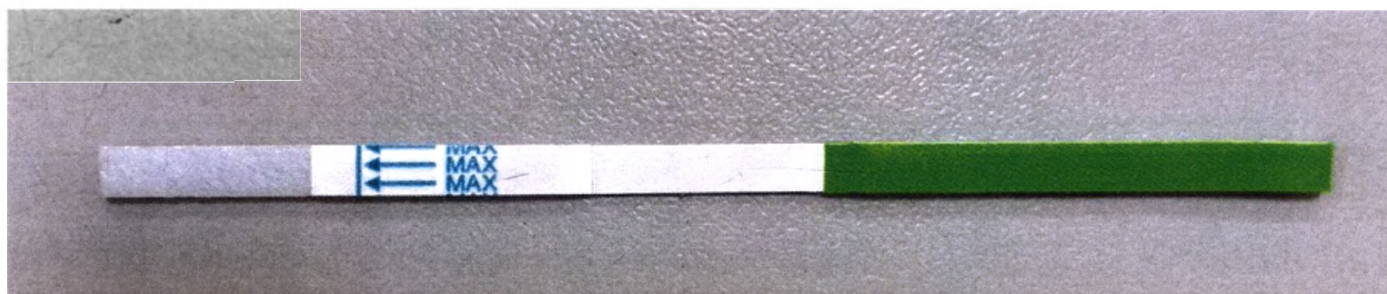

Пипетка Пастера (0,25 мл) (РУ № РЗН 2019/8912)

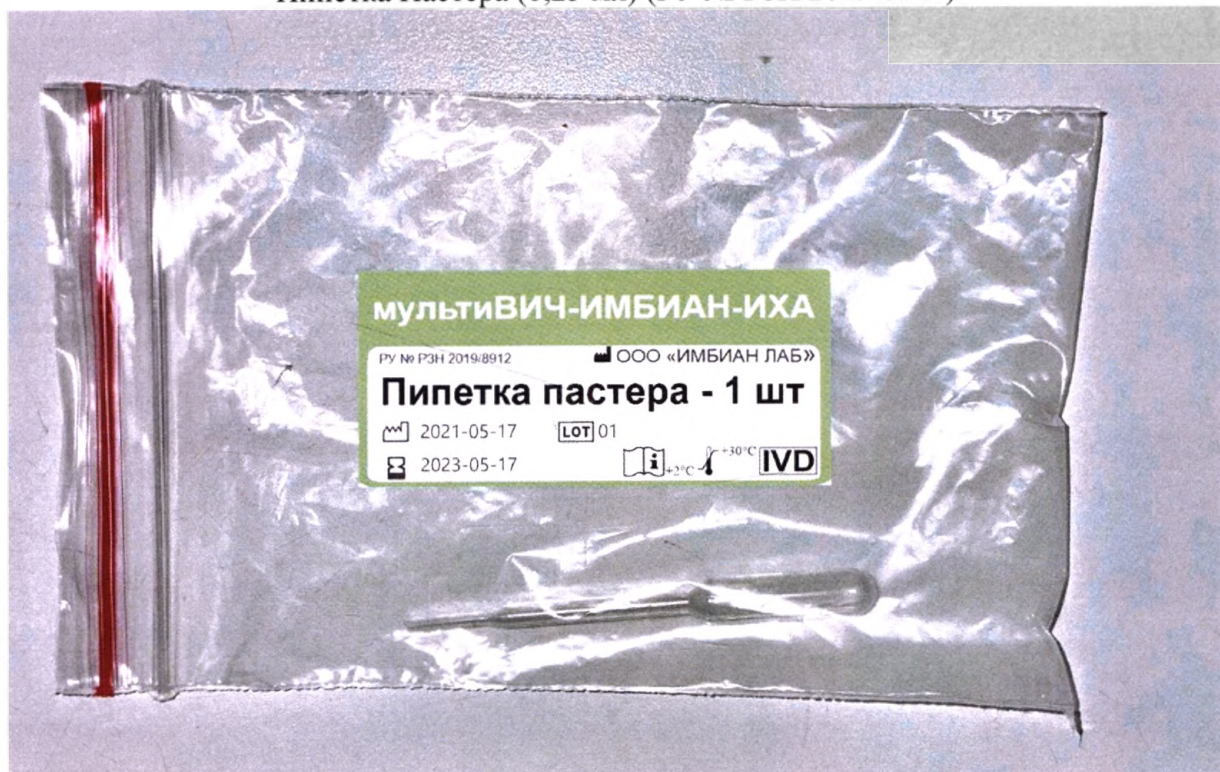

Микропробирка (1,8 мл)



Флакон-капельница с буферным раствором (5 мл)




Скарификатор (ПУ № ФСЗ 2011/09783)





Подставка под микропробирки

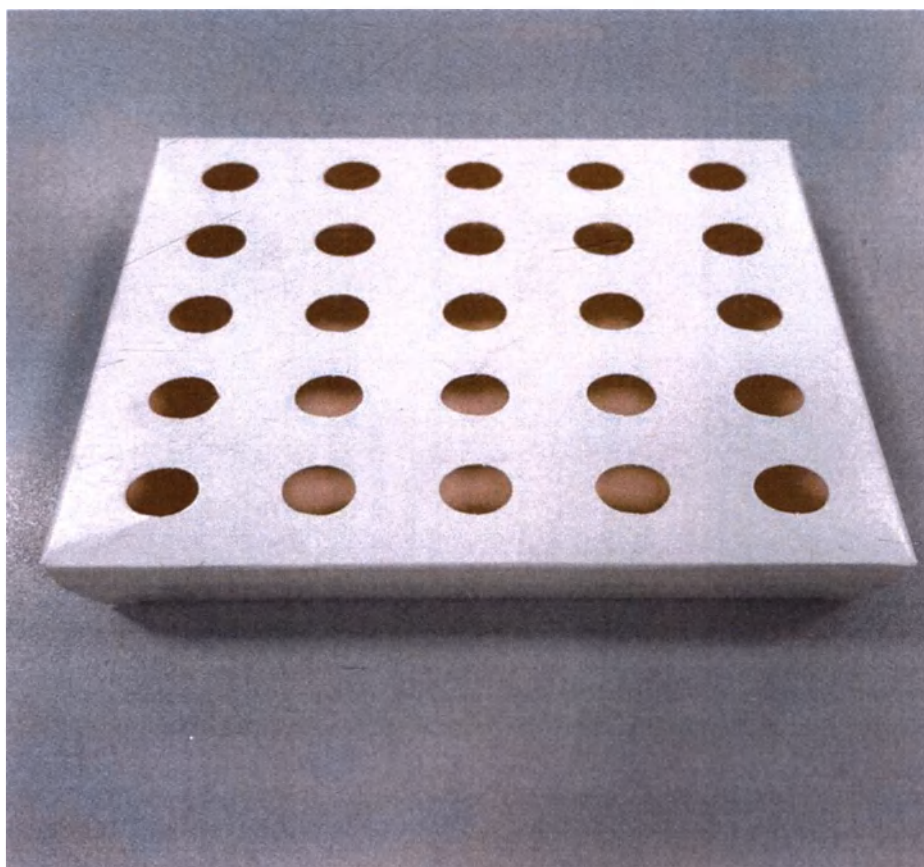

мультиВИЧ- ИМБИАН-ИХА

Комплект №1

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro антител к ВИЧ-1, включая группу О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека
«мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-121-41390295-2021, в исполнении



Набор содержит:

1. Тест-кассета	1 шт	
2. Флакон-капельница с буферным раствором (5 мл)	1 шт	LOT 01
3. Пипетка Пастера (0,25 мл) (ПУ № РЗН 2019/8912)	1 шт	REF 01
4. Скарификатор (ПУ № ФСЗ 2011/09783)	1 шт	2021-05-17
5. Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи (ПУ № РЗН 2013/822)	1 шт	2023-05-17
6. Схема использования скарификатора	1 шт	
7. Инструкция по применению	1 шт	

Готово к использованию
Только для диагностики in vitro. ТУ 21.20.23-121-41390295-2021
Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77, info@imbian.ru

мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА

Комплект №1

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro антител к ВИЧ-1, включая группу О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека «мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-121-41390295-2021, в исполнении

Imbian

Набор содержит:

- | | | | |
|--|------|-----|------------|
| 1. Тест-кассета | 1 шт | LOT | 01 |
| 2. Флакон-капельница с буферным раствором (5 мл) | 1 шт | REF | 01 |
| 3. Пипетка Пастера (0,25 мл) (РУ № РЗН 2019/8912) | 1 шт | | 2021-05-17 |
| 4. Скарификатор (РУ № ФСЗ 2011/09783) | 1 шт | | 2023-05-17 |
| 5. Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи (РУ № РЗН 2013/822) | 1 шт | | |
| 6. Схема использования скарификатора | 1 шт | | |
| 7. Инструкция по применению | 1 шт | | |

Схема и использование
Только для диагностики in vitro. ТУ 21.20.23-121-41390295-2021
Для профессионального применения



ООО «Имбиан» ИНН 63/0558, Новосибирская обл.
г. Обь, ул. Мухоморова, д. 217
Удобный адрес: г. Кемерово, ул. Садковая, д. 217
Удобный адрес: г. Кемерово, ул. Садковая, д. 217
8-800-400-80-77, 8-800-400-80-77



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия

«Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro антител к ВИЧ-1, включая группу О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека «мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-121-41390295-20», в исполнениях

СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКАРИФИКАТОРА



мультиВИЧ- ИМБИАН-ИХА

Комплект №2

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro антител к ВИЧ-1, включая группу О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека

«мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-121-41390295-2021, в исполнении



Набор содержит:

1. Тест-кассета	10 шт	
2. Флакон-капельница с буферным раствором (5 мл)	2 шт	LOT 01
3. Пипетка Пастера (0,25 мл) (ПУ № РЗН 2019/8912)	10 шт	REF 01
4. Скарификатор (ПУ № ФСЗ 2011/09783)	10 шт	2021-05-17
5. Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи (ПУ № РЗН 2013/822)	10 шт	2023-05-17
6. Схема использования скарификатора	1 шт	
7. Инструкция по применению	1 шт	

Готово к использованию
Только для диагностики in vitro, ТУ 21.20.23-121-41390295-2021
Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77, info@imbian.ru

мультиВИЧ- ИМБИАН-ИХА

Комплект №3

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro антител к ВИЧ-1, включая группу О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека
«мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-121-41390295-2021, в исполнении



Набор содержит:

1. Тест-кассета	30 шт	
2. Флакон-капельница с буферным раствором (5 мл)	2 шт	LOT 01
3. Пипетка Пастера (0,25 мл) (ПУ № РЗН 2019/8912)	30 шт	REF 01
4. Скарификатор (ПУ № ФСЗ 2011/09783)	30 шт	2021-05-17
5. Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи (ПУ № РЗН 2013/822)	30 шт	2023-05-17
6. Схема использования скарификатора	1 шт	
7. Инструкция по применению	1 шт	

Готово к использованию
Только для диагностики in vitro. ТУ 21.20.23-121-41390295-2021
Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77, info@imbian.ru

мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА

Комплект №3

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro антител к ВИЧ-1, включая группу О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека «мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА»

по ТУ 21.20.23-121-41390295-2021, в исполнении



Набор содержит:

1. Тест-кассета
2. Флакон-капельница с буферным раствором (5 мл)
3. Пипетка Пастера (0,25 мл) (РУ № РЗН 2019/8912)
4. Скарификатор (РУ № ФСЗ 2011/09783)
5. Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи (РУ № РЗН 2013/822)
6. Схема использования скарификатора
7. Инструкция по применению

30 шт

2 шт

30 шт

30 шт

30 шт

30 шт

1 шт

1 шт

LOT

01

REF

01

2021-05-17

2023-05-17

2023-05-17

Готово к использованию

Только для диагностики in vitro. ТУ 21.20.23-121-41390295-2021


Для профессионального применения



ООО «Имбиан Лаб»
630586 Новокузнецкий обл.
Г.О. Рабочий поселок Коммунар,
РП Коммунар ул. Садовая д. 27
этаж 2, помещ. 2
8-800-603-90-77 info@imbian.ru



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия
«Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения
in vitro антител к ВИЧ-1, включая группу О,
ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в
образцах сыворотки, плазмы или
цельной крови человека
«мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-121-41390295-20»,
в исполнении

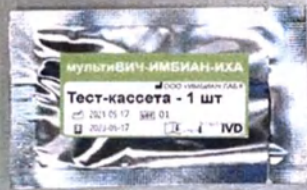

мультиВИЧ- ИМБИАН-ИХА

Комплект №4

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro антител к ВИЧ-1, включая группу О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека
«мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-121-41390295-2021, в исполнении



Набор содержит:

- 1.Тест-полоска
- 2.Флакон-капельница с буферным раствором (5 мл)
- 3.Пипетка Пастера (0,25 мл)
(ПУ № РЗН 2019/8912)
- 4.Скарификатор (ПУ № ФСЗ 2011/09783)
- 5.Микропробирка (1,8 мл)
- 6.Подставка под микропробирки
- 7.Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи
(ПУ № РЗН 2013/822)
- 8.Схема использования скарификатора
- 9.Инструкция по применению

30 шт

2 шт

30 шт

30 шт

30 шт

2 шт

30 шт

1 шт

1 шт

LOT 01

REF 01





2021-05-17

2023-05-17

Готово к использованию
Только для диагностики in vitro. ТУ 21.20.23-121-41390295-2021
Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77, info@imbian.ru

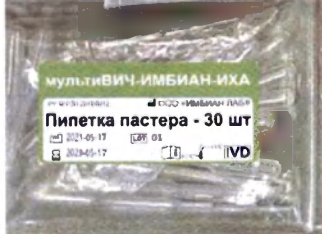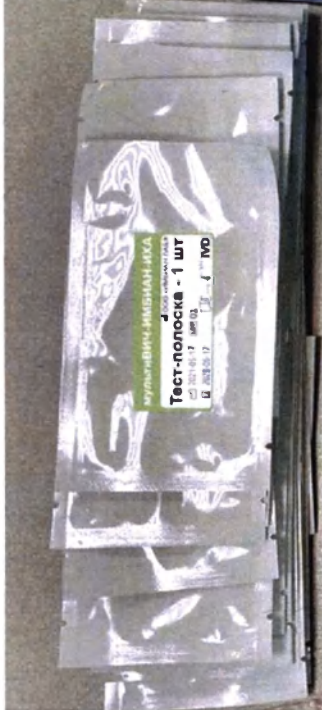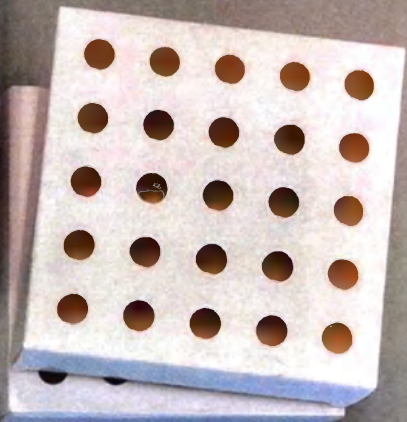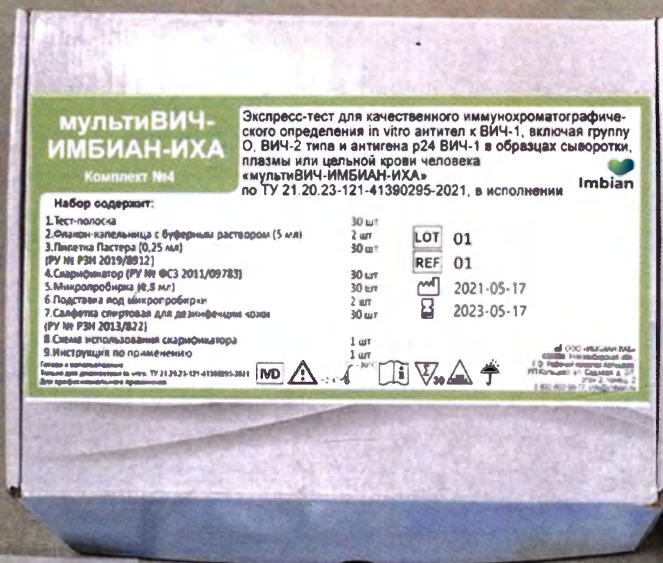

мультиВИЧ- ИМБИАН-ИХА

Комплект №5

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro антител к ВИЧ-1, включая группу О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека
«мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-121-41390295-2021, в исполнении



Набор содержит:

1.Тест-полоска (в тубе полимерной)	50 шт	
2.Флакон-капельница с буферным раствором (5 мл)	2 шт	
3.Пипетка Пастера (0,25 мл) (ПУ № РЗН 2019/8912)	50 шт	LOT 01
4.Скарификатор (ПУ № ФСЗ 2011/09783)	50 шт	REF 01
5.Микропробирка (1,8 мл)	50 шт	2021-05-17
6.Подставка под микропробирки	2 шт	2023-05-17
7.Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи (ПУ № РЗН 2013/822)	50 шт	
8.Схема использования скарификатора	1 шт	
9.Инструкция по применению	1 шт	

Готово к использованию
Только для диагностики in vitro. ТУ 21.20.23-121-41390295-2021
Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.
Г.О. Рабочий поселок Копыцово,
РП Копыцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77, info@imbian.ru

мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА

Комплект №5

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro антител к ВИЧ-1, включая группу О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека



«мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА» по ТУ 21.20.23-121-41390295-2021, в исполнении

Набор содержит:

- 1.Тест-полоска (в тубе полимерной)
- 2.Флакон-капельница с буферным раствором (5 мл)
- 3.Пипетка Пастера (0,25 мл) (РУ № РЗН 2019/8912)
- 4.Скарификатор (РУ № ФСЗ 2011/09783)
- 5.Микропробирка (1,8 мл)
- 6.Подставка под микропробирки
- 7.Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи (РУ № РЗН 2013/822)
- 8.Схема использования скарификатора
- 9.Инструкция по применению

50 шт
2 шт
50 шт
50 шт
50 шт
2 шт
50 шт

LOT

01

REF

01

2021-05-17

2023-05-17

1 шт
1 шт

-30°C

IVD

2°C

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50


Готово к использованию
Только для диагностики in vitro. ТУ 21.20.23-121-41390295-2021
Для профессионального применения

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630558, Новосибирская обл.
Г.О. Рыбинский район, Колыбельное
РП Колыбельное, ул. Садовая, д. 207,
Этаж 2, помещ. 2
8-800-600-8017, info@imbian.ru



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия
«Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro антител к ВИЧ-1, включая группу О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека»
«мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-121-41390295-20, в исполнении

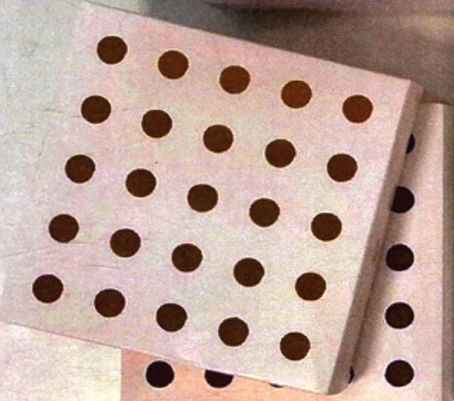

мультиВИЧ- ИМБИАН-ИХА

Комплект №6

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения *in vitro* антител к ВИЧ-1, включая группу О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека

«мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА»

по ТУ 21.20.23-121-41390295-2021, в исполнении



Набор содержит:

1.Тест-полоска (в тубе полимерной)	100 шт	
2.Флакон-капельница с буферным раствором (5 мл)	4 шт	
3.Пипетка Пастера (0,25 мл)	100 шт	
(ПУ № РЗН 2019/8912)		
4.Скарификатор (ПУ № ФСЗ 2011/09783)	100 шт	
5.Микропробирка (1,8 мл)	100 шт	
6.Подставка под микропробирки	4 шт	
7.Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи	100 шт	
(ПУ № РЗН 2013/822)		
8.Схема использования скарификатора	1 шт	
9.Инструкция по применению	1 шт	

LOT 01

REF 01

2021-05-17

2023-05-17

Готово к использованию
Только для диагностики *in vitro*. ТУ 21.20.23-121-41390295-2021
Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77, info@imbian.ru

мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА

Комплект №6

Экспресс-тест для качественного иммунохроматографического определения in vitro антител к ВИЧ-1, включая группы О, ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в образцах сыворотки, плазмы или цельной крови человека
«мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-121-41390295-2021, в исполнении

Imbian

Набор содержит:

1.Тест-полоска (в tube полимерной)	100 шт	LOT	01
2.Флакон-капельница с буферным раствором (5 мл)	4 шт	REF	01
3.Пипетка Пастера (0,25 мл) (ПУ № РЗН 2019/8912)	100 шт		
4.Скарификатор (ПУ № ФСЗ 2011/09783)	100 шт		
5.Микропипетка (1,8 мл)	100 шт		
6.Подставка под микропипетки	4 шт		
7.Салфетка спиртовая для дезинфекции кожи (ПУ № РЗН 2013/822)	100 шт		
8.Схема использования скарификатора	1 шт		
9.Инструкция по применению	1 шт		

Готово к использованию
Только для диагностики in vitro. ТУ 21.20.23-121-41390295-2021
Для профессионального применения




ООО «ИМБИАН ПЛАС»
630559, Новосибирская обл.
г.О. Рабочий поселок Колызово
РП Колызово, ул. Садовая, д. 2/7
этаж 2, помещ. 2
8-800-800-90-77, info@imbian.ru

Imbian

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия
«Экспресс-тест для качественного
иммунохроматографического определения
in vitro антител к ВИЧ-1, включая группы О,
ВИЧ-2 типа и антигена р24 ВИЧ-1 в
образцах сыворотки, плазмы или
цельной крови человека»
«мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА»
по ТУ 21.20.23-121-41390295-20»,
в исполнении


СХЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКАРИФИКАТОРА



мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА
Микропипетка (1,8 мл) - 100 шт
ТУ 21.20.23-121-41390295-2021
2021-05-17
LOT 01
IVD

мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА
Скарификатор - 100 шт
ПУ № ФСЗ 2011/09783
ТУ 21.20.23-121-41390295-2021
2021-05-17
LOT 01
IVD

мультиВИЧ-ИМБИАН-ИХА
Пипетка пастера - 100 шт
ТУ 21.20.23-121-41390295-2021
2021-05-17
LOT 01
IVD

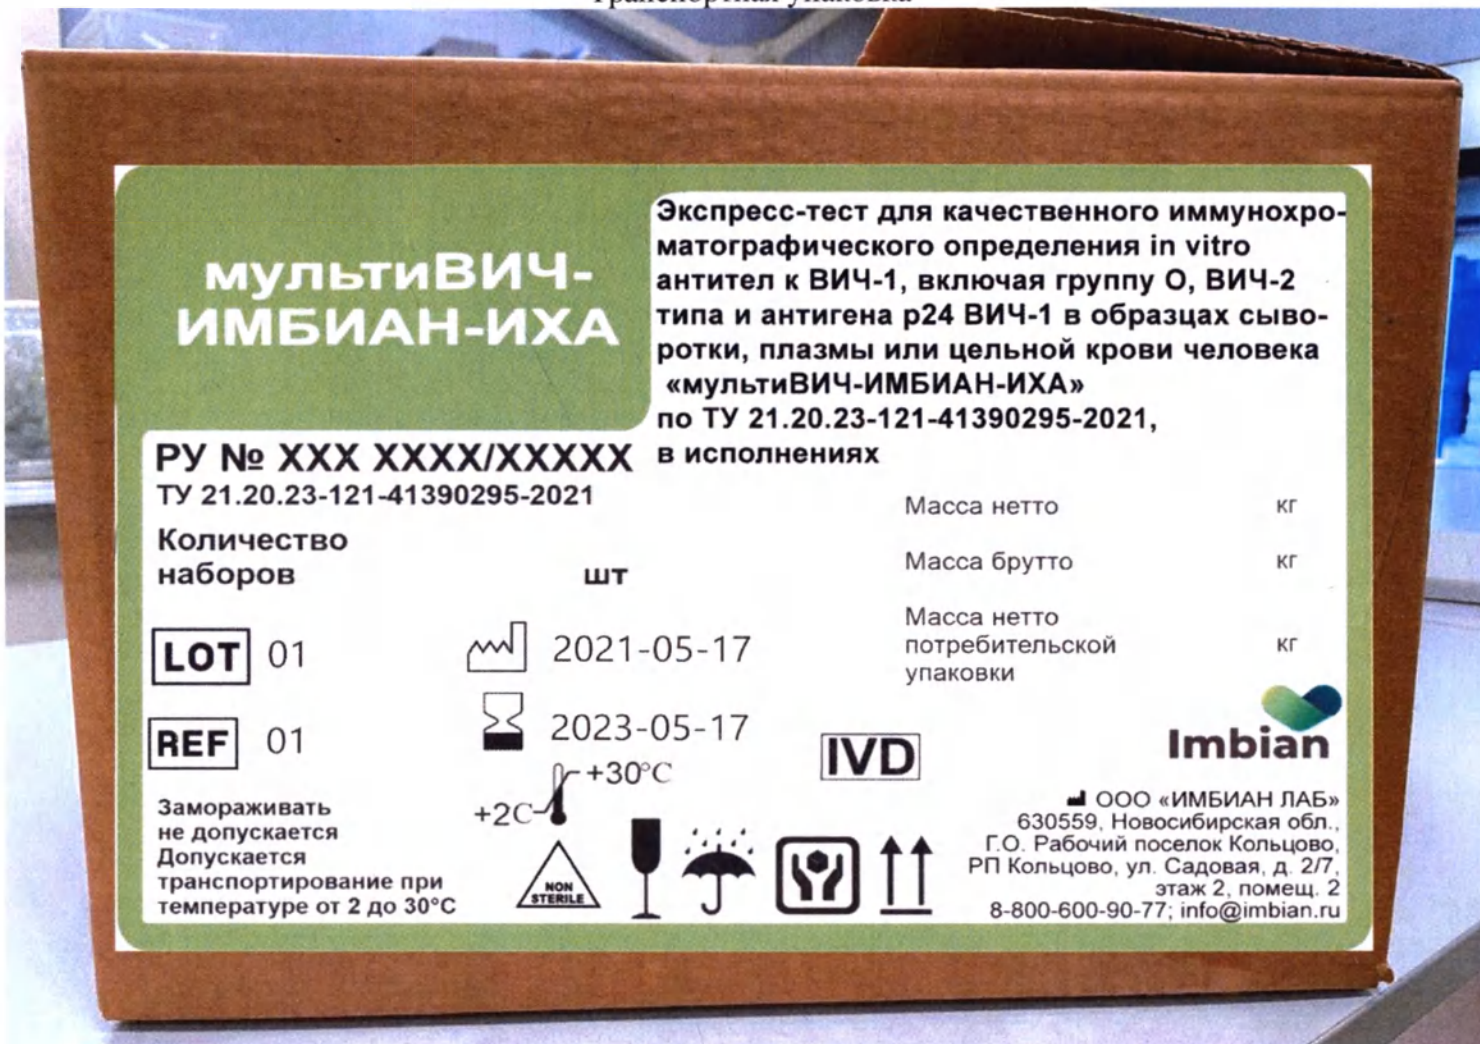

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»



В.В. Осипова

Сшито и заверено печатью 18
(всего 18 листов)

Генеральный директор ООО «Имбиан лаб»
Осипова В.В.

