




Утверждено
Генеральный директор
ООО «ЭЛЕКТА»
Задорожний Т.В.




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ медицинского изделия

Система стереотаксическая радиотерапевтическая Versa HD с принадлежностями.


Система стереотаксическая радиотерапевтическая Versa HD (общий вид).

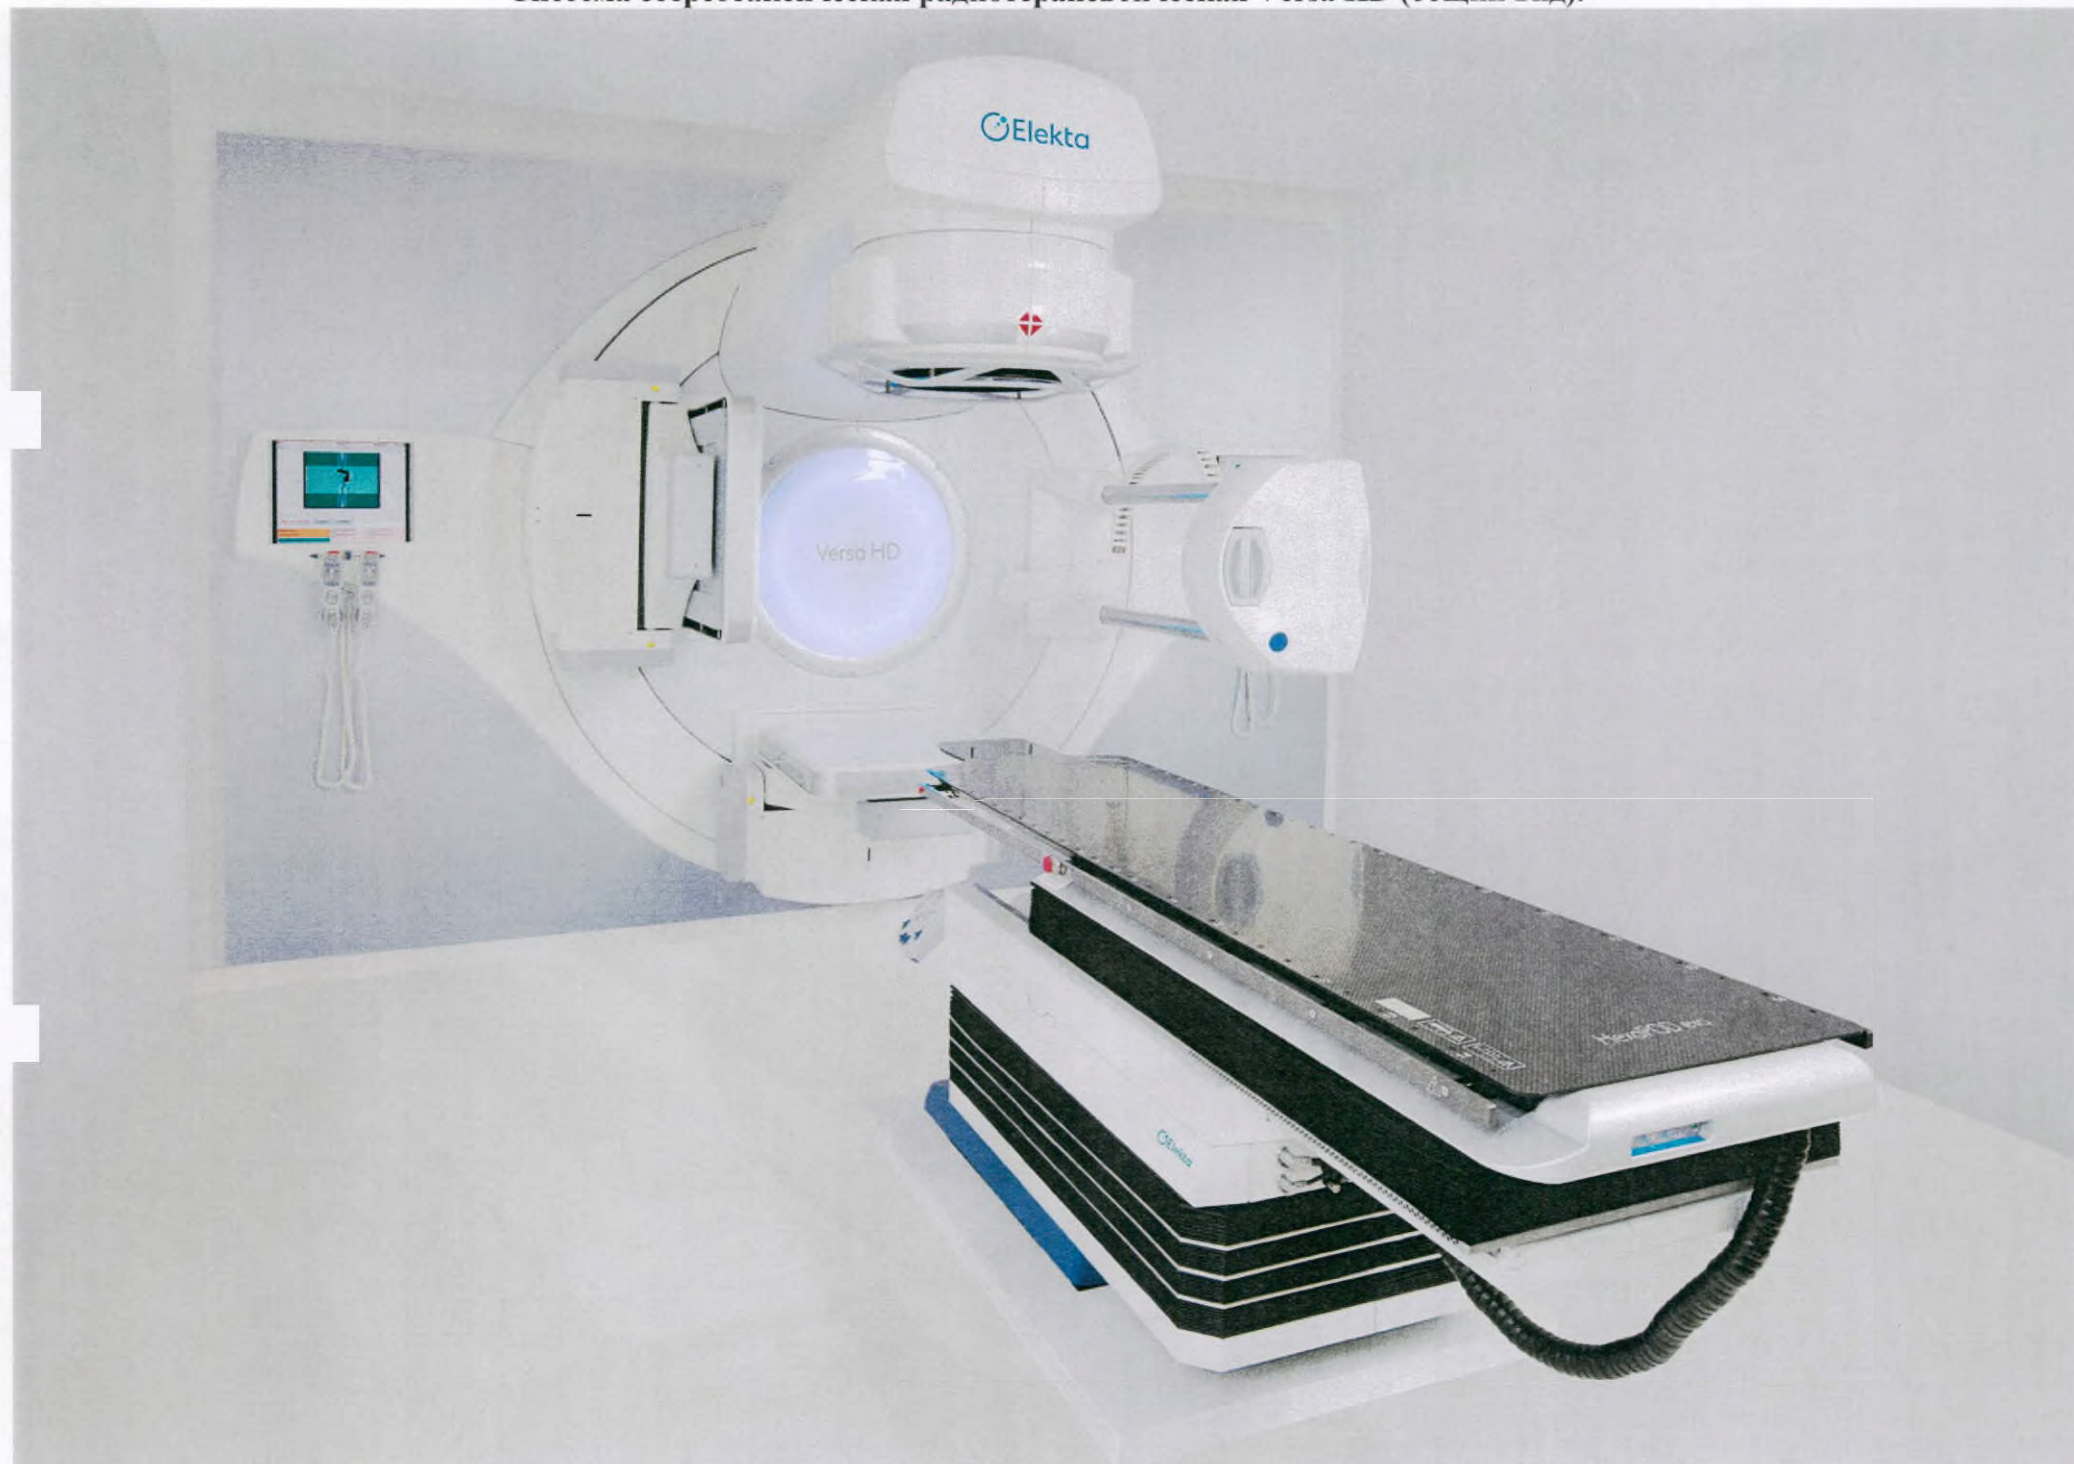

Линейный ускоритель Versa HD.

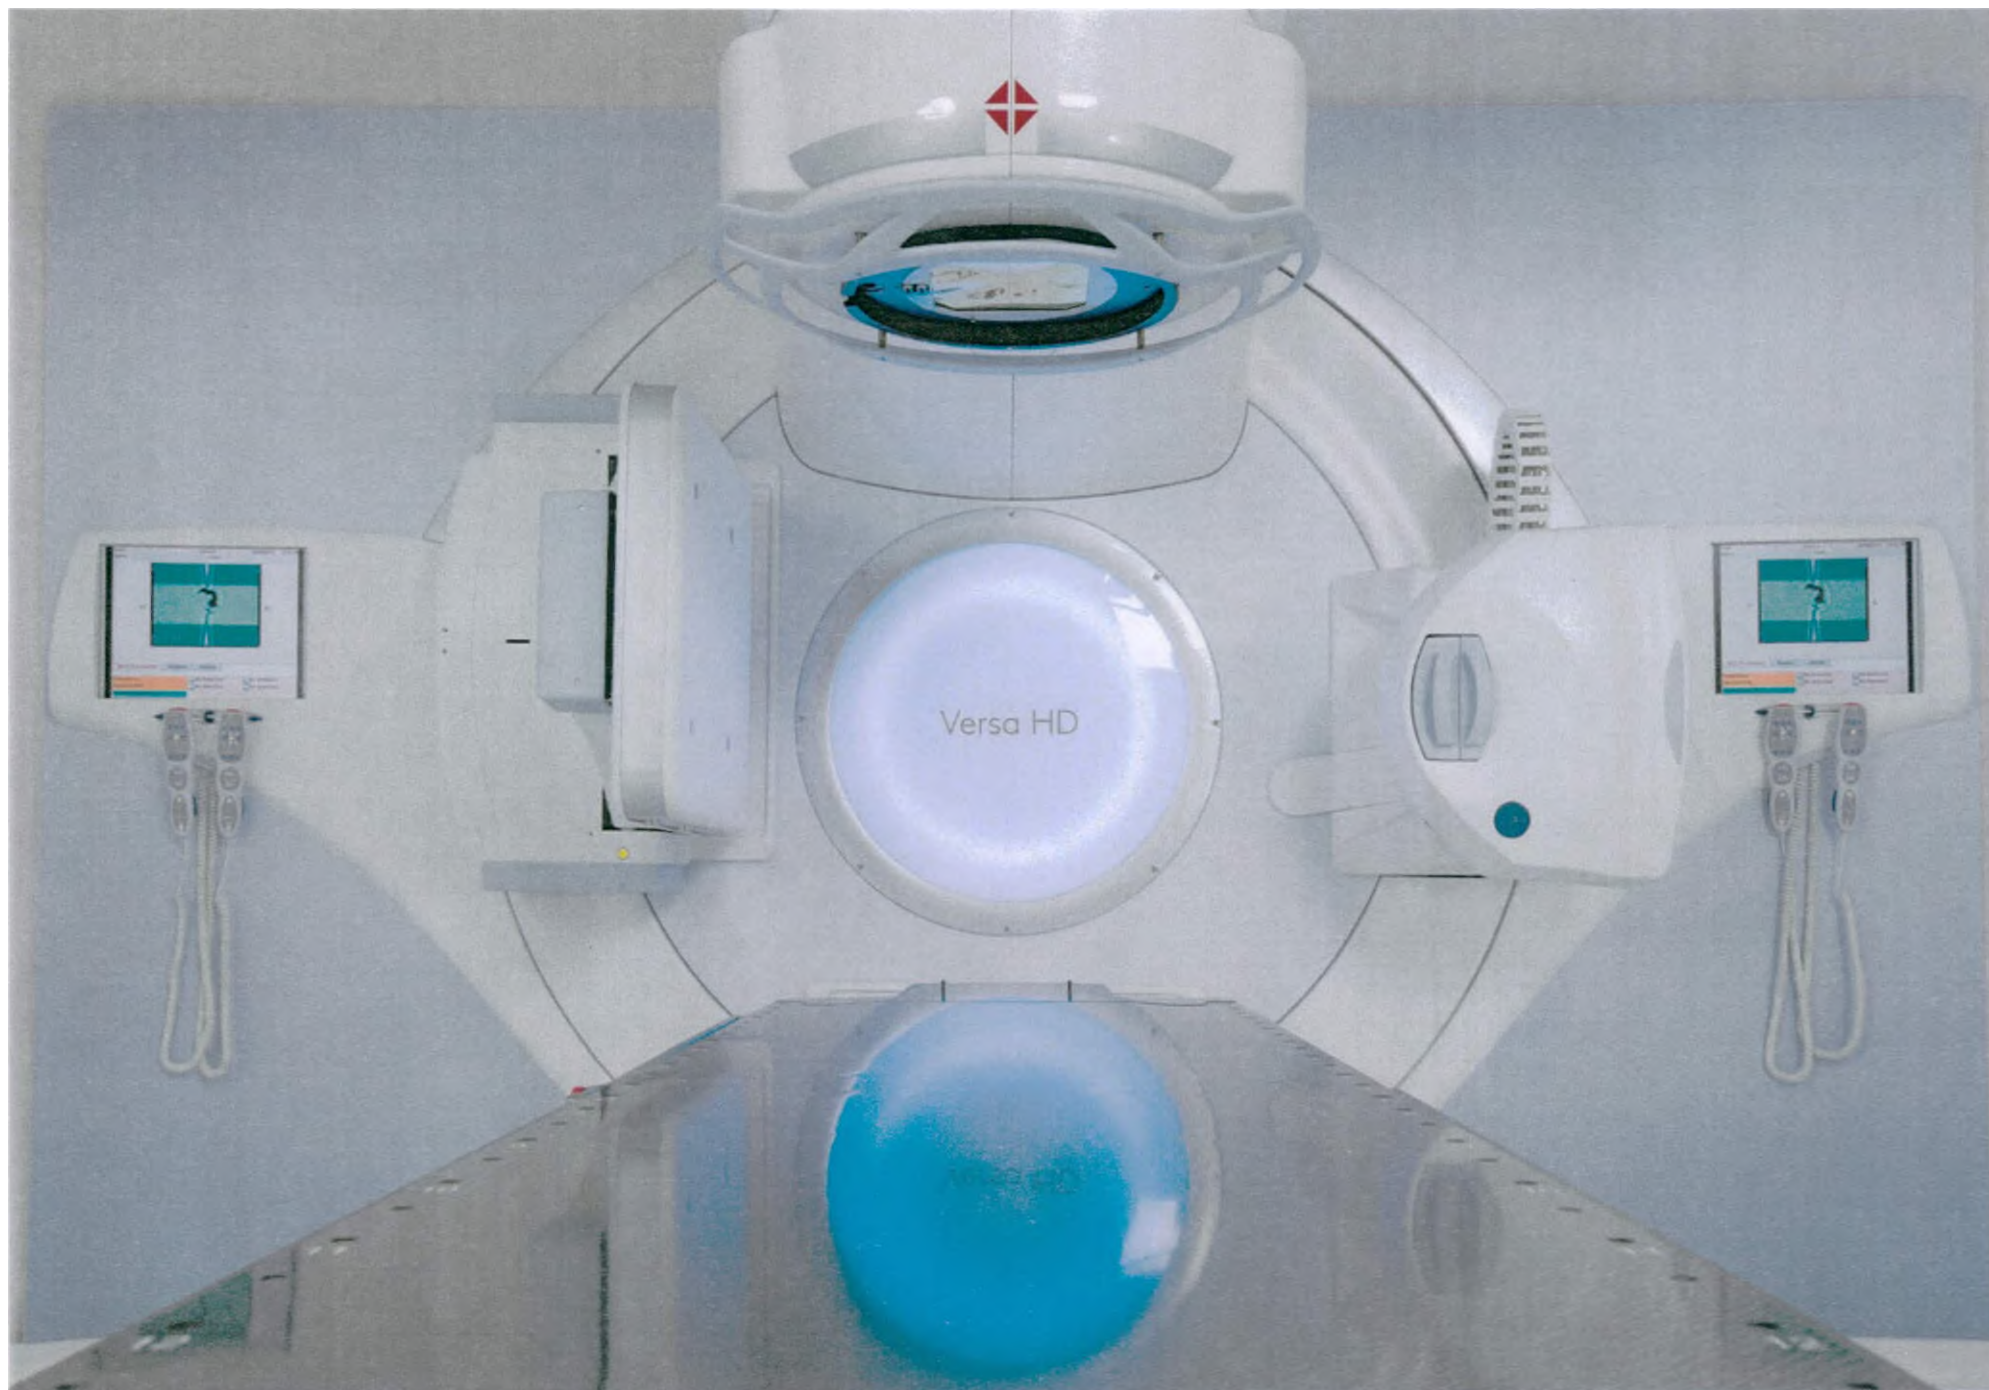


Многолепестковый колиматор Agility.

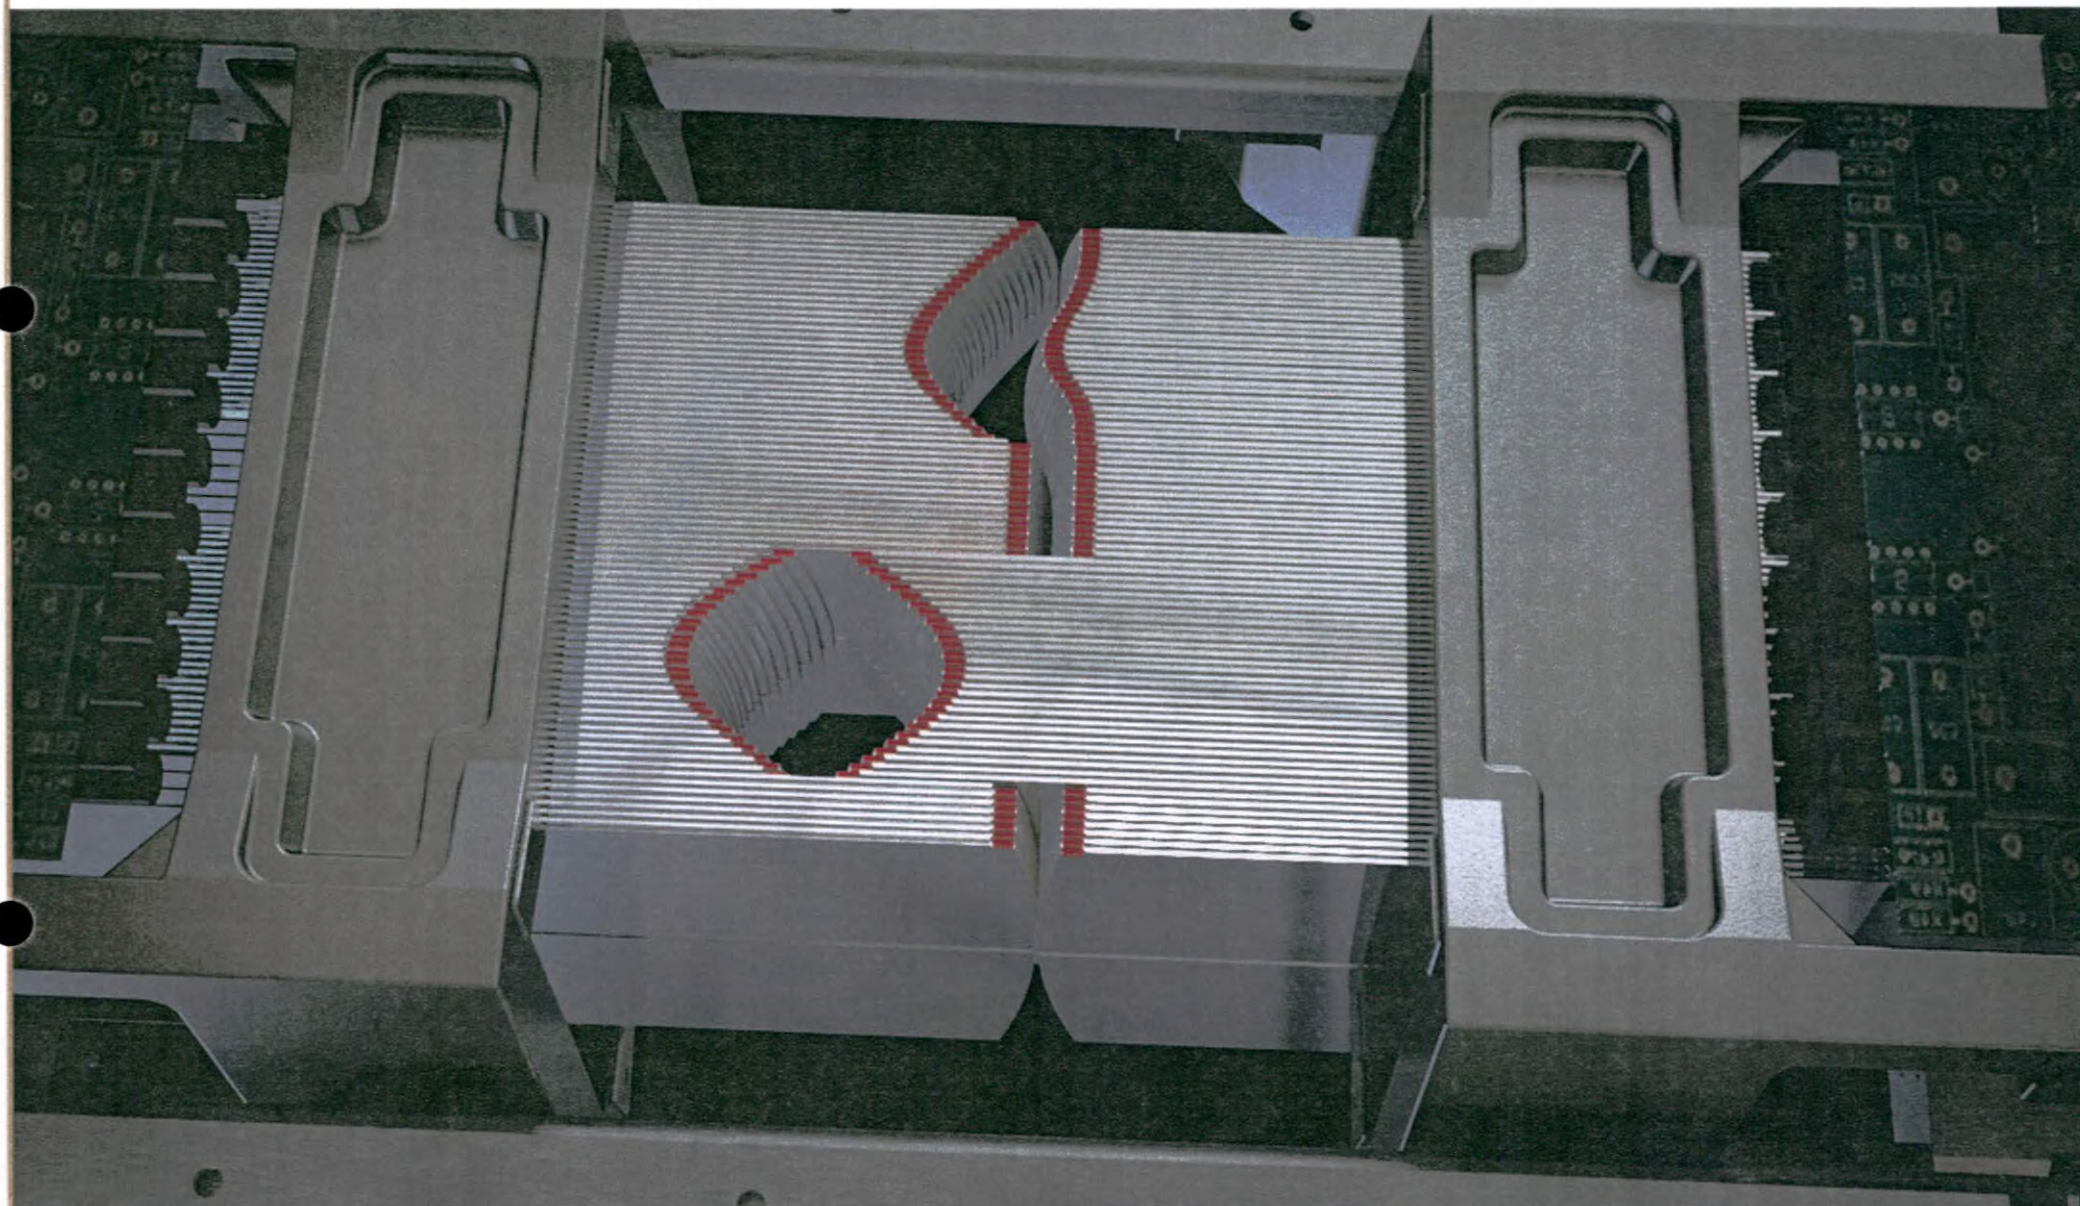




Магнетрон

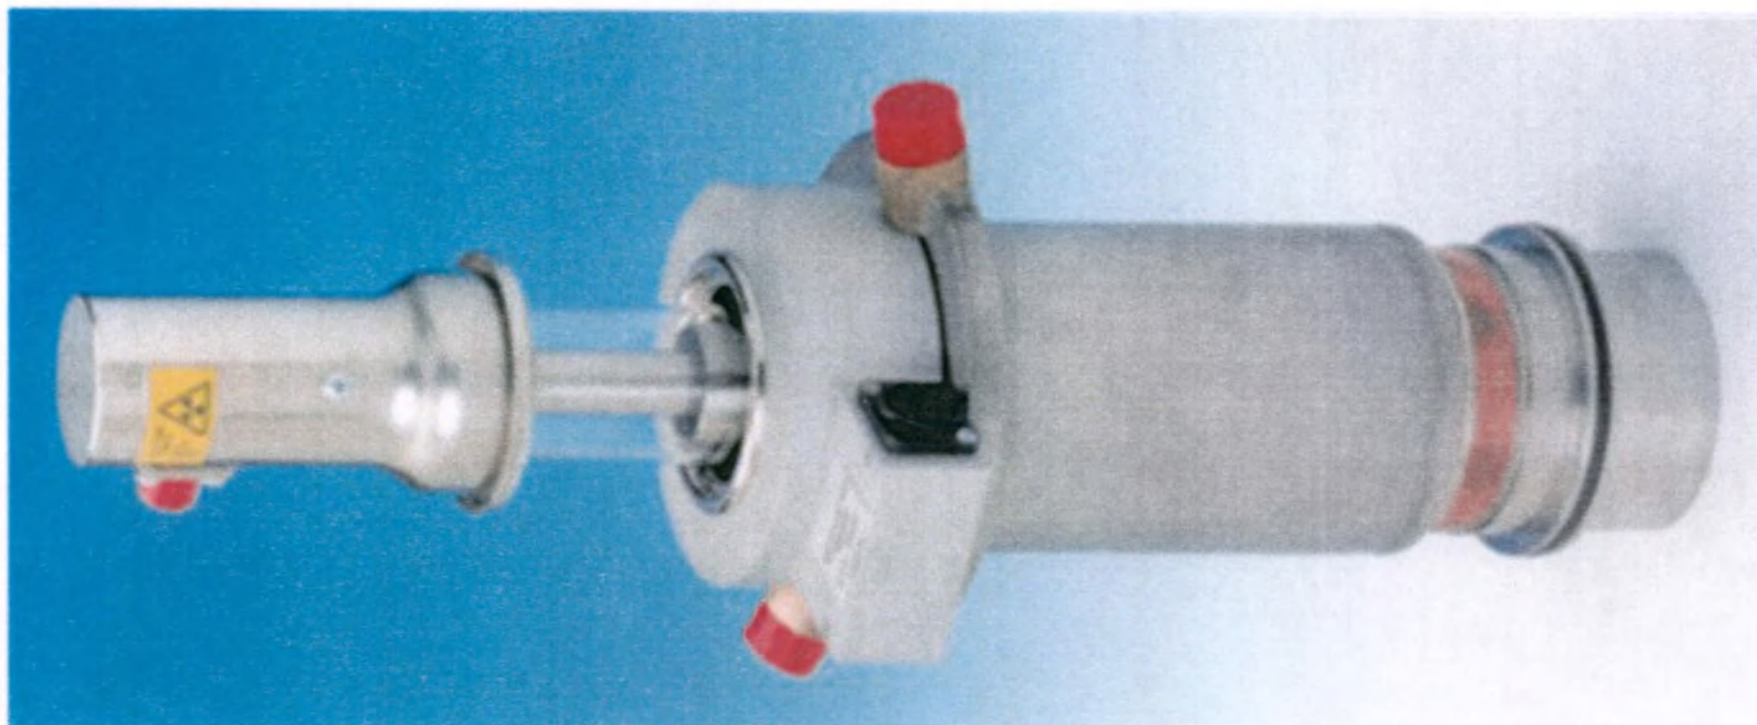



Система управления ускорительного комплекса.

- Программное обеспечение Integrity

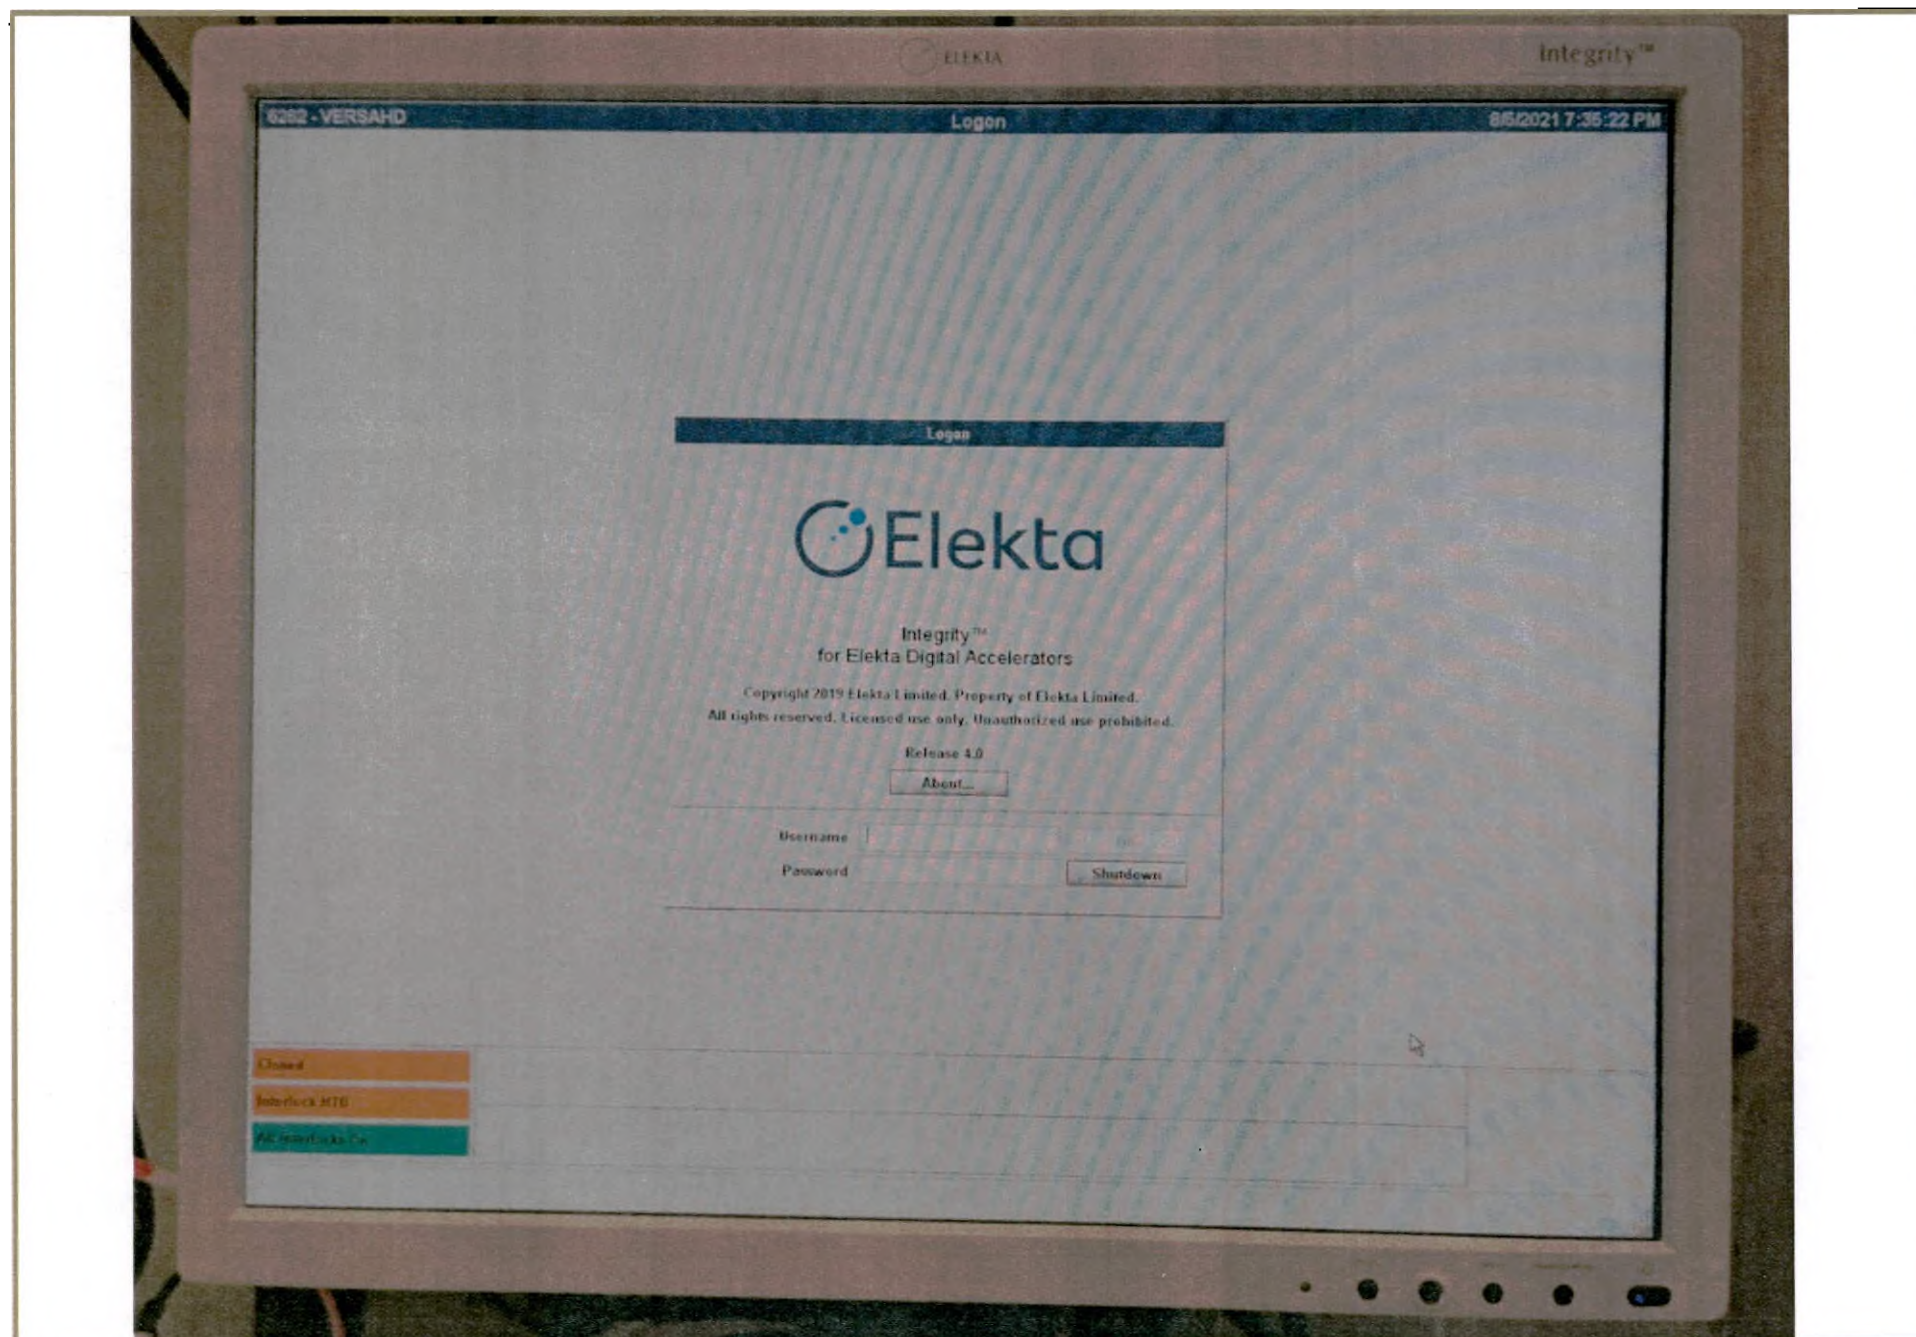

- Стойка управления ССР

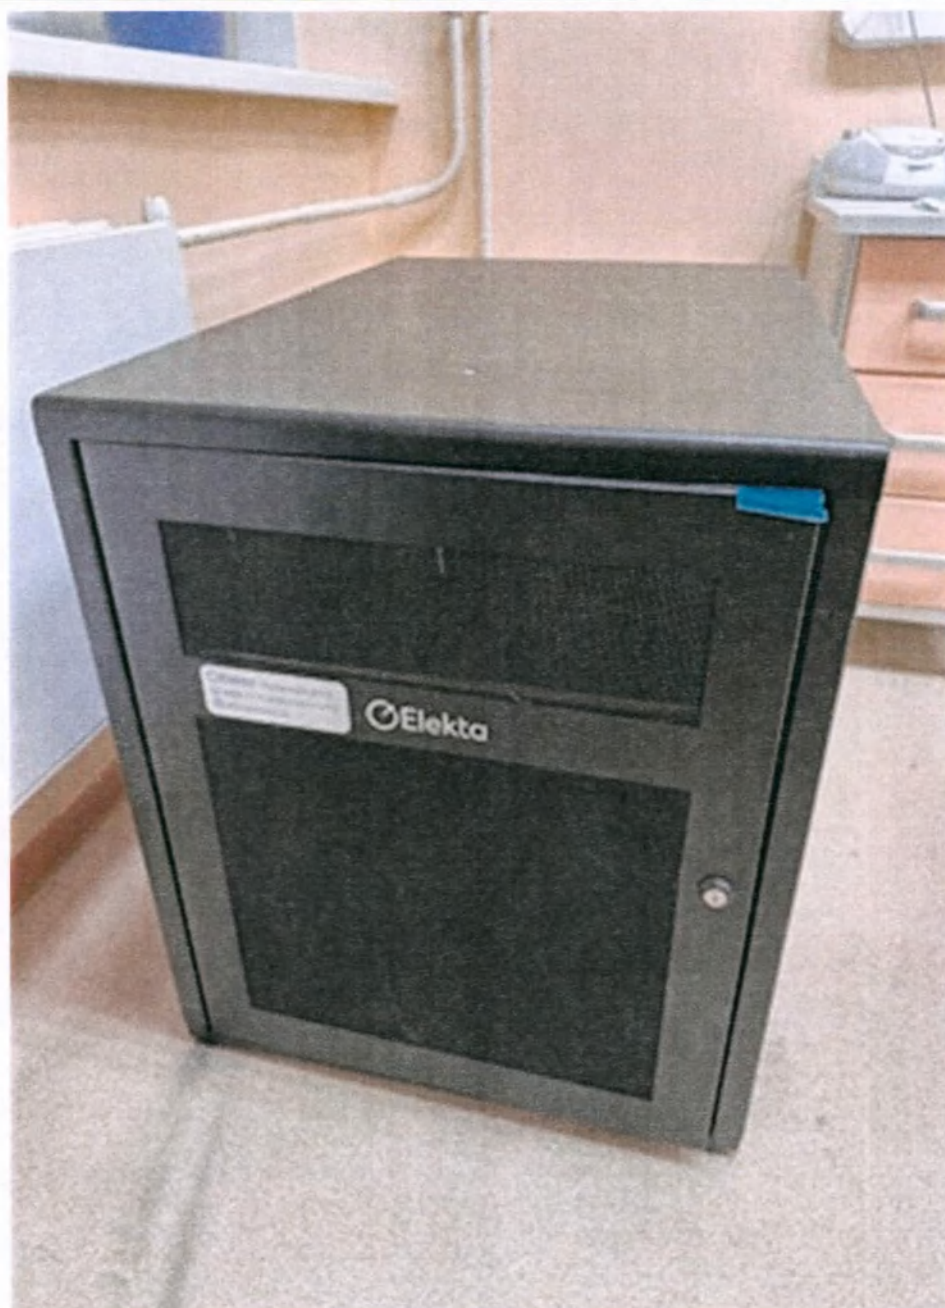

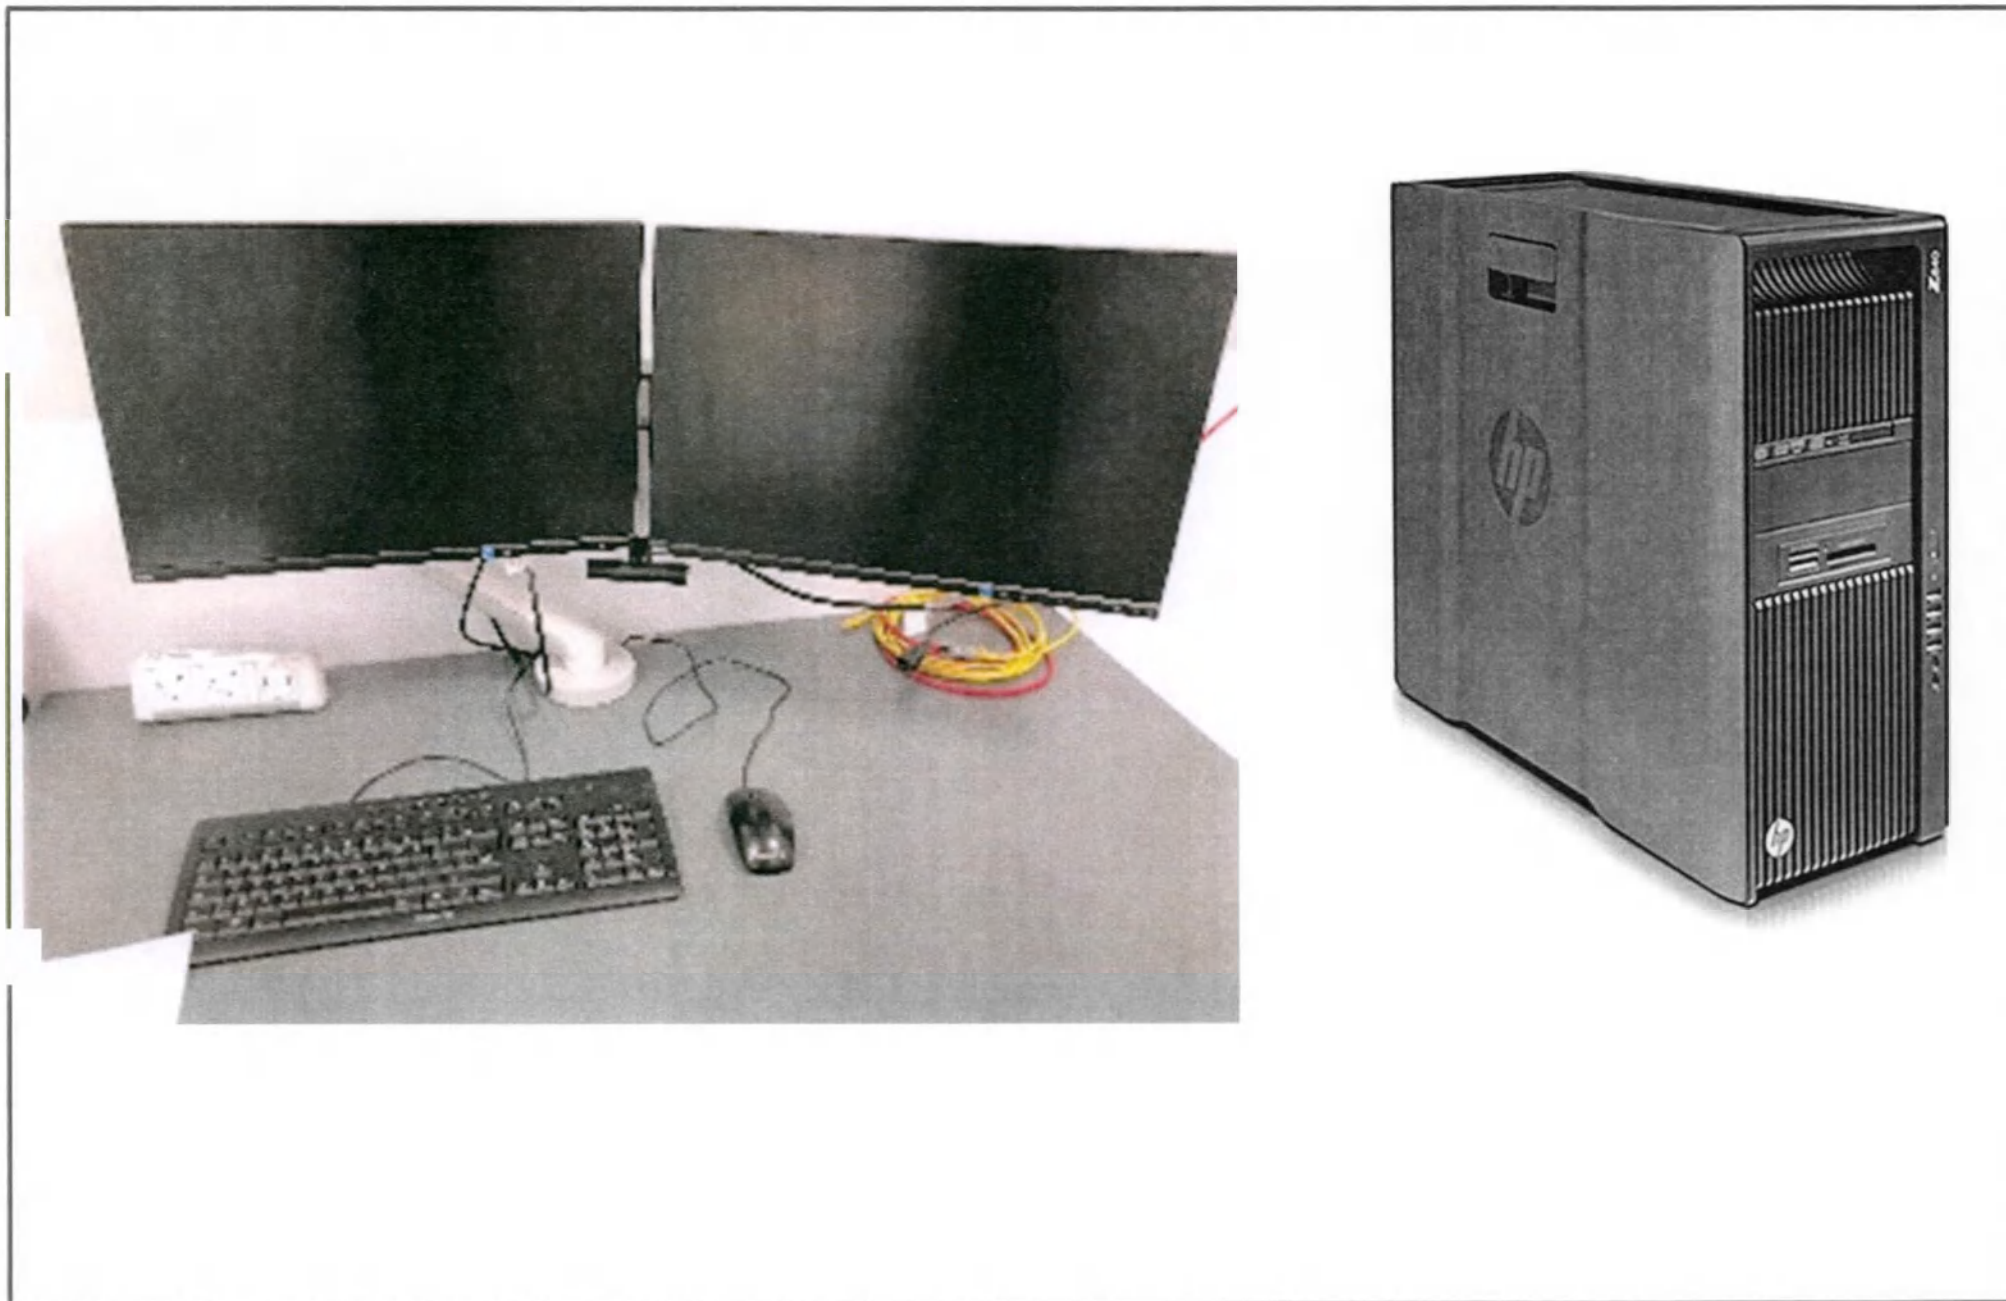



Специальный монитор системы управления комплексом с пультом




Многофункциональная клавиатура управления

- Дисплей мониторинговых единиц пучка



Роботизированный терапевтический стол Precise Treatment Table

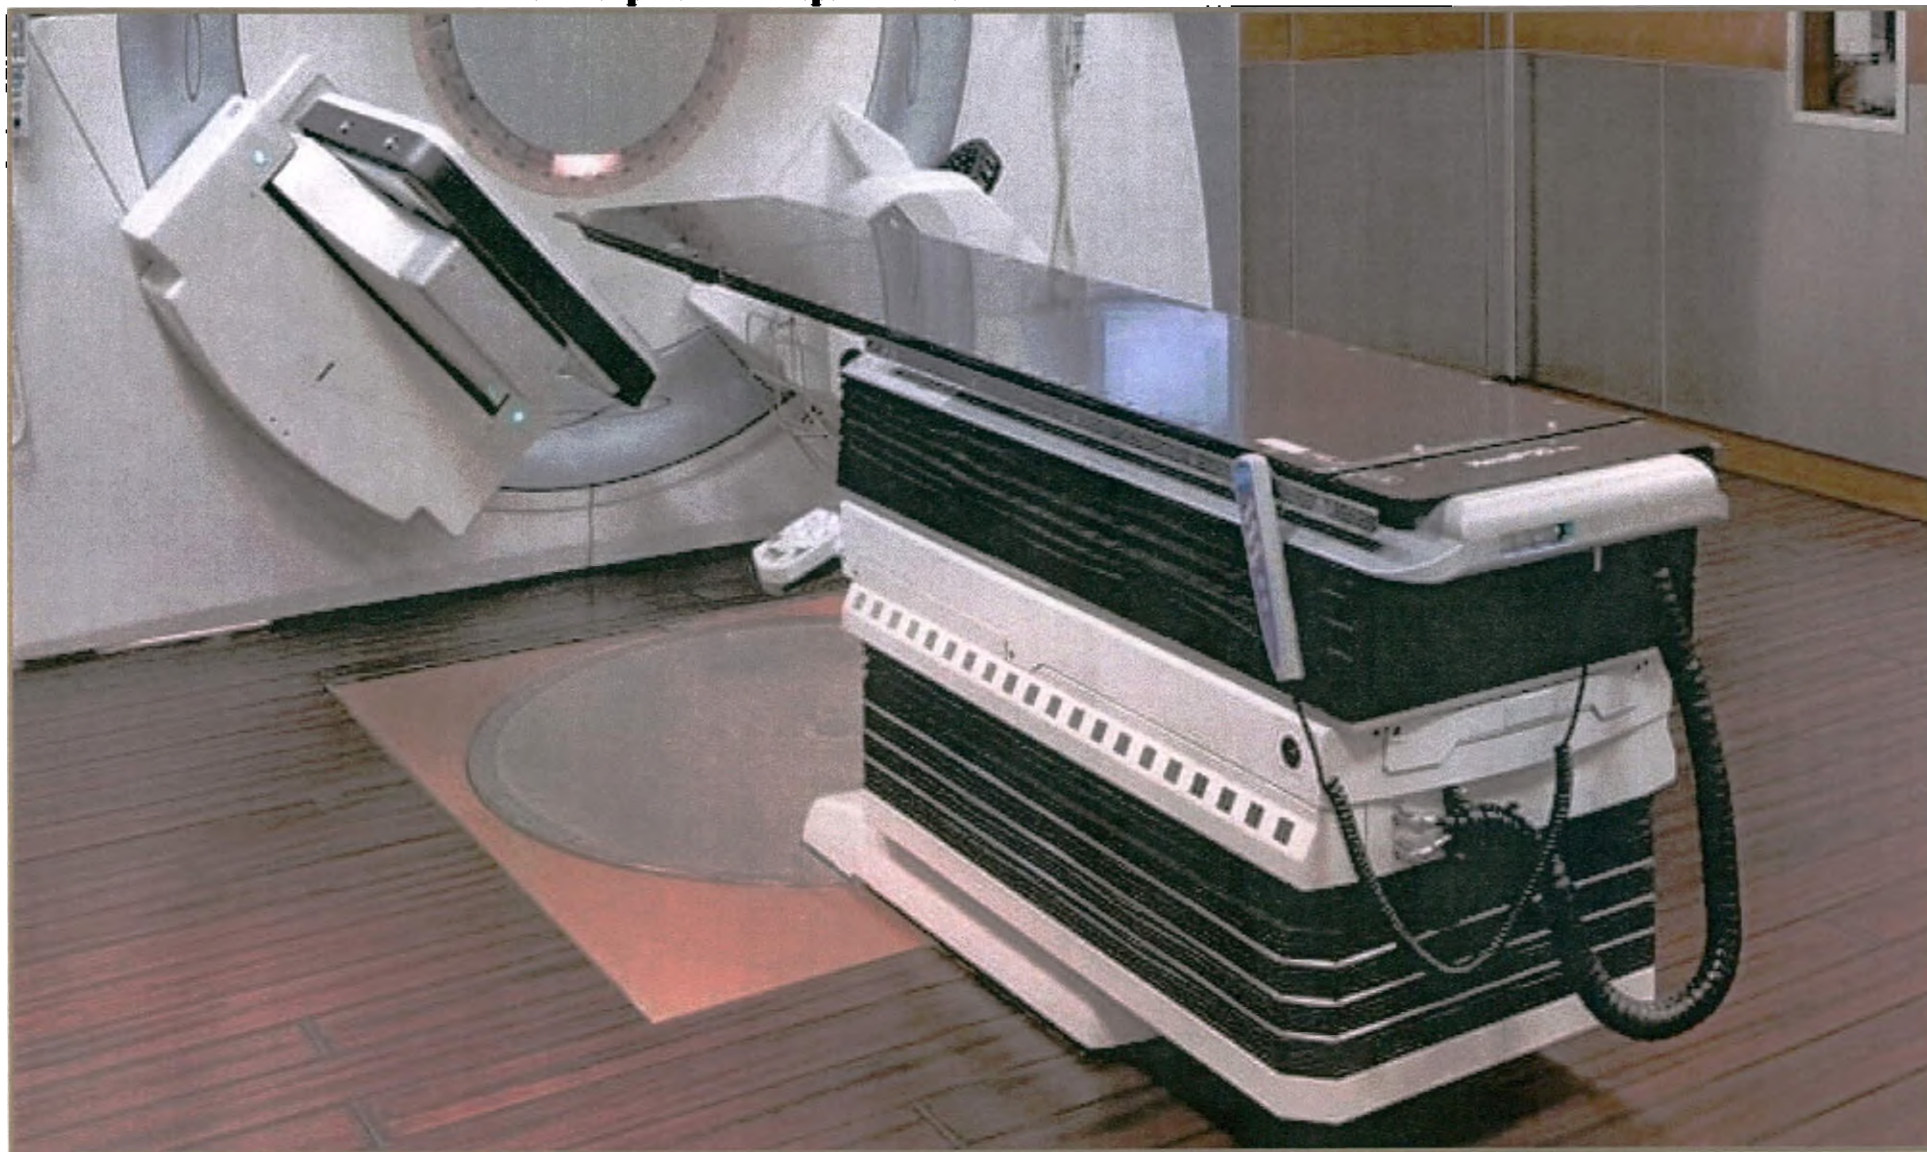



Модуль управления Response для включения и отключения системы управления синхронизацией Response

Система портальной визуализации iViewGT.

- Плоский цифровой детектор iViewGT







Система объёмного визуального контроля XVI


- Детекторная панель XVI - 1 шт.;
- Держатель-манипулятор детекторной панели XVI – 1 шт.




- Рентгеновская трубка (кВ-трубка)
- Держатель-манипулятор рентгеновской трубки

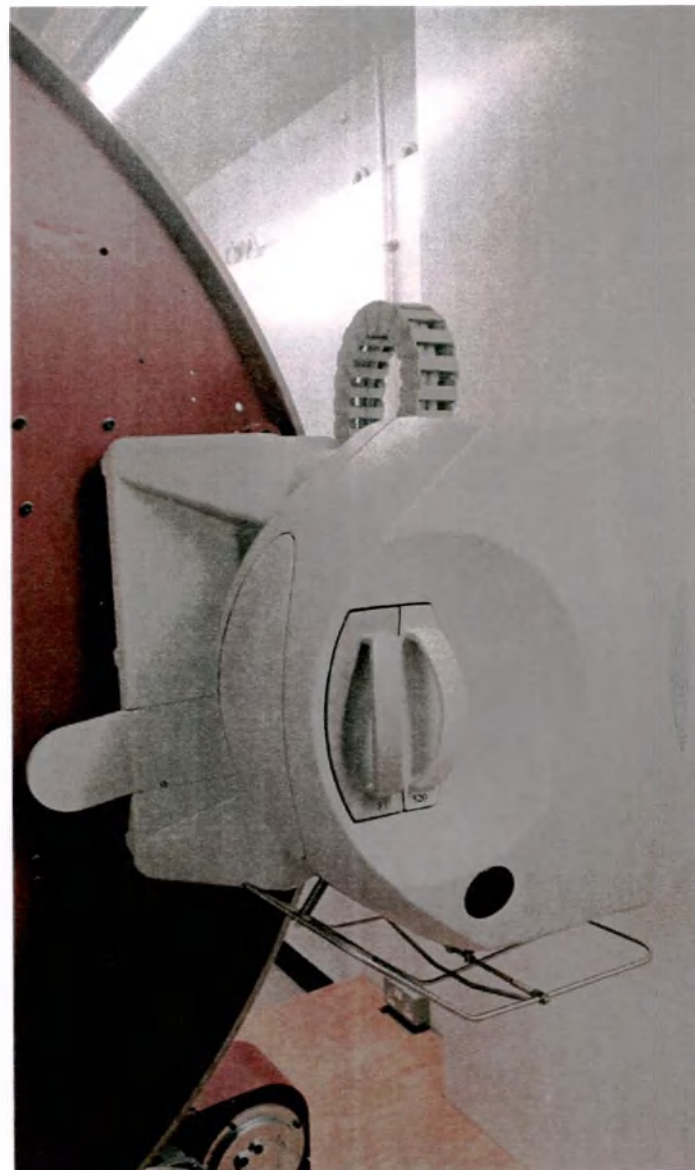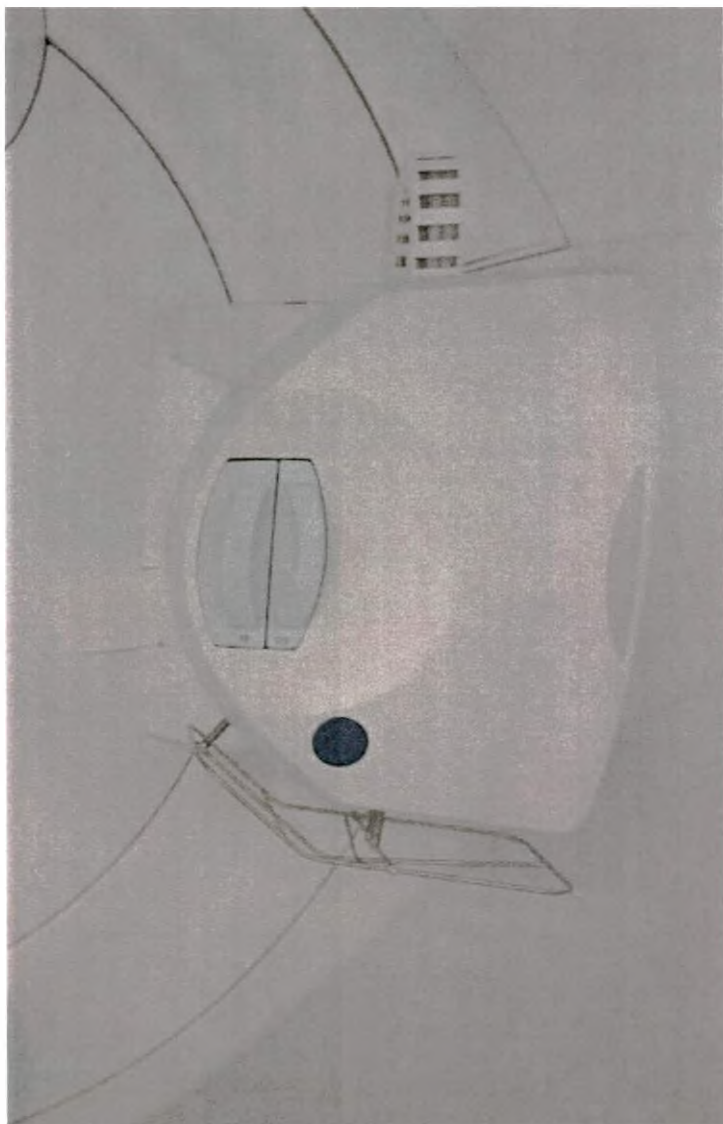


Стандартный набор кассет коллиматора для системы XVI

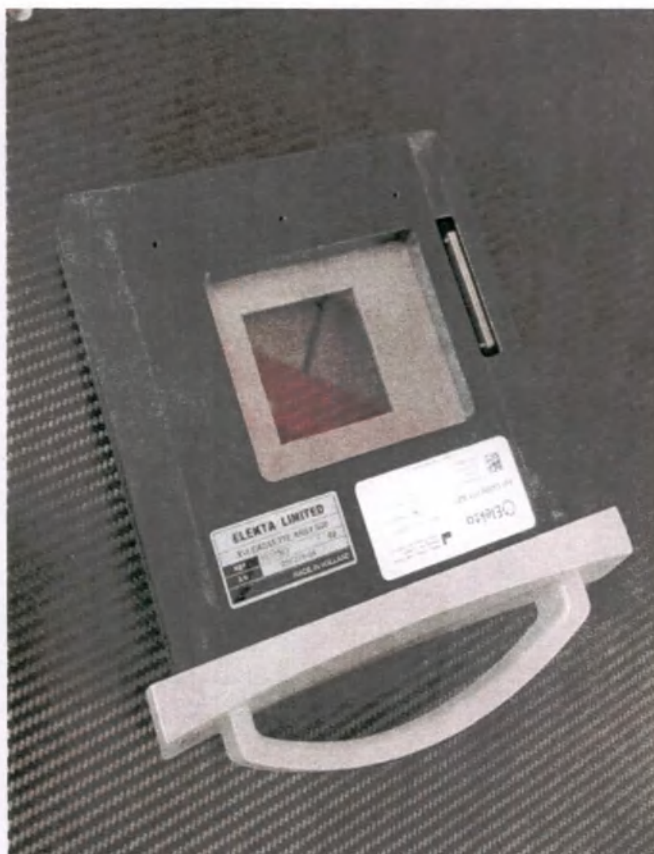


Устройство обеспечения режимов высокой мощности дозы фотонного излучения без использования сглаживающего фильтра FFF

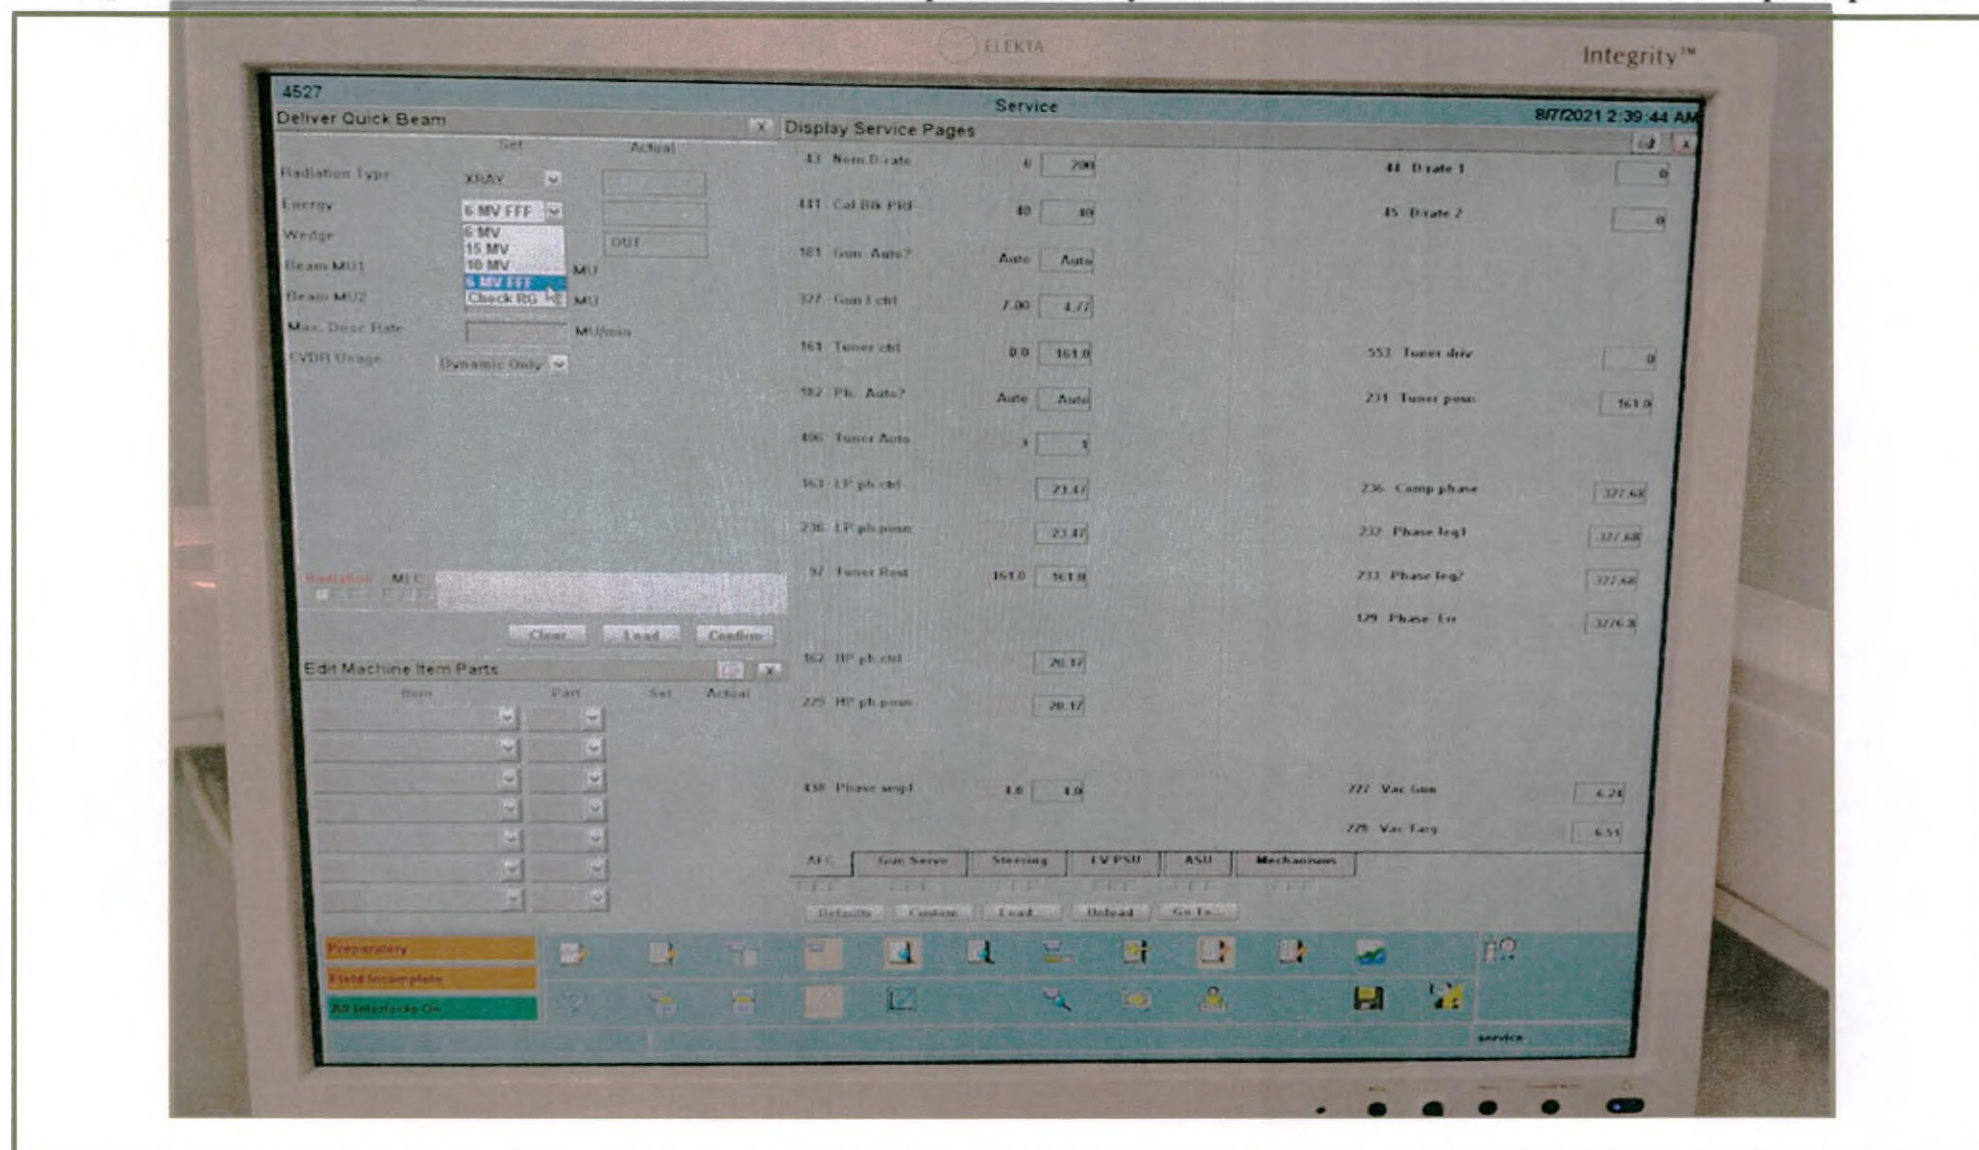


**Аппликатор для электронных пучков, в составе: 6 x 6 см, 10 x 10 см, 14 x 14 см, 20 x 20 см, 10 x 6 см,
10 x 6 см, 14 x 6 см, 16 x 8 см, 20 x 10 см, 25 x 25 см**

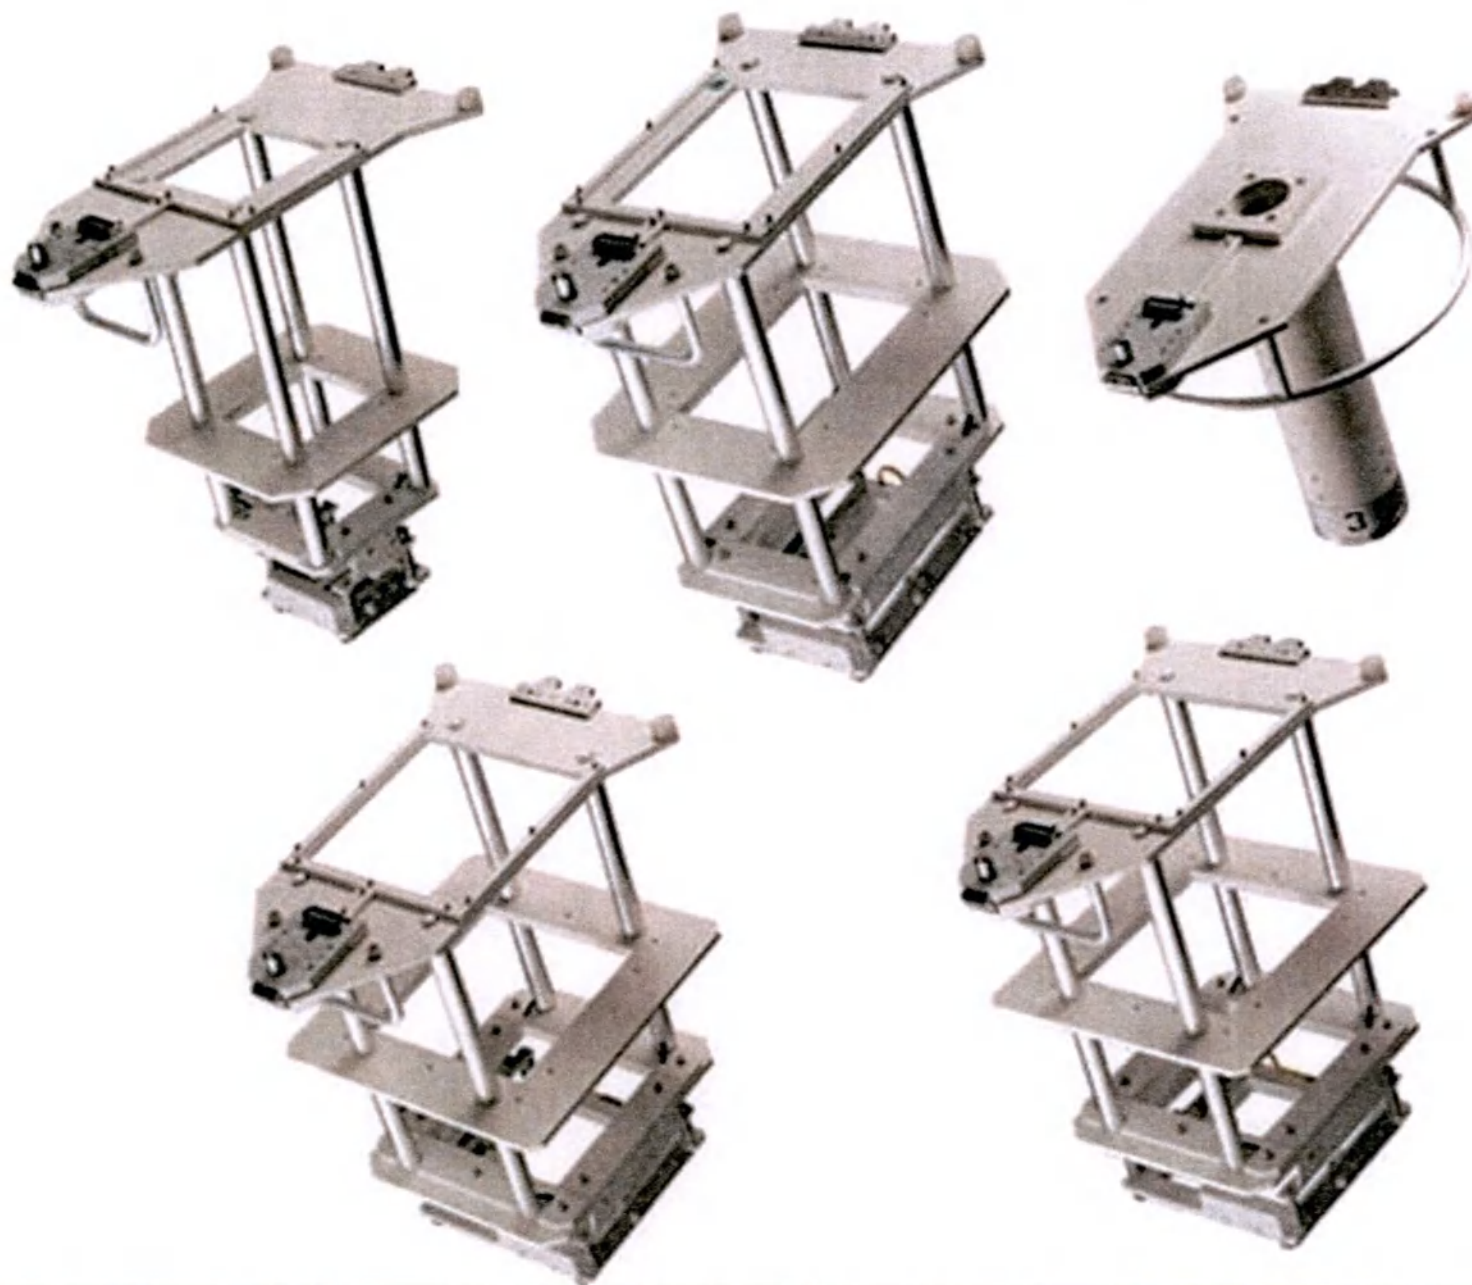


Аппликатор для электронных пучков HDRE

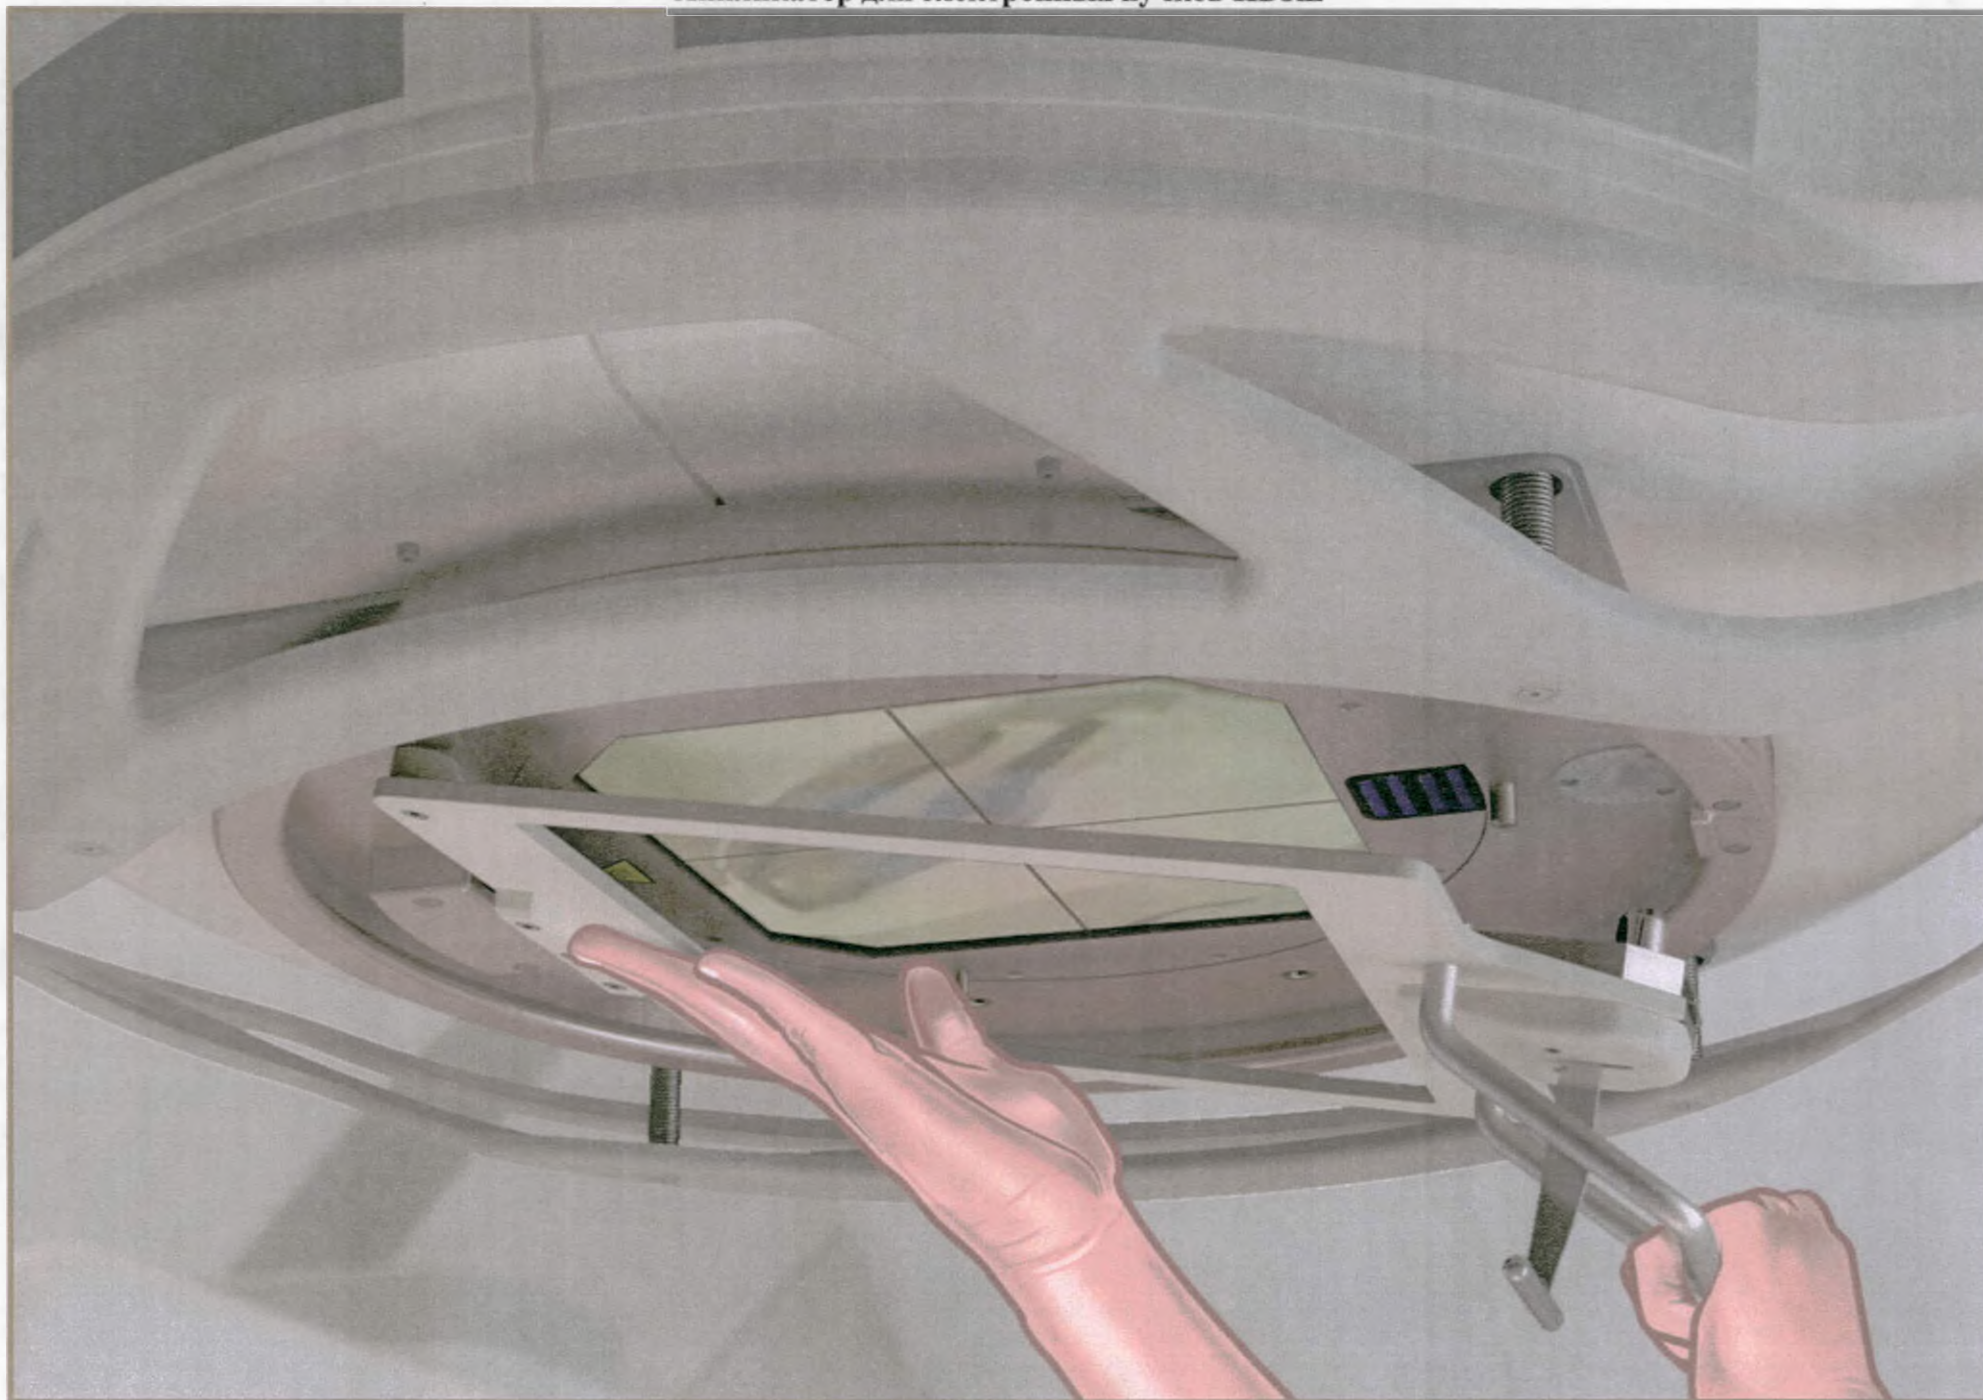


Устройства лазерных центраторов.

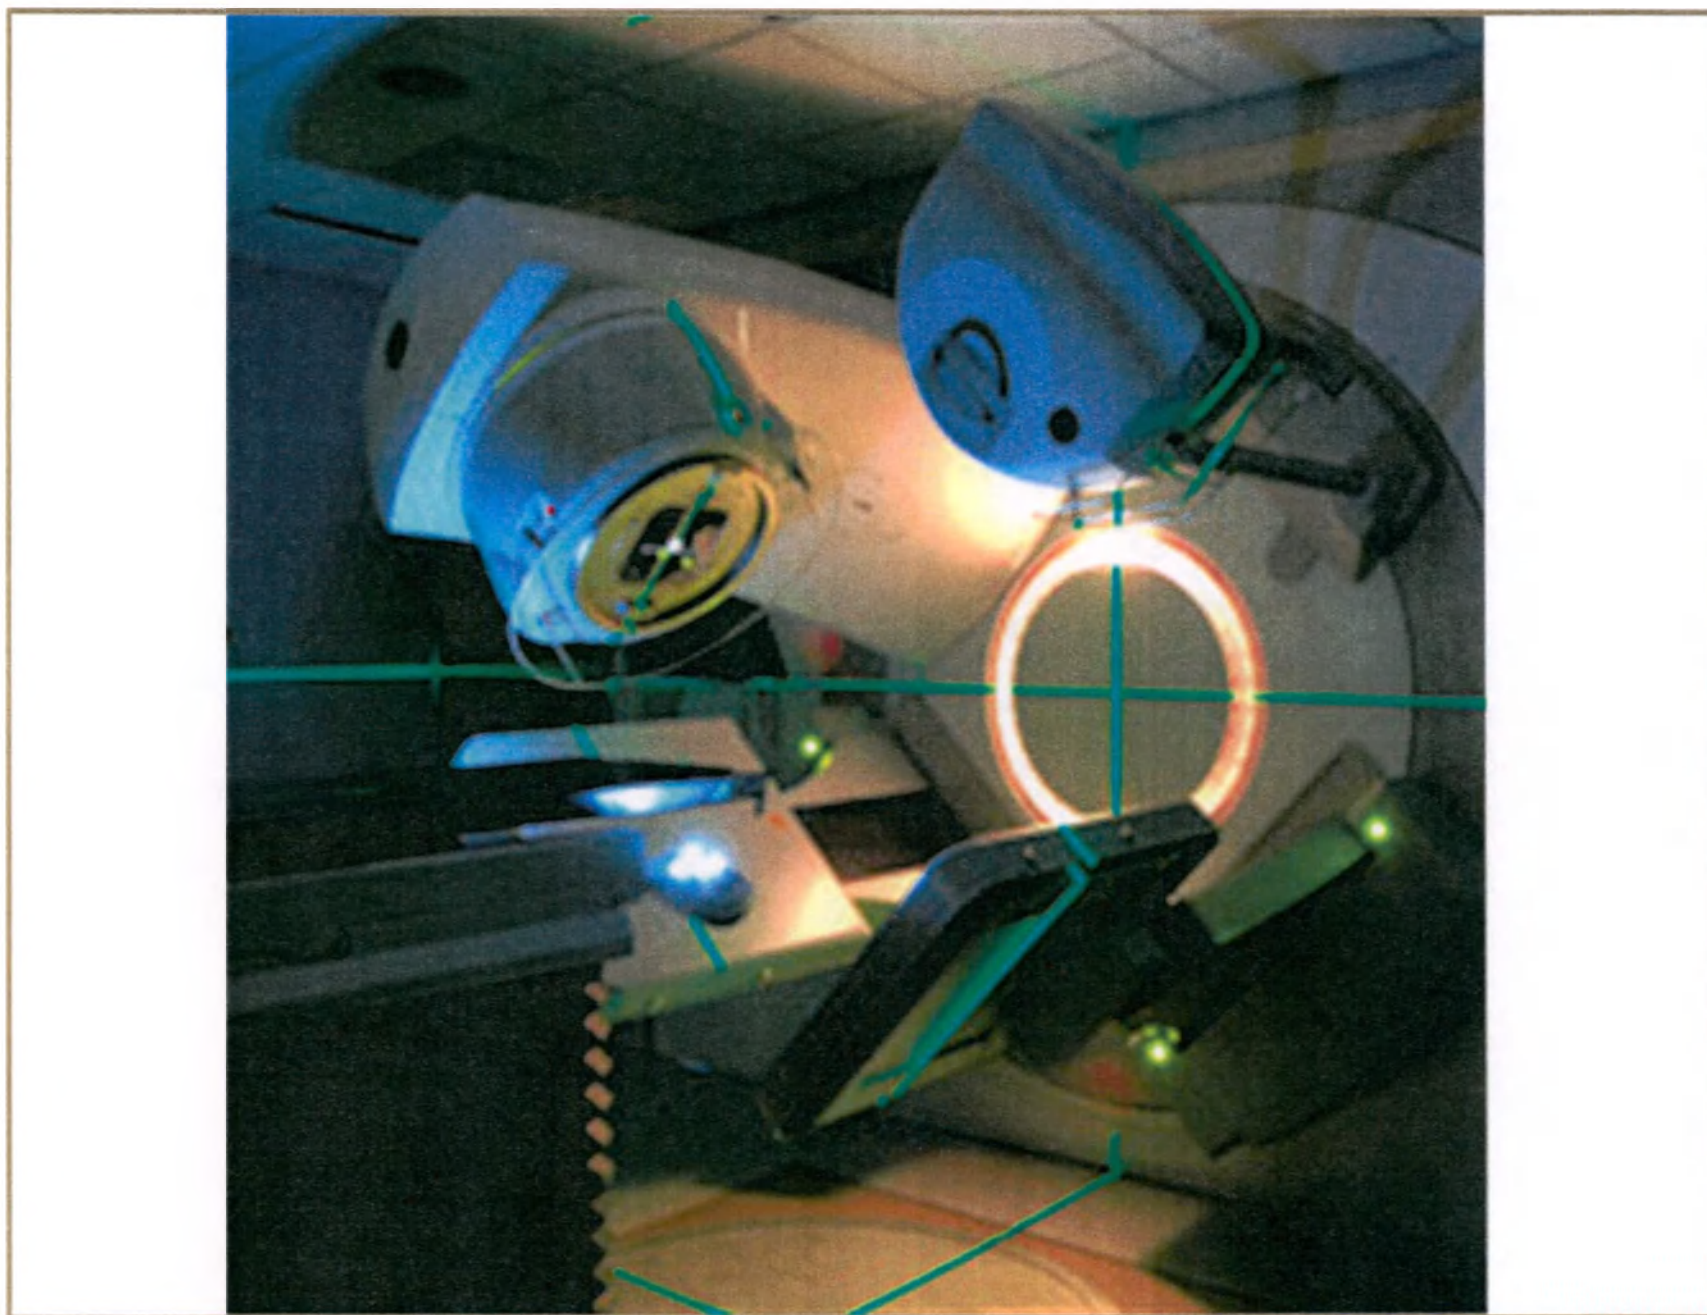

Система видеонаблюдения за пациентом.

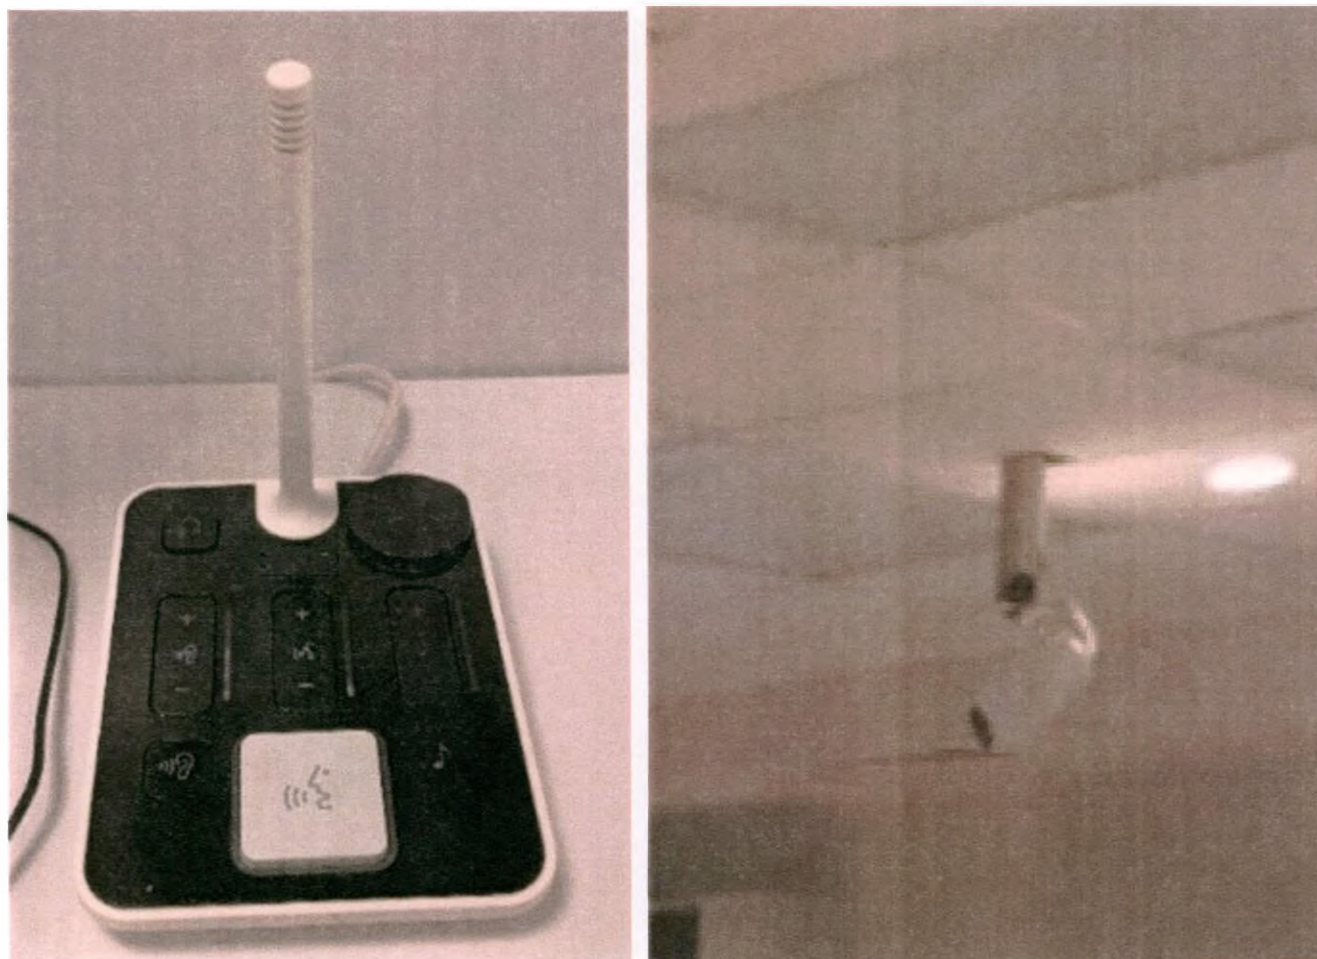


Система координации дыхания пациента (Active Breathing Coordinator).

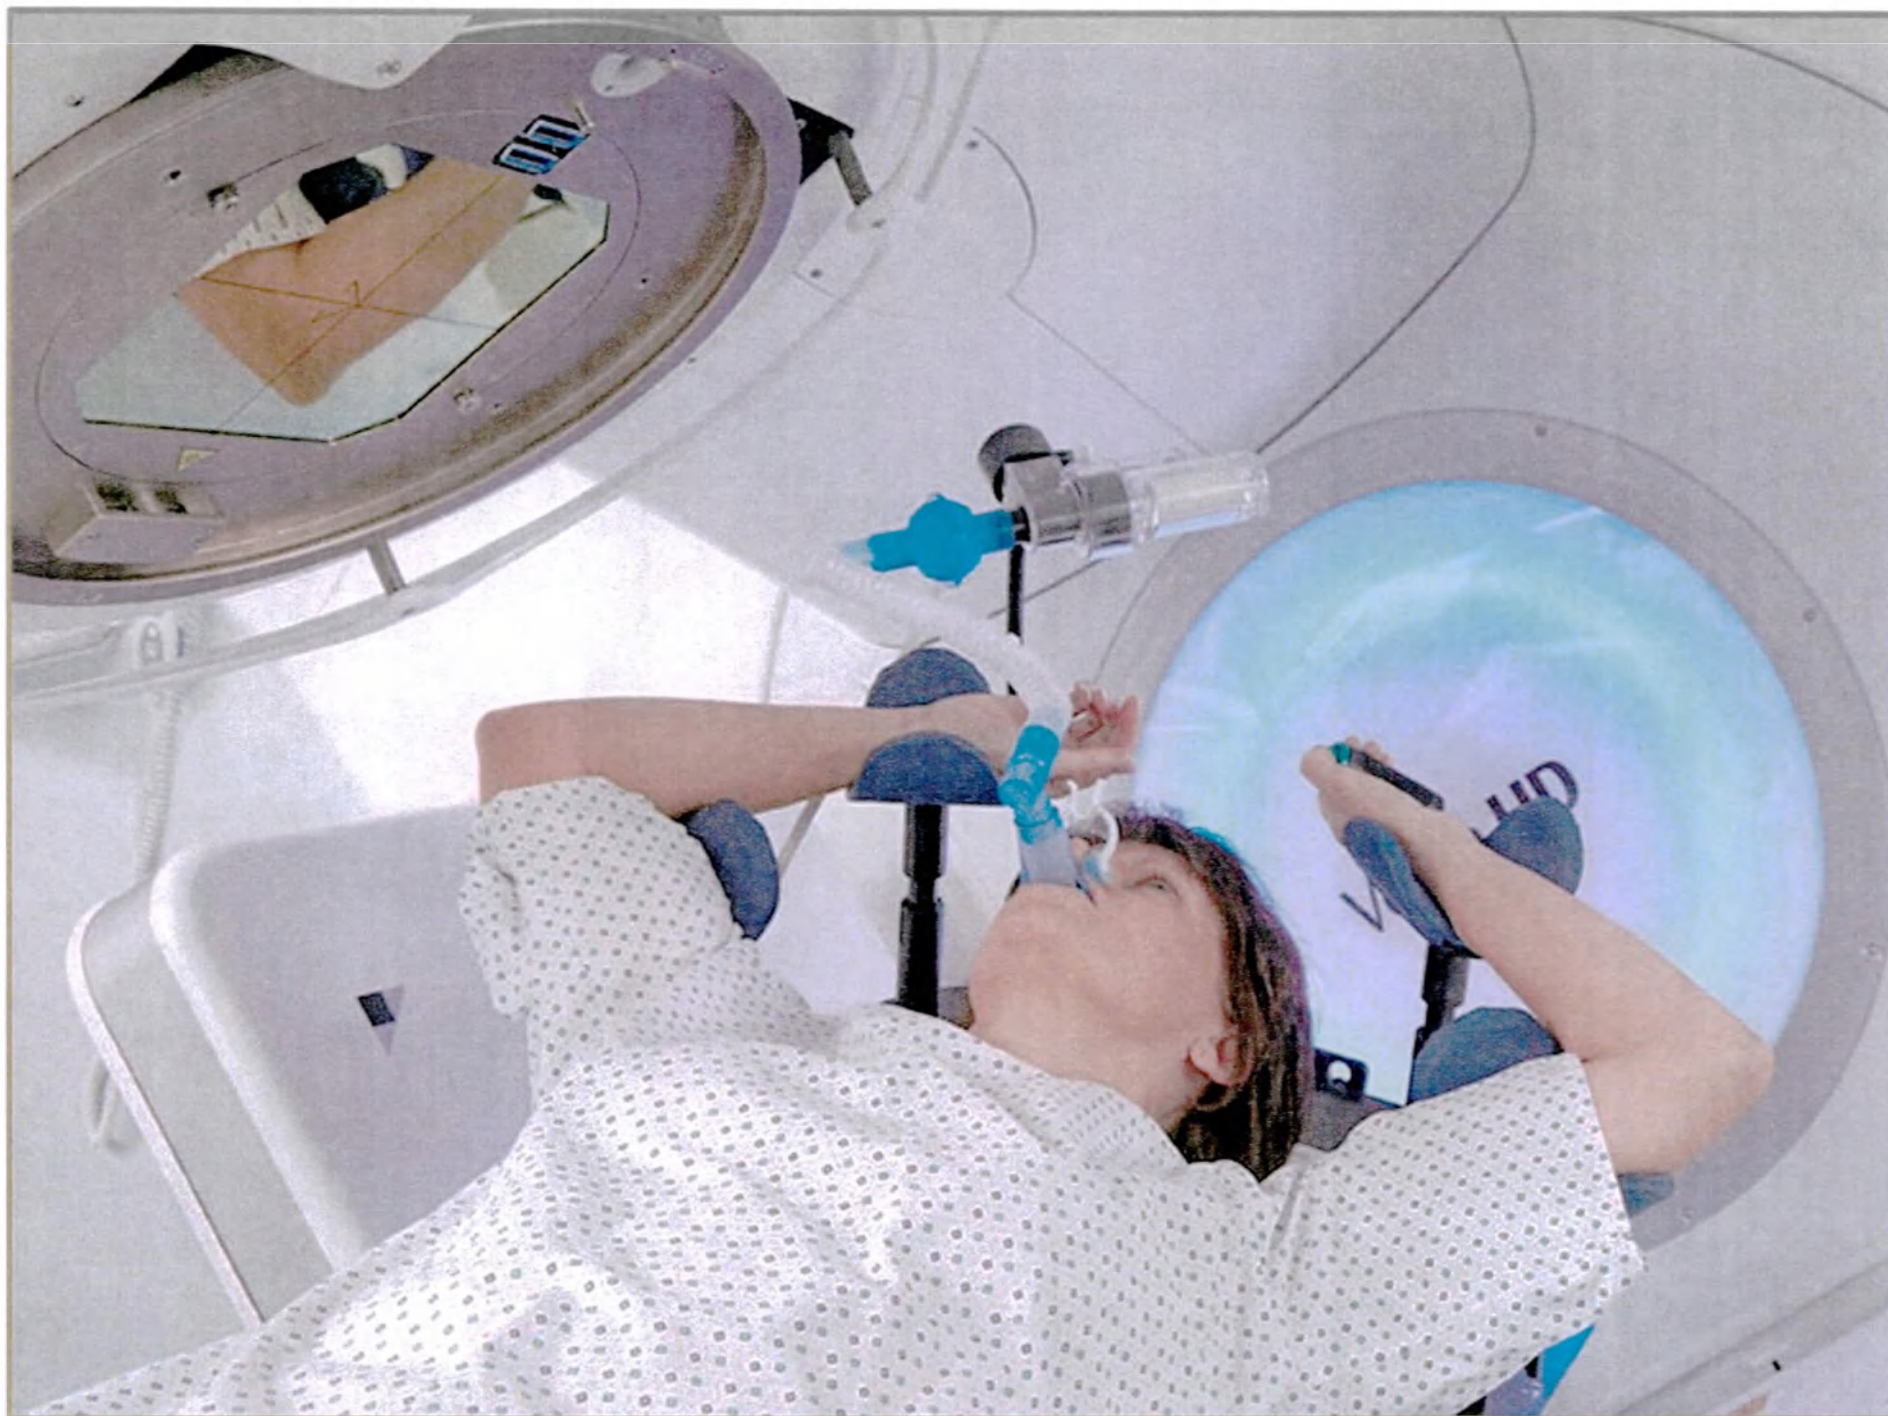

Роботизированная система позиционирования пациента 6D HexaPod evo RT



- Роботизированная дека стола

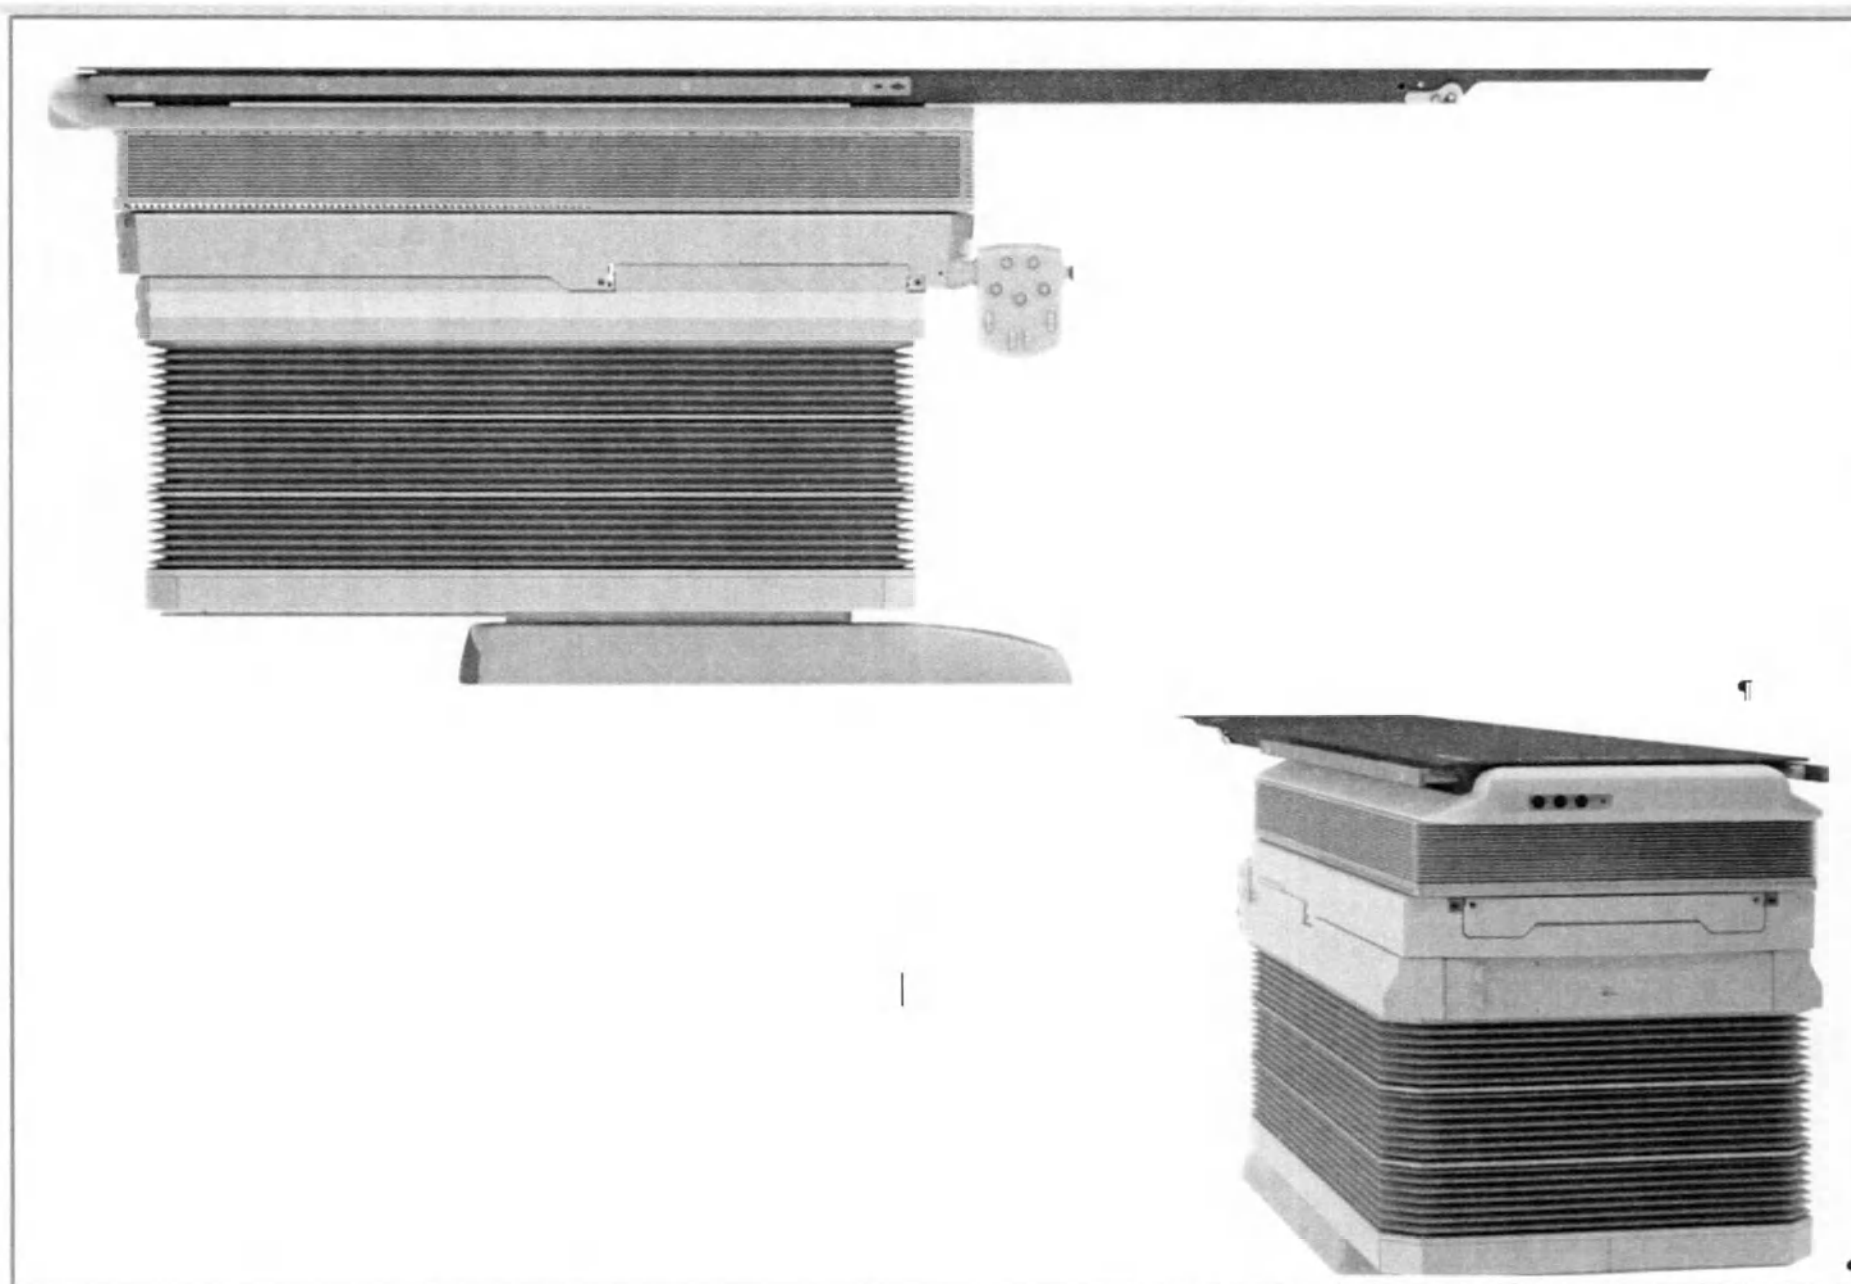


- Система отслеживания iGUIDE с установленным ПО iGUIDE
- Рабочая станция и терминалы системы iGUIDE
- Инструмент отслеживания системы iGUIDE




- Калибровочное устройство
- Распределительная коробка HexaPod

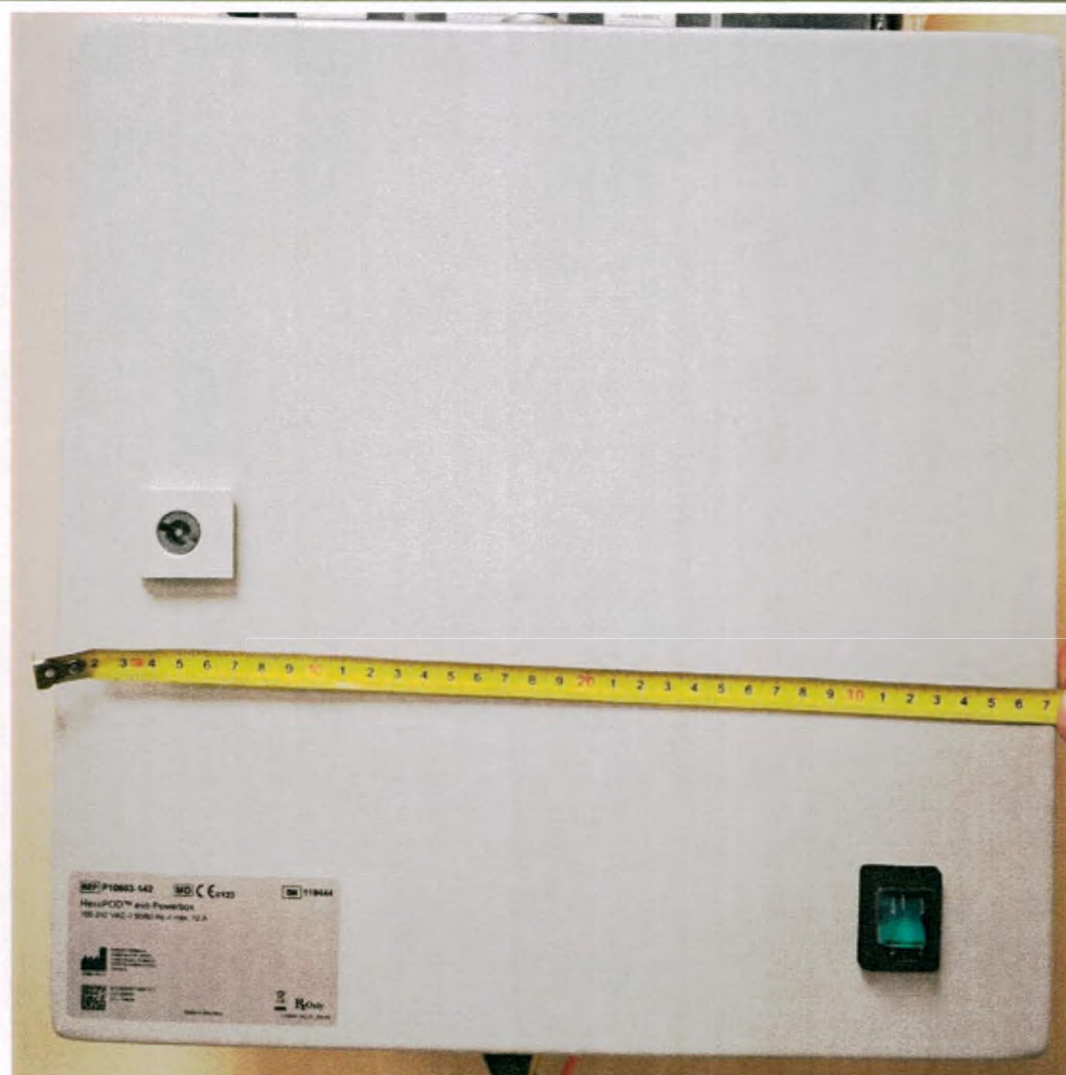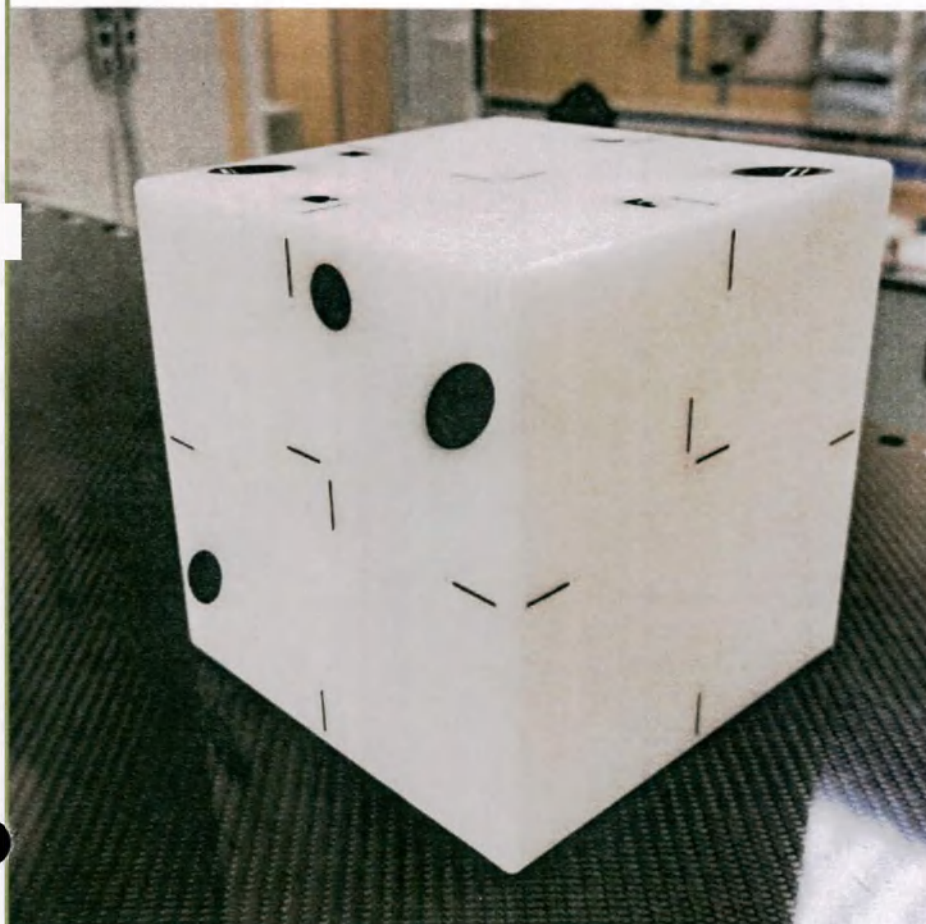


Дека лечебного стола iBEAM evo Couchtop

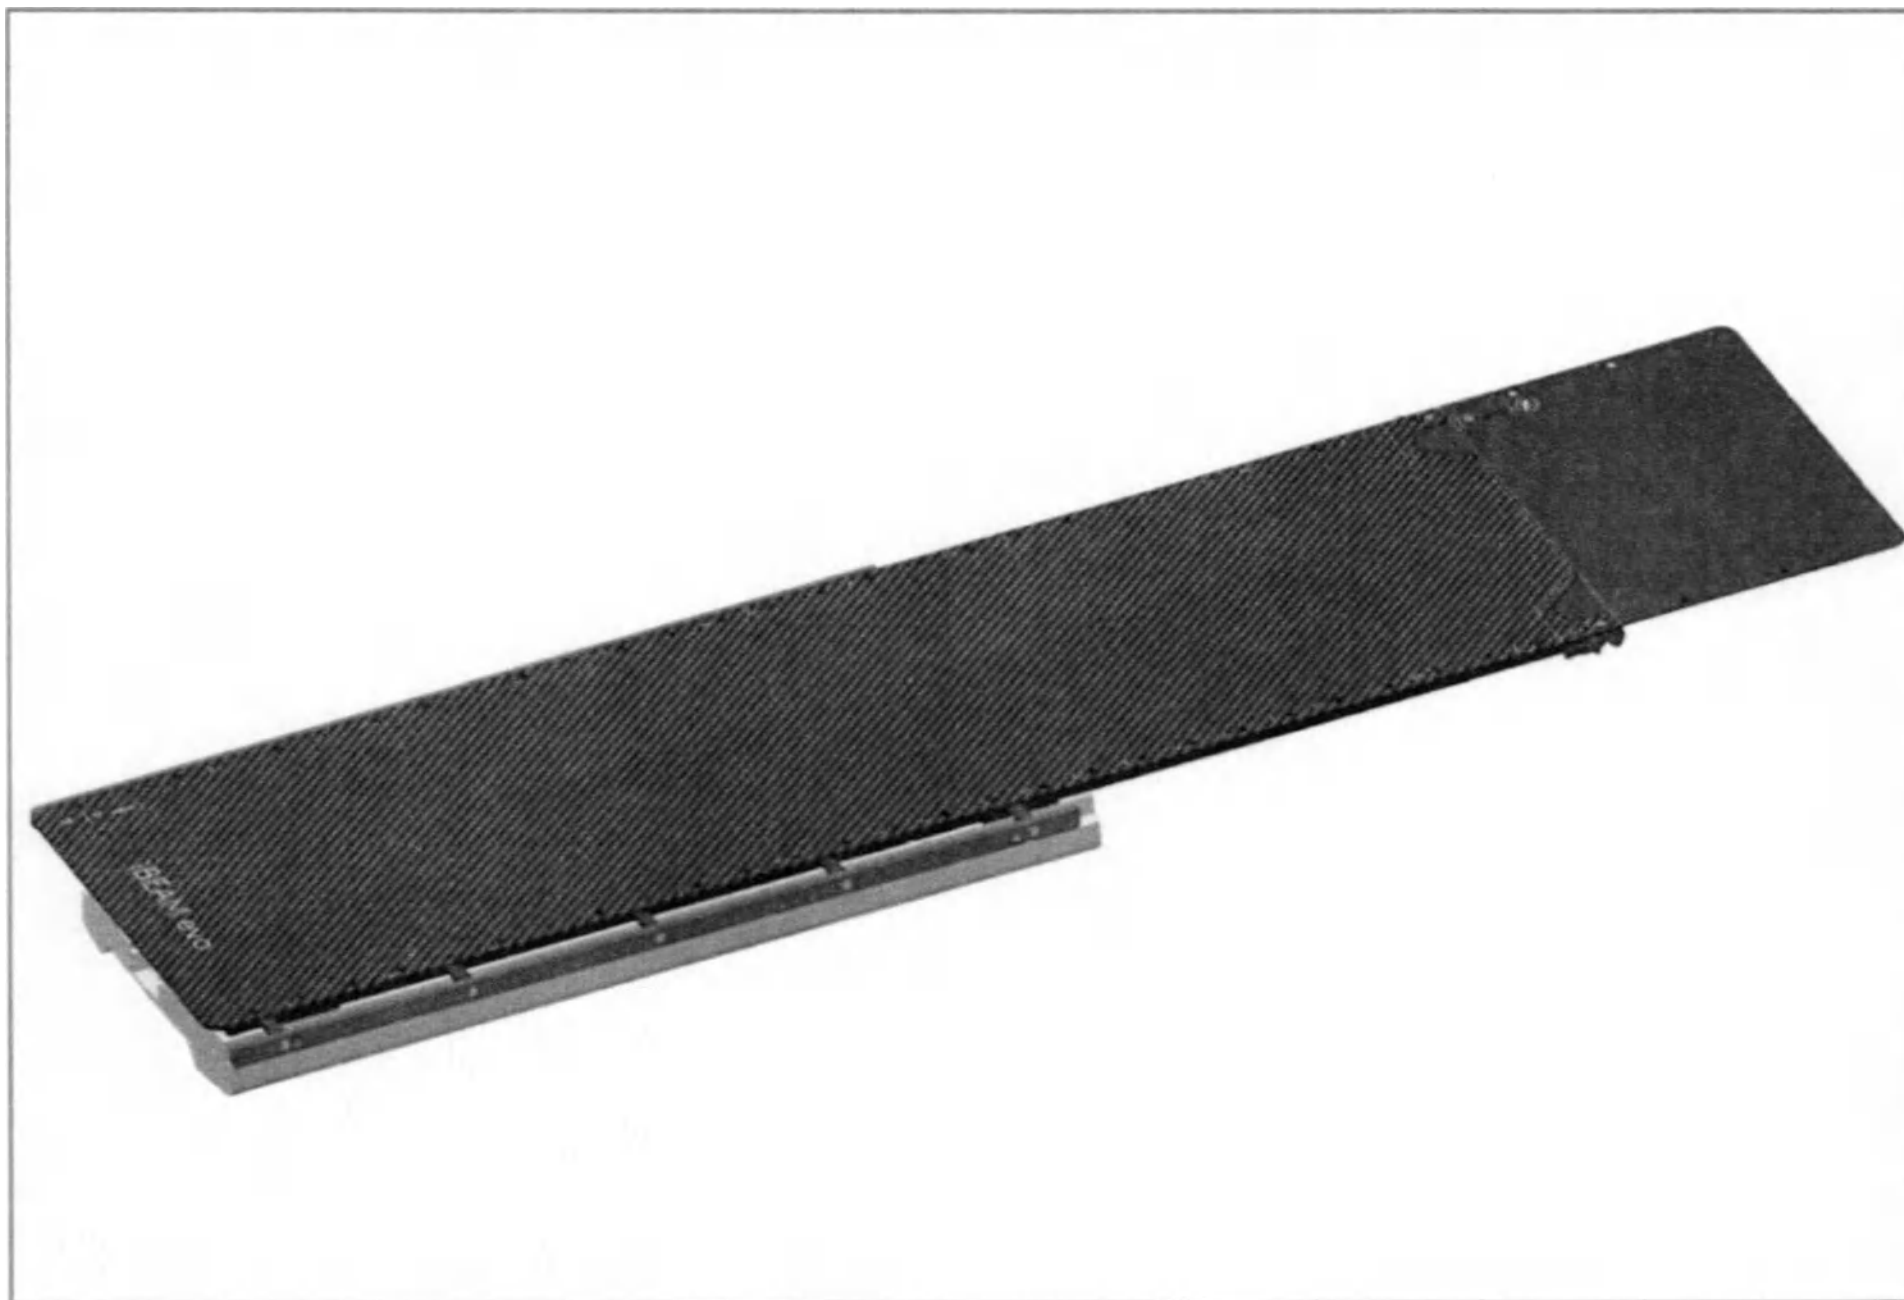


Дека лечебного стола iBEAM one Couchtop

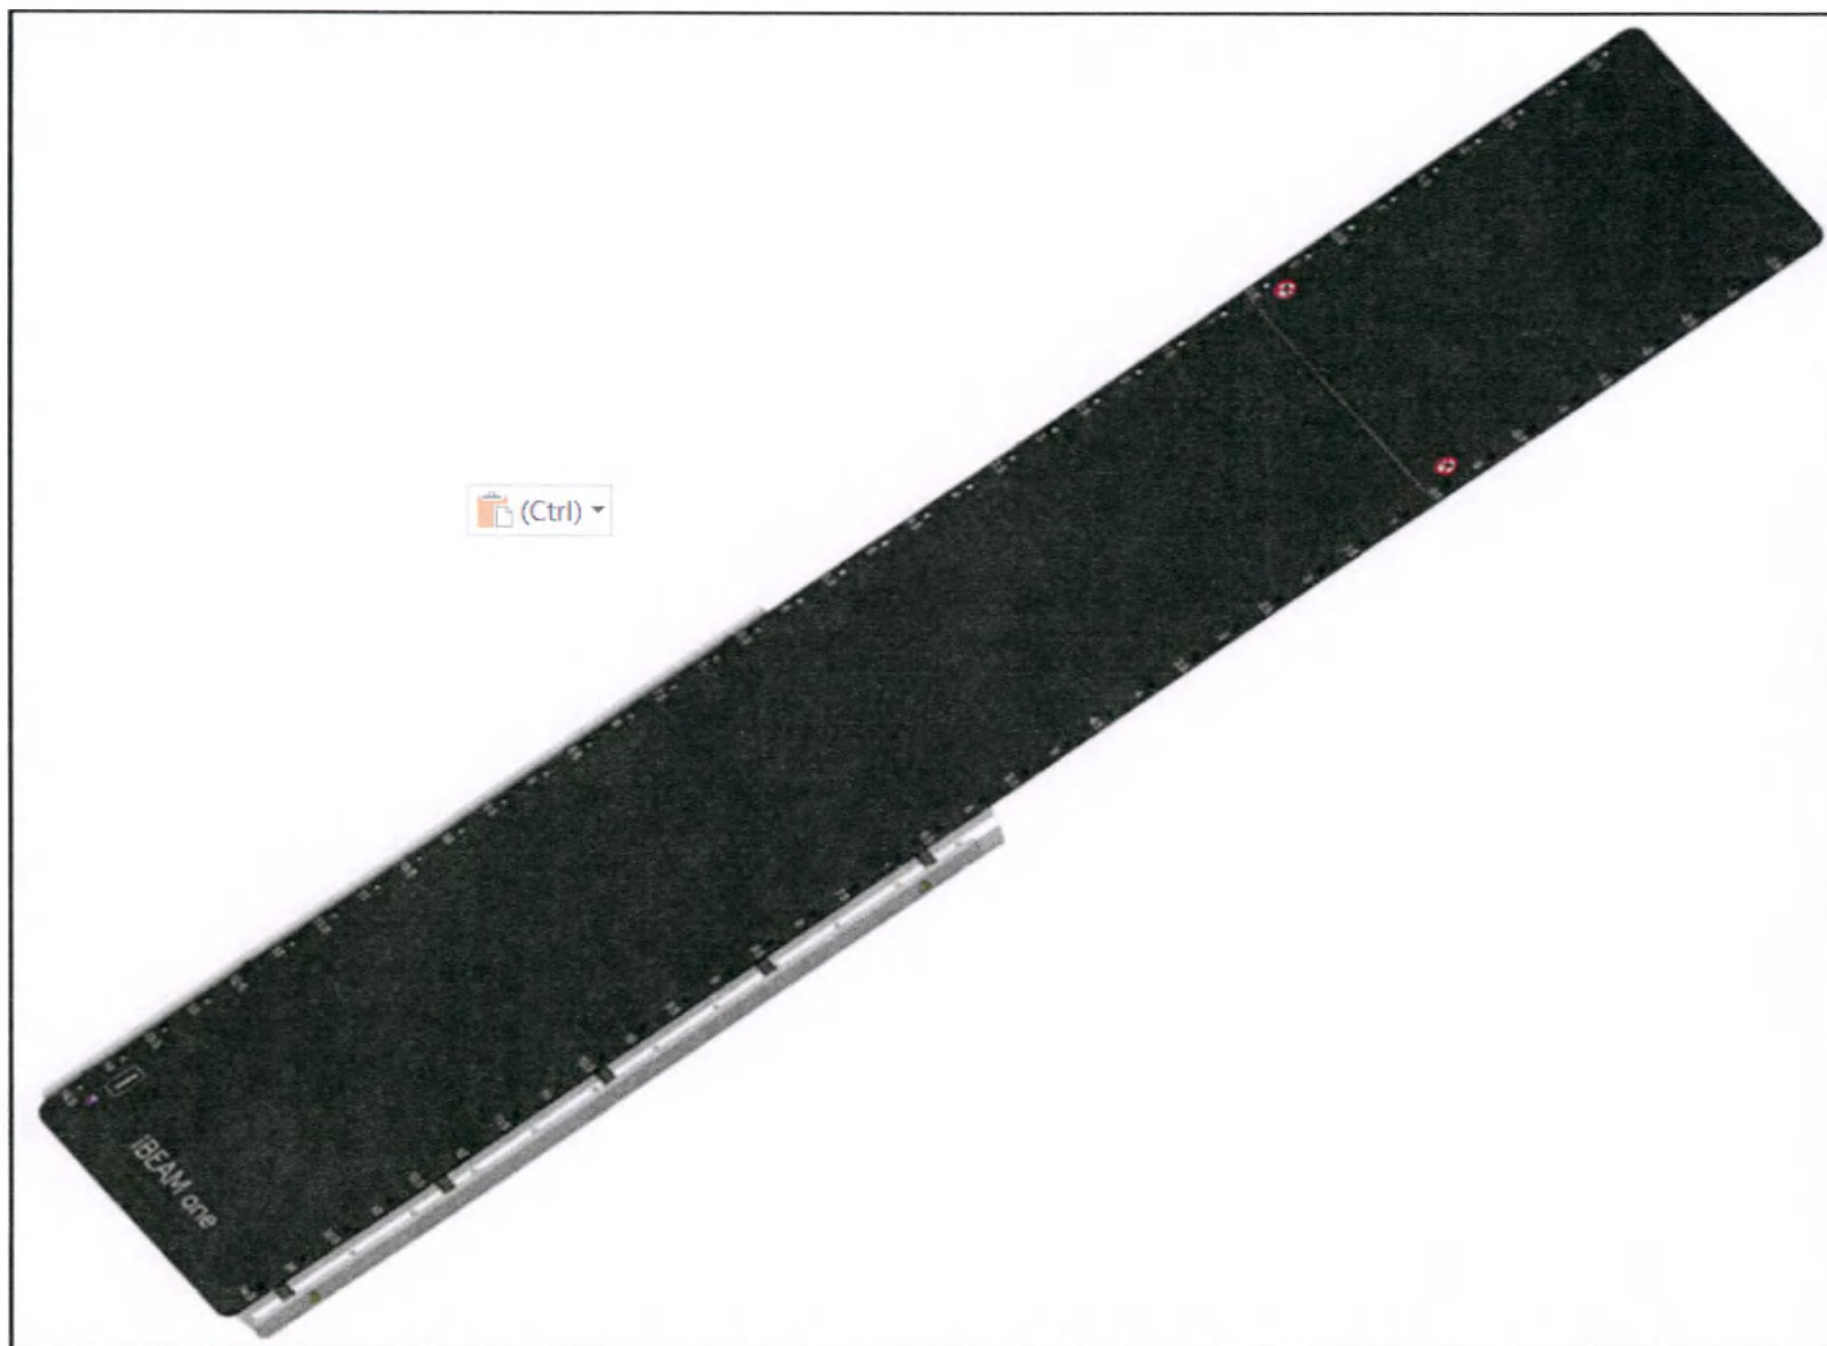


Дека лечебного стола НехаPOD evo RT Couchtop

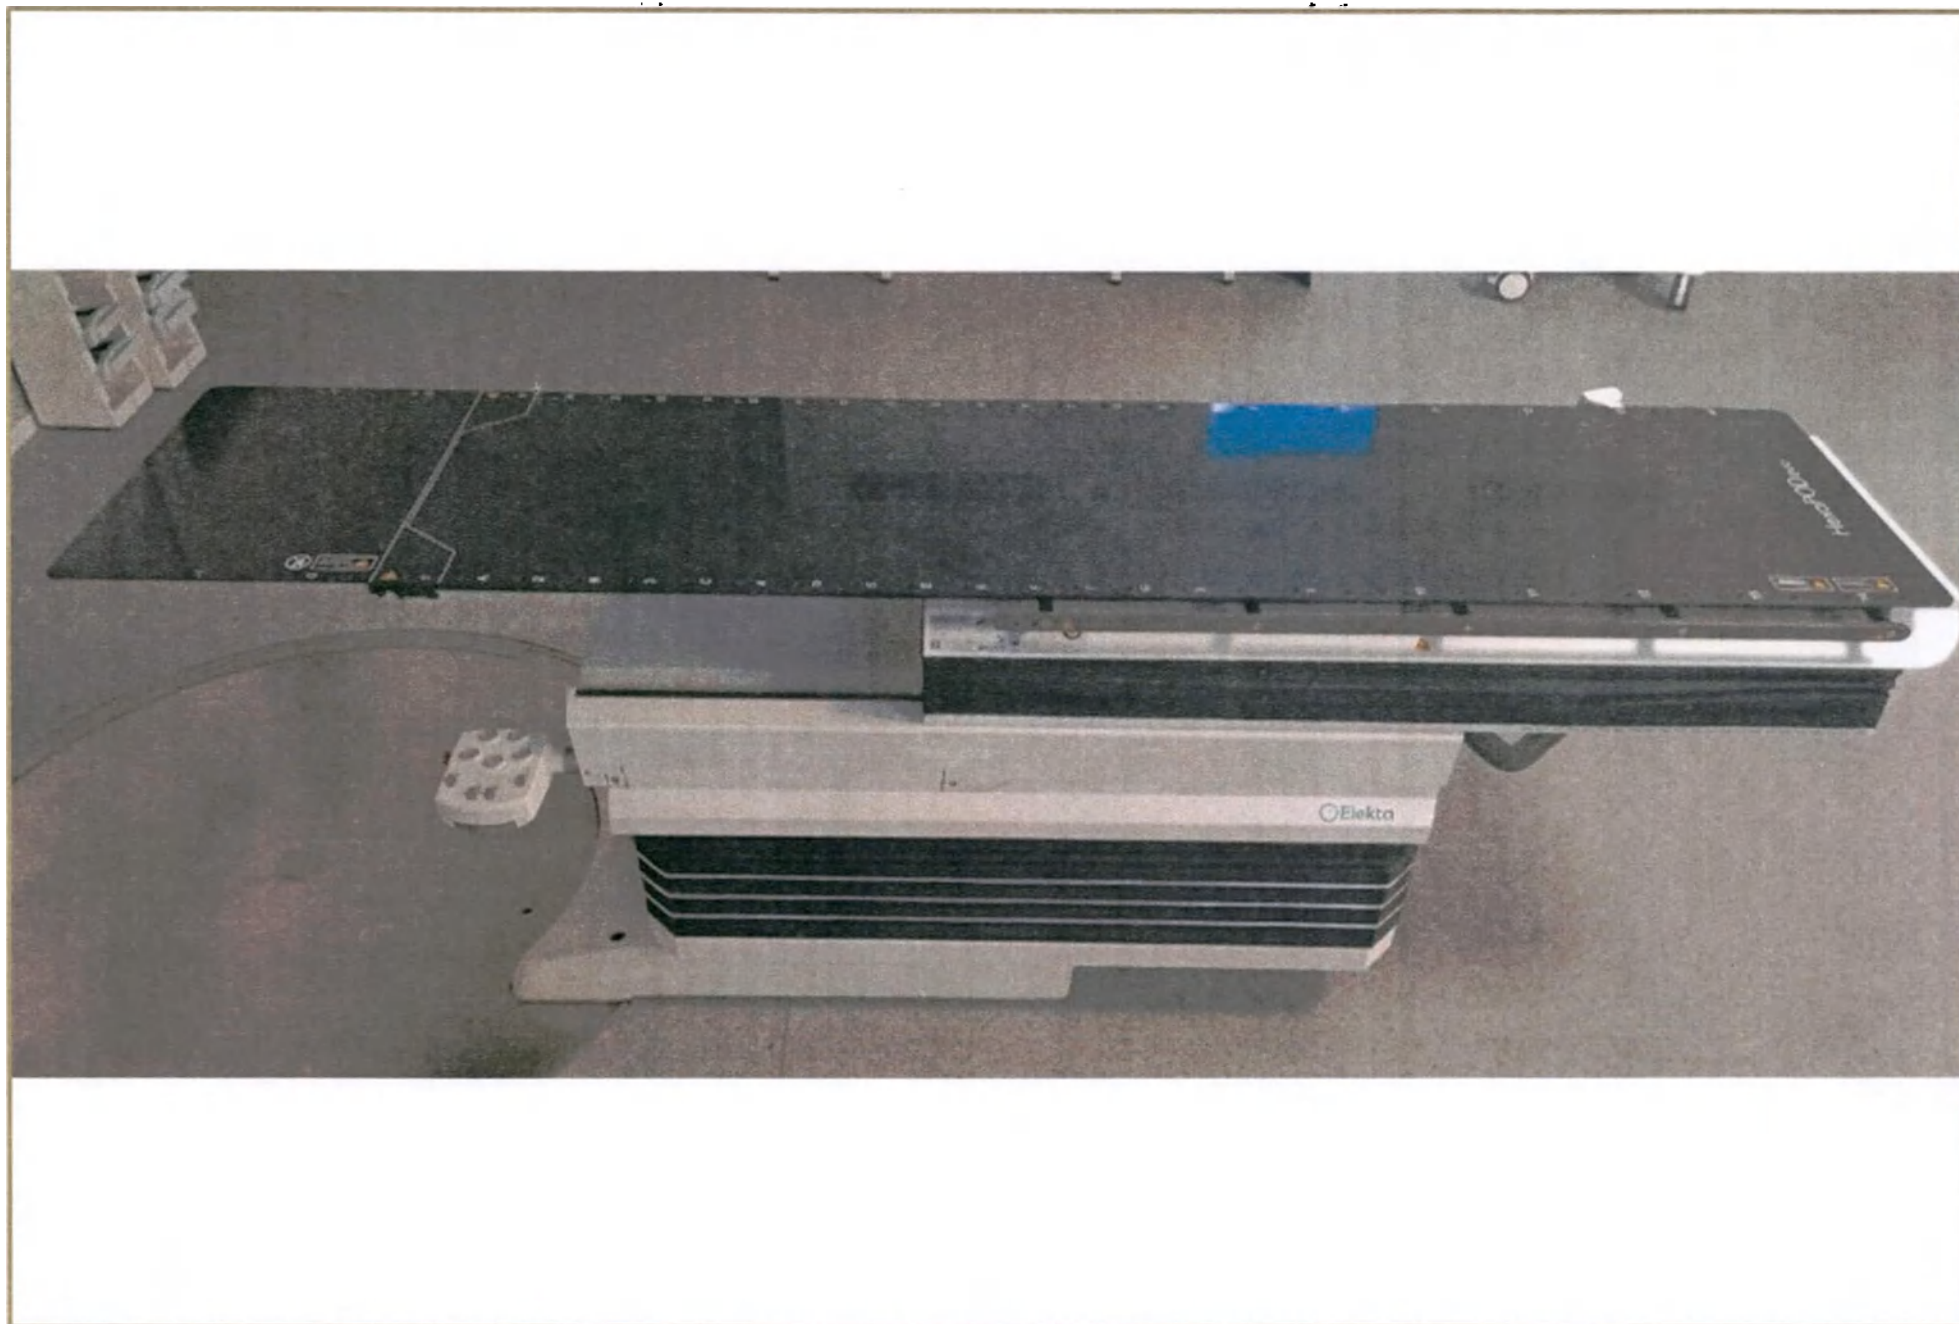


Система видеонаблюдения за пациентом

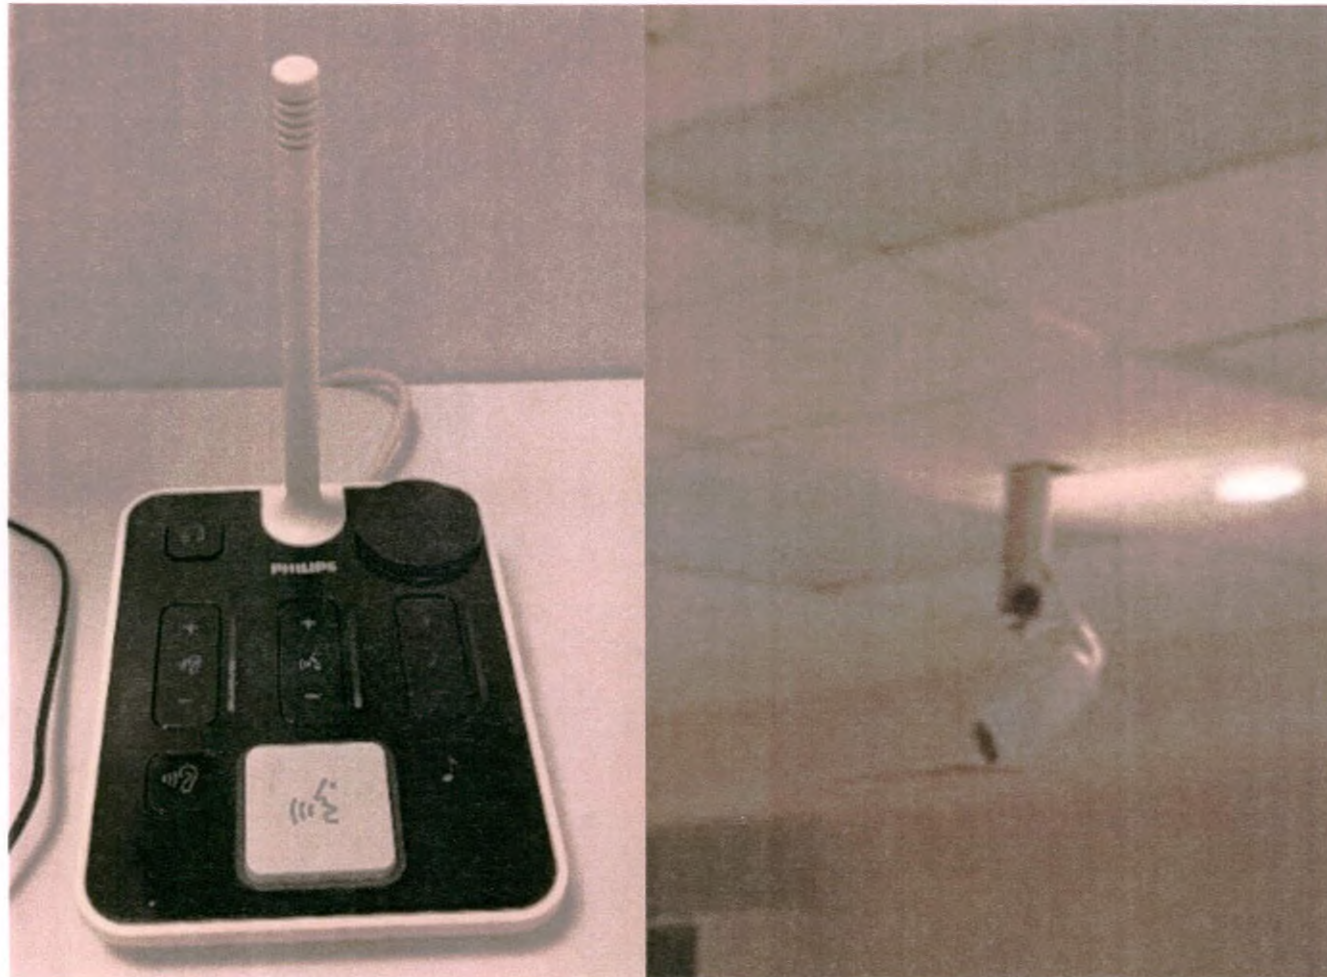


Программное обеспечение для расширения возможностей системы: Монасо.

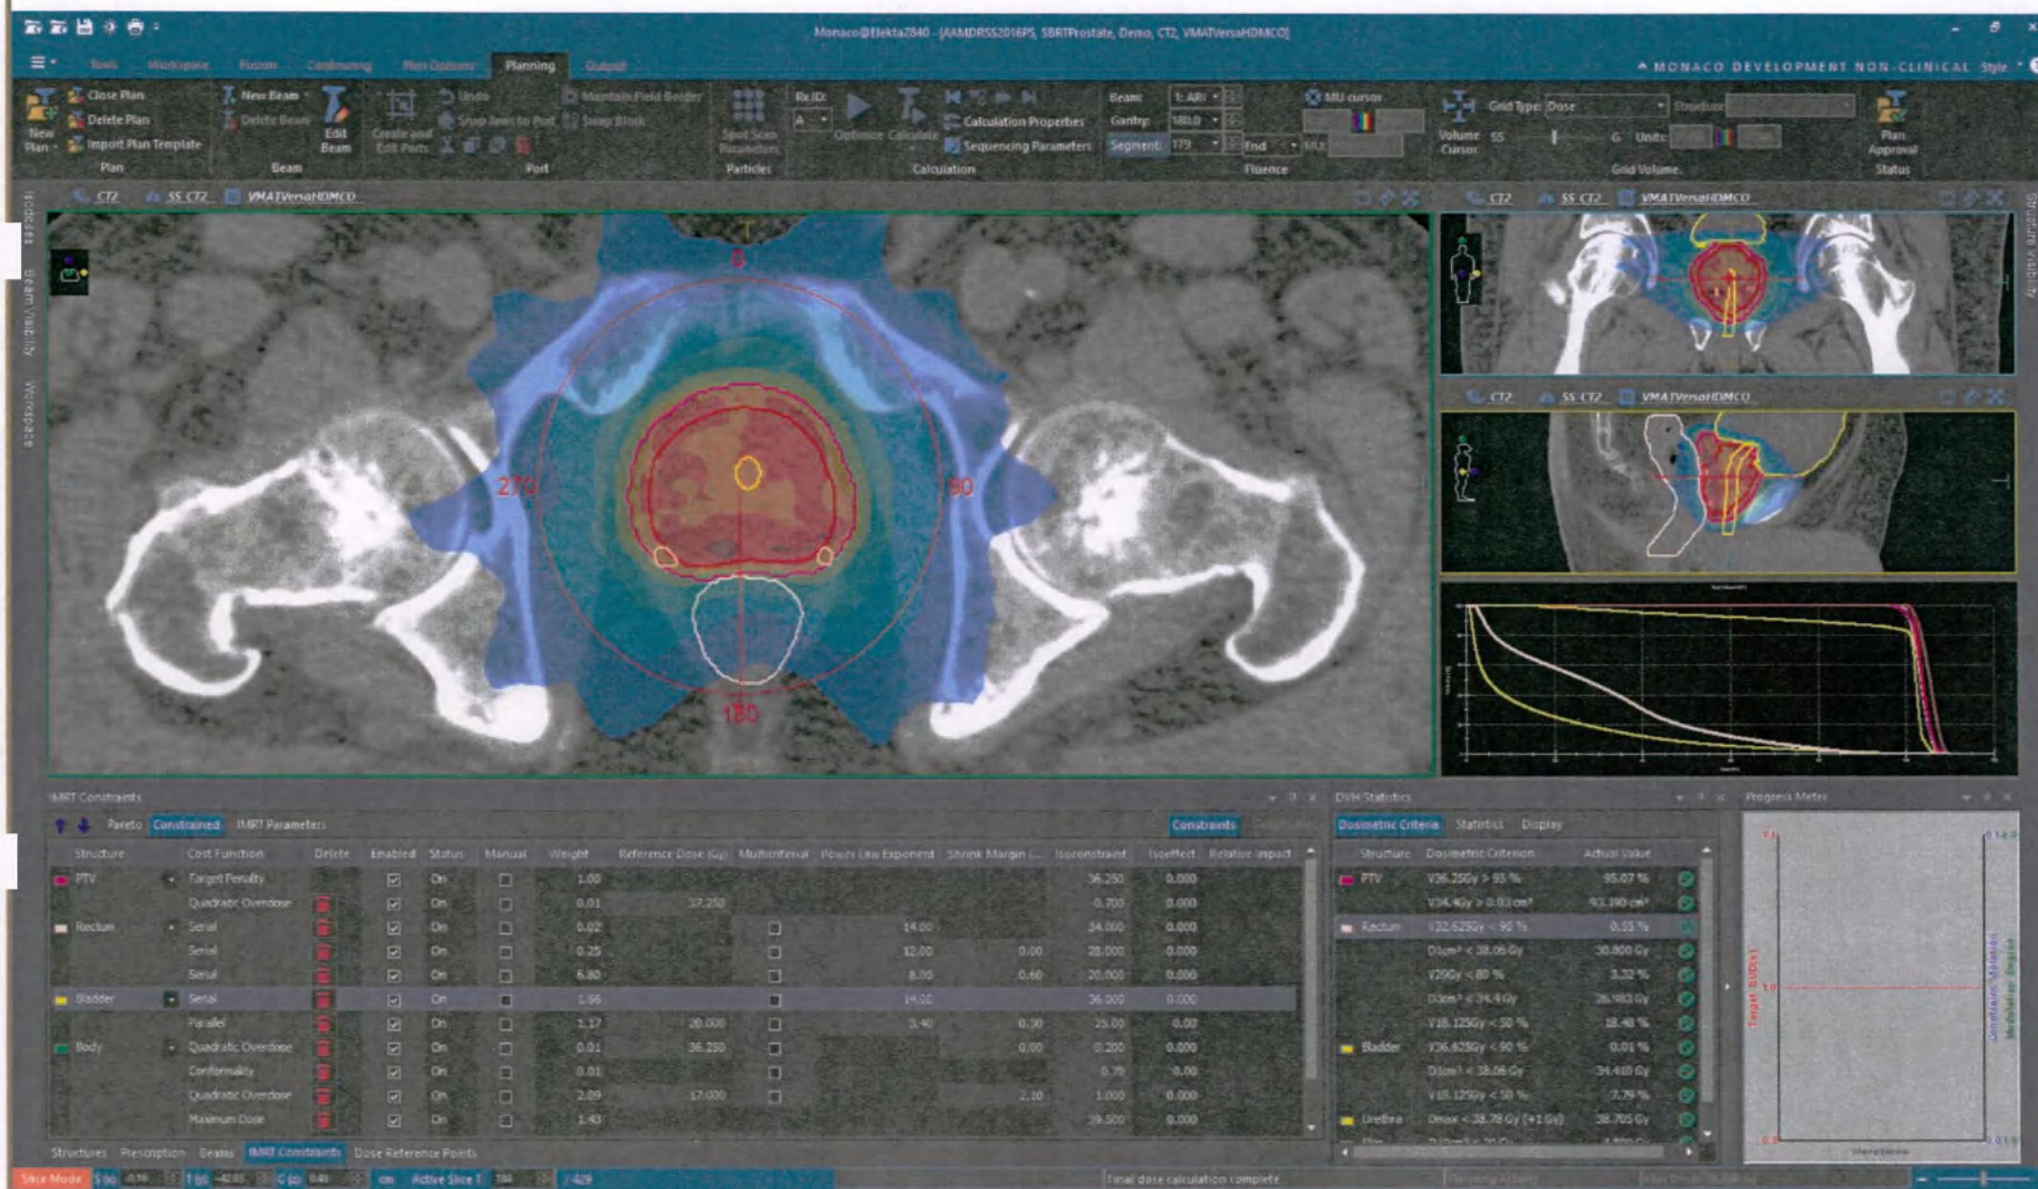

Программное обеспечение для расширения возможностей системы: ABAS.

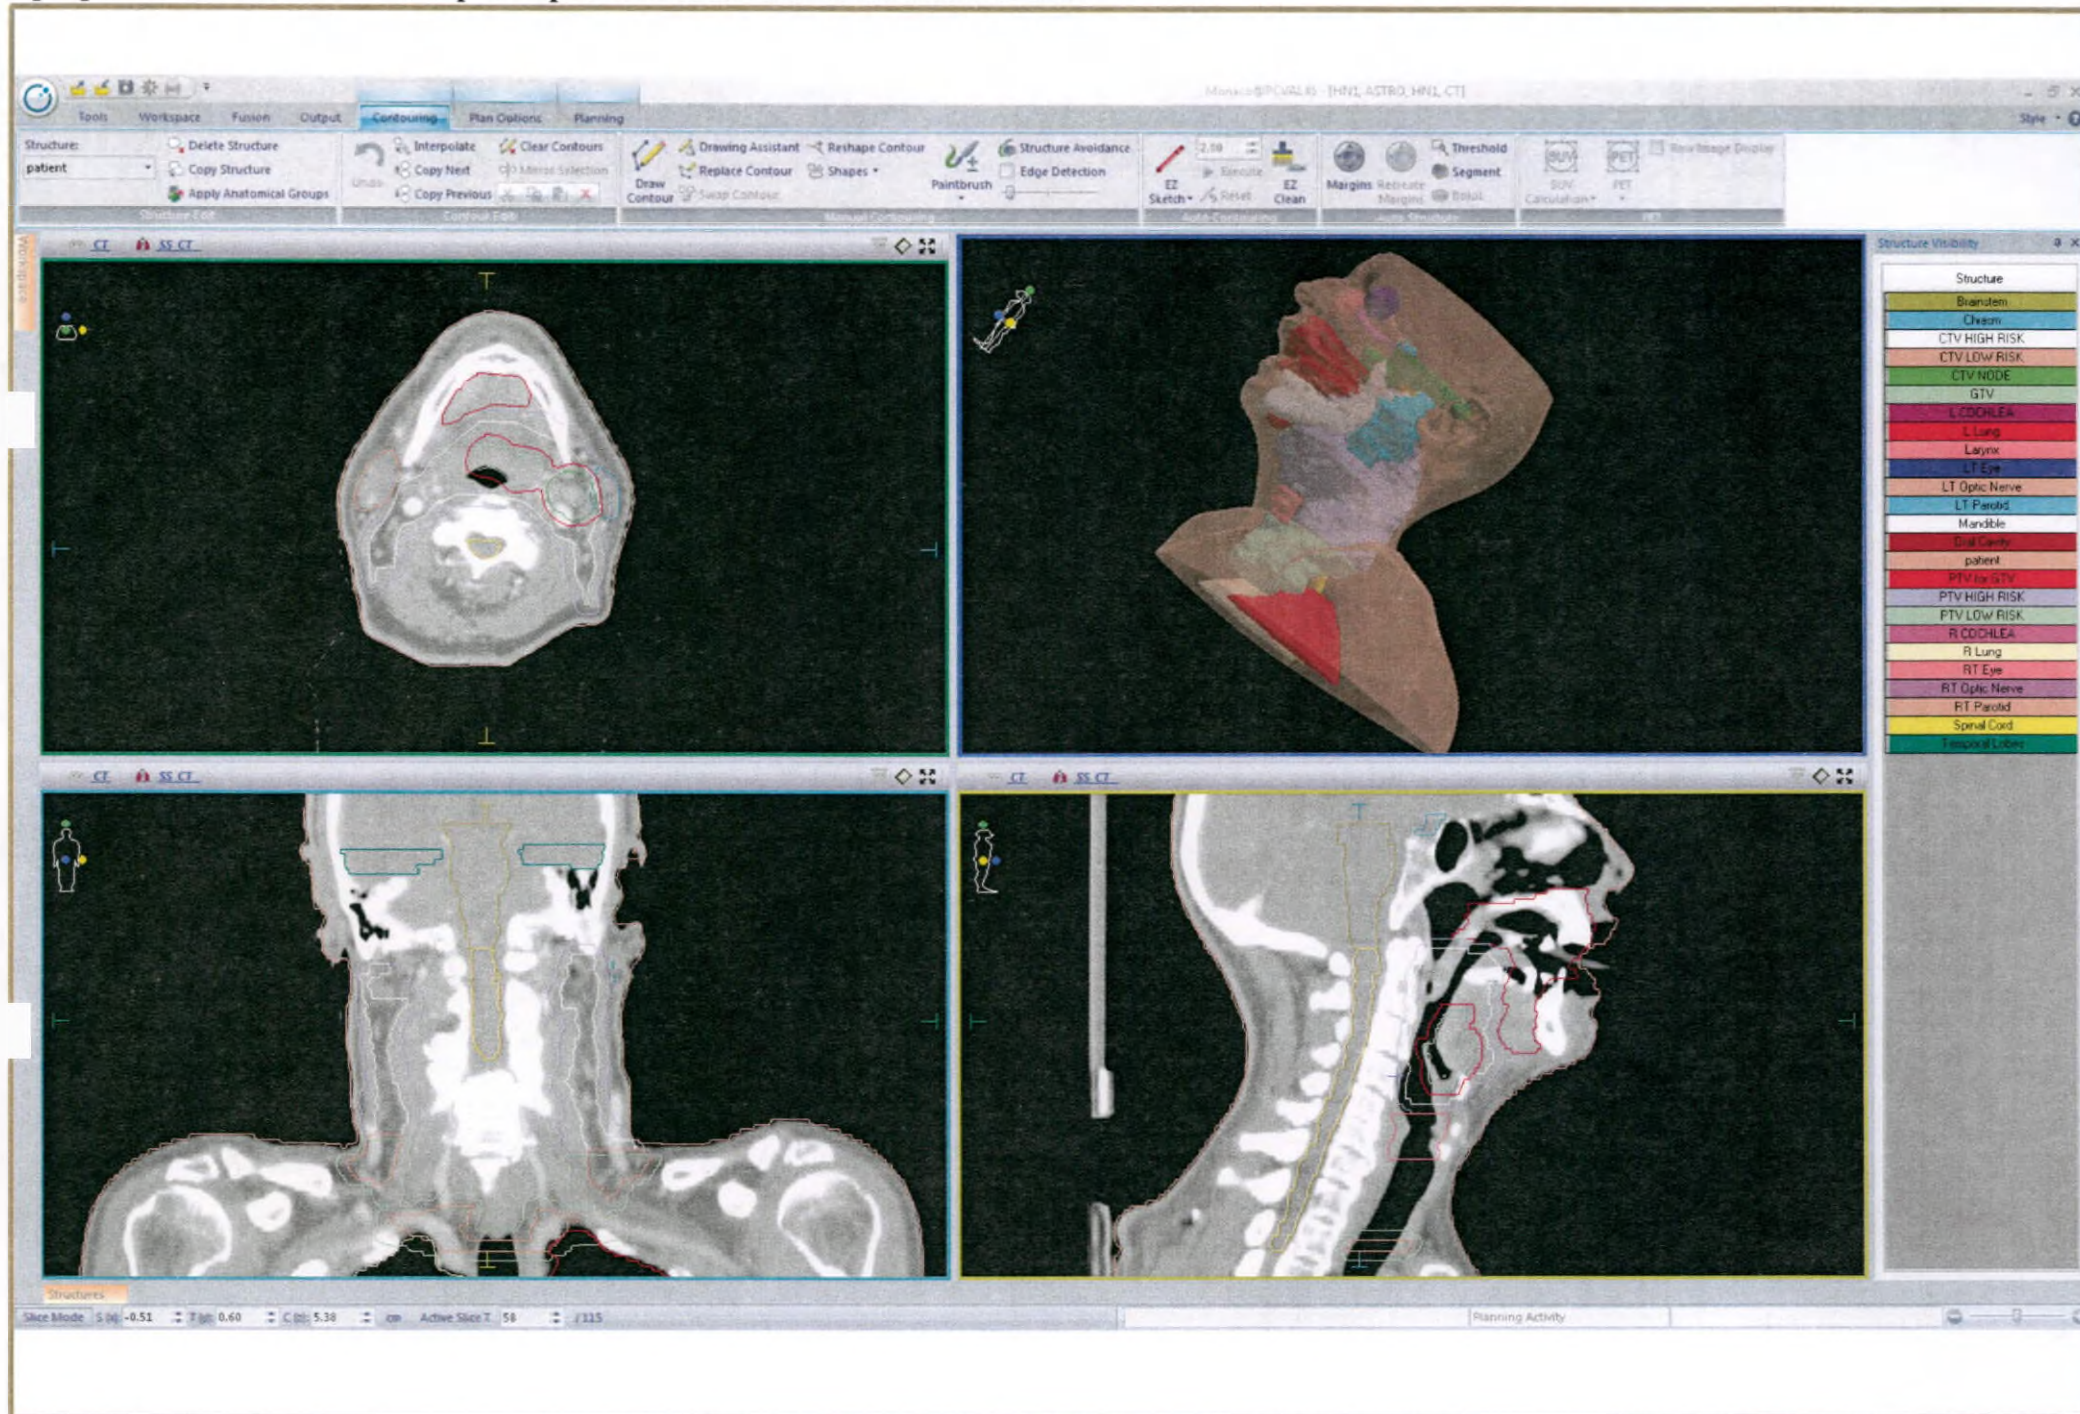


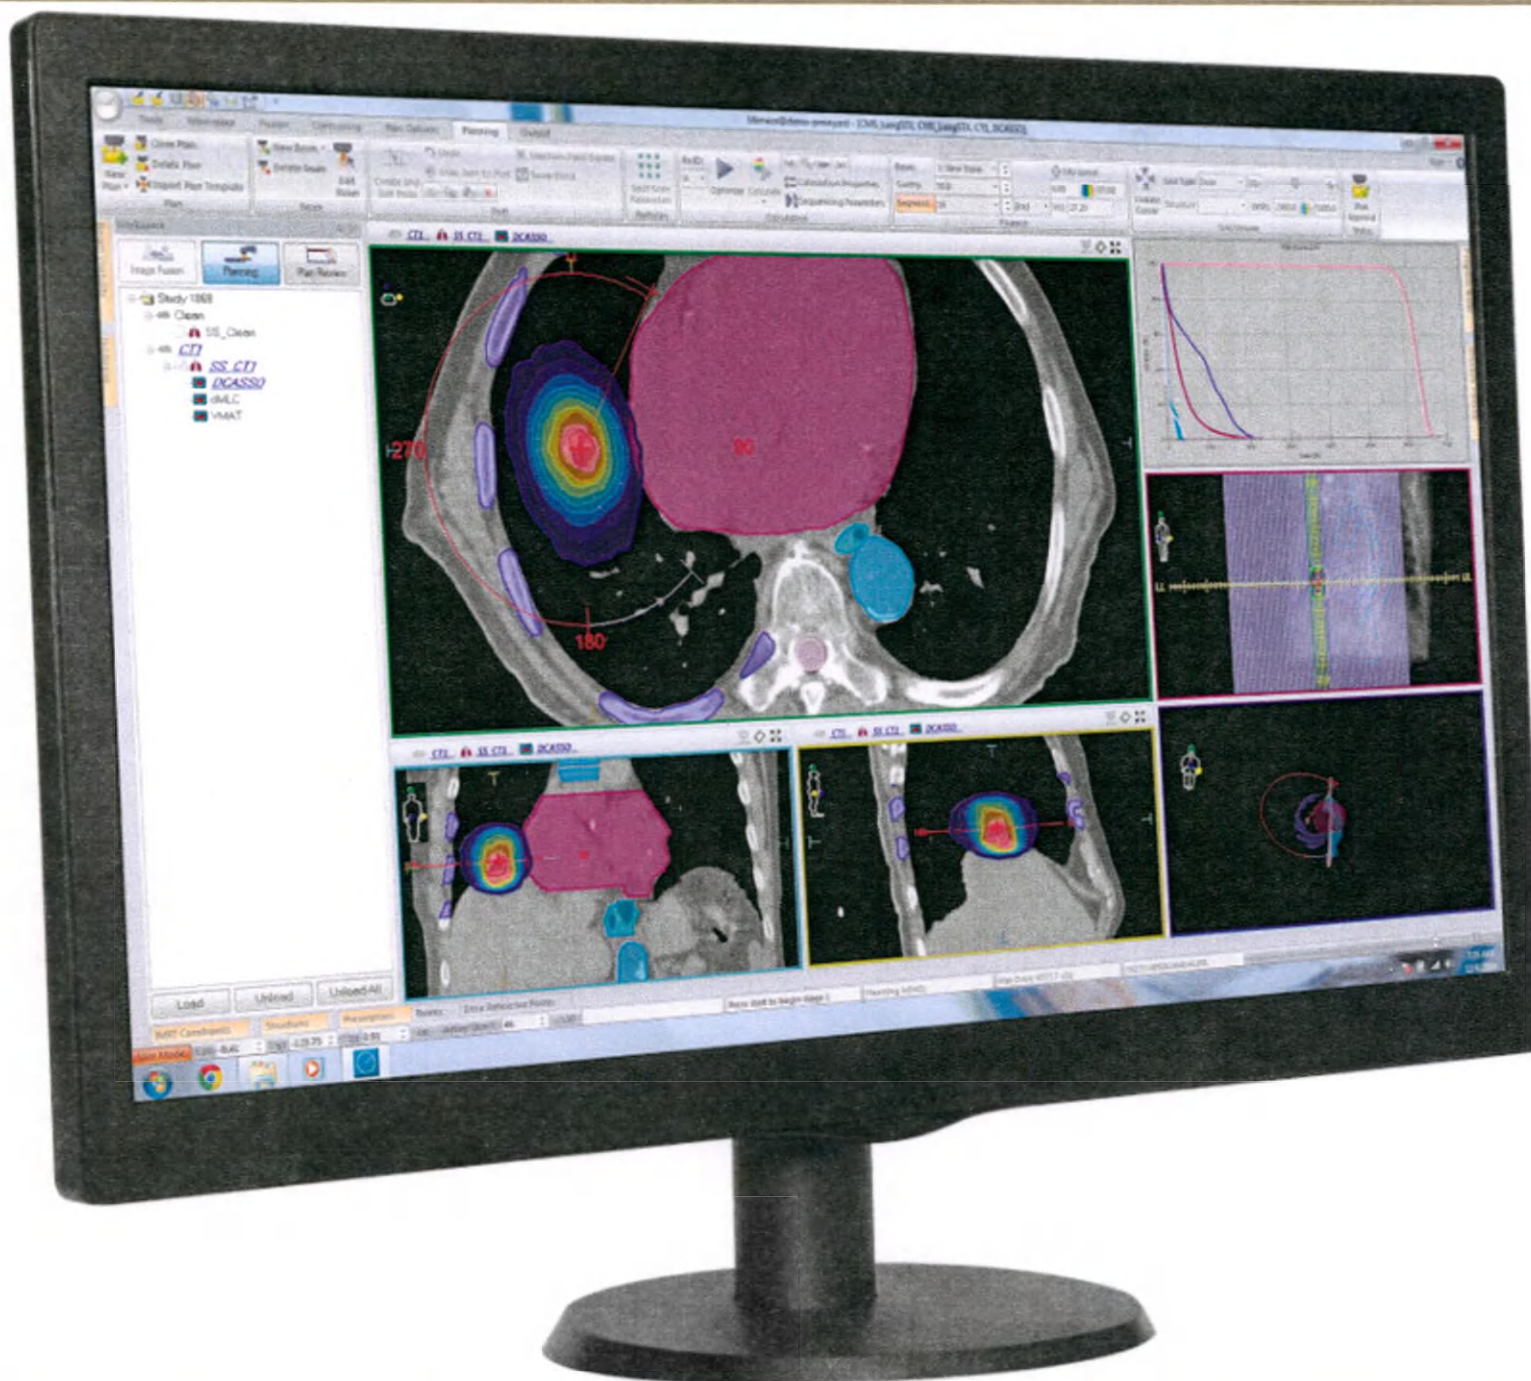


Программное обеспечение для расширения возможностей системы: Aqua.




Программное обеспечение для расширения возможностей системы EpiRay.

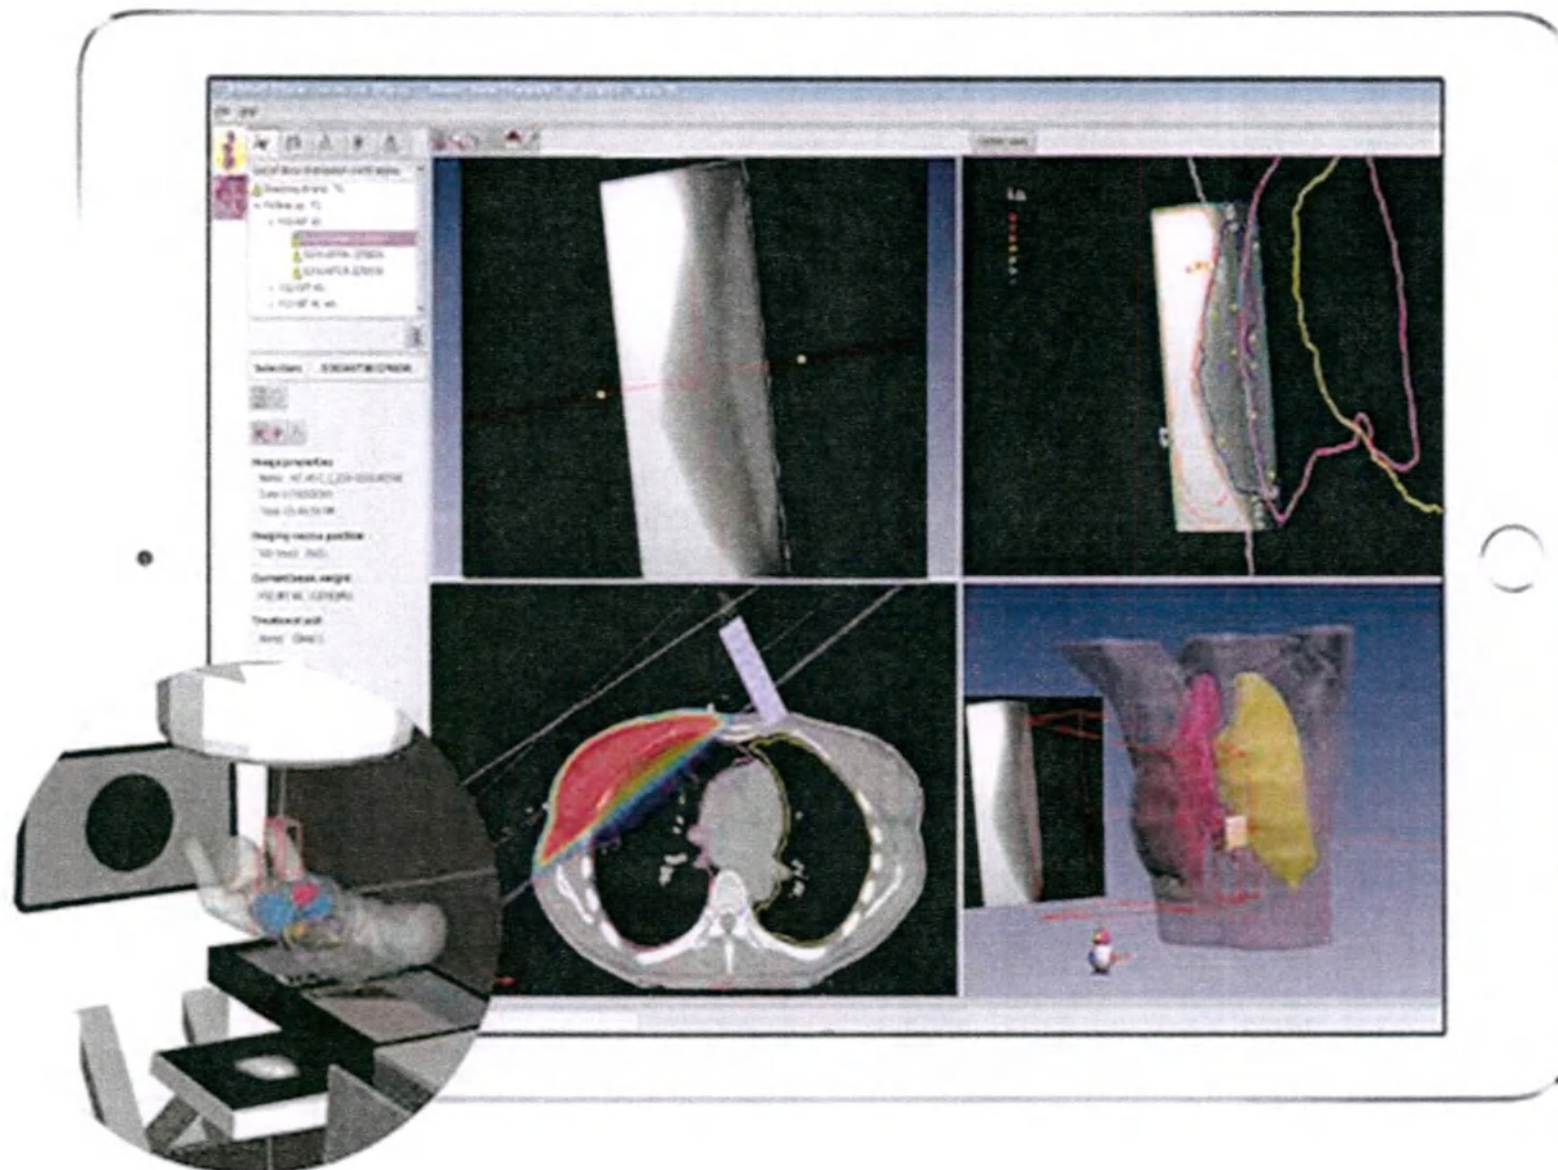


Программное обеспечение для расширения возможностей системы Epibeat.

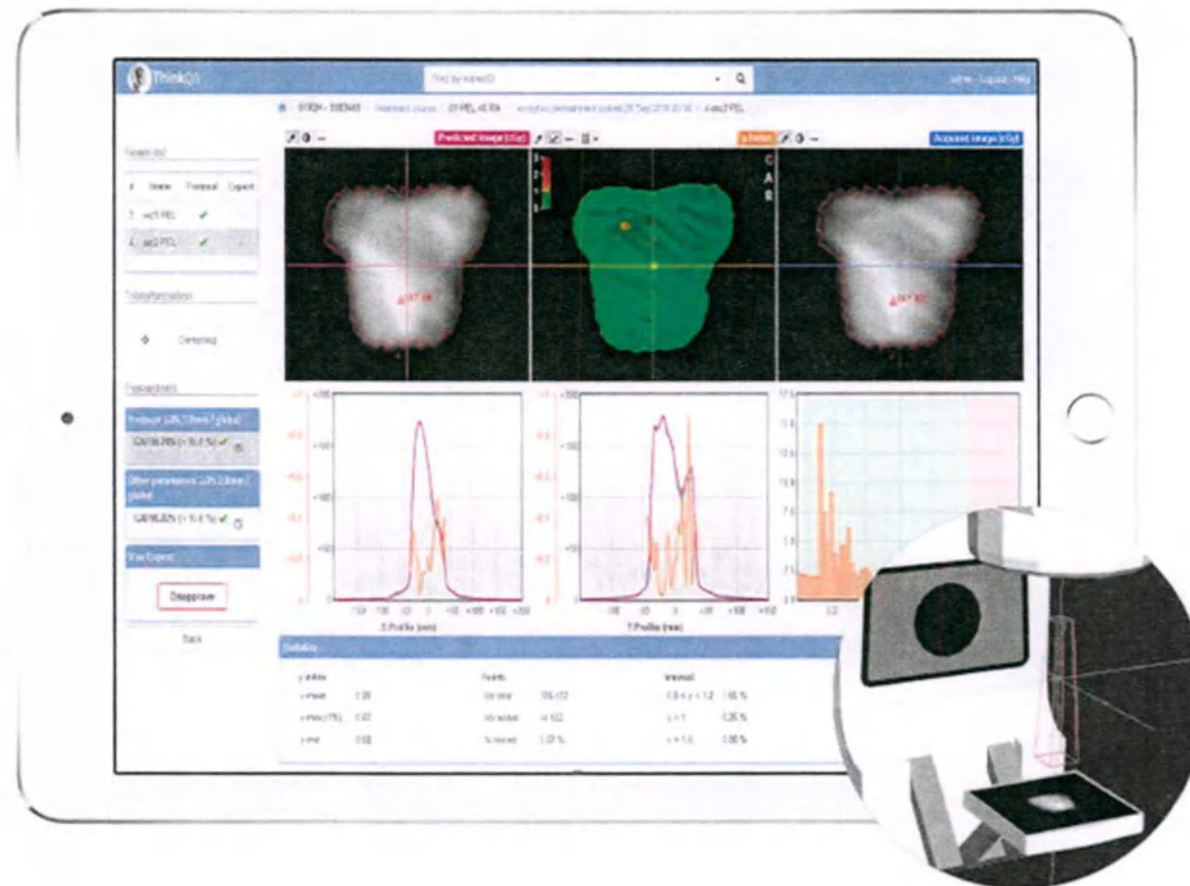



Программное обеспечение для расширения возможностей системы MU2net.

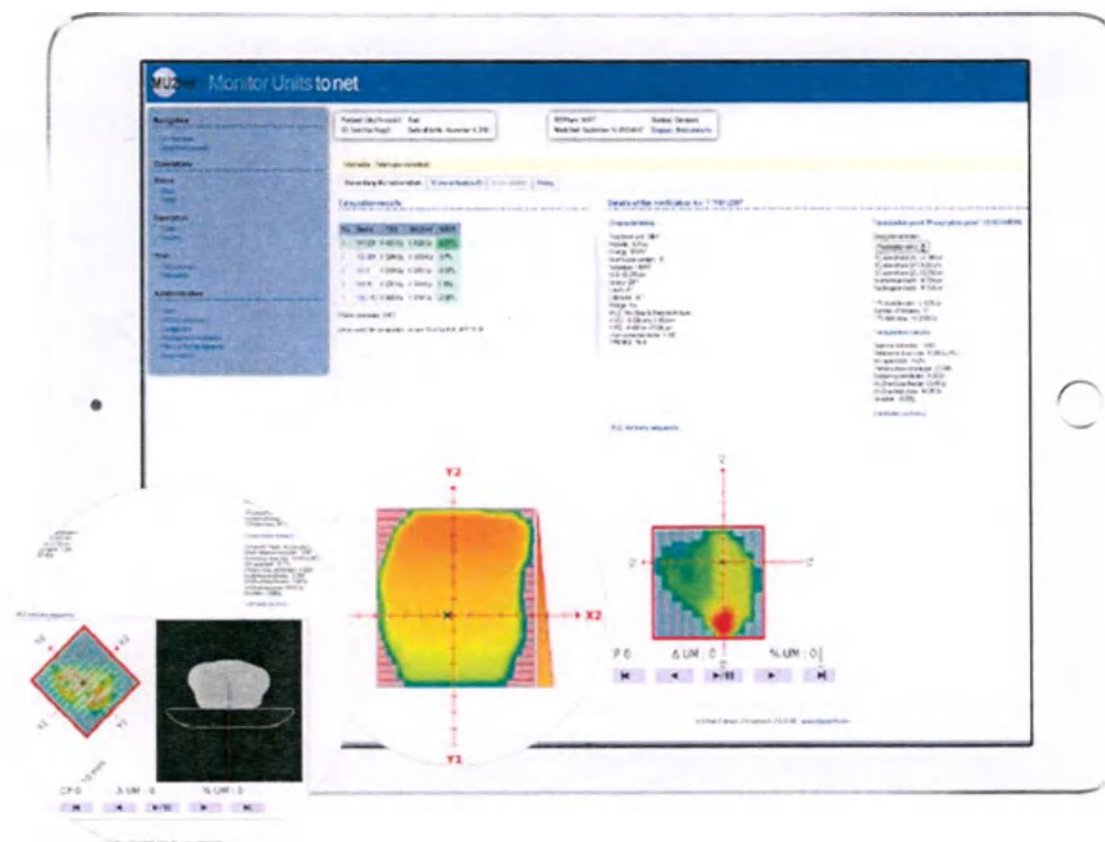

Рабочие станции медицинского ускорительного комплекса: Мопасо.

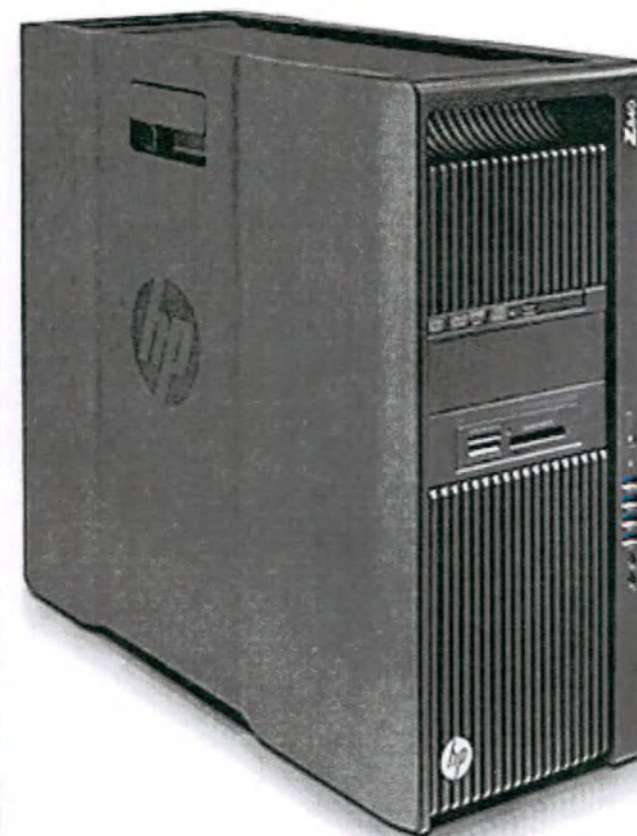

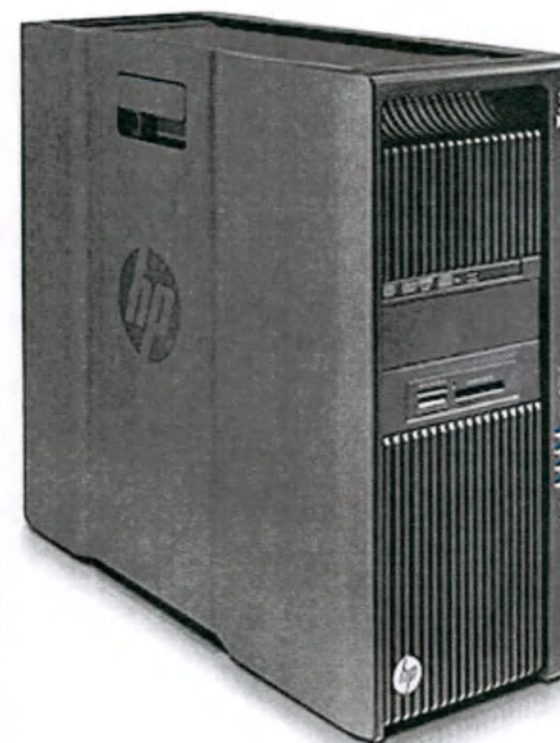

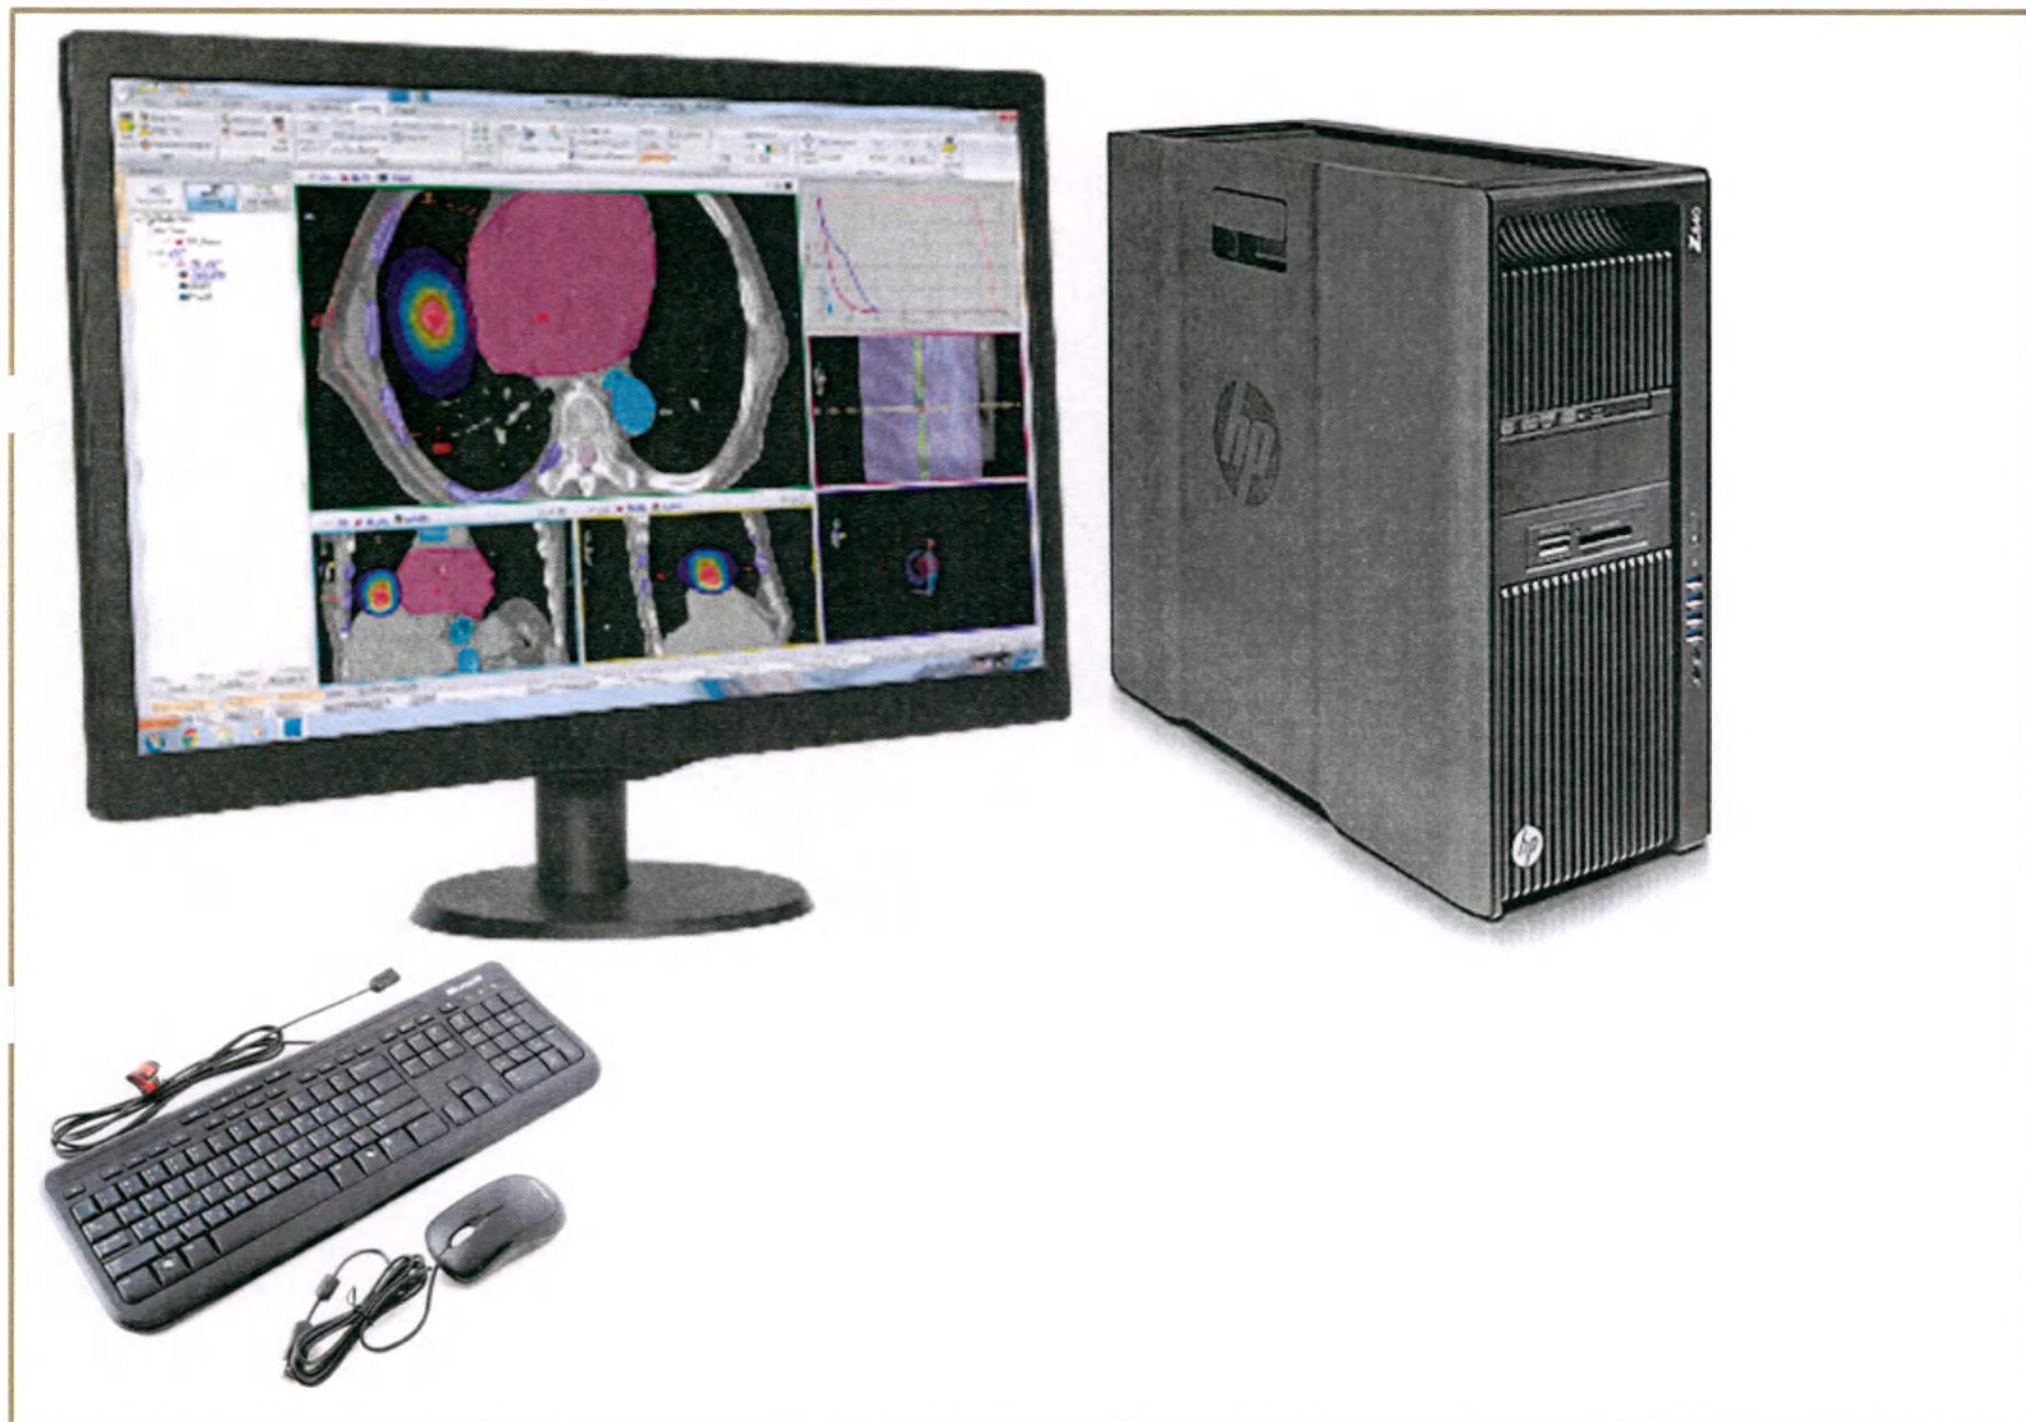






Калибровочные фантомы: Delta4.




Калибровочные фантомы: для процедур обеспечения качества XVI.

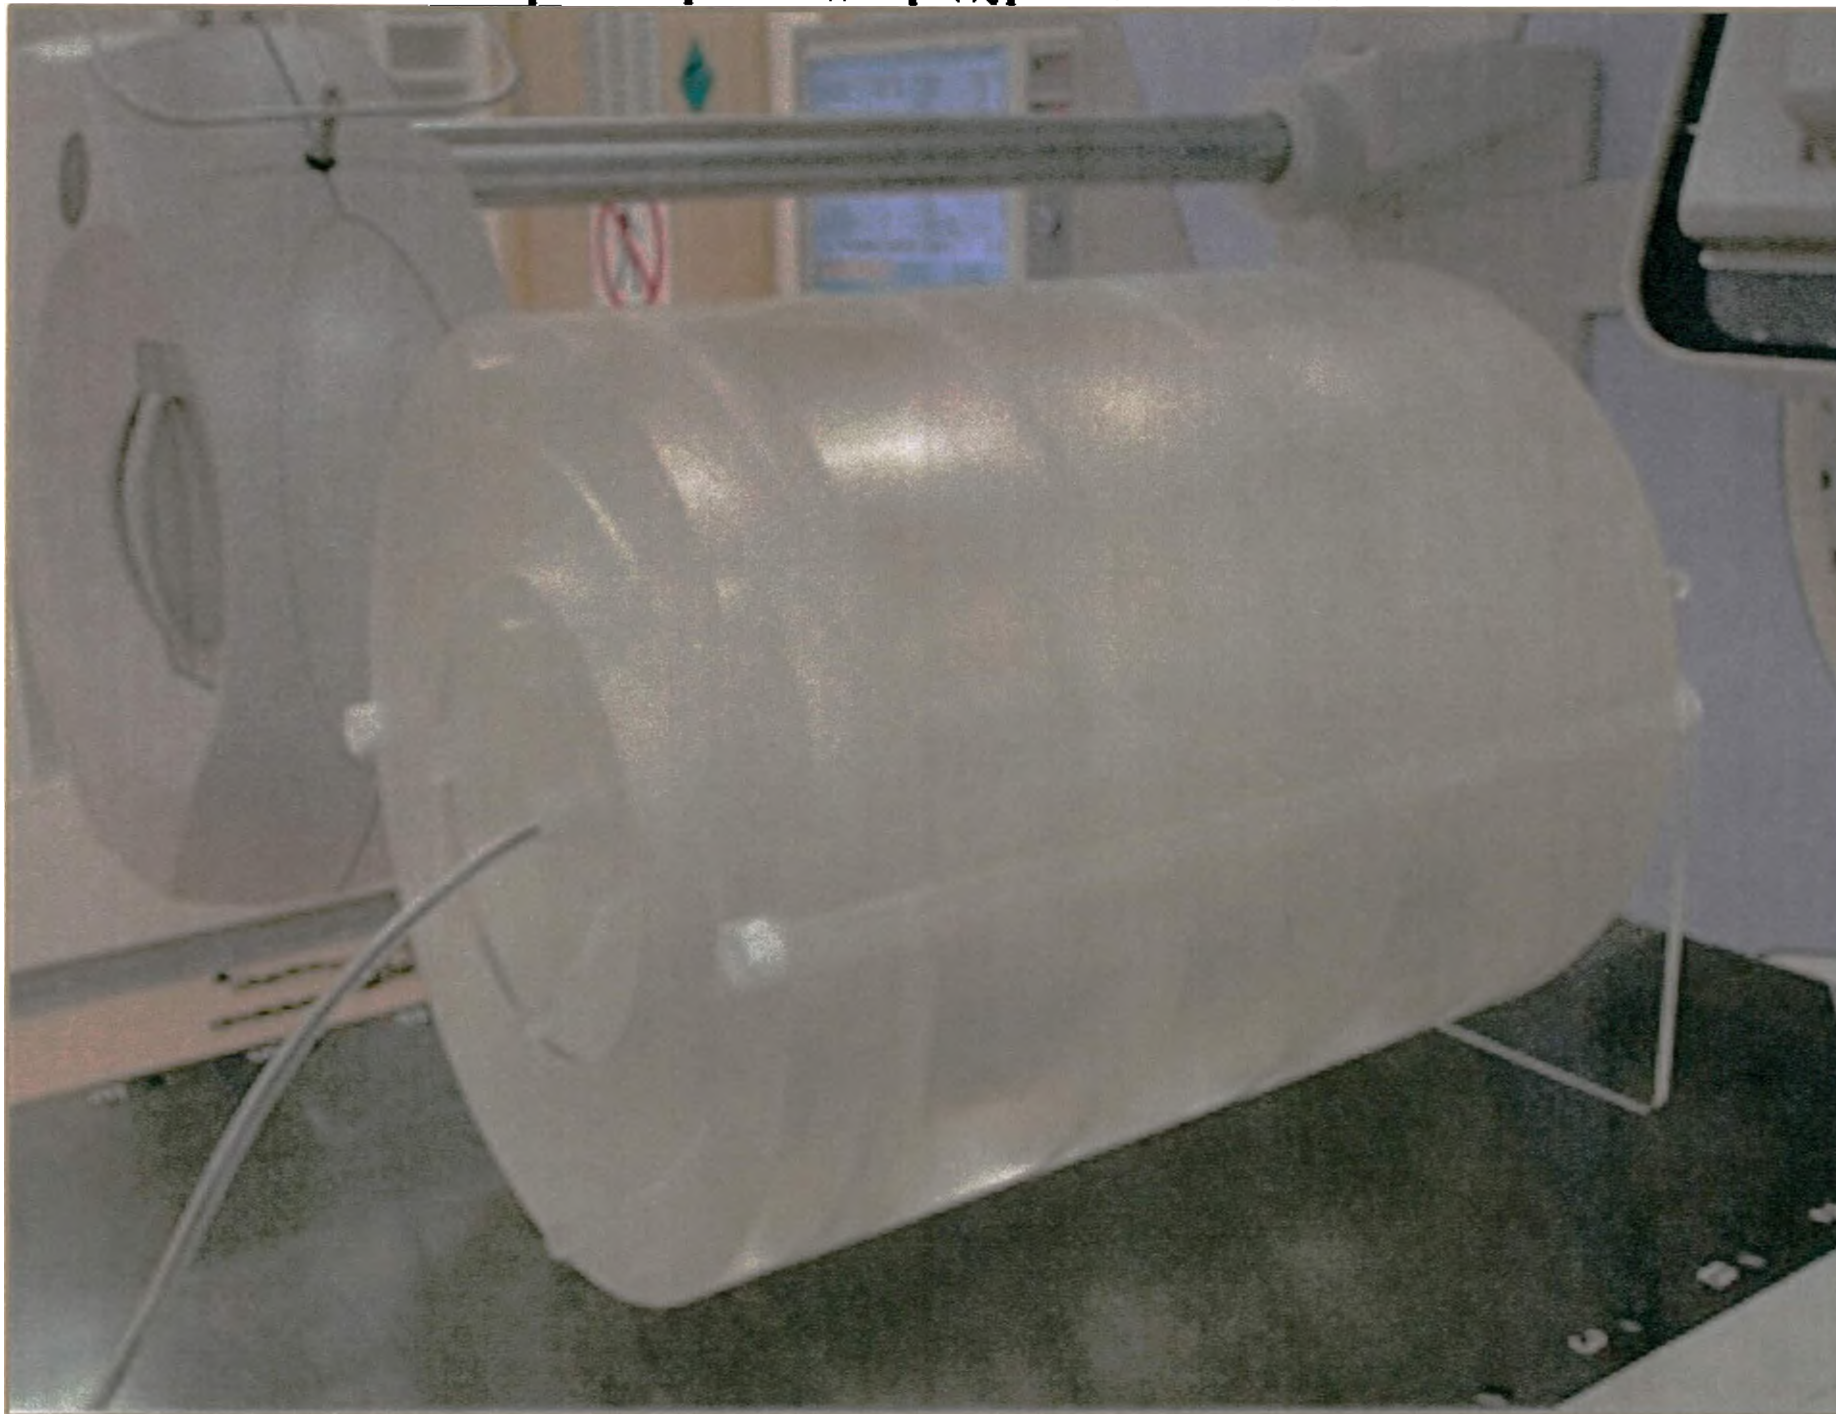


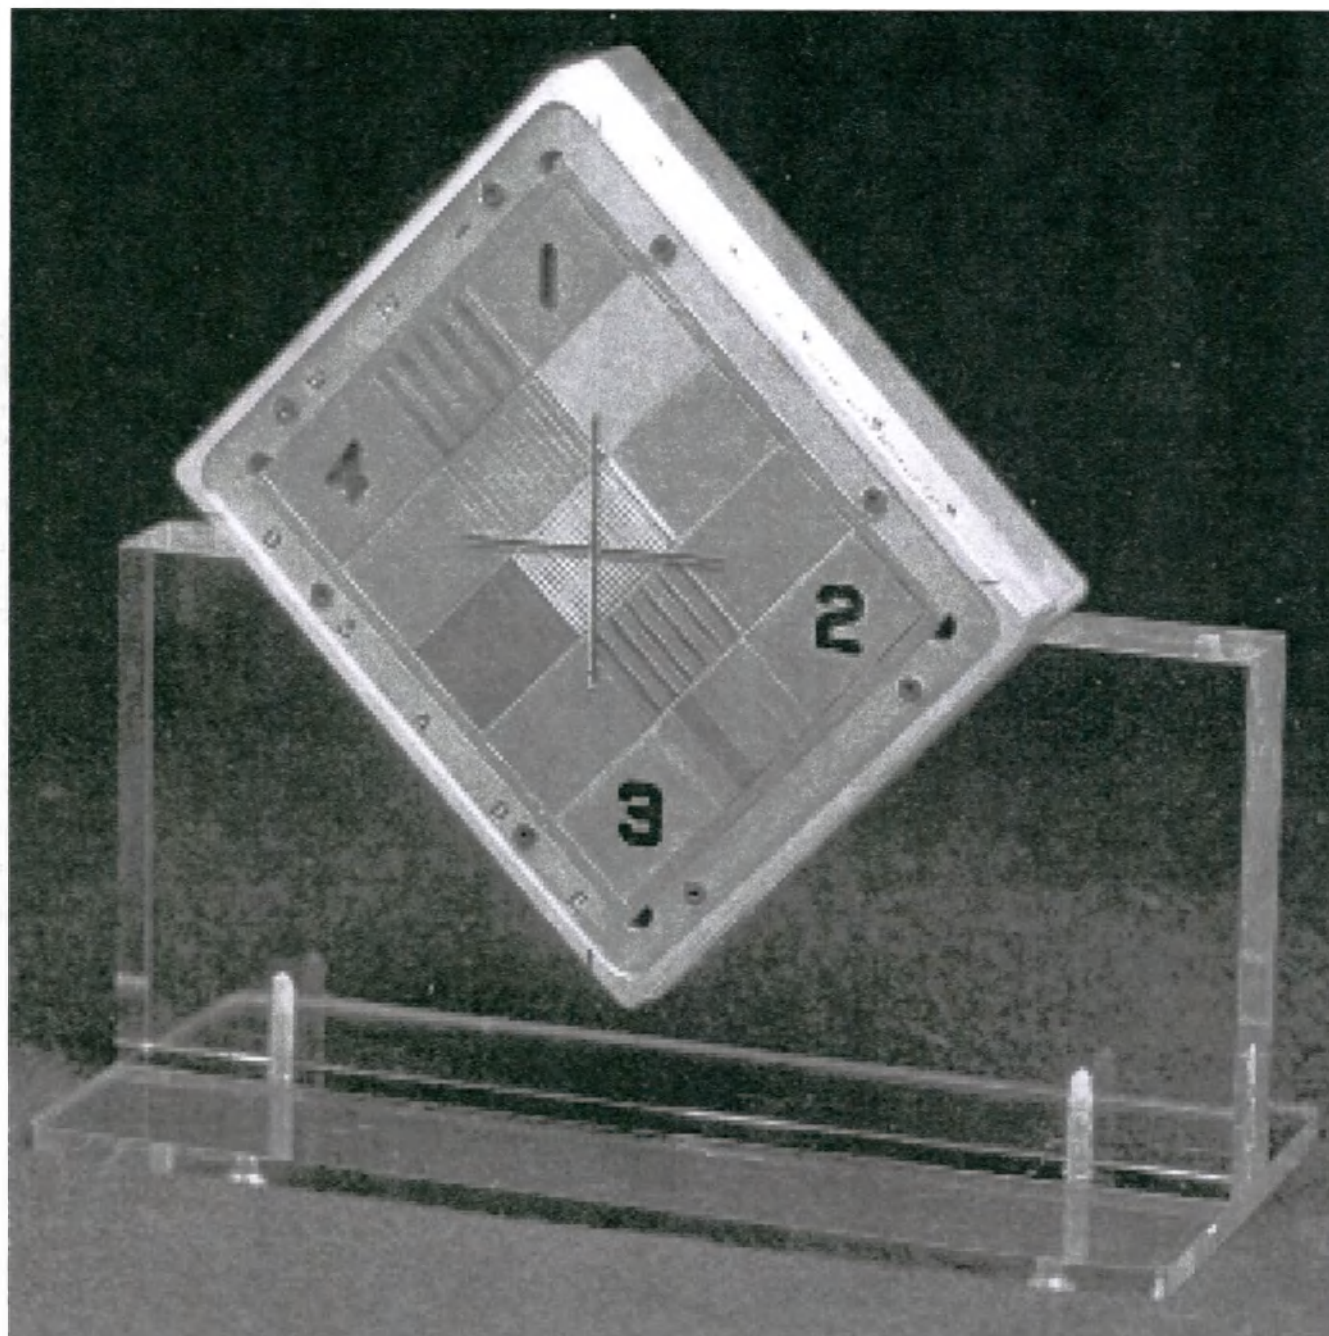

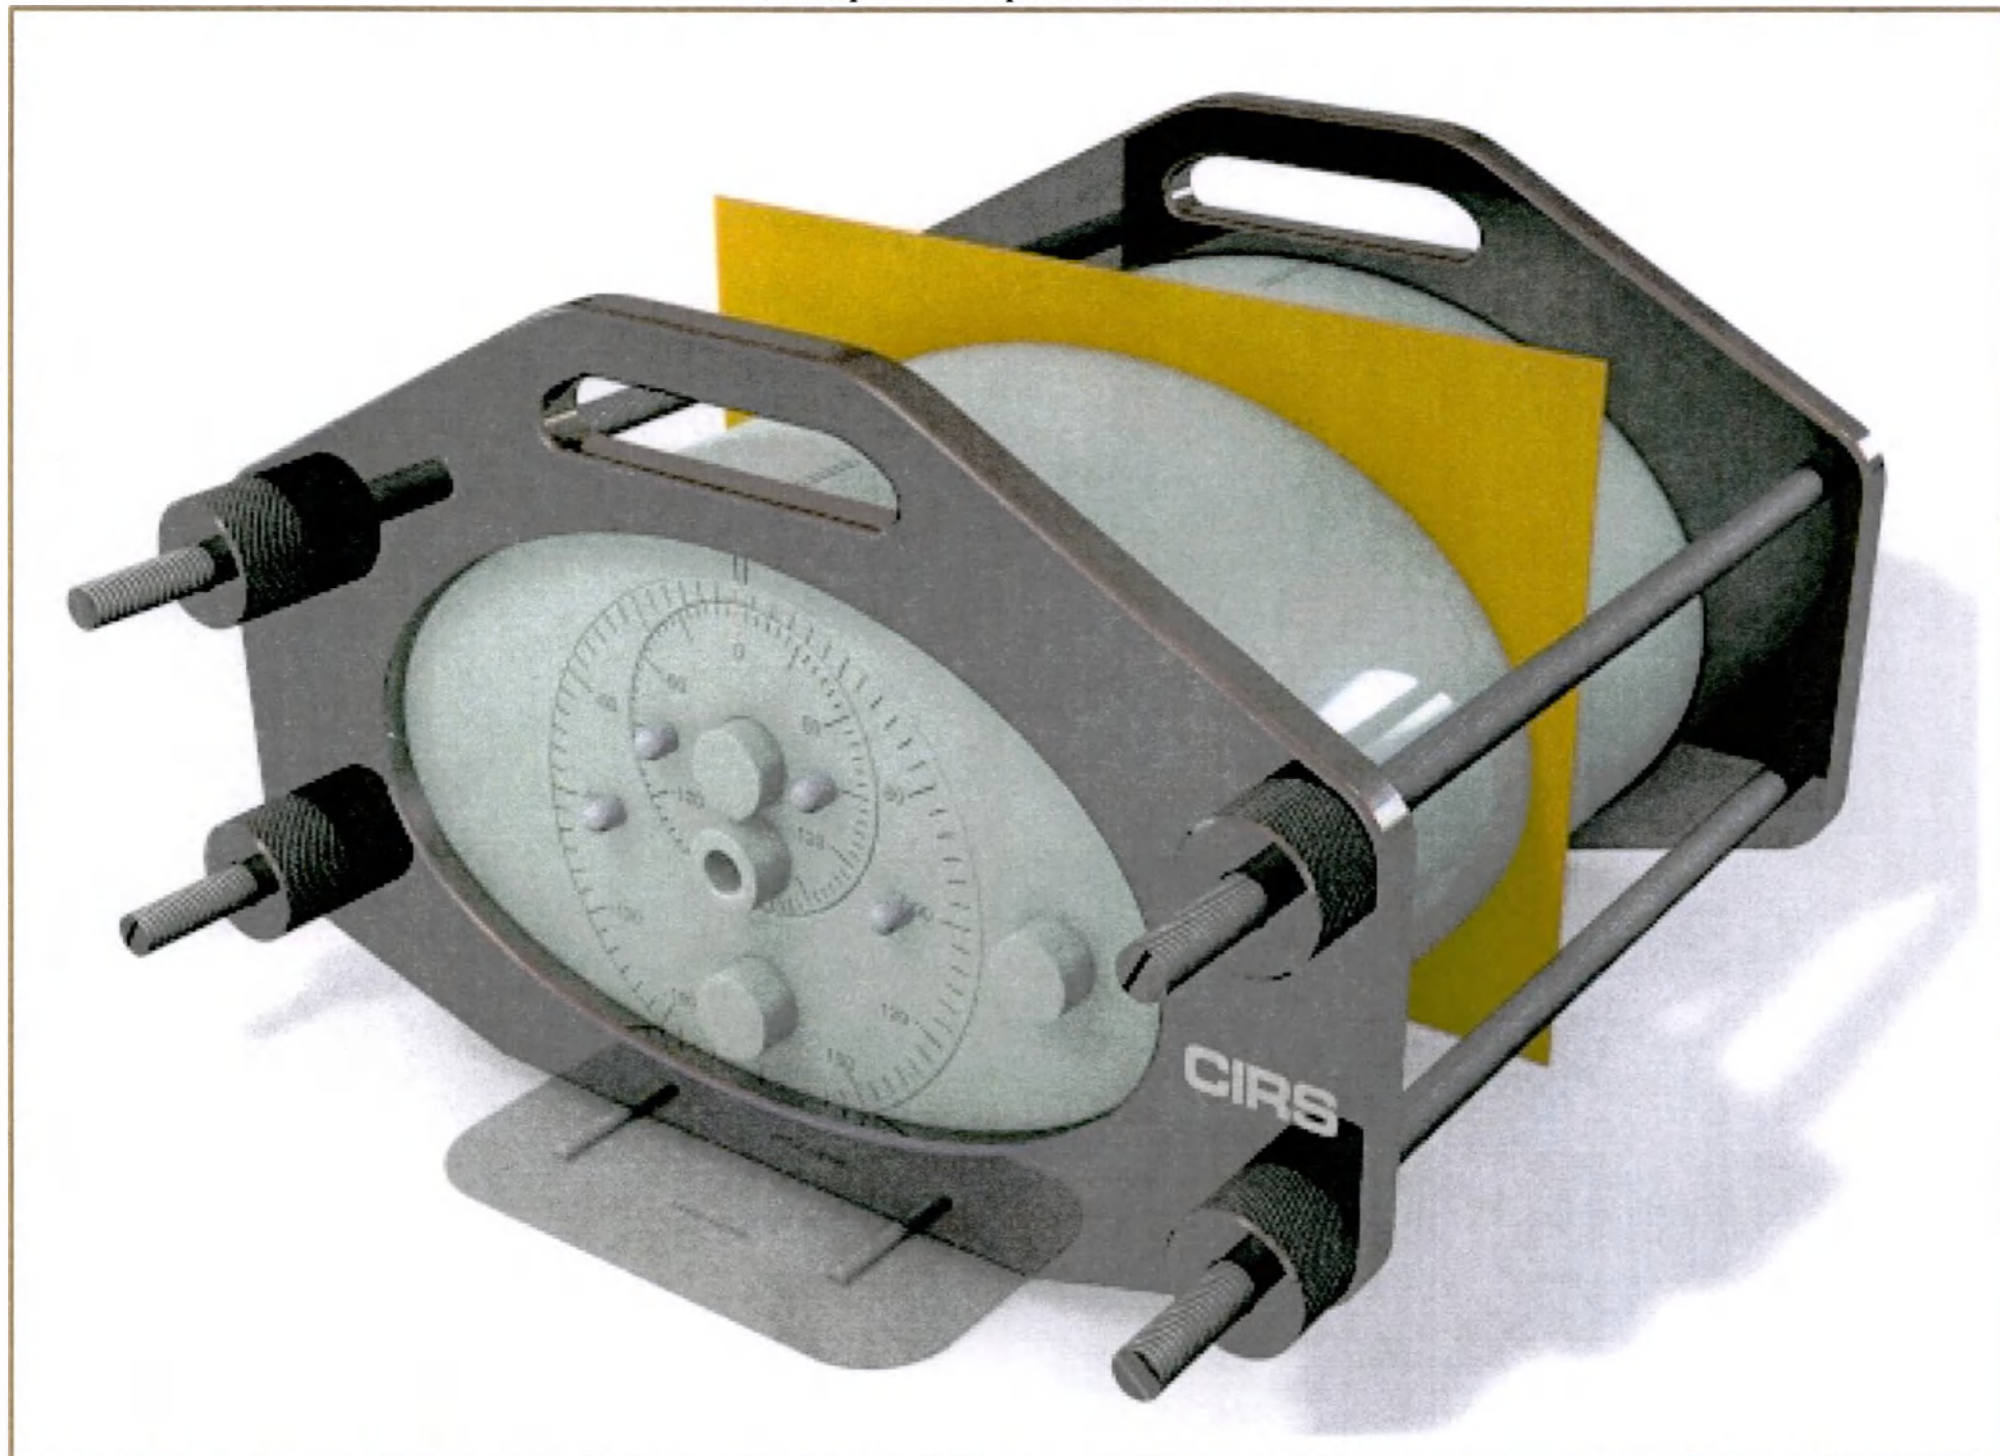


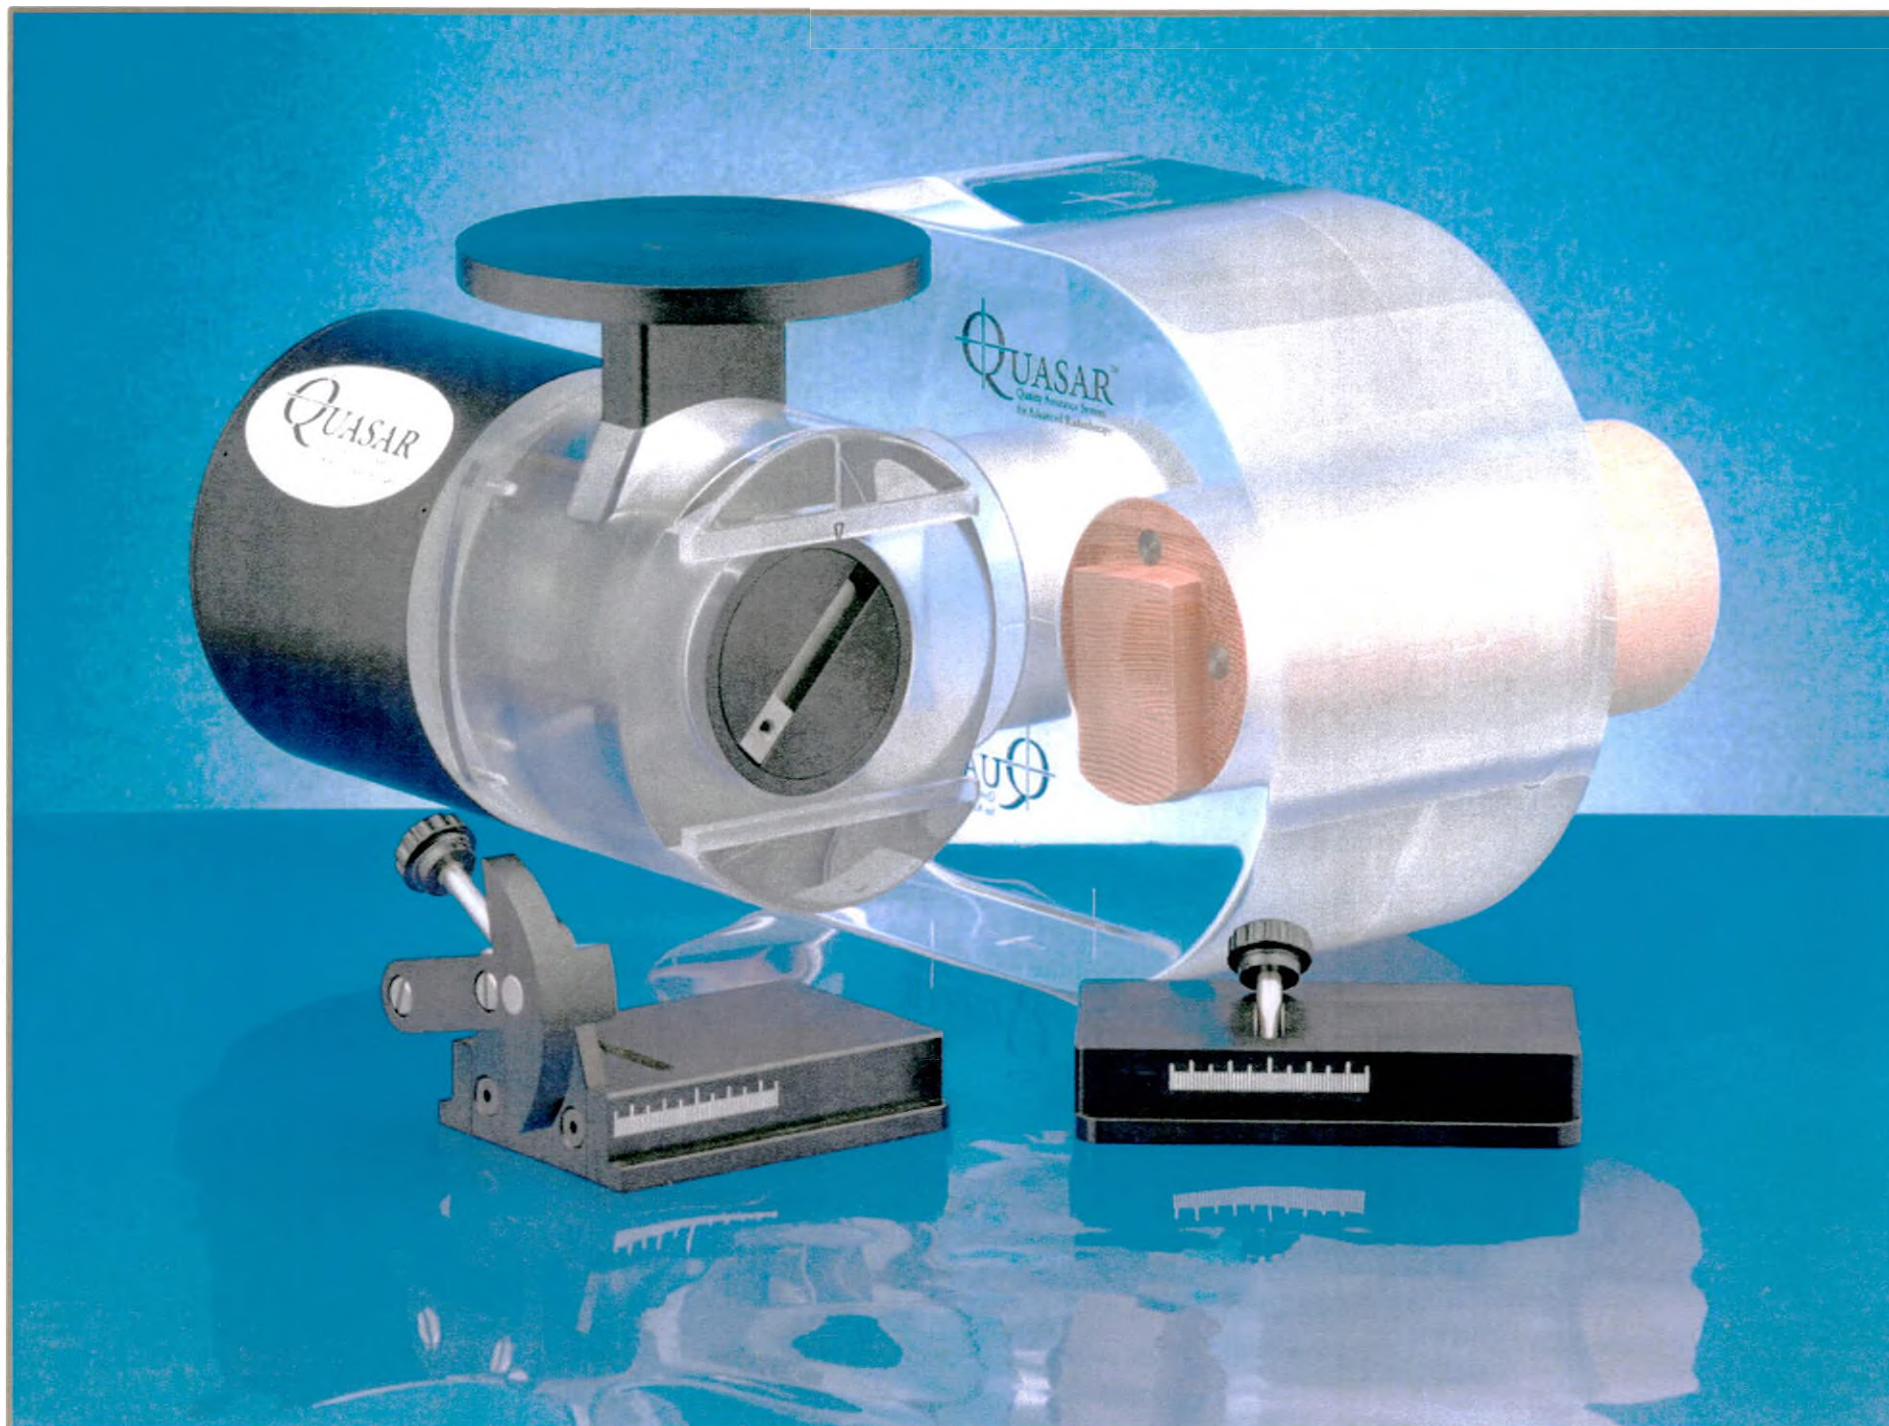


Калибровочные фантомы: Contrast.

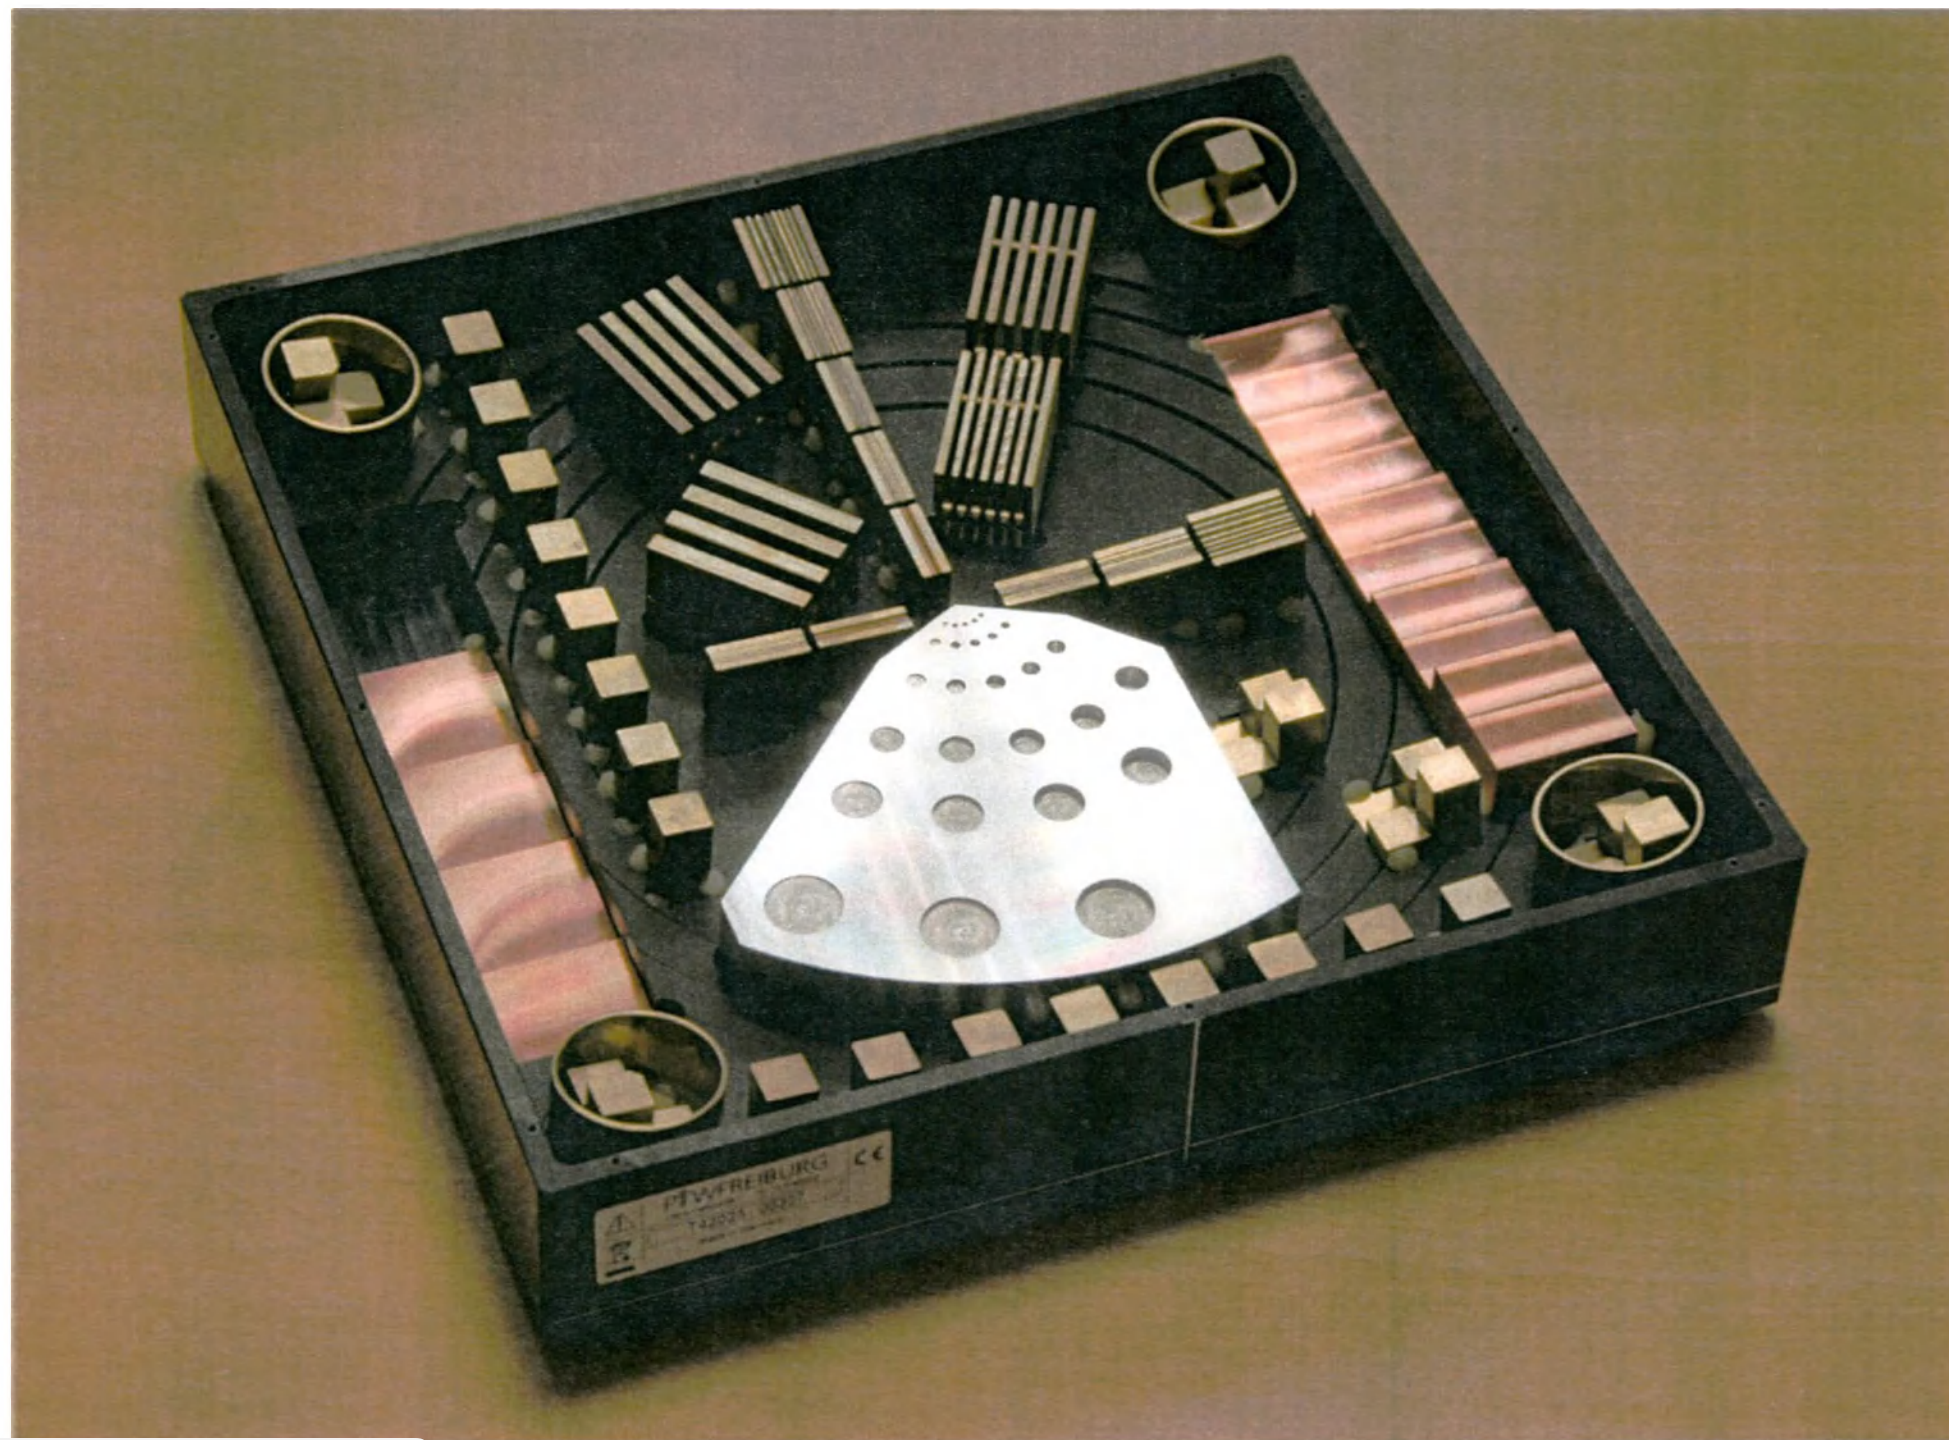

Калибровочные фантомы: XVI Whater Calibration

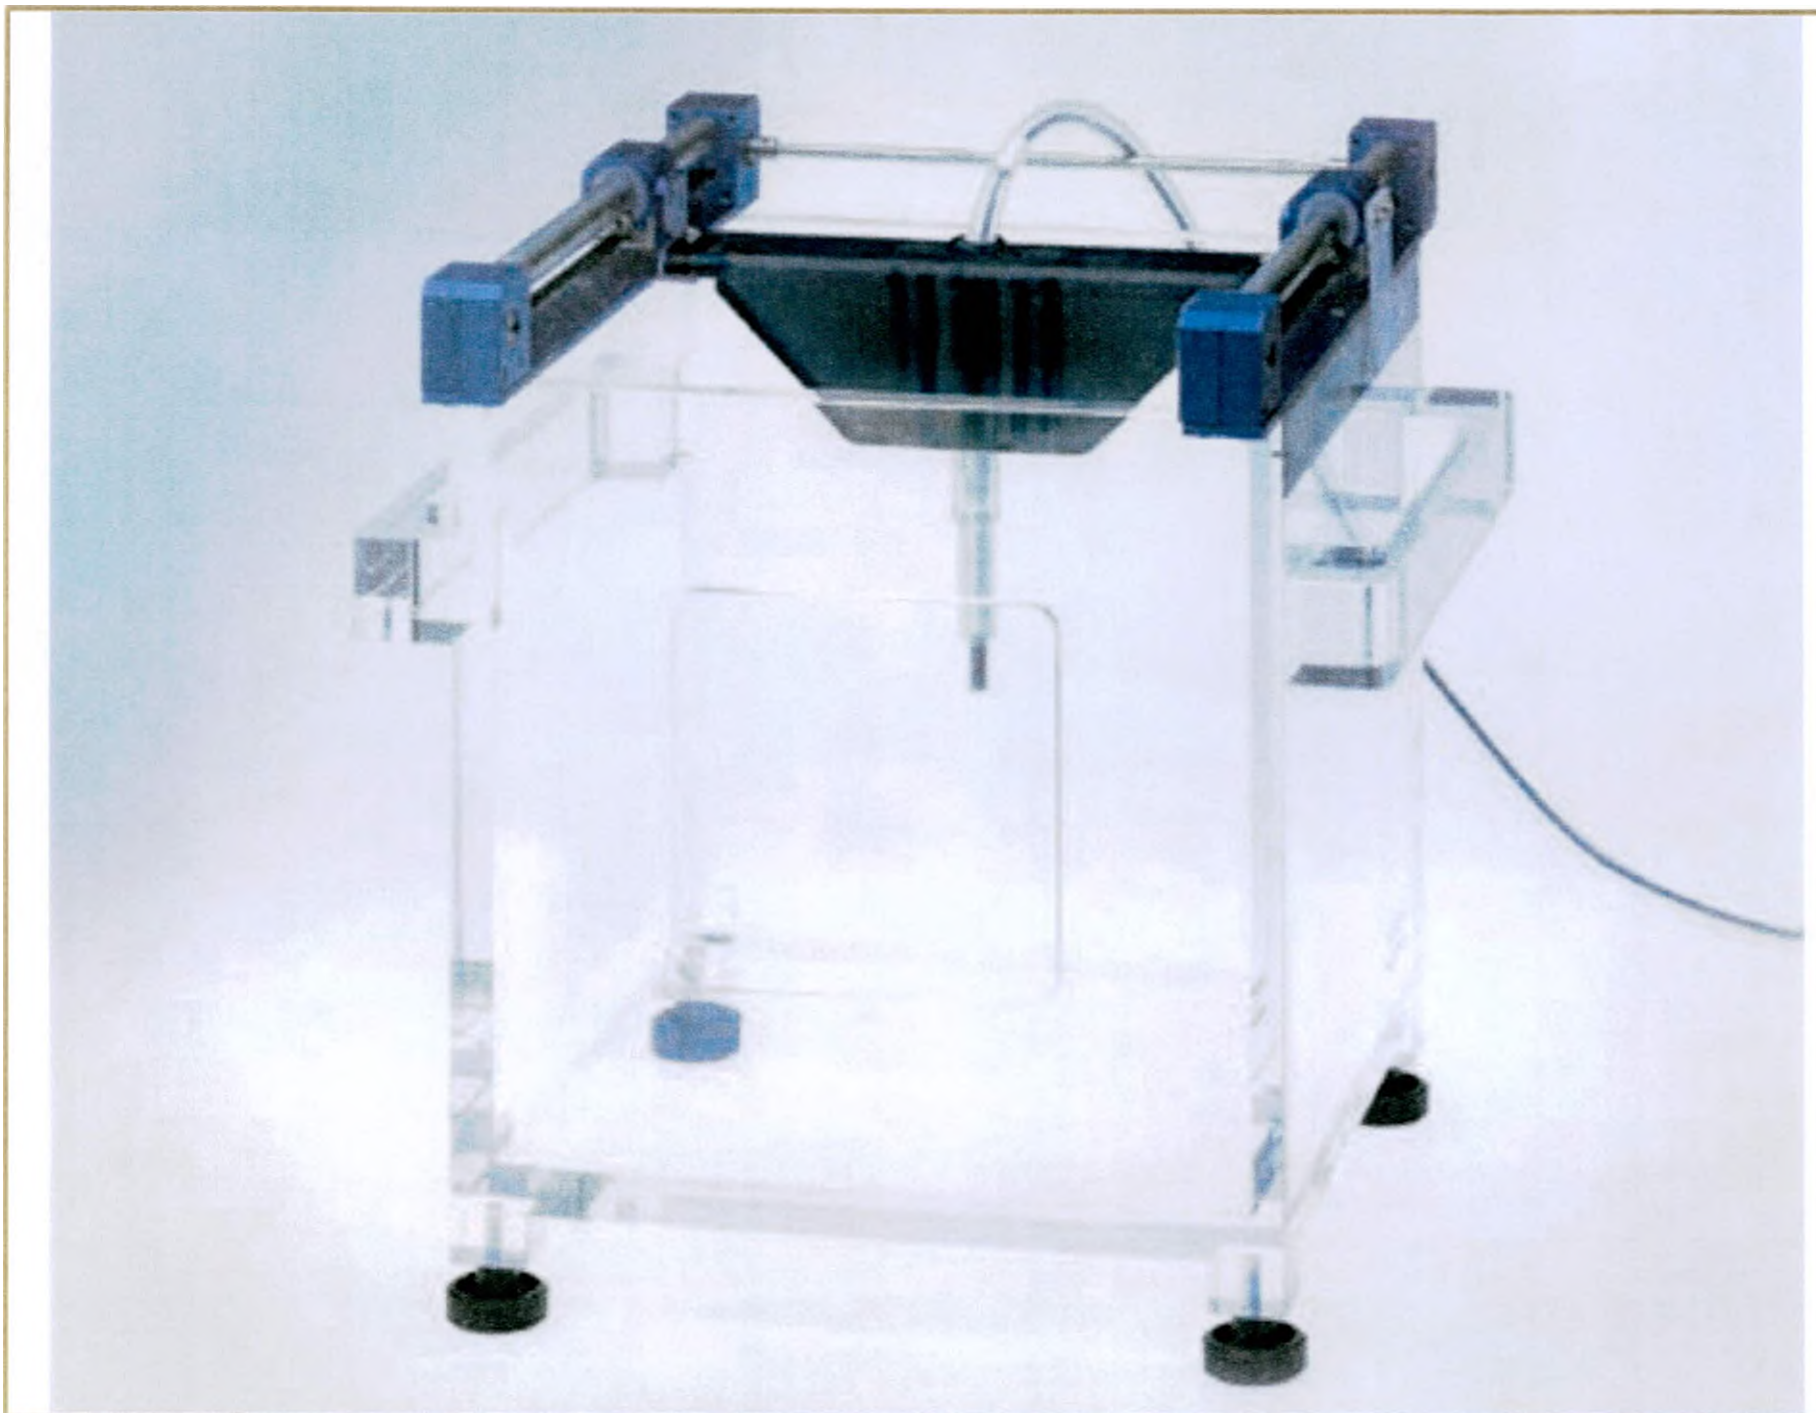


Калибровочные фантомы Flextar

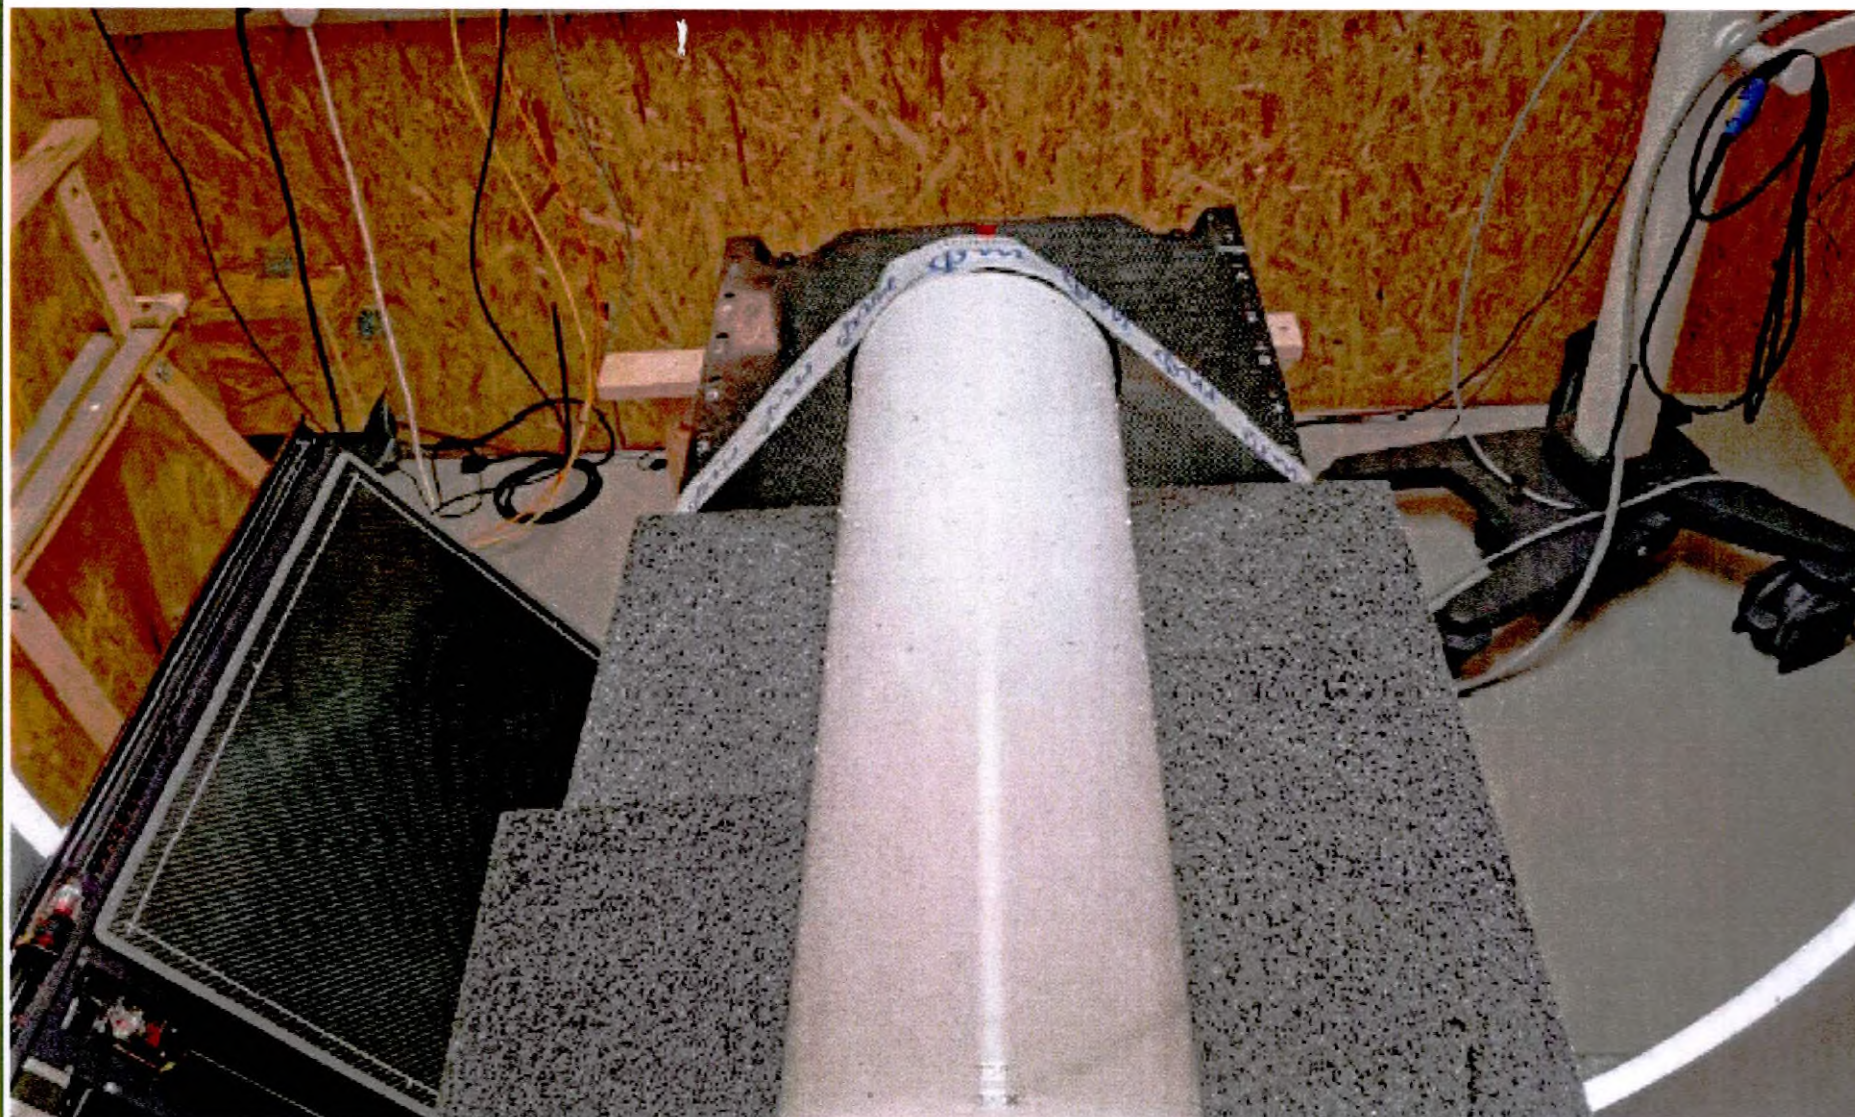


Источник бесперебойного питания




Панели удлинительные iBEAM evo Extension

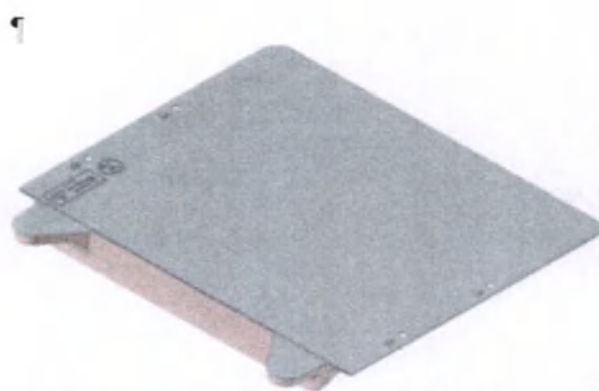


Панель удлинительная iBEAM evo Extension 415

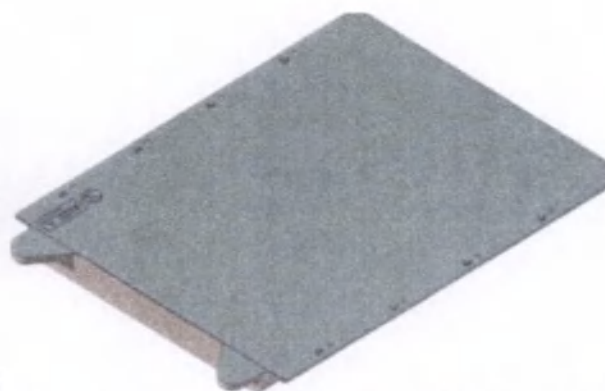

Панель удлинительная iBEAM evo Extension 650

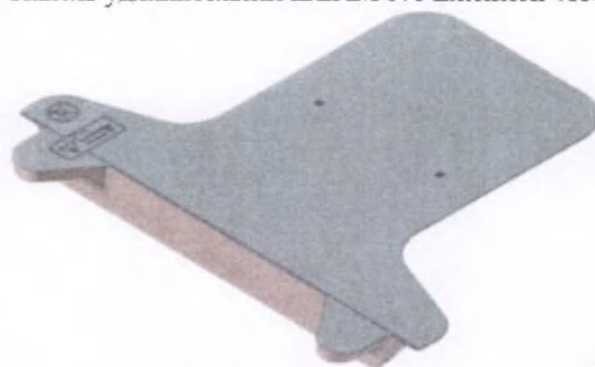


Панель удлинительная iBEAM evo Extension H&N

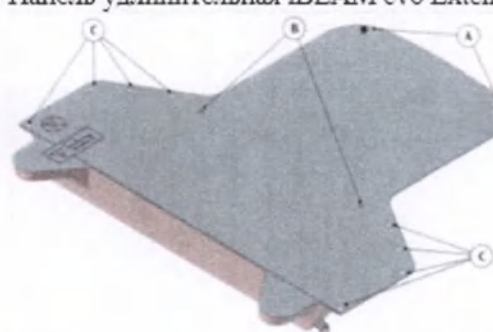



Панель удлинительная iBEAM evo Frameless Extension

Панели для КТ накладные iBEAM evo CT Overlay.

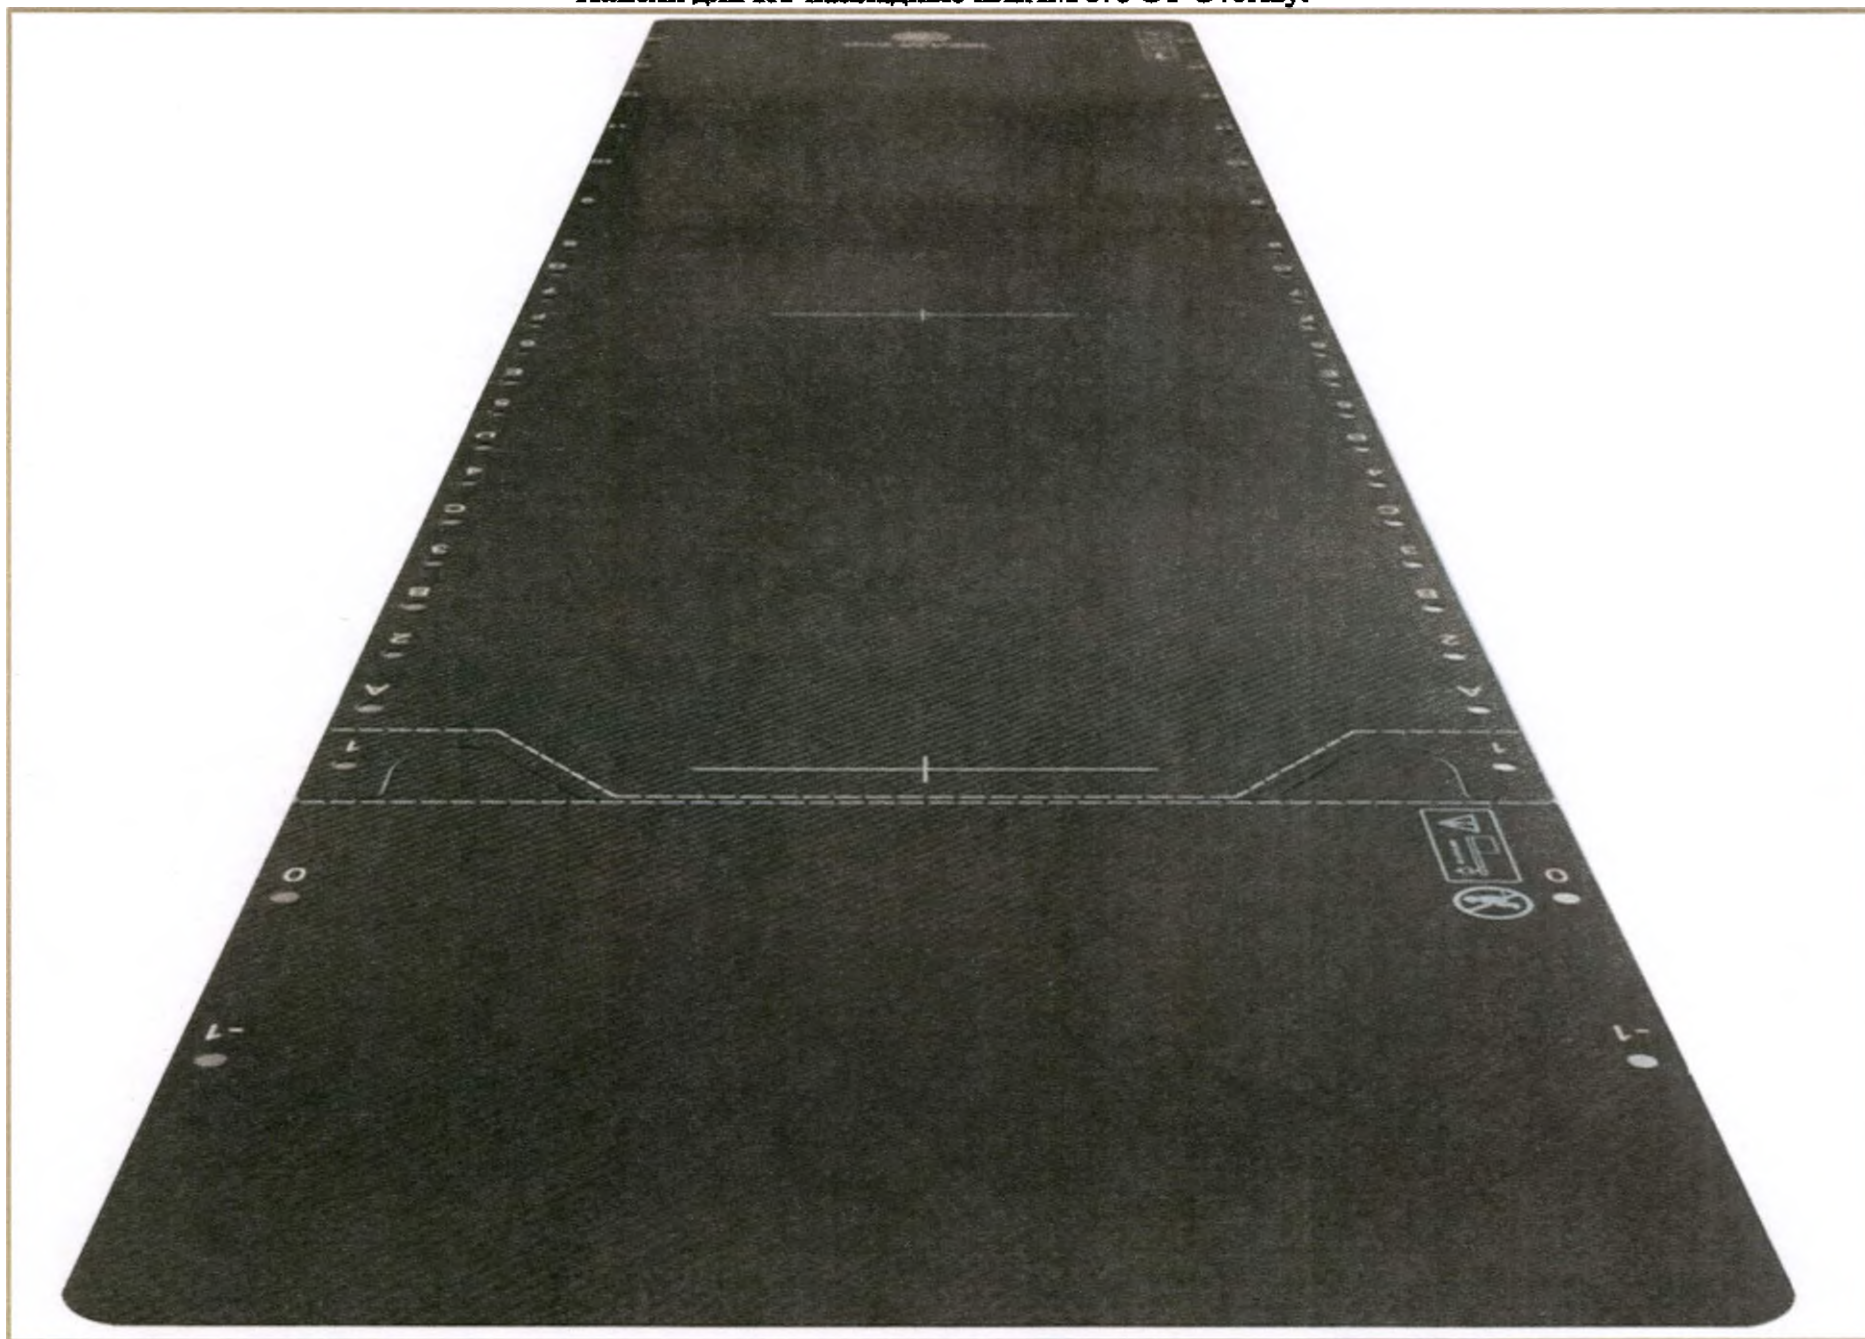

Планки разметочные Indexing Bar.

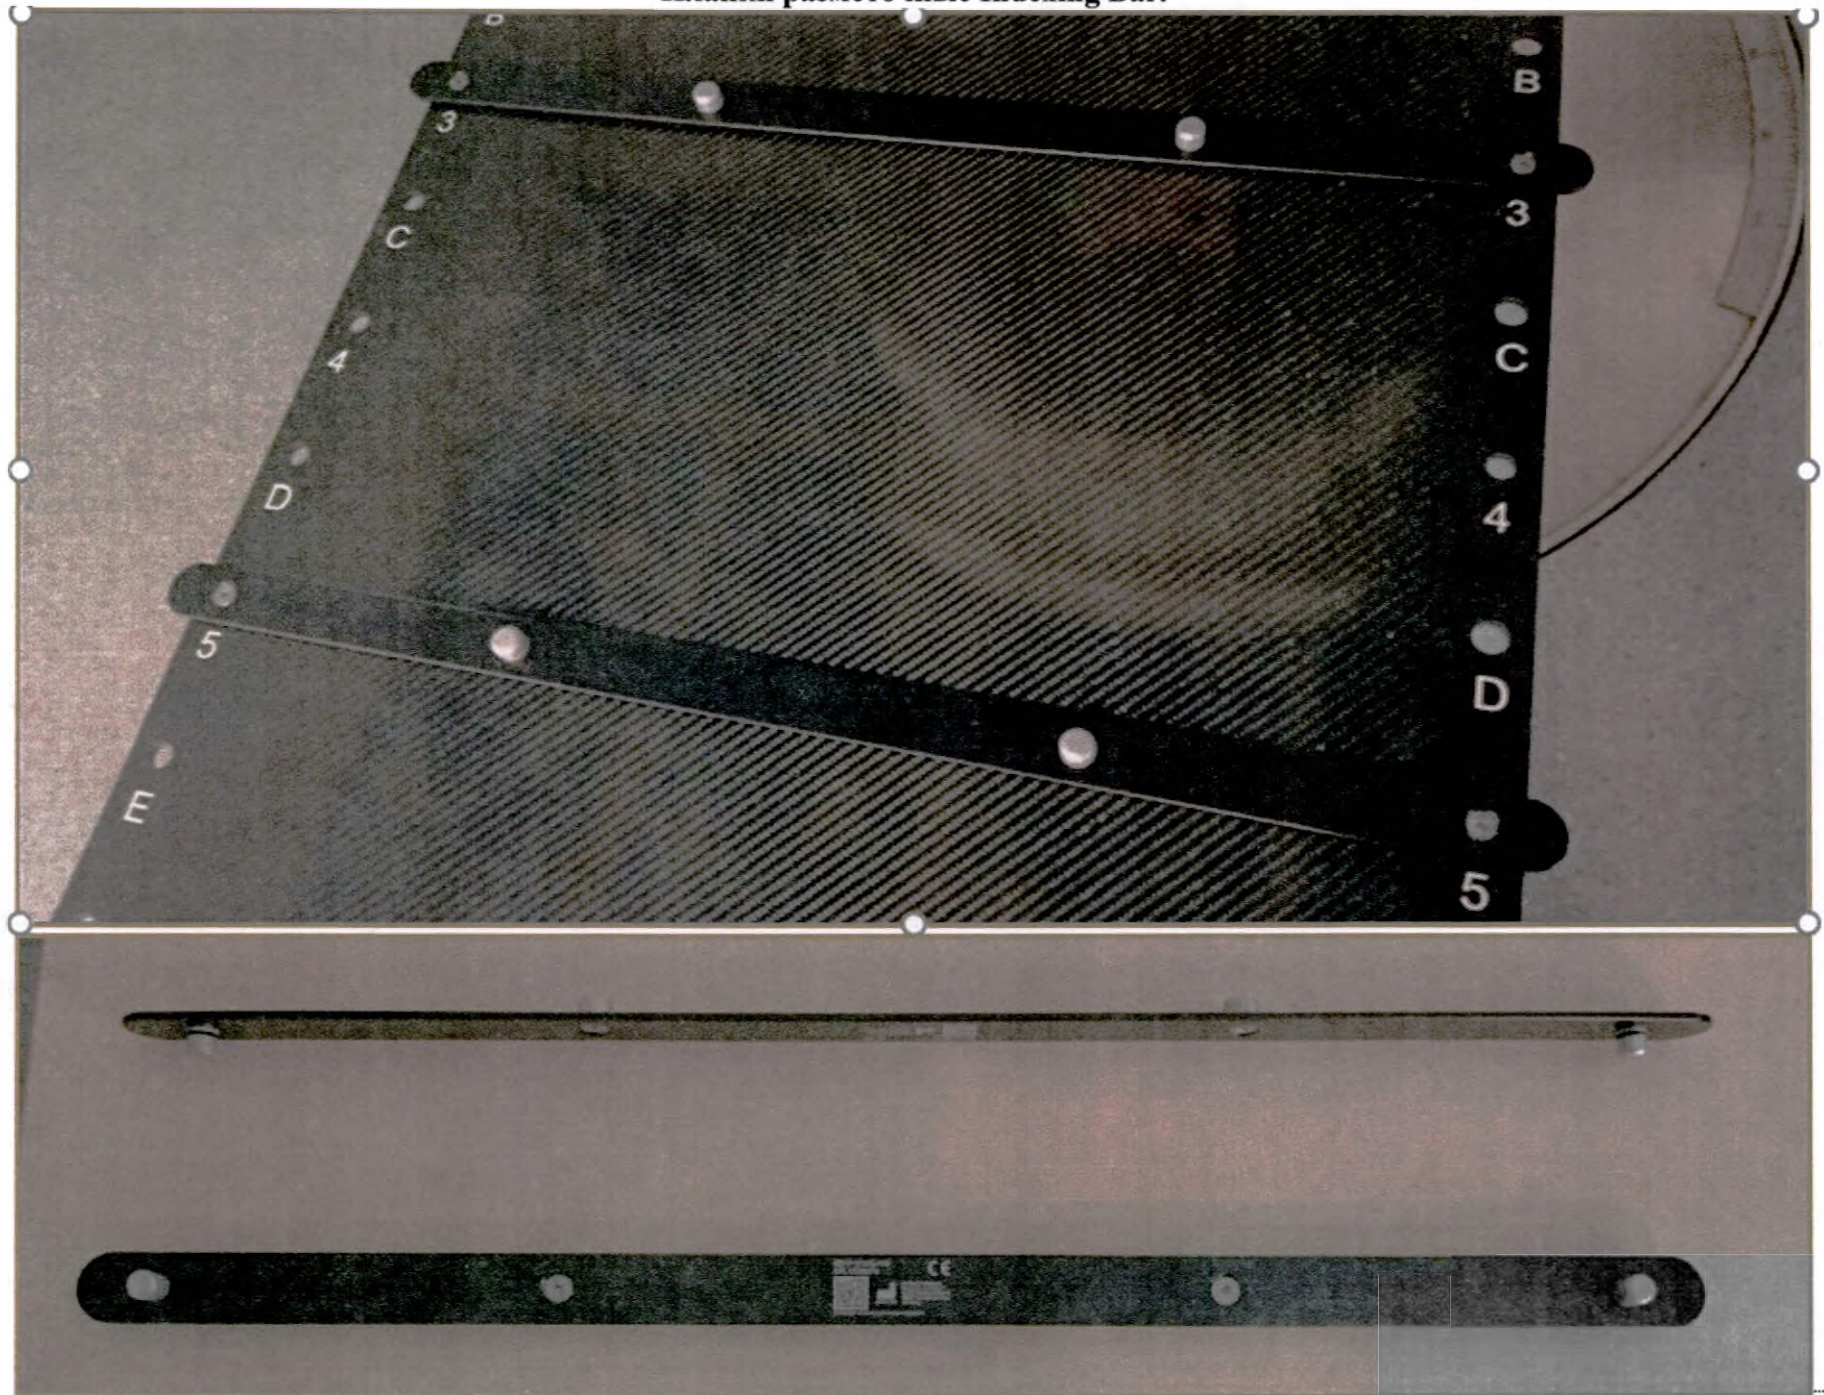

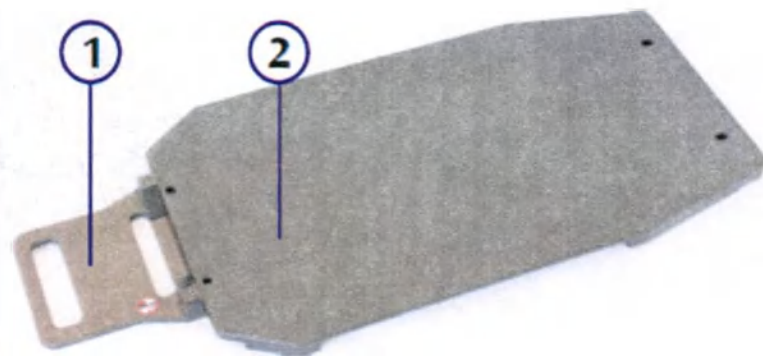


Fraxion CT Adapter




Stereotactic Adapter



Fraxion Linac Tabletop Adapter iBEAM-evo-0DoF

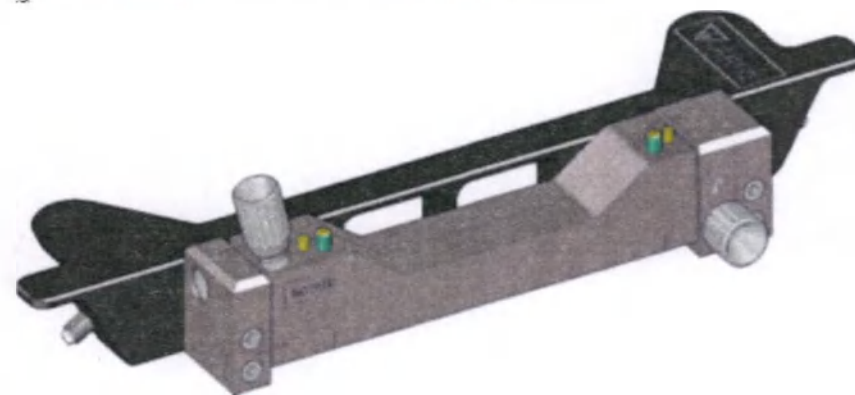

Fraxion Linac Tabletop Adapter iBEAM-evo-(2DoF)


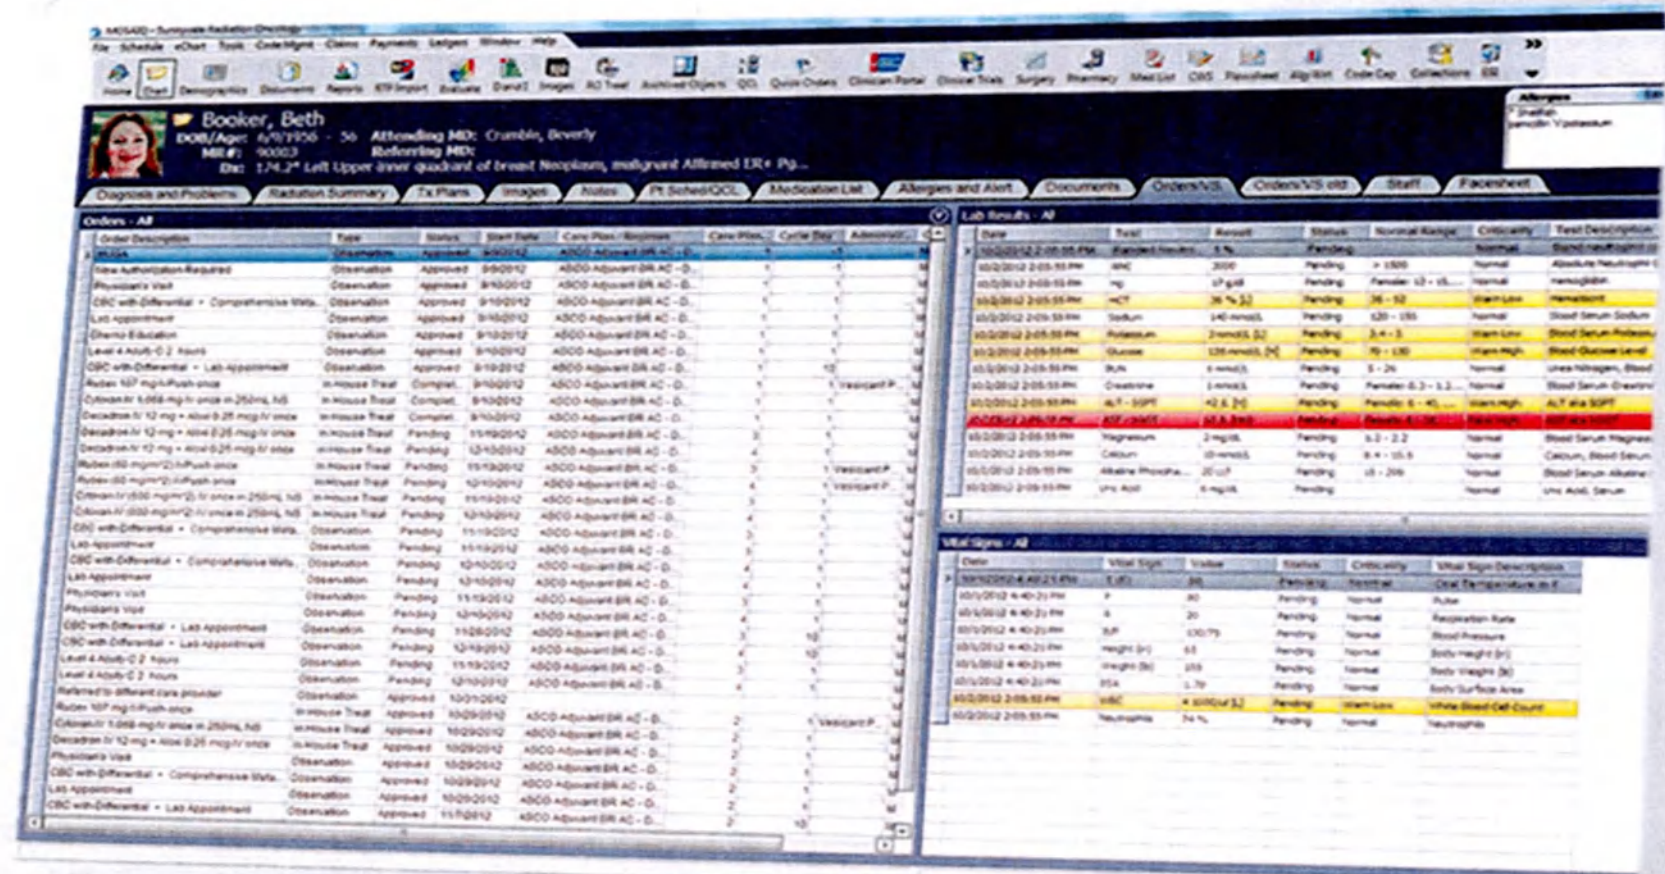


Система фиксации: BodyFIX.







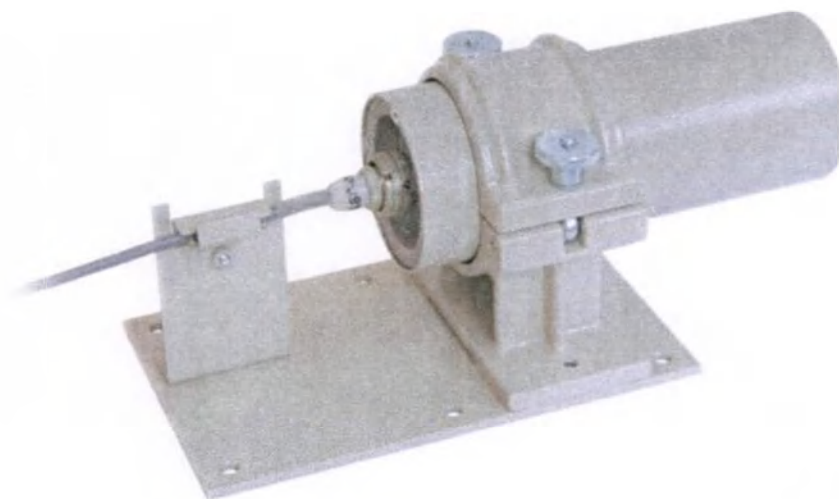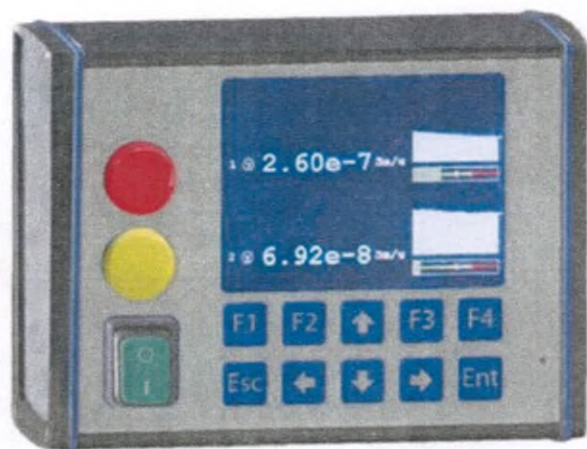

Фотографическое изображение упаковки




Маркировка

Макет русскоязычной маркировки

SN	Система стереотаксическая радиотерапевтическая Versa HD с принадлежностями	CE
Производитель	 «Электа Лимитед» Linac House, Fleming Way, Crawley, West Sussex, RH10 9RR, United Kingdom Дата производства ДД-ММ-ГГГГ	
Сведения об уполномоченном представителе	Общество с ограниченной ответственностью «Электа»; 115035, город Москва, Космодамианская набережная, дом 52 строение 4, этаж 11 пом I; +7 495 788 8045; info.ree@elekta.com	
Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2407		
Срок действия бессрочно		

Макет русскоязычной маркировки системы, произведенной на российской площадке

SN	Система стереотаксическая радиотерапевтическая Versa HD с принадлежностями
Производитель	«Электа Лимитед» Linac House, Fleming Way, Crawley, West Sussex, RH10 9RR, United Kingdom Дата производства ДД-ММ-ГГГГ
Место производства	АО «НИИТФА», Россия, 115230, Москва, Варшавское ш., д.46
Сведения об уполномоченном представителе	Общество с ограниченной ответственностью «Электа»; 115035, город Москва, Космодамианская набережная, дом 52 строение 4, этаж 11 пом I; +7 (495) 788-80-45; info@elekta.com
       	
Регистрационное удостоверение № РЗН 2015/2407	
Срок действия бессрочно	
Сделано в России	

Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 62 листов

