

Утверждаю

Генеральный директор
ООО «Компания «БиВи»
Т.А. Носова

«27» декабря 2022 г.
М.П.



Доверенность
77 АД 1754197

КУСАЙЛО Р.В.

Фотографические изображения изделия
Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический для качественного
обнаружения антигена нуклеокапсидного белка коронавируса SARS-CoV-2 в
мазке из нижнего носового входа для диагностики in vitro для
самотестирования (SARS-CoV-2 Antigen (GICA)). Партии SAR2200800,
SAR2200900

«Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd.»
(«Шэньчжэнь Лифотроник Технолоджи Ко., Лтд.»), Китай



Общий вид, Партия SAR2200900 МИ «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический для качественного обнаружения антигена нуклеокапсидного белка коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из нижнего носового входа для диагностики in vitro для самотестирования (SARS-CoV-2 Antigen (GICA)). Партии SAR2200800, SAR2200900, в варианте исполнения 1 шт./уп., мягкая упаковка»



Общий вид, Партия SAR2200800 МИ «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический для качественного обнаружения антигена нуклеокапсидного белка коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из нижнего носового входа для диагностики in vitro для самотестирования (SARS-CoV-2 Antigen (GICA)). Партии SAR2200800, SAR2200900, в варианте исполнения 1 шт./уп., мягкая упаковка»




Общий вид, Партия SAR2200900 МИ «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический для качественного обнаружения антигена нуклеокапсидного белка коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из нижнего носового входа для диагностики in vitro для самотестирования (SARS-CoV-2 Antigen (GICA)). Партии SAR2200800, SAR2200900, в варианте исполнения 1 шт./уп., твердая упаковка»



Общий вид, Партия SAR2200800 МИ «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический для качественного обнаружения антигена нуклеокапсидного белка коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из нижнего носового входа для диагностики in vitro для самотестирования (SARS-CoV-2 Antigen (GICA)). Партии SAR2200800, SAR2200900, в варианте исполнения 1 шт./уп., твердая упаковка»



Тест-картридж Партия SAR2200800 МИ «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический для качественного обнаружения антигена нуклеокапсидного белка коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из нижнего носового входа для диагностики in vitro для самотестирования (SARS-CoV-2 Antigen (GICA)). Партии SAR2200800, SAR2200900, в варианте исполнения 1 шт./уп., твердая упаковка»

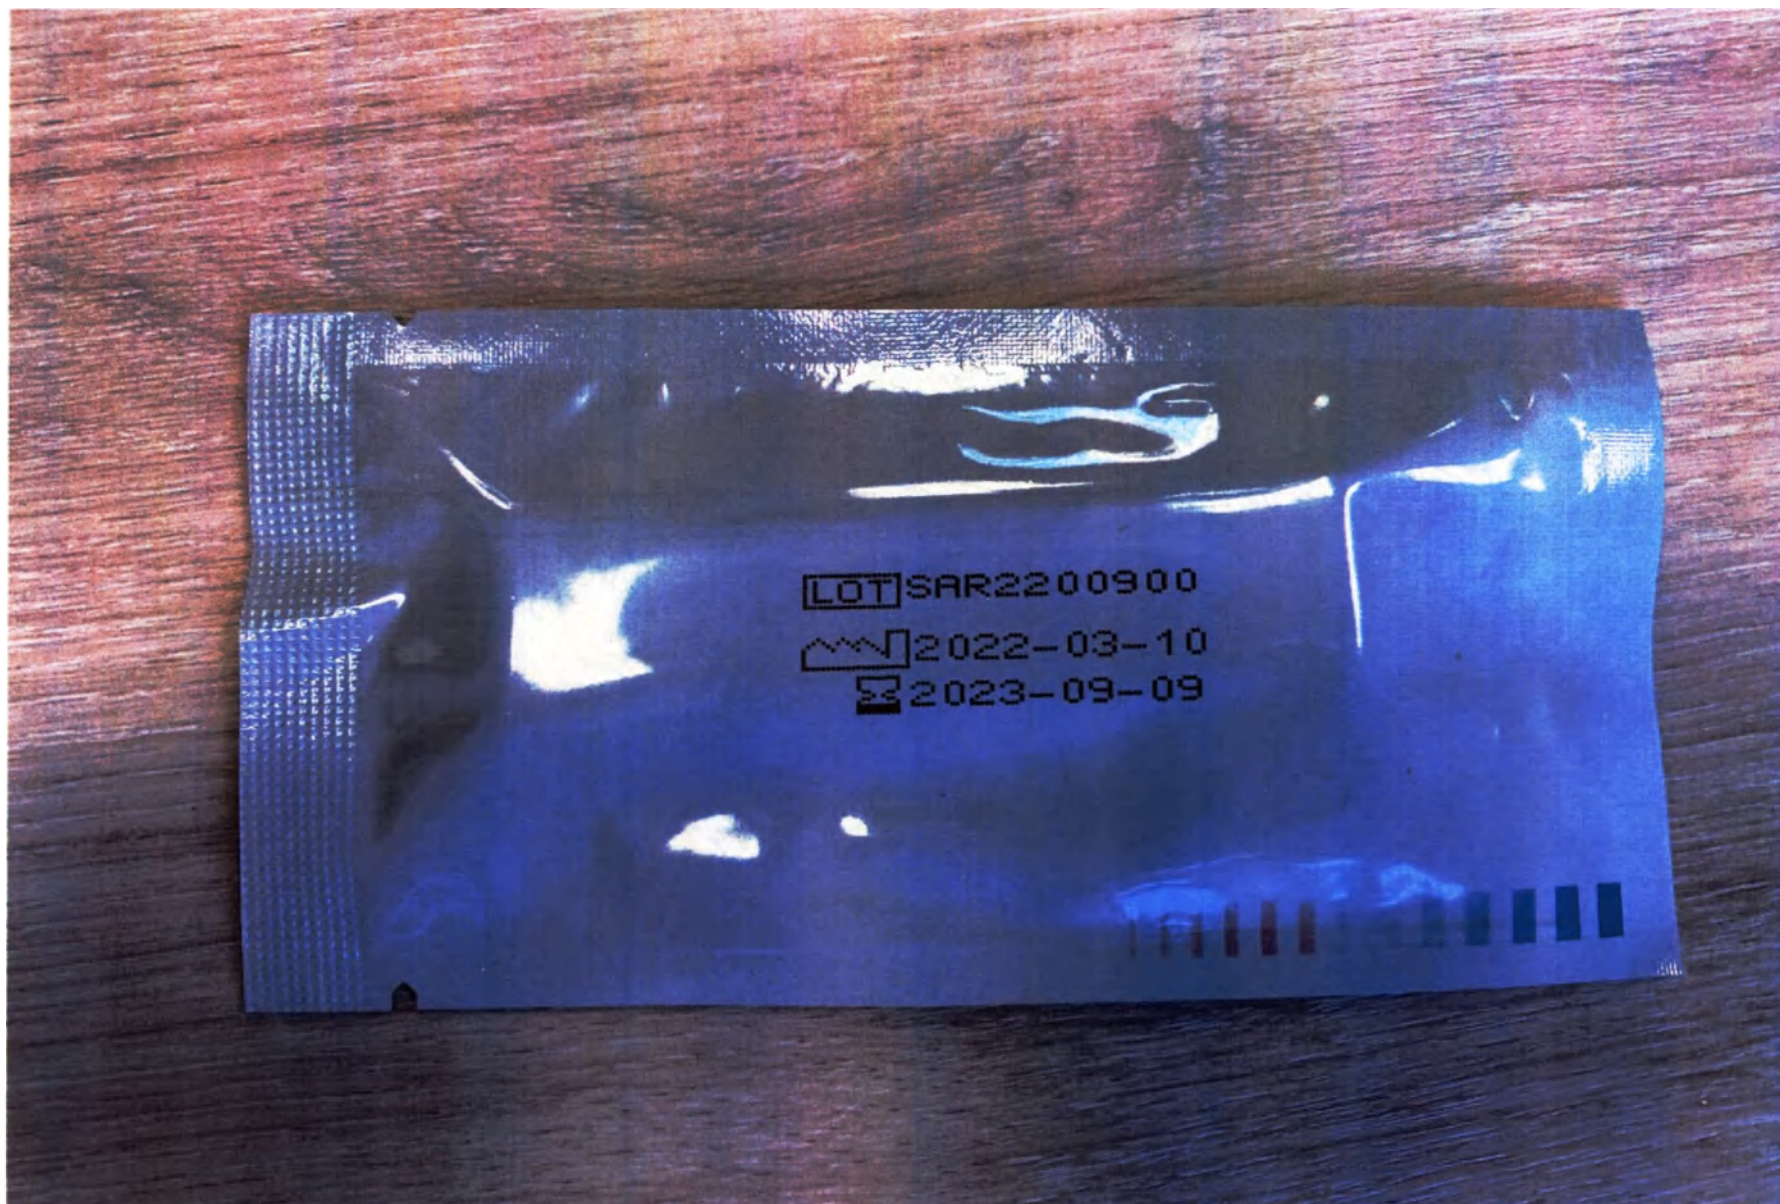

Тест-картридж Партия SAR2200900 МИ «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический для качественного обнаружения антигена нуклеокапсидного белка коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из нижнего носового входа для диагностики in vitro для самотестирования (SARS-CoV-2 Antigen (GICA)). Партии SAR2200800, SAR2200900, в варианте исполнения 1 шт./уп., мягкая упаковка»



Пробирка с реагентом



Зонд для образцов одноразовый



Общий вид, Партия SAR2200800 МИ «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический для качественного обнаружения антигена нуклеокапсидного белка коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из нижнего носового входа для диагностики in vitro для самотестирования (SARS-CoV-2 Antigen (GICA)). Партии SAR2200800, SAR2200900, в варианте исполнения 5 шт./уп., твердая упаковка»



Общий вид, Партия SAR2200900 МИ «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический для качественного обнаружения антигена нуклеокапсидного белка коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из нижнего носового входа для диагностики in vitro для самотестирования (SARS-CoV-2 Antigen (GICA)). Партии SAR2200800, SAR2200900, в варианте исполнения 5 шт./уп., твердая упаковка»



Тест-картридж Партия SAR2200800 МИ «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический для качественного обнаружения антигена нуклеокапсидного белка коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из нижнего носового входа для диагностики in vitro для самотестирования (SARS-CoV-2 Antigen (GICA)). Партии SAR2200800, SAR2200900, в варианте исполнения 5 шт./уп., твердая упаковка»



Тест-картридж Партия SAR2200900 МИ «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический для качественного обнаружения антигена нуклеокапсидного белка коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из нижнего носового входа для диагностики in vitro для самотестирования (SARS-CoV-2 Antigen (GICA)). Партии SAR2200800, SAR2200900, в варианте исполнения 5 шт./уп., твердая упаковка»



Пробирка с реагентом

← OPEN Disposable Sampling Swabs Model: AR100 CE 0197 LOT 20220328
Suzhou Shengtian Biotechnology Co., Ltd. Room 301, F3, B5, No.35 Dongfu Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, 215000 Jiangsu, P.R. China EC REP Name: MedPath GmbH Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 Munich, Germany
1. Single use only.
2. Do not use if package is damaged. 20220328 20250327

← OPEN Disposable Sampling Swabs Model: AR100 CE 0197 LOT 20220328
Suzhou Shengtian Biotechnology Co., Ltd. Room 301, F3, B5, No.35 Dongfu Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, 215000 Jiangsu, P.R. China EC REP Name: MedPath GmbH Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 Munich, Germany
1. Single use only.
2. Do not use if package is damaged. 20220328 20250327

← OPEN Disposable Sampling Swabs Model: AR100 CE 0197 LOT 20220328
Suzhou Shengtian Biotechnology Co., Ltd. Room 301, F3, B5, No.35 Dongfu Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, 215000 Jiangsu, P.R. China EC REP Name: MedPath GmbH Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 Munich, Germany
1. Single use only.
2. Do not use if package is damaged. 20220328 20250327

← OPEN Disposable Sampling Swabs Model: AR100 CE 0197 LOT 20220328
Suzhou Shengtian Biotechnology Co., Ltd. Room 301, F3, B5, No.35 Dongfu Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, 215000 Jiangsu, P.R. China EC REP Name: MedPath GmbH Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 Munich, Germany
1. Single use only.
2. Do not use if package is damaged. 20220328 20250327

← OPEN Disposable Sampling Swabs Model: AR100 CE 0197 LOT 20220328
Suzhou Shengtian Biotechnology Co., Ltd. Room 301, F3, B5, No.35 Dongfu Road, Suzhou Industrial Park, Suzhou, 215000 Jiangsu, P.R. China EC REP Name: MedPath GmbH Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 Munich, Germany
1. Single use only.
2. Do not use if package is damaged. 20220328 20250327

Зонд для образцов одноразовый



Общий вид, Партия SAR2200800 МИ «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический для качественного обнаружения антигена нуклеокапсидного белка коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из нижнего носового входа для диагностики in vitro для самотестирования (SARS-CoV-2 Antigen (GICA)). Партии SAR2200800, SAR2200900, в варианте исполнения 25 шт./уп., твердая упаковка»




Общий вид, Партия SAR2200900 МИ «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический для качественного обнаружения антигена нуклеокапсидного белка коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из нижнего носового входа для диагностики in vitro для самотестирования (SARS-CoV-2 Antigen (GICA)). Партии SAR2200800, SAR2200900, в варианте исполнения 25 шт./уп., твердая упаковка»



Пробирка с реагентом



Зонд для образцов одноразовый

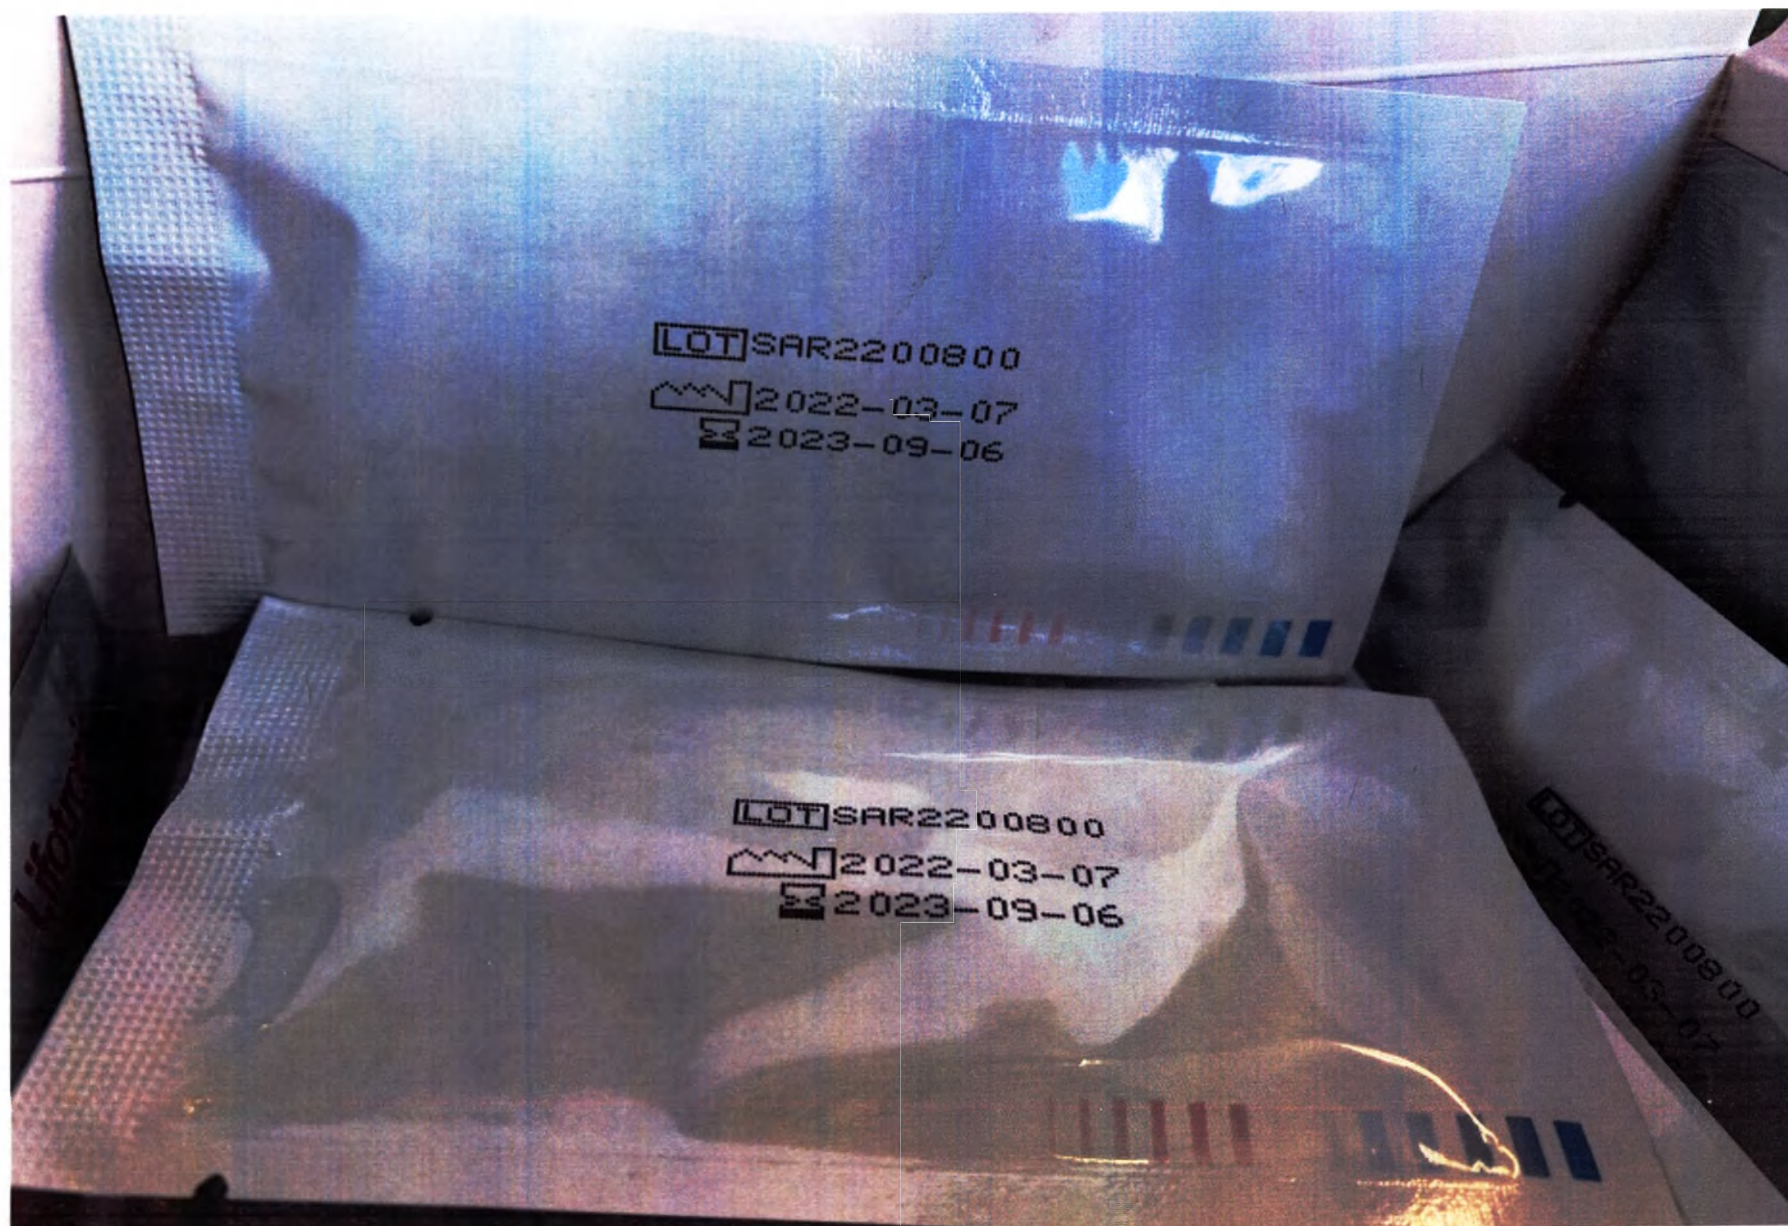

Тест-картридж Партия SAR2200800 МИ «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический для качественного обнаружения антигена нуклеокапсидного белка коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из нижнего носового входа для диагностики in vitro для самотестирования (SARS-CoV-2 Antigen (GICA)). Партии SAR2200800, SAR2200900, в варианте исполнения 25 шт./уп., твердая упаковка»



Тест-картридж Партия SAR2200900 МИ «Набор экспресс-тестирования иммунохроматографический для качественного обнаружения антигена нуклеокапсидного белка коронавируса SARS-CoV-2 в мазке из нижнего носового входа для диагностики in vitro для самотестирования (SARS-CoV-2 Antigen (GICA)). Партии SAR2200800, SAR2200900, в варианте исполнения 5 шт./уп., твердая упаковка»

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью и подписью: 21 листа (-ов)

Генеральный директор _____ / Носова Т.А
М.П.

ПО ПОВЕРЕННОСТИ
77111/1754197
АКСАНДР Р.В.

