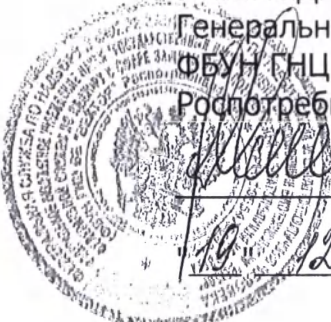


УТВЕРЖДАЮ
 Генеральный директор
 ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
 Роспотребнадзора

 Р.А. Максютов
 19/12 2022 г.

Маркировка медицинского изделия


Федеральное бюджетное учреждение науки
 «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»
 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
 благополучия человека

Набор реагентов для амплификации ДНК вирусов натуральной оспы,
 оспы обезьян, оспы коров, осповакцины
 с гибридизационно-флуоресцентной детекцией
 в режиме реального времени
 «Вектор-МПЦРрв-Оспа»
 по ТУ 9398-035-05664012-2014

Внутренняя упаковка

Этикетка на микропробирки

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора «Вектор-МПЦРрв-Оспа»	
Наименование реагента	Объем (мл)
Серия:	
Дата изготовления:	
Годен до:	
Хранить при температуре от минус 15 °С до минус 25 °С	
«Только для диагностики ин витро»	

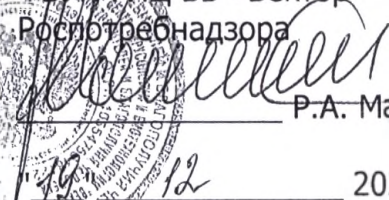УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
Роспотребнадзора

Р.А. Максютлов
12 2022 г.

Этикетка для коробки (пакета)



Федеральное бюджетное учреждение науки
«Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

630559, рабочий поселок Кольцово Новосибирской области
Тел. (383) 363-47-10, Тел./факс (383) 363-47-14

Набор реагентов для амплификации ДНК вирусов
натуральной оспы, оспы обезьян, оспы коров, осповакцины
с гибридизационно-флуоресцентной детекцией
в режиме реального времени
«Вектор-МПЦРrv-Оспа»
по ТУ 9398-035-05664012-2014

Регистрационный номер

Дата регистрации

Серия:

Дата изготовления:

Годен до:

Хранить при температуре от минус 15 °С до минус 25 °С

Транспортирование набора реагентов должно производиться при температуре от
минус 15 °С до минус 25 °С в термоконтейнере.

Допускается транспортирование при температуре от 2 °С до 8 °С
в термоконтейнере в течение не более 3 суток.

«Только для диагностики ин витро»

Состав набора:

1. Реагент-1-ПОКС, прозрачная светло-фиолетовая жидкость, 0,15 мл, 1 пробирка.
2. Реагент-2-ПОКС, прозрачная бесцветная жидкость, 0,25 мл, 1 пробирка.
3. ПКО-ВНО-ПОКС, прозрачная бесцветная жидкость, 0,1 мл, 1 пробирка.
4. ПКО-ВОО-ПОКС, прозрачная бесцветная жидкость, 0,1 мл, 1 пробирка.
5. ПКО-ВОК-ПОКС, прозрачная бесцветная жидкость, 0,1 мл, 1 пробирка.
6. ПКО-ВОВ-ПОКС, прозрачная бесцветная жидкость, 0,1 мл, 1 пробирка.
7. ОКО-ПОКС, прозрачная бесцветная жидкость, 0,1 мл, 1 пробирка.
8. Эксплуатационная документация: инструкция по применению.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
Роспотребнадзора

Р.А. Максютлов

2022 г.

Маркировка групповой упаковки
(транспортной тары)



**Федеральное бюджетное учреждение науки
«Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**630559, рабочий поселок Кольцово Новосибирской области
Тел. (383) 363-47-10, Тел./факс (383) 363-47-14**

**Набор реагентов для амплификации ДНК вирусов
натуральной оспы, оспы обезьян, оспы коров, осповакцины
с гибридизационно-флуоресцентной детекцией
в режиме реального времени
«Вектор-МПЦРrv-Оспа»
по ТУ 9398-035-05664012-2014**

Регистрационный номер

Дата регистрации

Серия:

Дата изготовления:

Годен до:

Хранить при температуре от минус 15 °С до минус 25 °С

Транспортирование набора реагентов должно производиться при температуре от
минус 15 °С до минус 25 °С в термоконтейнере.

Допускается транспортирование при температуре от 2 °С до 8 °С
в термоконтейнере в течение не более 3 суток.

«Только для диагностики ин витро»

«Хрупкое, обращаться осторожно»

«Беречь от влаги»

«Температурный диапазон»

Масса нетто _____


Масса брутто _____

Масса нетто набора _____

Количество наборов _____



В данном документе
пронумеровано и
печатью 3 листов
три листа
Зав. ОТК М.Я. Вязьминский
Должность, подпись

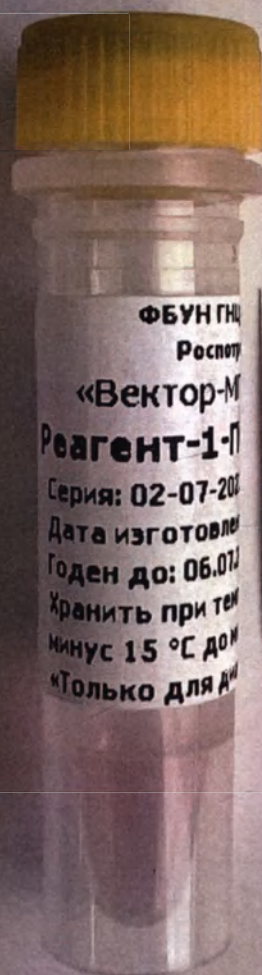


ФБУН ГНЦ
Роспотр
«Вектор-М
Реагент-1-П
Серия: 02-07-20
Дата изготовления
Годен до: 06.07
Хранить при тем
минус 15 °С до
«Только для д

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
Роспотребнадзора
«Вектор-МПЦРрв-Оспа»
Реагент-1-ПОКС 0,15 мл
Серия: 02-07-2022
Дата изготовления: 06.07.2022
Годен до: 06.07.2023
Хранить при температуре от
минус 15 °С до минус 25 °С
«Только для диагностики ин витро»



Зеленый

И. В. Тюркина

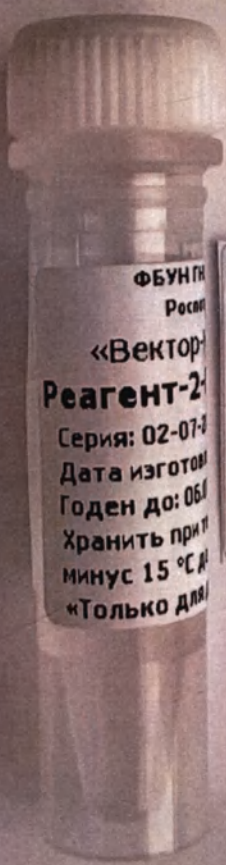


ФБУН ГНЦ
Роспотребнадзора
«Вектор-МПЦРрв-Оспа»
Реагент-2
Серия: 02-07-2022
Дата изготовления: 06.07.2022
Годен до: 06.07.2023
Хранить при температуре от
минус 15 °С до минус 25 °С
«Только для диагностики in vitro»

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
Роспотребнадзора
«Вектор-МПЦРрв-Оспа»
Реагент-2-ПОКС 0,25 мл
Серия: 02-07-2022
Дата изготовления: 06.07.2022
Годен до: 06.07.2023
Хранить при температуре от
минус 15 °С до минус 25 °С
«Только для диагностики in vitro»

*Зид Овта
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
Роспотребнадзора*



М.П. Тюрин

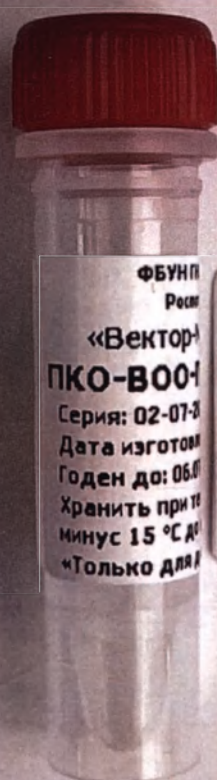


ФБУН
Роспотребнадзора
«Вектор»
ПКО-ВОО-П
Серия: 02-07-2022
Дата изготовления: 06.07.2022
Годен до: 06.07.2023
Хранить при температуре от
минус 15 °C до минус 25 °C
«Только для диагностики in vitro»

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
Роспотребнадзора
«Вектор-МПЦРрв-Оспа»
ПКО-ВОО-ПОКС 0,1 мл
Серия: 02-07-2022
Дата изготовления: 06.07.2022
Годен до: 06.07.2023
Хранить при температуре от
минус 15 °C до минус 25 °C
«Только для диагностики in vitro»



Зав. ОБТН
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
Роспотребнадзора


[Handwritten signature]

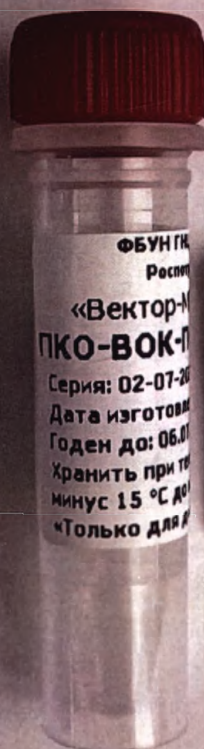

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
Роспотребнадзора
«Вектор-МПКРрв-Оспа»
ПКО-ВОК-ПКОКС 0,1 мл
Серия: 02-07-2022
Дата изготовления: 06.07.2022
Годен до: 06.07.2023
Хранить при температуре от
минус 15 °C до минус 25 °C
«Только для диагностики in vitro»



Зав. ОВТ
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
Директор
г. Москва

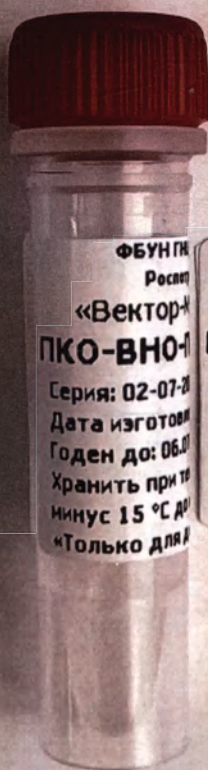


ФБУН ГНЦ
Роспотребнадзора
«Вектор»
ПКО-ВНО-П
Серия: 02-07-2022
Дата изготовления: 06.07.2022
Годен до: 06.07.2023
Хранить при температуре от
минус 15 °С до минус 25 °С
«Только для диагностики ин витро»

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
Роспотребнадзора
«Вектор-МПЦРрв-Оспа»
ПКО-ВНО-ПОКС 0,1 мл
Серия: 02-07-2022
Дата изготовления: 06.07.2022
Годен до: 06.07.2023
Хранить при температуре от
минус 15 °С до минус 25 °С
«Только для диагностики ин витро»



Зад ОБТК
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»

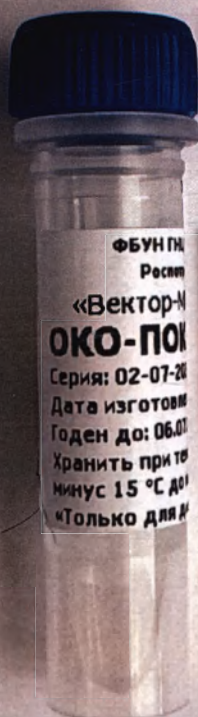


ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
Роспотребнадзора
«Вектор-МПЦРрв-Оспа»
ОКО-ПОКС 0,1 мл
Серия: 02-07-2022
Дата изготовления: 06.07.2022
Годен до: 06.07.2023
Хранить при температуре от
минус 15 °C до минус 25 °C
«Только для диагностики in vitro»



*Инс ОБТК
ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
Москва*

Вектор-МПЦРрв-Оспа



Ид с/м Формы №1 В.Вектор, 1/1 М.В.Вектор

Состав набора:

1. Реагент-1-ПОКС, прозрачная светло-фиолетовая жидкость, 0,15 мл, 1 пробирка.
2. Реагент-2-ПОКС, прозрачная бесцветная жидкость, 0,25 мл, 1 пробирка.
3. ПКО-ВНО-ПОКС, прозрачная бесцветная жидкость, 0,1 мл, 1 пробирка.
4. ПКО-ВОО-ПОКС, прозрачная бесцветная жидкость, 0,1 мл, 1 пробирка.
5. ПКО-ВОК-ПОКС, прозрачная бесцветная жидкость, 0,1 мл, 1 пробирка.
6. ПКО-ВОВ-ПОКС, прозрачная бесцветная жидкость, 0,1 мл, 1 пробирка.
7. ОКО-ПОКС, прозрачная бесцветная жидкость, 0,1 мл, 1 пробирка.
8. Эксплуатационная документация: инструкция по применению.



Лакснотов
2022 г.

ЦИНЫ



Федеральное бюджетное учреждение науки
«Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

630559, рабочий посёлок Кольцово Новосибирской области
Тел. (383) 363-47-10, Тел./факс (383) 363-47-14

Набор реагентов для амплификации ДНК вирусов
натуральной оспы, оспы обезьян, оспы коров, осповакцины
с гибридационно-флуоресцентной детекцией
в режиме реального времени

«Вектор-МПЦРрв-Оспа»

по ТУ 9398-035-05664012-2014

№ РЗН 2016/3685 от 02.06.2017

Срок: 01-07-2022

Дата изготовления: 04.07.2022

Годен до: 04.07.2023

Хранить при температуре от минус 15 °С до минус 25 °С

Транспортирование набора реагентов должно производиться при температуре от
минус 15 °С до минус 25 °С в термоконтейнере.

Допускается транспортирование при температуре от 2 °С до 8 °С
в термоконтейнере в течение не более 3 суток.

«Только для диагностики in vitro»

«Вектор-МПЦРрв-Оспа»

по ТУ 9398-035-05664012-2014

Состав набора:

1. Реагент-1-ПОКС, прозрачная светло-фиолетовая
жидкость, 0,15 мл, 1 пробирка.
2. Реагент-2-ПОКС, прозрачная бесцветная жидкость,
0,25 мл, 1 пробирка.
3. ПКО-ВНО-ПОКС, прозрачная бесцветная жидкость,
0,1 мл, 1 пробирка.
4. ПКО-ВОО-ПОКС, прозрачная бесцветная жидкость,
0,1 мл, 1 пробирка.
5. ПКО-ВОК-ПОКС, прозрачная бесцветная жидкость,
0,1 мл, 1 пробирка.
6. ПКО-ВОВ-ПОКС, прозрачная бесцветная жидкость,
0,1 мл, 1 пробирка.
7. ОКО-ПОКС, прозрачная бесцветная жидкость,
0,1 мл, 1 пробирка.
8. Эксплуатационная документация:
инструкция по применению.



Зав. ОТК ФБУН НИИ ВБ-Вектор
Роспотребнадзор

С.И. [подпись]

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»

Роспотребнадзора



Р.А. Максютов

«19» декабря 2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов для амплификации
ДНК вирусов натуральной оспы, оспы обезьян, оспы коров, осповакцины
с гибридизационно-флуоресцентной детекцией
в режиме реального времени
(«Вектор- МПЦРв-Оспа»)
по ТУ 9398-035-05664012-2014

Вектор- МПЦРв-Оспа страница 1 из 11



Зав. отдела ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»
Роспотребнадзора



В данном документе
прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 12 листов
двенадцать листов
прописью
Зав. ОТК Г. М. П. Богданова
должность, подпись